

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«28» июля

2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАНЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина
электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на
анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence
Immunoassay)/PCT)**


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)

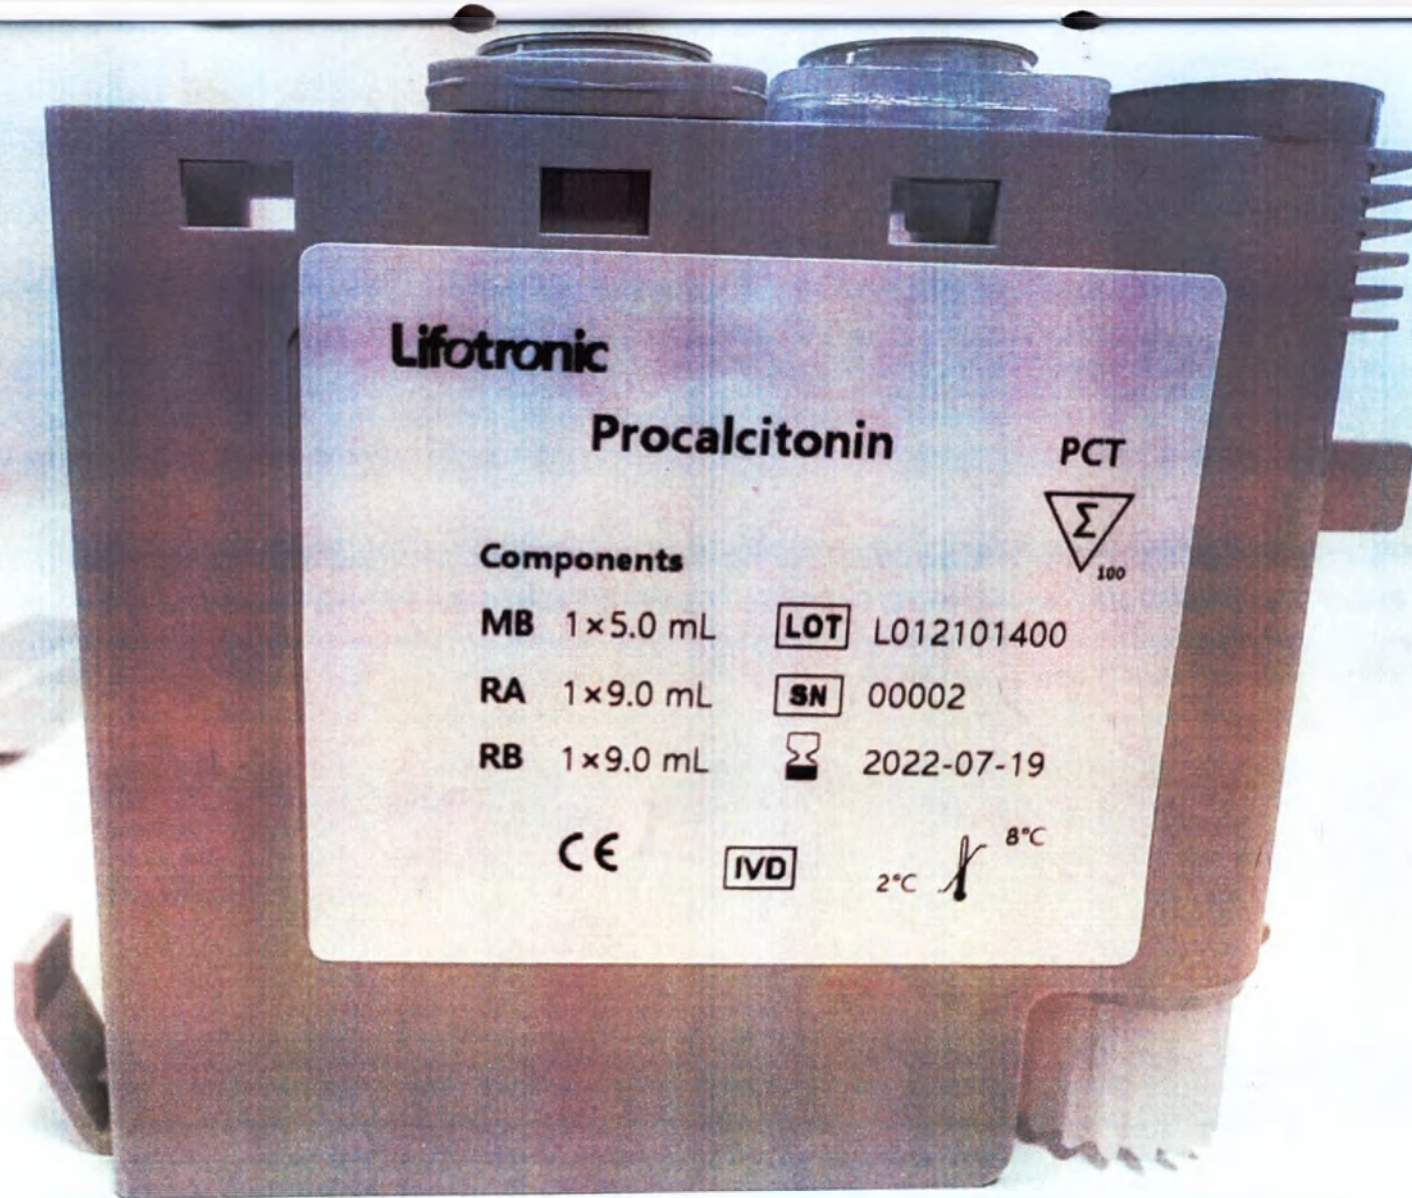

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови

направлена на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)

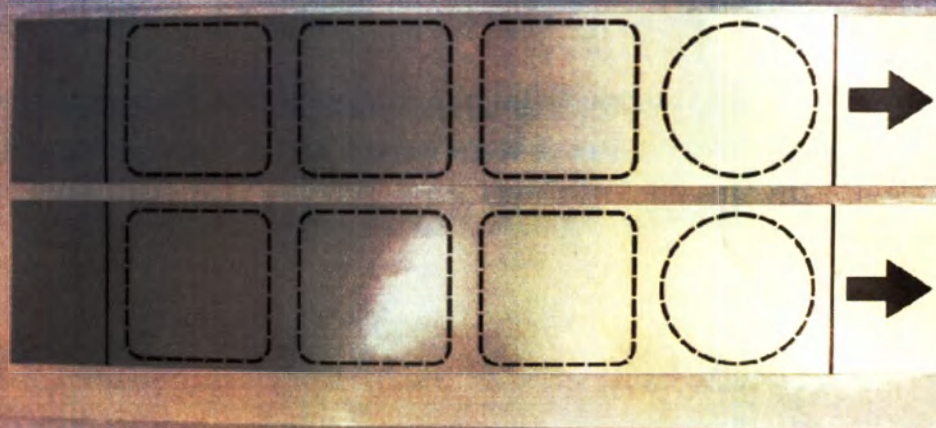

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Procalcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/PCT)

PCT Control Material RFID

LOT L012101400  2022-07-19

QC Range (Low): 0.327-0.867 ng/mL

QC Range (High): 7.070-13.130 ng/mL

Lifotronic

Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЯЛО Р. В.

