



«УТВЕРЖДАЮ»

Представитель

ООО «ХИЛЛ-РОМ РУС»

Е.Д. Владимирова

«29» сентября 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская функциональная Hill-Rom® 900 Accella™
в вариантах исполнения

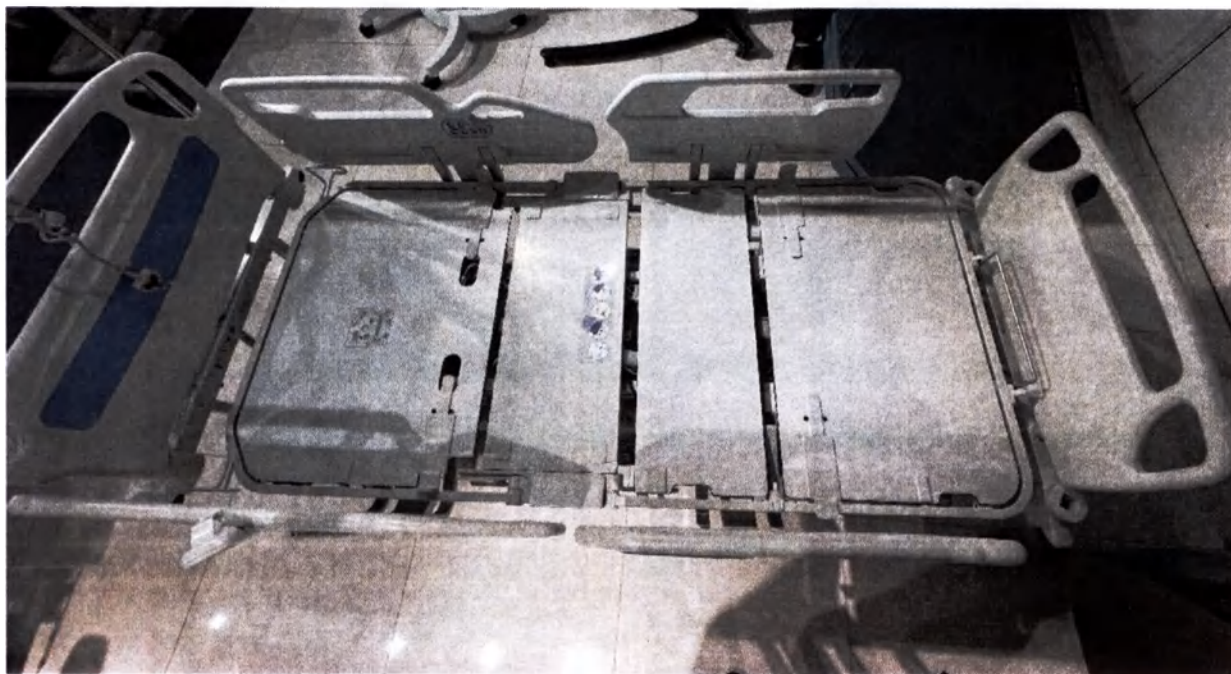


Фото 1 Ложе кровати четырех секционное – 1 шт.



Фото 2 Индикатор угла наклона спинной секции – 1 шт.



Фото 3 Индикатор угла наклона положения Тренделенбург / обратный Тренделенбург – 1 шт.



Фото 4 Встроенная система взвешивания пациента – 1шт.



Фото 5 Боковые ограждения верхние - 2 шт.



Фото 6 Боковые ограждения нижние - 2 шт.



Фото 7 Панель кнопочная - для управления функциями кровати (для медперсонала), встроенная в верхние боковые ограждения - 2 шт.



Фото 8 Панель кнопочная - для управления функциями кровати (для пациента),
встроенная в верхние боковые ограждения - 1 шт.

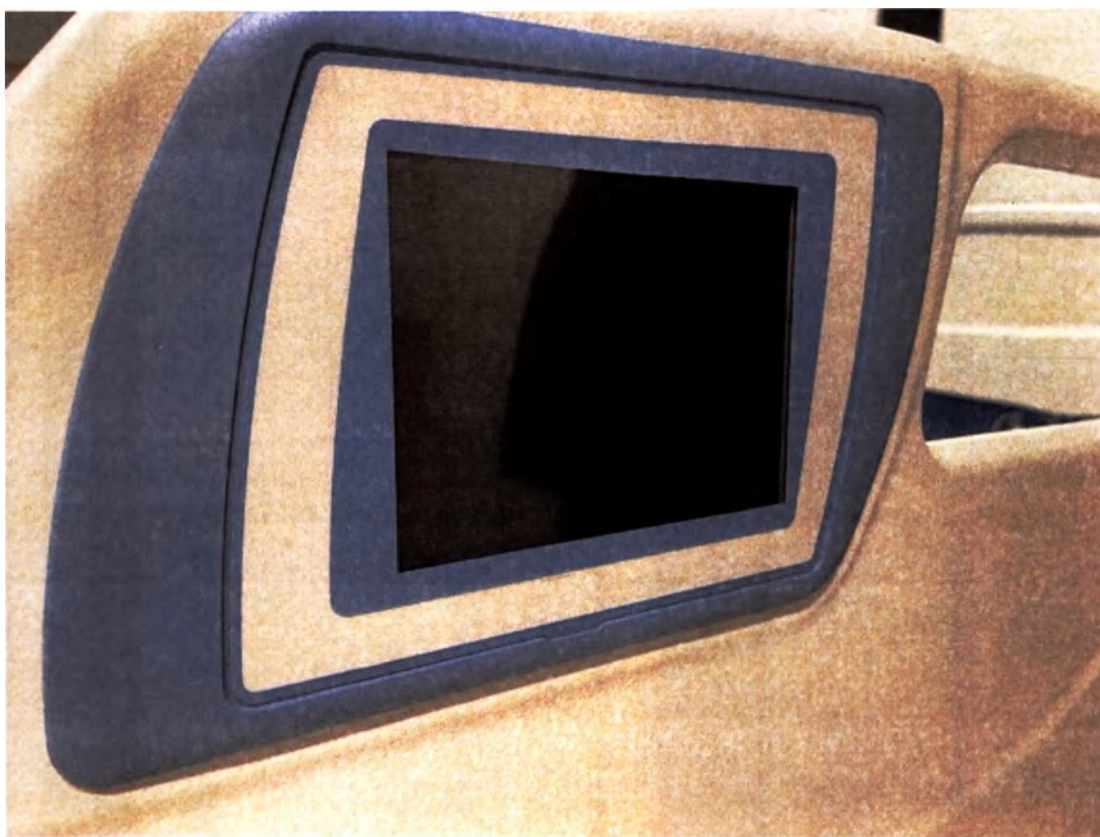


Фото 9 Панель сенсорная – для управления функциями кровати (для медперсонала),
встроенная в нижнее боковое ограждение (по необходимости) – 1 шт.



Фото 10 Матрас пенополиуретановый, перераспределяющий давление (при необходимости) – 1 шт.



Фото 11 Матрас терапевтический с воздушным компрессором (при необходимости) – 1 шт.

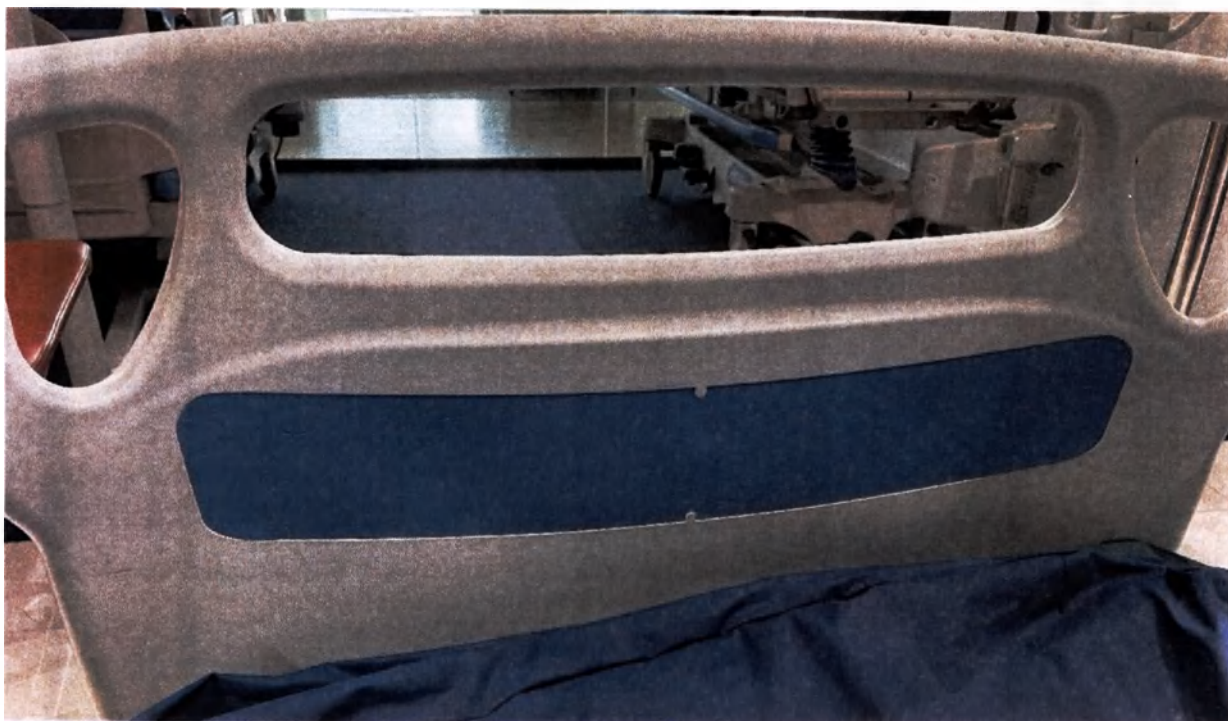


Фото 12 Спинка съемная головного конца – 1 шт.



Фото 13 Спинка съемная ножного конца – 1 шт.

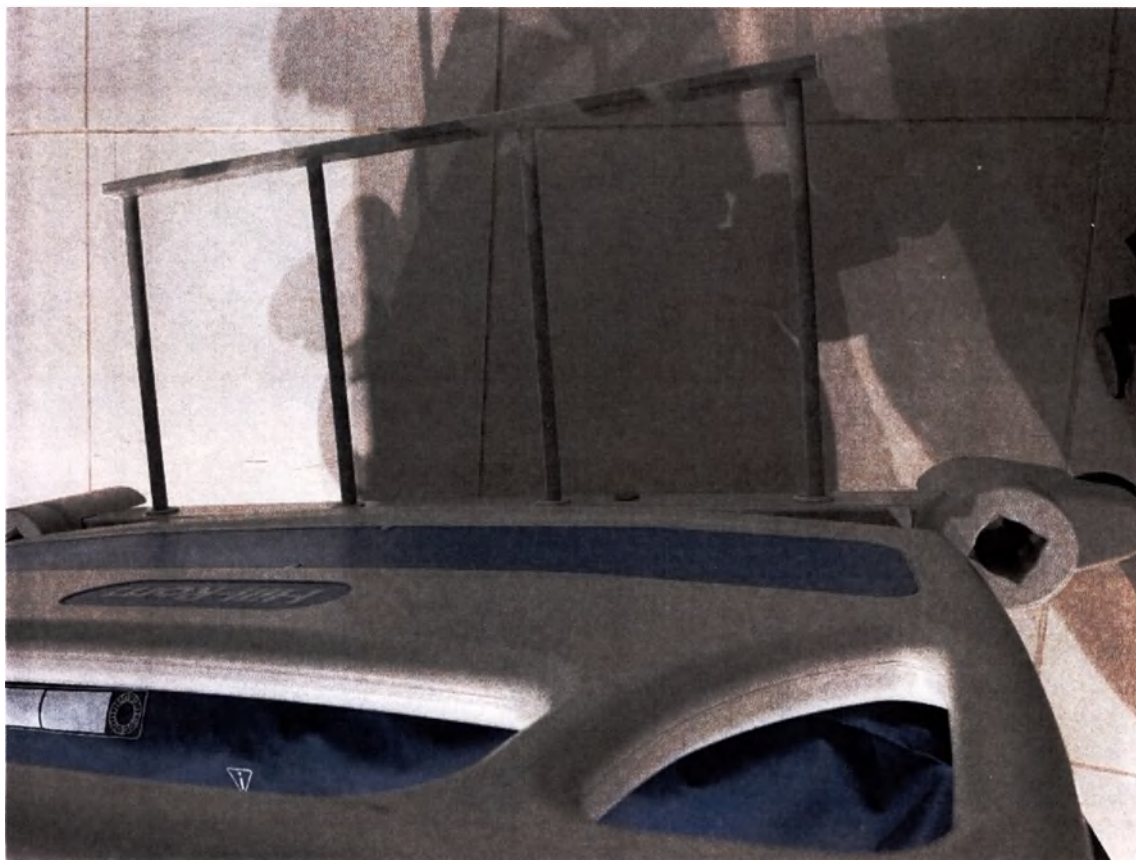


Фото 14 Удлинитель ложа, встроенный с держателем сменного белья (при необходимости) – 1 шт

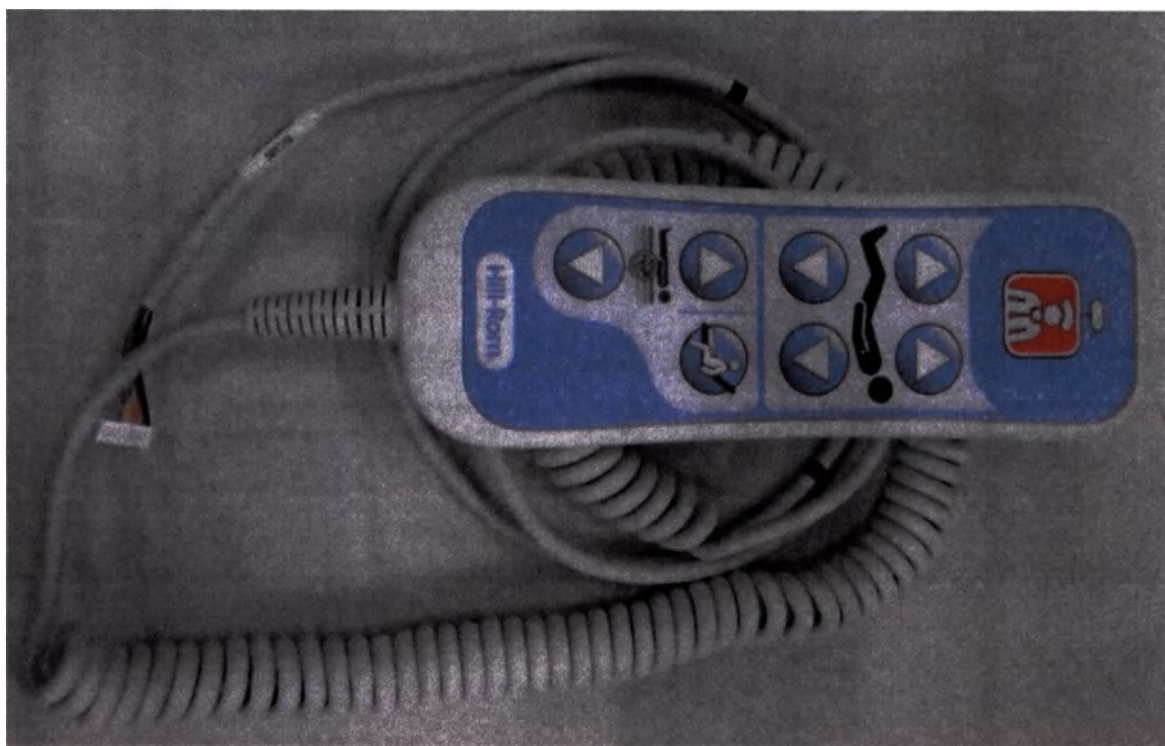


Фото 15 Пульт управления на проводе (при необходимости) – 1 шт.



Фото 16 Комплект оборудования для рентгенографии (при необходимости) – 1 шт.

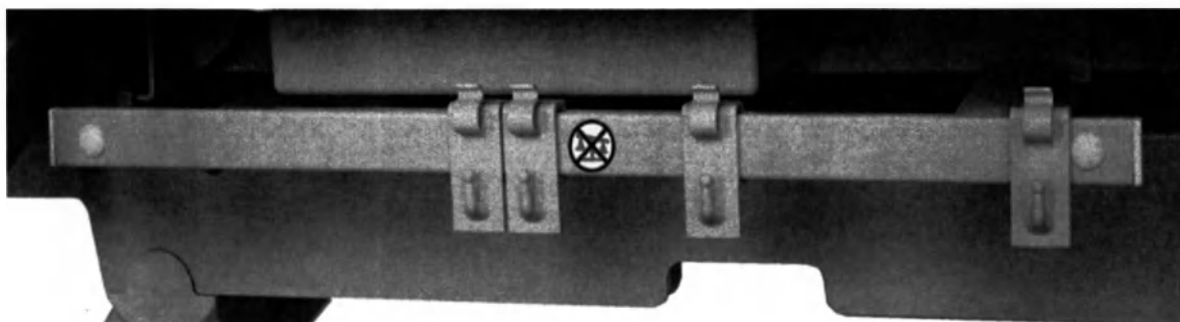


Фото 17 Держатели принадлежностей – 2 шт.

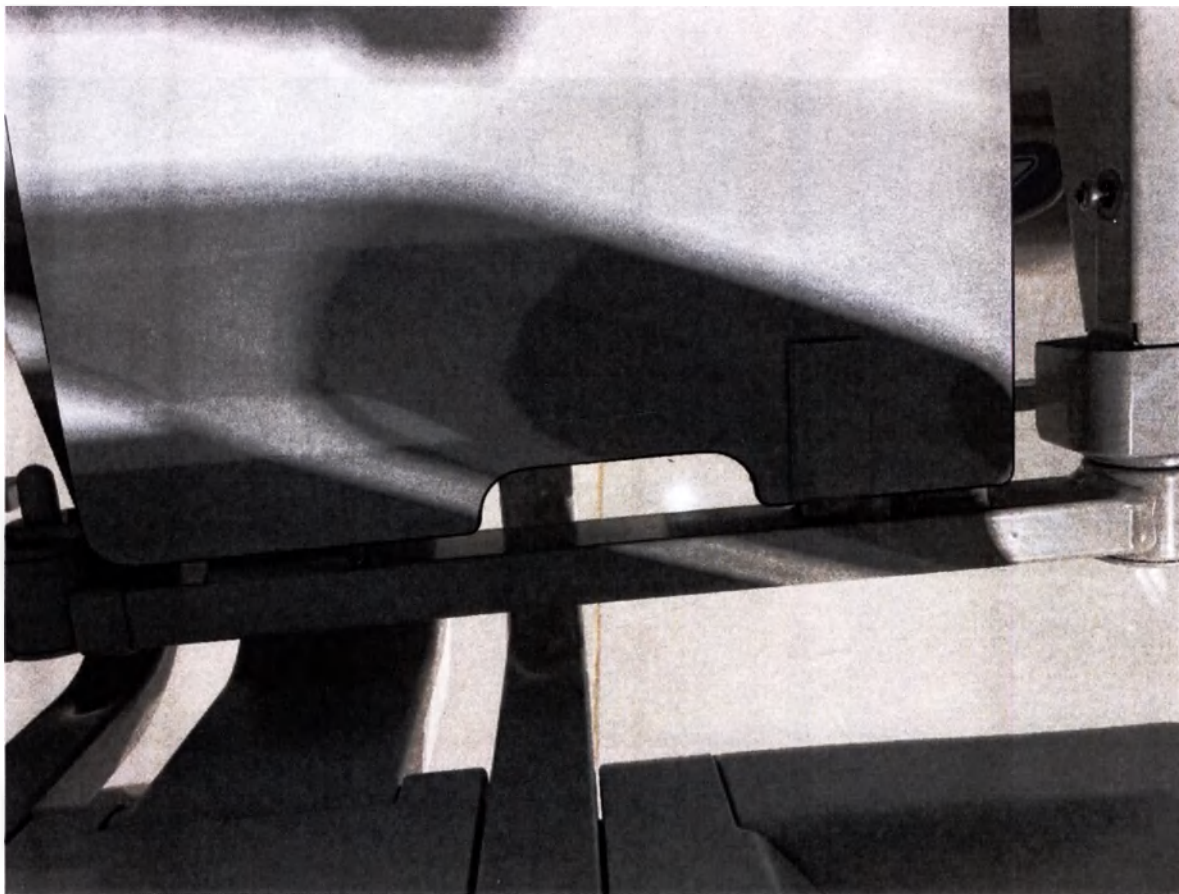


Фото 18 Держатели ограничительных ремней – 6 шт.

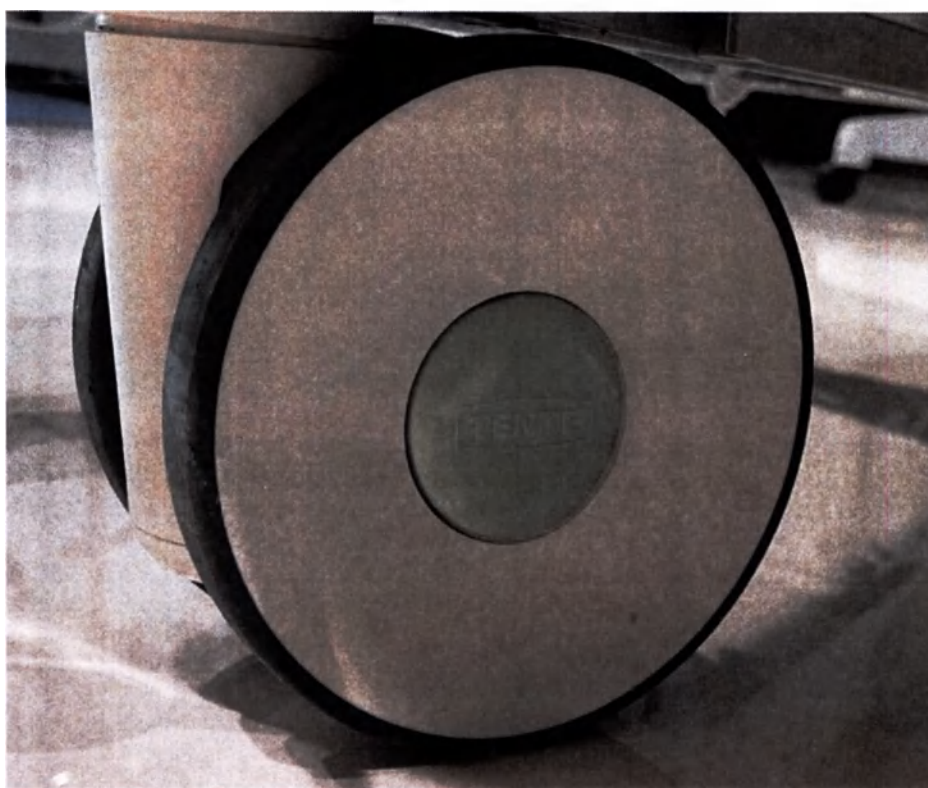


Фото 19 Колеса диаметром 150 мм – 4 шт.



Фото 20 Колеса диаметром 125 мм



Фото 21 Рулевое колесо пятое – 4 шт.

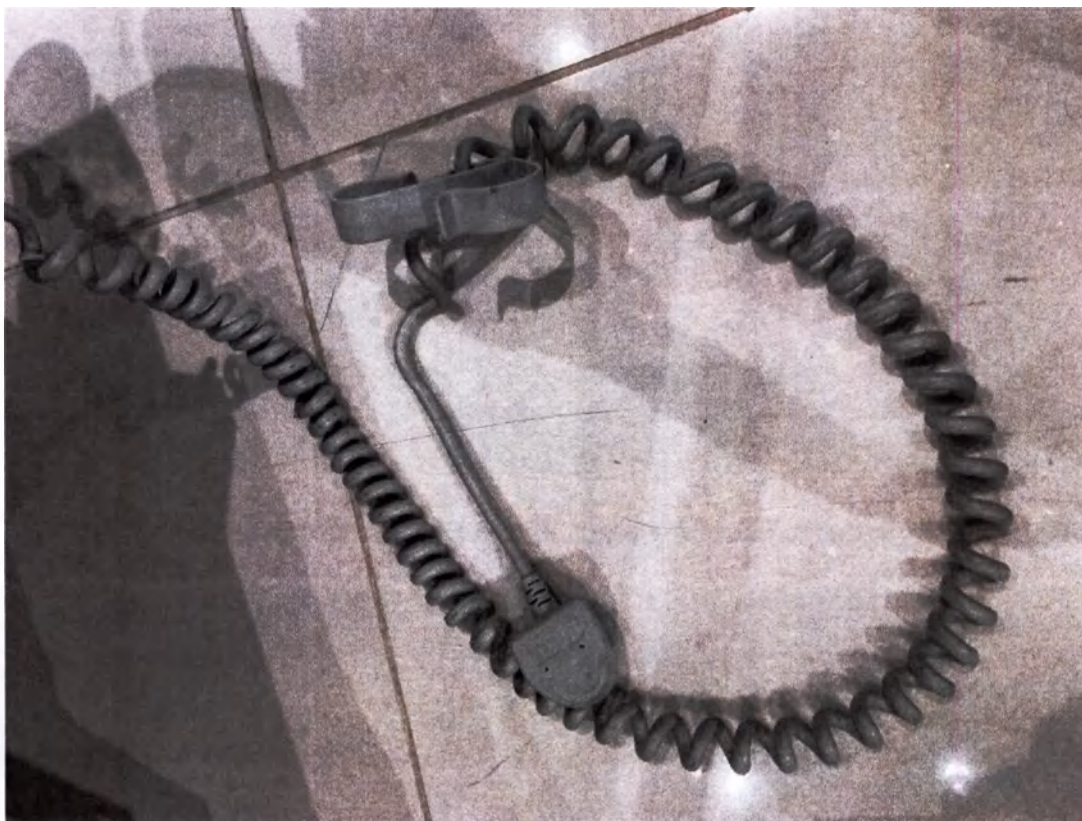


Фото 22 Кабель питания – 1 шт.



Фото 23 Педаль для управления функцией регулировки высоты ложа (при необходимости) – 2 шт.

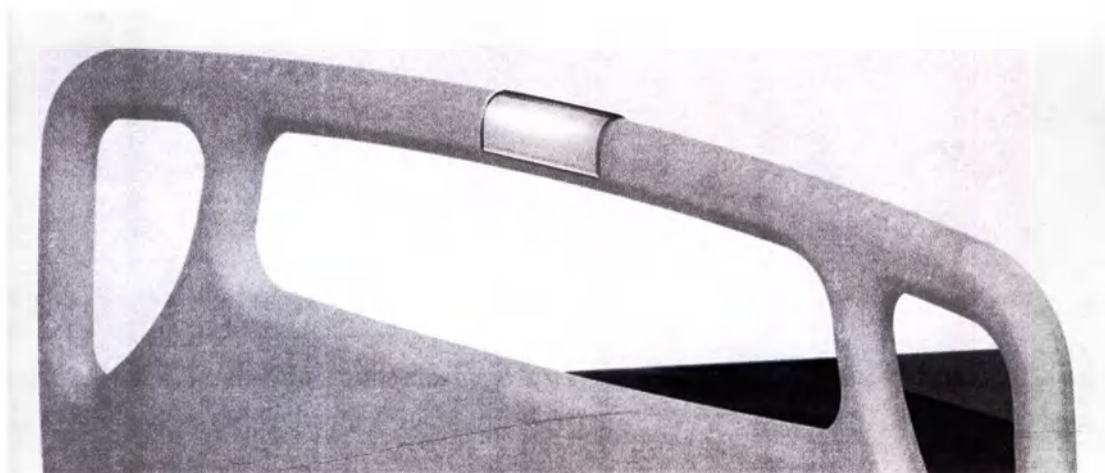


Фото 24 Табличка-держатель для имени пациента (при необходимости) – 1 шт.

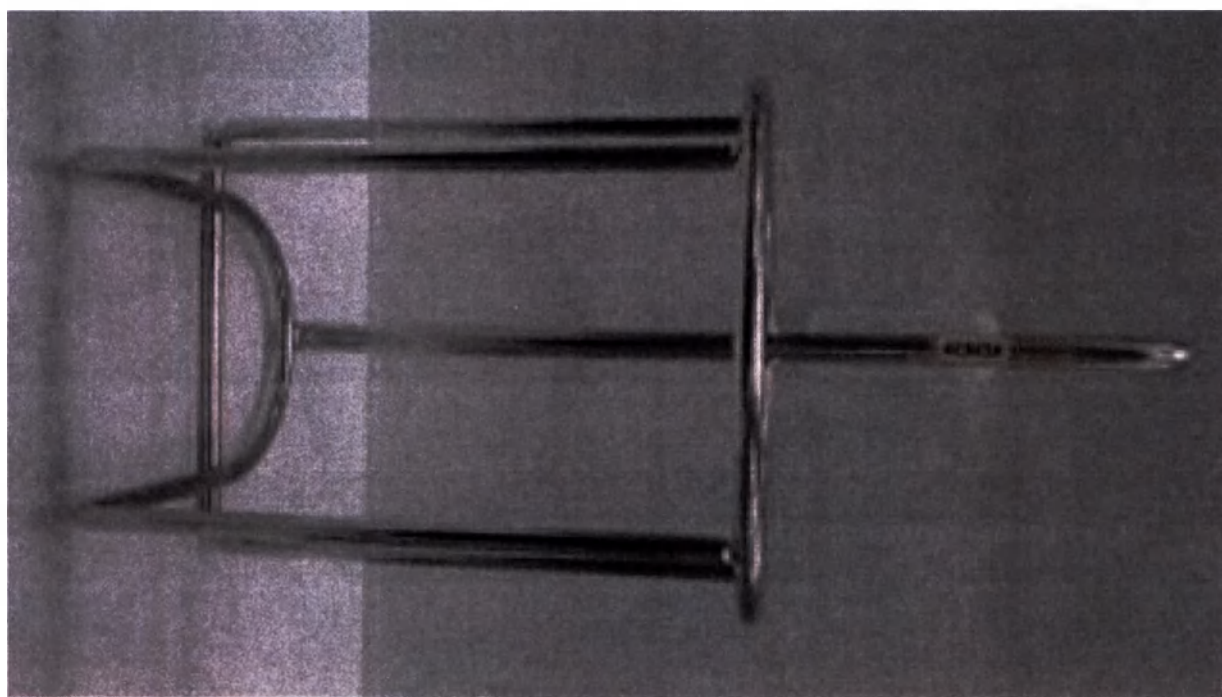


Фото 25 Вращающийся держатель для бутылей (при необходимости) – 1 шт.

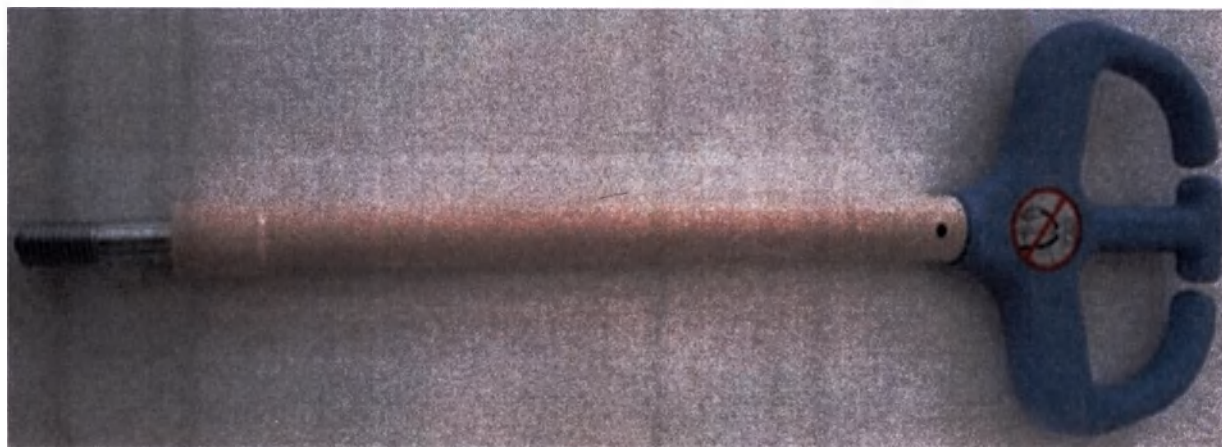


Фото 26 Направляющий-держатель сервисных трубопроводов жизнеобеспечения (при необходимости) – 1 шт.

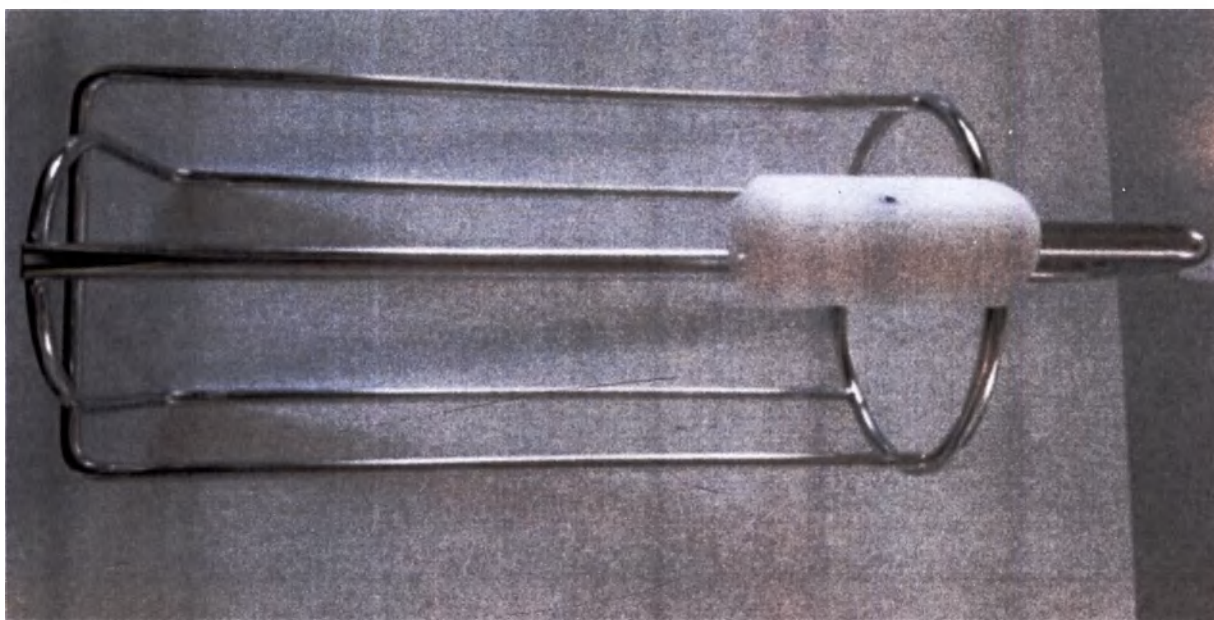


Фото 27 Держатель кислородного баллона (при необходимости) – 1 шт.

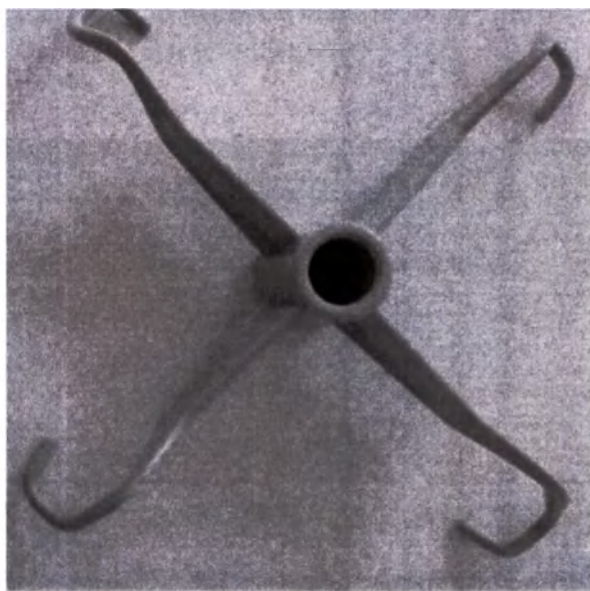


Фото 28, 29 Стойка для внутривенных вливаний фиксированной высоты (при необходимости) – 1 шт.



Фото 30 Стойка для внутривенных вливаний с регулируемой высотой (при необходимости) – 1 шт.



Фото 31 Г-образная стойка для помощи пациенту при подъеме с ручьяткой (при необходимости) – 1 шт.

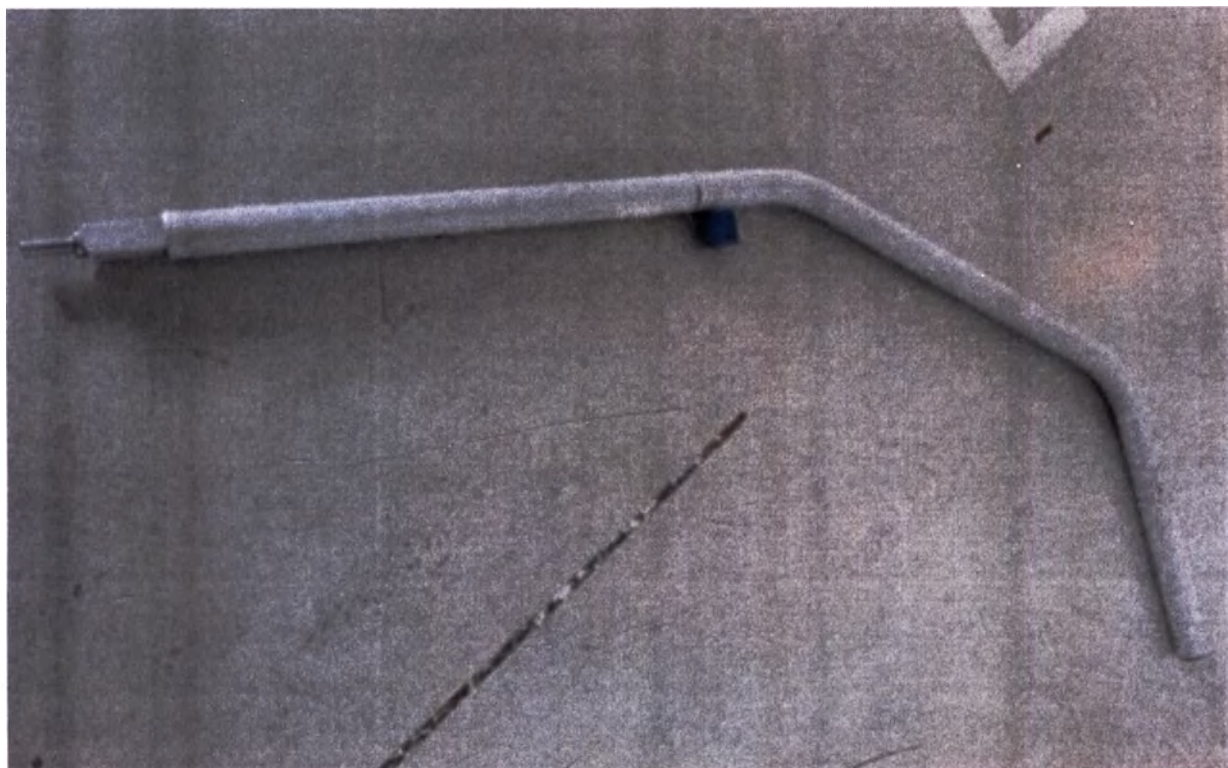


Фото 32 Г-образная стойка для помощи пациенту при подъеме с регулировкой угла продольного положения с Рукояткой – захватом для пациента на ремне к Г-образной стойке (при необходимости)– 1шт.



Фото 33 Ограждение бокового пространства ножной части ложа (при необходимости) – 2 шт.

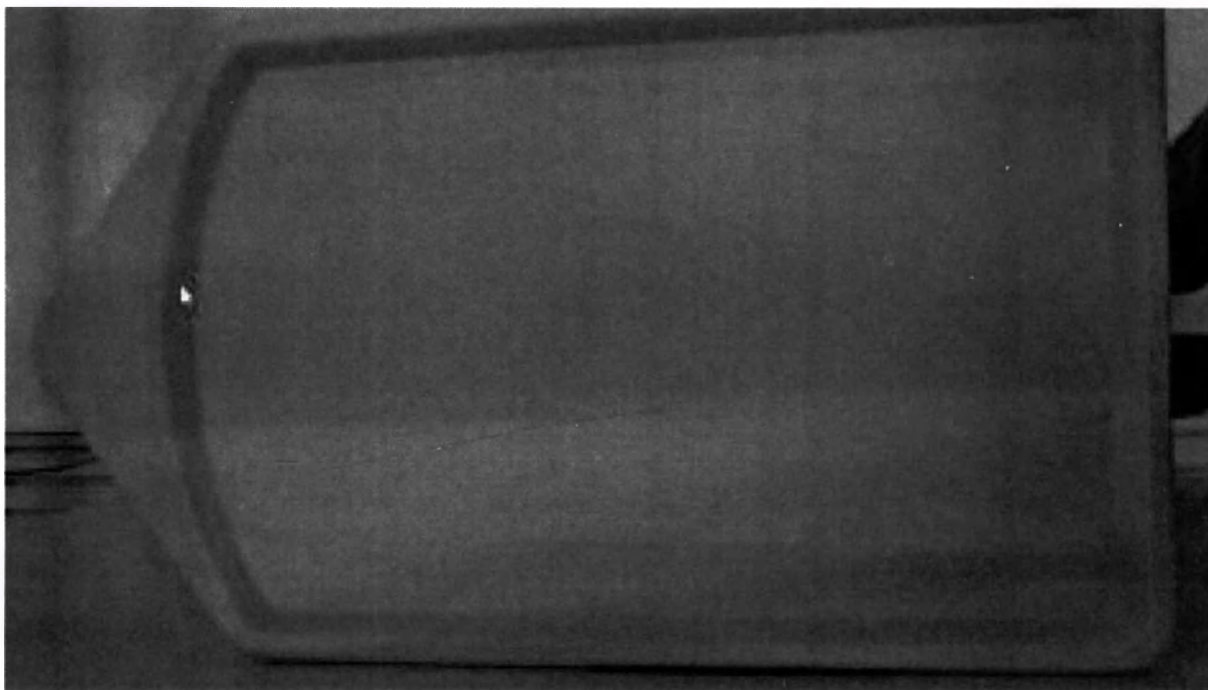


Фото 34 Лоток для процедурных принадлежностей (при необходимости) – 1 шт.

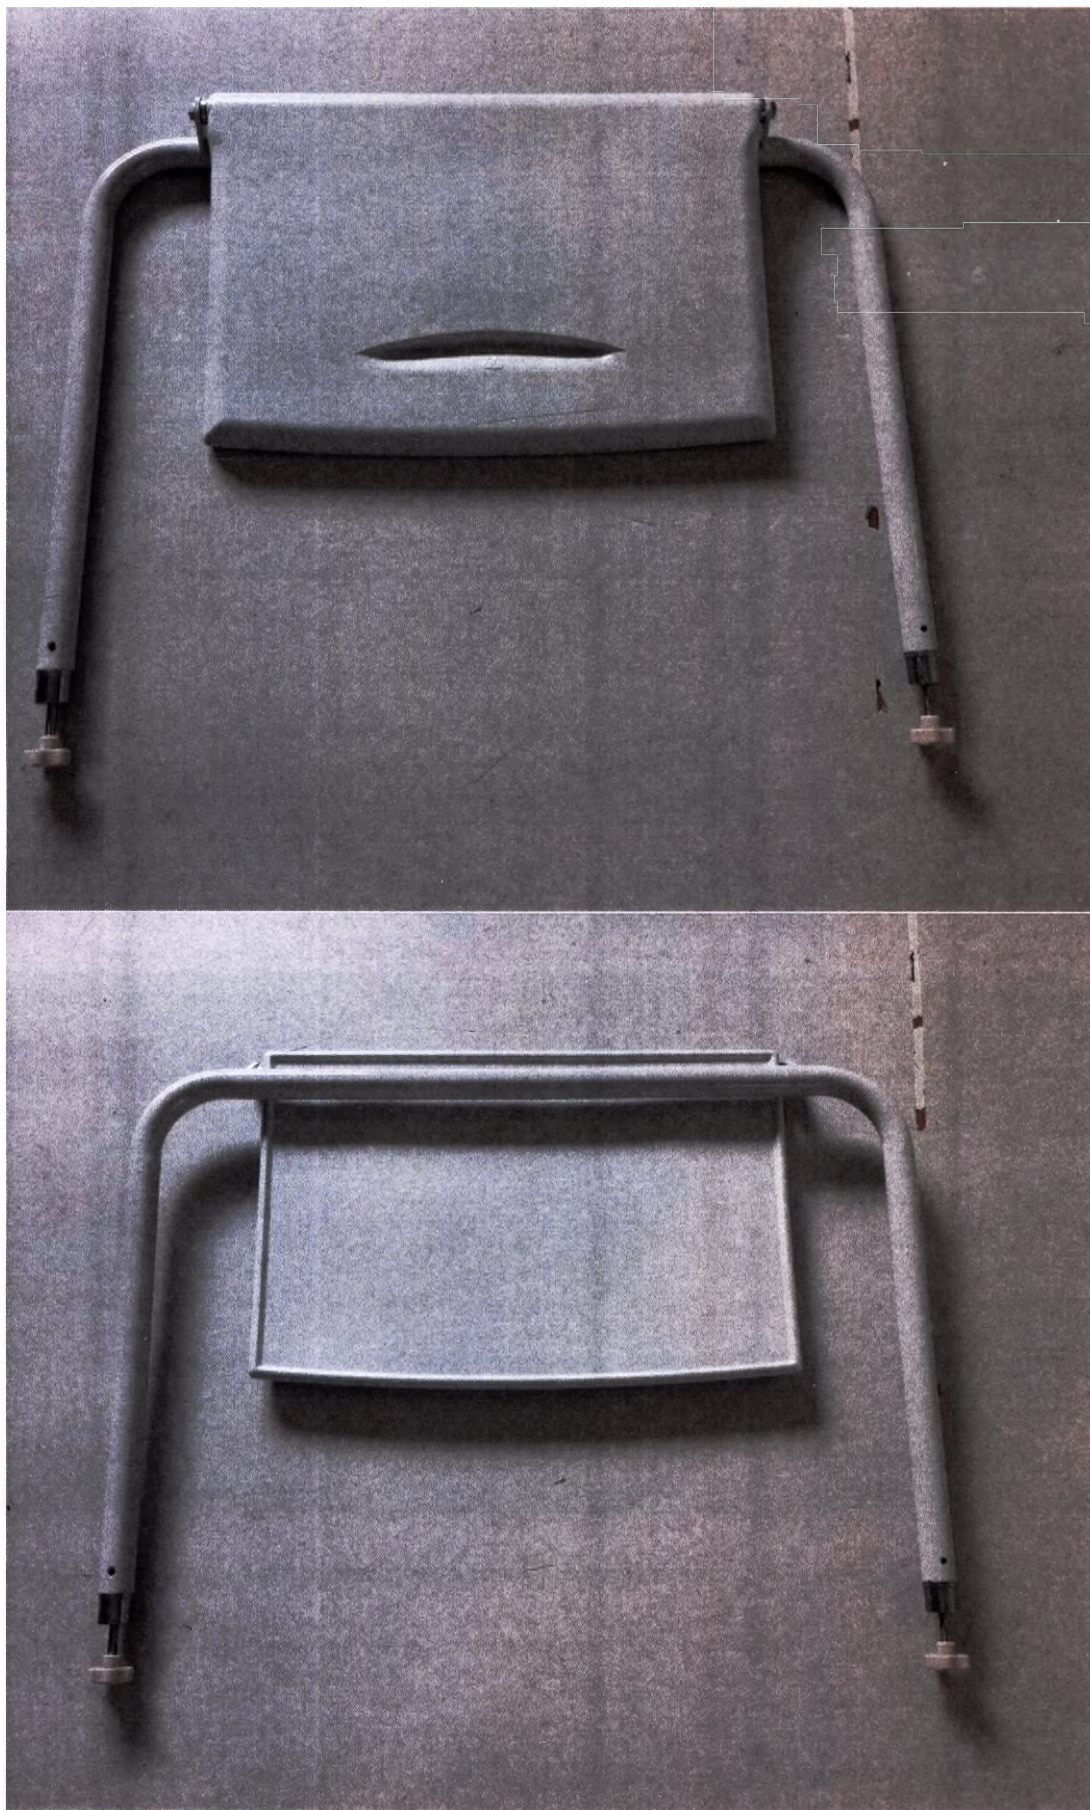


Фото 35 Подставка для монитора (при необходимости) – 1 шт.



Фото 36 Дополнительная матрасная вставка для использования при удлинении ложа кровати (при необходимости) – 1 шт.



Фото 37 Хромированный крючок для внутривенного вливания (при необходимости)

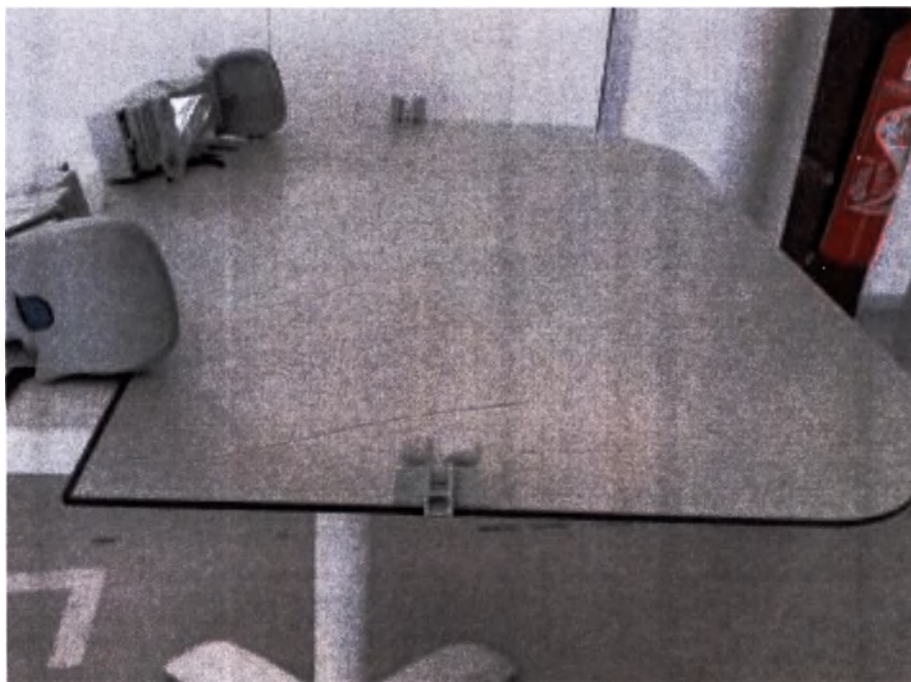


Фото 38 Вспомогательные рукоятки для пациента в головном конце (при необходимости)

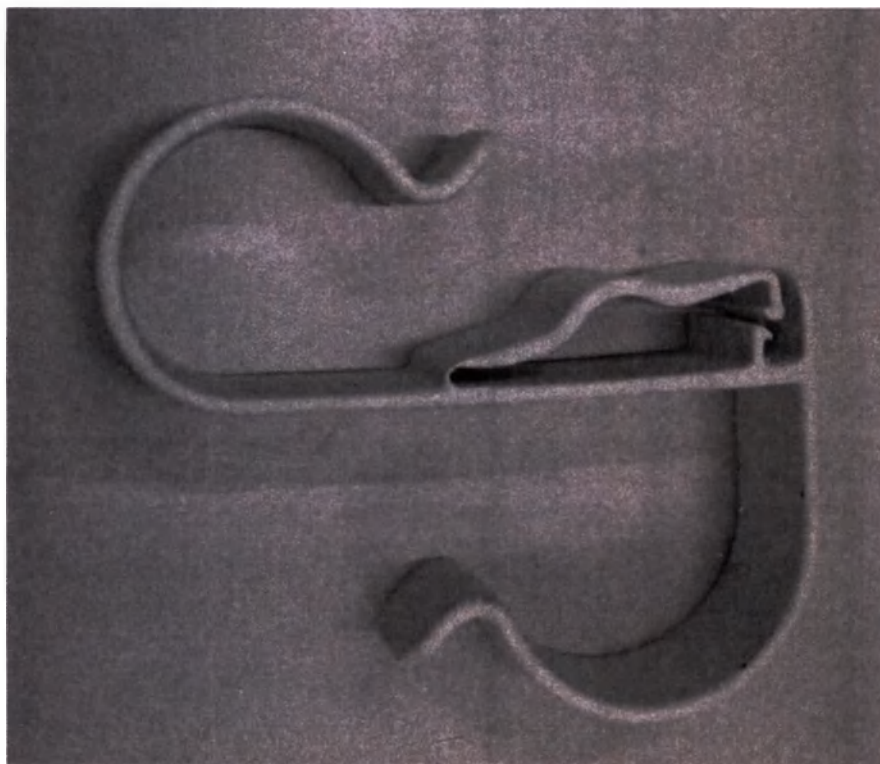


Фото 39 Держатель электрического провода



Фото 40 WIFI модуль (при необходимости)

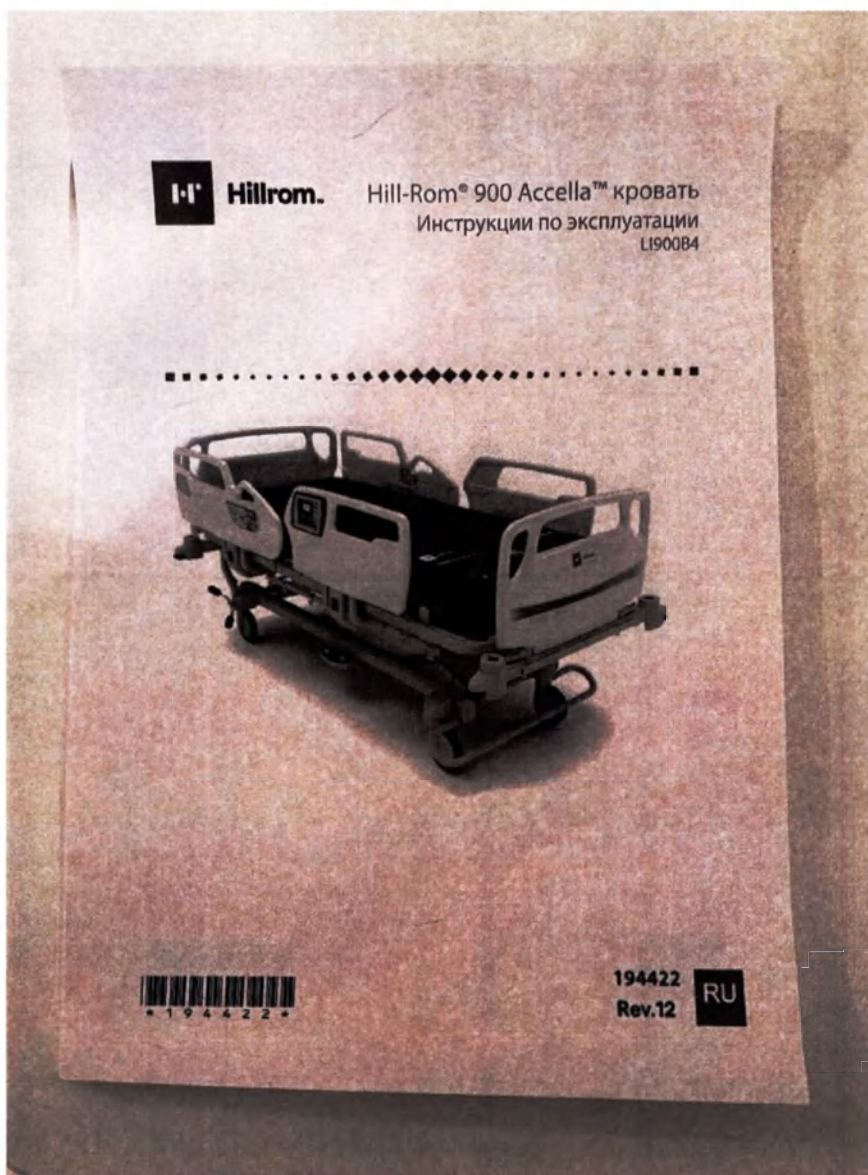


Фото 41 Эксплуатационная документация

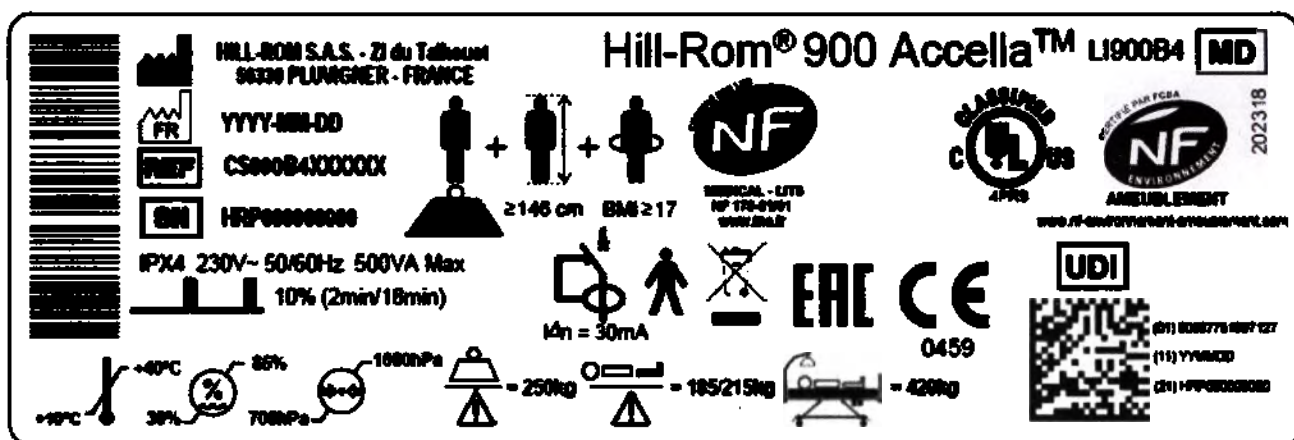


Фото 42 – Кровать медицинская функциональная Hill-Rom® 900 Accella™ (Маркировка)

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

М

24

листах

