


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Инфомед»

О.Н. Вязьмин

«26» декабря 2021 г.

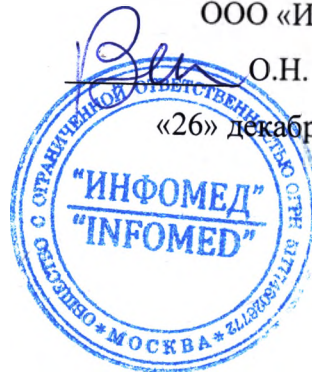

**Фотографии медицинского изделия:**

**«Системы быстрого кортикального картирования CortiQ Pro».**

**Производитель:**

«Джи.Тек Медикал Энджиниринг ГмбХ», Австрия/  
«G.Tec Medical Engineering GmbH », Austria

2021 г.

## НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система быстрого кортикального картирования CortiQ Pro, в составе:

1. Усилитель биосигналов g.NIamp, варианты исполнения g.NIamp 80, g.NIamp 144, g.NIamp 256:
  - Усилитель биосигналов в варианте исполнения g.NIamp 80 - 1 шт.;
  - Усилитель биосигналов в варианте исполнения g.NIamp 144 - 1 шт.;
  - Усилитель биосигналов в варианте исполнения g.NIamp 256 - 1 шт.;
2. Блок питания - 1 шт.;
3. Кабель питания - 1 шт.;
4. USB кабель для подключения усилителя к компьютеру - 1 шт.;
5. Руководство по использованию g.NIamp - 1 шт.;
6. Кабель триггерный для g.NIamp для DIG IN 1 - 1 шт.;
7. Кабель триггерный для g.NIamp для DIG IN 2 - 1 шт.;
8. Кабель с винтовым зажимом - 1 шт.;
9. Блок соединительный для подключения пассивных электродов на 64 канала - не более 4 шт. (при необходимости);
10. Кабель соединительный - не более 4 шт. (при необходимости);
11. Управляющий компьютер - 1 шт. (при необходимости);
12. Монитор пациента, включая кабель для подключения монитора пациента и кабель переходный USB тип А-тип С - не более 2 шт. (при необходимости);
13. Программное обеспечение cortiQ PRO - не более 5 шт.;
14. USB-ключ - 1 шт.;
15. Джампер замыкающий - не более 250 шт. (при необходимости);
16. Руководство по использованию cortiQ PRO (PDF) - не более 5 шт. ;
17. Руководство по использованию cortiQ PRO (печатная) - не более 5 шт.(при необходимости);
18. Руководство по использованию электродов и шапок - не более 5 шт.(при необходимости);
19. Руководство по использованию кортикальных электродов cortiQ - не более 10 шт.(при необходимости);
20. Руководство по использованию сенсоров и утилит - не более 10 шт(при необходимости);
21. Разделительный блок для подключения пассивных электродов на 64 канала, включая кабель соединительный - не более 4 шт (при необходимости);

Принадлежности:

- 1 - Кейс для переноски для усилителя - 1 шт.;
- 2 - Кабель питания компьютера - 1 шт.;
- 3 - Кейс для переноски - 1 шт.;
- 4 - Предохранитель запасной - 2 шт.;

Фото

# 1. Усилитель биосигналов в варианте исполнения g.Hlamp 80 (Фото 1-2)

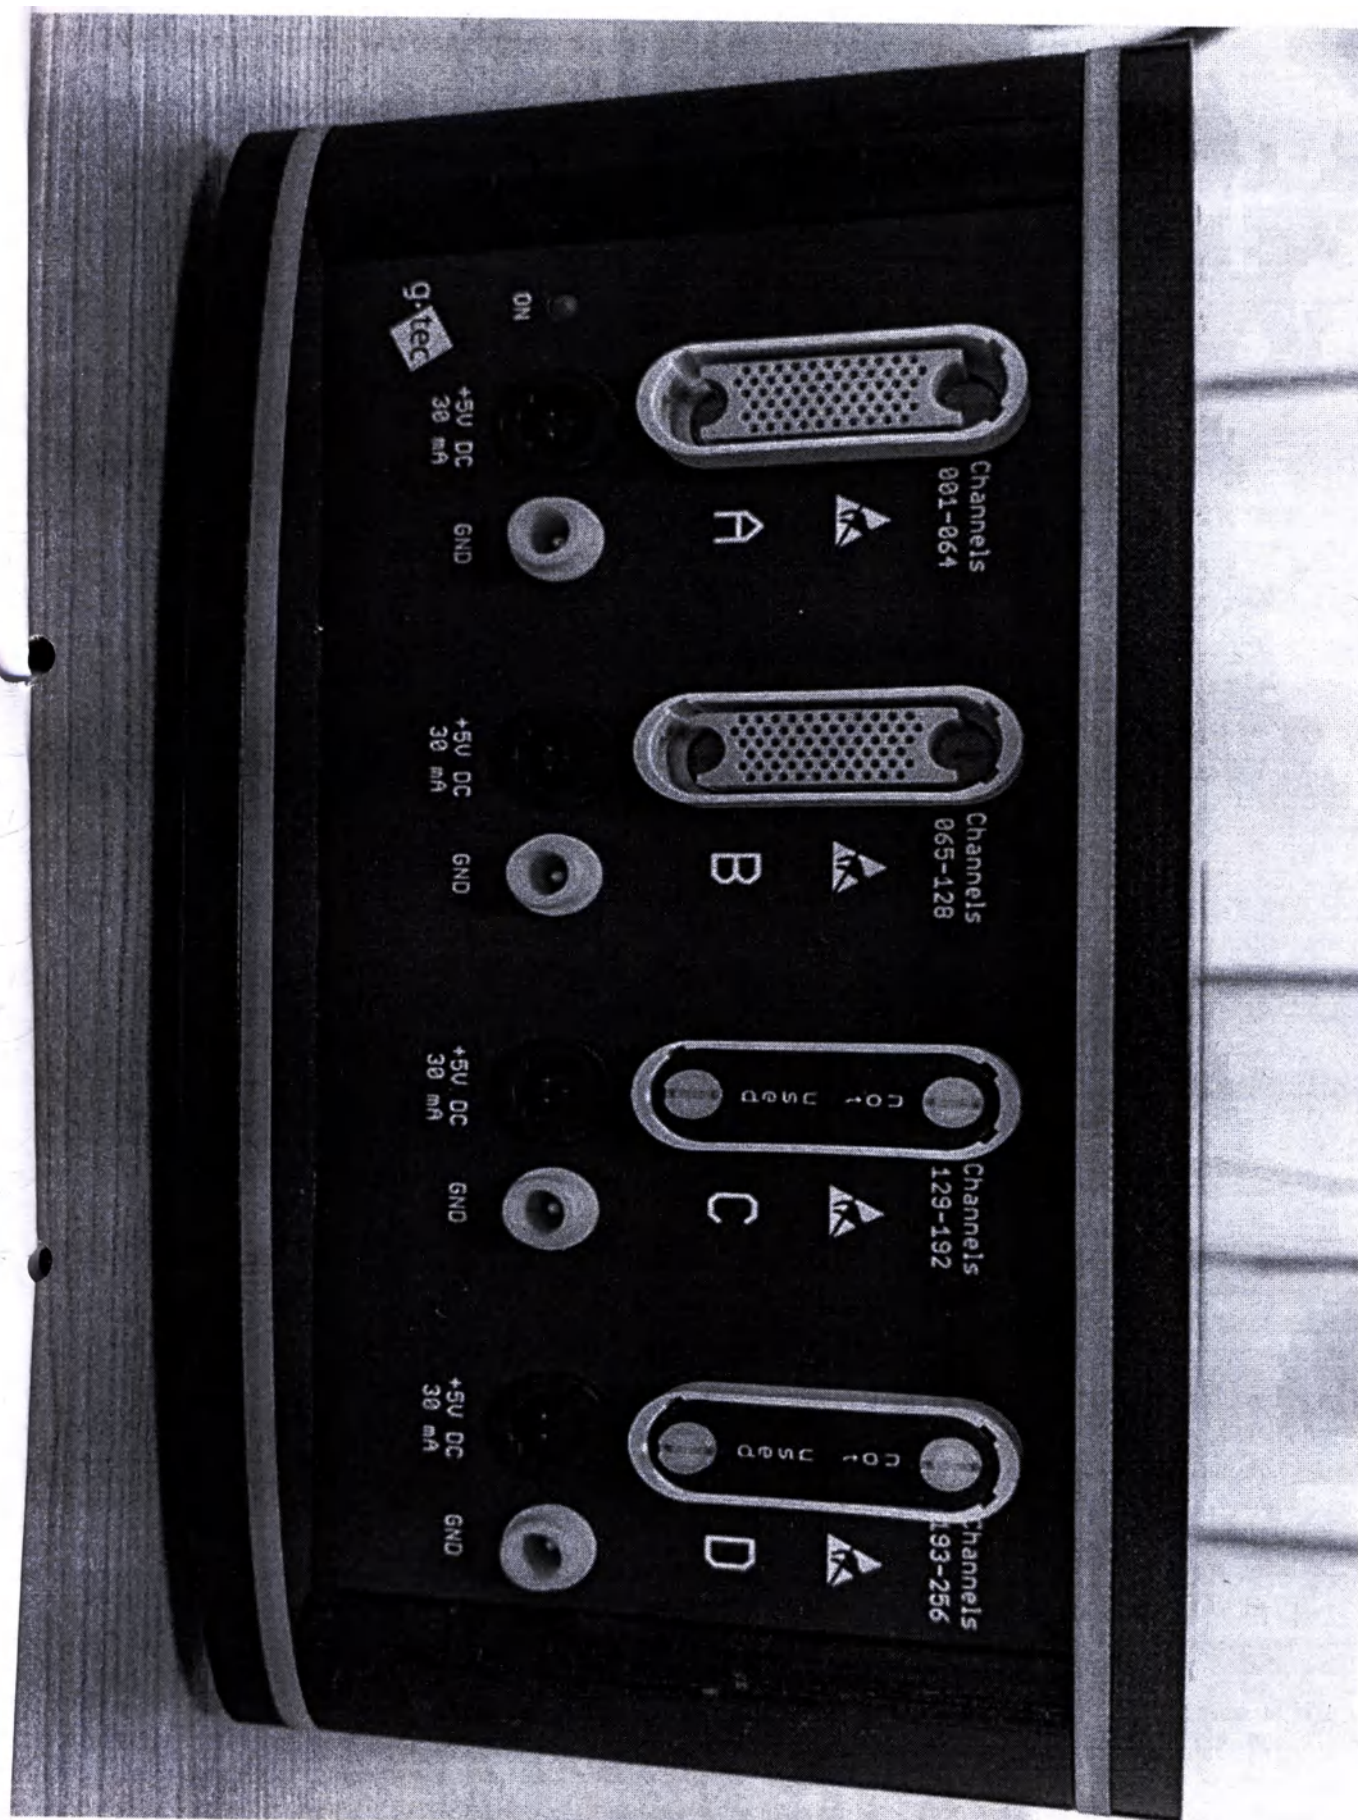


Фото 1: передняя панель.


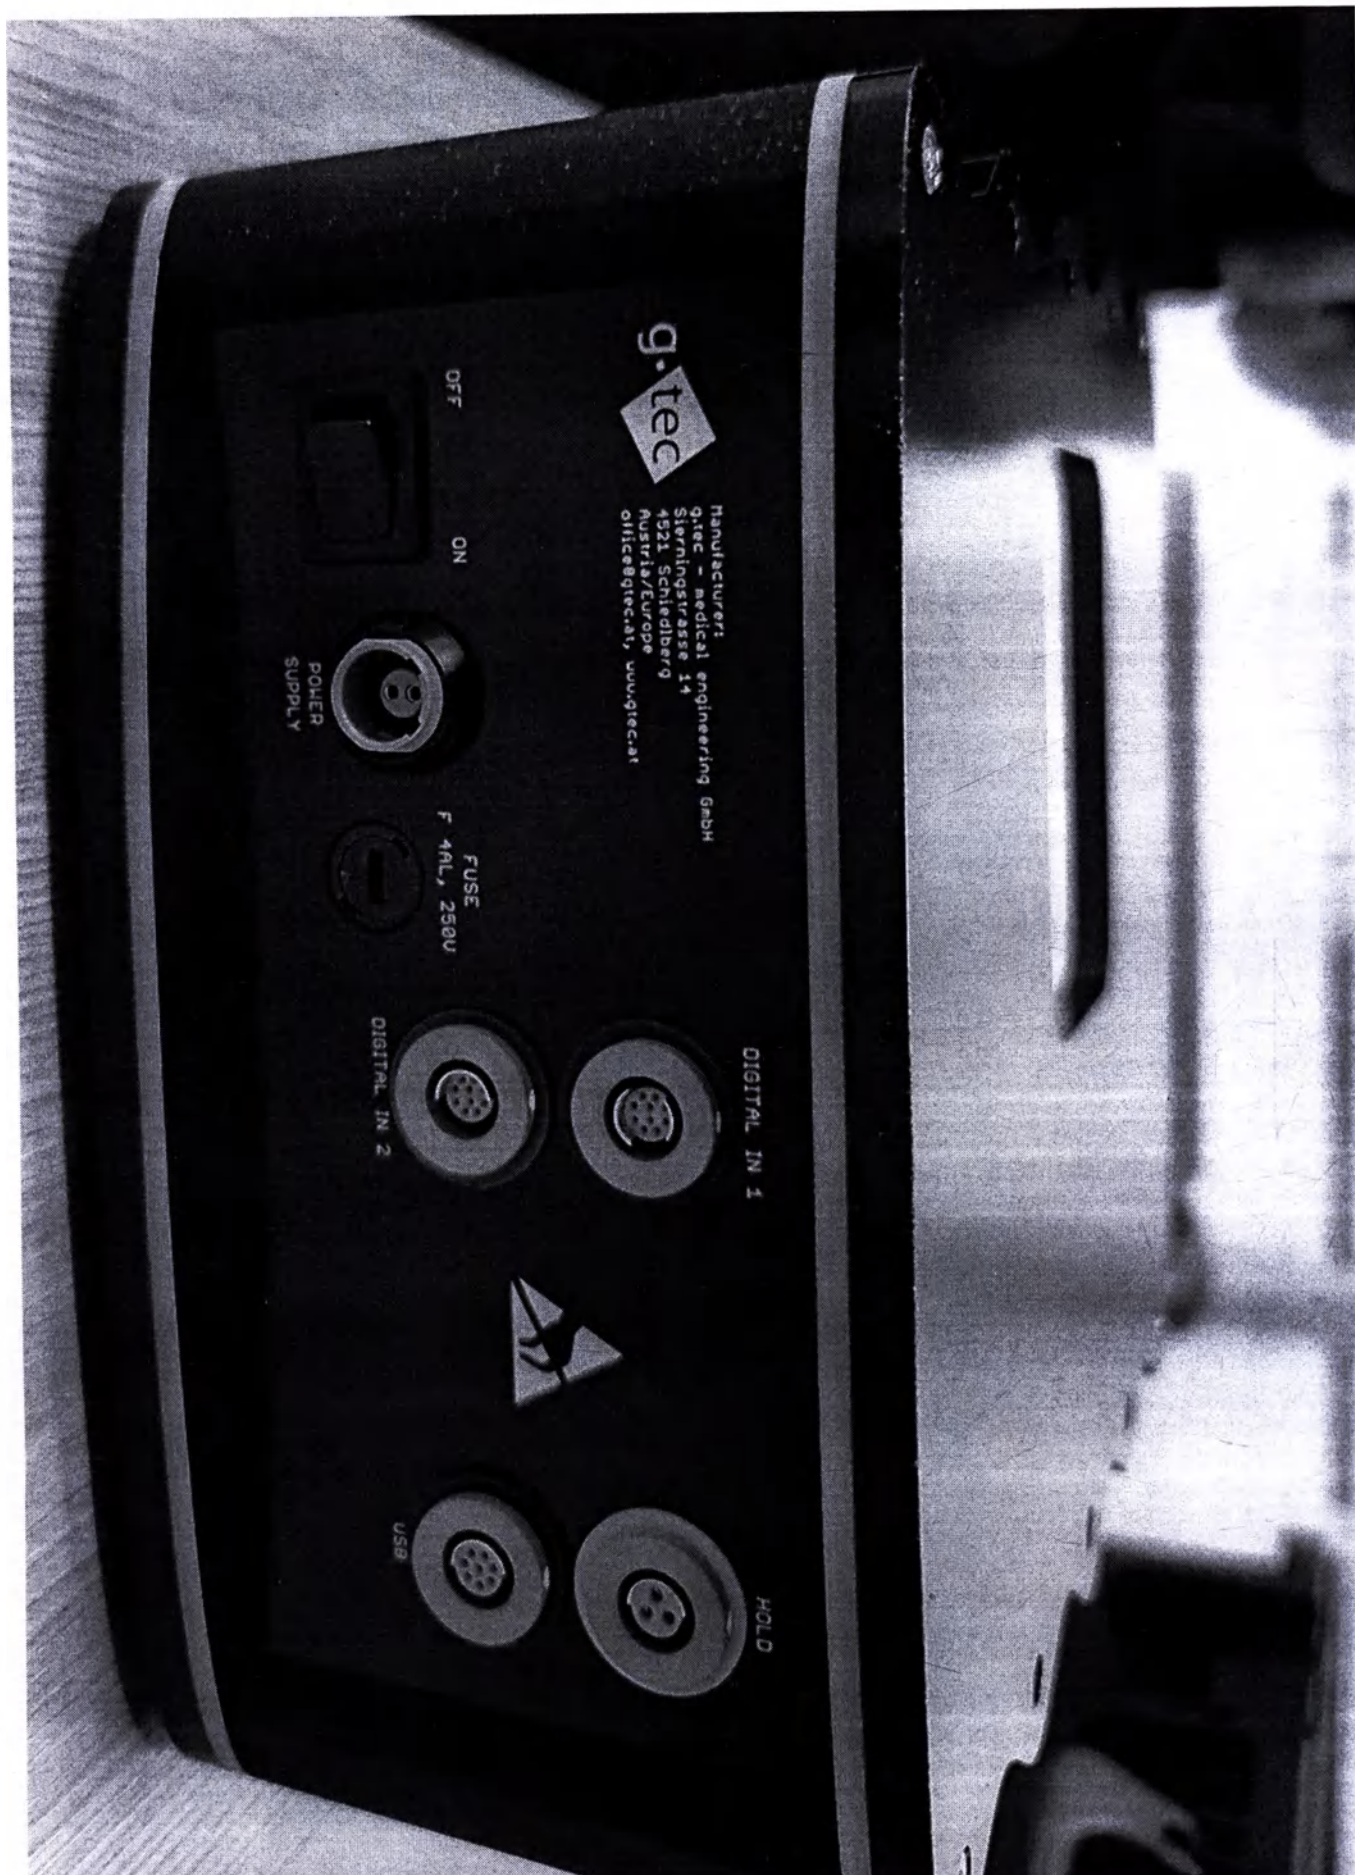


Фото 2: задняя панель.



2. Блок питания

### 3. Кабель питания

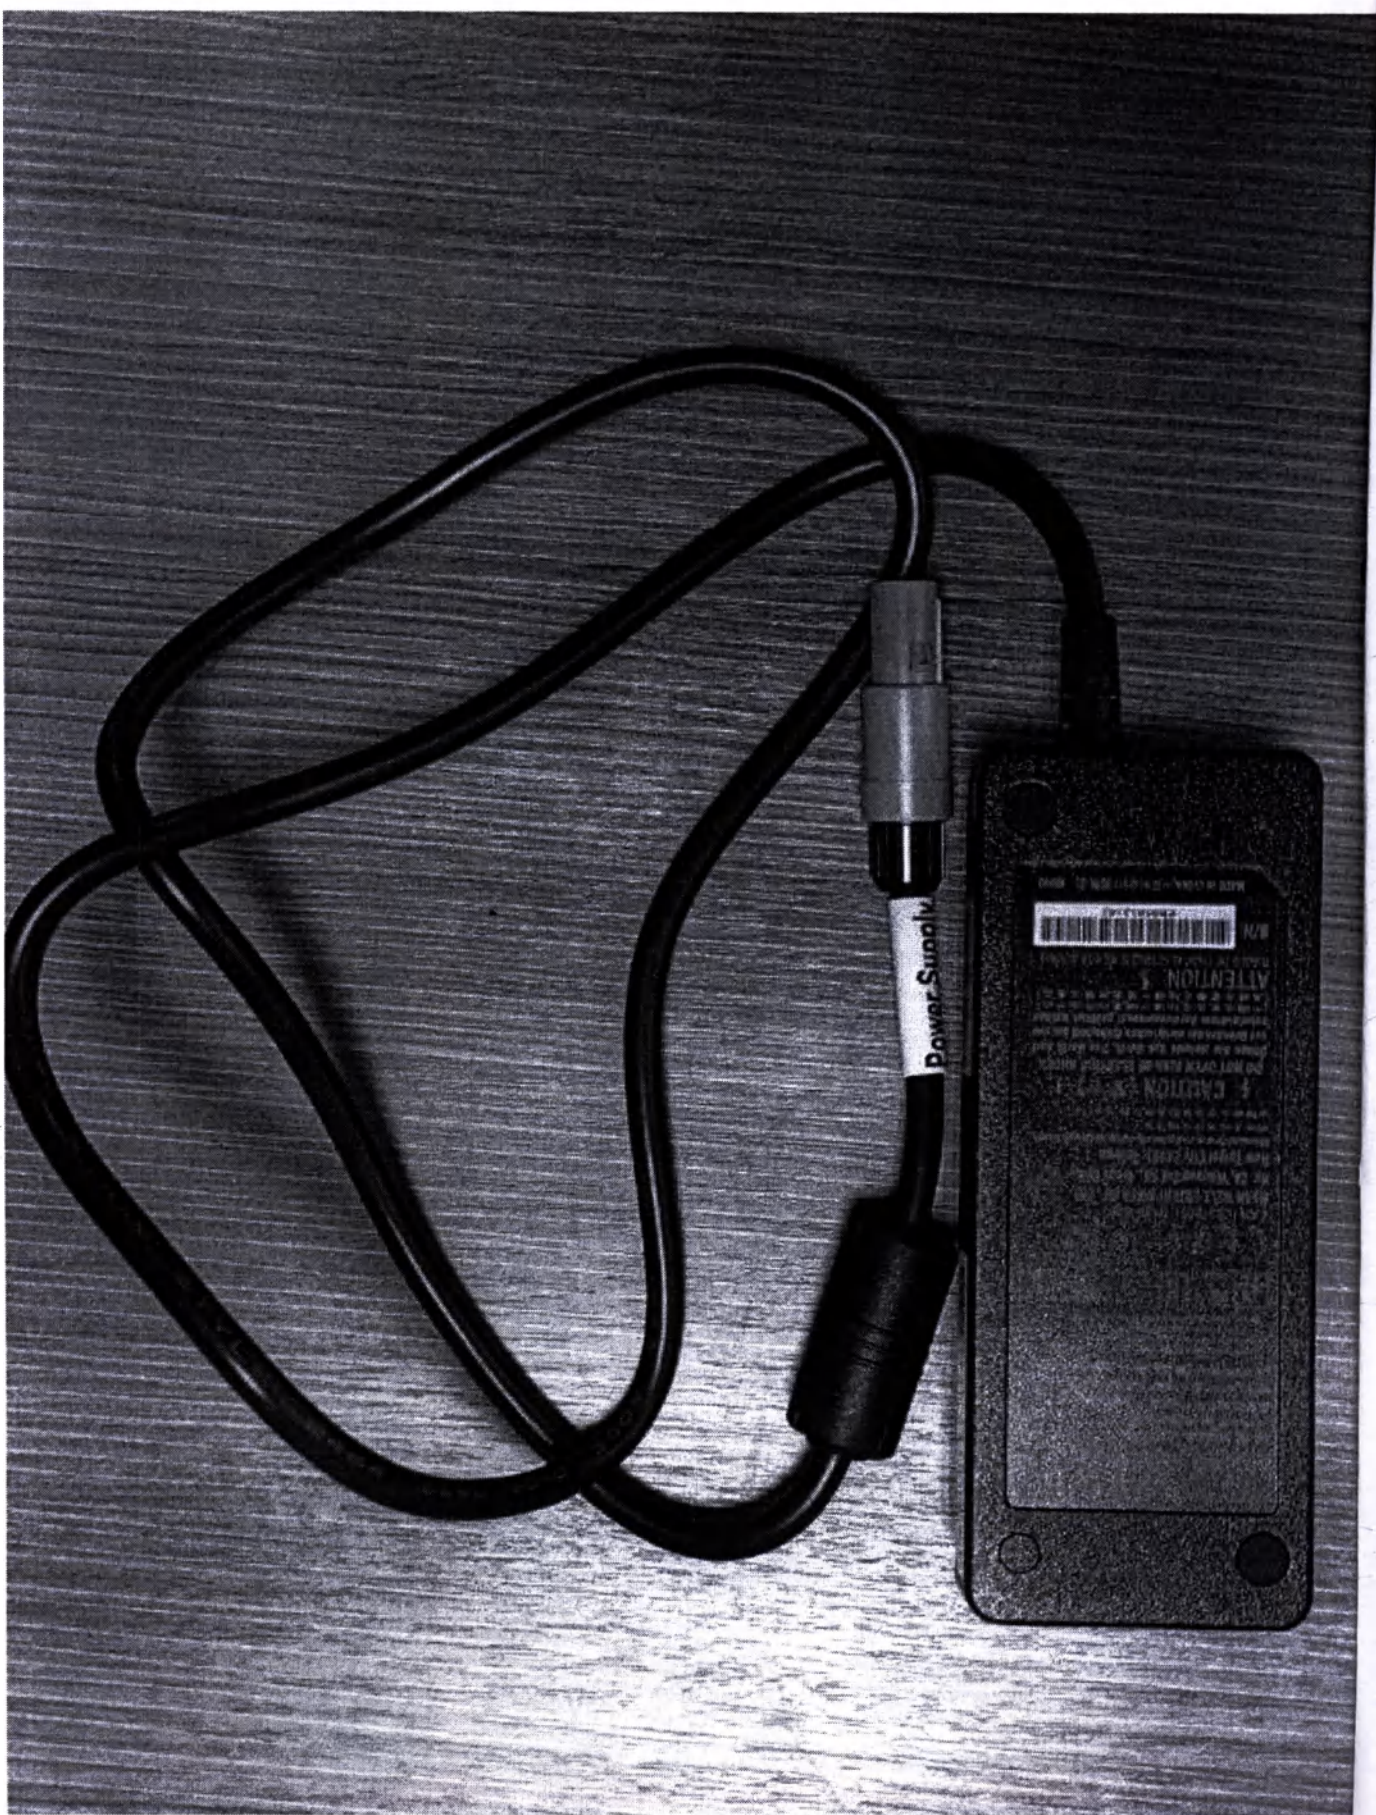

4. USB кабель для подключения усилителя к компьютеру



## 5. Руководство по использованию g.Hiamp

# g·HIAMP

MULTICHANNEL AMPLIFIER

## INSTRUCTIONS FOR USE



6. Кабель триггерный для g.Нлаmp для DIG IN 1



## 7. Кабель триггерный для g.Hamp для DIG IN 2



## 8. Кабель с винтовым зажимом



# 9. Блок соединительный для подключения пассивных электродов на 64 канала



10. Кабель соединительный



## 11. Управляющий компьютер (Фото 1-4)



Фото 1. Управляющий компьютер. Открытое положение.

Фото



Фото 2. Управляющий компьютер. Вид сверху

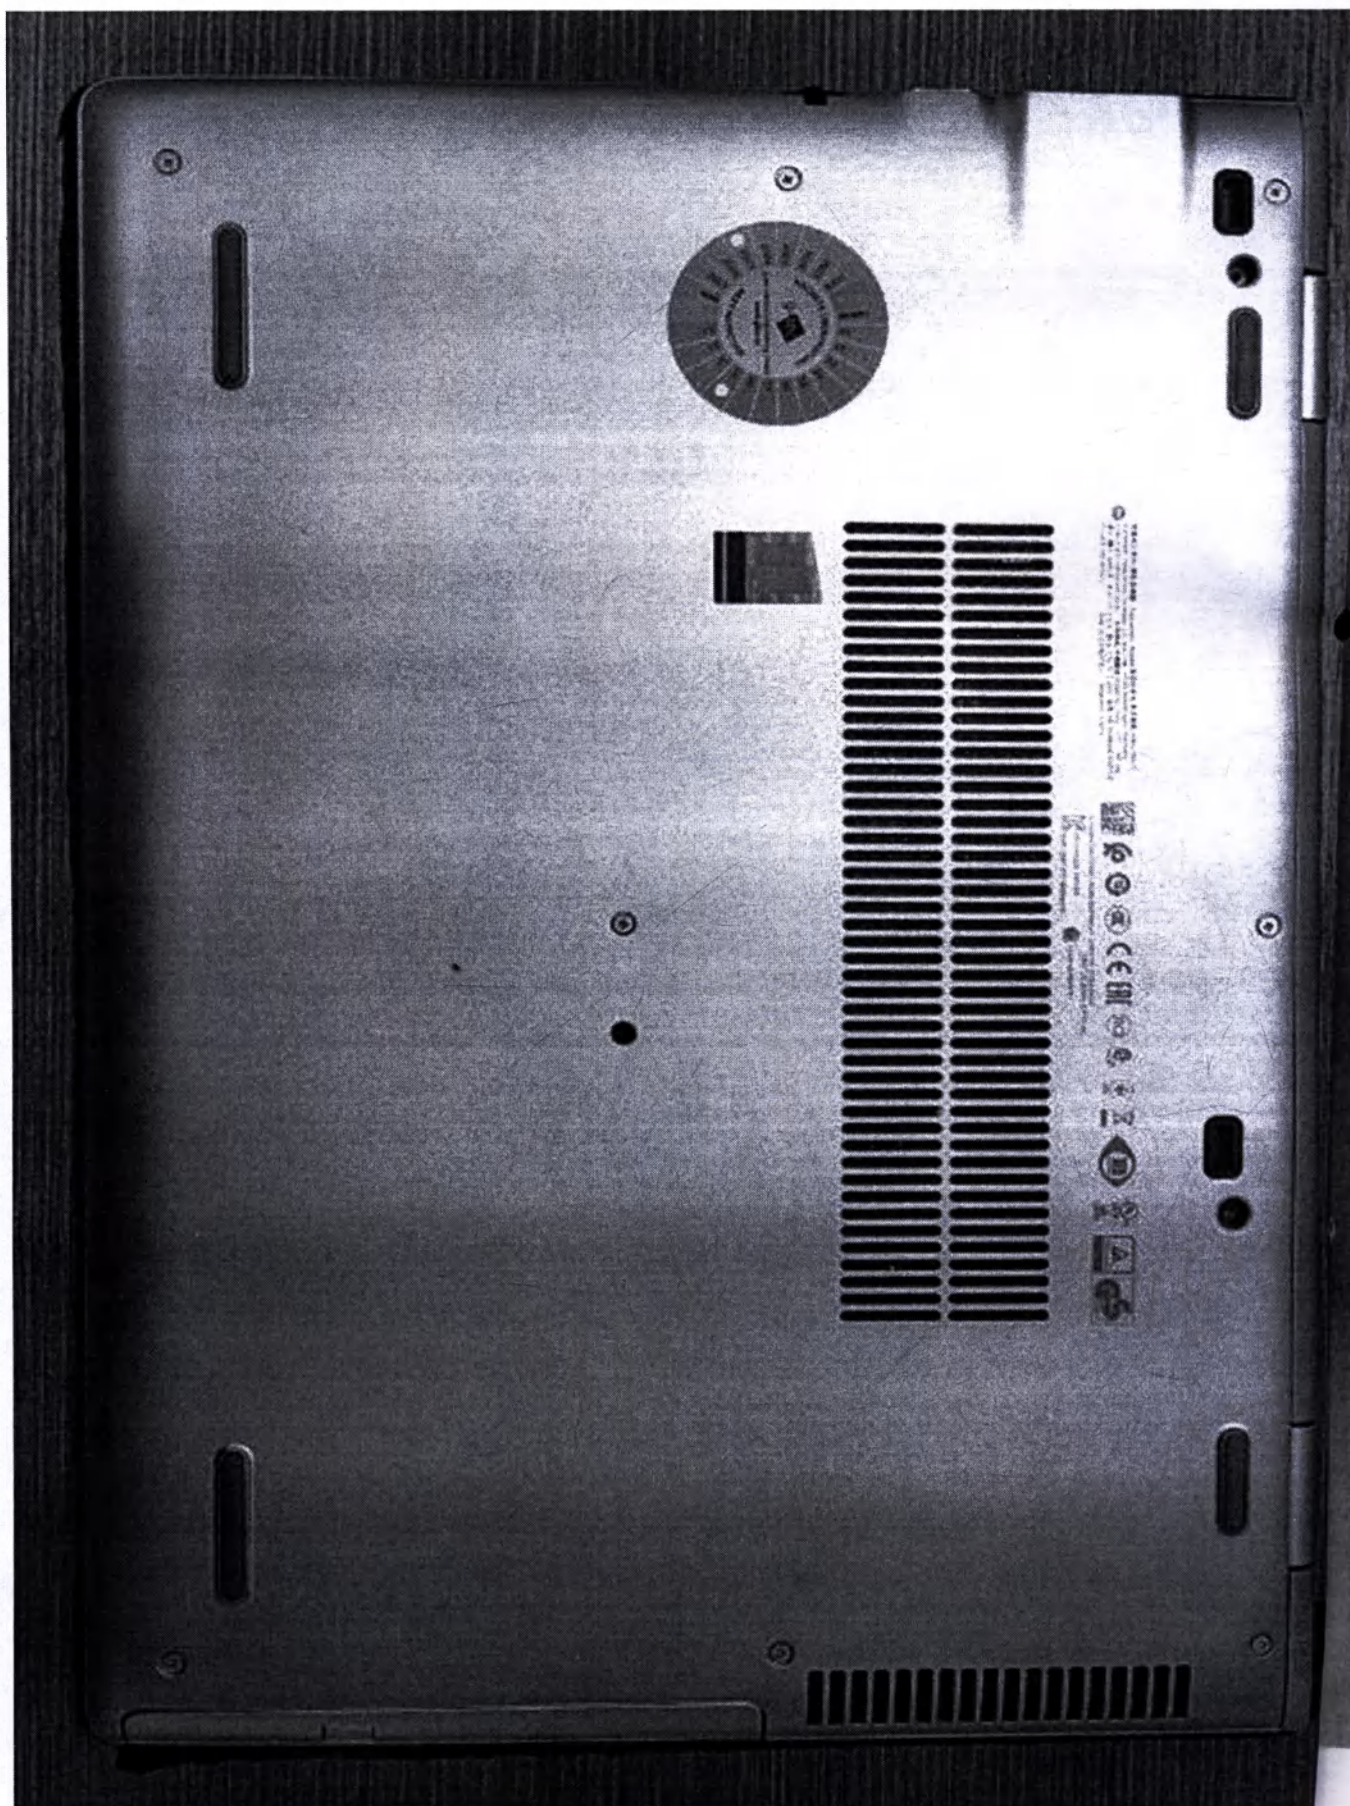


Фото 3. Управляющий компьютер. Вид сзади.

Фото 4.


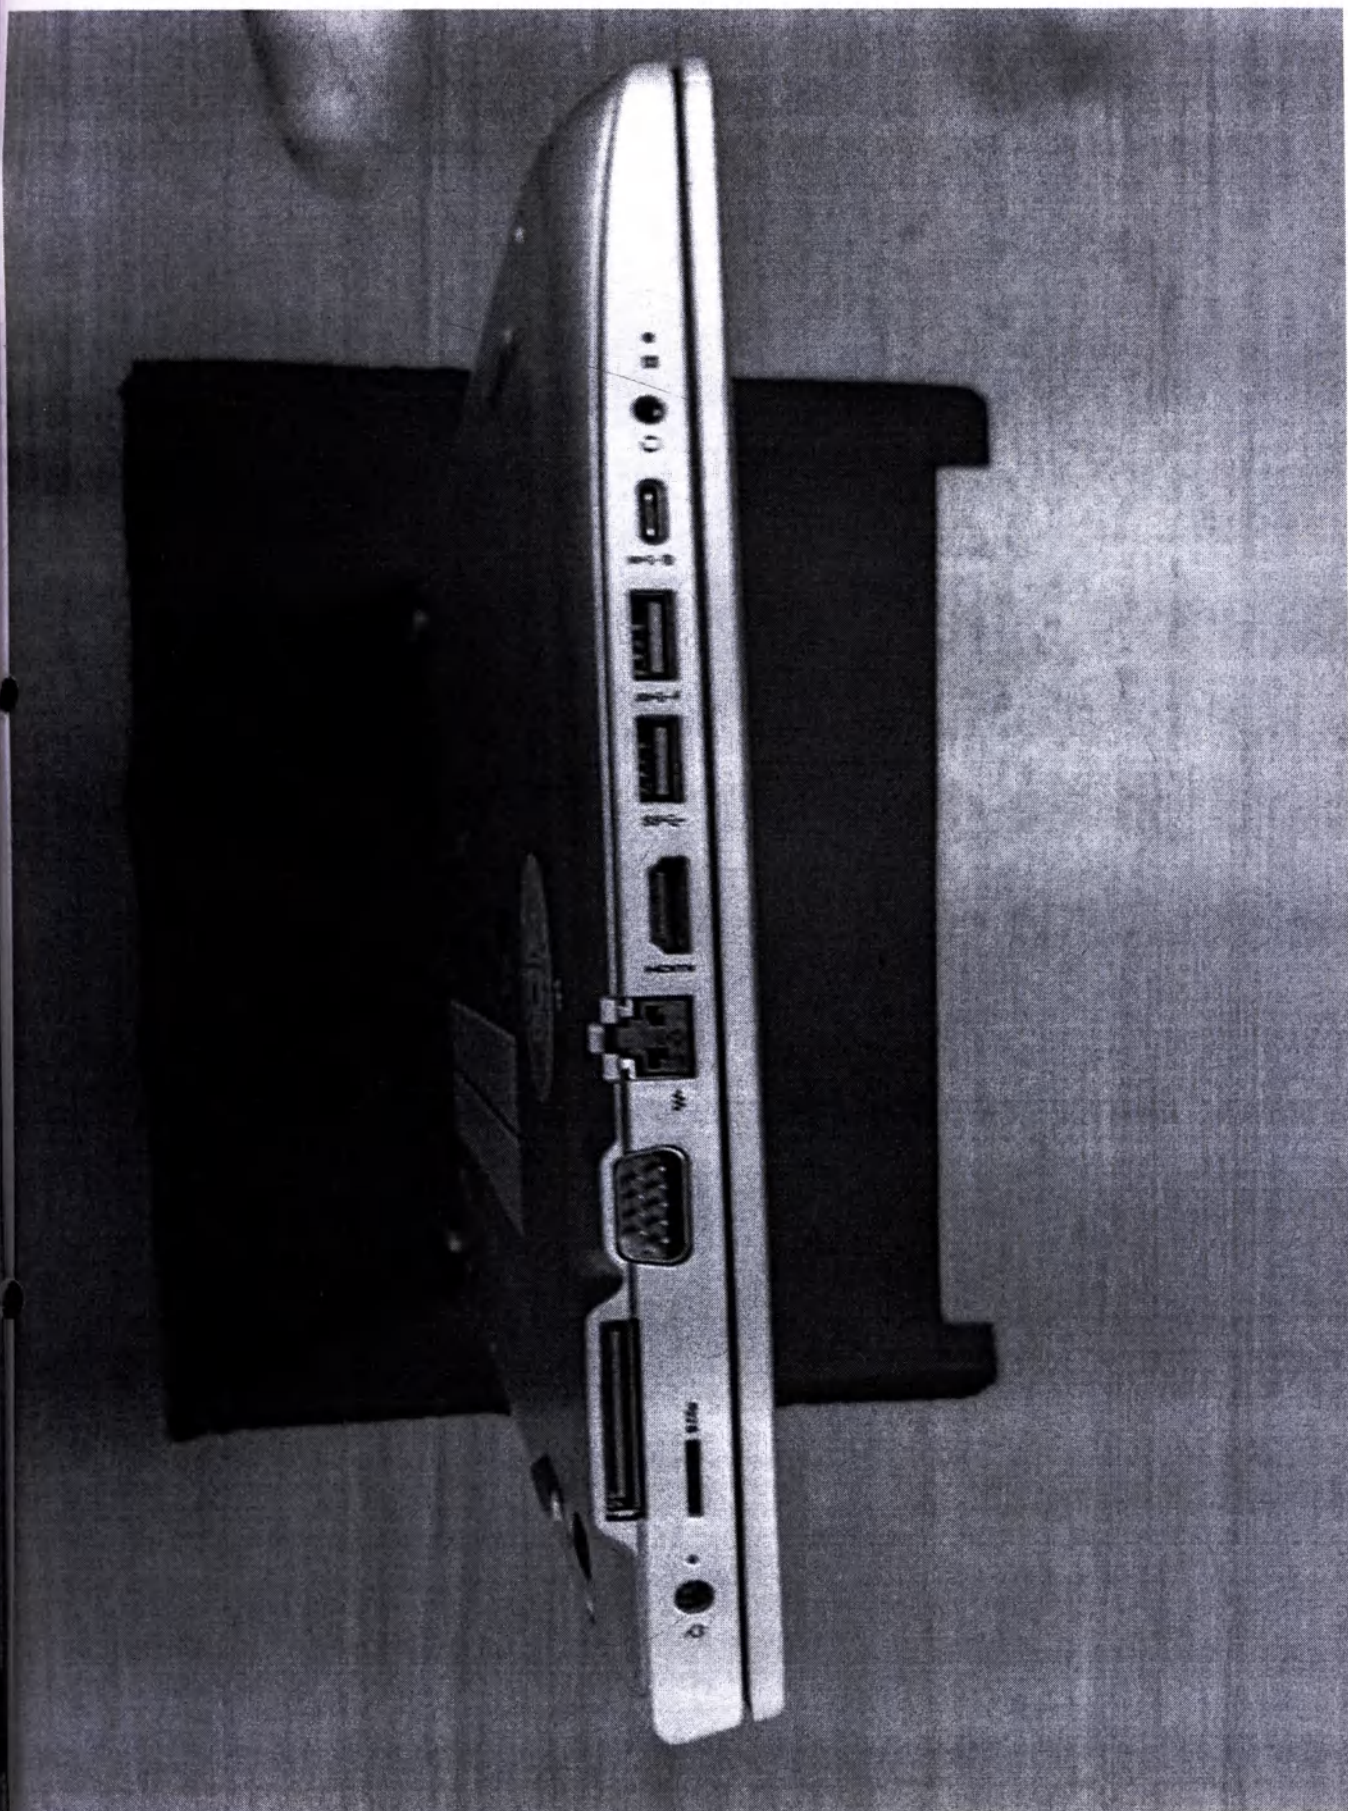



Фото 4. Управляющий компьютер. Вид сбоку.

12. Монитор пациента, включая кабель для подключения монитора пациента и кабель переходный USB тип А-тип С (Фото 1-4)



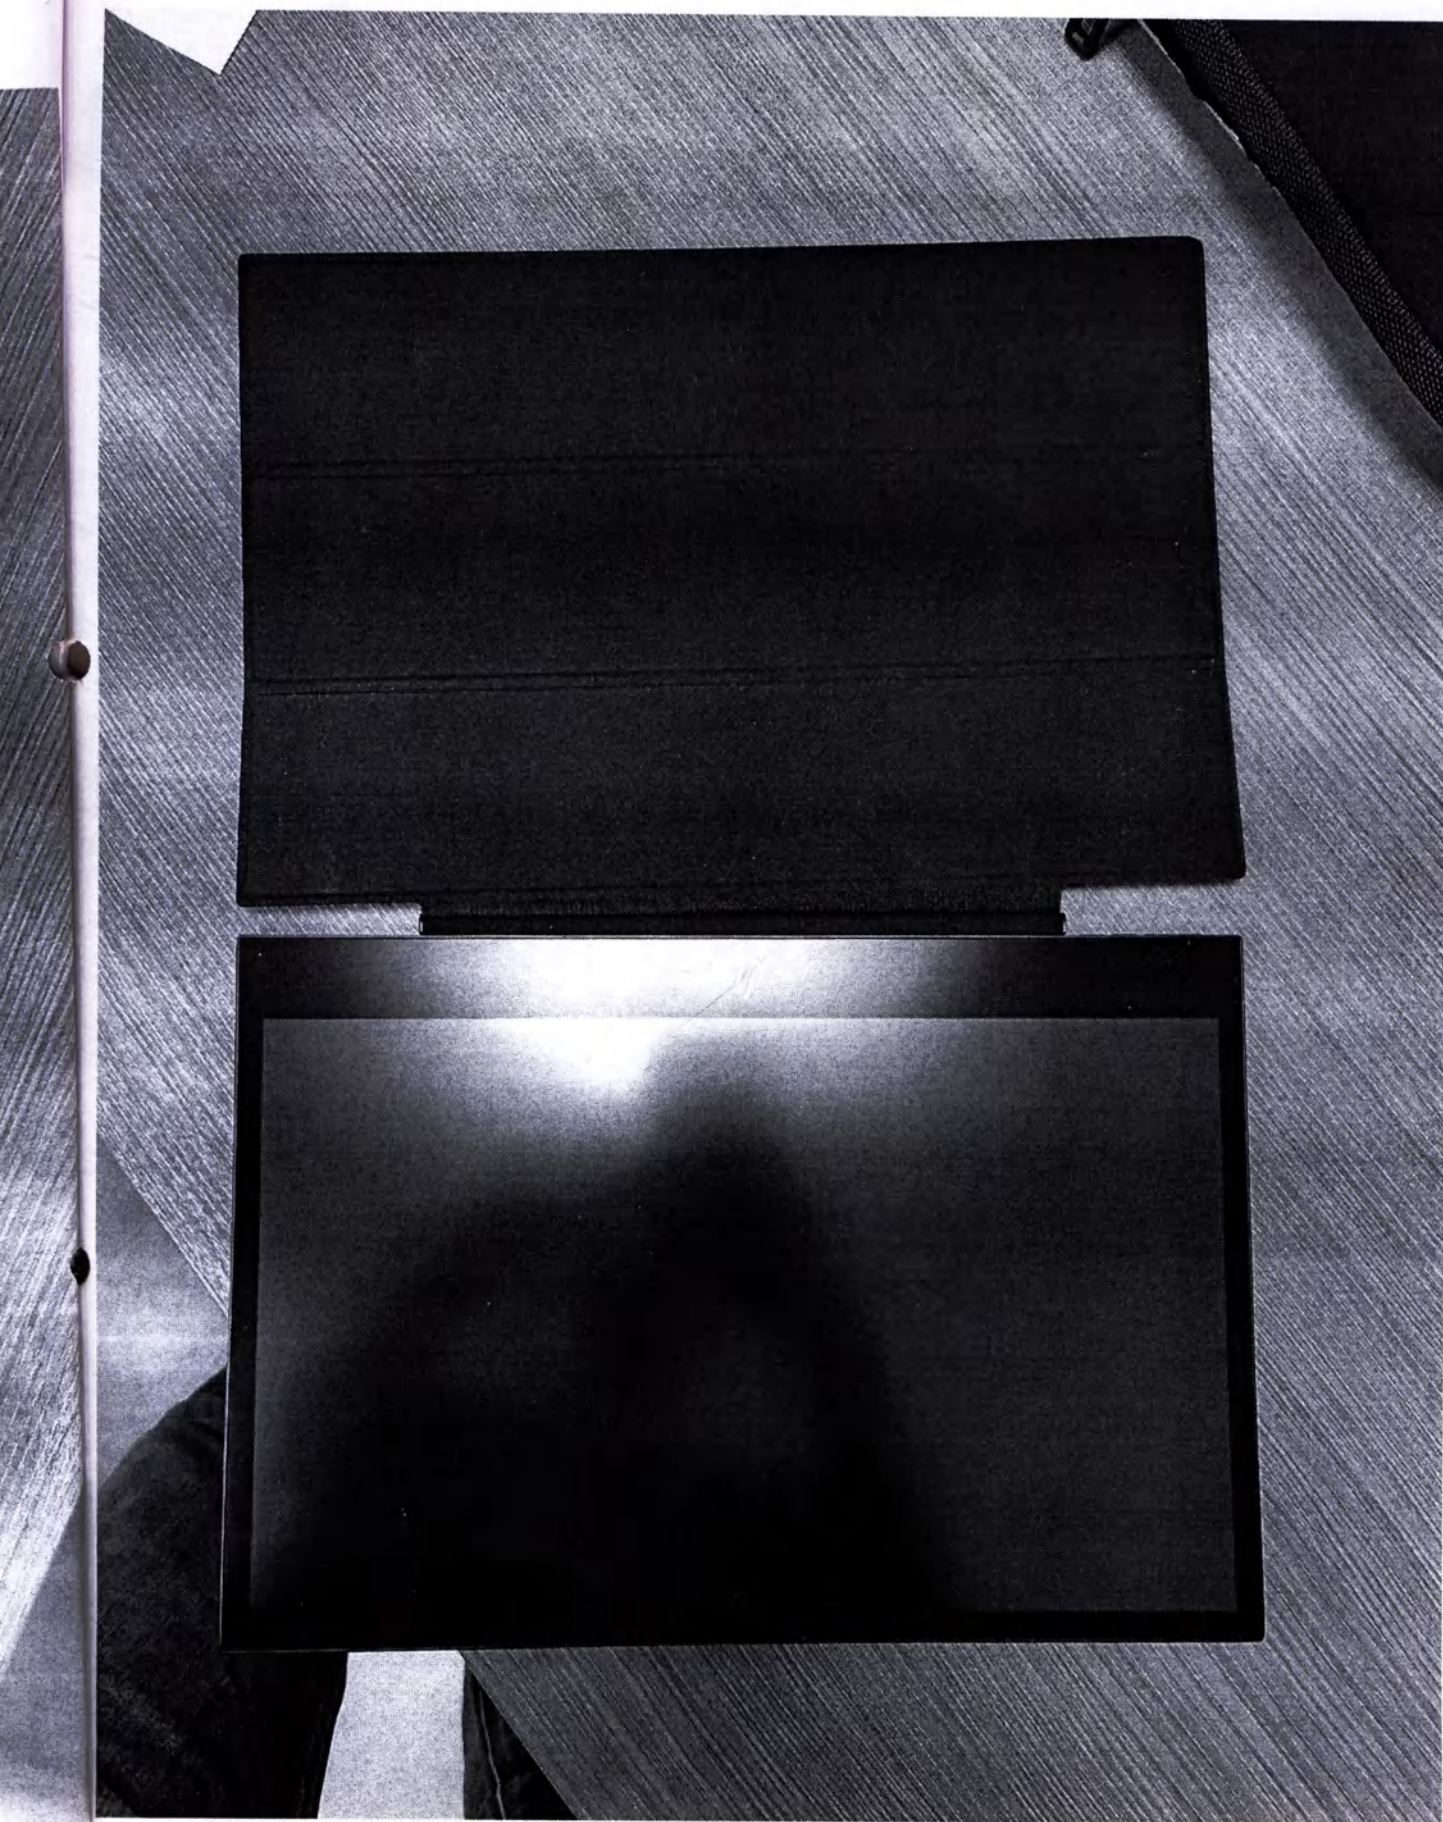

**Фото 2. Монитор пациента. Вид сверху. Открытый.**

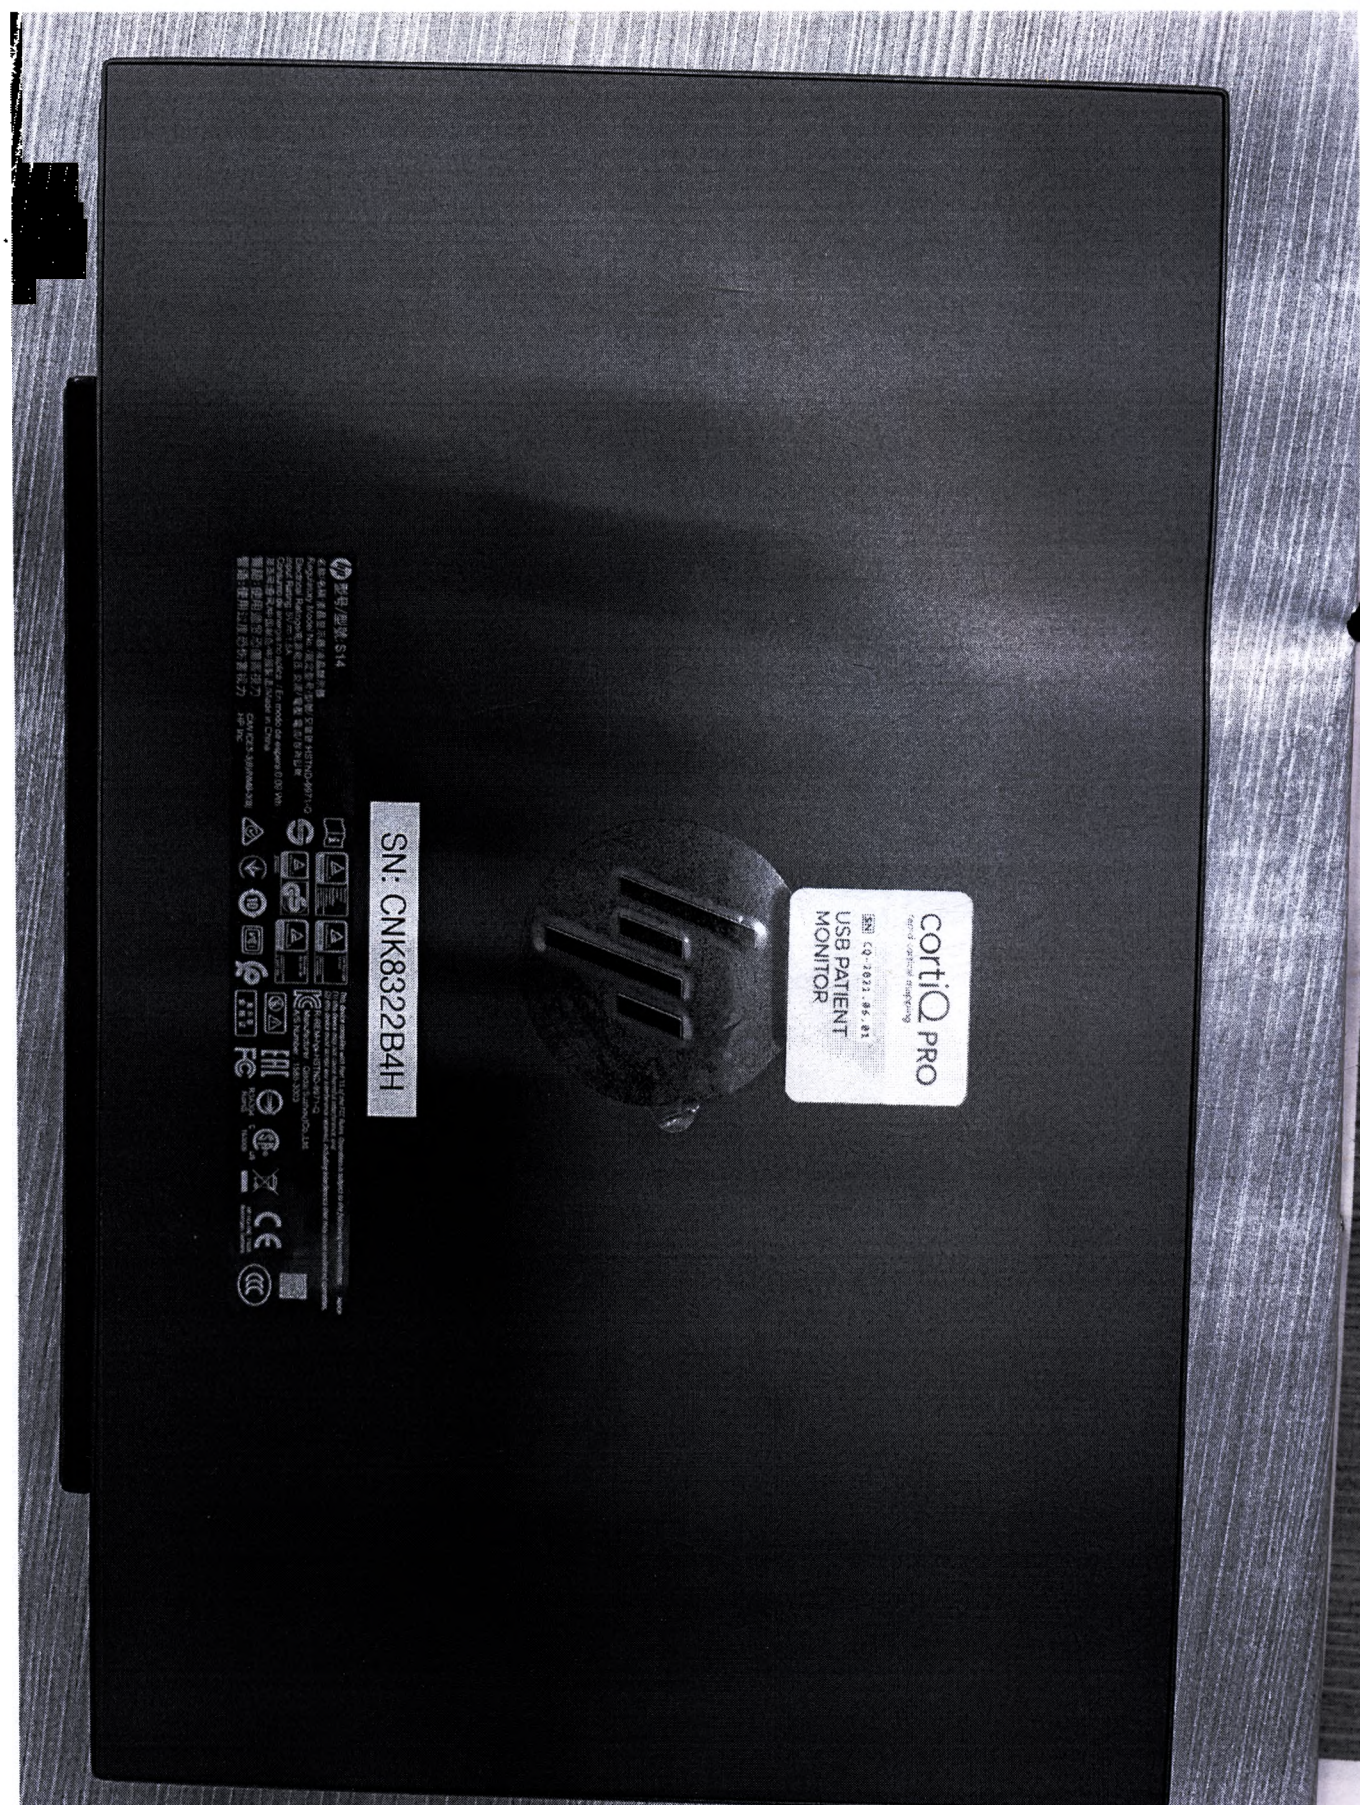

Фото

Фото 3. Монитор пациента. Вид задней части.




**Фото 4. Кабель переходный USB тип А-тип С**




13. Программное обеспечение cortiQ PRO (Установлено на управляющем компьютере)

15. Дампер замыкающий

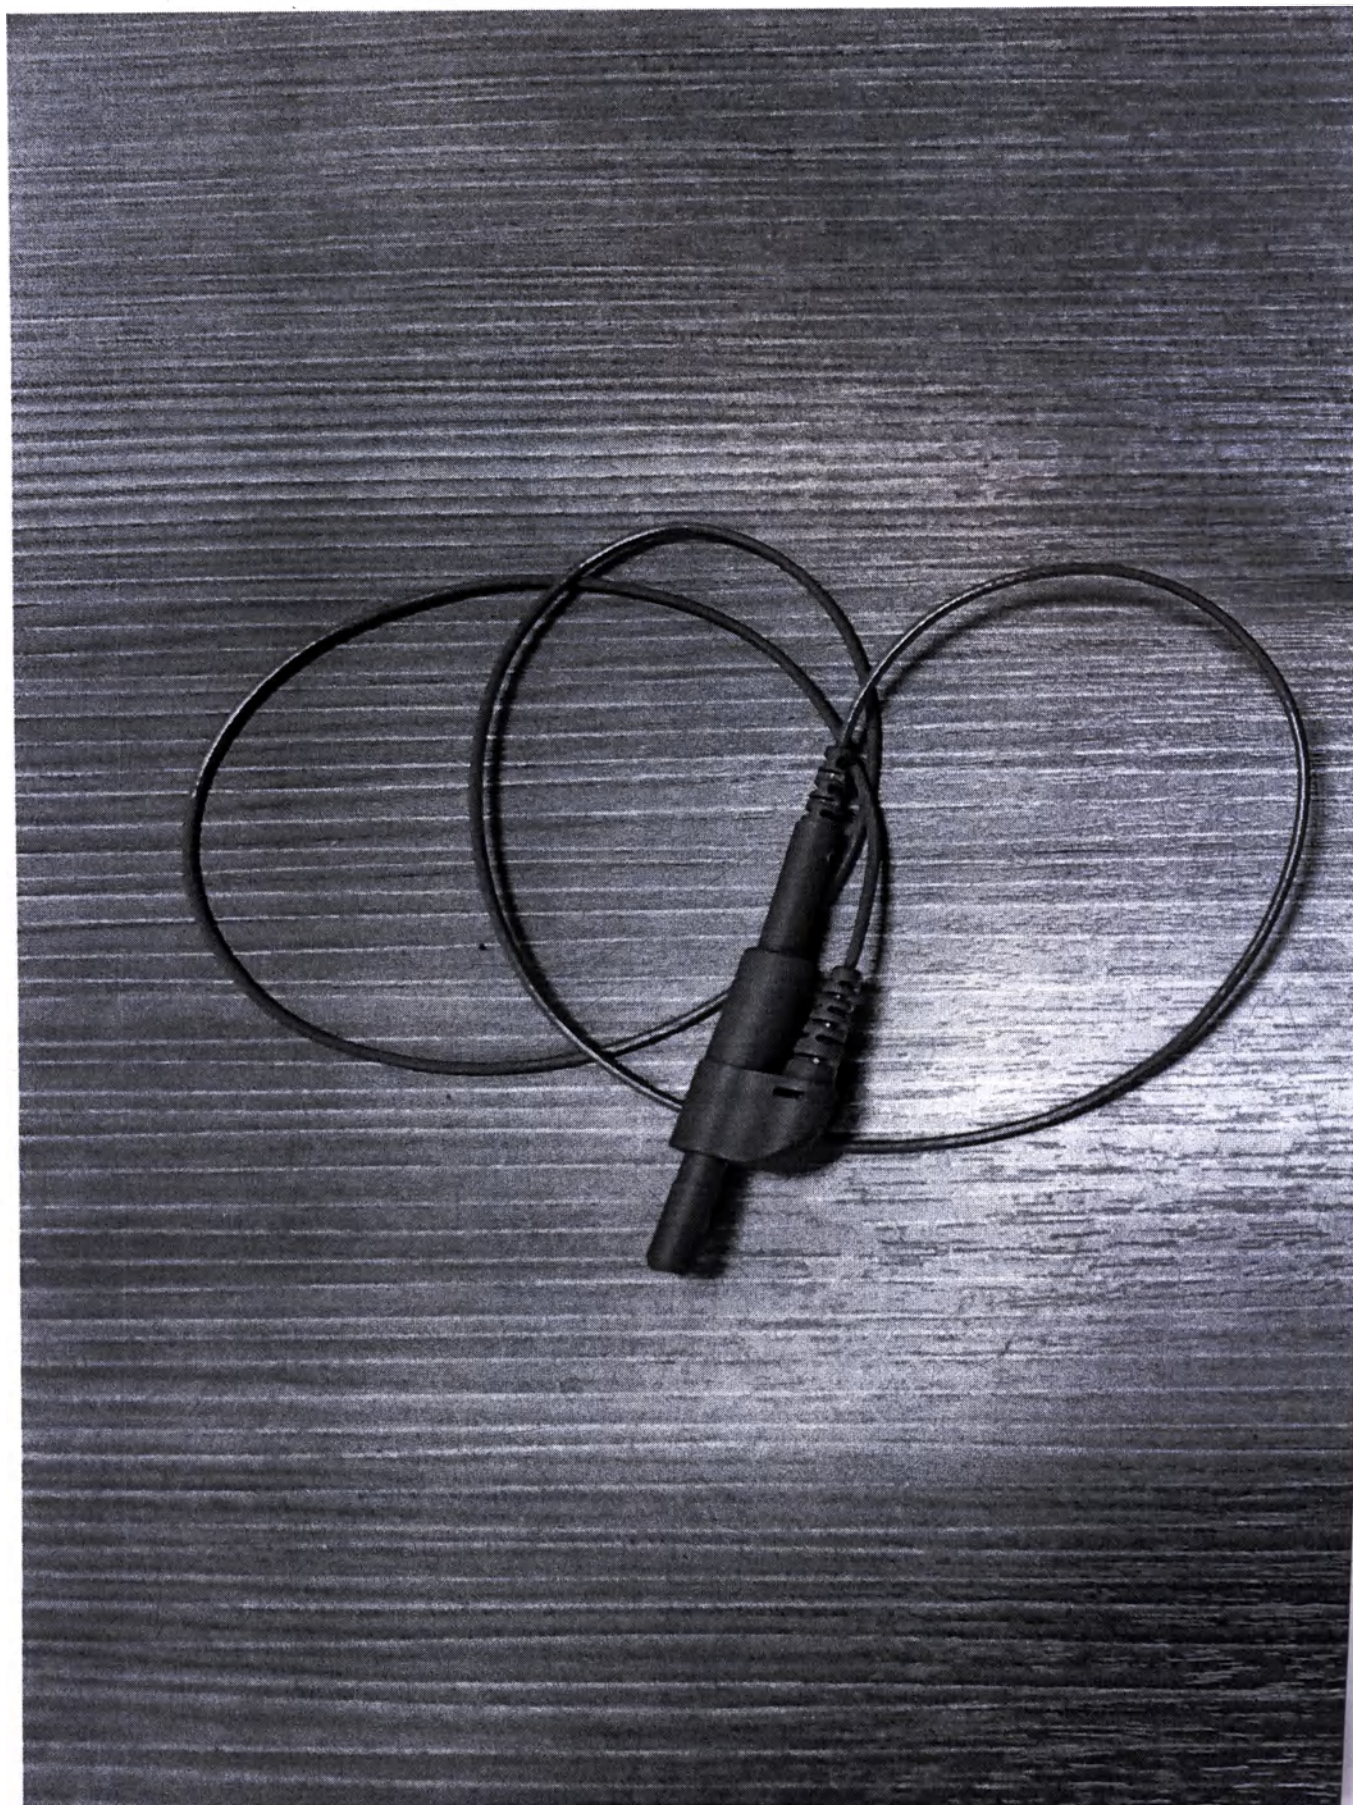

16. Руководство по использованию cortiQ PRO (PDF) (установлено на управляющем компьютере)

17. Руководство по использованию cortiQ PRO (печатная)

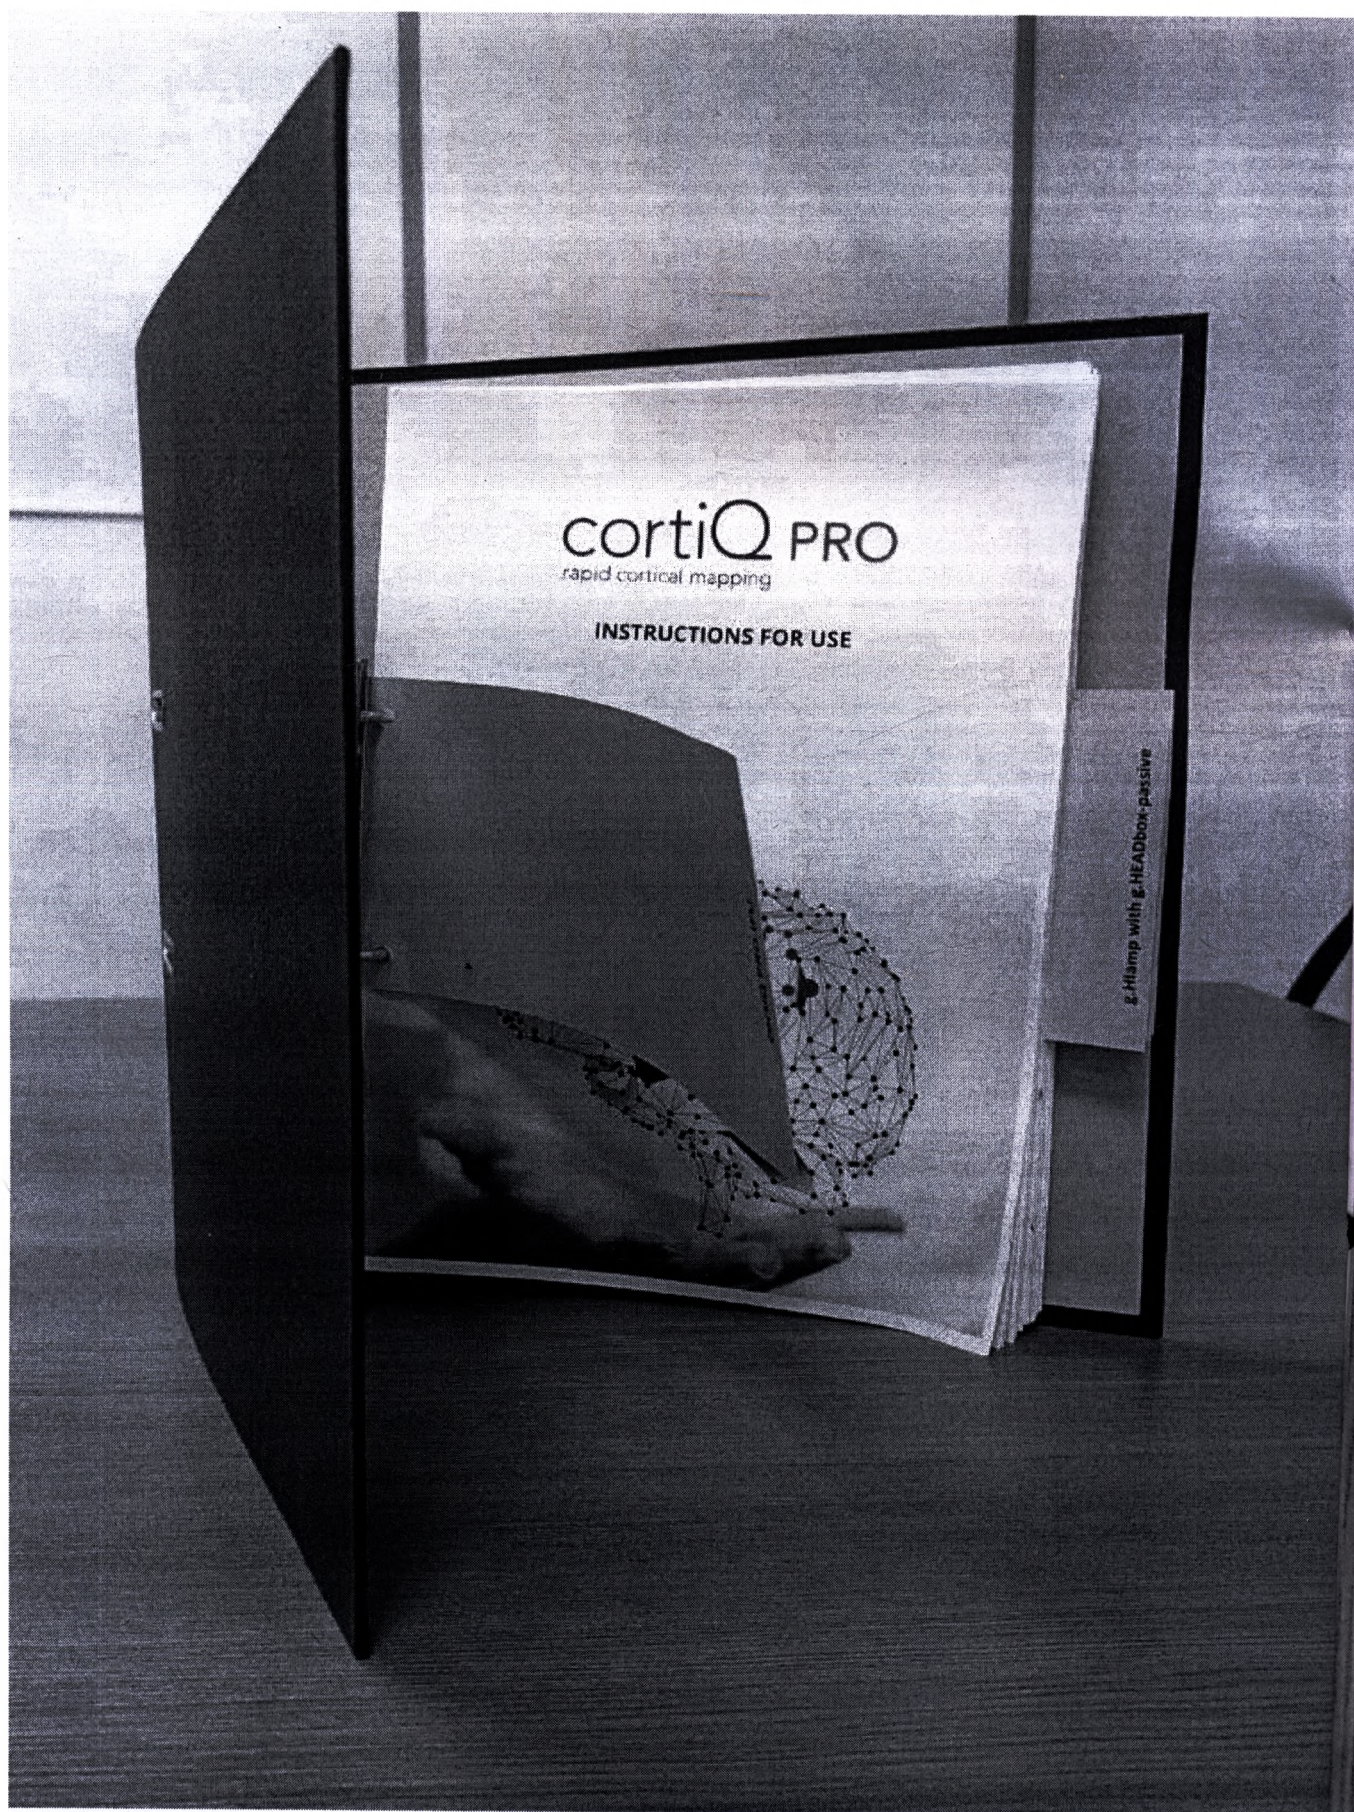


18. Руководство по использованию электродов и шапок




19. Руководство по использованию кортикальных электродов cortiQ



## 20. Руководство по использованию сенсоров и утилит

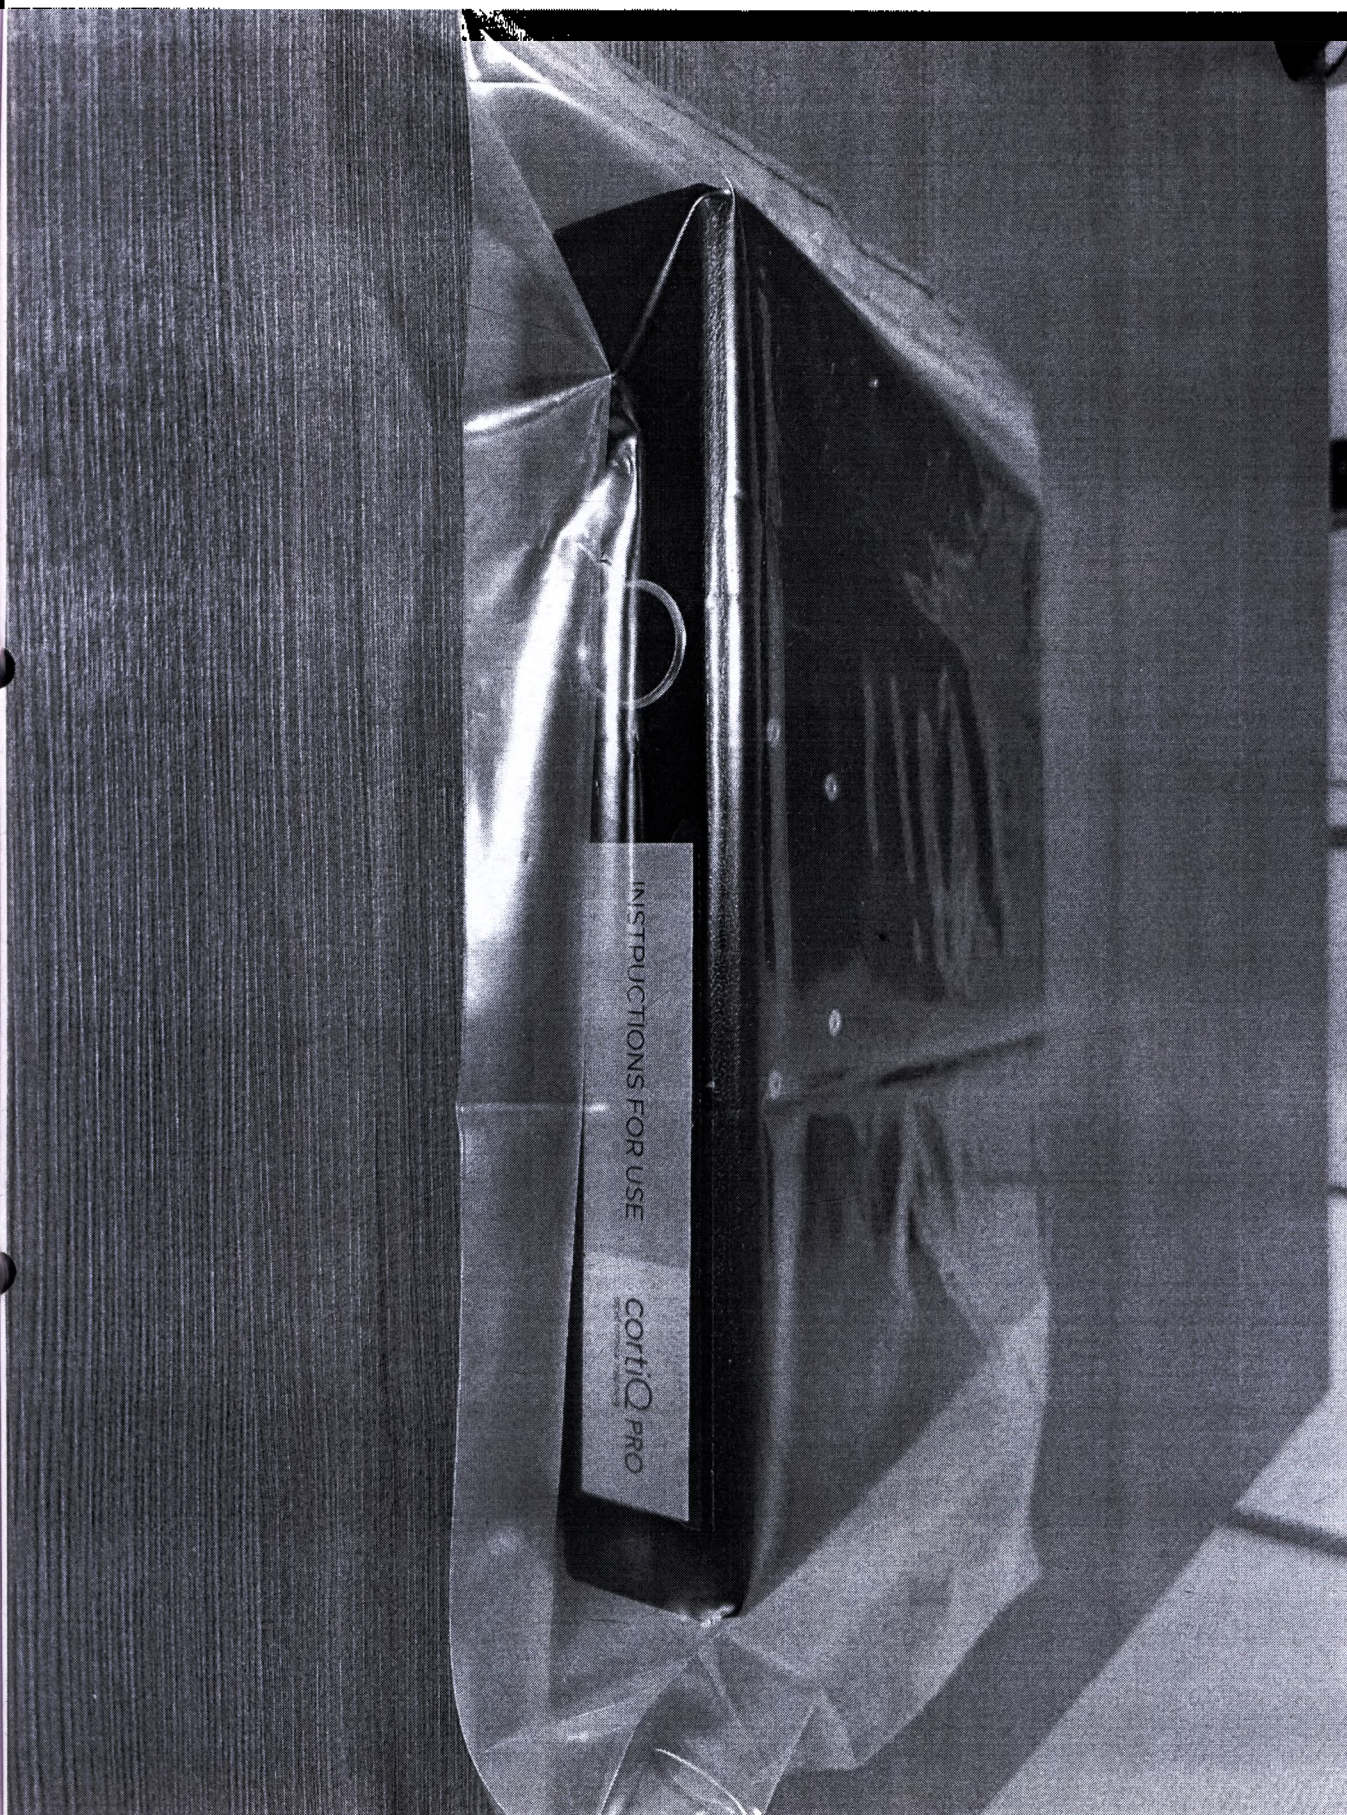

**21. Разделительный блок для подключения пассивных электродов на 64 канала, включая кабель соединительный (Фото 1-3)**

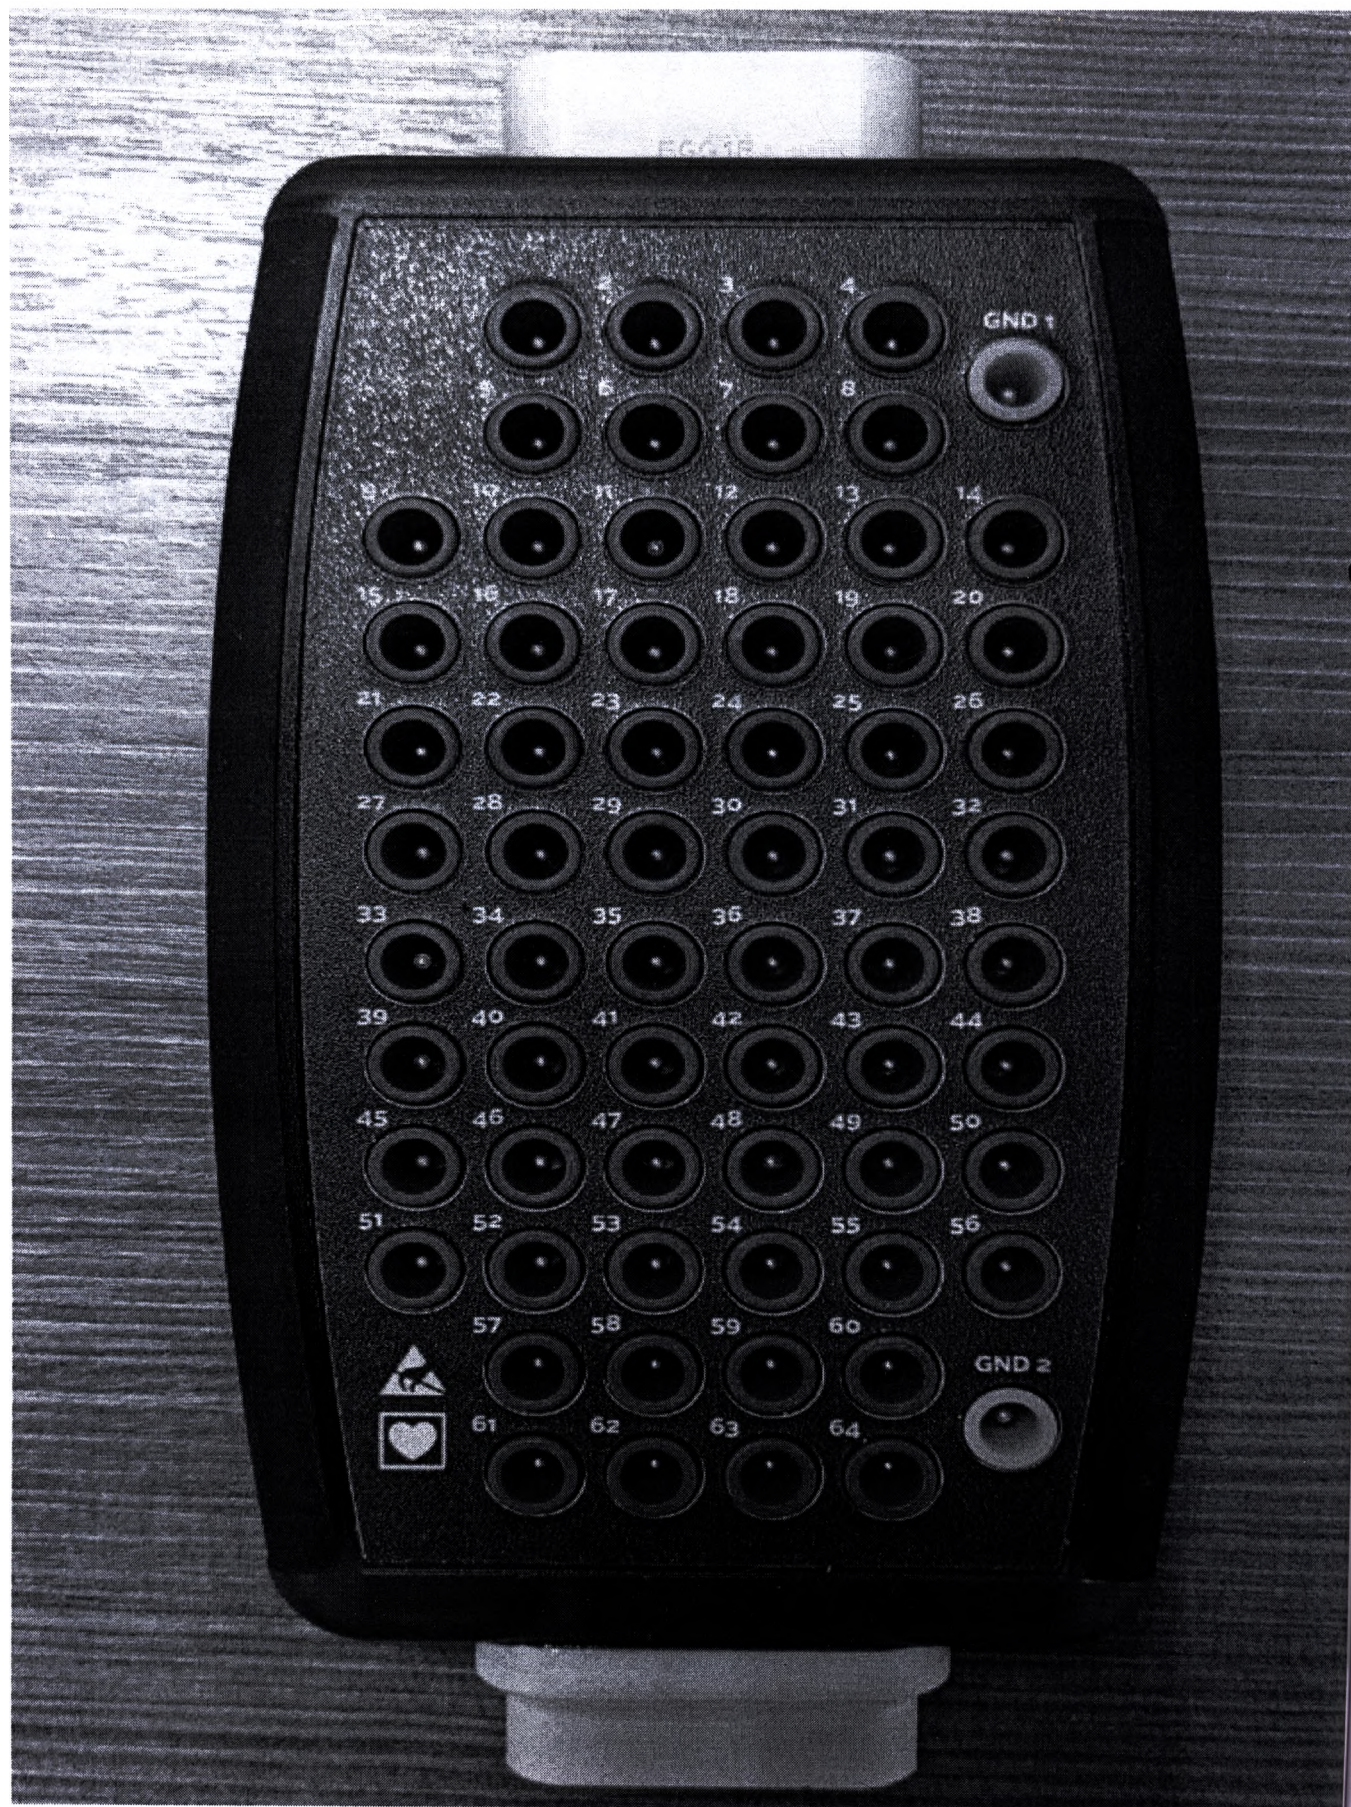

**Фото 1. Вид разделительного блока спереди.**




Фото 2. Вид разделительного блока сзади.




Фото 3. Кабель соединительный.

## Принадлежности


### 1. Кейс для переноски для усилителя

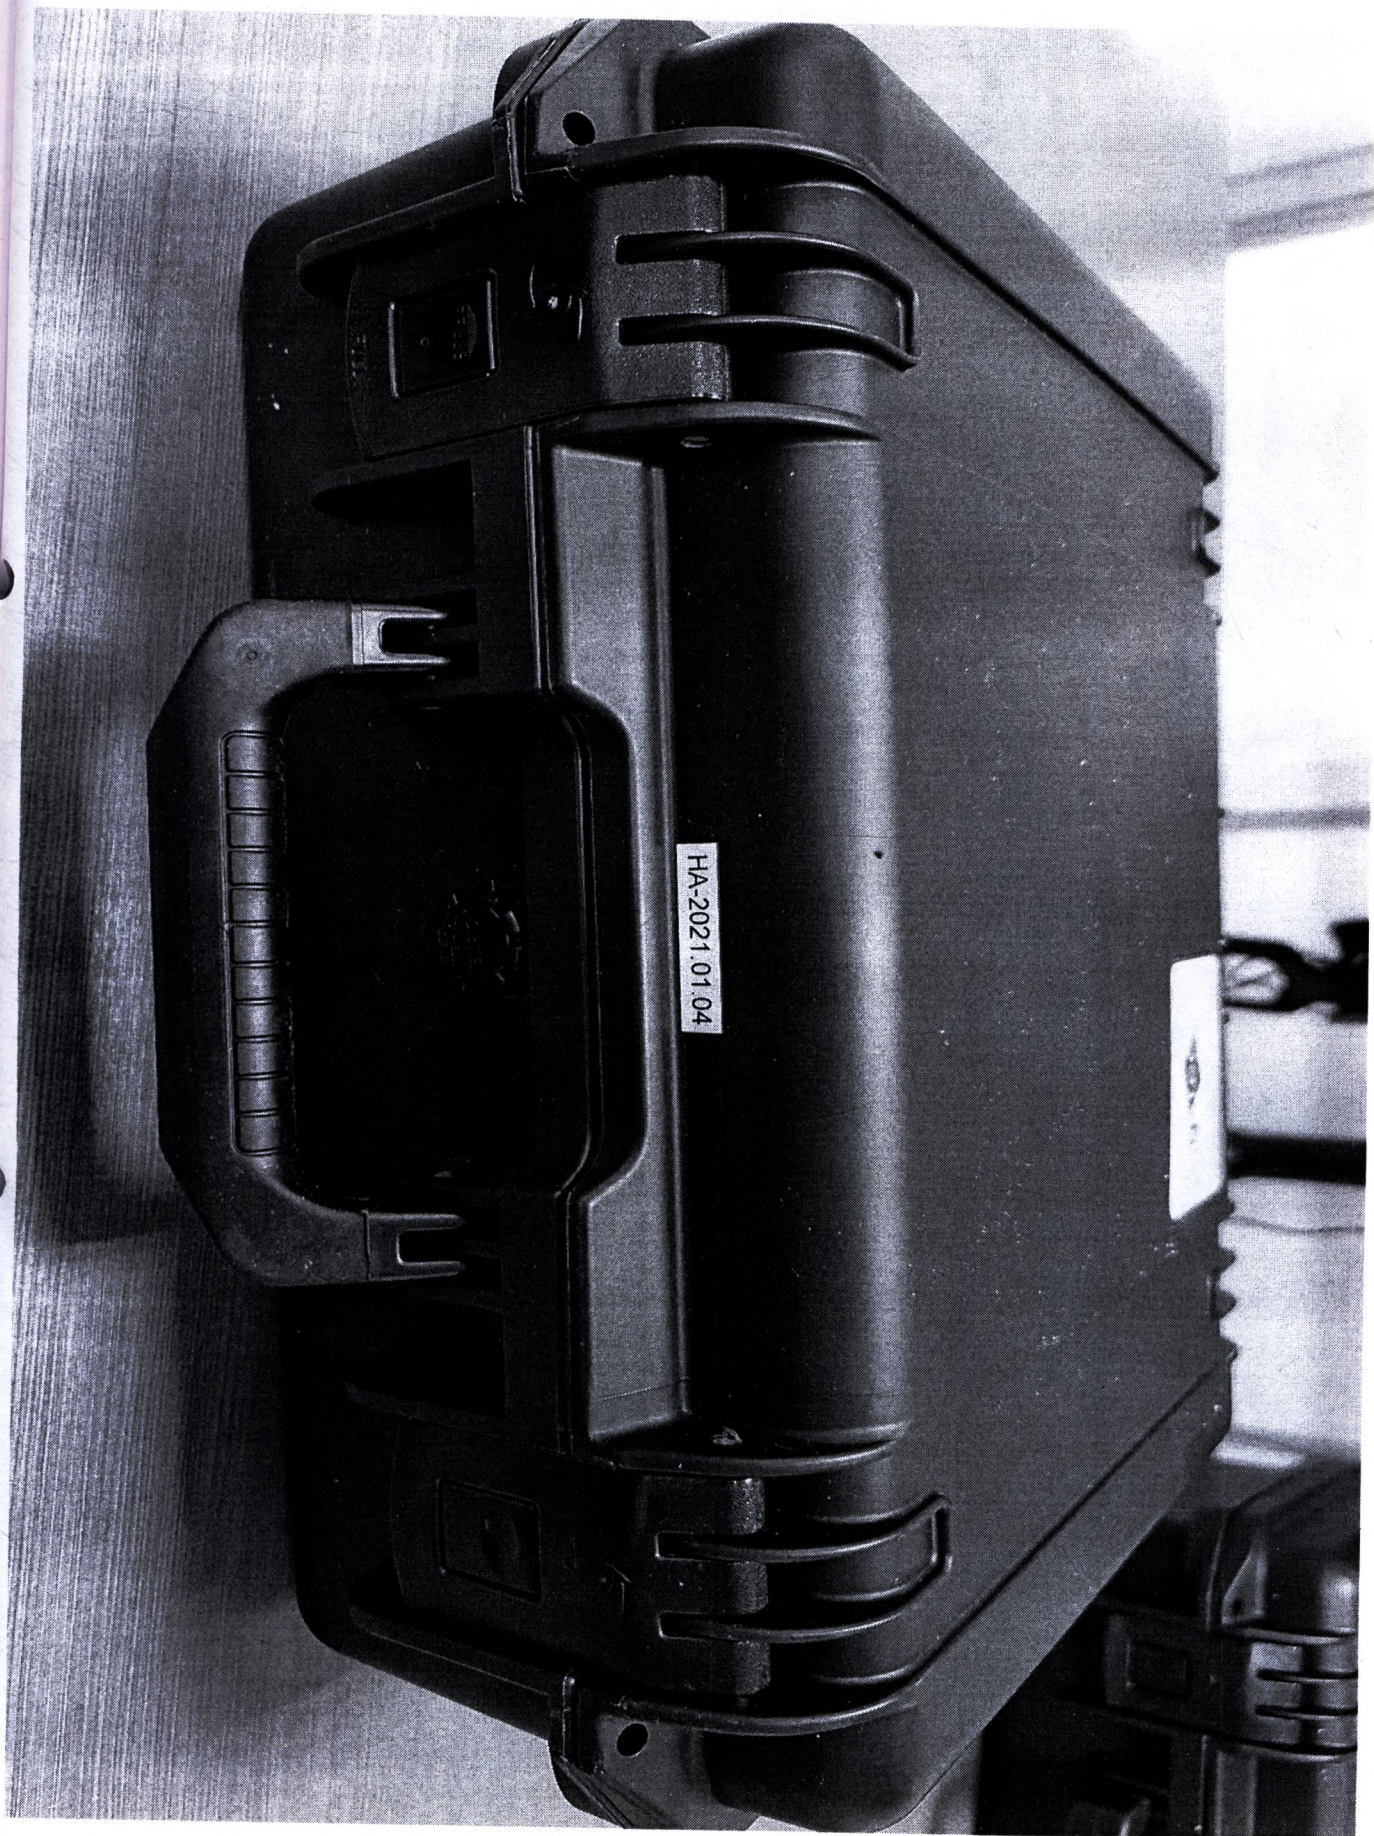

## 2. Кабель питания компьютера

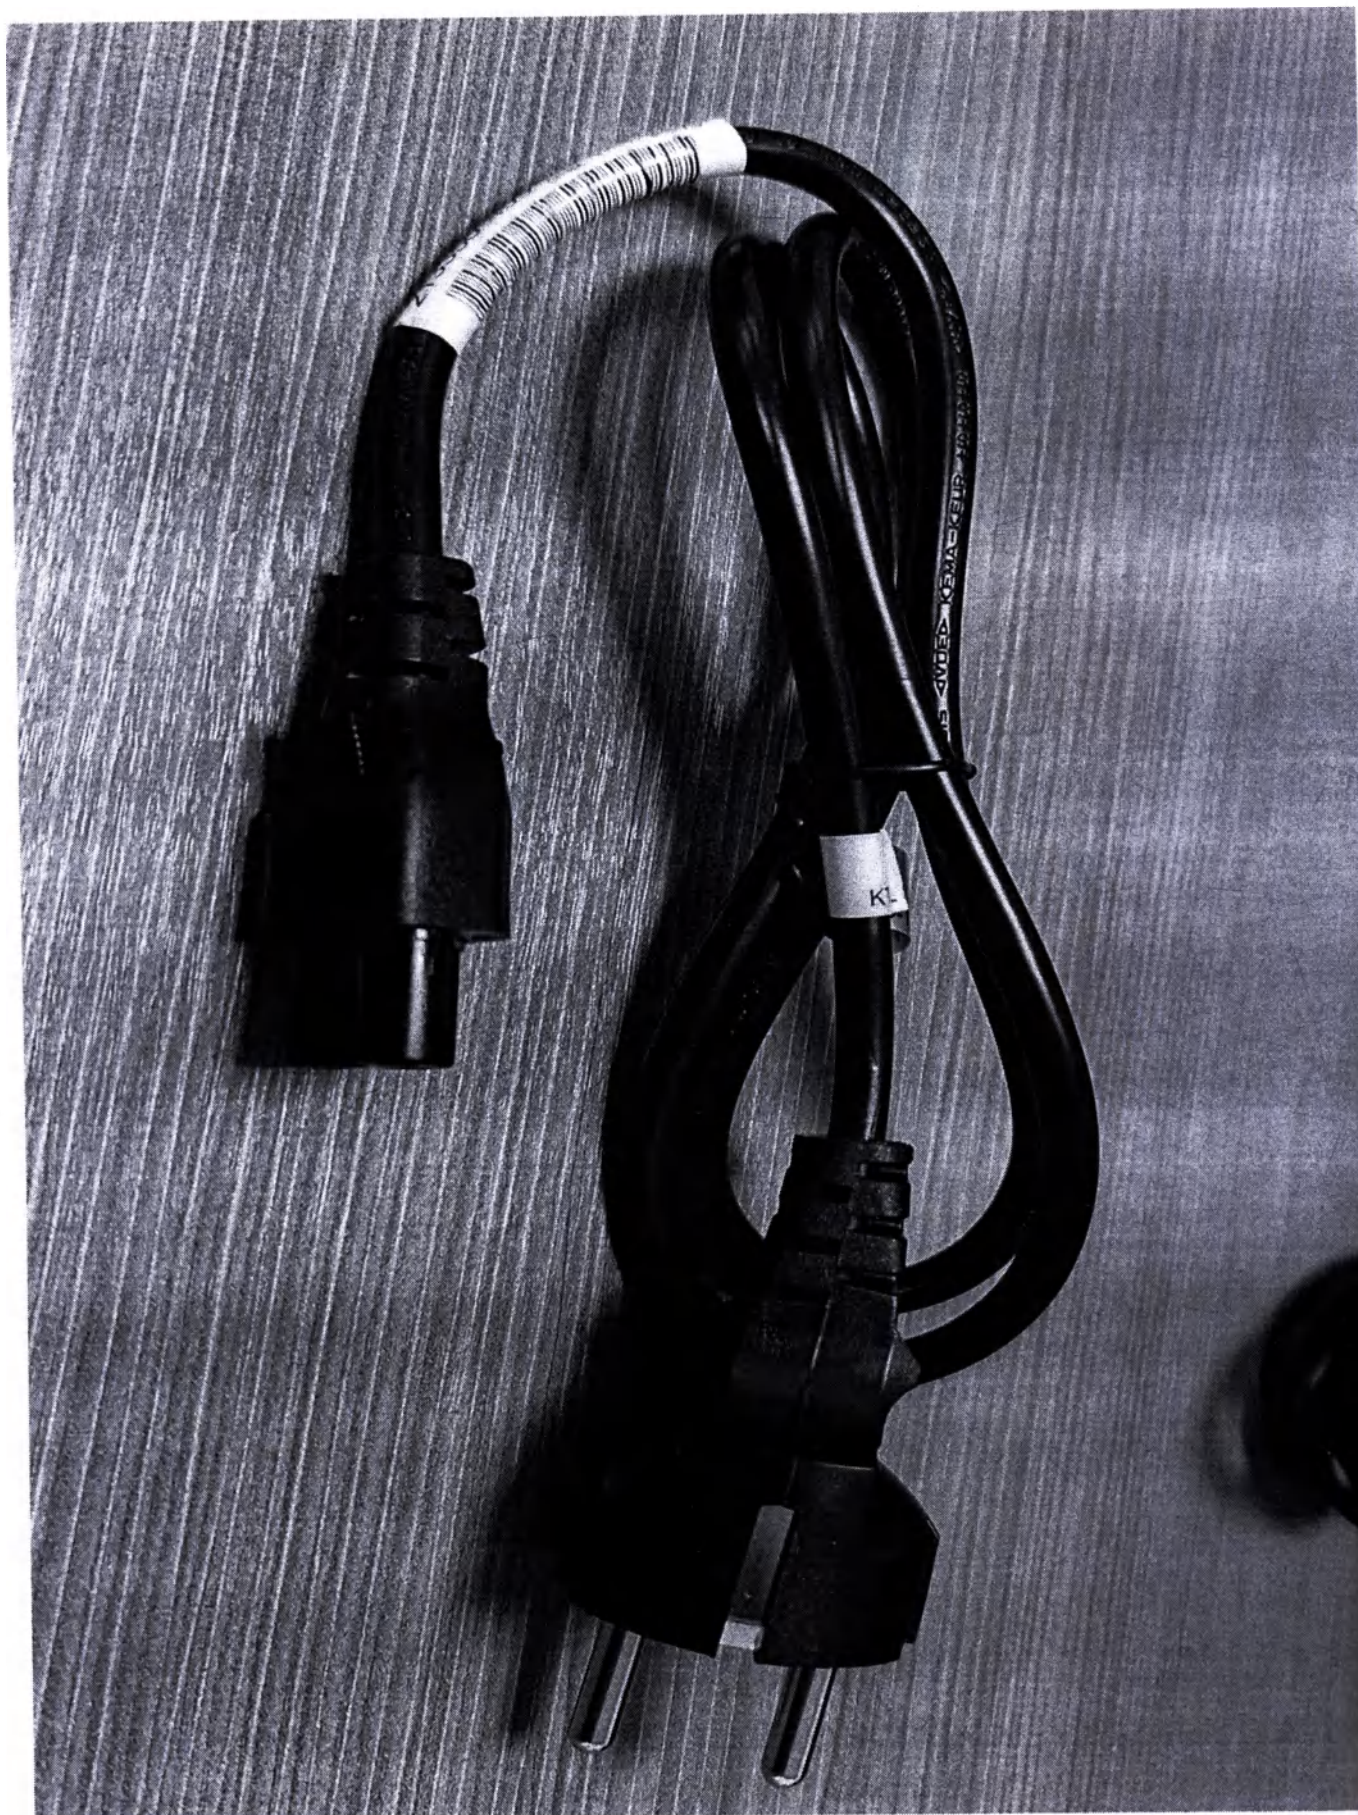

### 3. Кейс для переноски

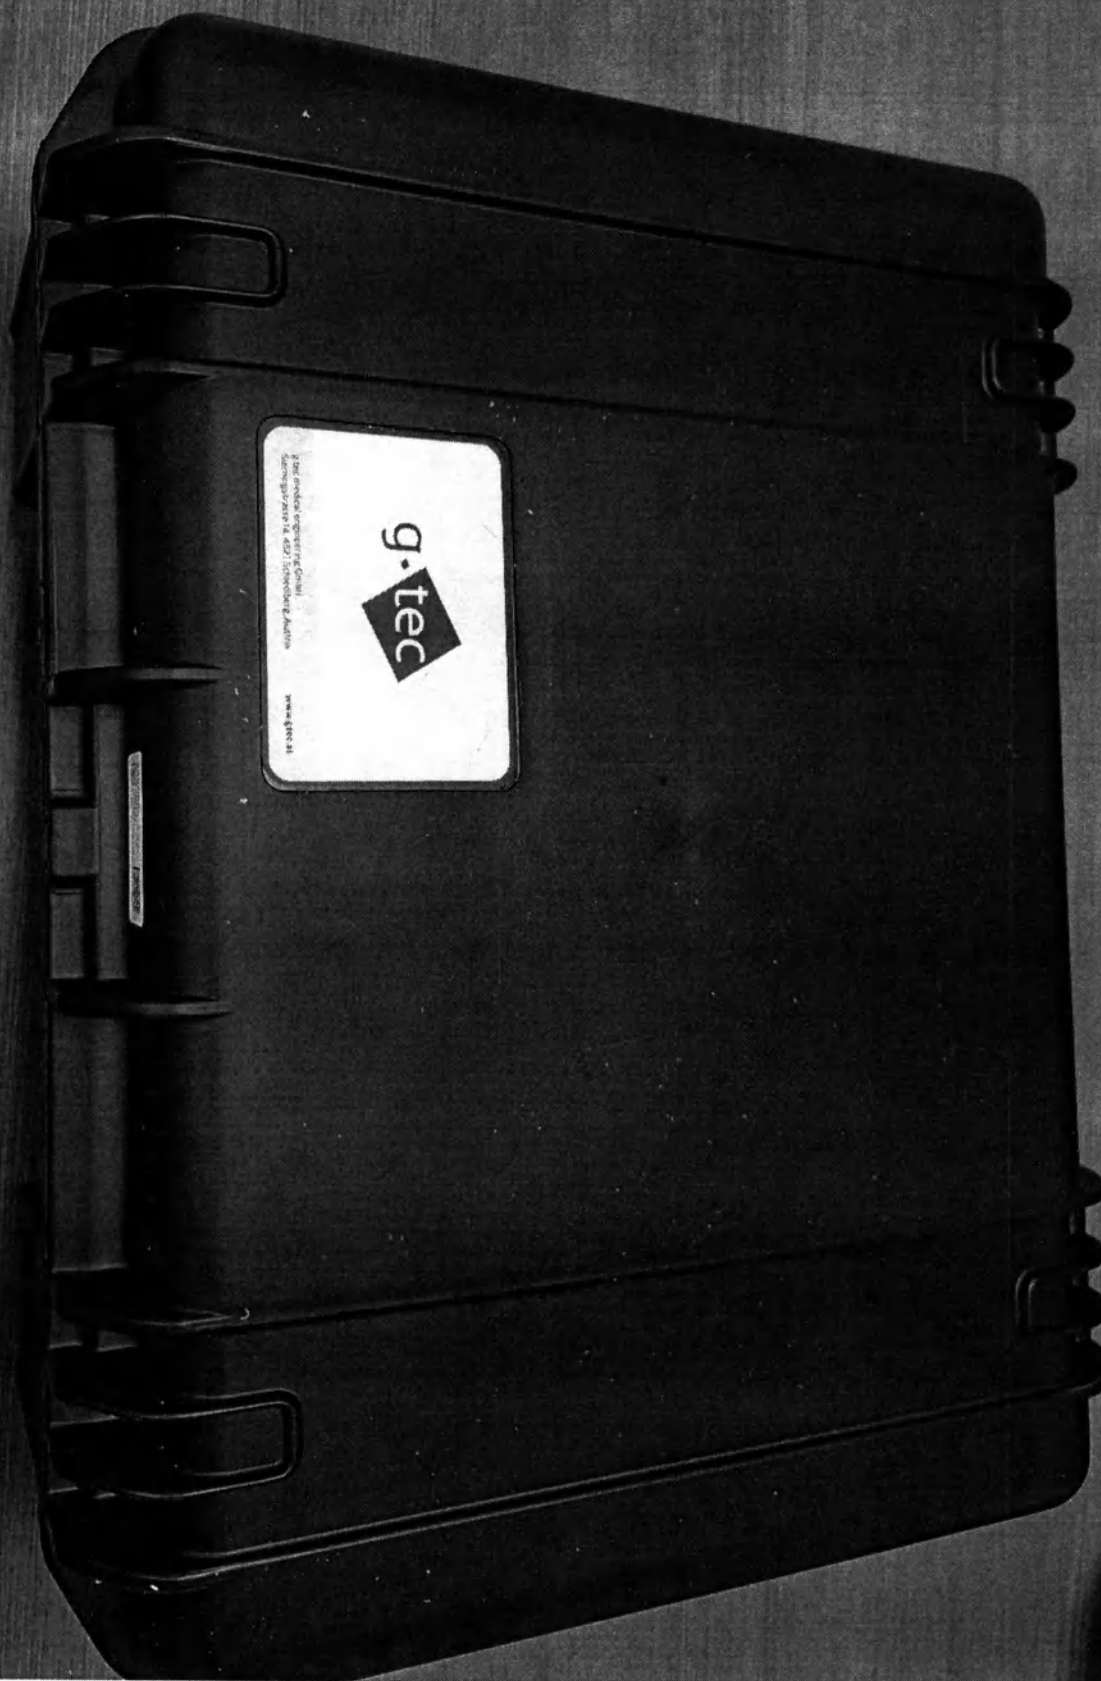

#### 4. Предохранитель запасной



Генеральный директор  
ООО «ИНФОМЕД»

\_\_\_\_\_/О.Н. Вязьмин/

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

19 (девятнадцать) листов  
цифрами прописью

Должность Главный директор

Подпись [подпись]

« 27 » декабря 20 21

