

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации

Пичугова Н.А.

2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Материал контрольный гематокрита Eurotrol (Eurotrol Hct Control)

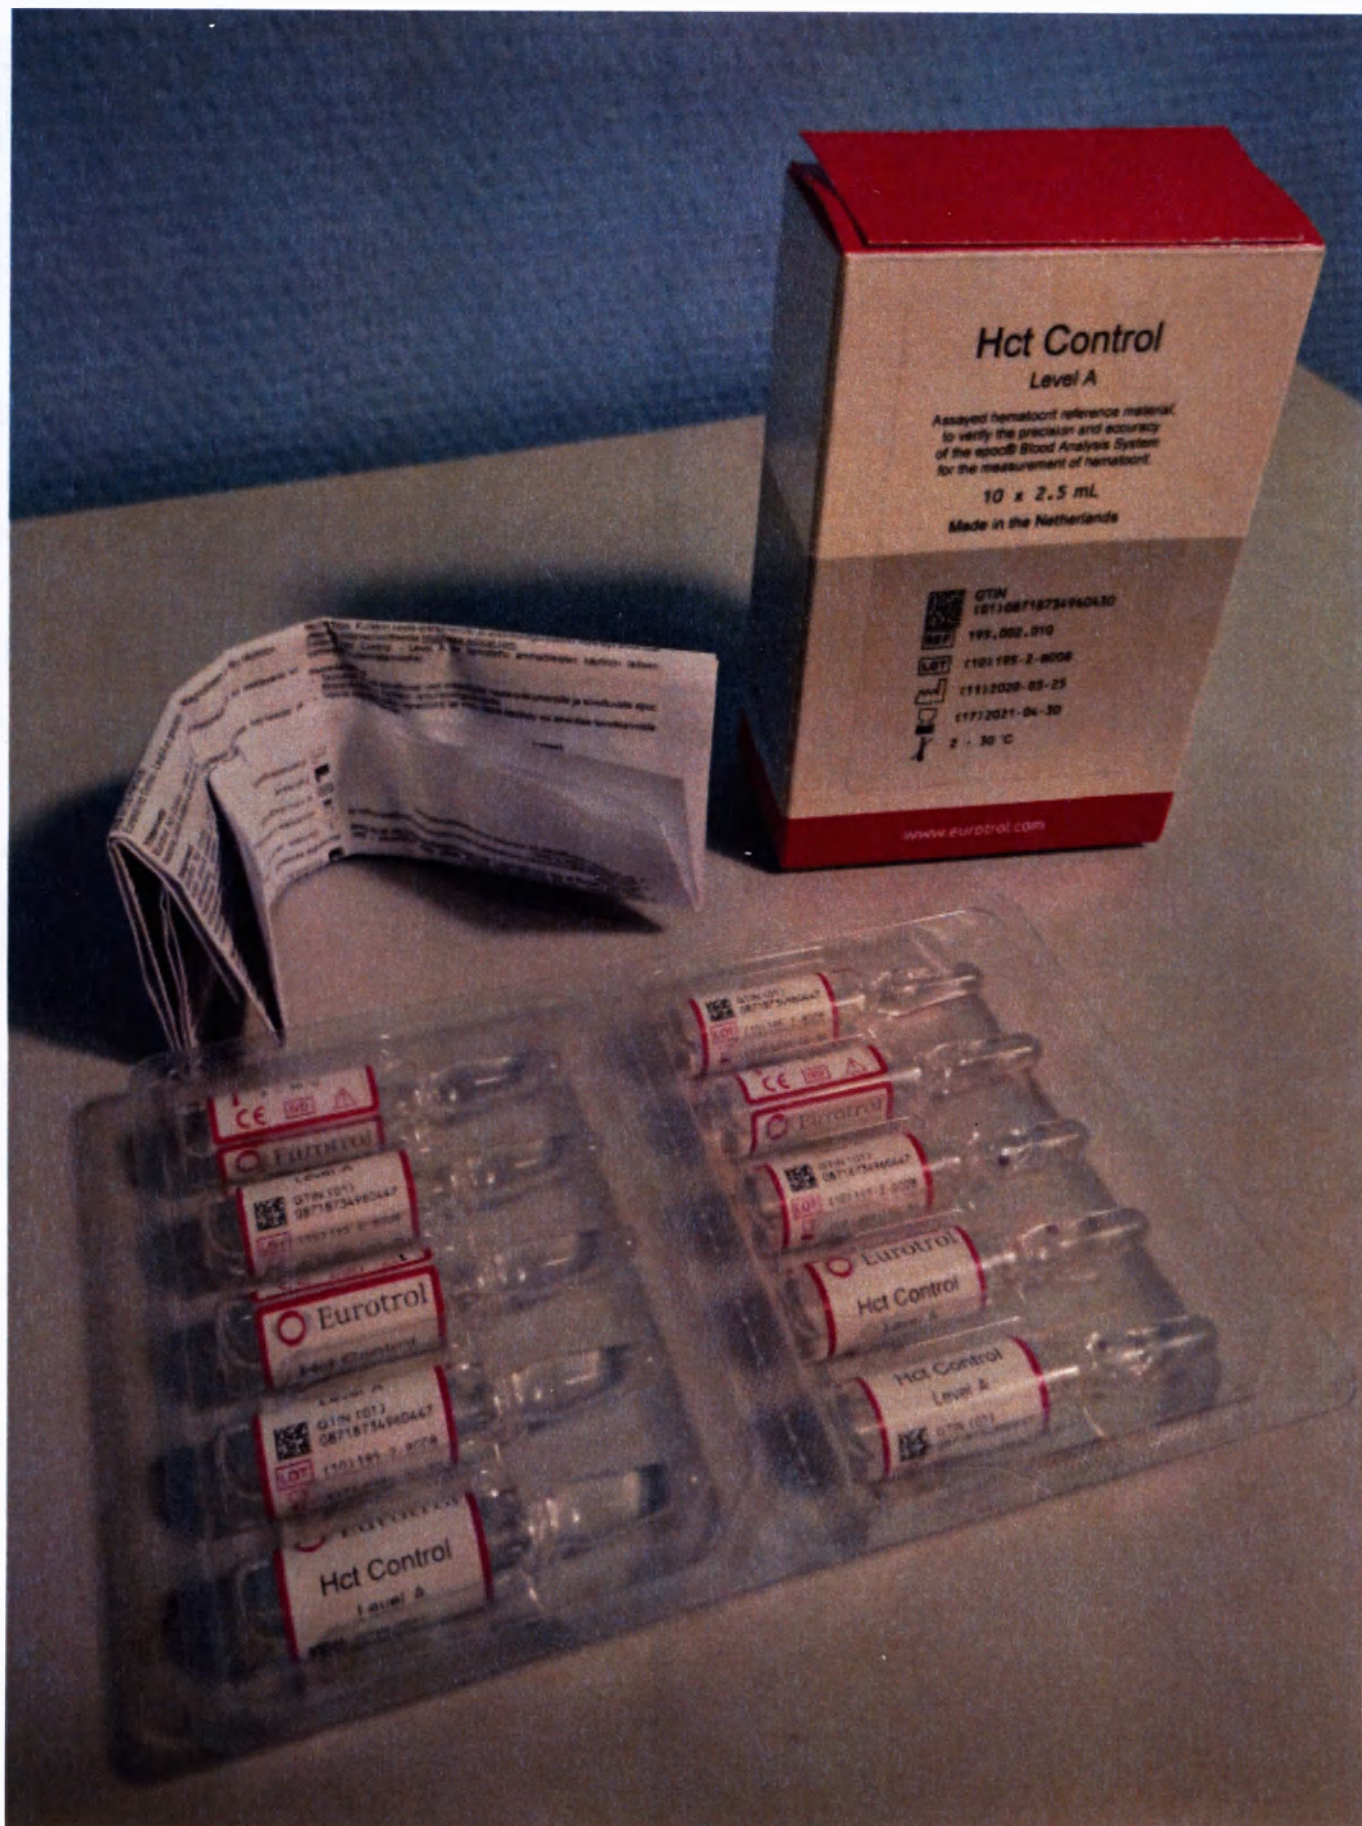


Рисунок 1 Вариант исполнения 1:

- Материал контрольный гематокрита Eurotrol (Eurotrol Hct Control) – Уровень А – 10 ампул по 2, 5 мл.
- Инструкция по применению

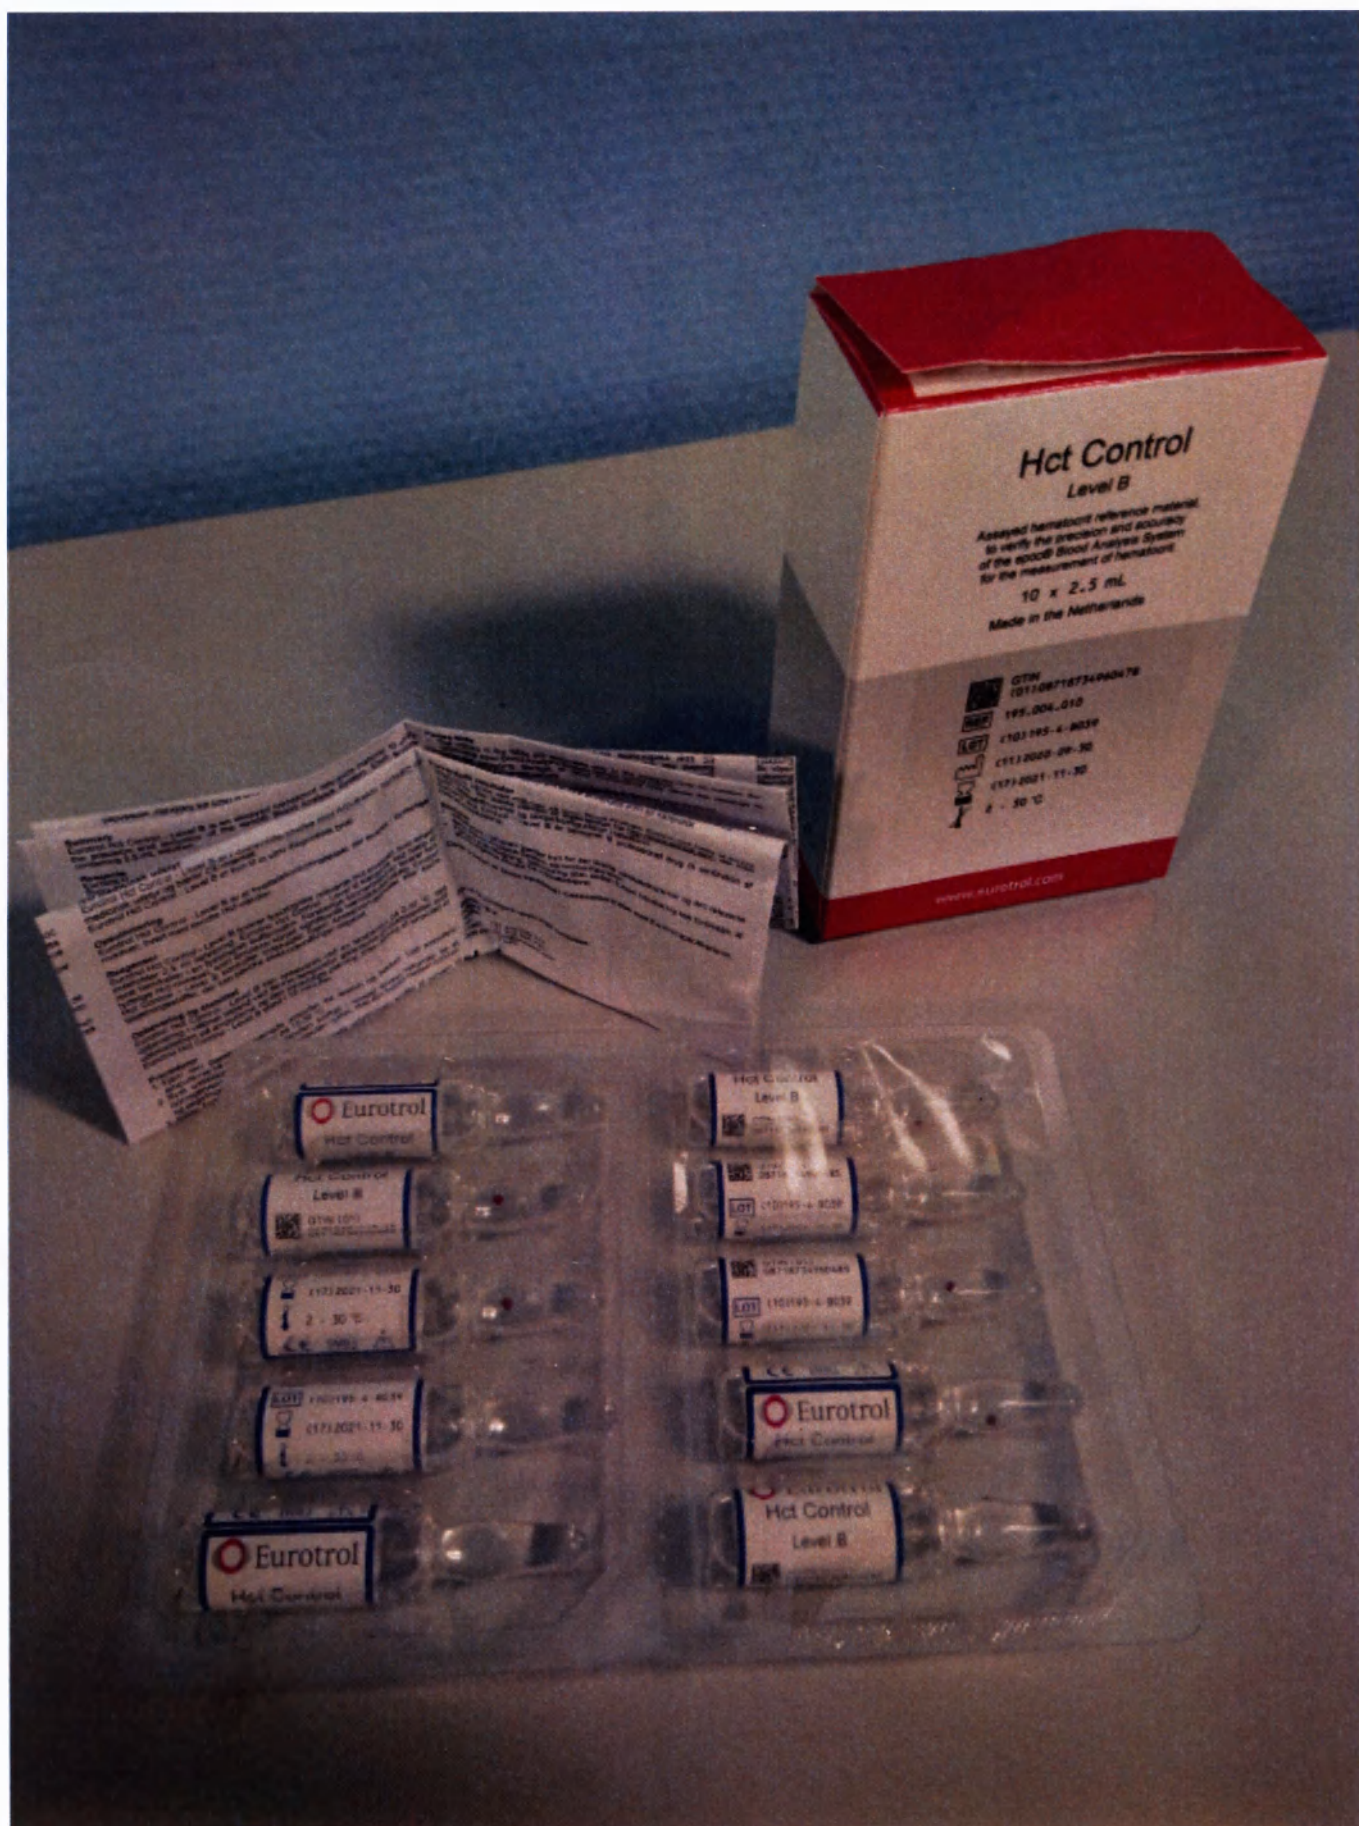


Рисунок 2 Вариант исполнения 2:

- Материал контрольный гематокрита Eurotrol (Eurotrol Hct Control) – Уровень В – 10 ампул по 2, 5 мл.
- Инструкция по применению

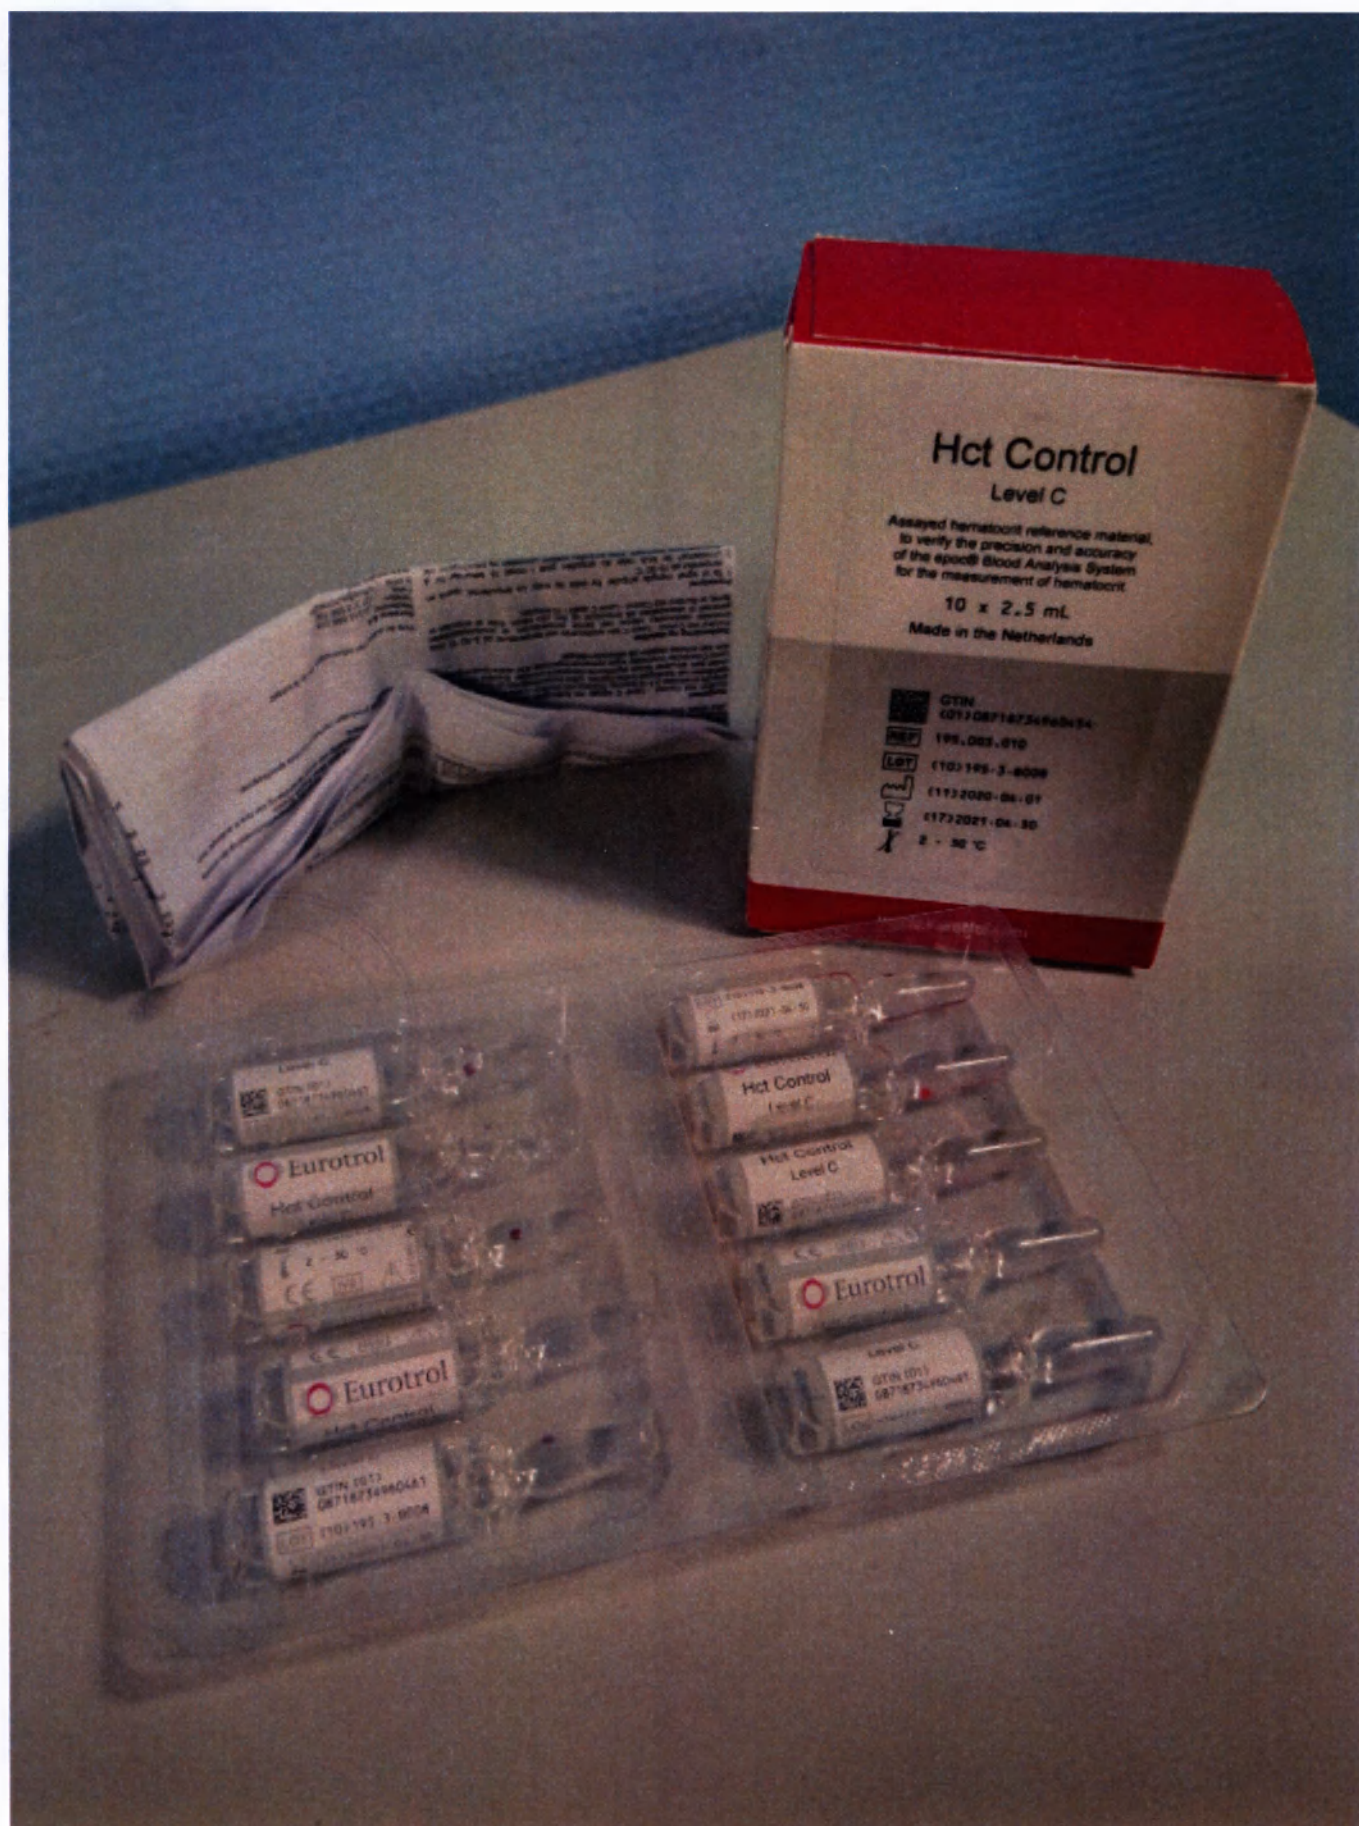


Рисунок 3 Вариант исполнения 3:

- Материал контрольный гематокрита Eurotrol (Eurotrol Hct Control) – Уровень С – 10 ампул по 2, 5 мл.
- Инструкция по применению



Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

