


**Фотографические изображения общего вида**


**Набор контролей «Alinity m HCV CTRL Kit» для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m**

В состав наборов входят следующие компоненты:

Набор пробирок с отрицательным контролем (1,15 мл)

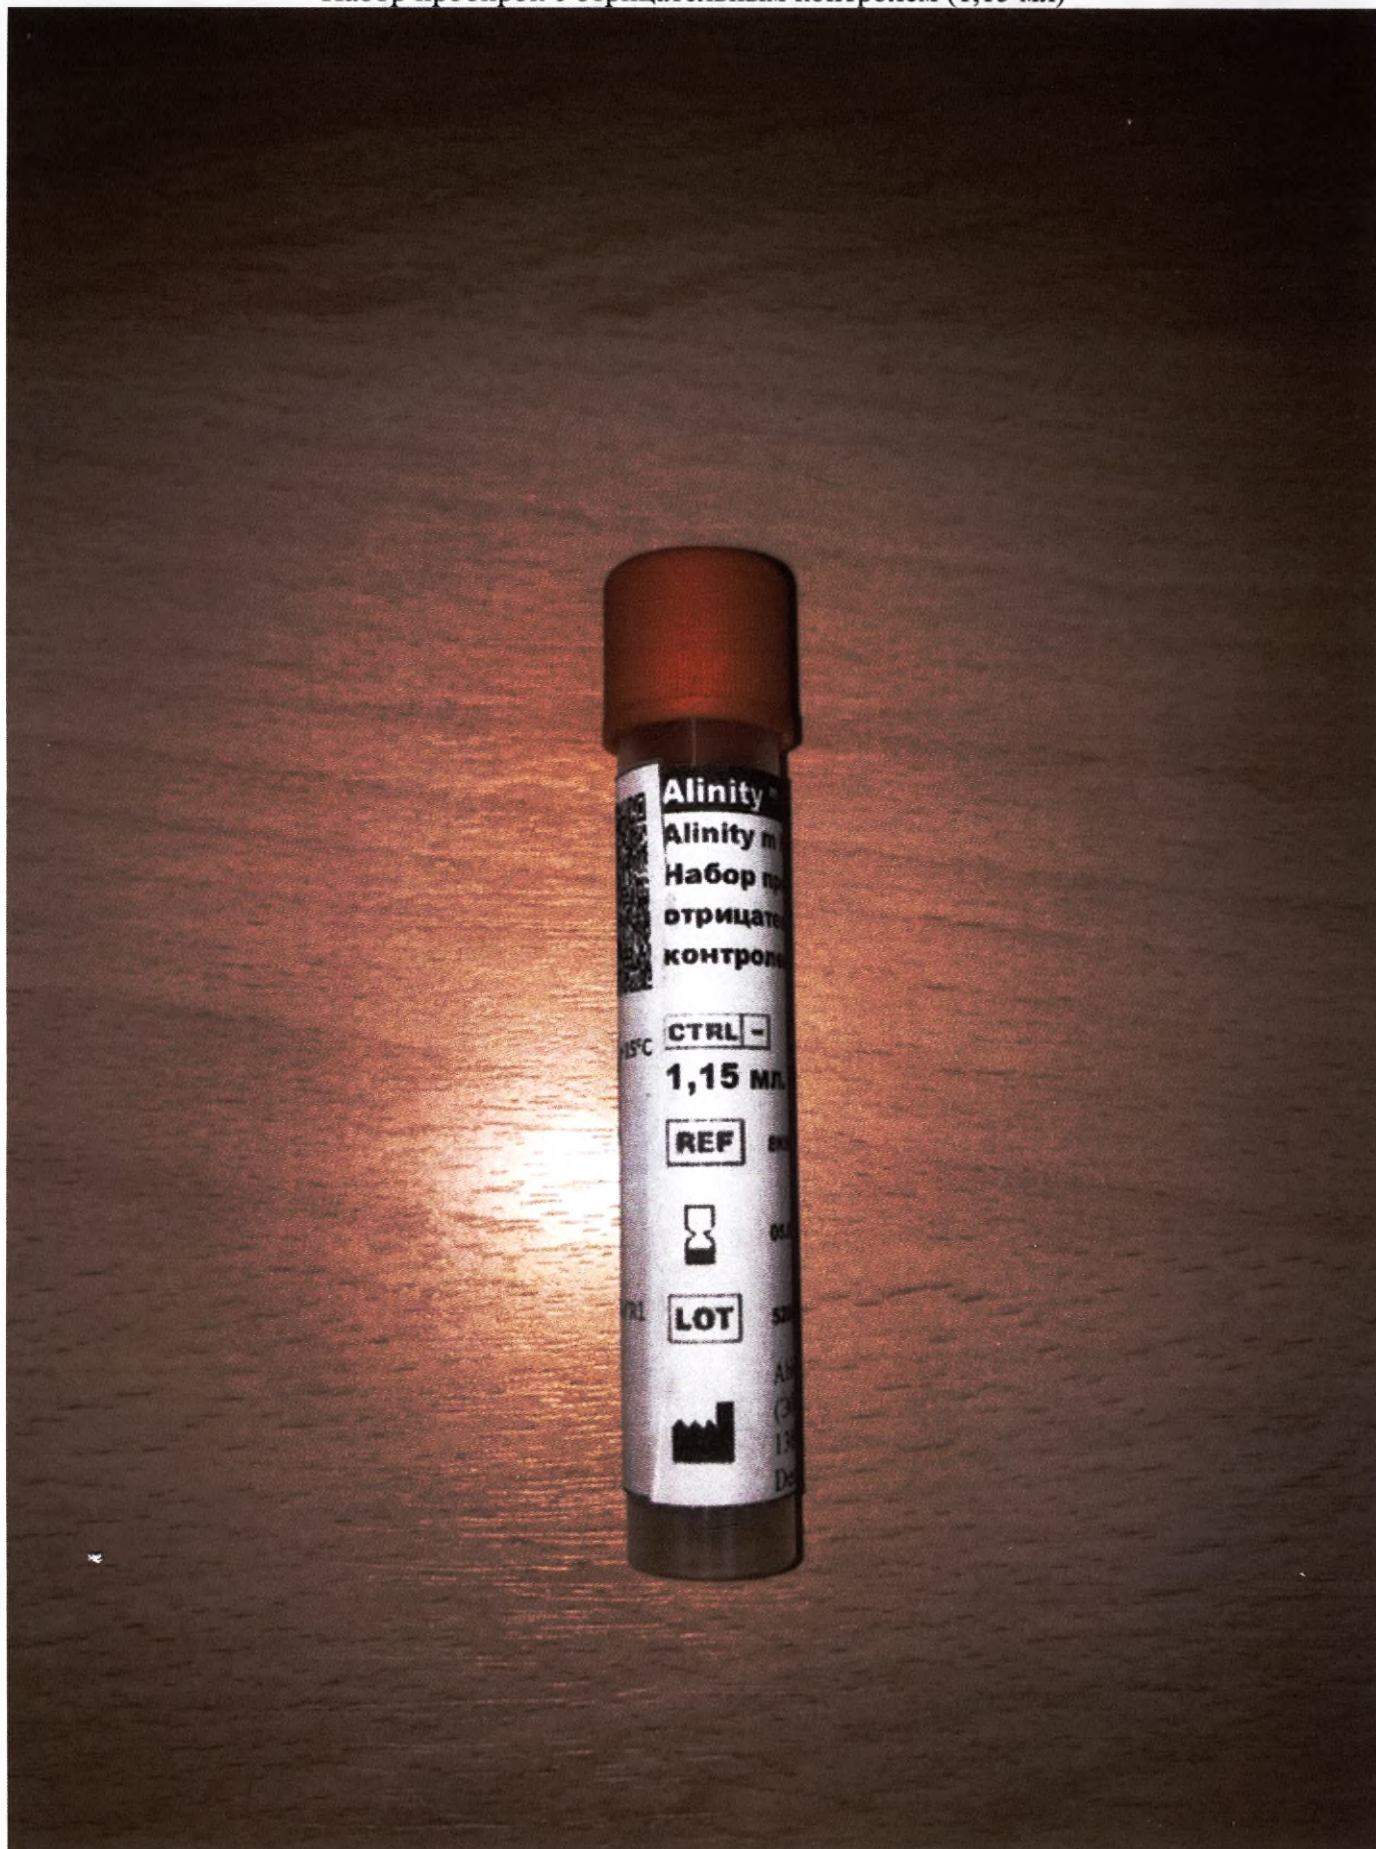


.Набор пробирок с положительным контролем с низкой концентрацией (0,75 мл.)

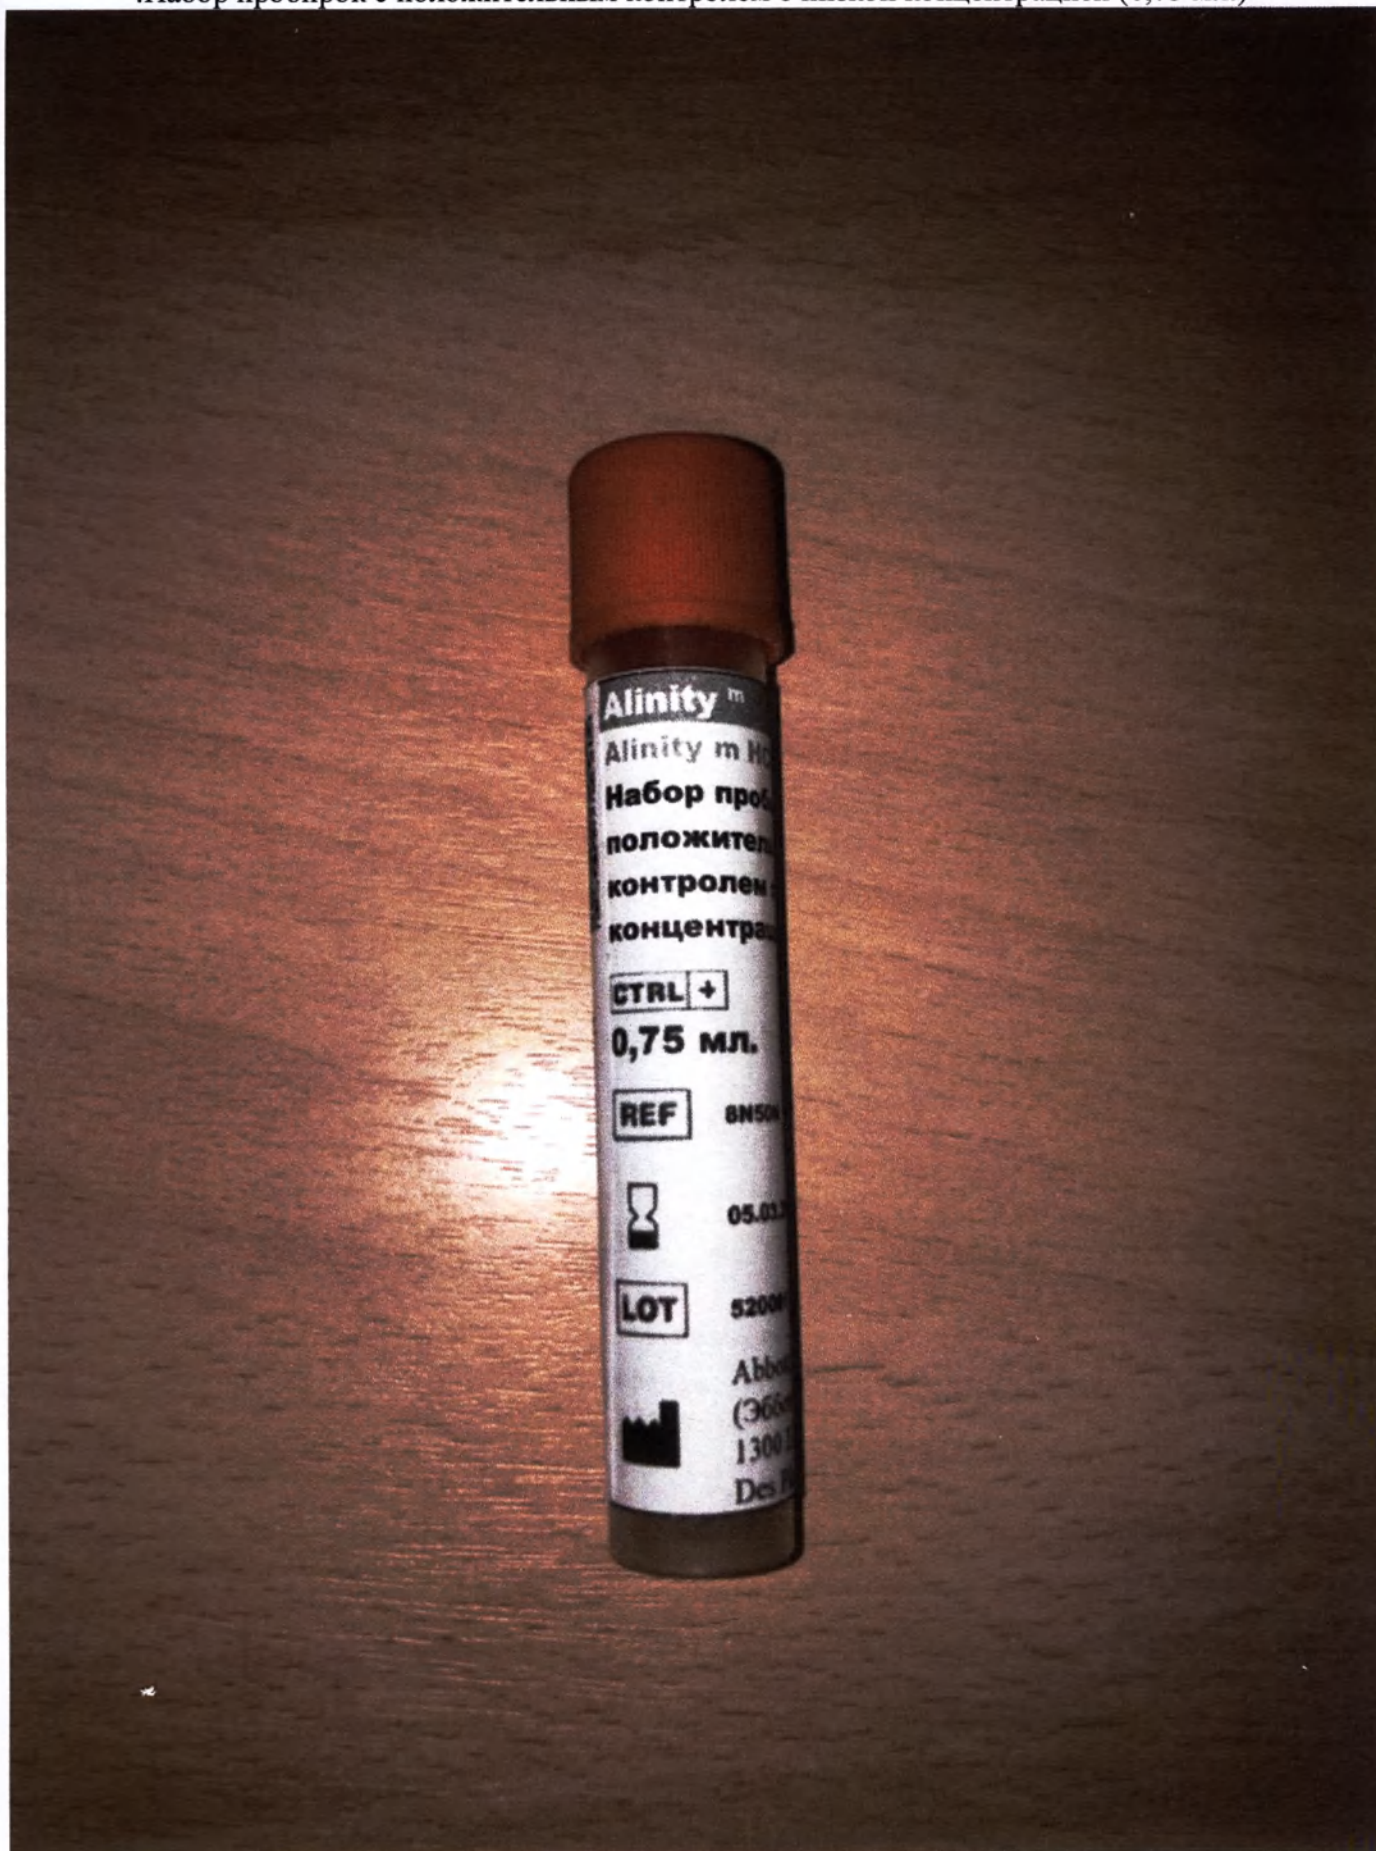



Набор контролей «Alinity m HCV CTRL Kit» для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m с компонентами

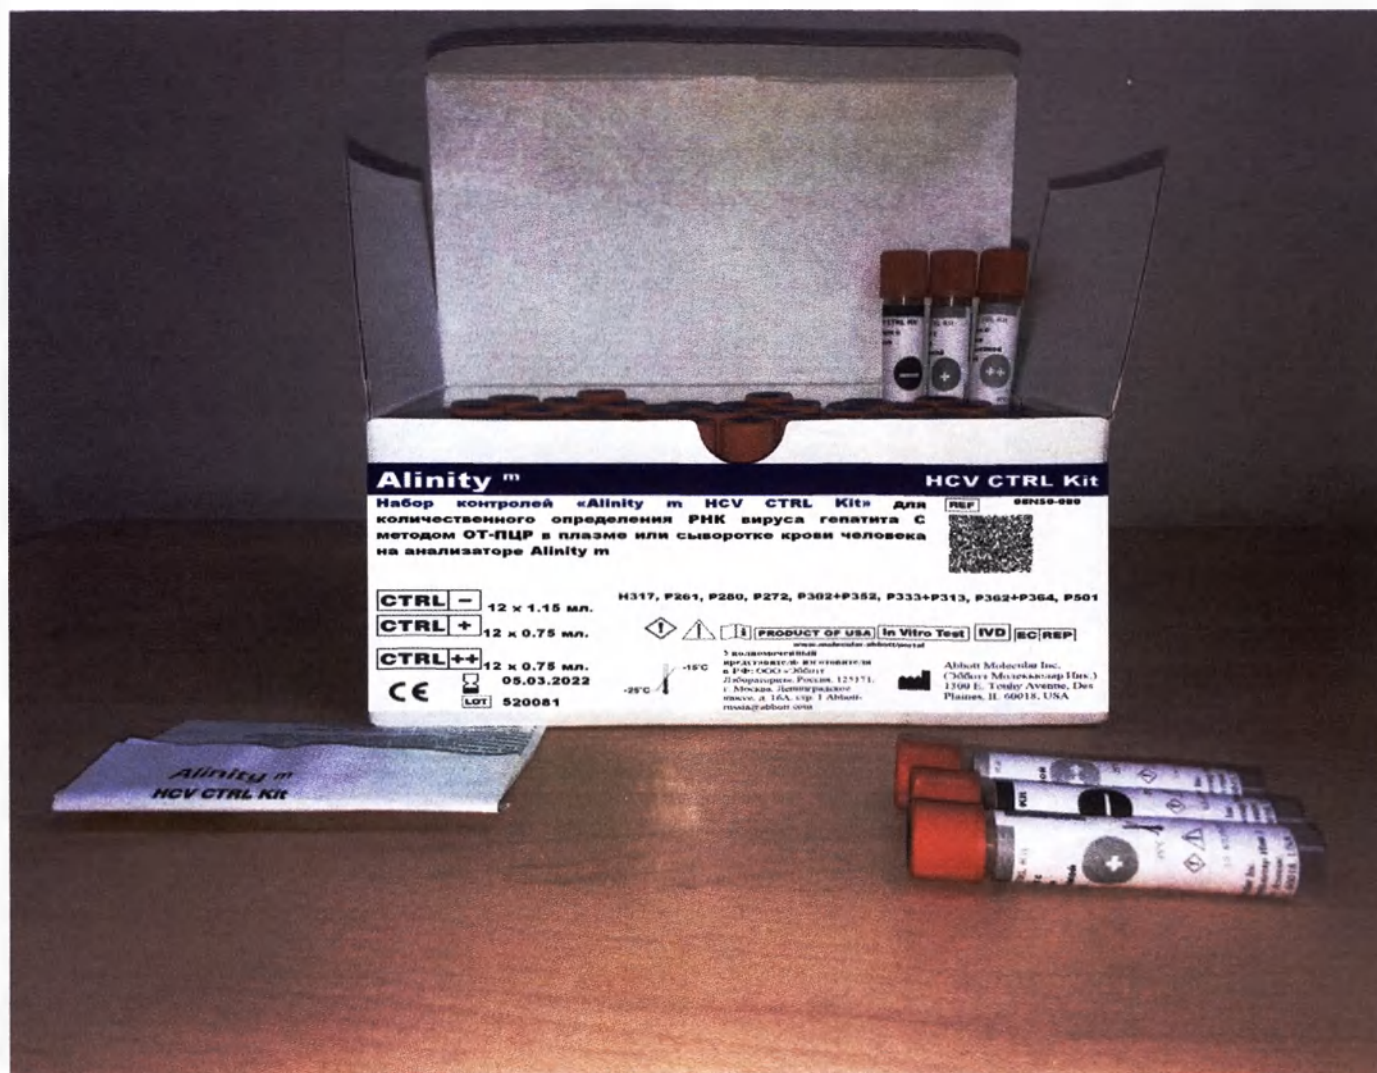


Руководитель Подразделения Молекулярной  
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»

Е.Р. Конишева

Сшито и заверено печатью 5  
( ) лист

Руководитель Подразделения Молекулярной  
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэборатори»  
Конишева Е.Р.

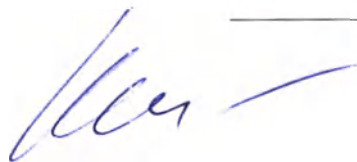

**Макет маркировки «Набор контролей «Alinity m HIV-1 CTRL Kit» для  
количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ОТ-ПЦР в плазме и  
сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m.»**

### Набор пробирок с отрицательным контролем (1,15 мл)

**Набор пробирок с положительным контролем с низкой концентрацией (0,75 мл)**

The image shows the front of the Abbott Alinity m HCV CTRL Kit box. The box is white with a large blue 'Alinity m' logo at the top. Below it, 'Alinity m HCV CTRL Kit' is written in blue. The Russian text 'Набор пробирок с положительным контролем с низкой концентрацией' (Kit of tubes with positive control with low concentration) is printed in black. A blue 'CTRL+' label is visible. The volume '0,75 мл.' (0.75 ml) is printed in large black digits. A green circle with a white cross is on the right. Below it, a thermometer icon indicates storage temperatures of '-15°C' and '-25°C'. At the bottom, there is a 'REF' label with the number '8N50N', a barcode, and two warning symbols (exclamation mark and biohazard). The 'LOT' label shows 'XXXXXX'. The manufacturer's name 'Abbott Molecular Inc.' and address '1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018 USA' are at the bottom.

## Набор пробирок с положительным контролем с высокой концентрацией (0,75 мл)

**Alinity™**  
**Alinity m HCV CTRL Kit**  
**Набор пробирок с**  
**положительным**  
**контролем с высокой**  
**концентрацией**  
**CTRL++**  
**0,75 мл.**

**REF** 8N47X

**LOT** XXXXXX

Abbott Molecular Inc.  
(Эбботт Молекулар Инк.)  
1300 E. Touhy Avenue,  
Des Plaines, IL 60018, USA

XX.XX.XXXX

53-602036/R1

-25°C

-15°C

++

Сшито и заверено печатью \_\_\_\_\_  
( 2 ) лист \_\_\_\_\_

Руководитель Подразделения Молекулярн  
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэб  
Коничева Е.Р.

