

Фотографическое изображение медицинского изделия


**«Анализатор гематологический автоматический, в вариантах исполнения
МЕК-1301, МЕК-1302, МЕК-1305»**

**производства NIHON KONDEN CORPORATION (Нихон Кодэн Корпорейшн),
Япония**

...нализатор гематологический автоматический МЕК-1301, в составе:
1. Анализатор гематологический автоматический МЕК-1301, общий вид



Анализатор гематологический автоматический МЕК-1301, вид справа

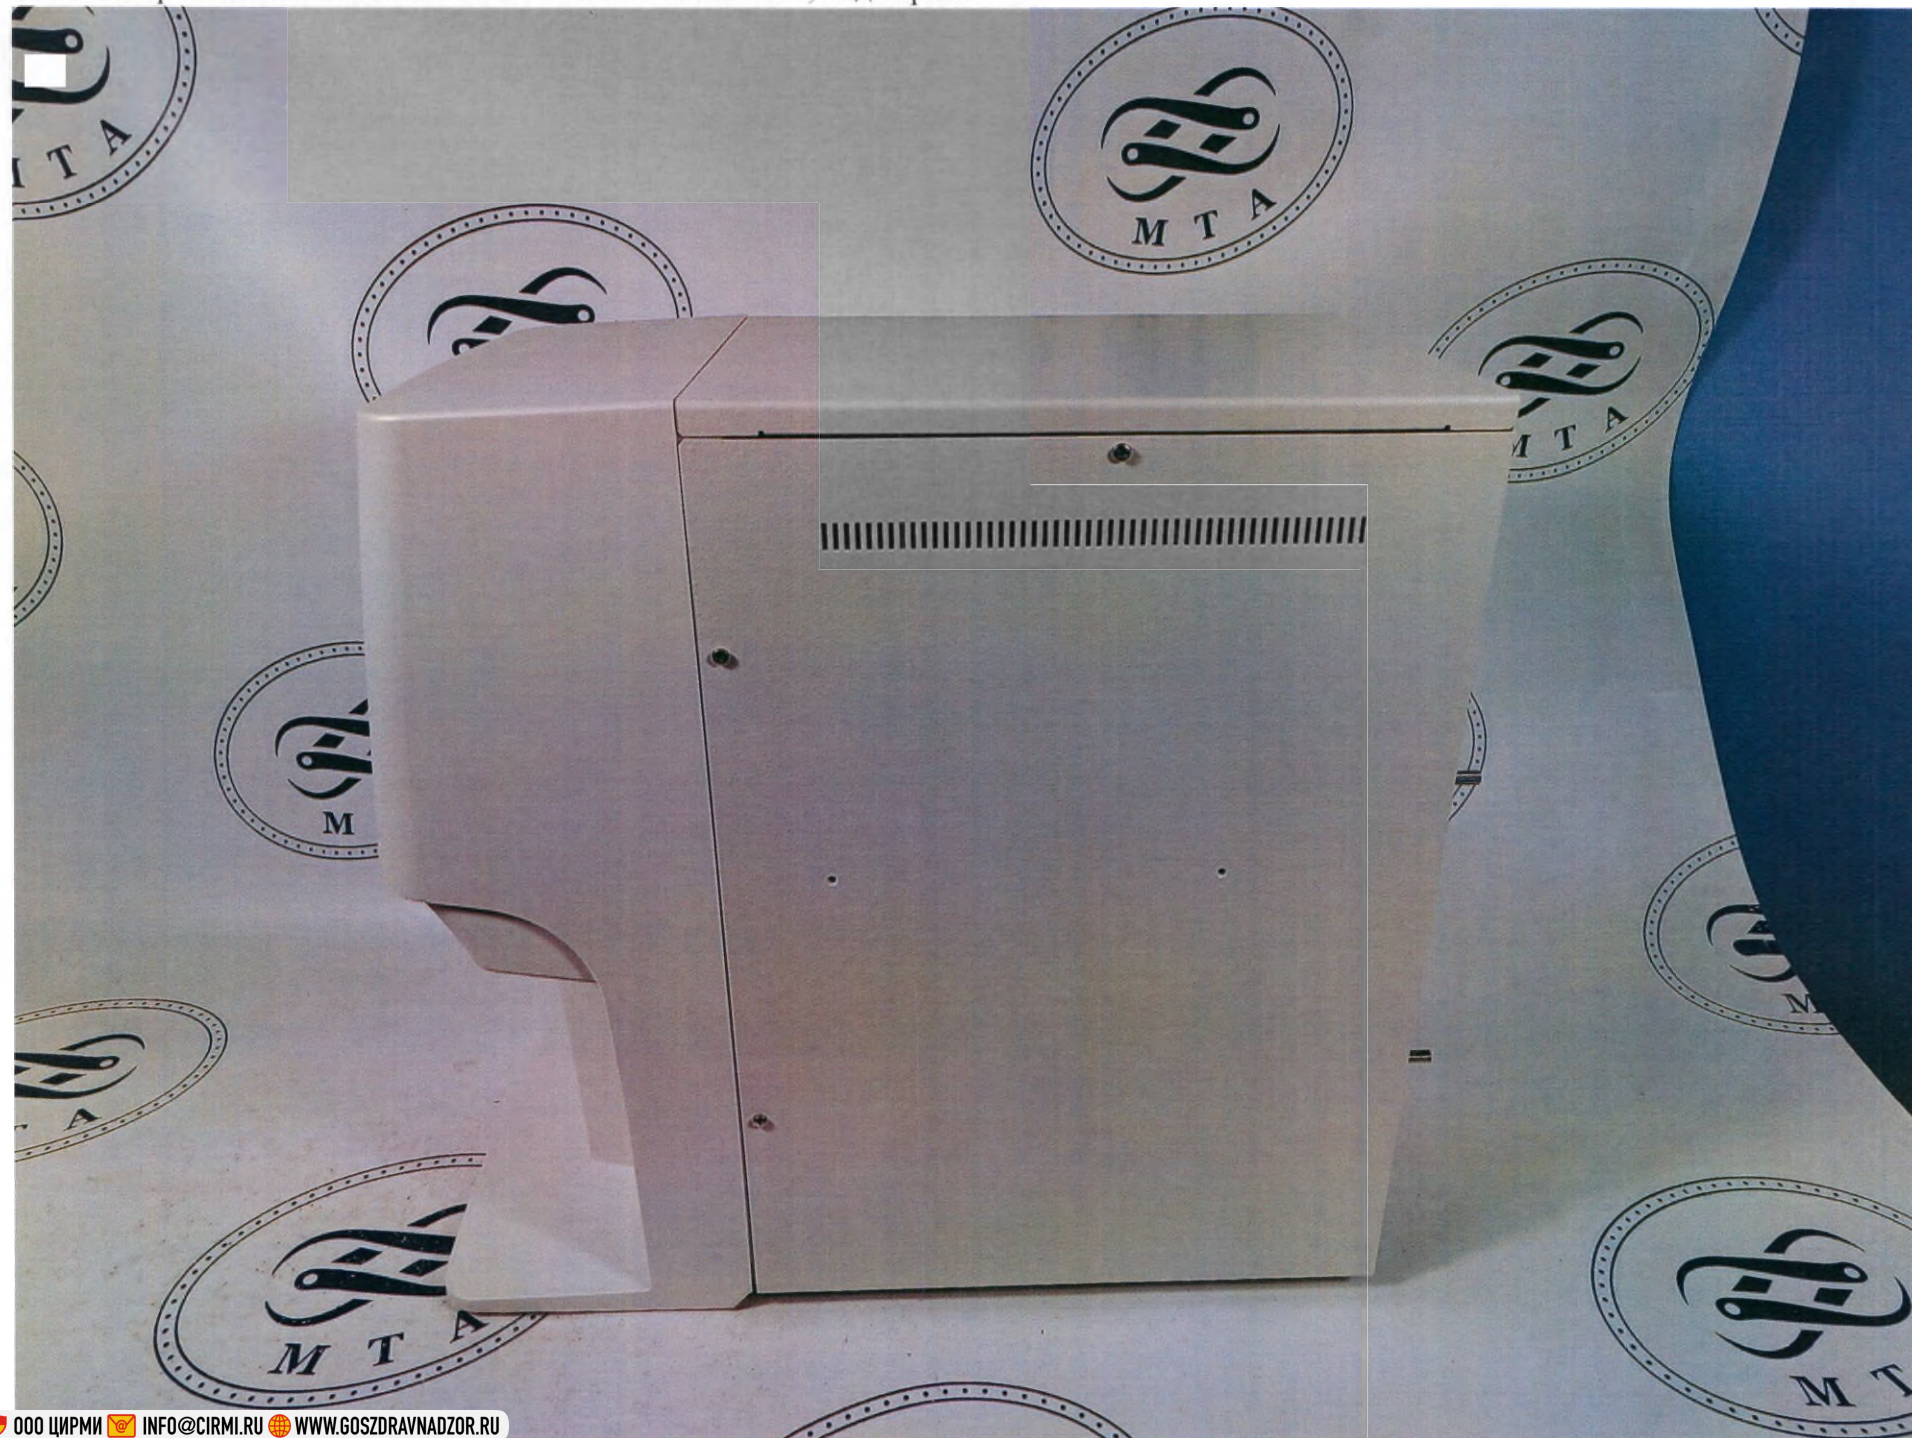


Анализатор гематологический автоматический МЕК-1301. вид слева







2. Шнур электропитания

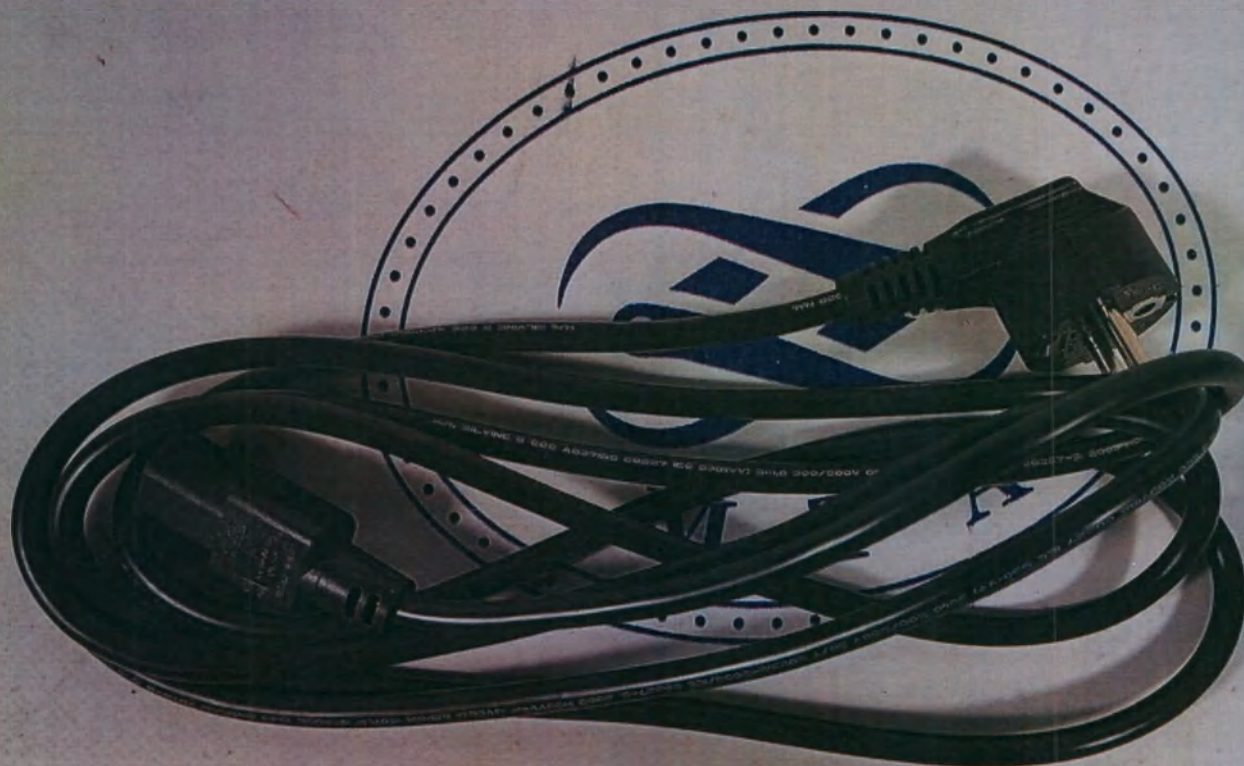




4. Плавкий инерционный предохранитель, 250 В, 2.0 А, $\varnothing 5.2 \times 20$ мм




5. Фильтр в сборе



Трубка дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4 в сборе (с позицией 15. Трубка дилюента (с синей манжетой) (для дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4 и с позицией принадлежностей 2. Крышка (для дилюента ISOTONAC•3 / ISOTONAC•4))

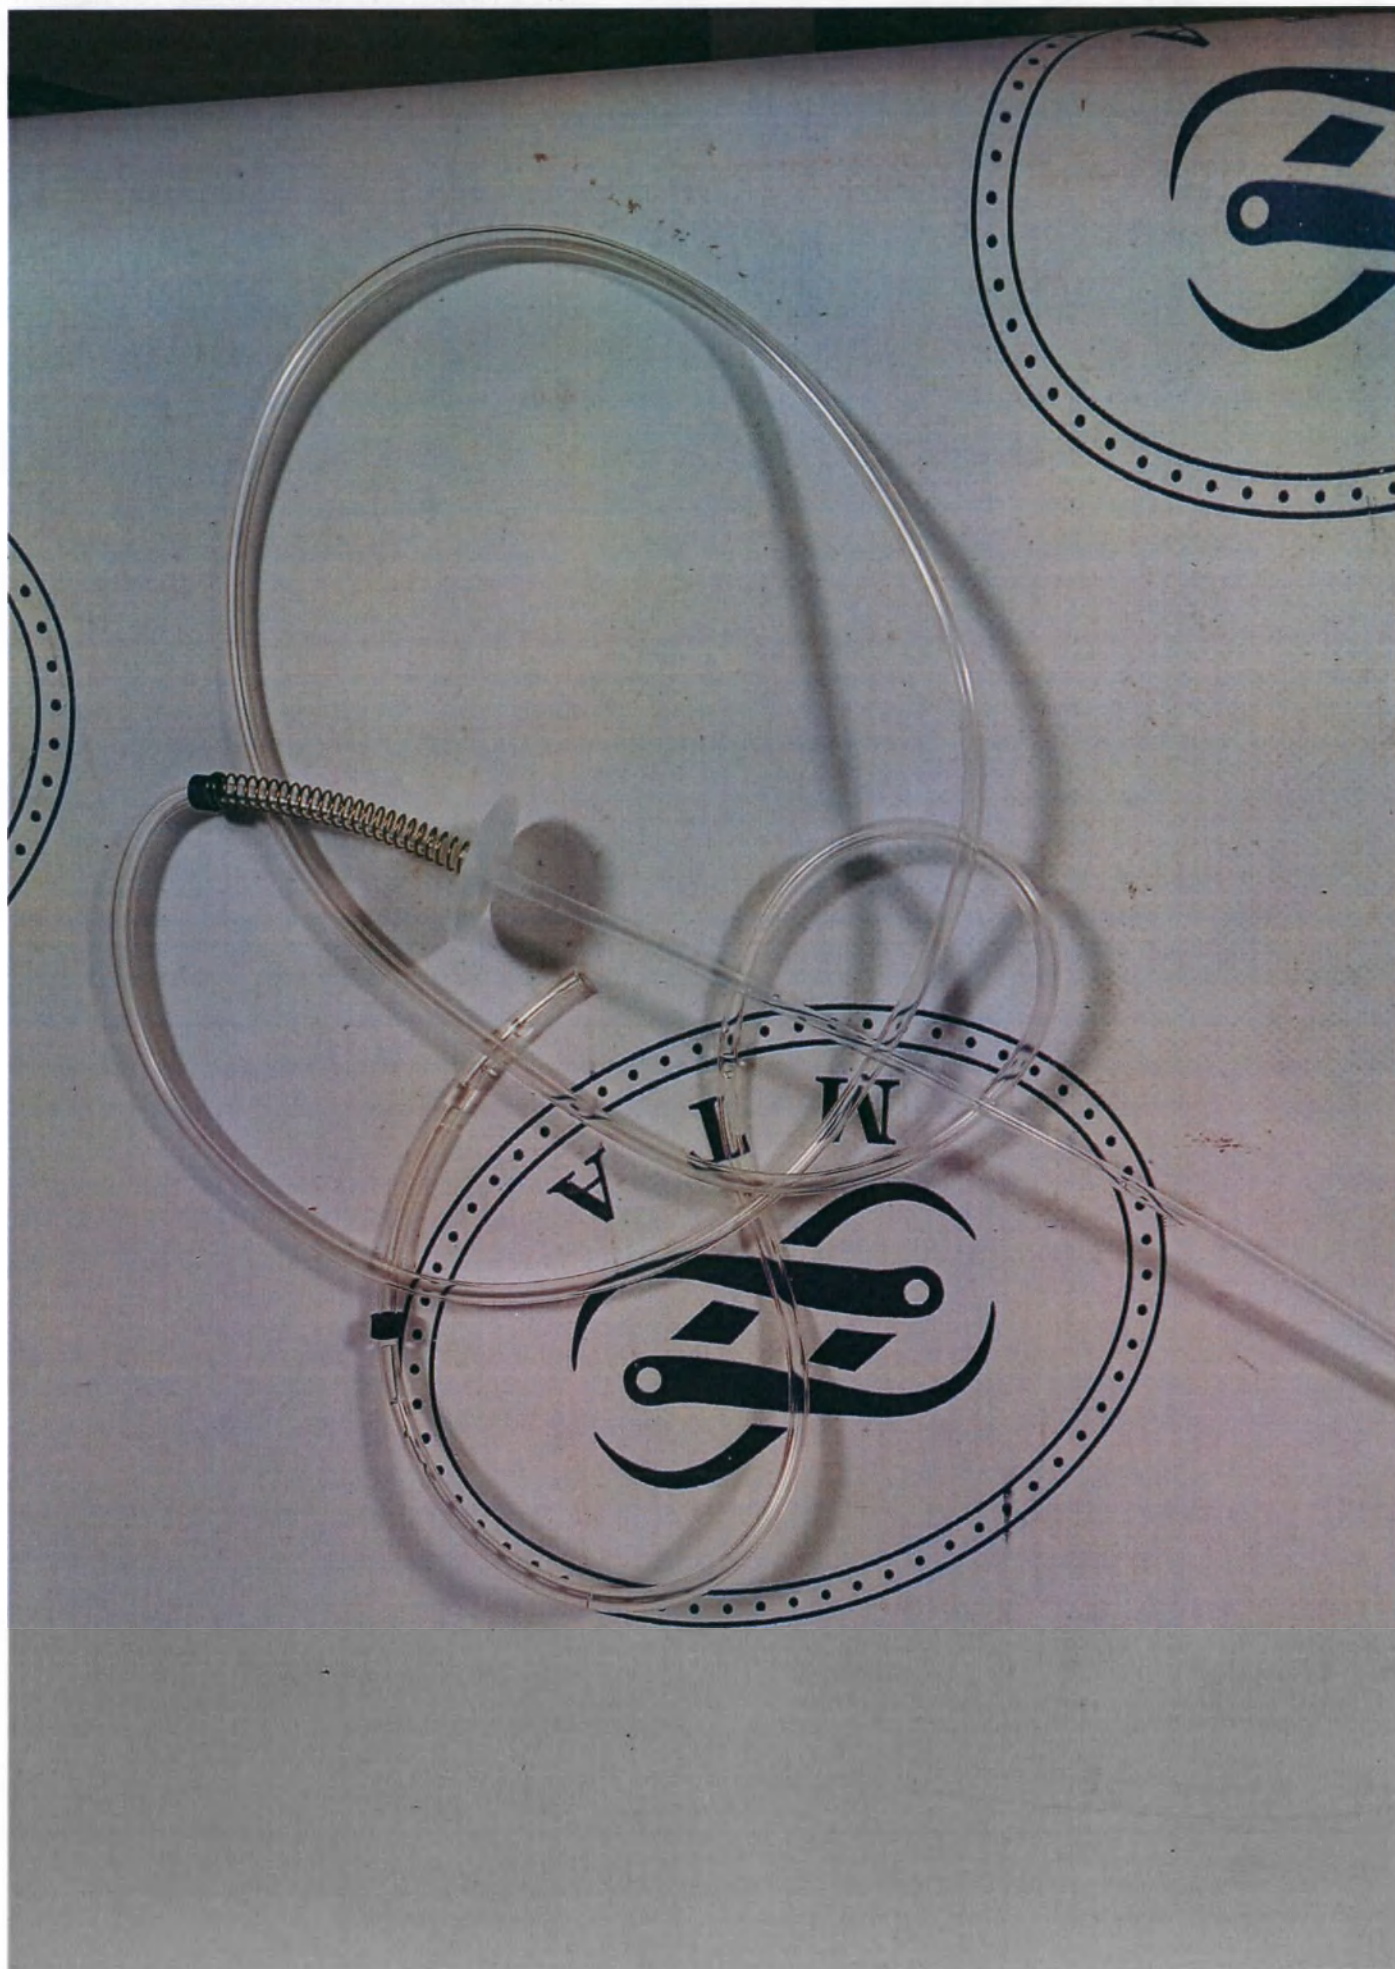

7. Трубка детергента CLEANAC•710 в сборе (с позицией 16. Трубка детергента (с зеленой манжетой), позицией 17. Трубка в сборе (для детерген CLEANAC•710) и позицией принадлежностей 3. Крышка МЕК (для детергента CLEANAC•710))

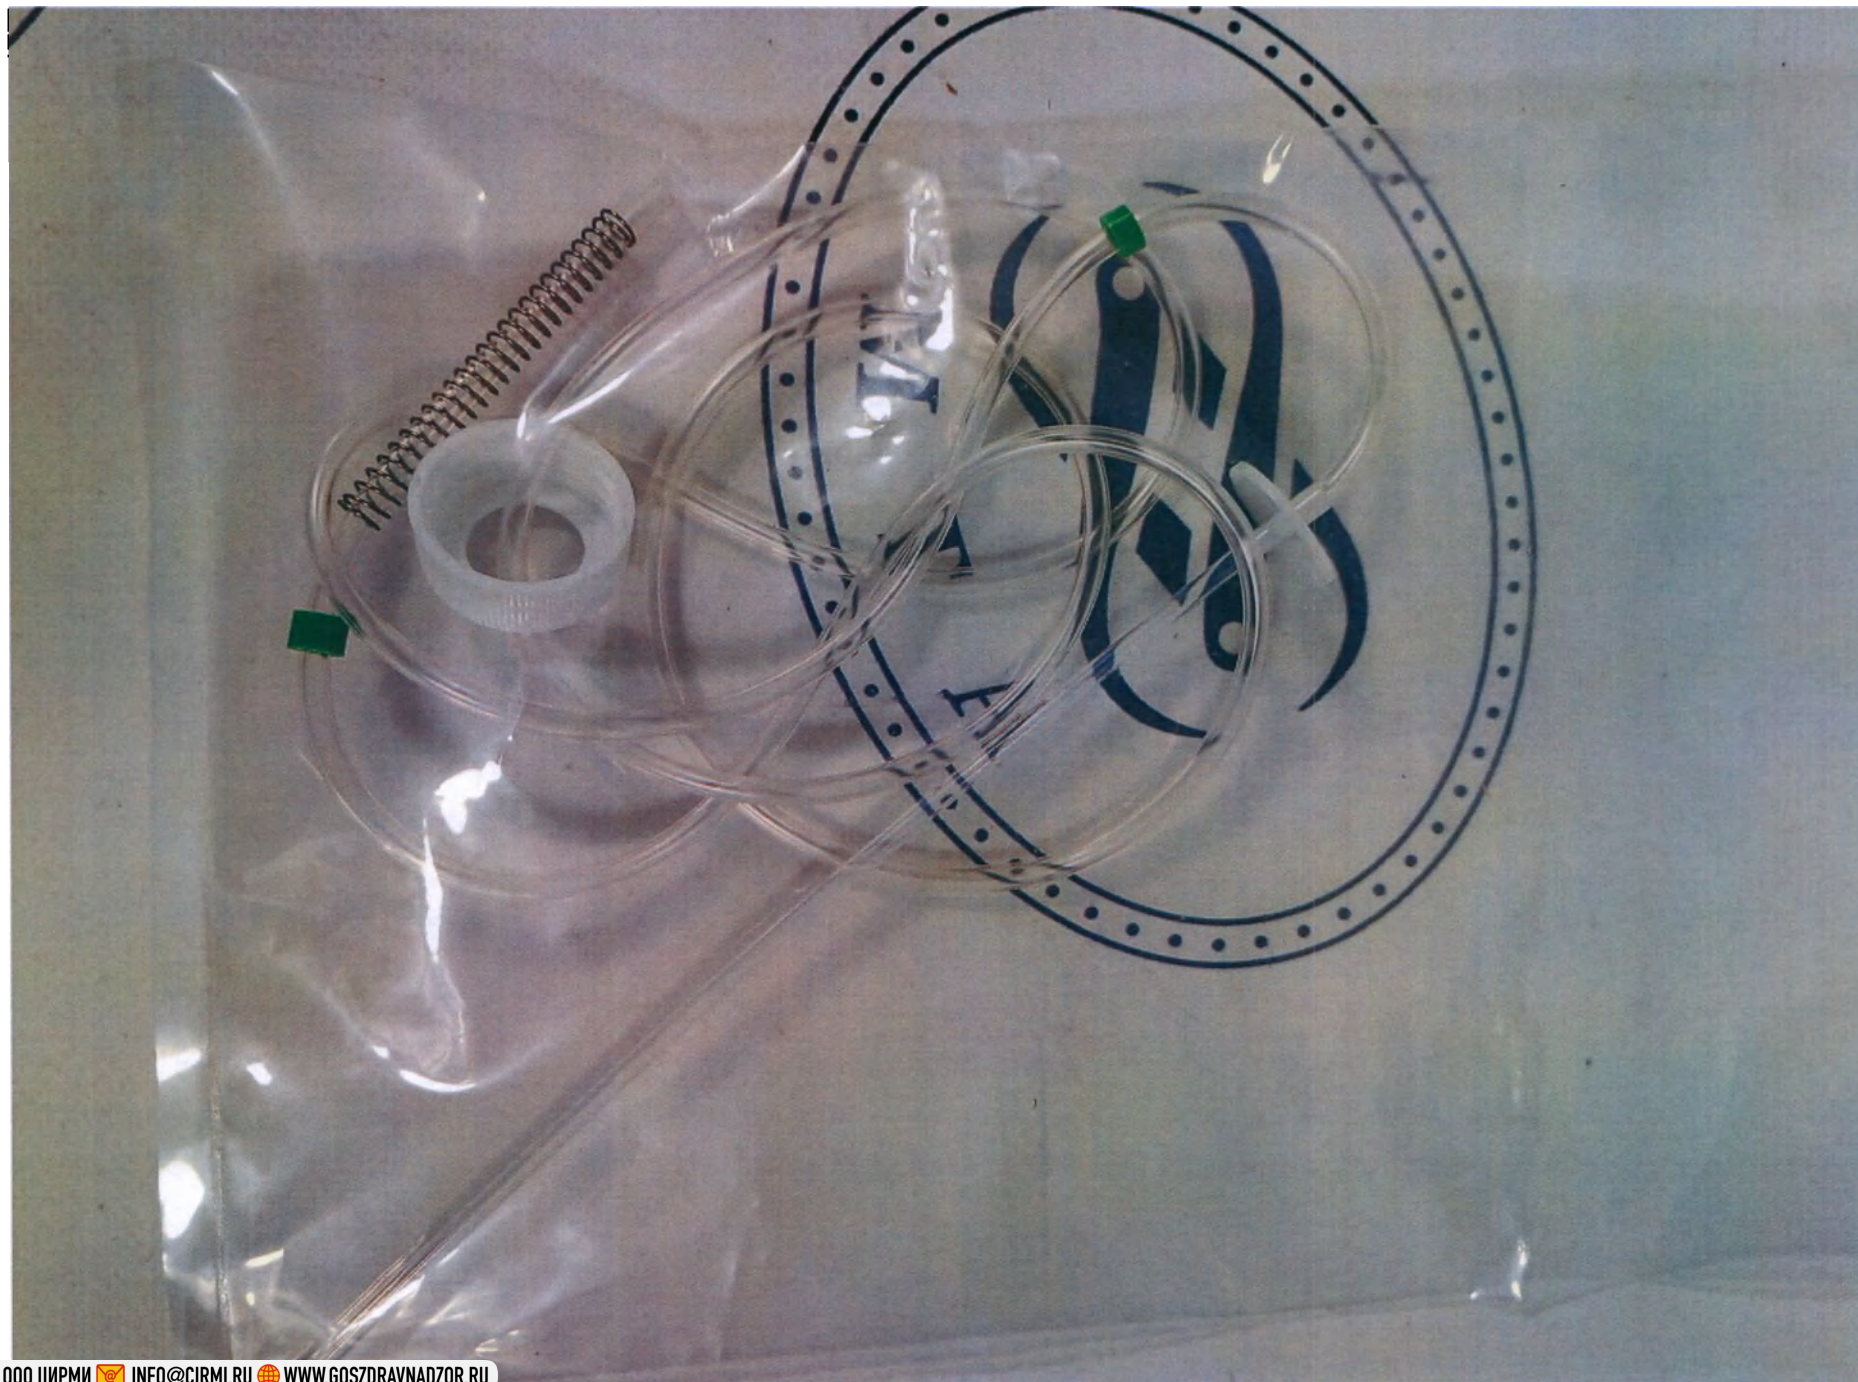


8. Трубка детергента CLEANAC•3 в сборе (с позицией 20. Трубка детергента (с белой манжетой) (для детергента CLEANAC•3))




Трубка реагента HEMOLYNAC•310 в сборе (с позицией 23. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 (цвет соединения: оранжевый)и позицией принадлежностей 4. Крышка реагента HEMOLYNAC•310 (оранжевая))



Трубка для отходов в сборе (с позицией 19. Трубка для отходов (с красными манжетами)и позицией принадлежностей 1. Крышка контейнера для отходов (крышка бака для отходов))

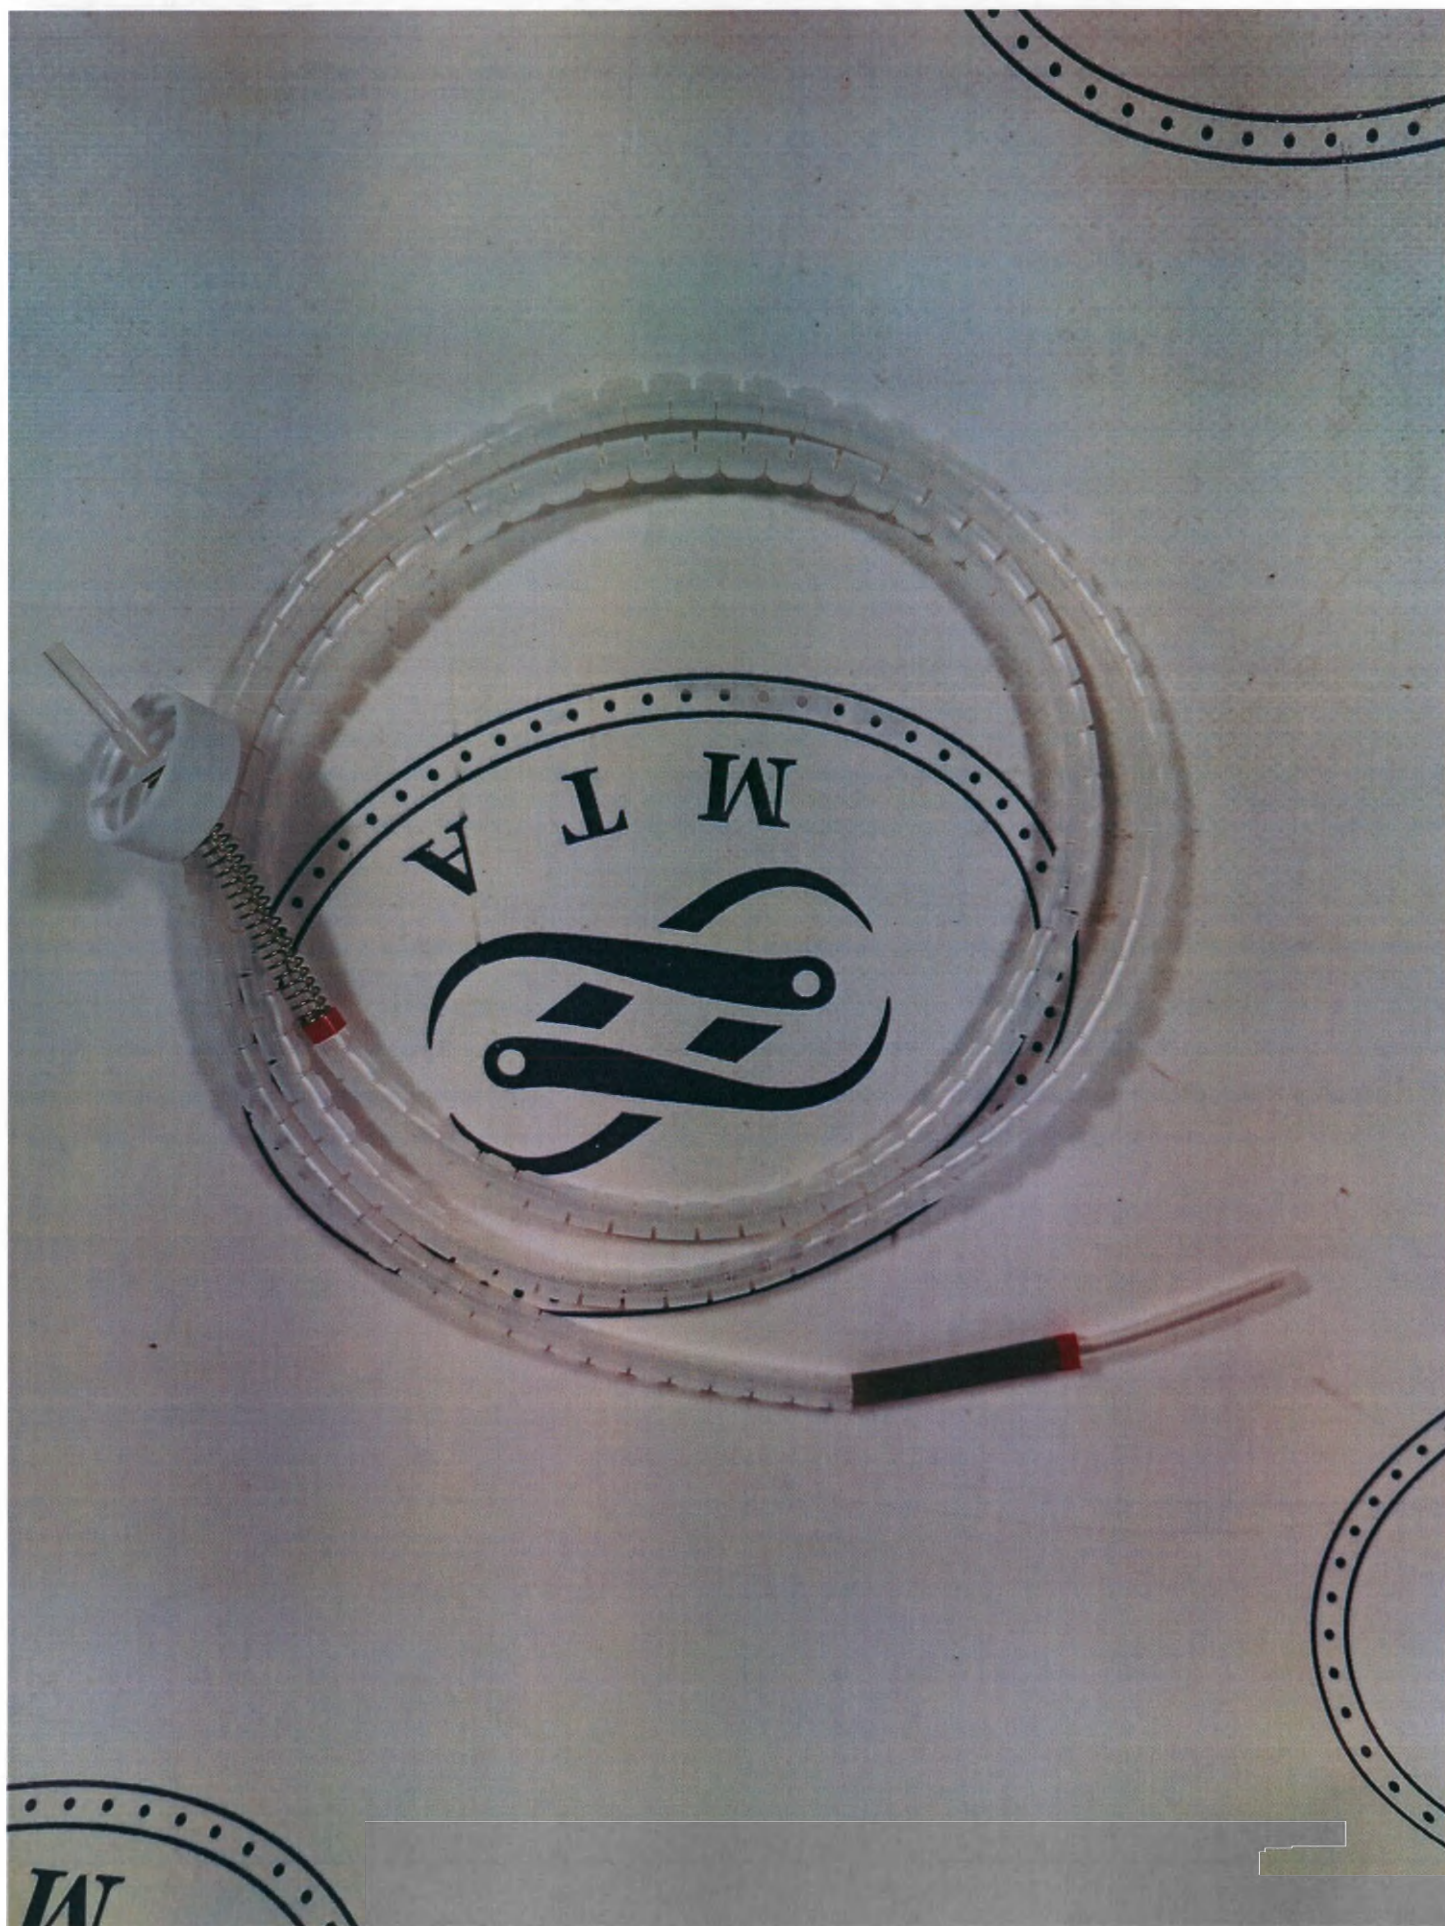

11. Контейнер для отходов (2л.)

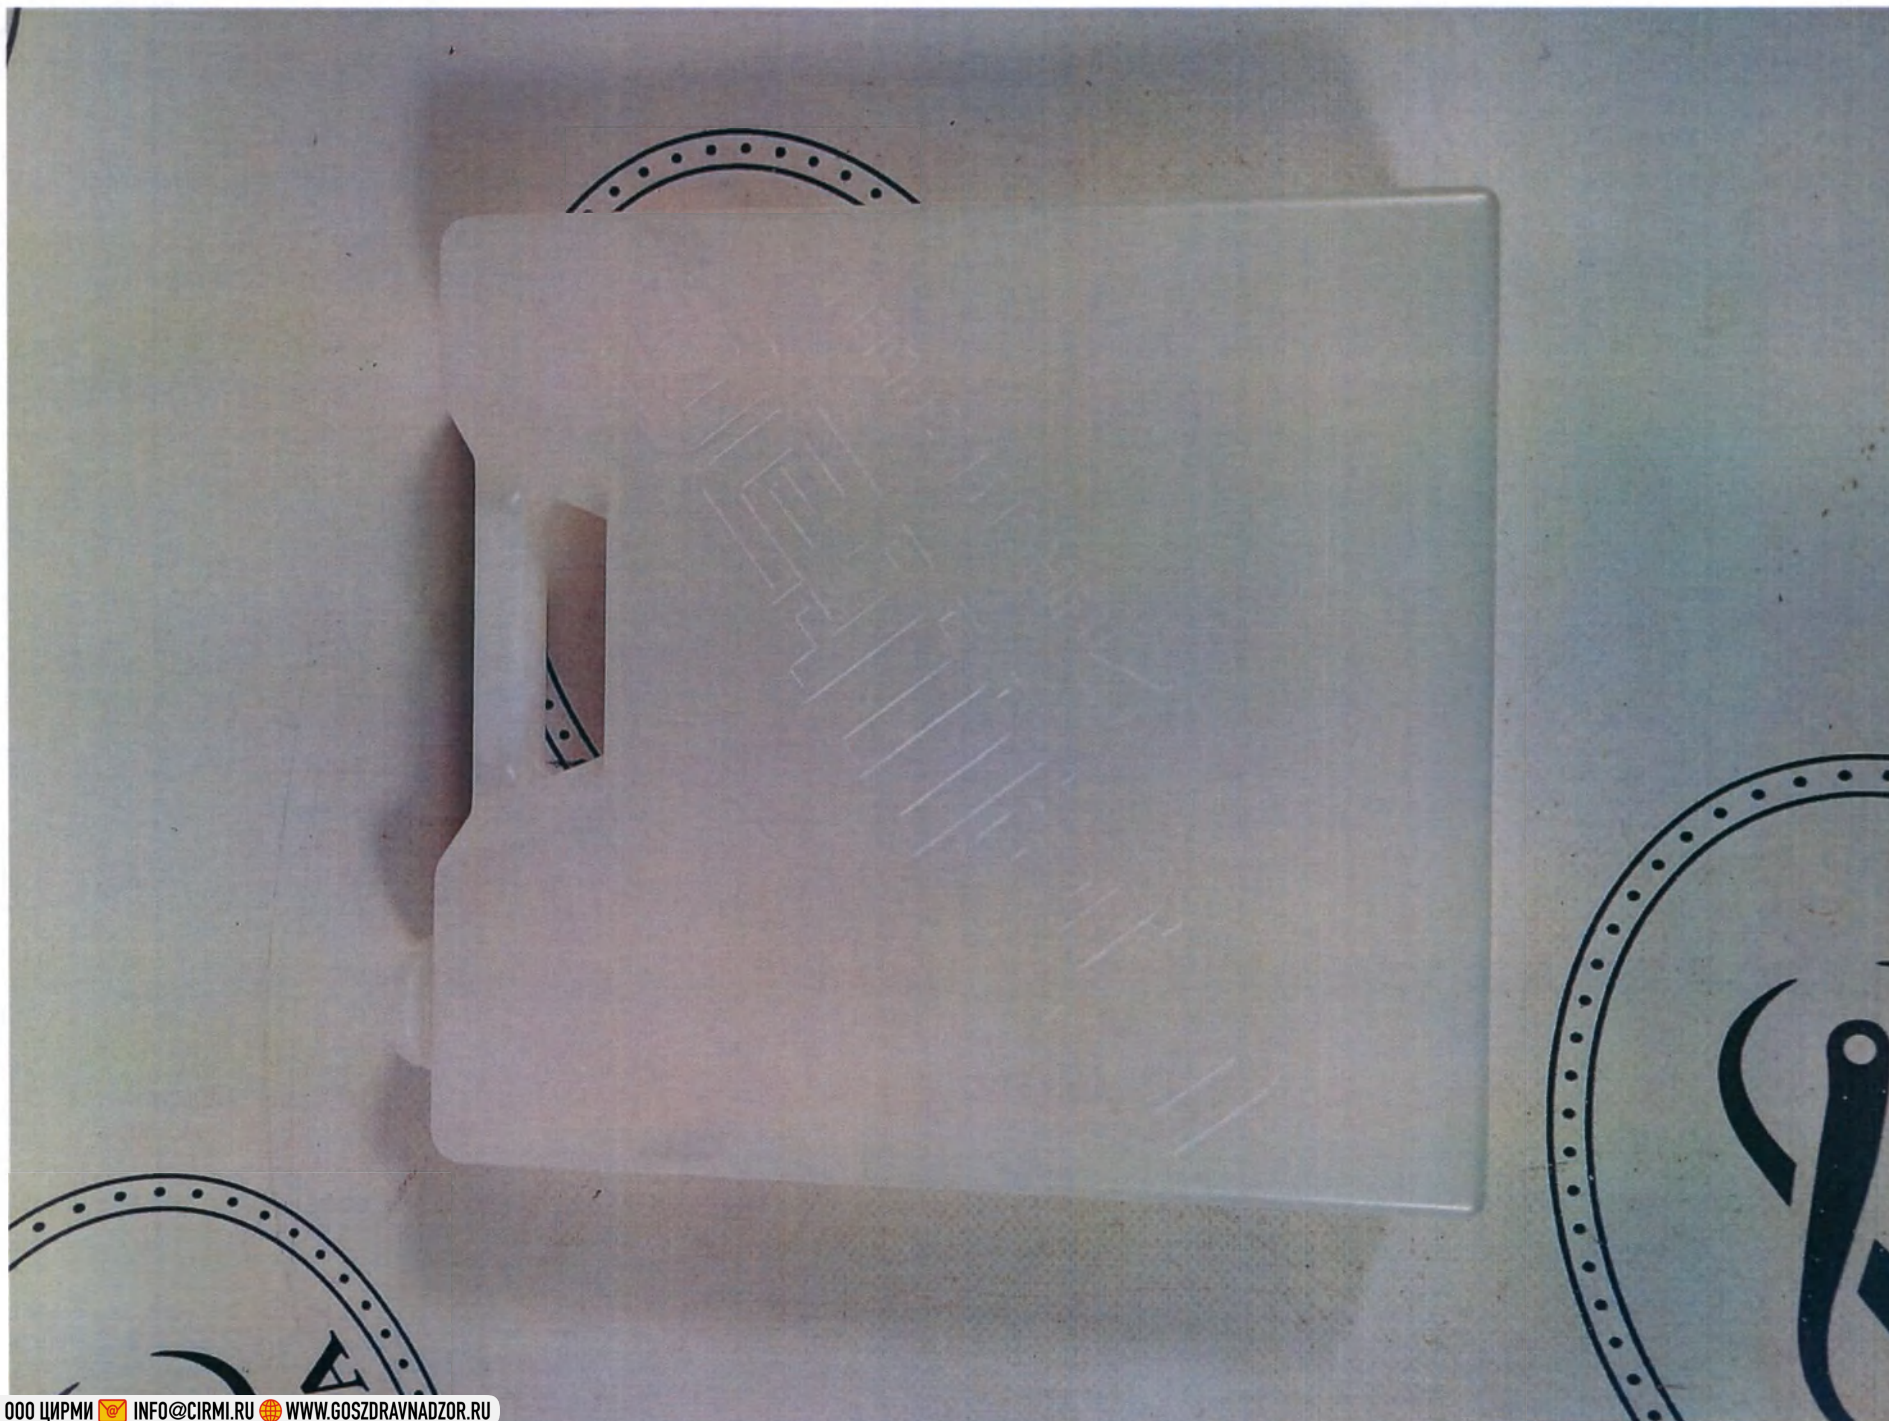


12. Трубка насоса в сборе




13. Портативный считыватель штрихкодов



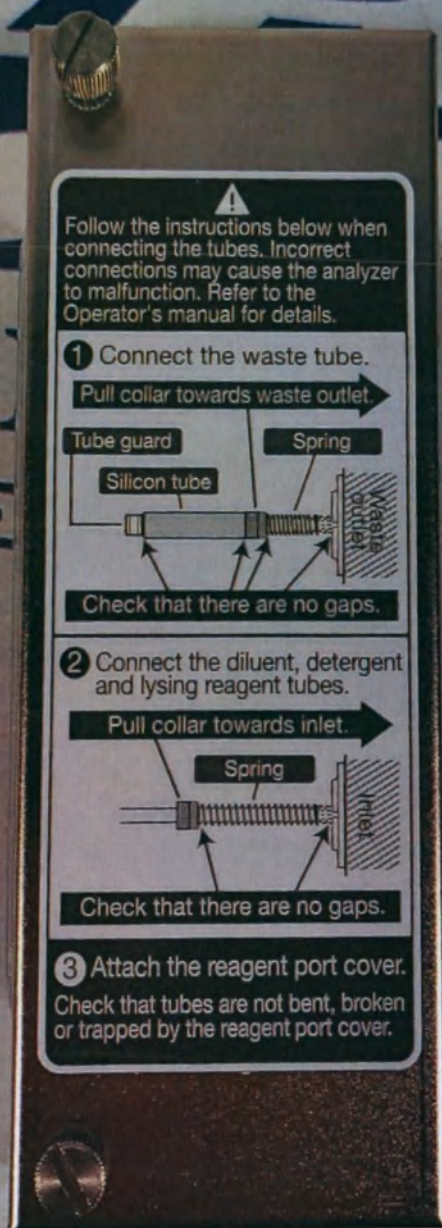

15. Трубка дилуэнта (с синей манжетой) (для дилуэнта ISOTONAC•3/ISOTONAC•4) (см. Рис. 6)
16. Трубка детергента (с зеленой манжетой) (для детергента CLEANAC•710) (см. Рис. 7)
17. Трубка в сборе (для детергента CLEANAC•710) (см. Рис. 7)

18. Трубка в сборе 3л (для детергента CLEANAC•710)

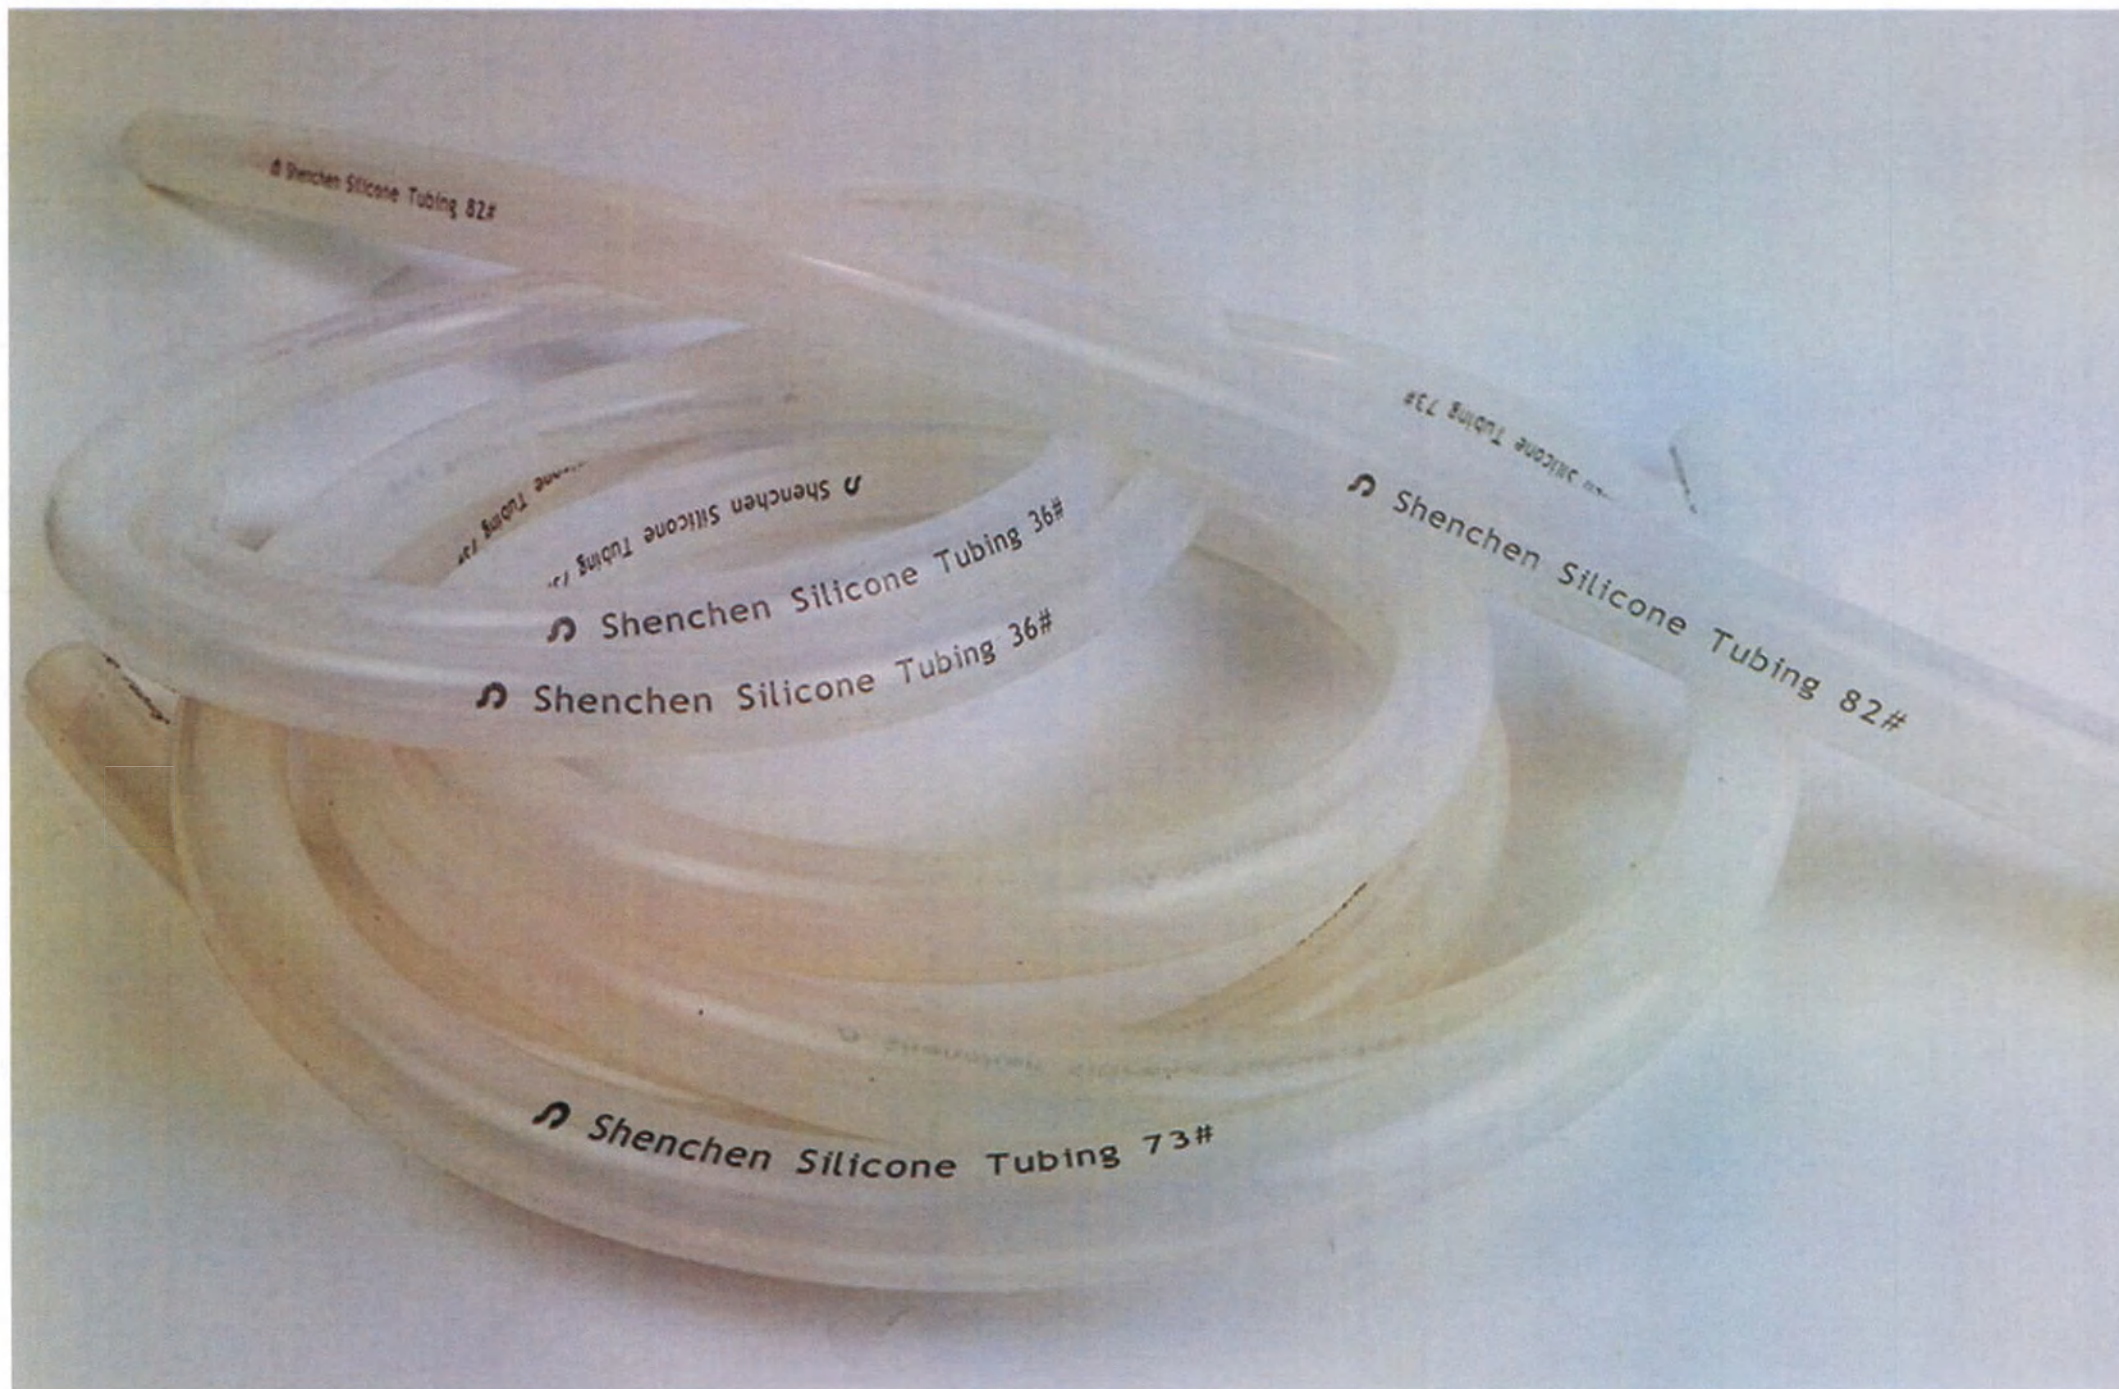

19. Трубка для отходов (с красными манжетами) (см. Рис. 10)
20. Трубка детергента (с белой манжетой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
21. Трубка в сборе 500 мл (с крышкой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
22. Трубка в сборе 1 л (с крышкой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
23. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 (цвет соединения: оранжевый) (см. Рис. 9)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие**


**«Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения
МЕК-1301»**

**производства NIHON KONDEN CORPORATION (Нихон Кондэн
Корпорейшн), Япония**

Принадлежности:

1. Крышка контейнера для отходов (крышка бака для отходов) – см. Рис 10.
2. Крышка (для дилуэнта ISOTONAC•3 / ISOTONAC•4) – см. Рис 6.
3. Крышка MEK (для детергента CLEANAC•710) – см. Рис 7.
4. Крышка реагента HEMOLYNAC•310 (оранжевая) – см. Рис 9.


5. Штатив для реагентов

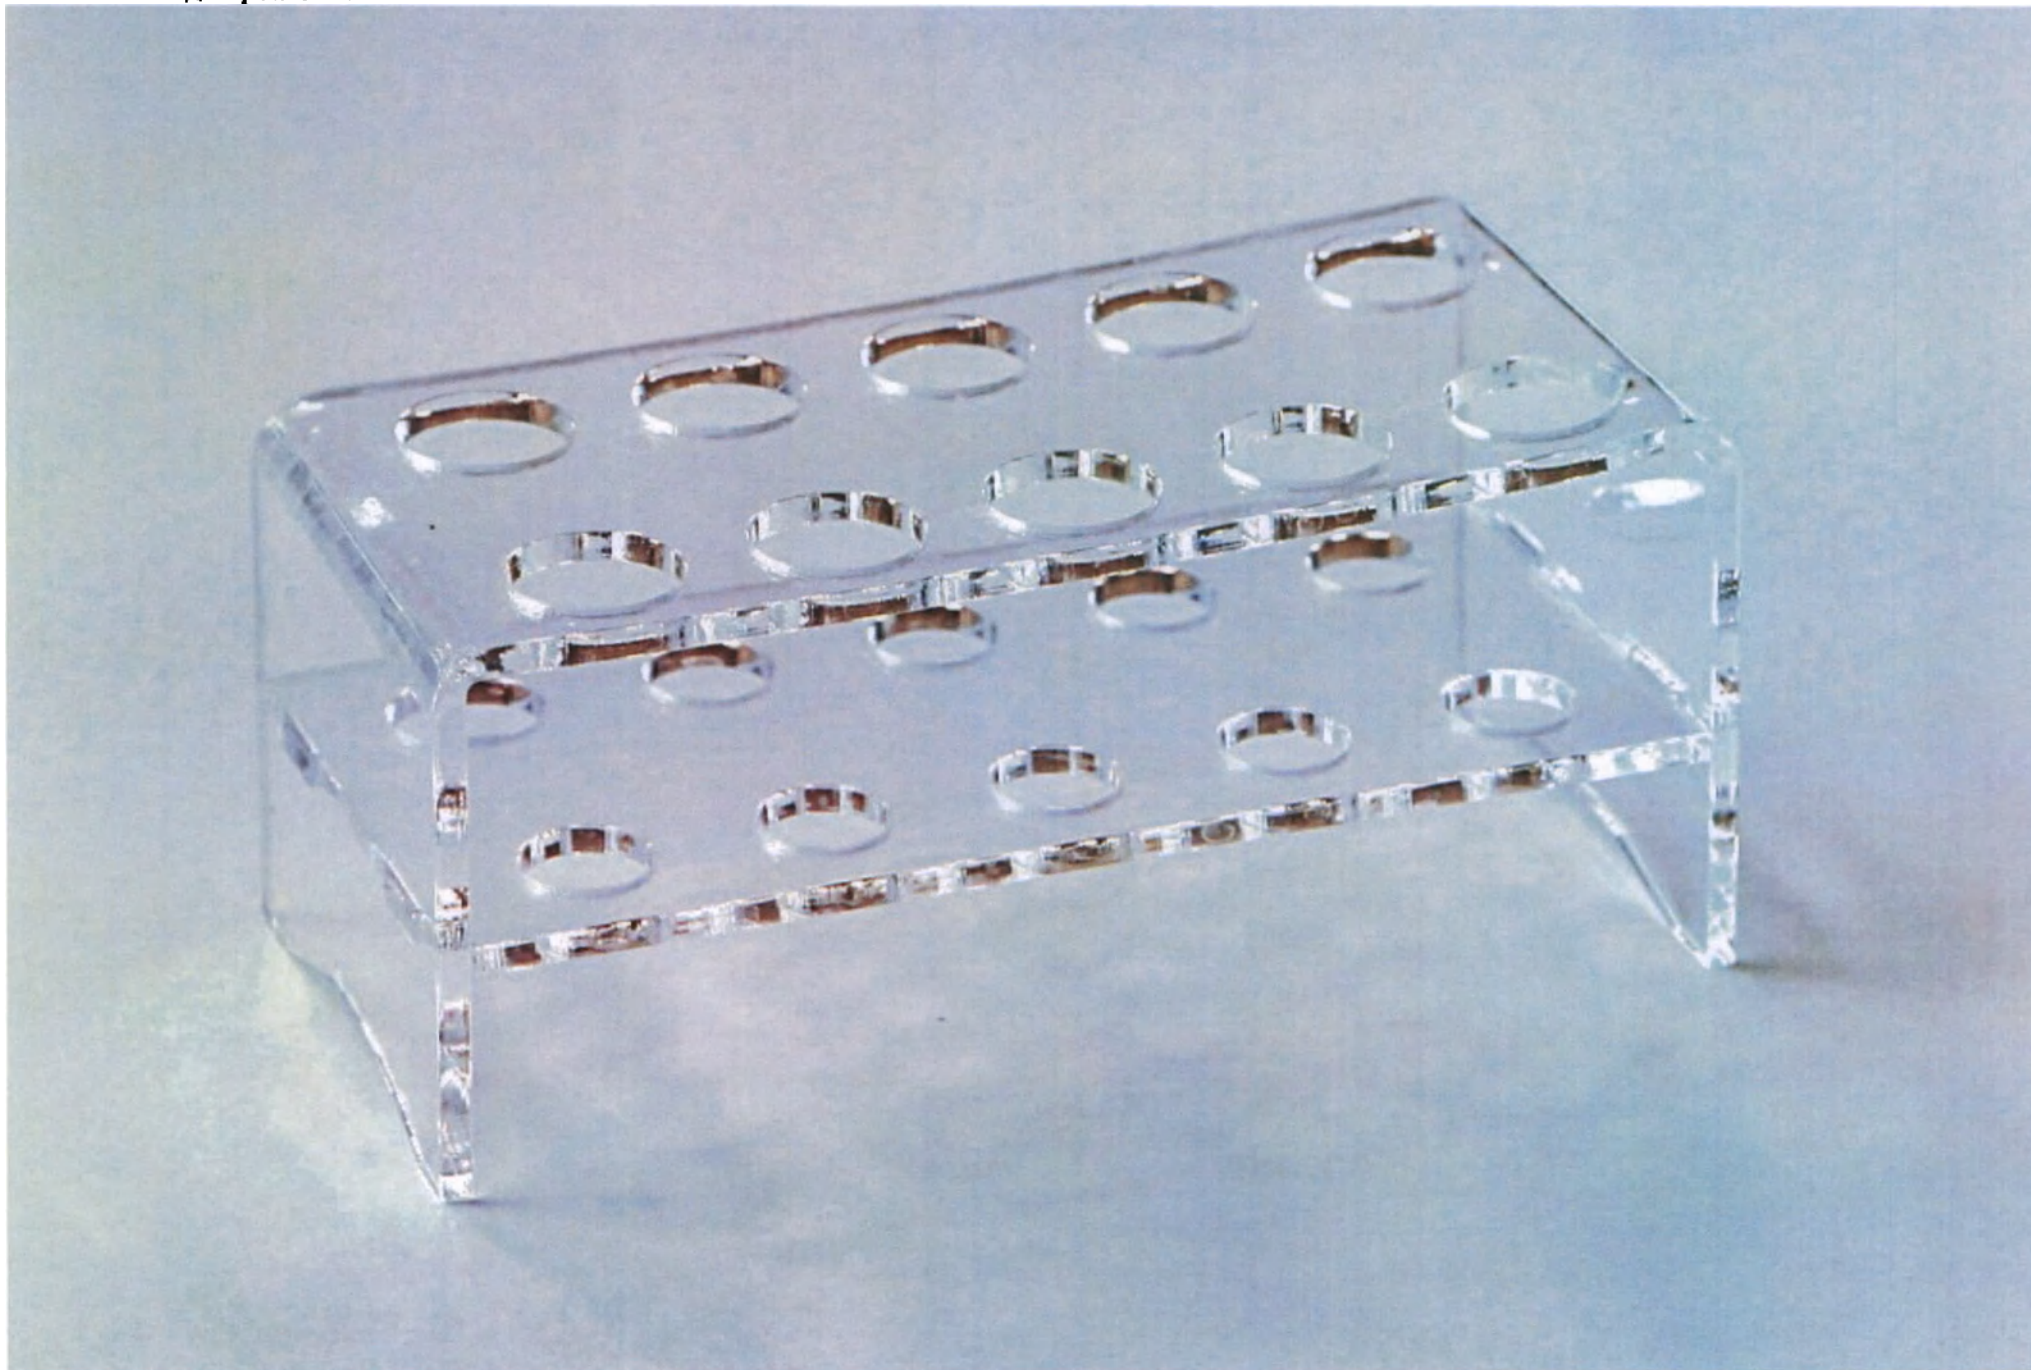

6. Бумажная лента




7. Компактный принтер – 1 шт.

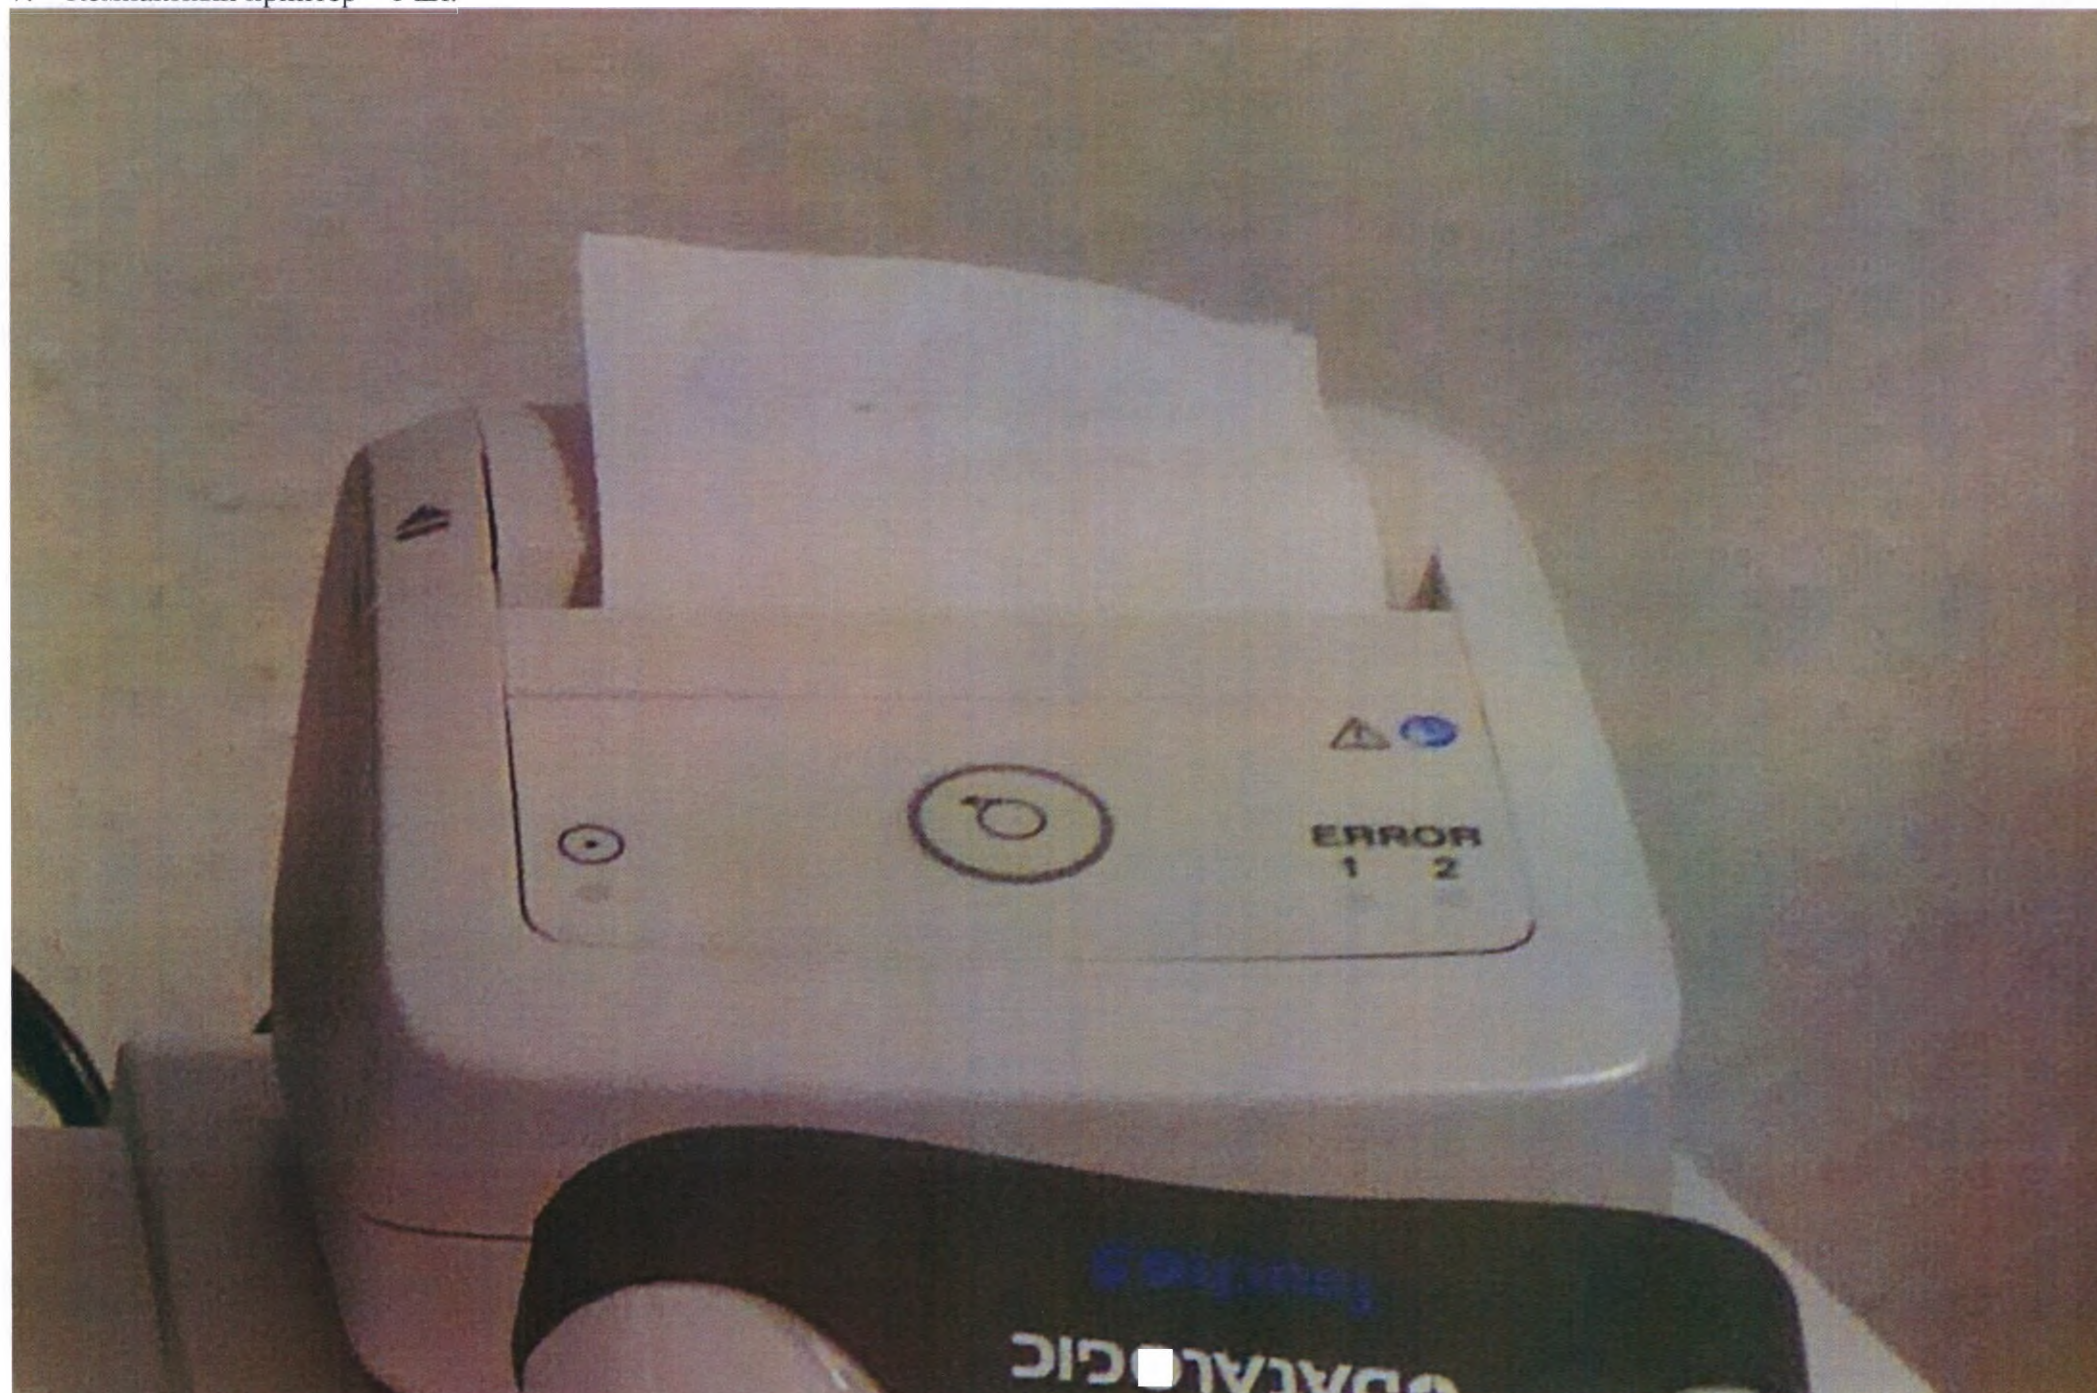


8. Кабель USB




9. Последовательный перекрестный кабель D9-D9

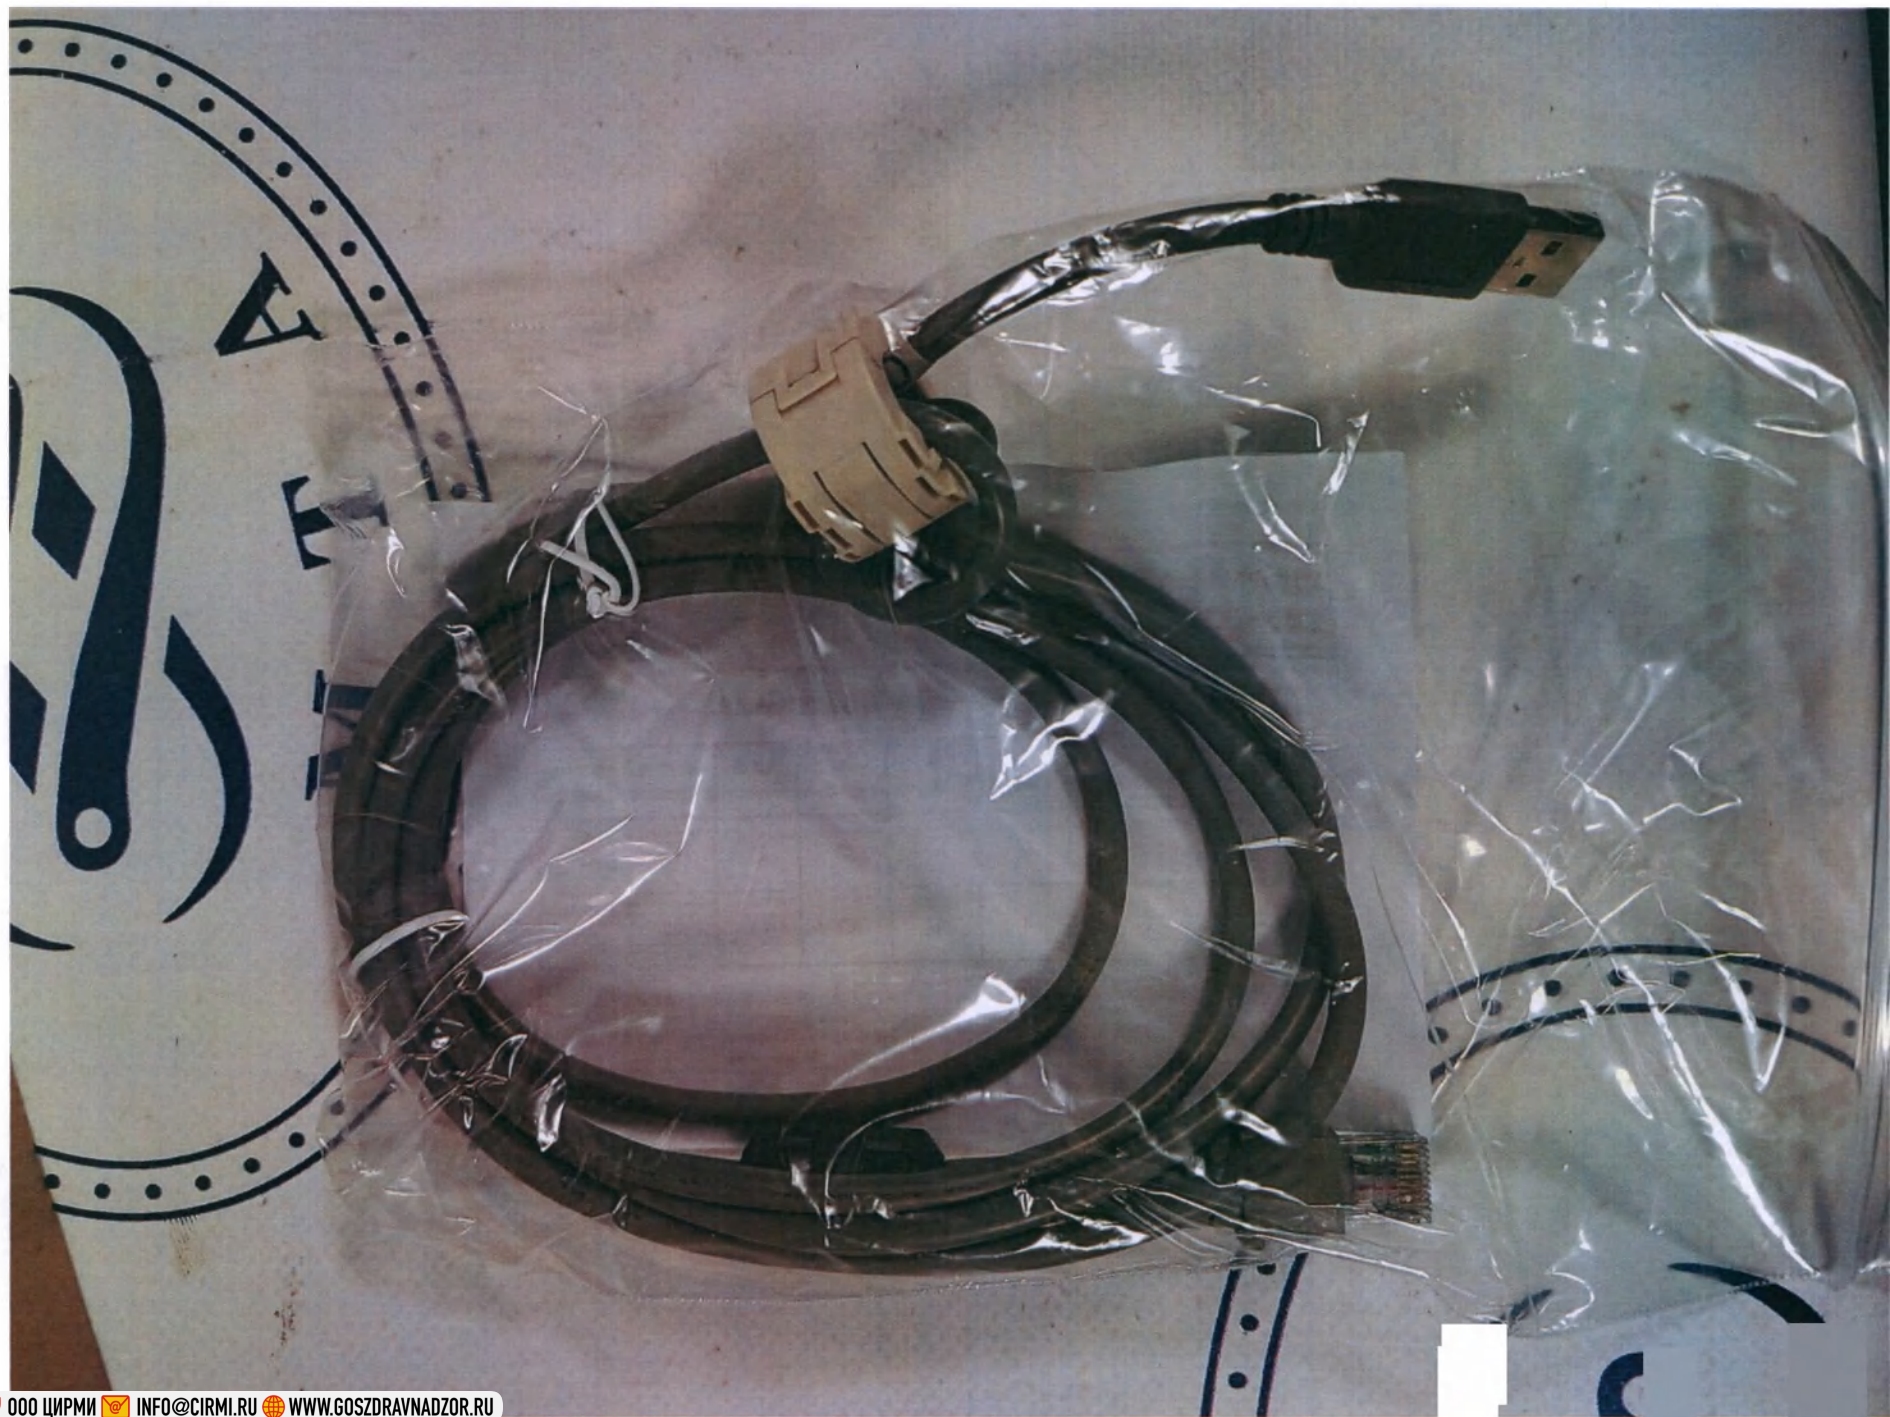

10. Кабель LAN

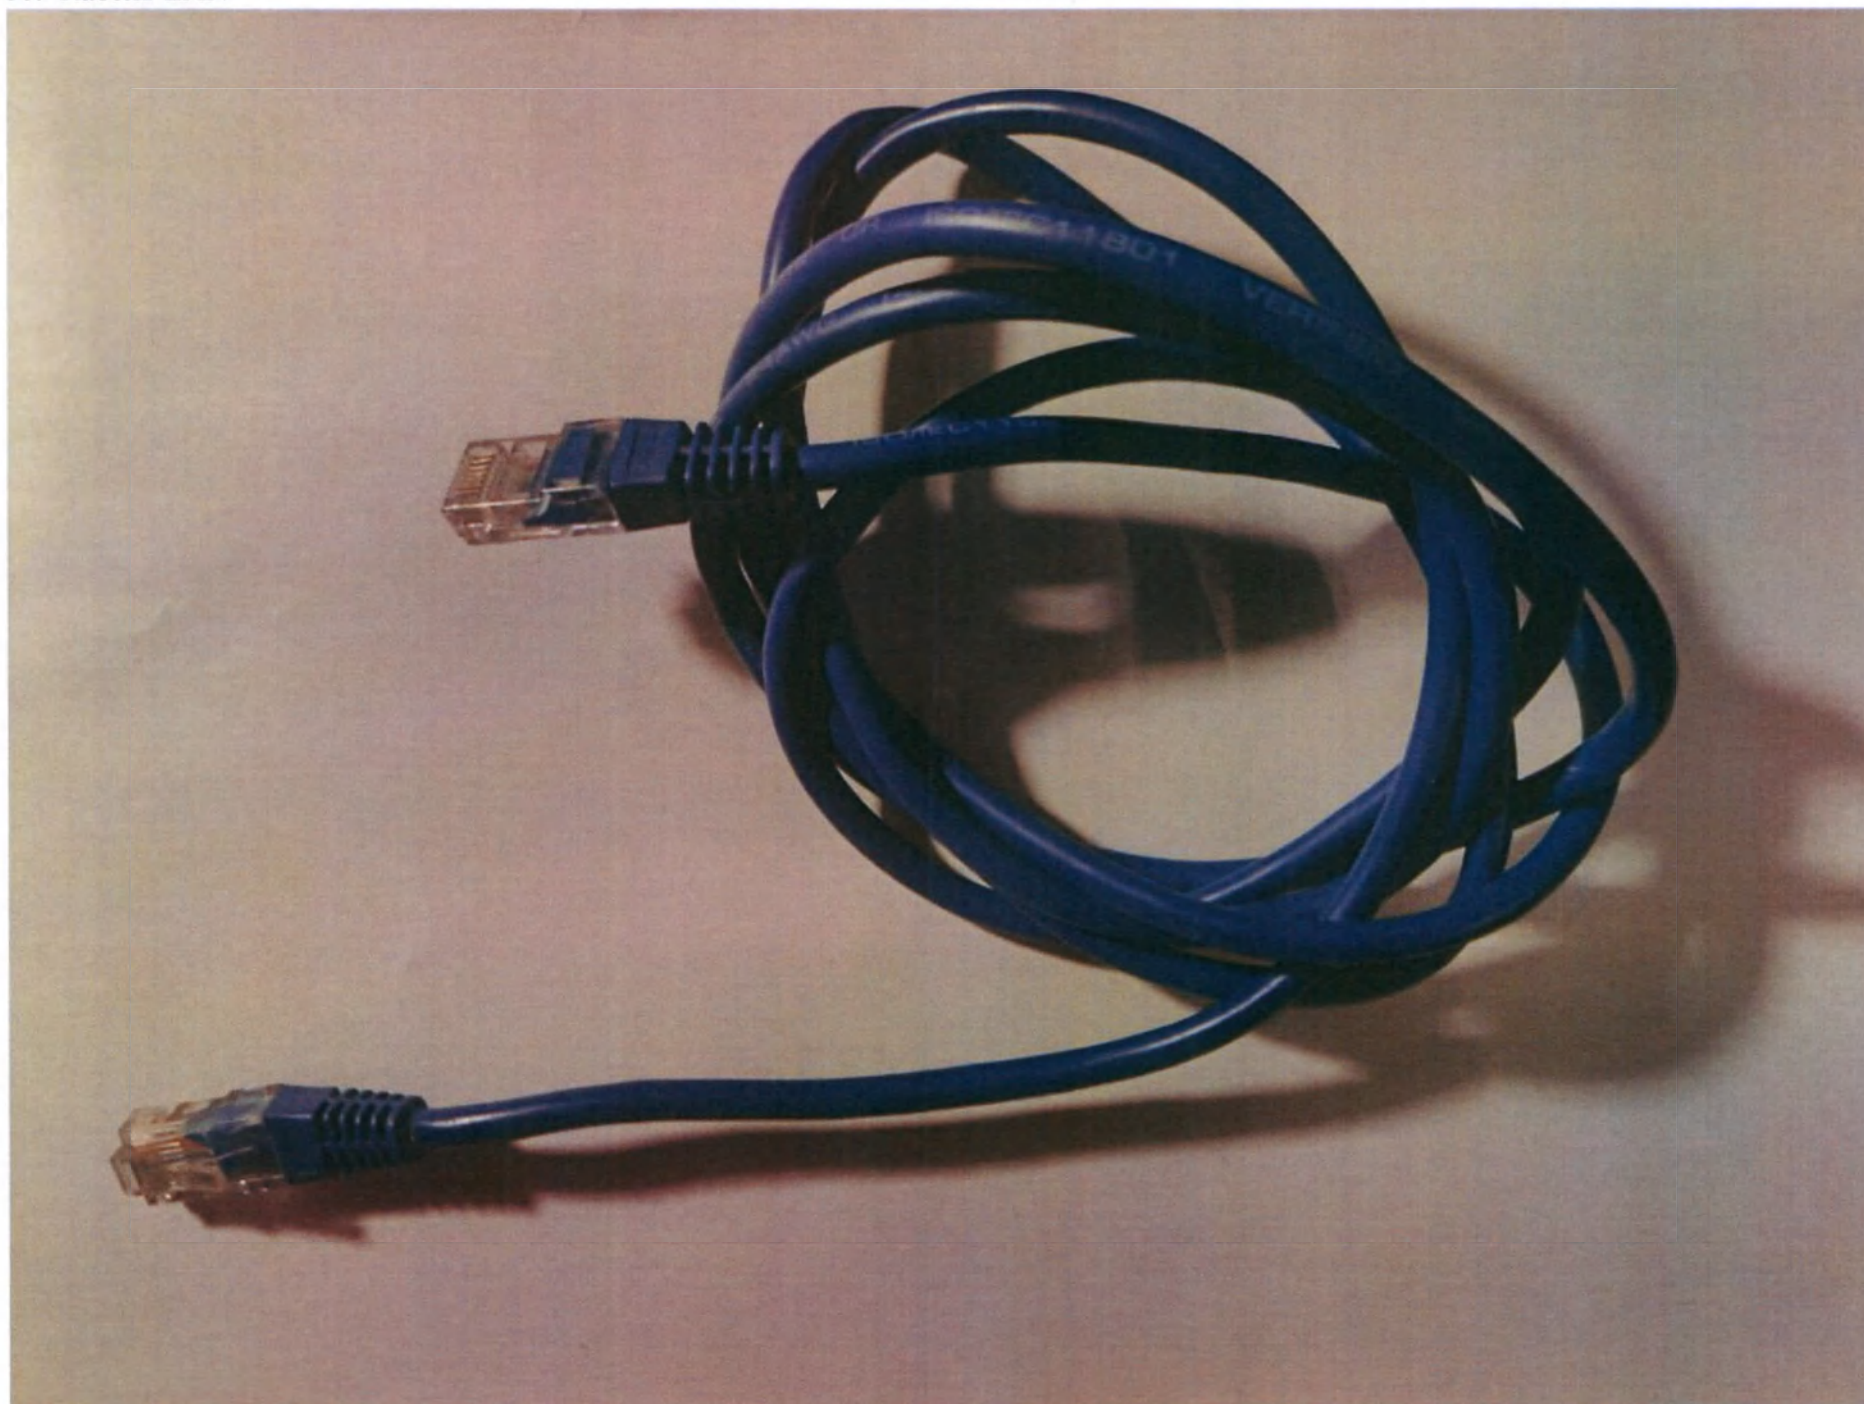

11. Пакет программного обеспечения – 1 шт.

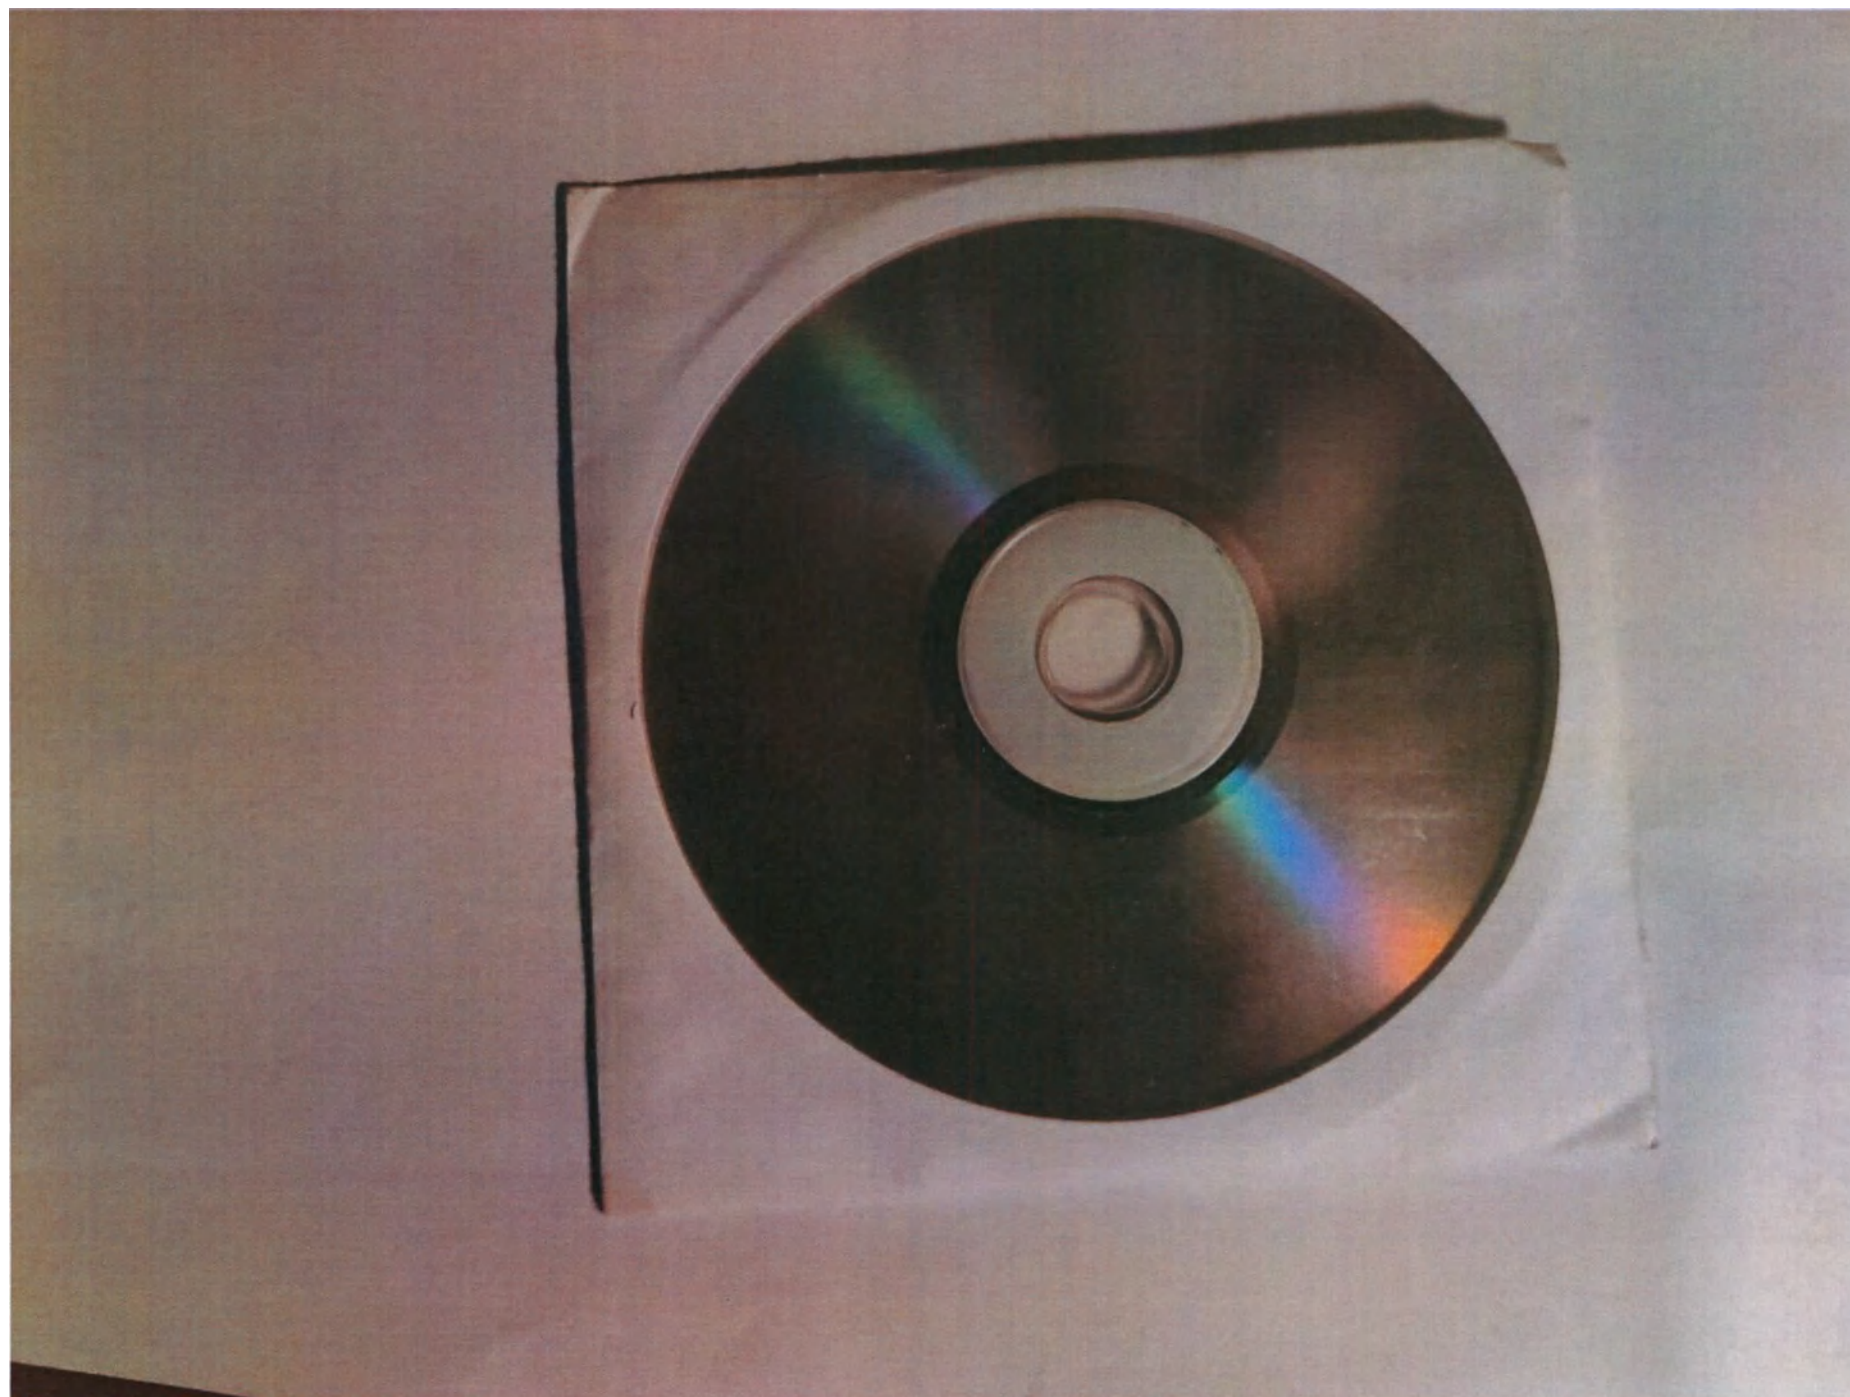

Комплект адаптера для капилляра (10 мкл):

- Адаптер для капилляра (10 мкл)
- Сборочное устройство (10 мкл)

YZ -0262

0000987406

AA

 **NIHON KOHDEN**

JAN



4931921868874

T478

商 品 名: キャップピースチューブASSY

数量 Quantity 1

2ホソ

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4

NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

GS1-128



(01)04931921868874

<http://www.nihonkohden.co.jp/>


T478

Наконечник прокалывателя, 2 шт/уп - Nihon Kohden Corporation,
Япония, "Нихон Коуден Корпорейшн", Япония, 1-31-4 Nishiochiai,
Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan/ 1-31-4 Нисютиаи, Синдзюку-ку,
Токио 161-8560 Япония, ЯПОНИЯ, Общество с ограниченной
ответственностью "Эко-мед-с М", 111033, Москва г. Савоухатная ул,
дом № 2в строение 1.

13. Капилляр (20 мкл)



14. Канюляры (10 штук)

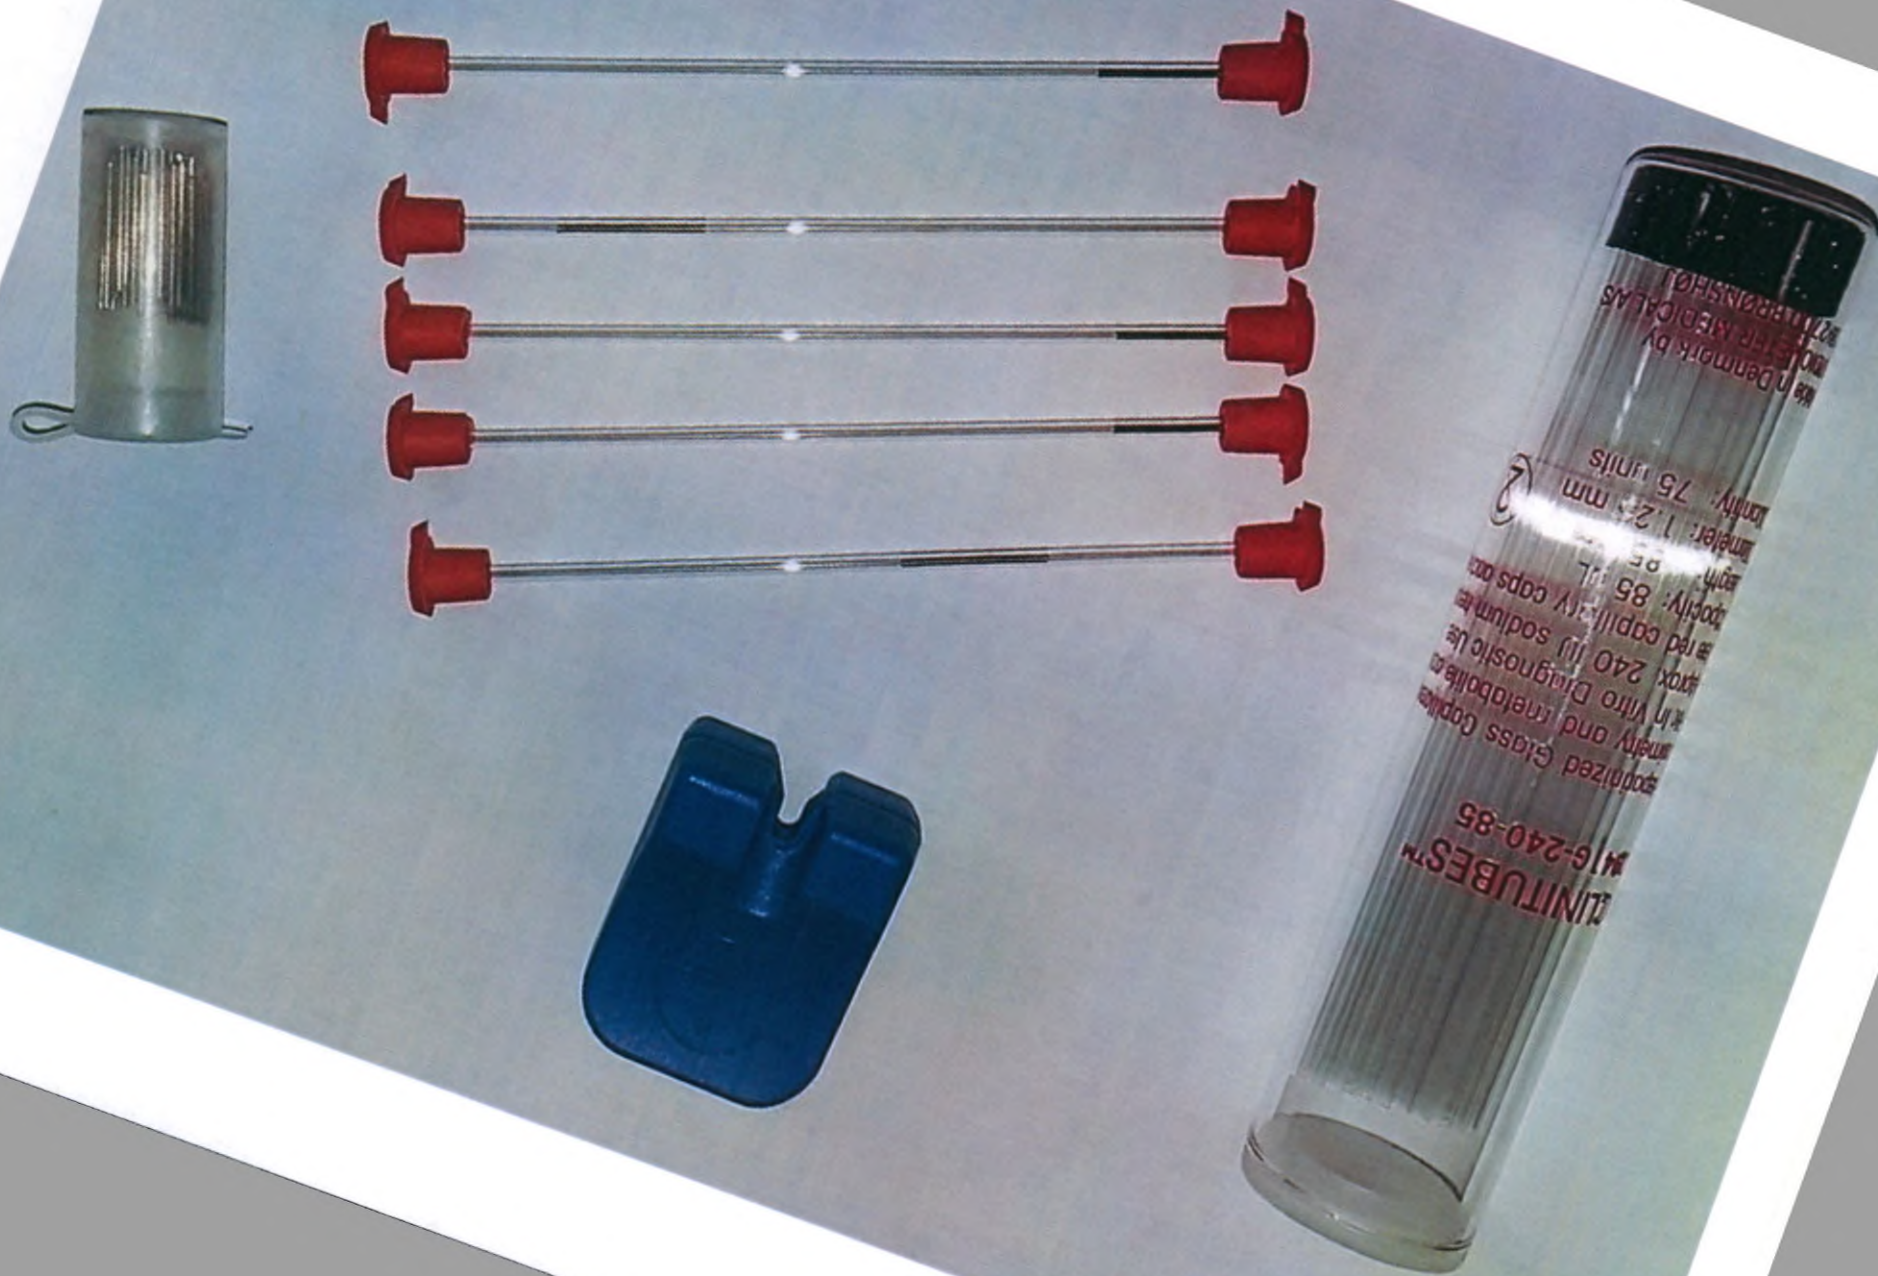

Микропробирка, 500 шт./уп.



YZ -0261
0000122519 AA



NIHON KOHDEN

JAN



4931921868881

T479

商 品 名: サンプルチューブ ASSY

数量 Quantity 1

2本

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4

NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

GS1-128




(01)04931921868881


MADE IN JAPAN

<http://www.nihonkohden.co.jp/>

Контейнер для отходов (10 л)

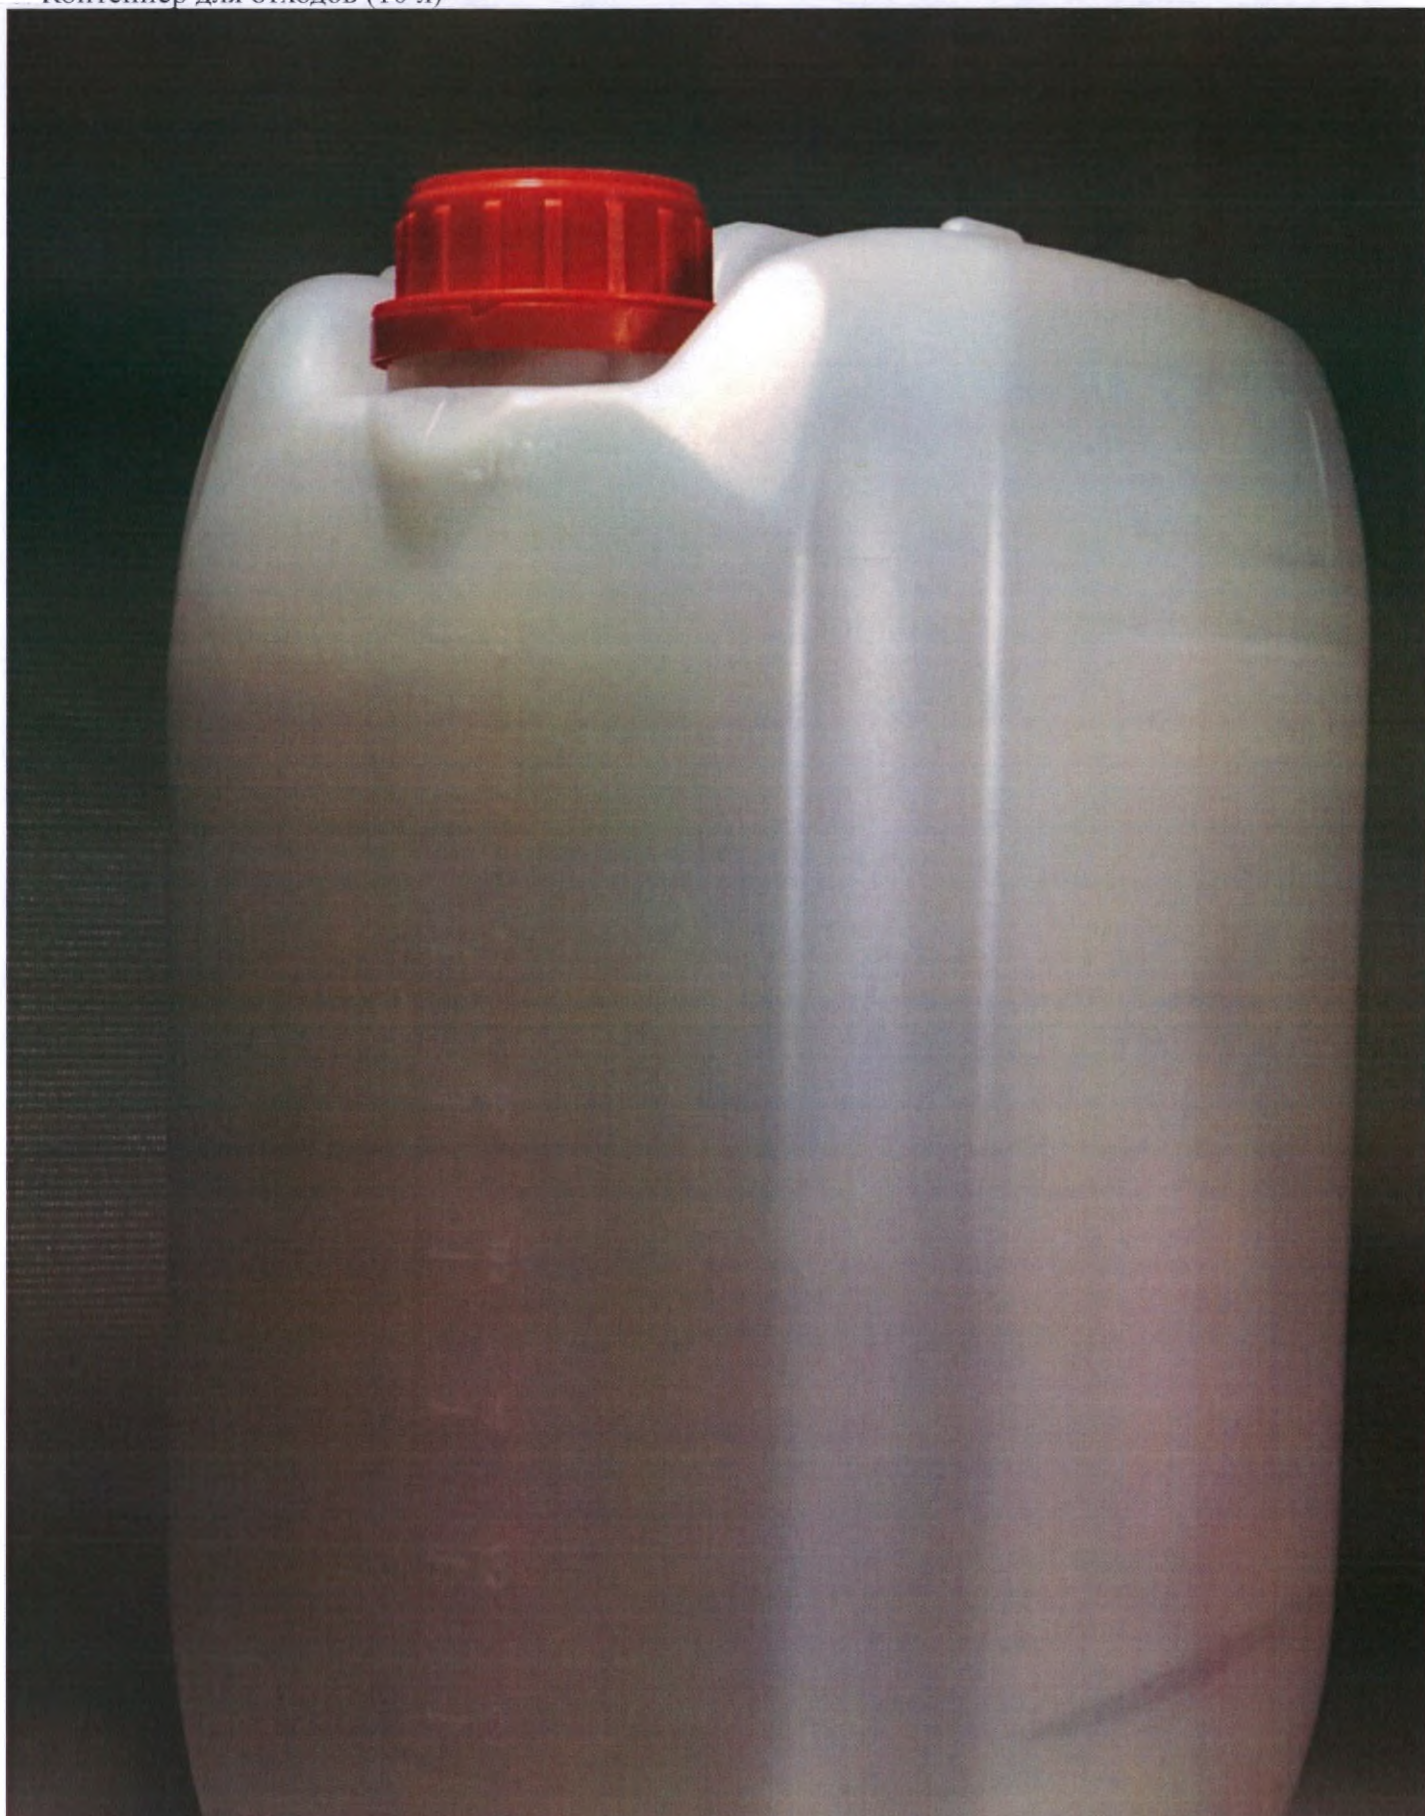

19. Датчик отходов – 1 шт.

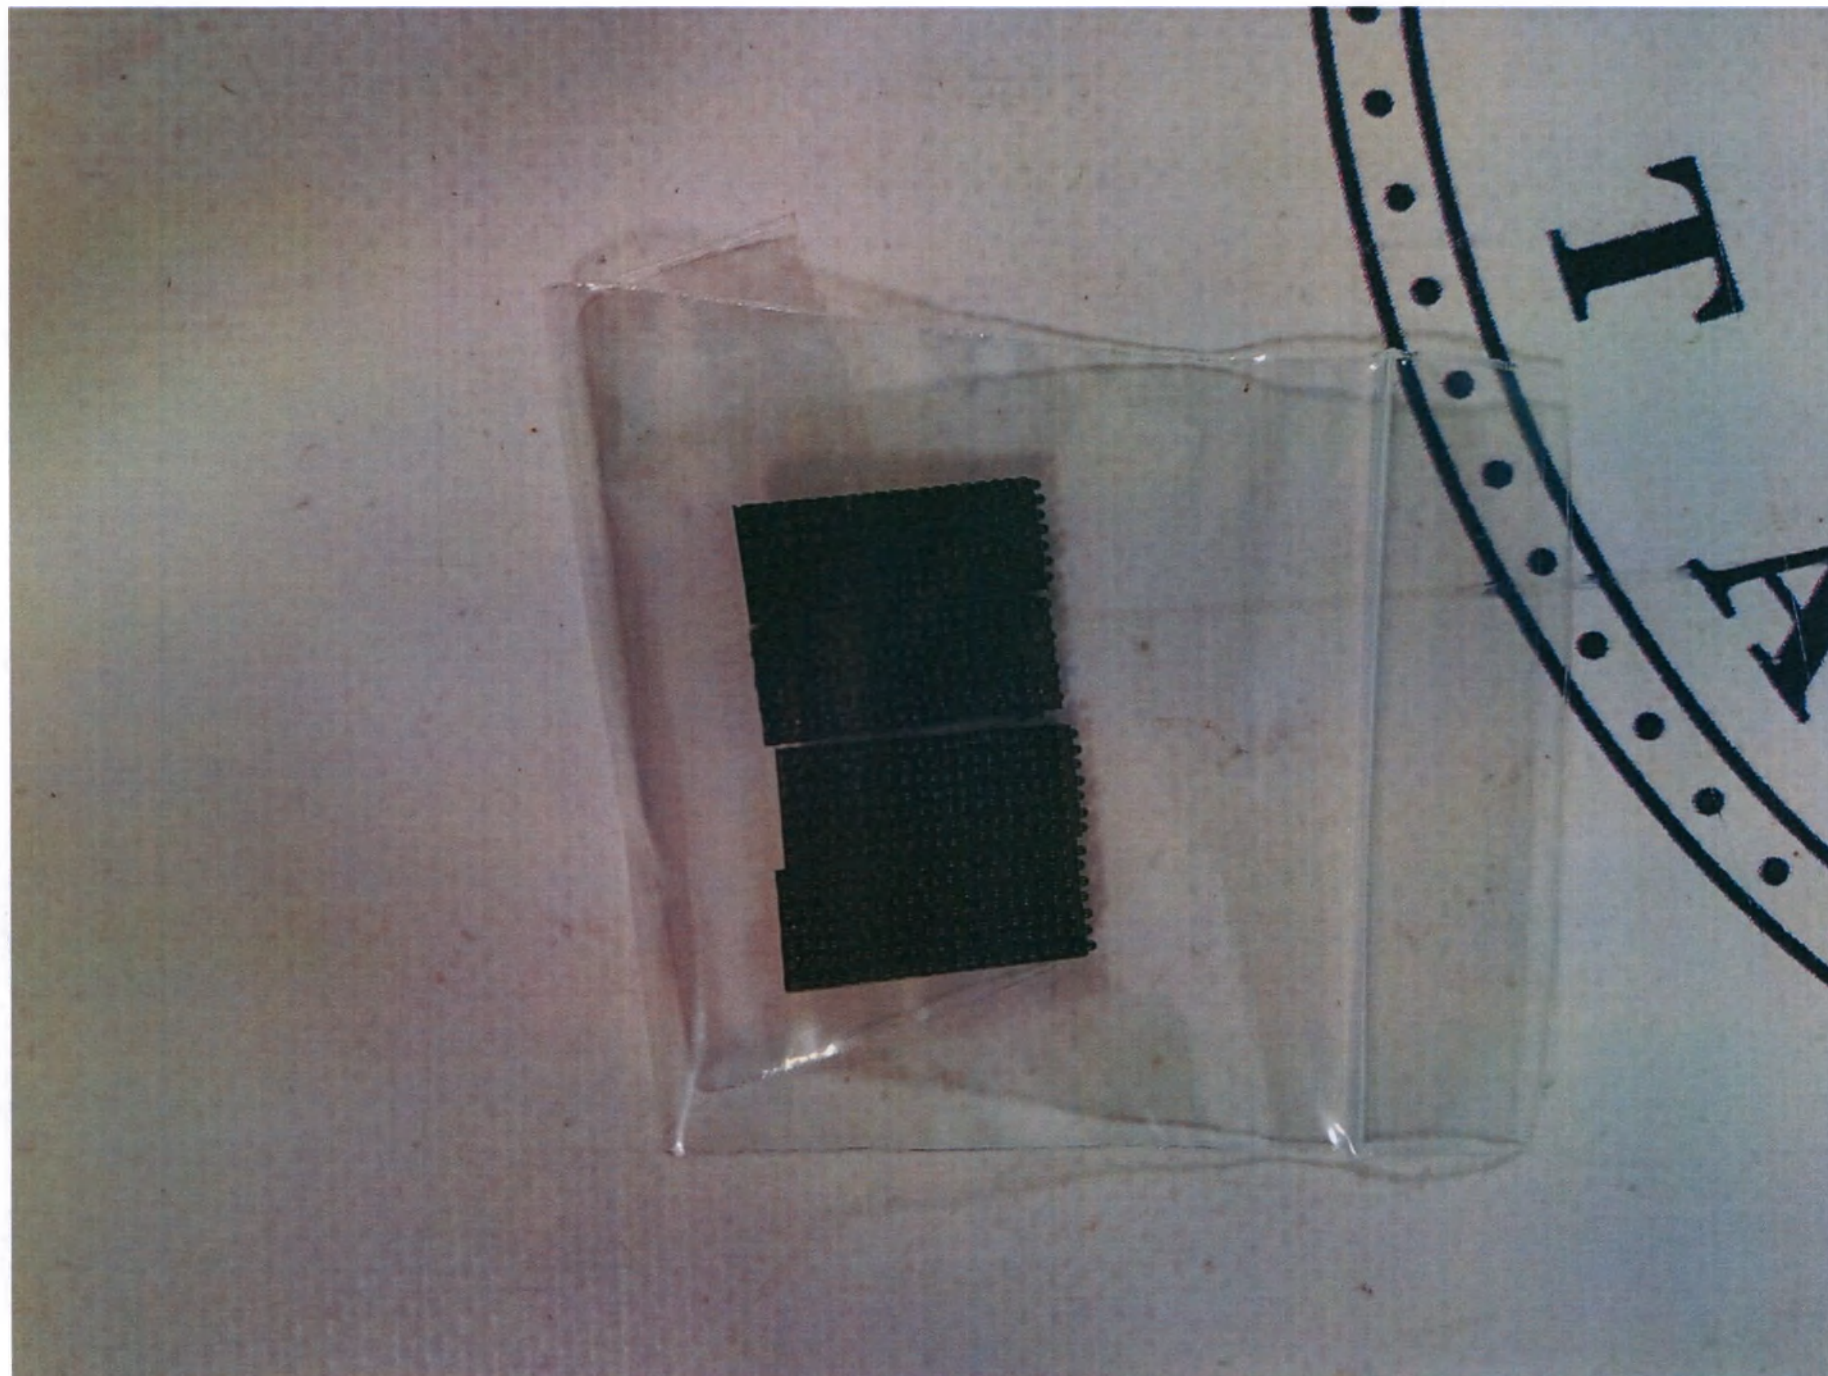



Celltac

HEMOGROBIN
FILTER 10PCS.
YZ-0024




NIHON KOHDEN

YZ -0024


0000477899

A0

Карта SD (1 Гб)

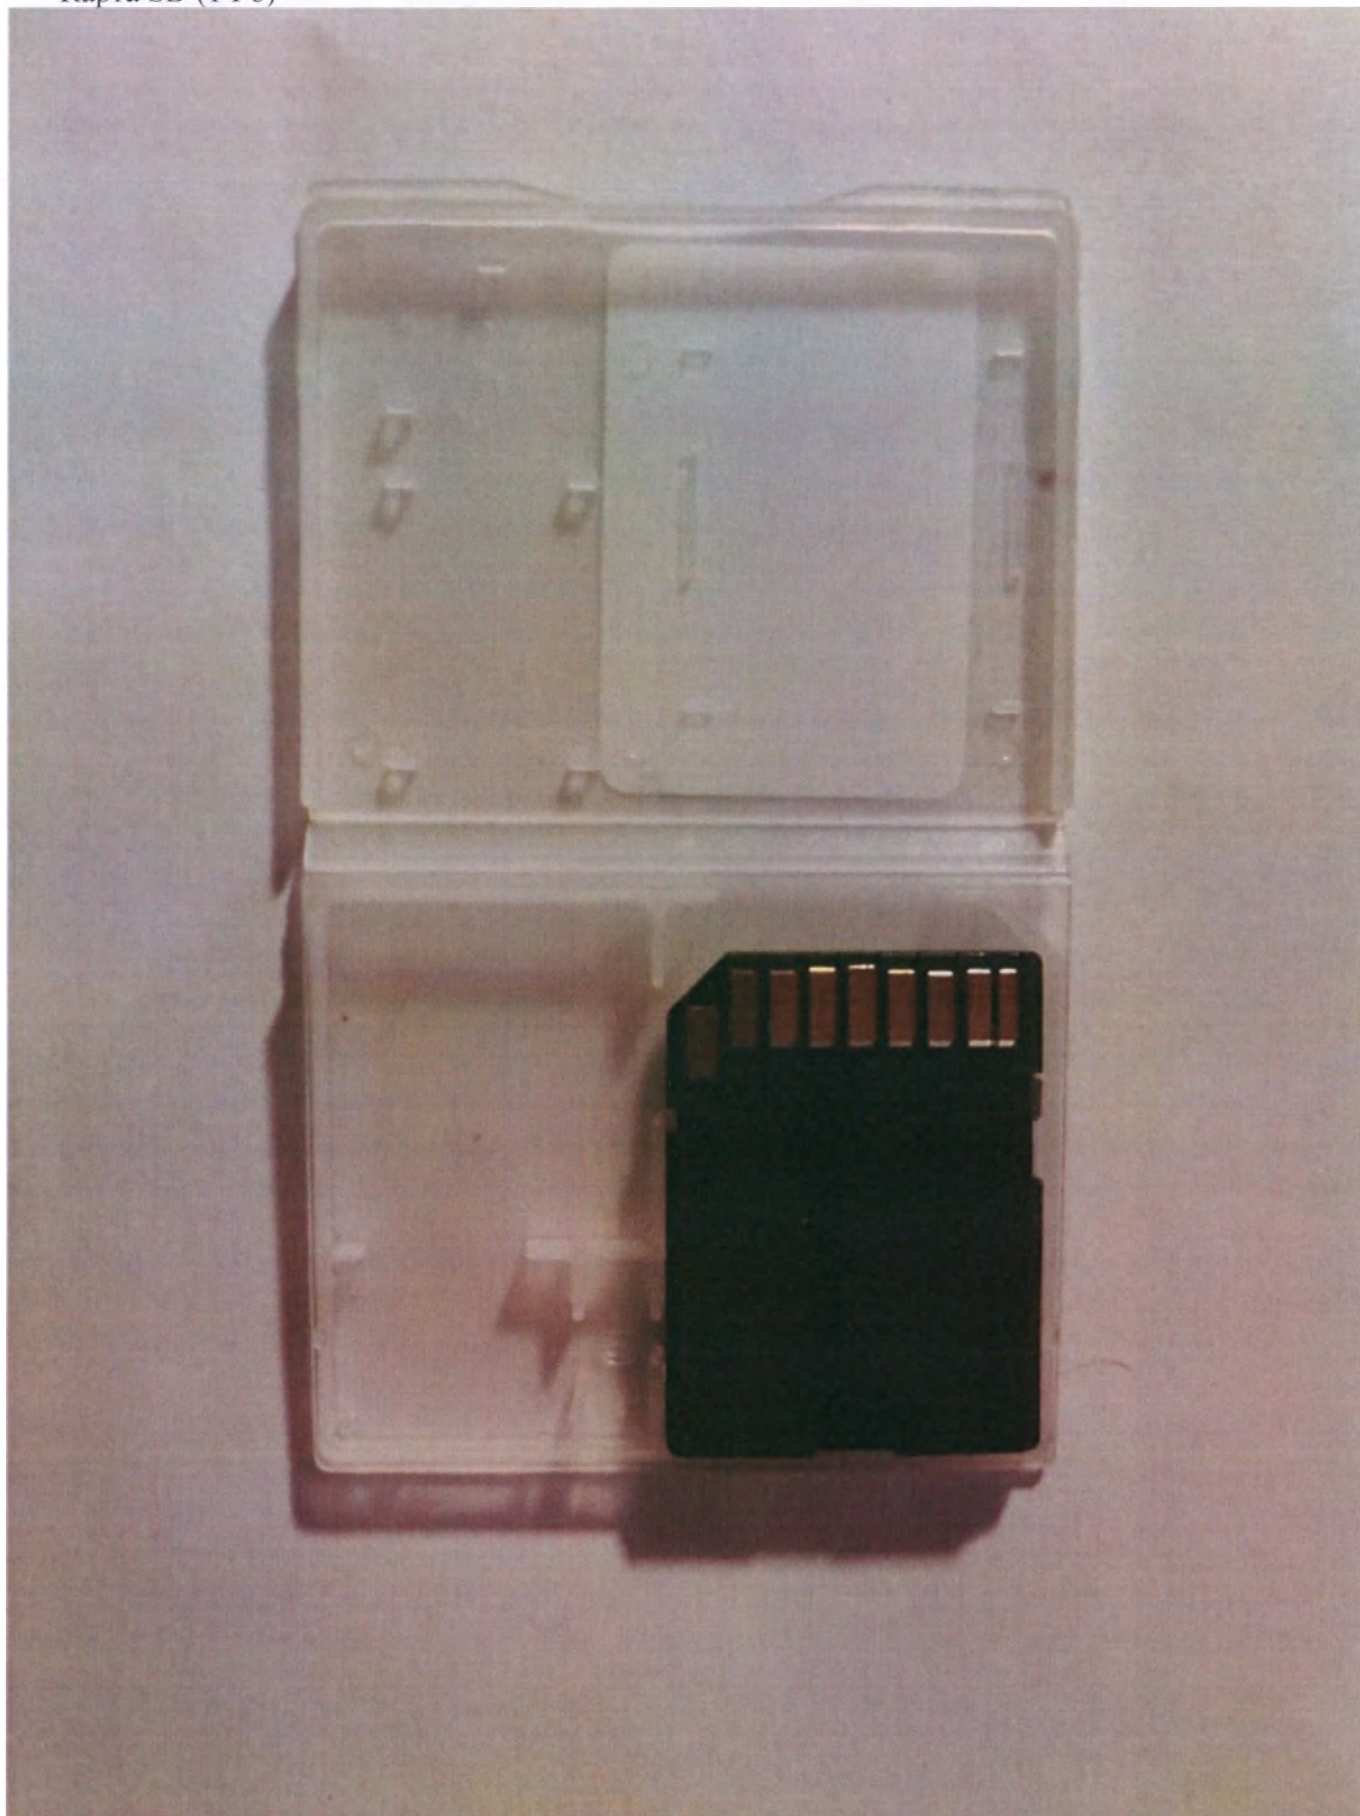

Карта SD (2 Гб) – 1 шт.

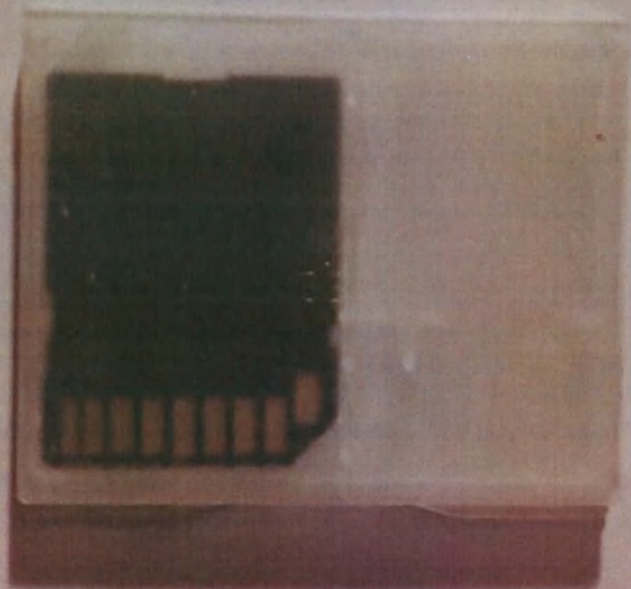

анализатор гематологический автоматический МЕК-1302, в составе:
Анализатор гематологический автоматический МЕК-1302, общий вид (включая позицию 13.
портативный считыватель штрихкодов и принадлежность 19. компактный принтер.)



сзади:





420016955 MEK-1302



型名/商品コード (MODEL) **MEK-1302**

SERIAL No. **00005** (02K) REV. AB VER. 02-07

LOT No.

品 名 全自動血球計数器

電 源 100-240V 50/60Hz

備 考 付属品

 2102

入庫元 日本光電富岡 (株)

日本光電(NIHON KOHDEN CORPORATION)

 (01)04931921001844(21)00005

NK-Logistics

ЭКО
СОВРЕМЕН
Петров
Тел.: (4
E-mail:

ЭМ
ВАНД
зд 28 стр. 2
748-4351
#comeds.ru

Кому : ОФИС


Куда : Москва

№ заявки : ЭМ

Грузовы

1 из 6

2. Шнур электропитания

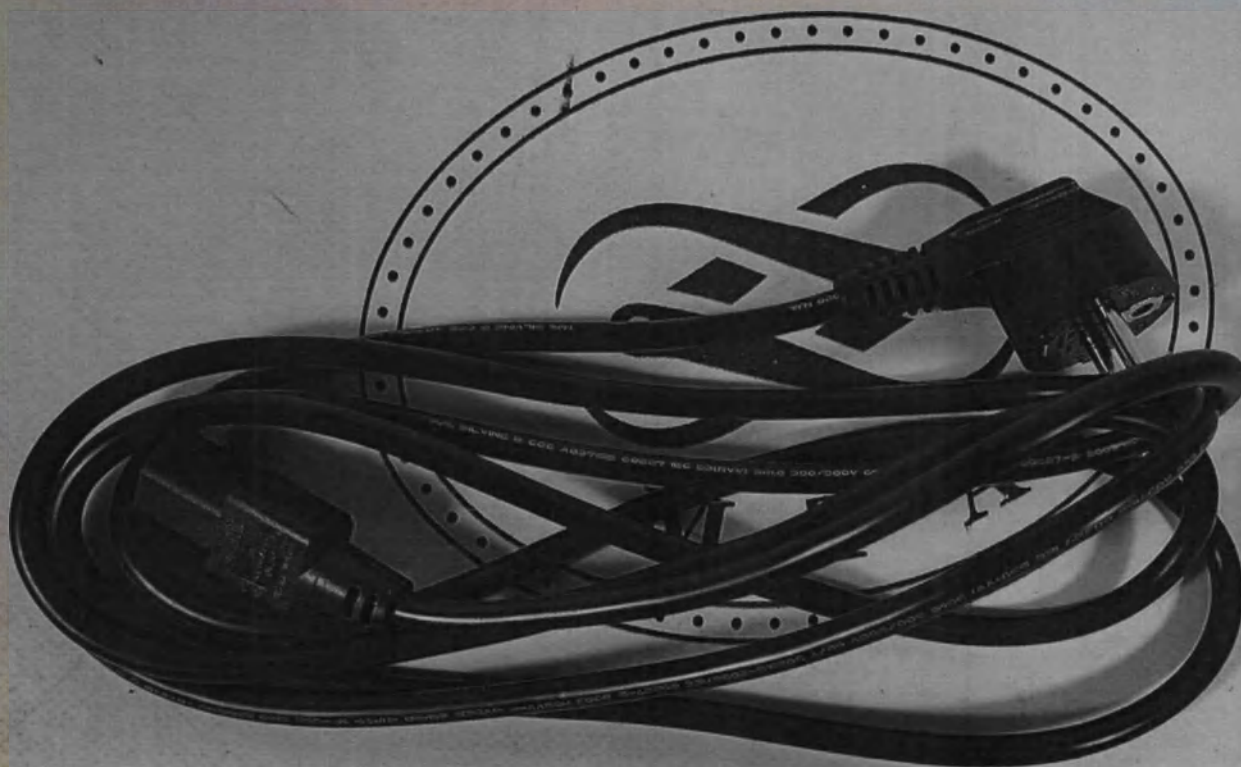

... Провод заземления D - 1 шт.




4. Плавкий инерционный предохранитель, 250 В, 2.0 А, $\varnothing 5.2 \times 20$ мм




5. Фильтр в сборе



Трубка дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4 в сборе (с позицией 15. Трубка дилюента (с синей манжетой) (для дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4 и с позицией принадлежностей 2. Крышка (для дилюента ISOTONAC•3 / ISOTONAC•4))

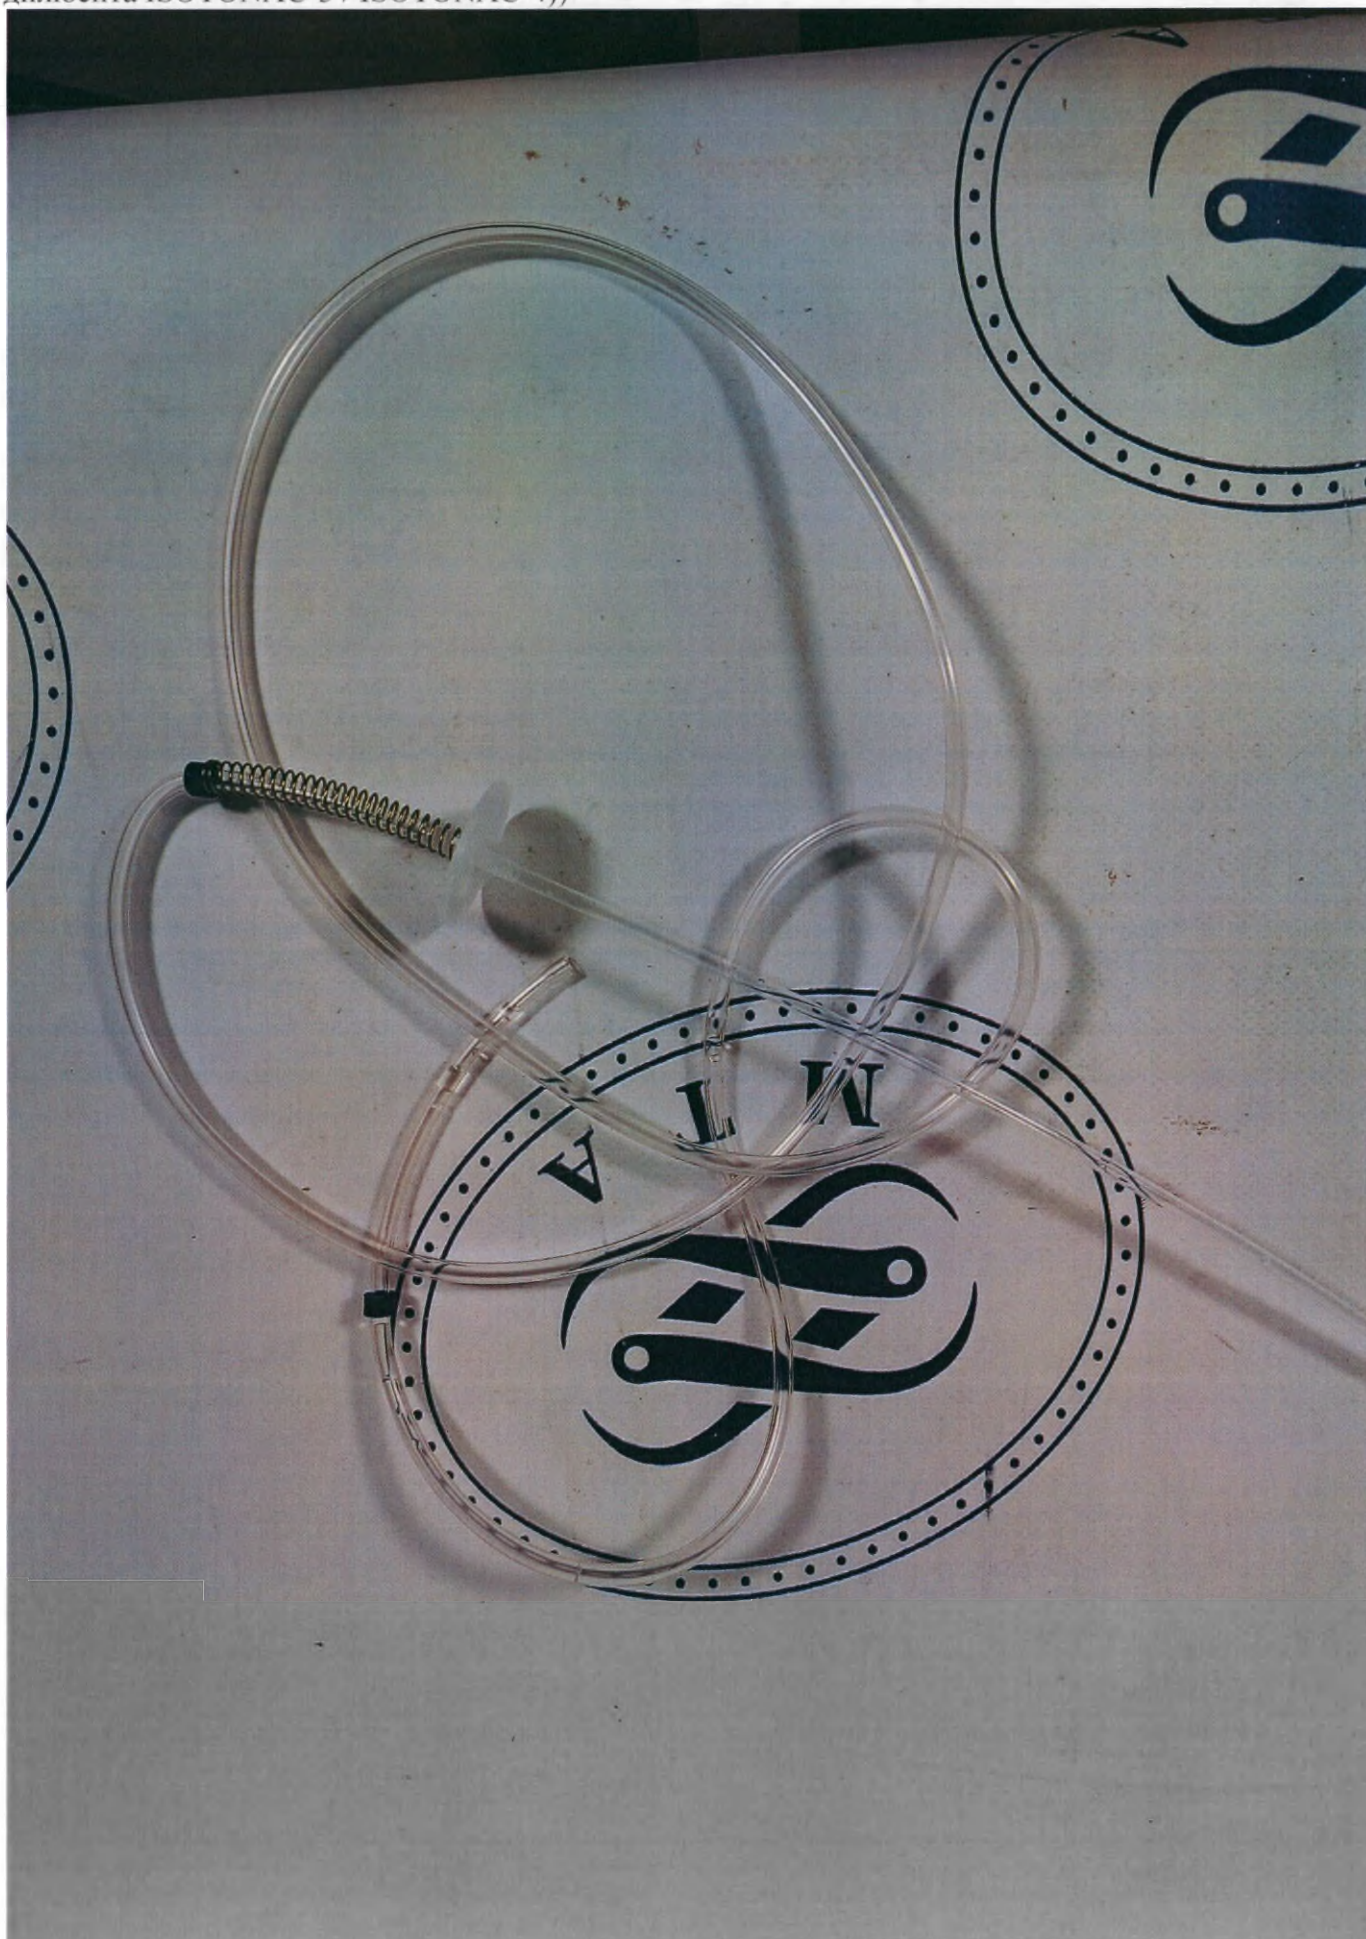

7. Трубка детергента CLEANAC•710 в сборе (с позицией 16. Трубка детергента (с зеленой манжетой), позицией 17. Трубка в сборе (для детерген CLEANAC•710) и позицией принадлежностей 3. Крышка МЕК (для детергента CLEANAC•710))

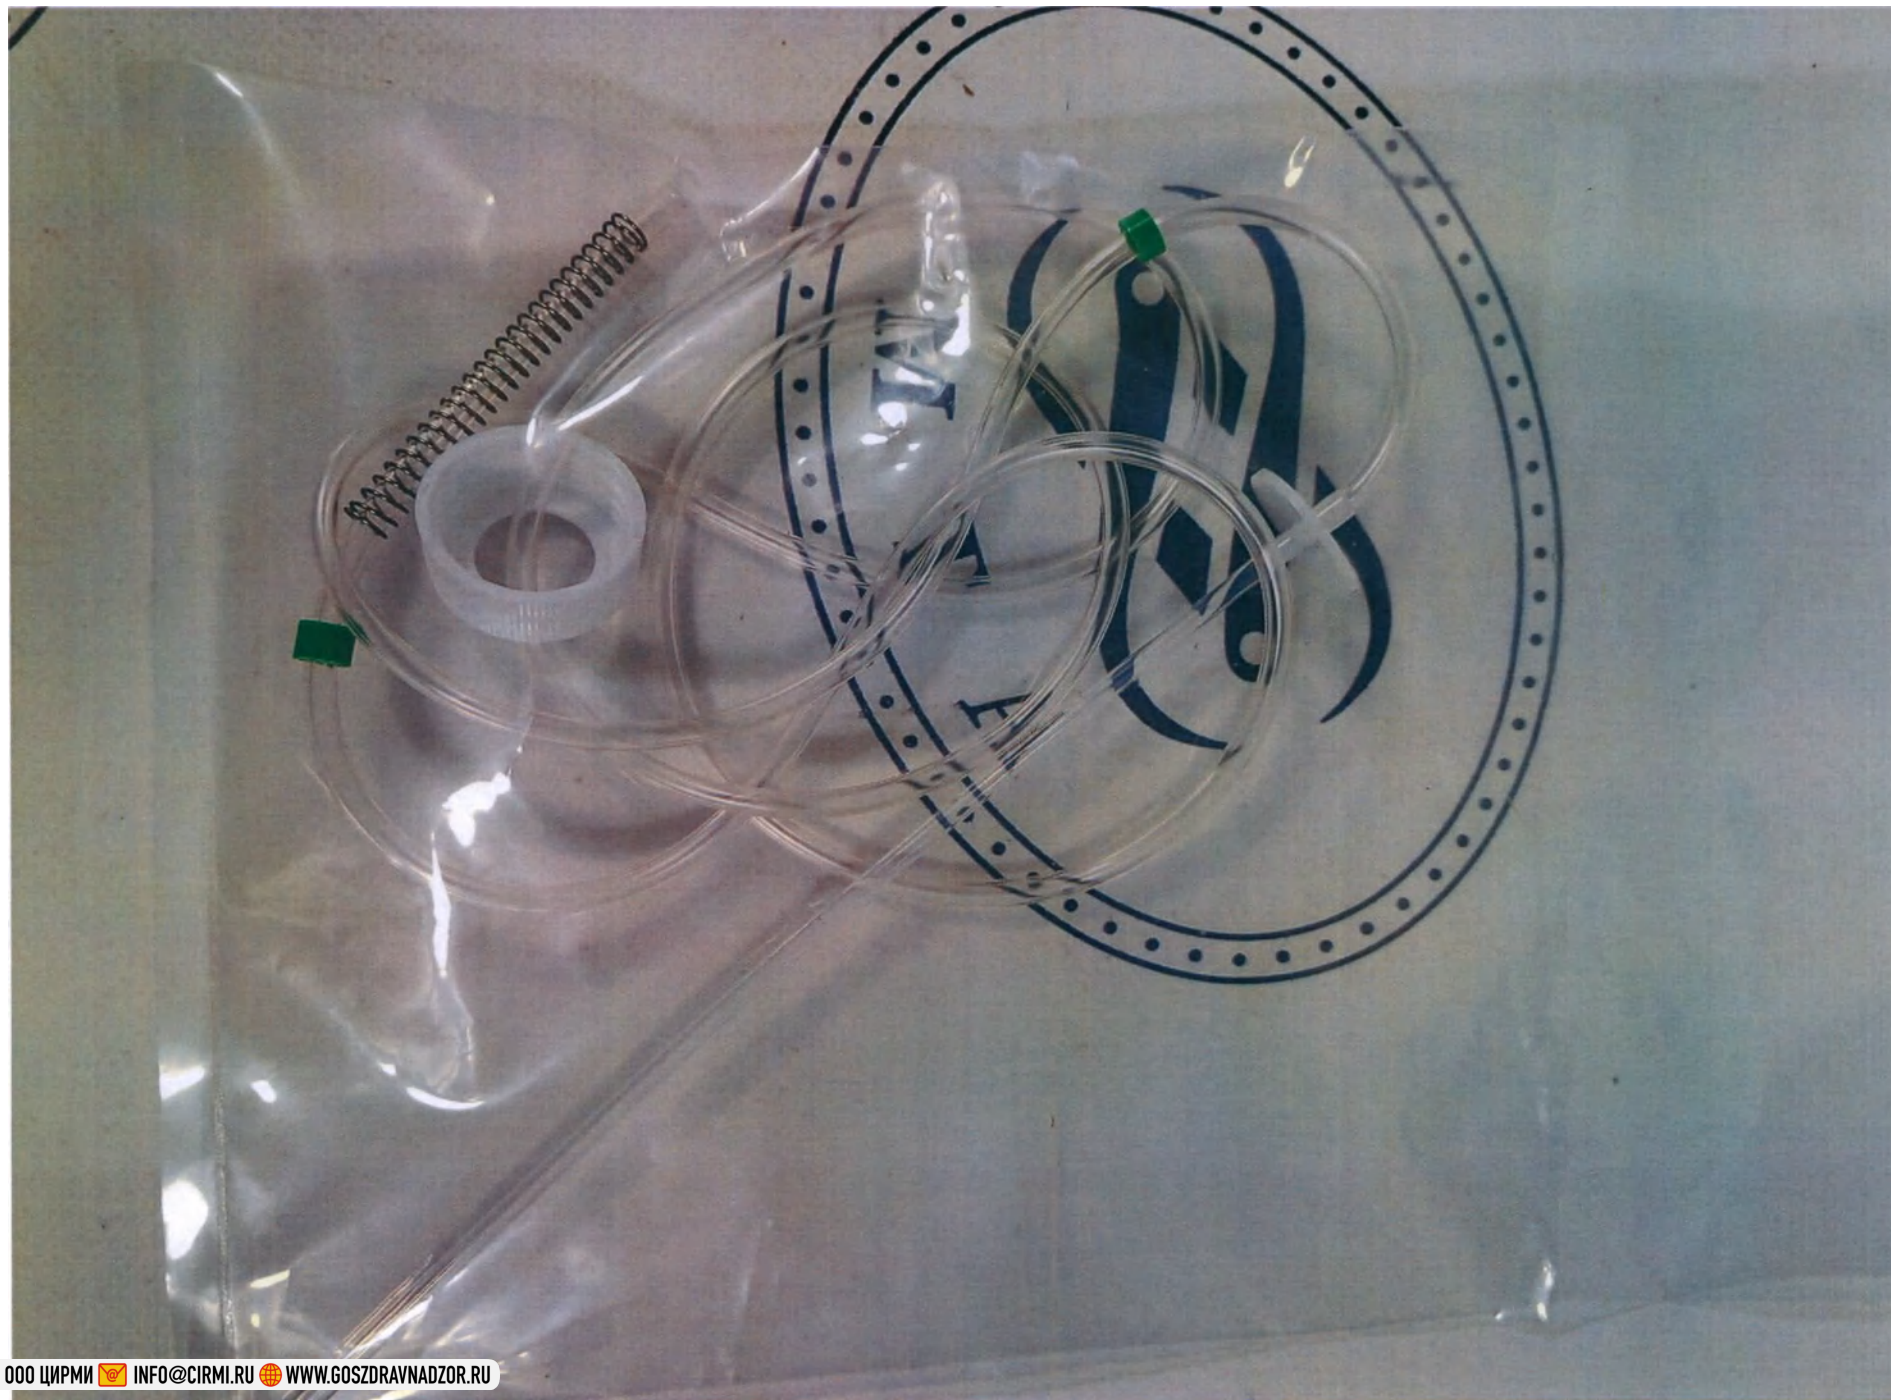


8. Трубка детергента CLEANAC•3 в сборе (с позицией 20. Трубка детергента (с белой манжетой) (для детергента CLEANAC•3))




Грубка реагента HEMOLYNAC•310 в сборе (с позицией 23. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 (цвет соединения: оранжевый)и позицией принадлежностей 4. Крышка реагента HEMOLYNAC•310 (оранжевая))



... Трубка для отходов в сборе (с позицией 19. Трубка для отходов (с красными манжетами)и позицией принадлежностей 1. Крышка контейнера для отходов (крышка бака для отходов))

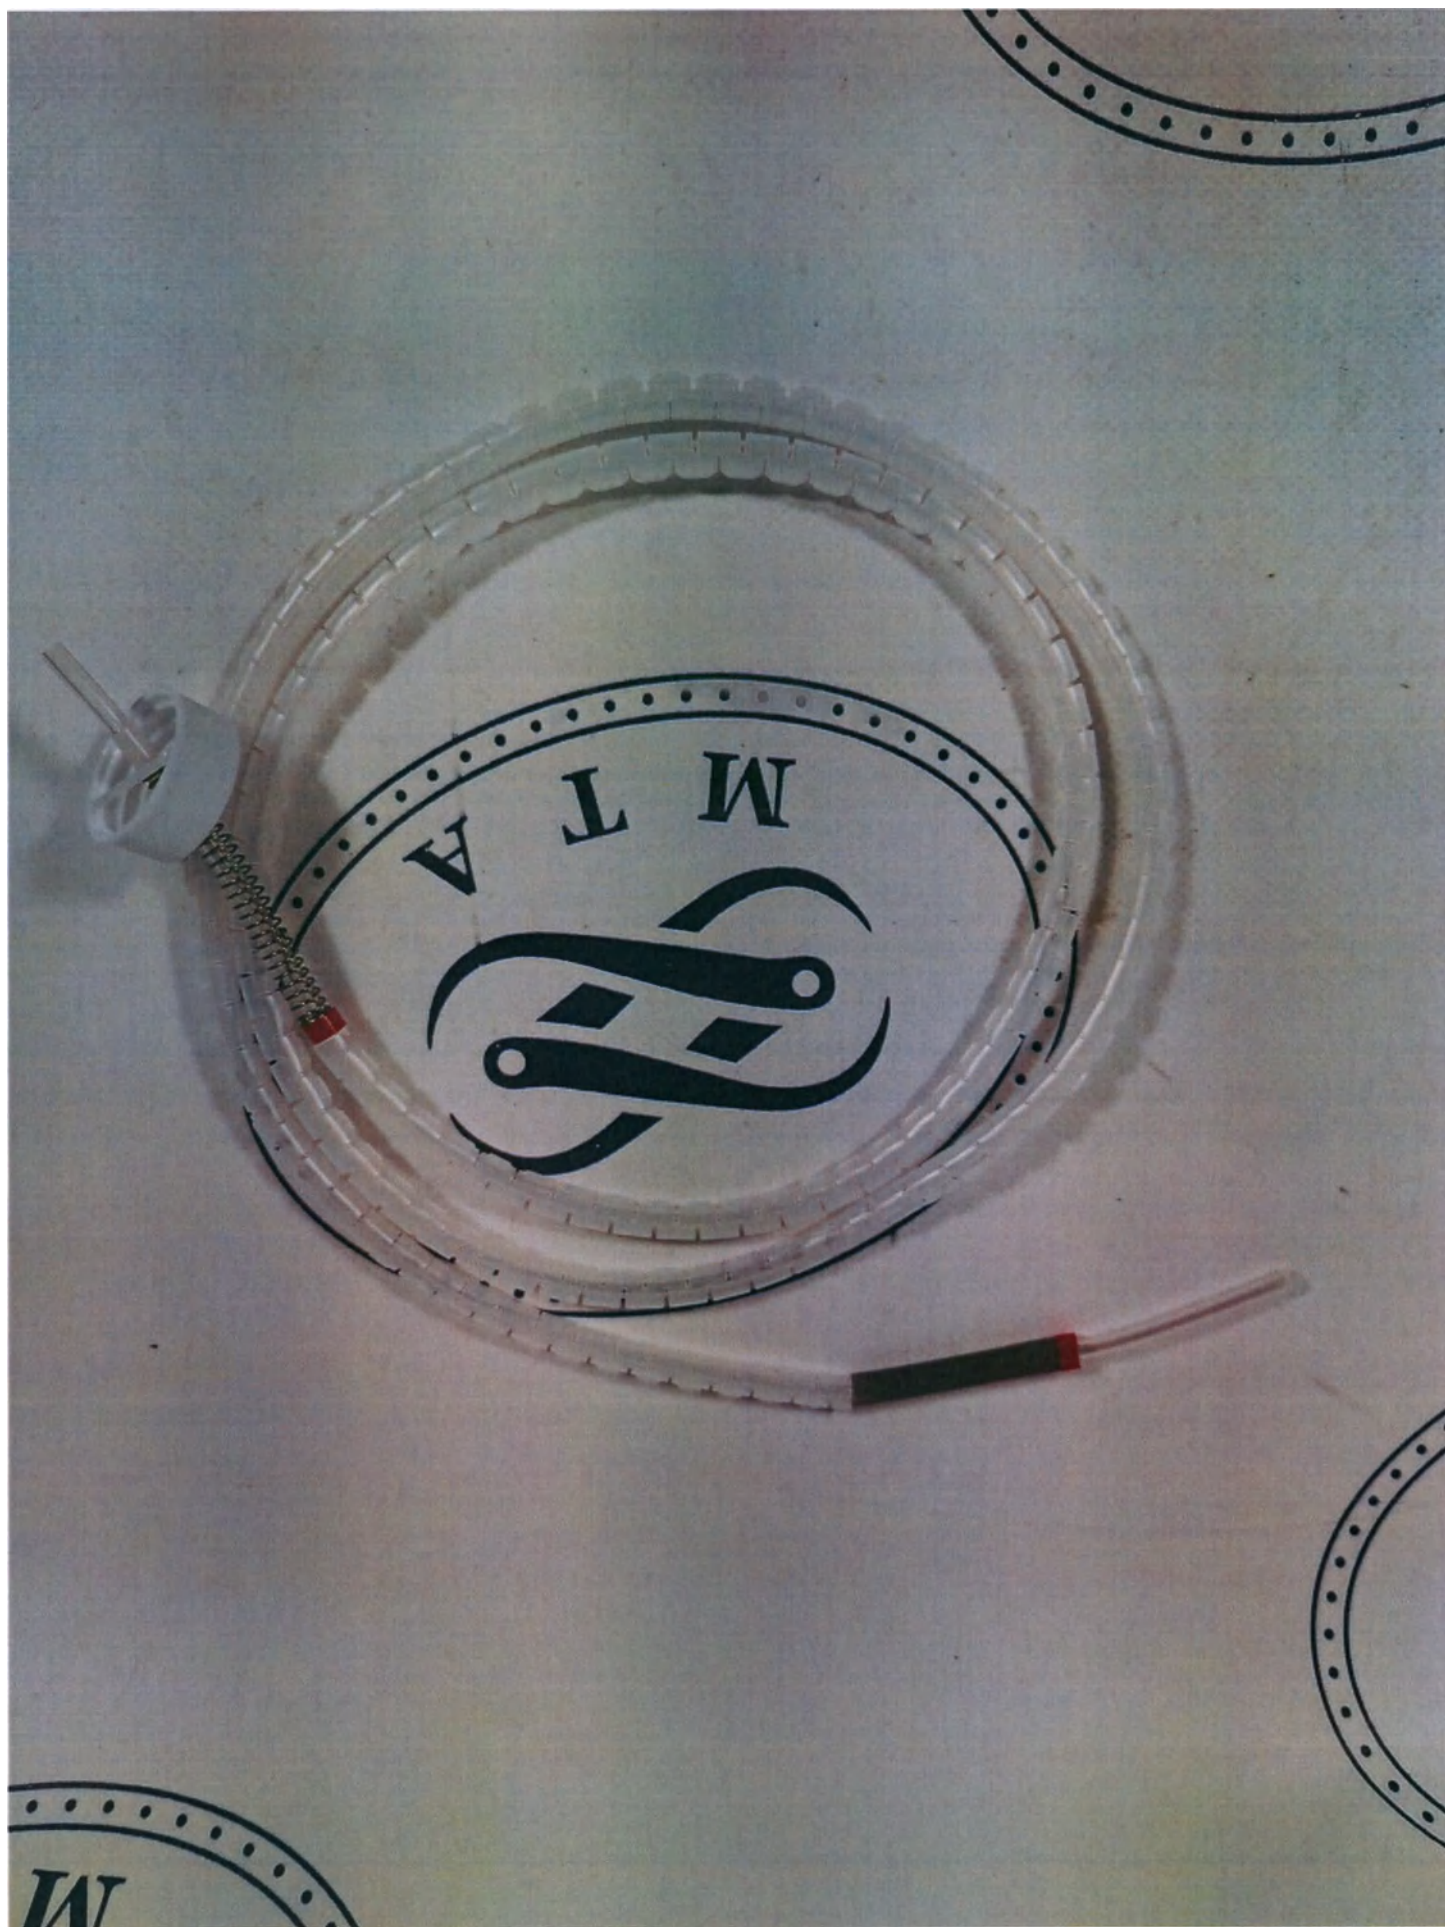

11. Контейнер для отходов

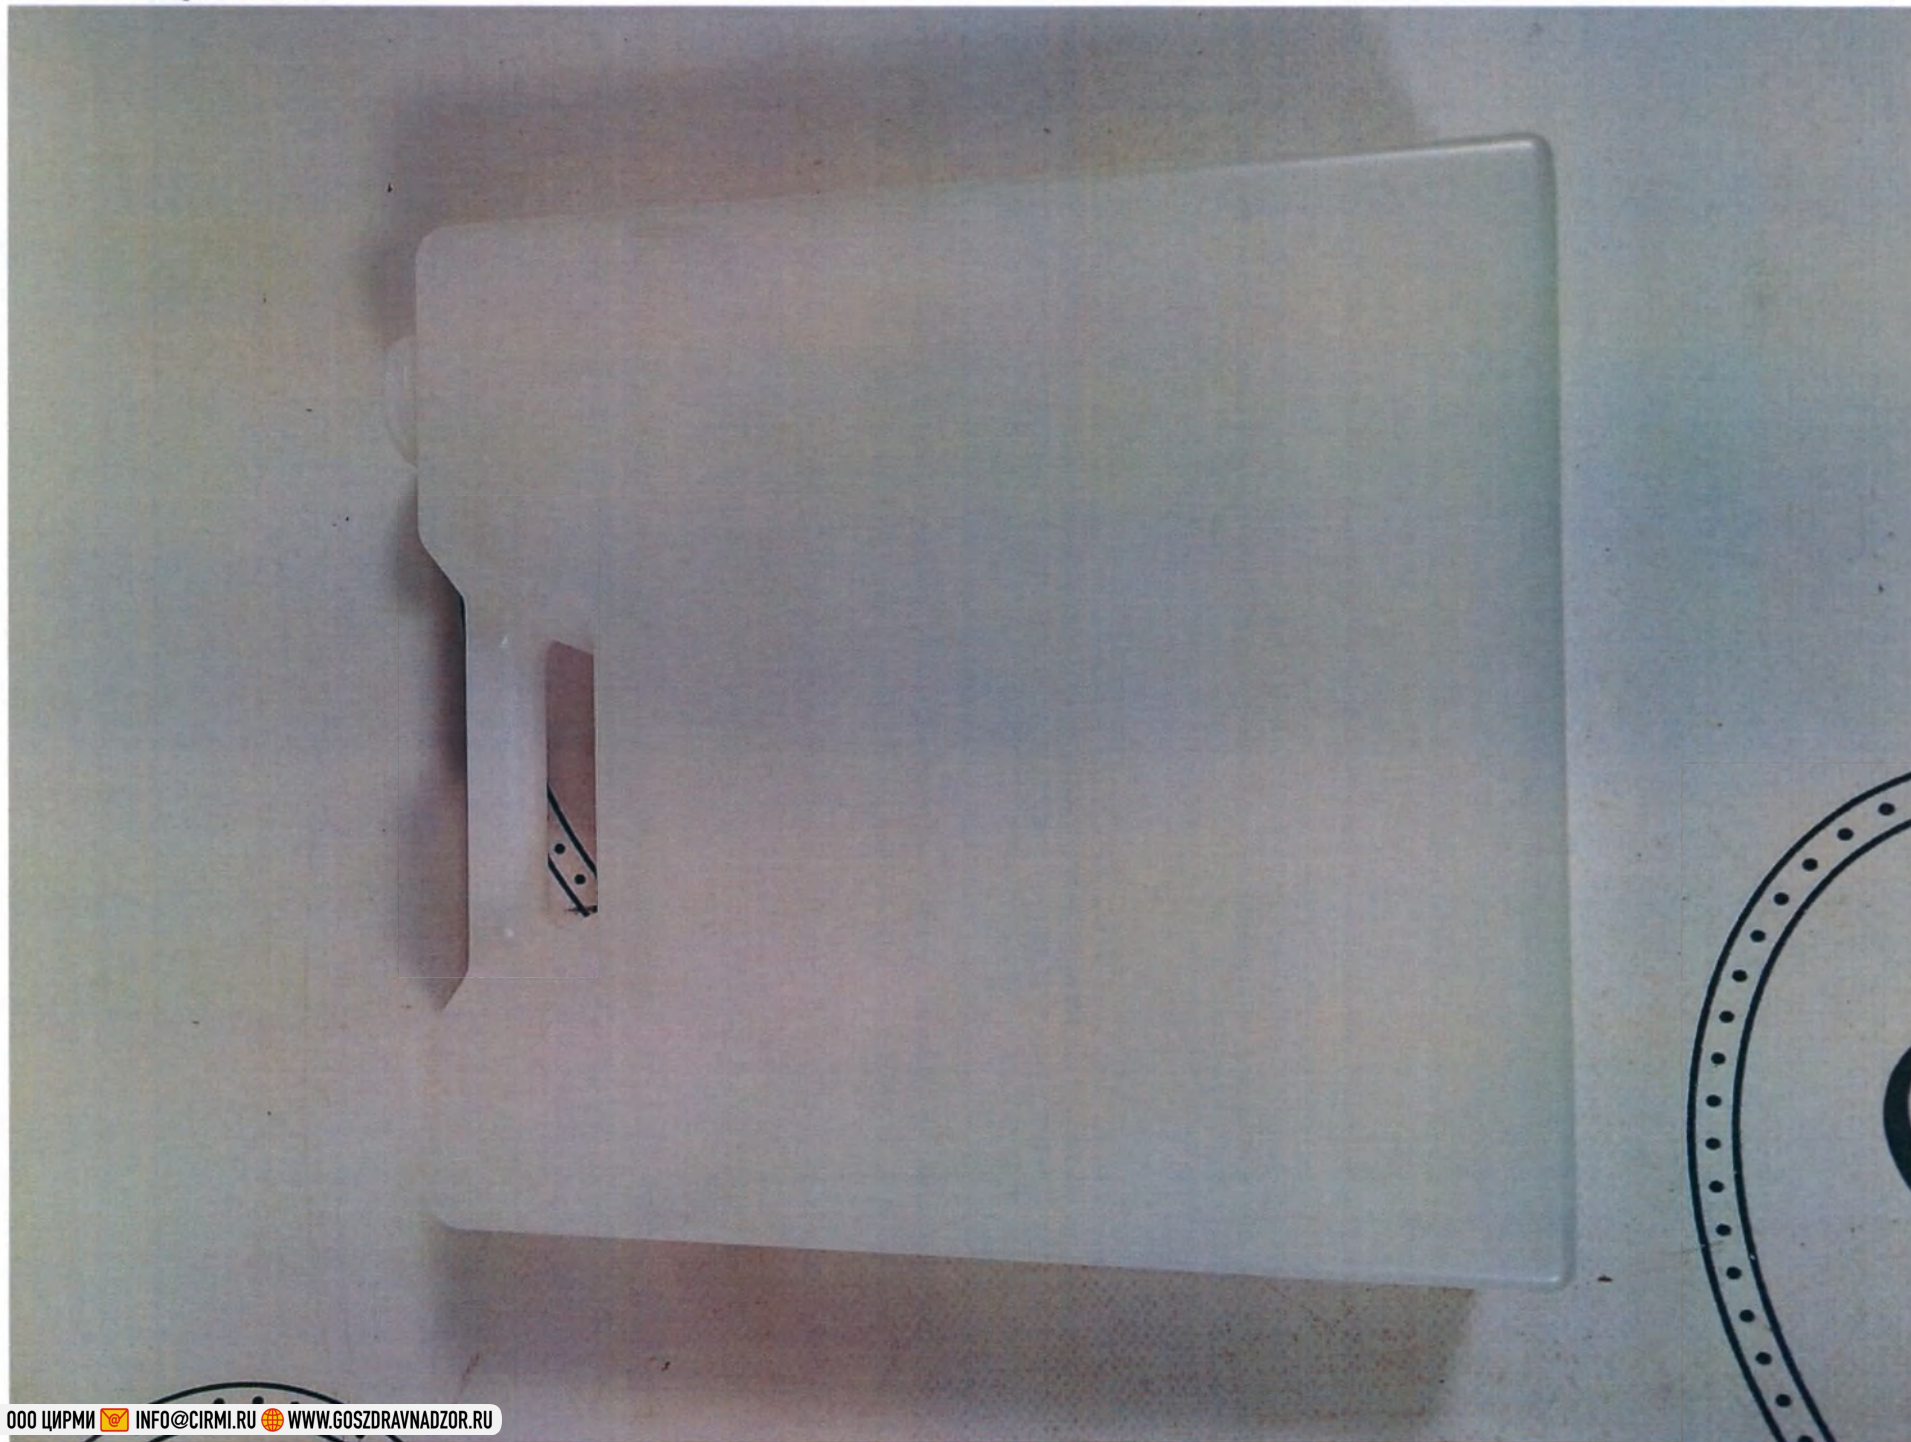


12. Трубка насоса в сборе



13. Портативный считыватель штрихкодов




14. Крышка отсека для реагентов

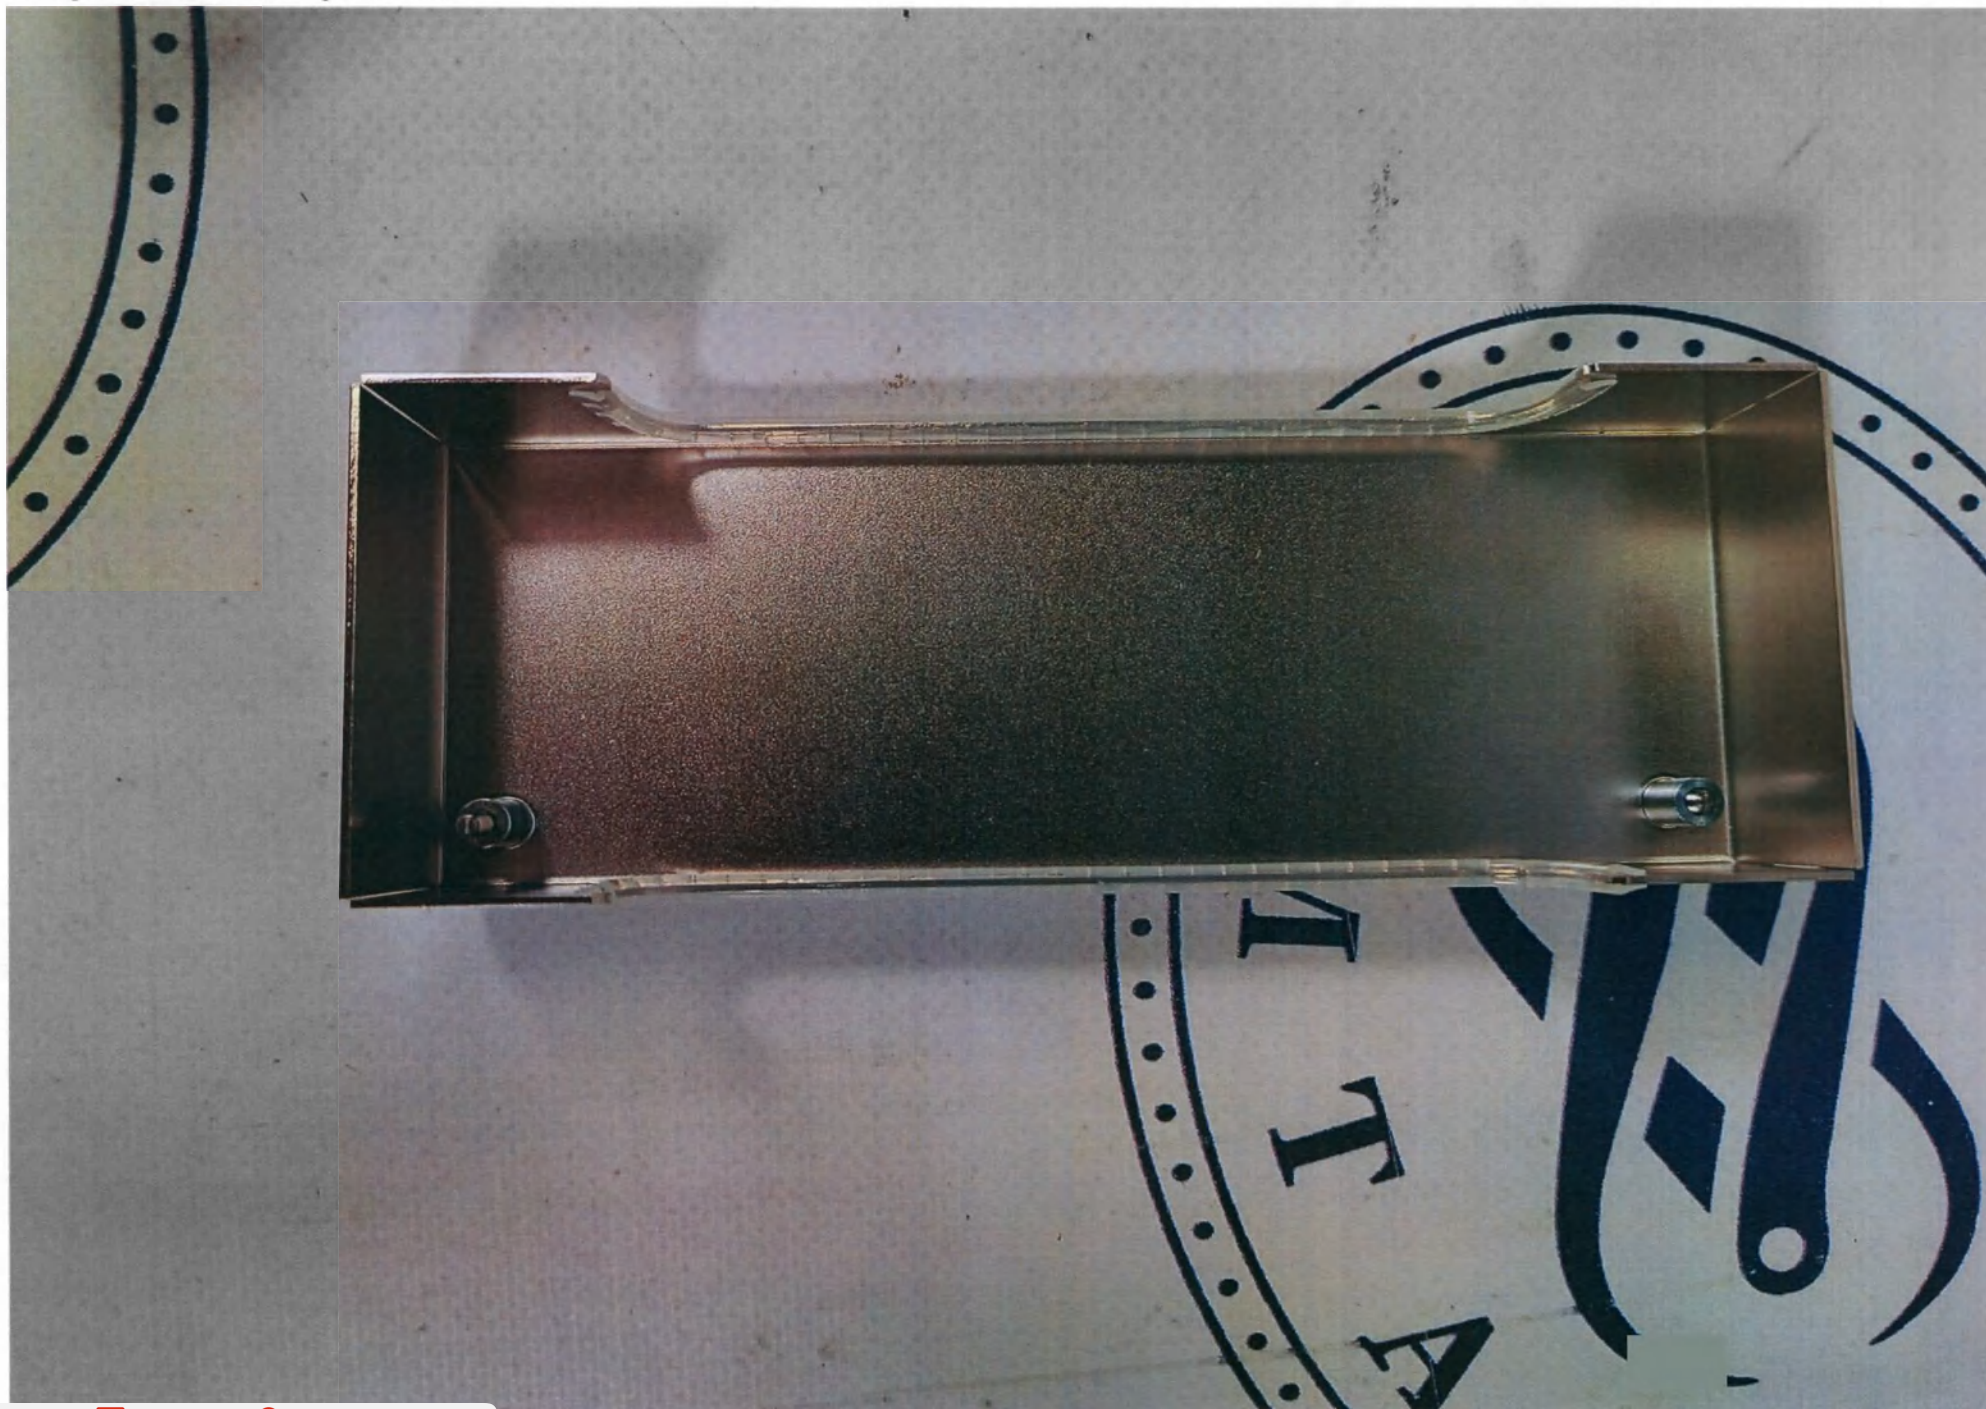

15. Трубка дилюента (с синей манжетой) (для дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4) (см. Рис. 6)
16. Трубка детергента (с зеленой манжетой) (для детергента CLEANAC•710) (см. Рис. 7)
17. Трубка в сборе (для детергента CLEANAC•710) (см. Рис. 7)

18. Трубка в сборе 3л (для детергента CLEANAC•710)

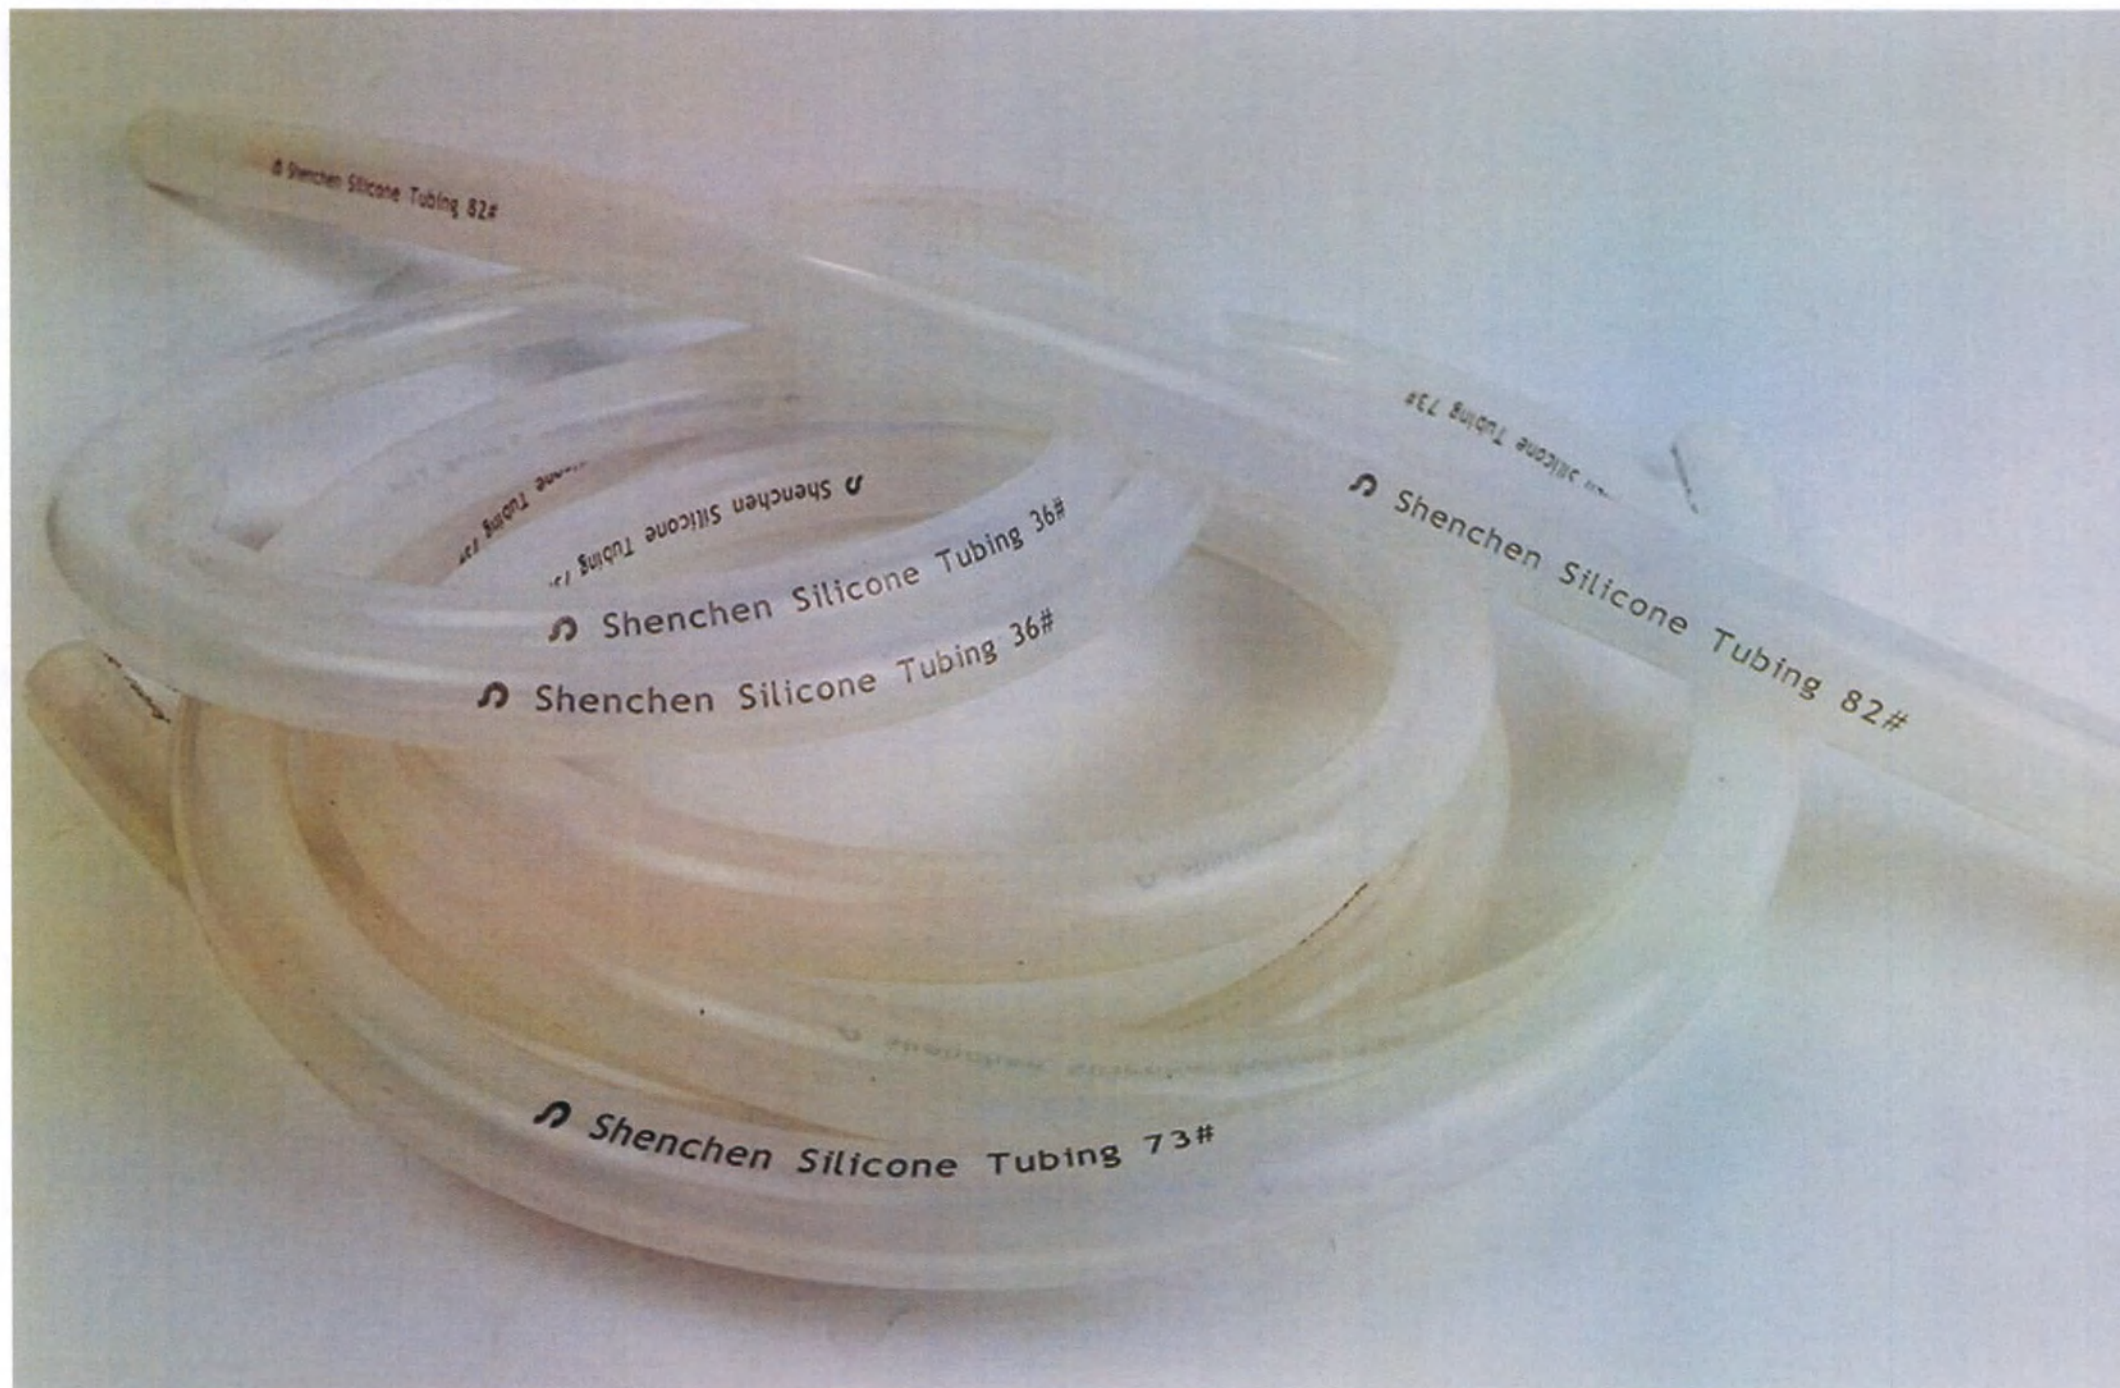

19. Трубка для отходов (с красными манжетами) (см. Рис. 10)
20. Трубка детергента (с белой манжетой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
21. Трубка в сборе 500 мл (с крышкой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
22. Трубка в сборе 1 л (с крышкой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
23. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 (цвет соединения: оранжевый) (см. Рис. 9)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНИЮ
на медицинское изделие**


**«Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения
МЕК-1302»**

**производства NIHON KOHDEN CORPORATION (Нихон Кодэн
Корпорейши), Япония**

Принадлежности:

1. Крышка контейнера для отходов (крышка бака для отходов) – см. Рис 10.
2. Крышка (для дилуэнта ISOTONAC•3 / ISOTONAC•4) – см. Рис 6.
3. Крышка MEK (для детергента CLEANAC•710) – см. Рис 7.
4. Крышка реагента HEMOLYNAC•310 (оранжевая) – см. Рис 9.

5. Штатив для реагентов

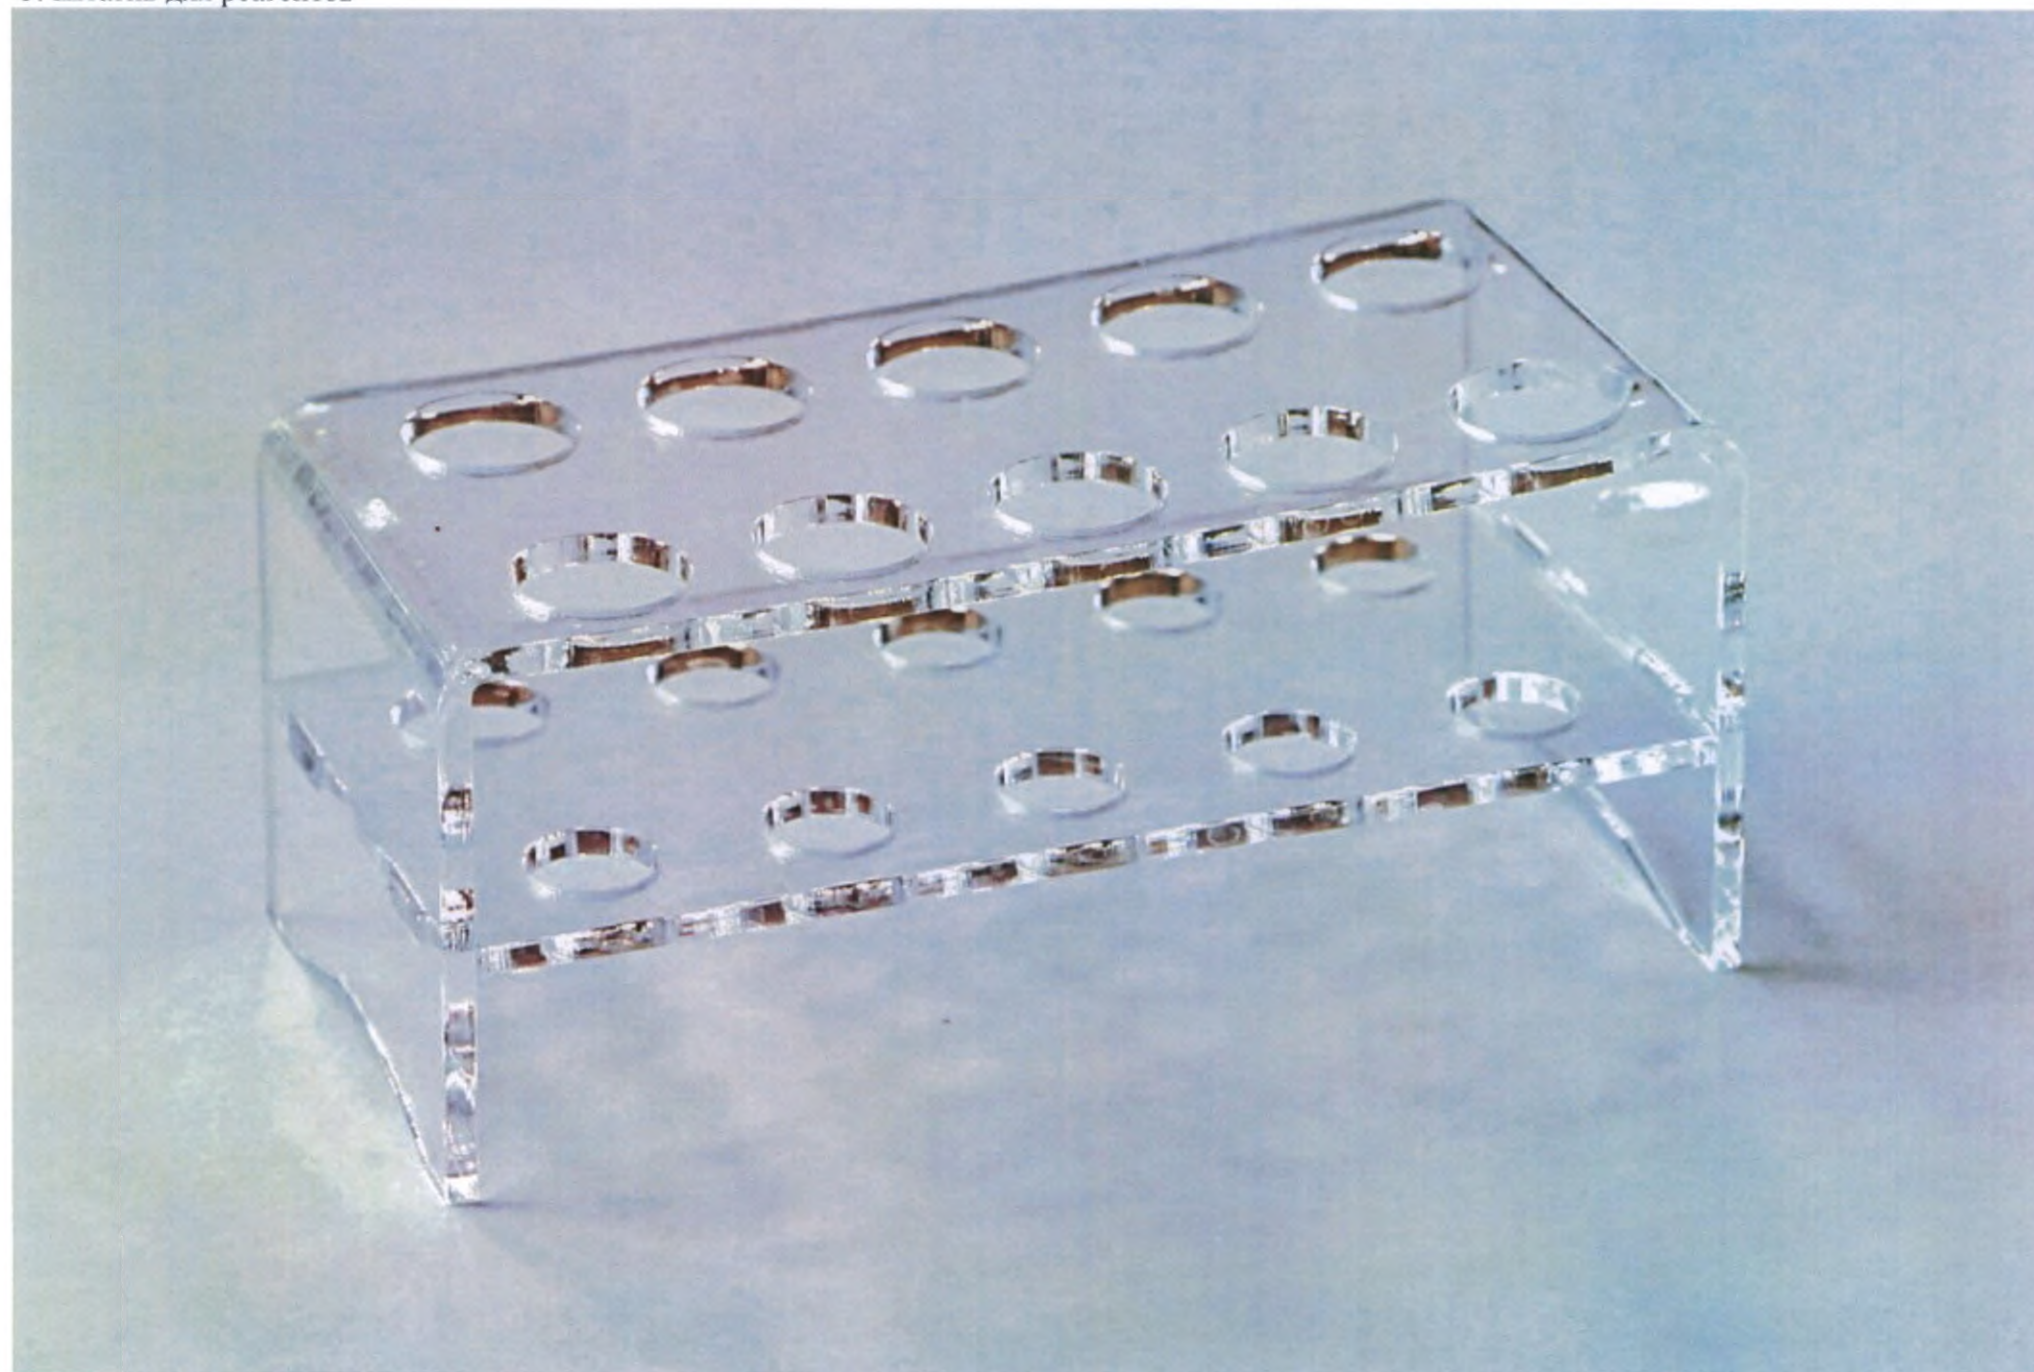

6. Бумажная лента




7. Компактный принтер – см Рис. 1 Общий вид анализатора


8. Кабель USB



9. Последовательный перекрестный кабель D9-D9

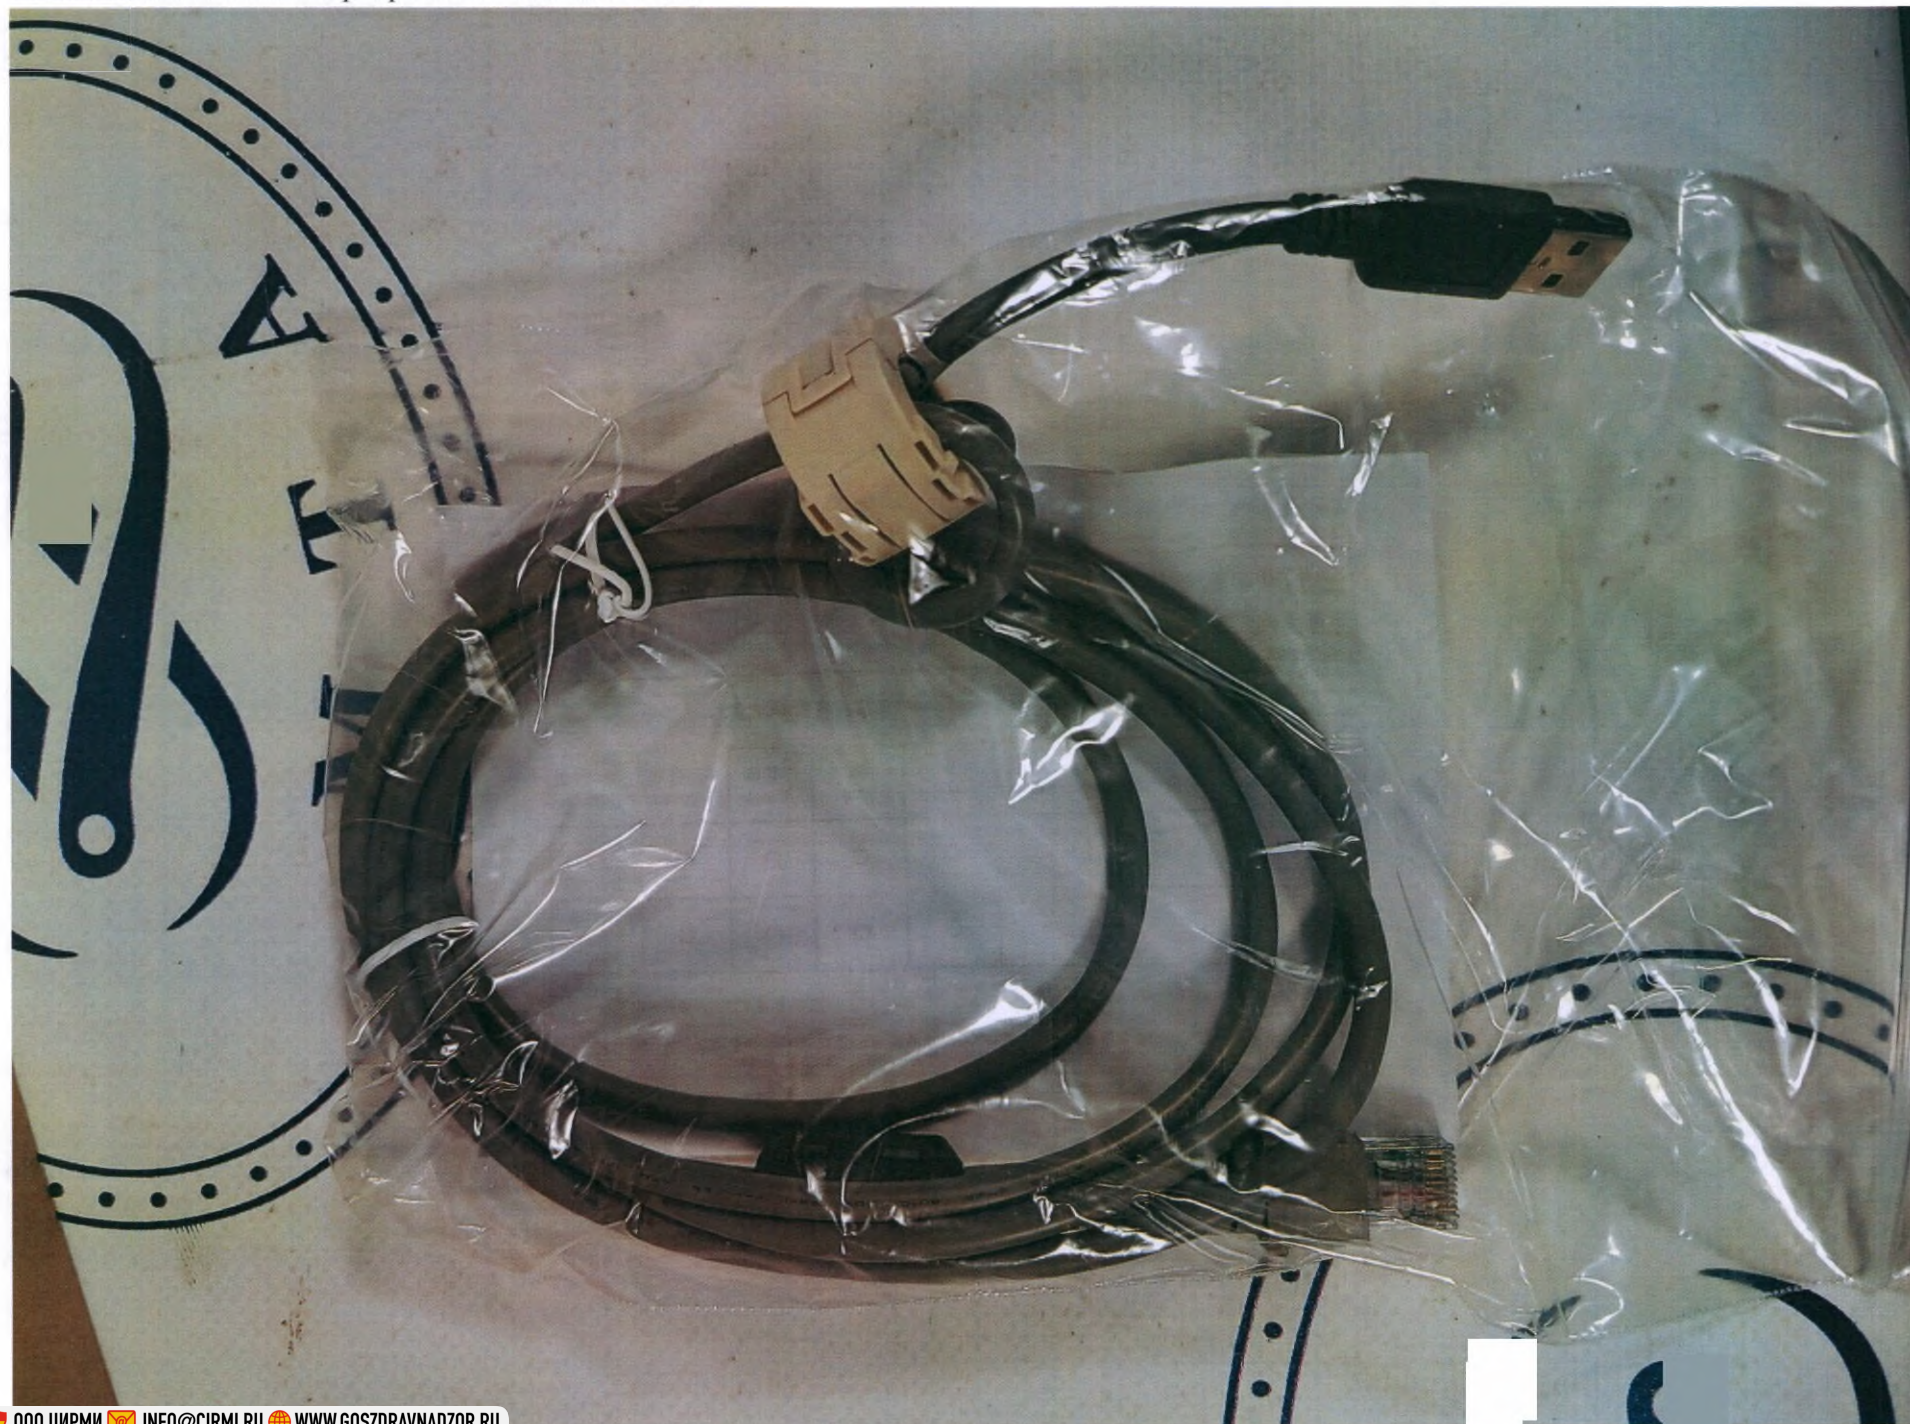


10. Кабель LAN

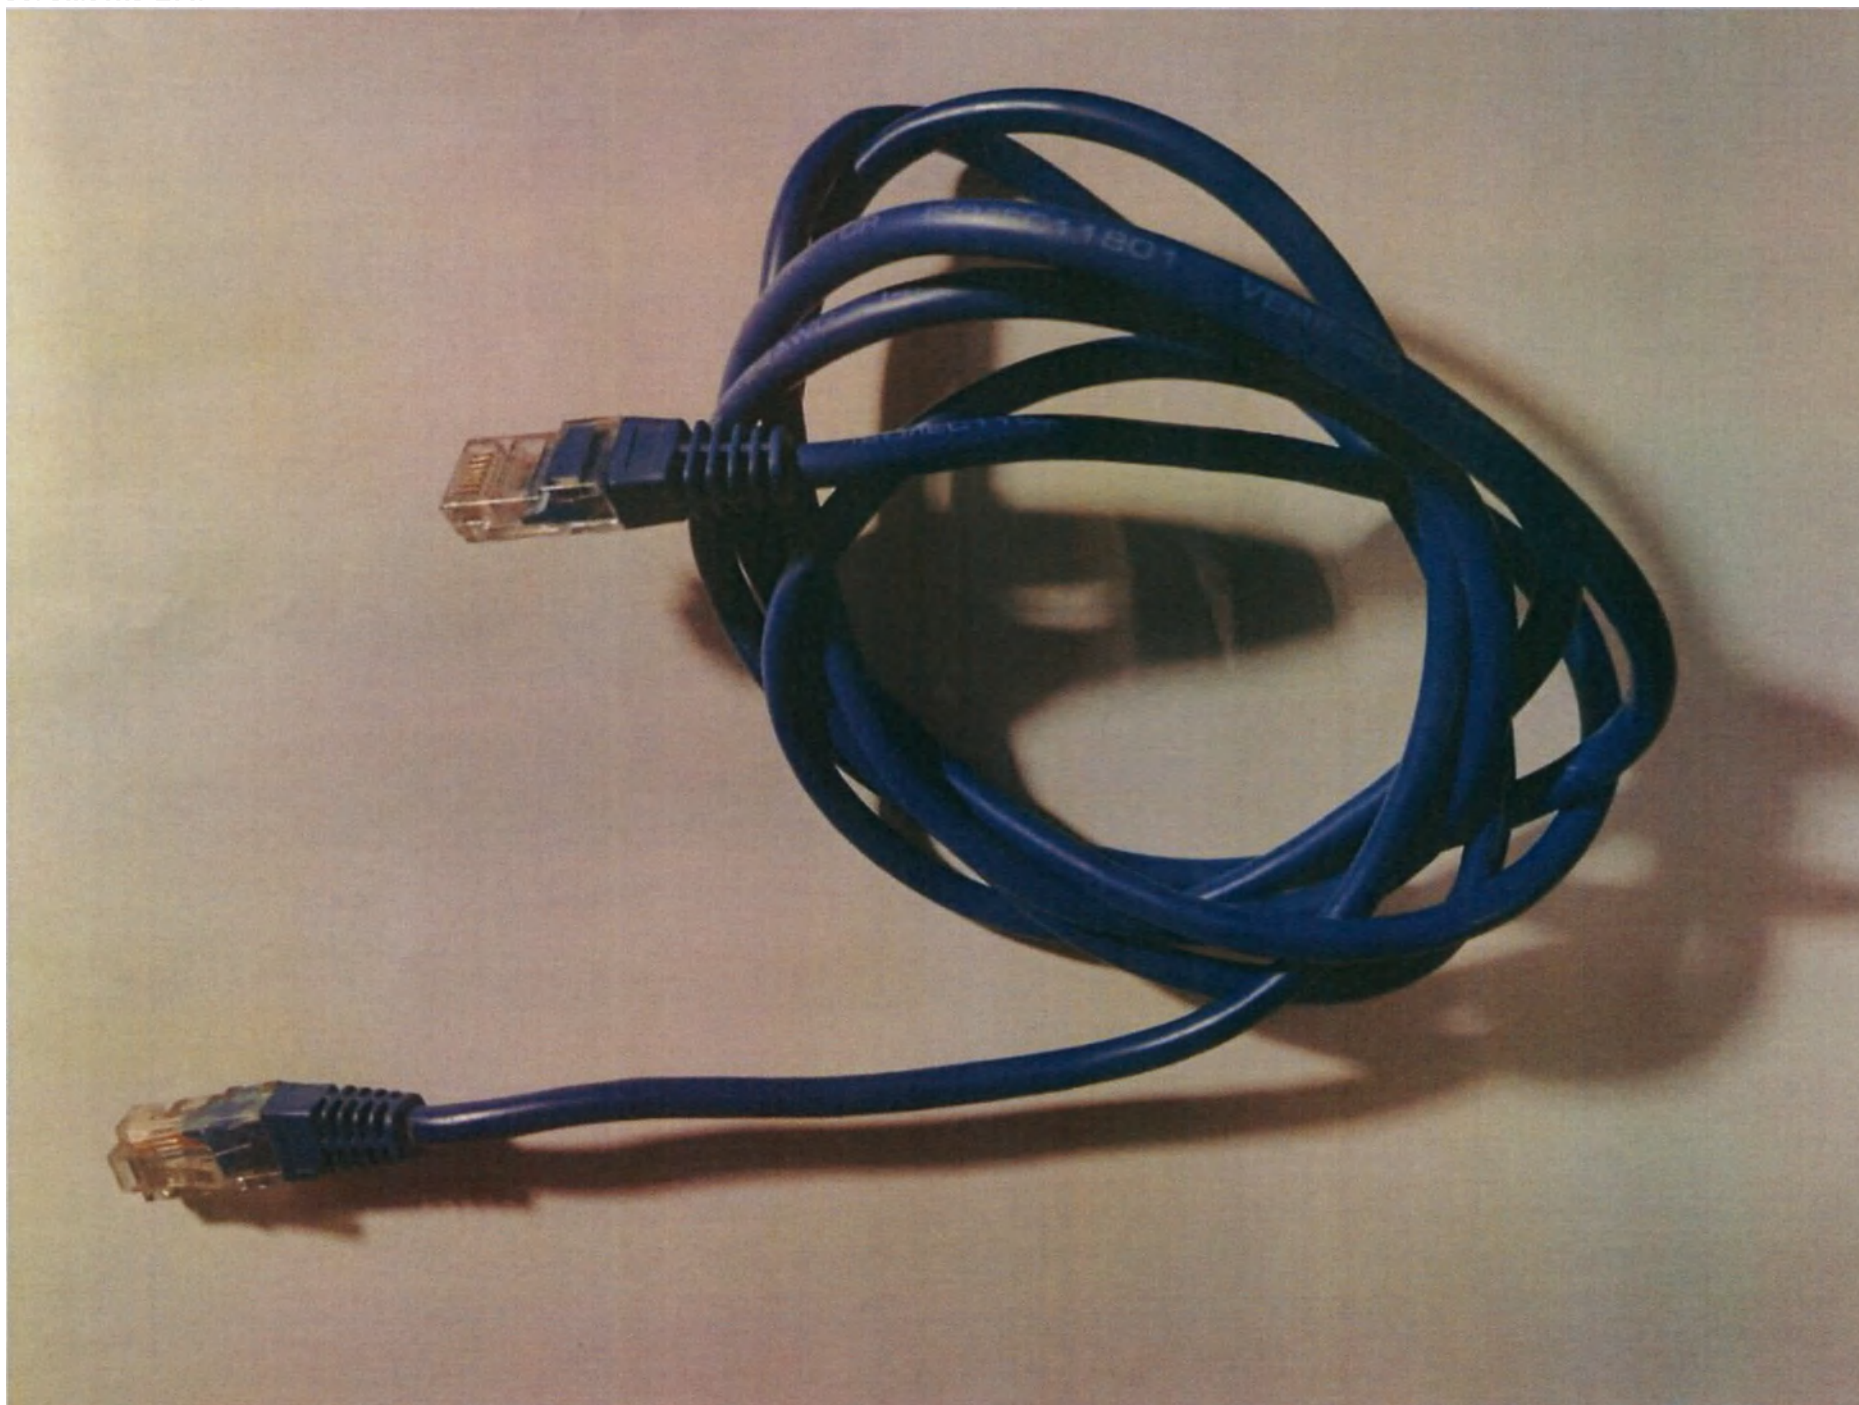


11. Пакет программного обеспечения



- . Комплект адаптера для капилляра (10 мкл) :
- Адаптер для капилляра (10 мкл)
 - Сборочное устройство (10 мкл)

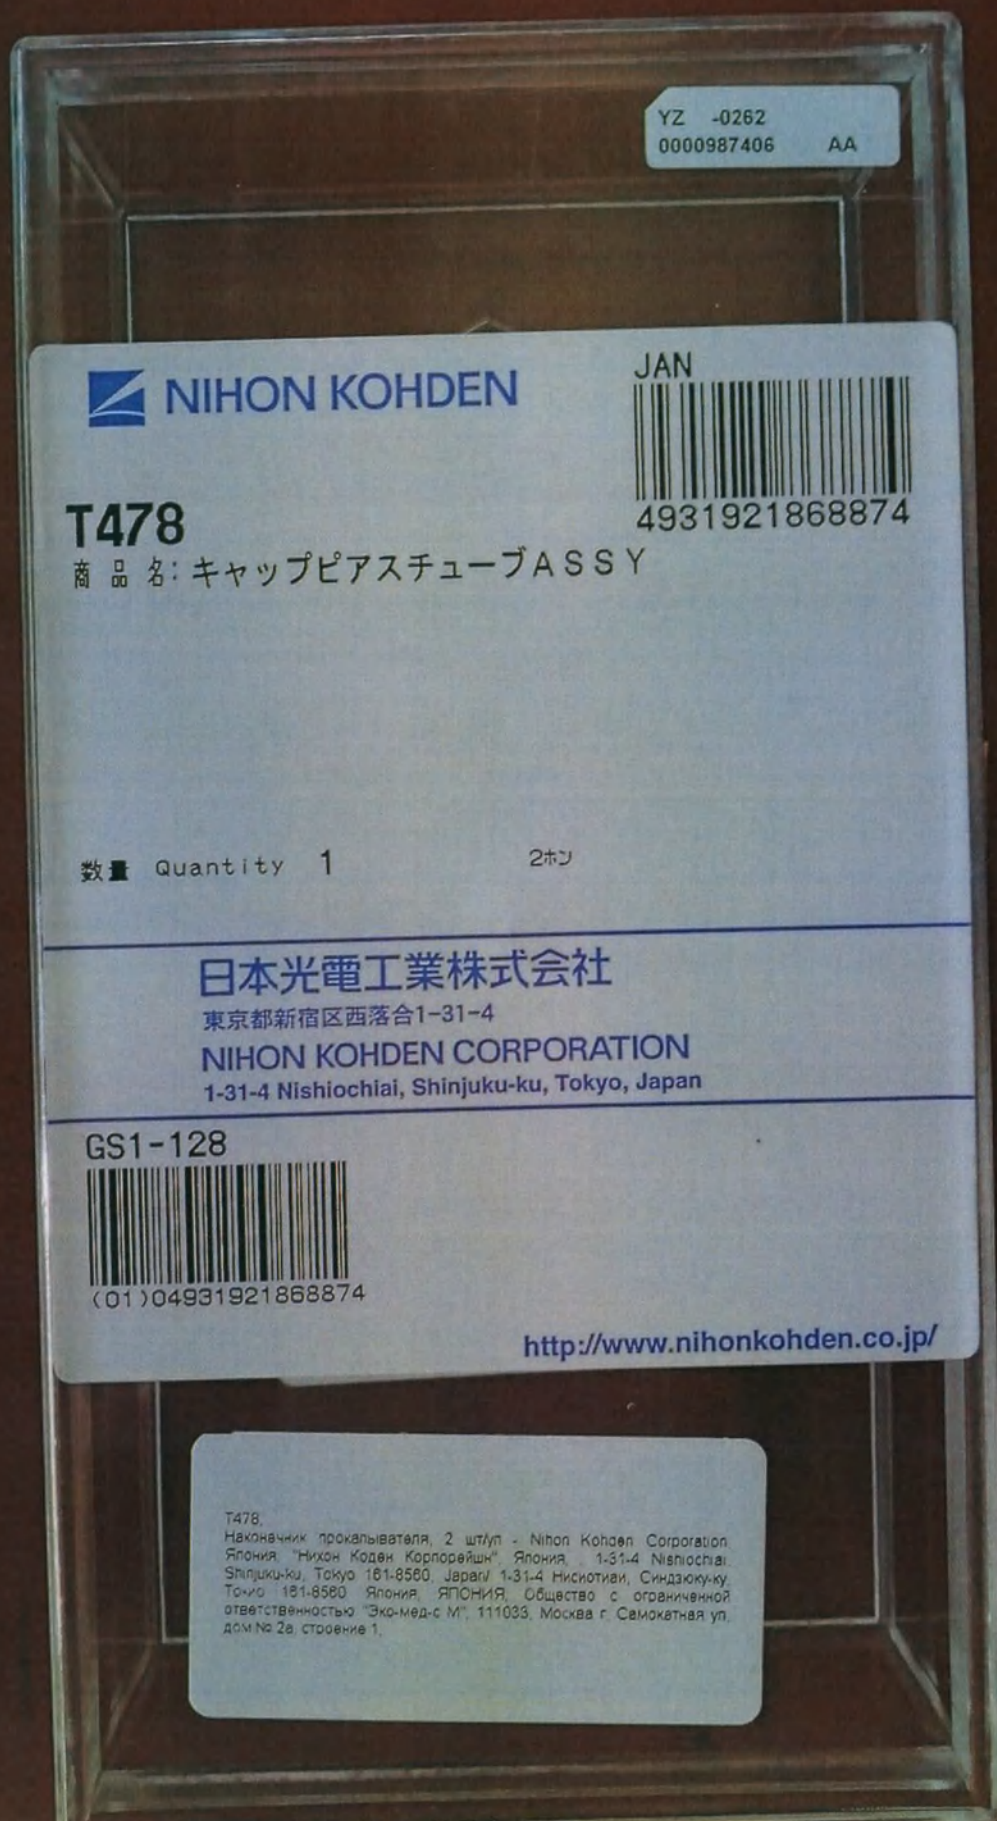

13. Капилляр (20 мкл)

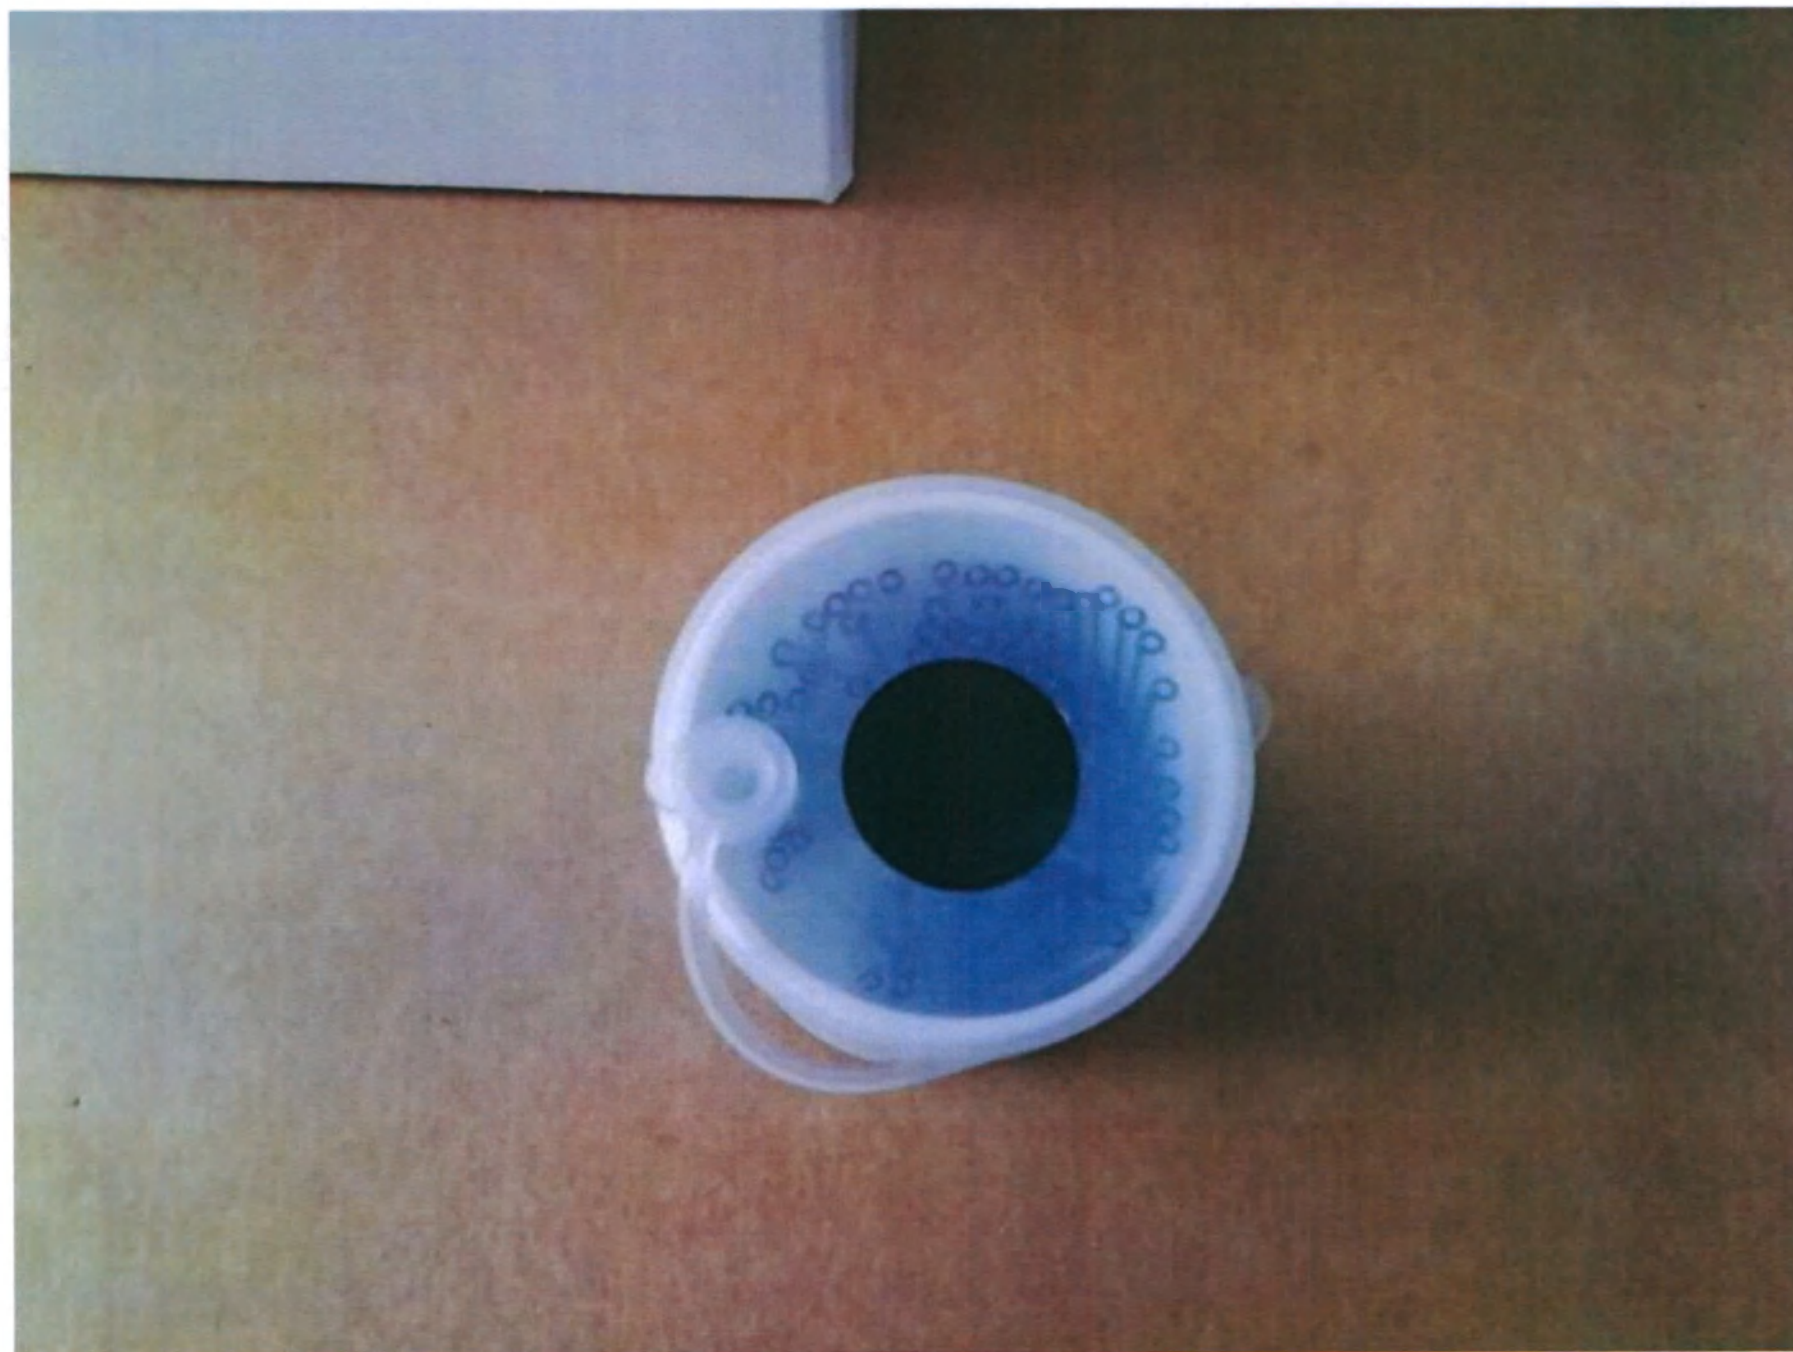


14. Капилляр (10 мкл)




Микропробирка, 500 шт./уп.




. Воздушная игла

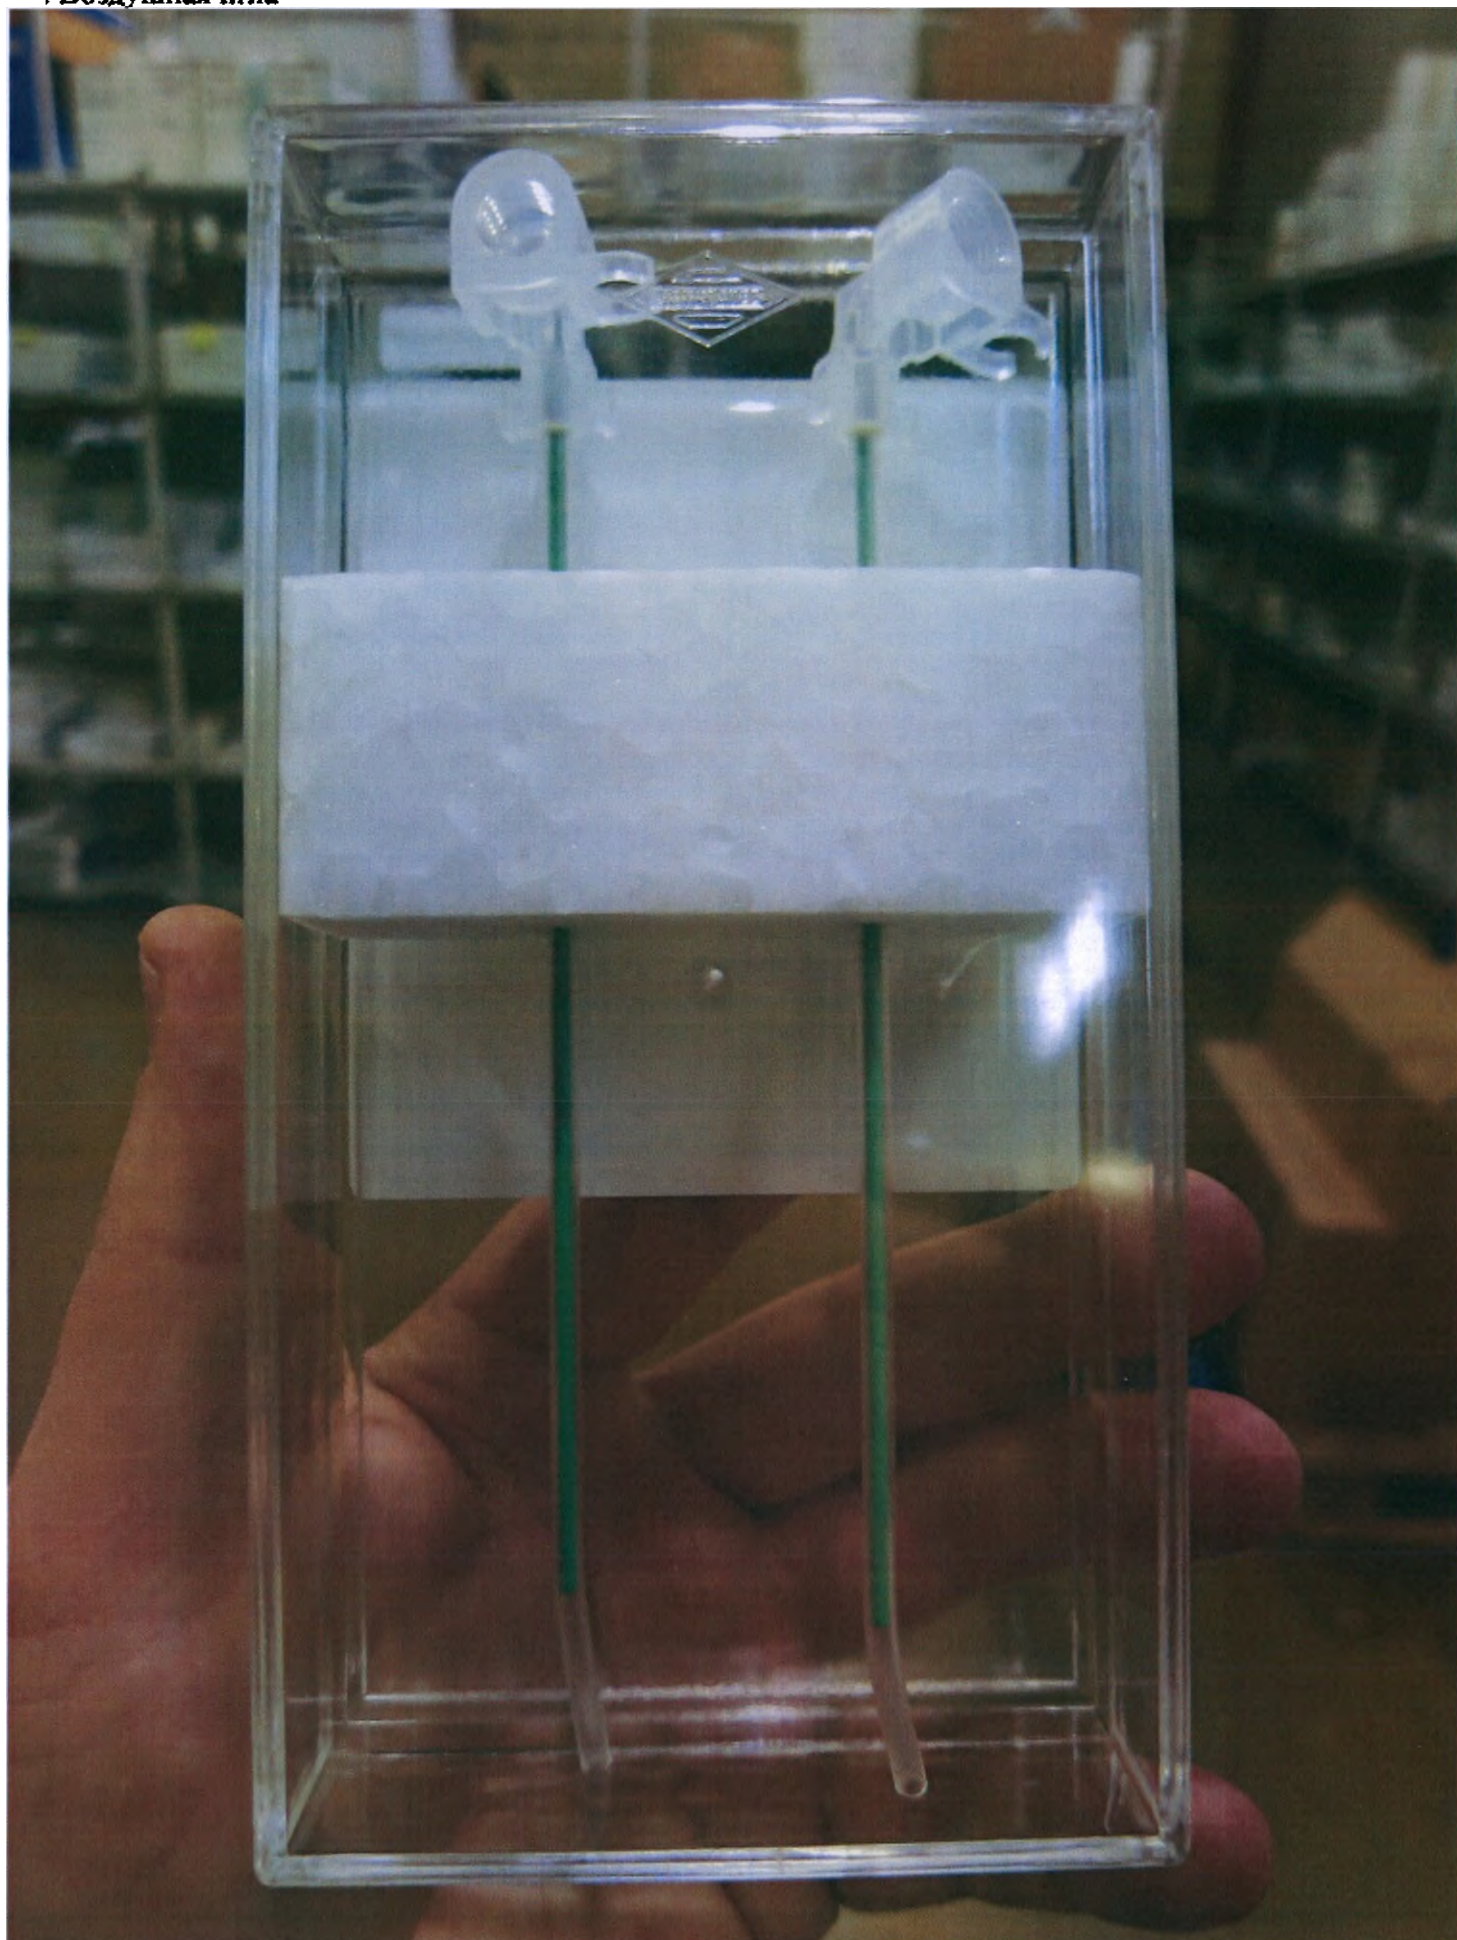


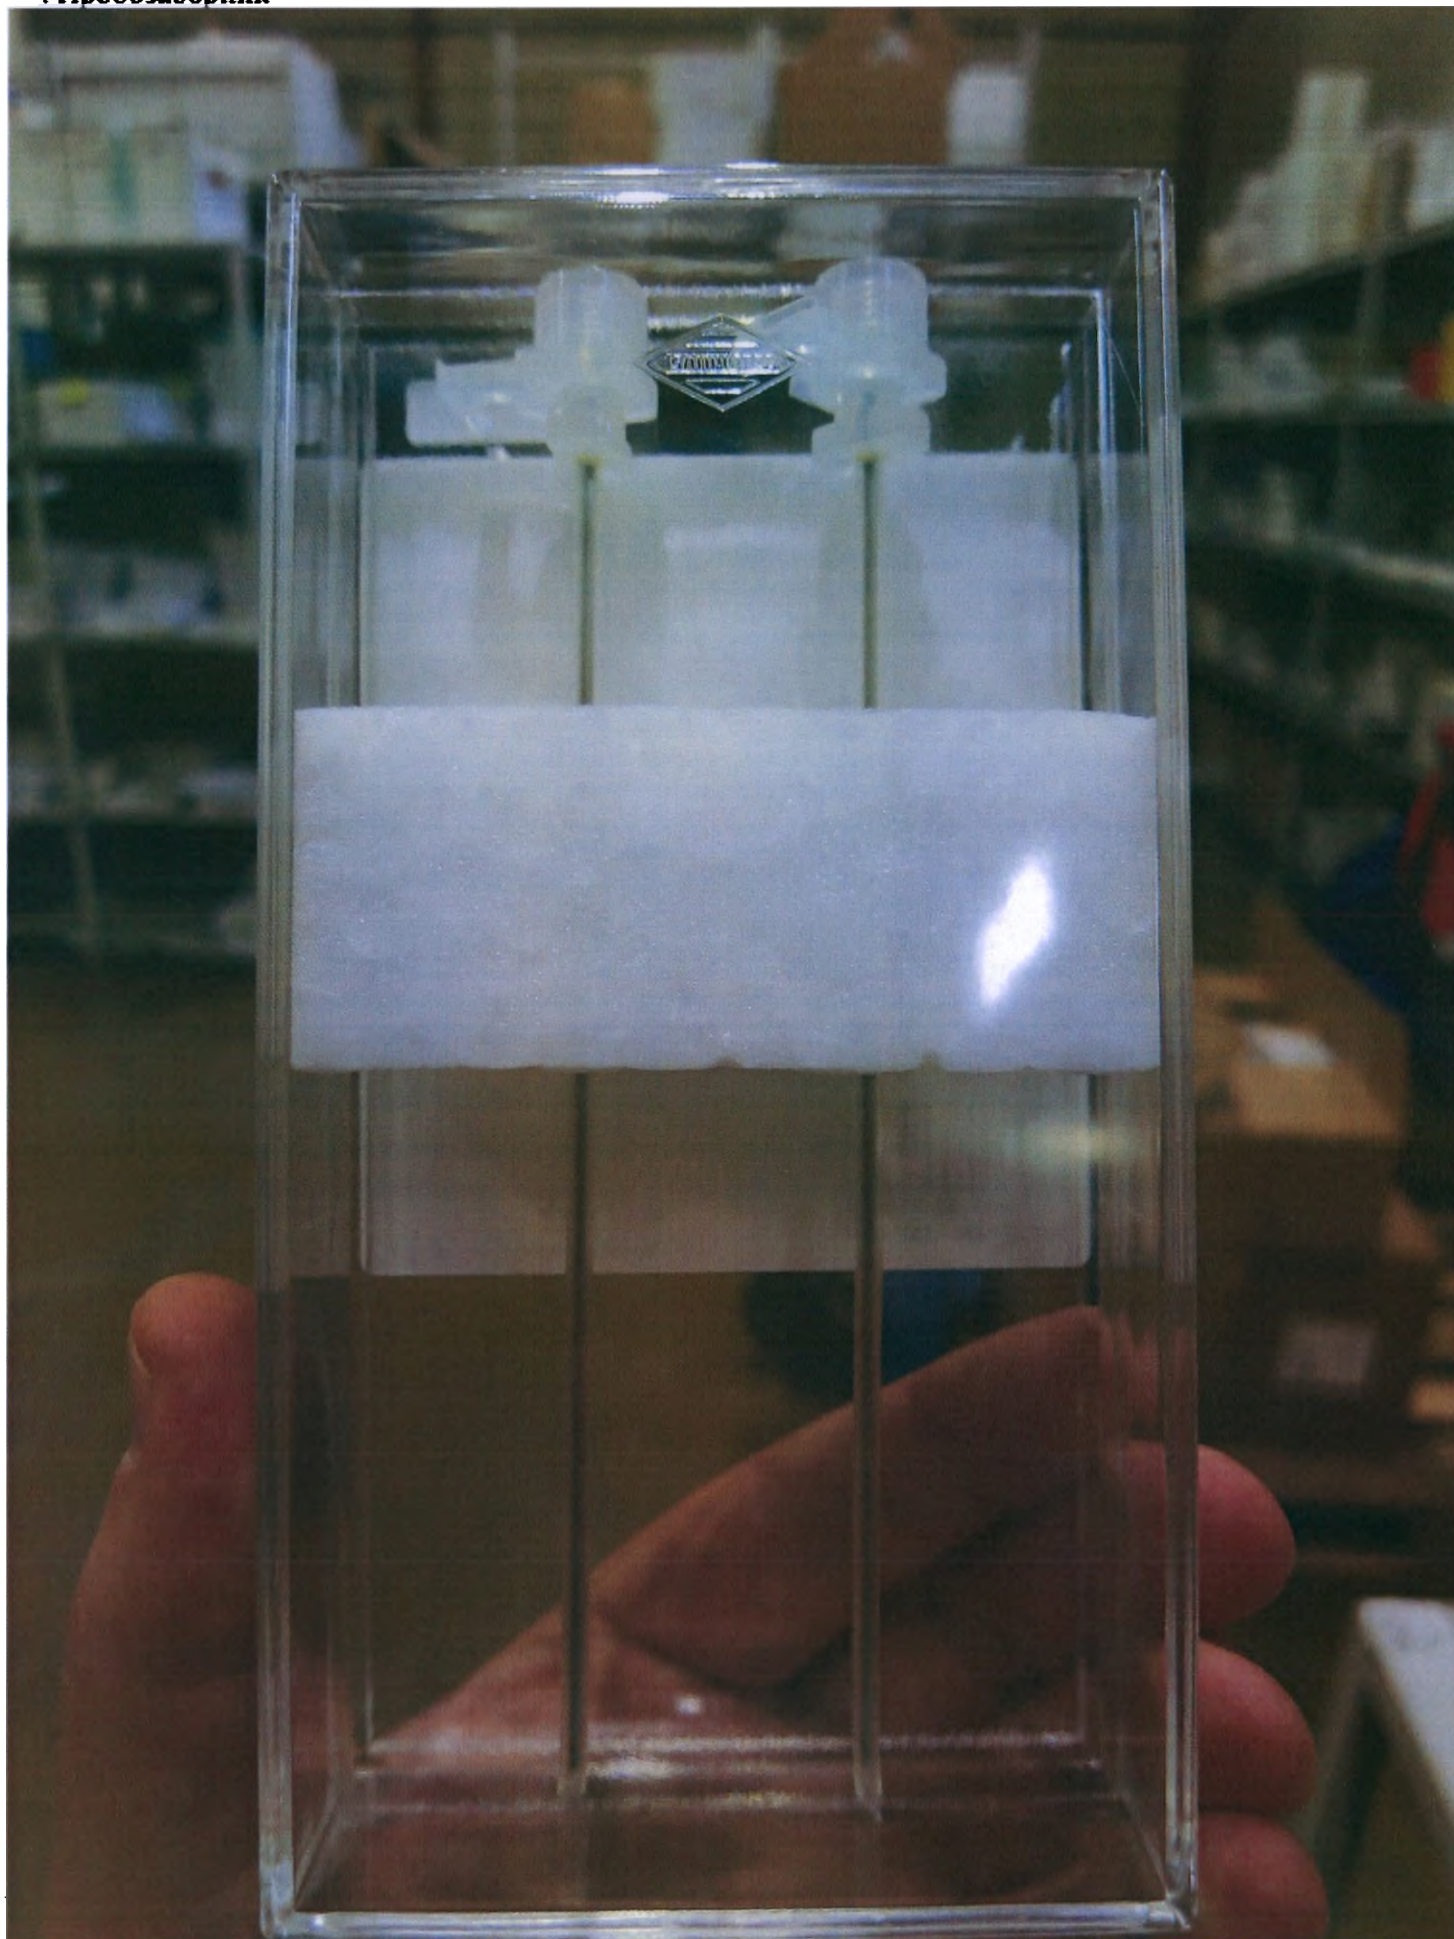

... Контейнер для отходов (10 л) при необходимости)

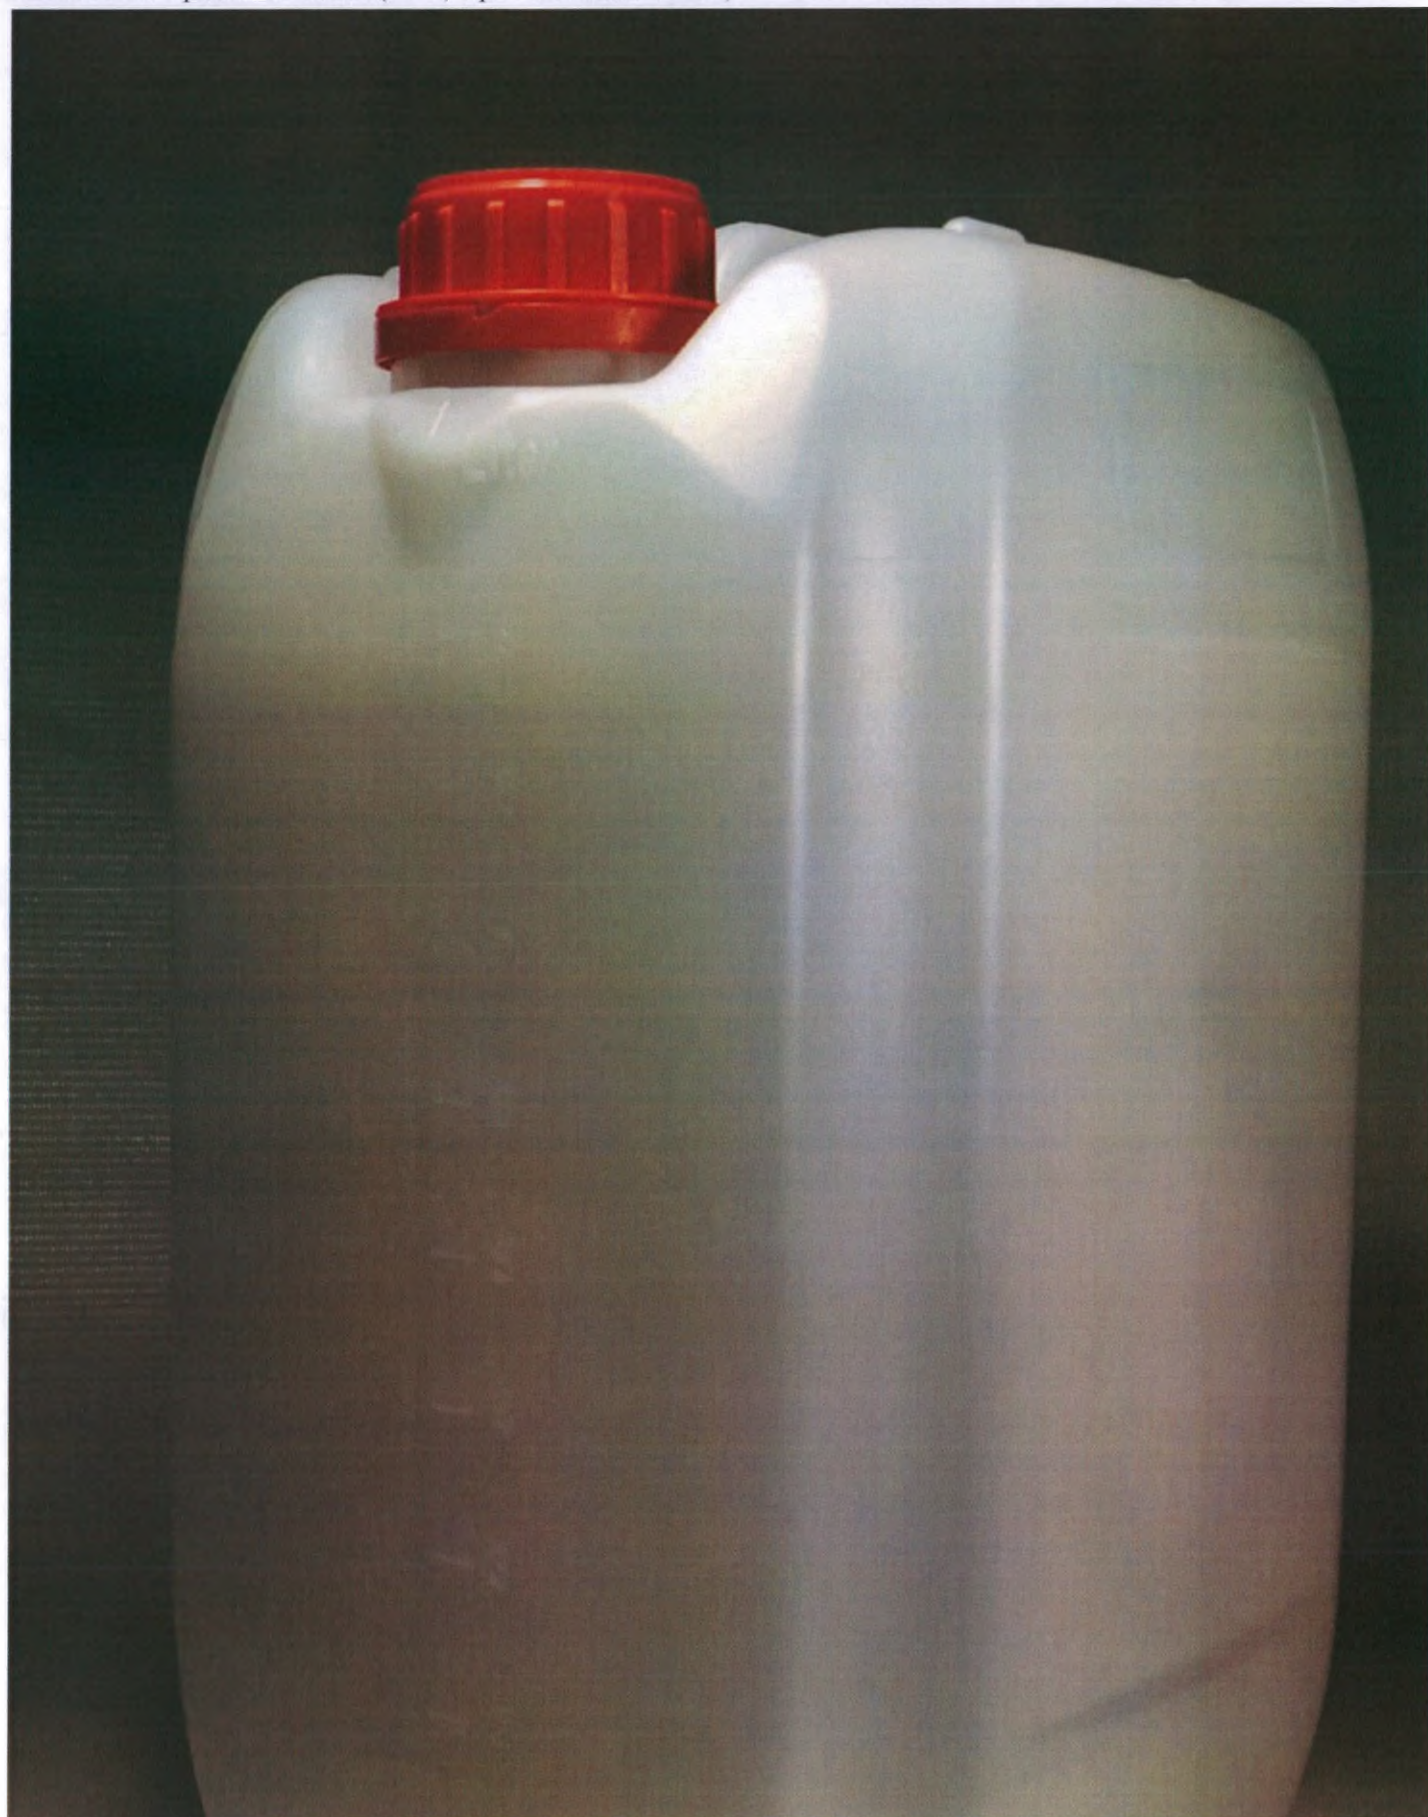

19. Датчик отходов

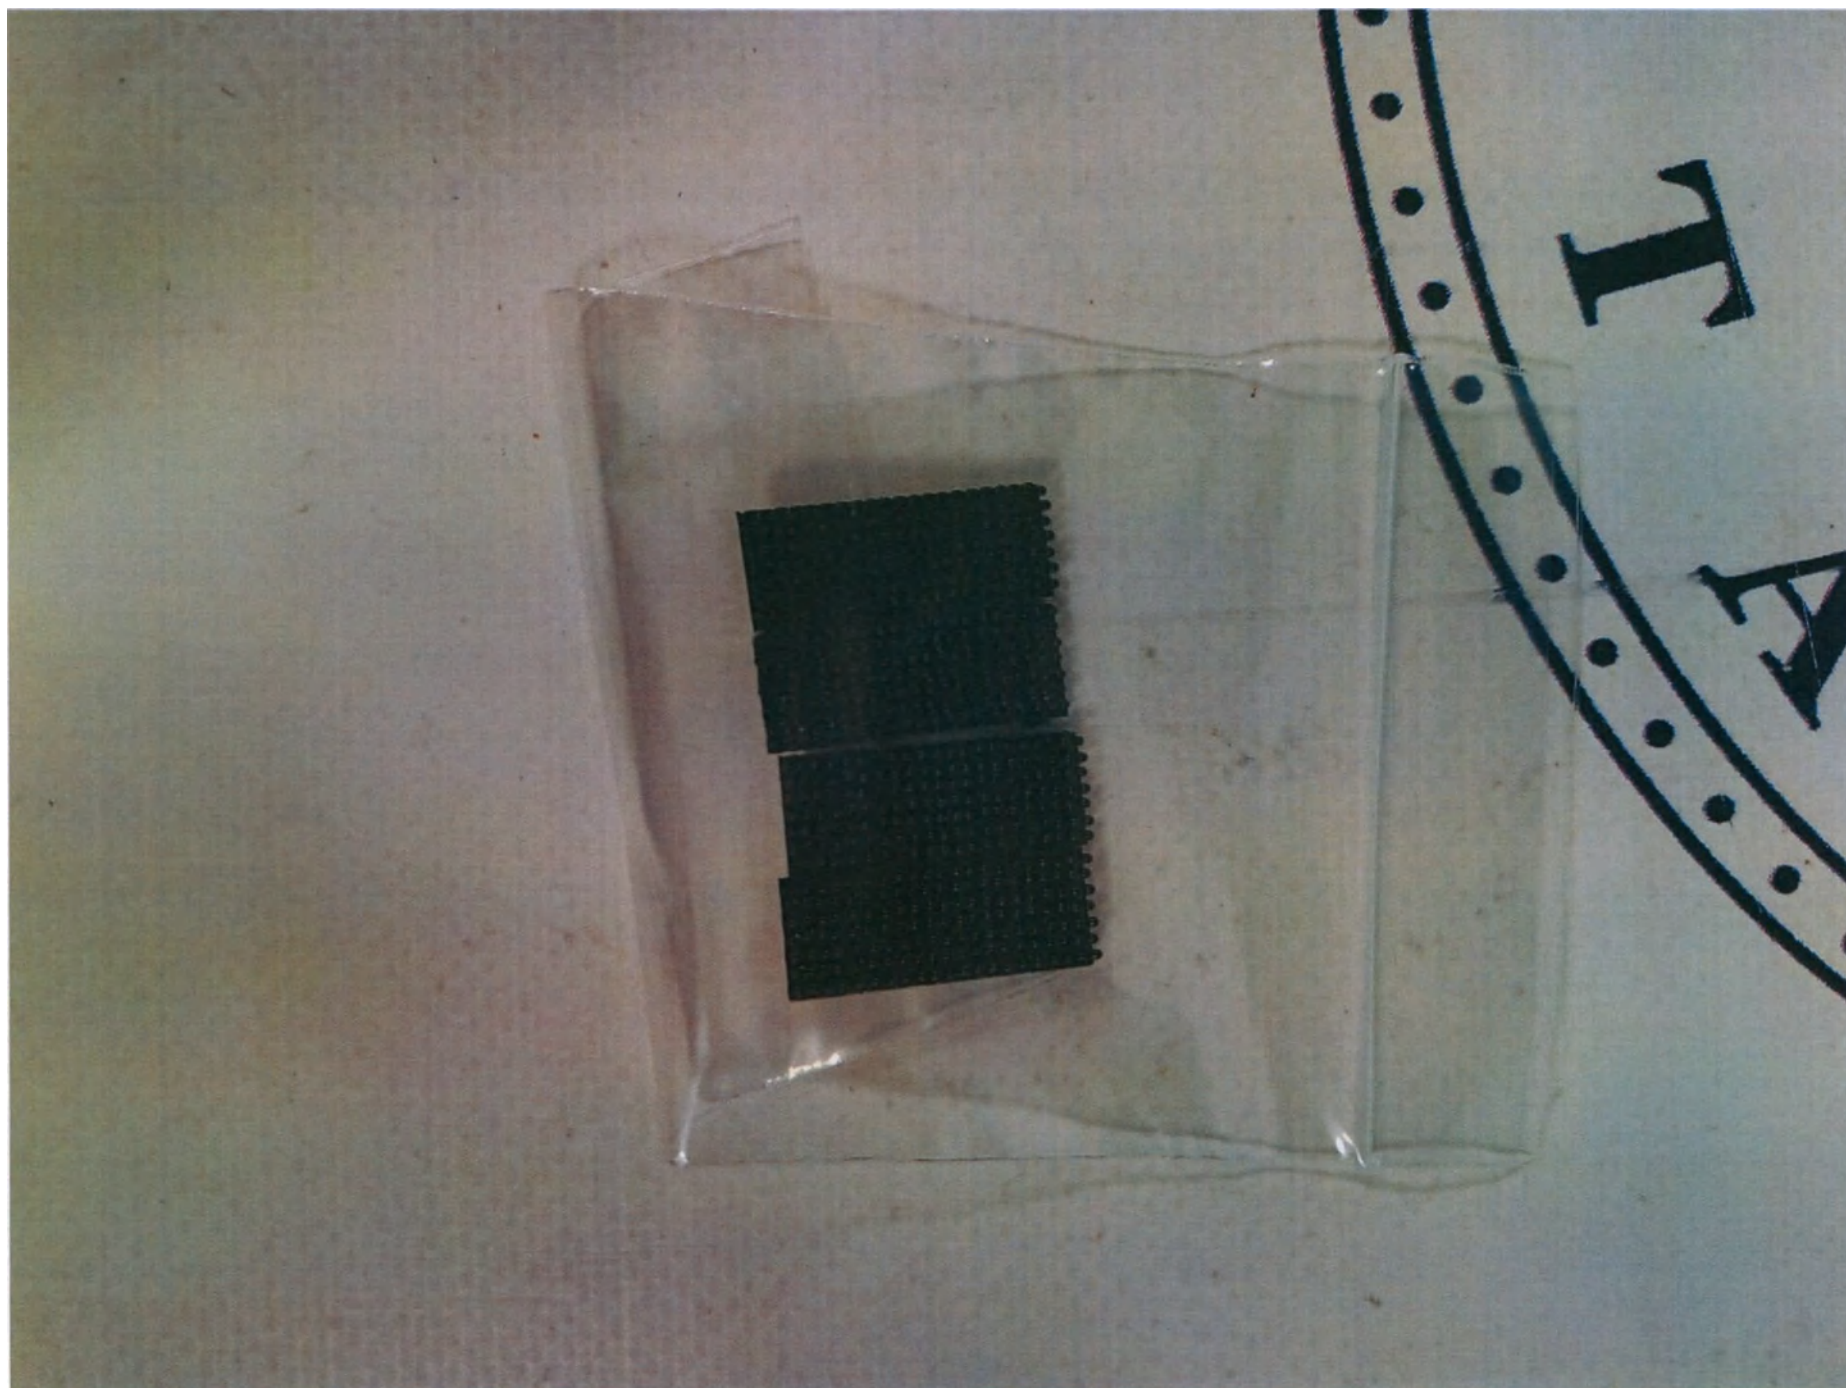



Celltac

HEMOGROBIN
FILTER 10PCS.
YZ-0024




NIHON KOHDEN

YZ -0024


0000477899

A0

. Капра SD (1 Гб)

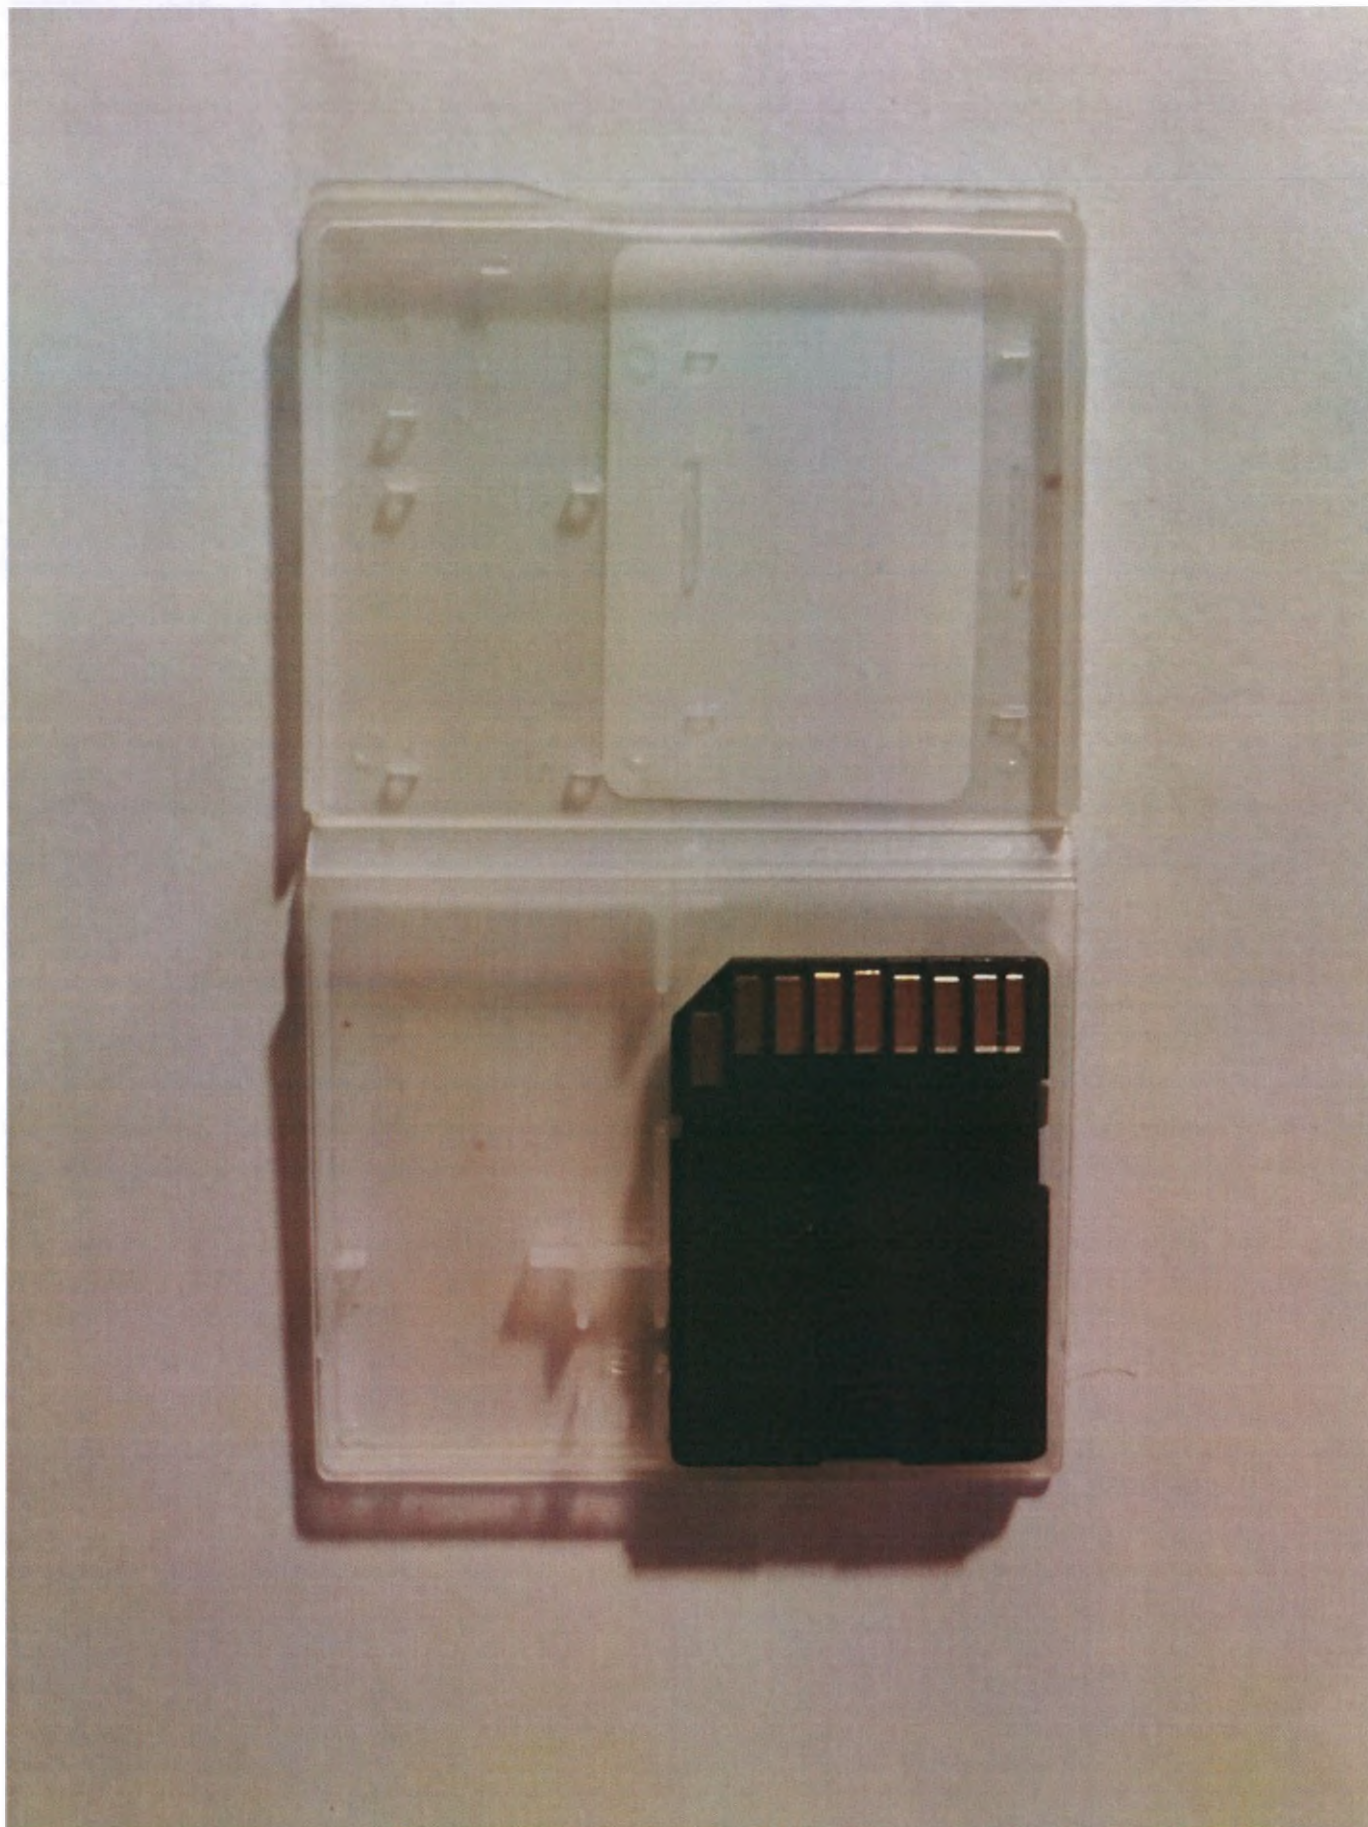

... Карта SD (2 Гб)

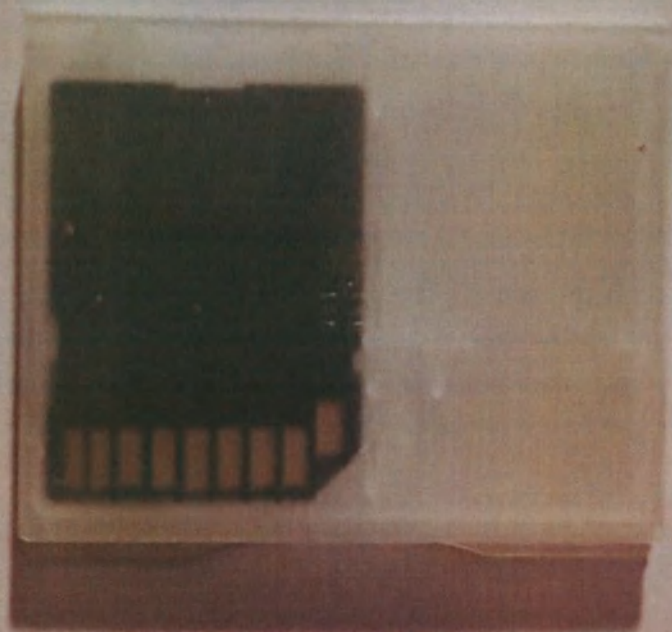


- Анализатор гематологический автоматический МЕК-1305, в составе:
1. Анализатор гематологический автоматический МЕК-1305. Общий вид.






Вид этикетки на задней стенке анализатора:

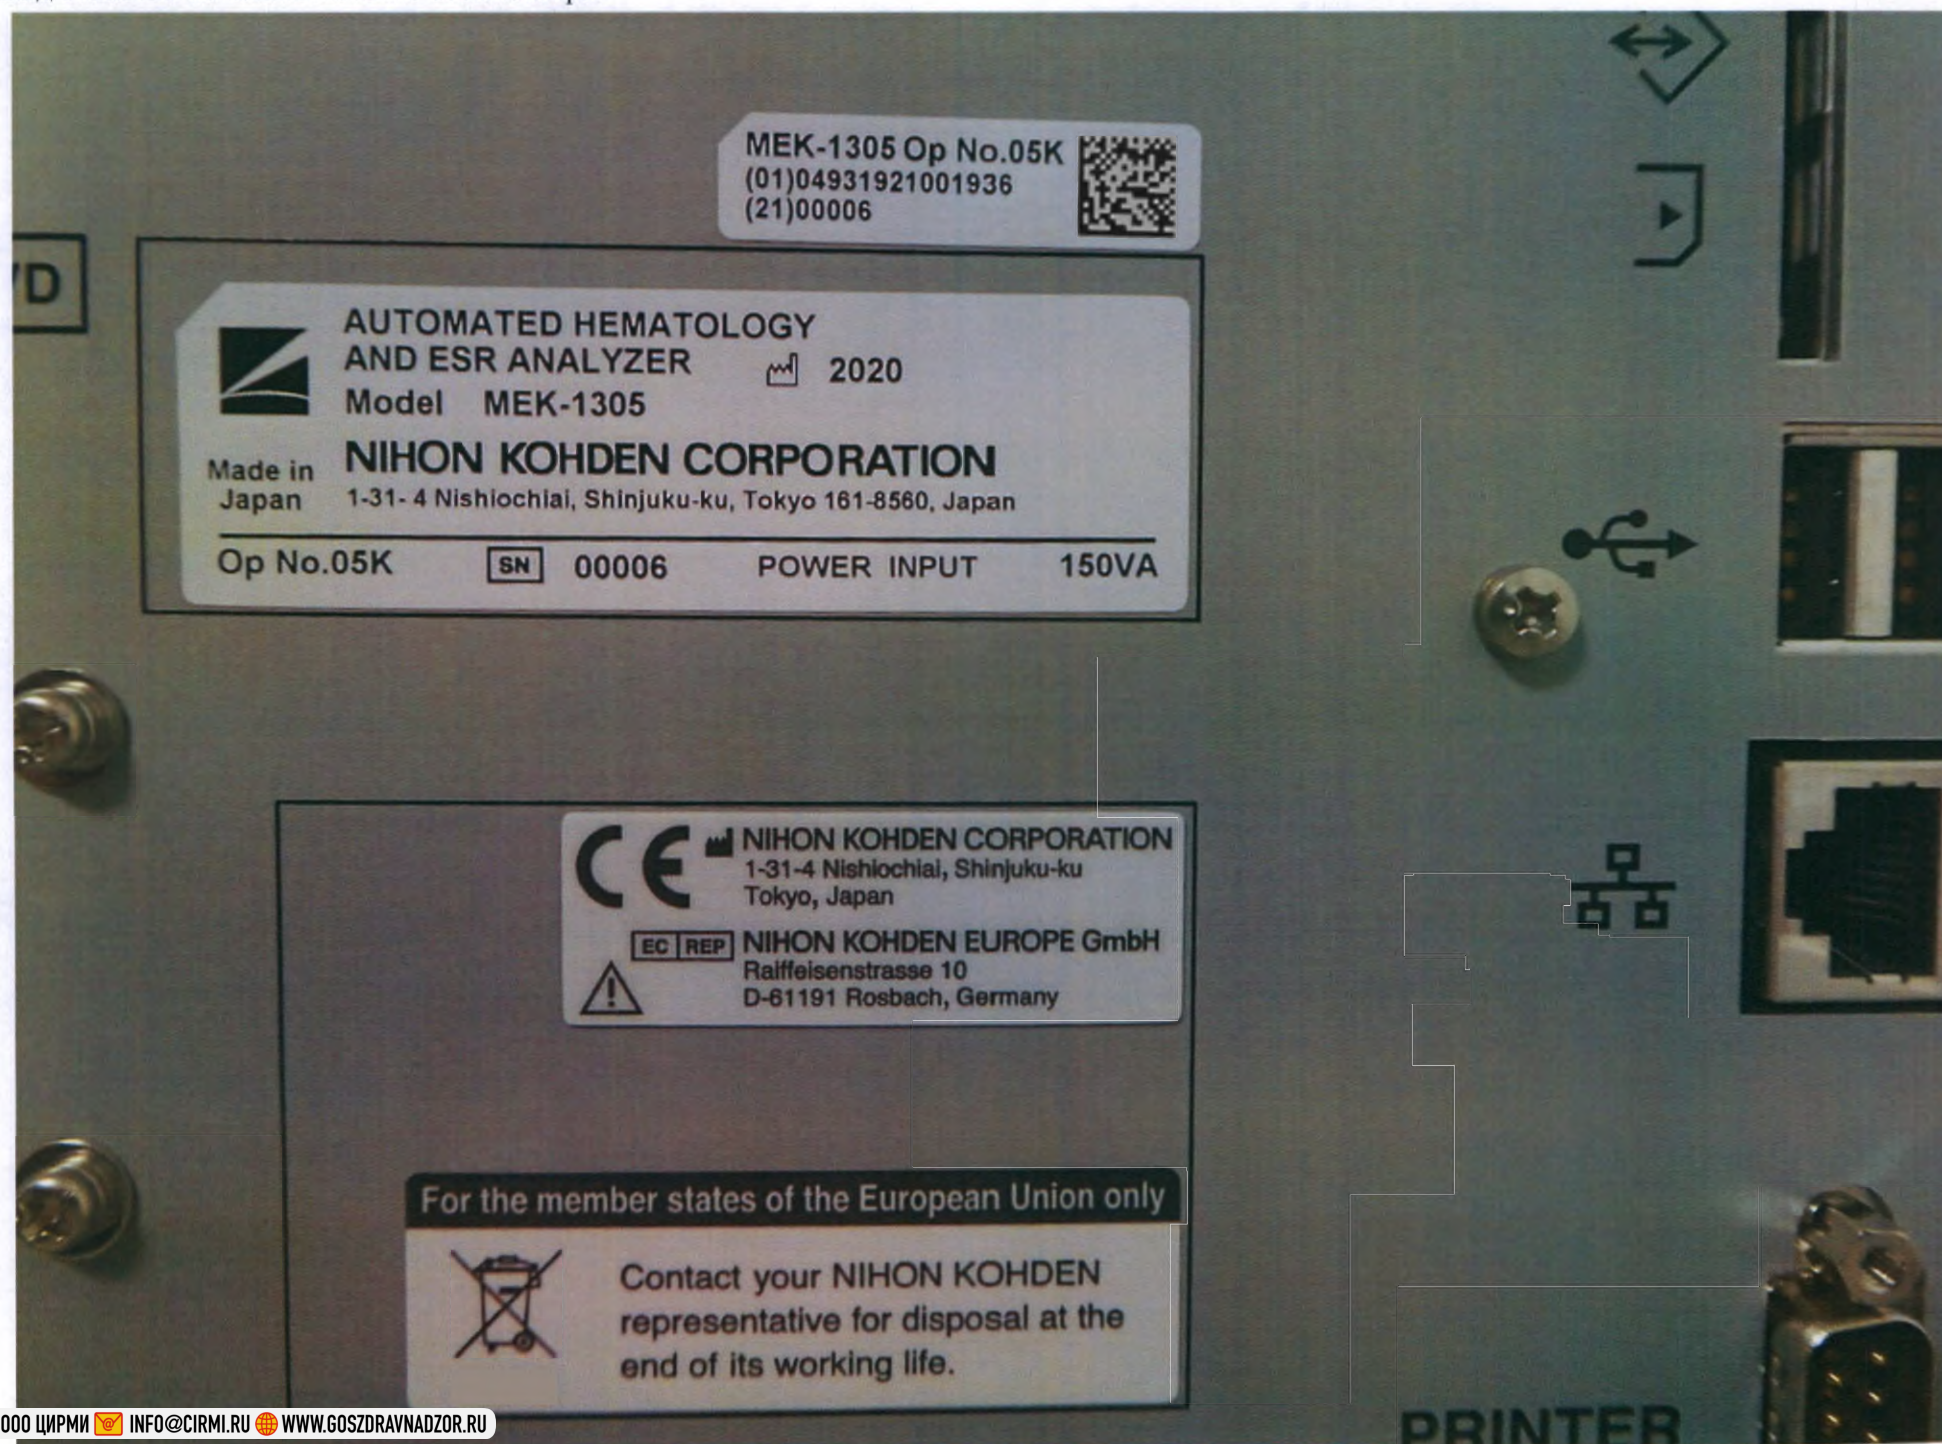

2. Шнур электропитания

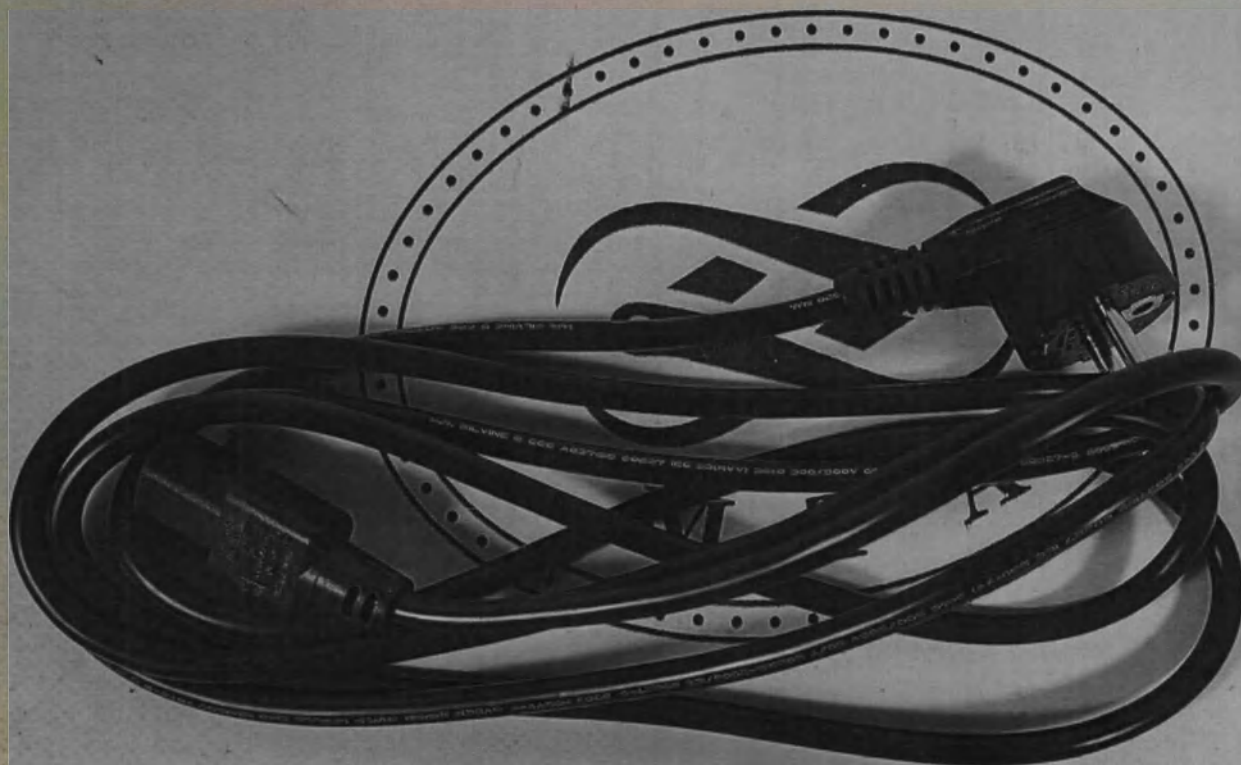

3. Провод заземления D - 1 шт.



4. Плавкий инерционный предохранитель, 250 В, 2.0 А, $\varnothing 5.2 \times 20$ мм




5. Фильтр в сборе



... Трубка дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4 в сборе (с позицией 15. Трубка дилюента (с синей манжетой) (для дилюента ISOTONAC•3/ISOTONAC•4 и с позицией принадлежностей 2. Крышка (для дилюента ISOTONAC•3 / ISOTONAC•4))



7. Трубка детергента CLEANAC•710 в сборе (с позицией 16. Трубка детергента (с зеленой манжетой), позицией 17. Трубка в сборе (для детергента CLEANAC•710) и позицией принадлежностей 3. Крышка МЕК (для детергента CLEANAC•710))

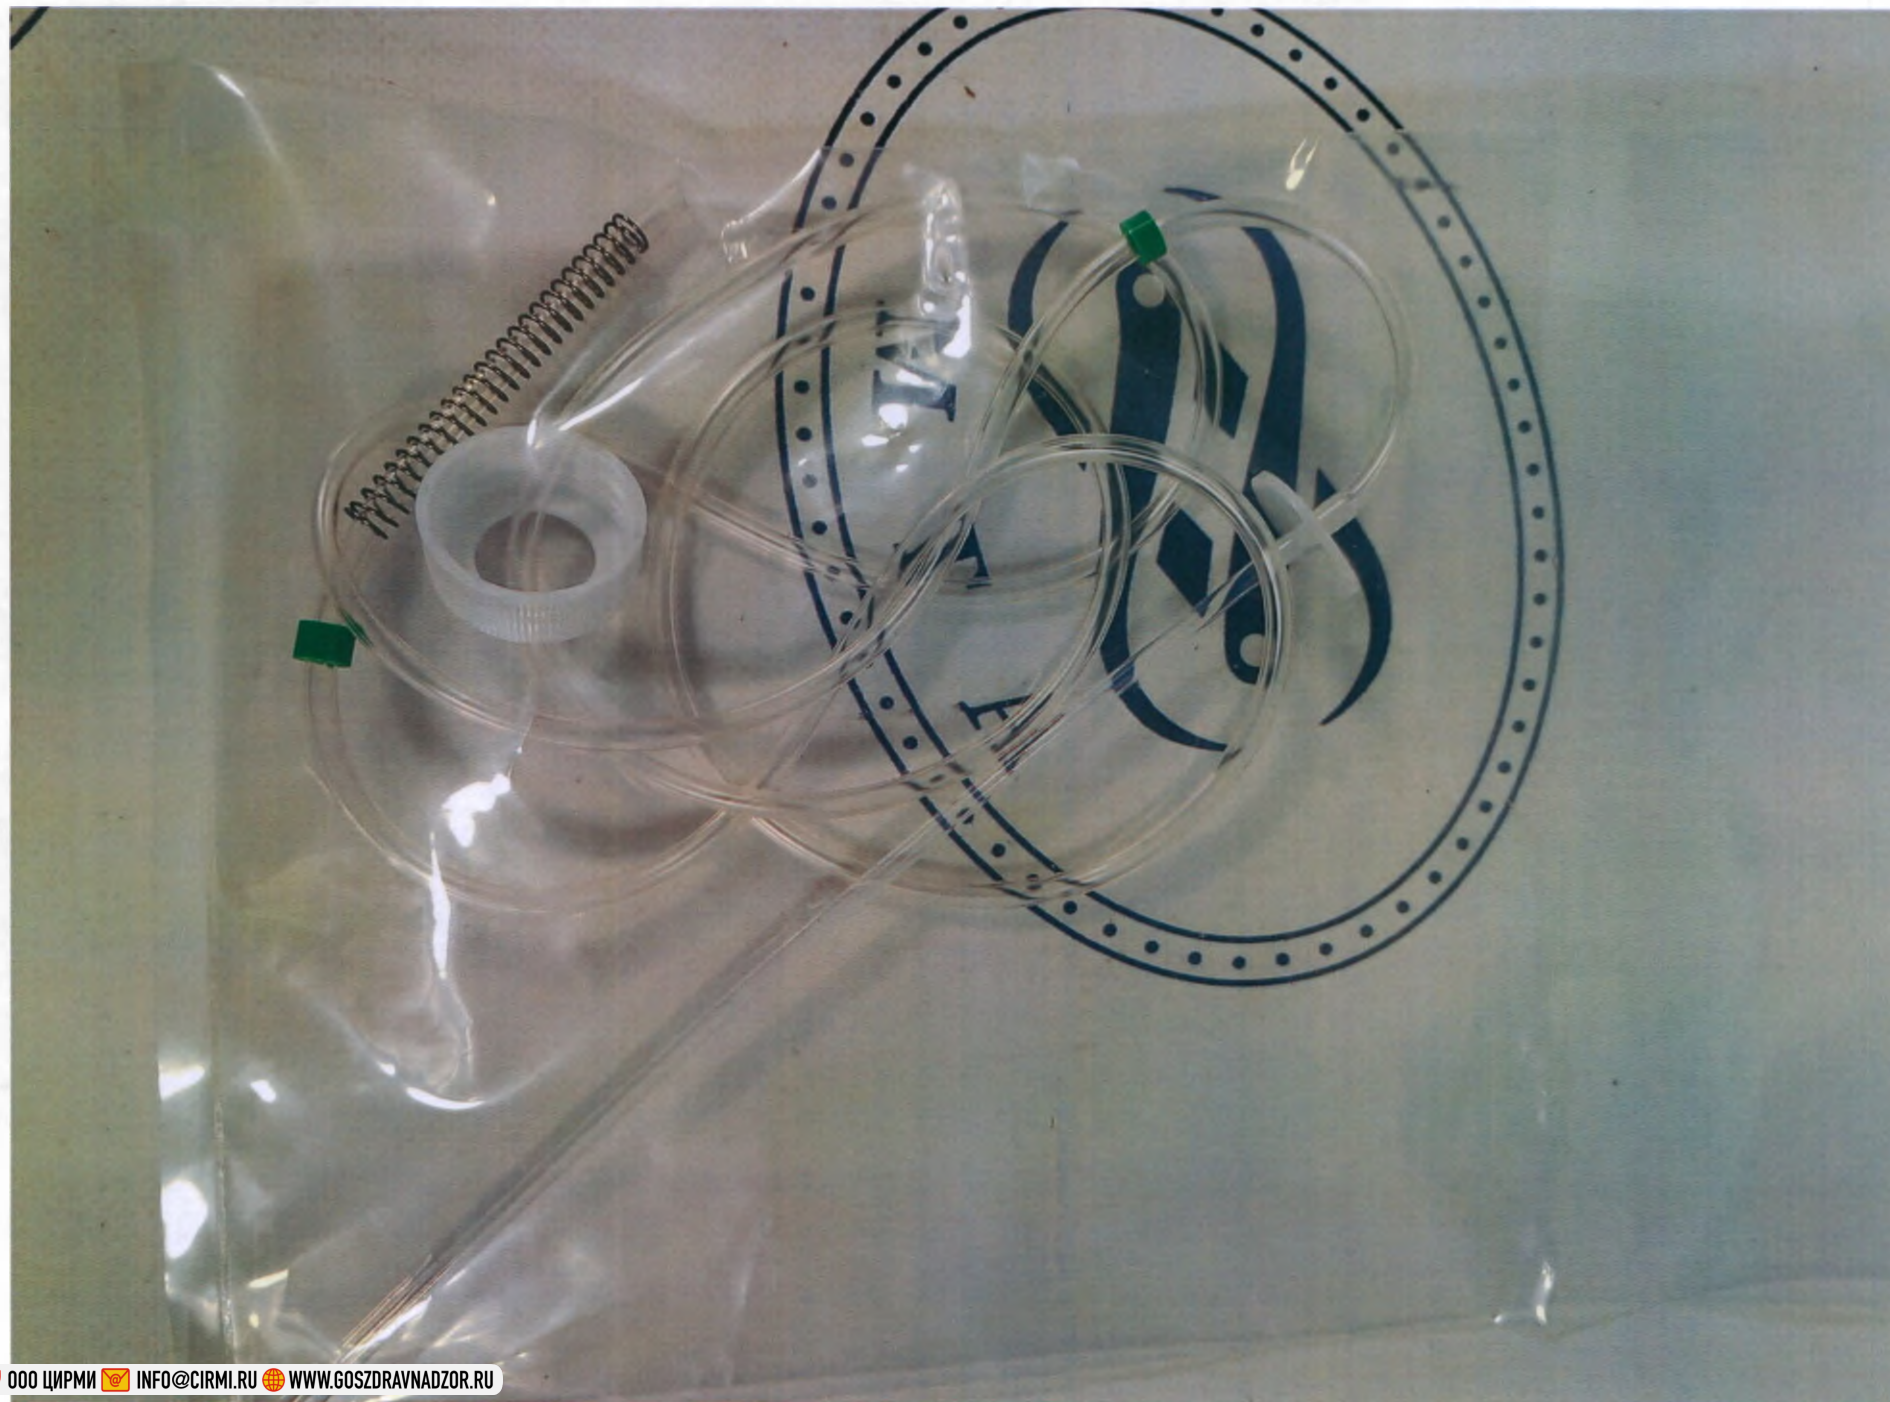

8. Трубка детергента CLEANAC•3 в сборе (с позицией 20. Трубка детергента (с белой манжетой) (для детергента CLEANAC•3))




9. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 в сборе (с позицией 23. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 (цвет соединения: оранжевый)и позицией принадлежностей 4. Крышка реагента HEMOLYNAC•310 (оранжевая))



10. Трубка для отходов в сборе (с позицией 19. Трубка для отходов (с красными манжетами) и позицией принадлежностей 1. Крышка контейнера для отходов (крышка бака для отходов))



11. Контейнер для отходов

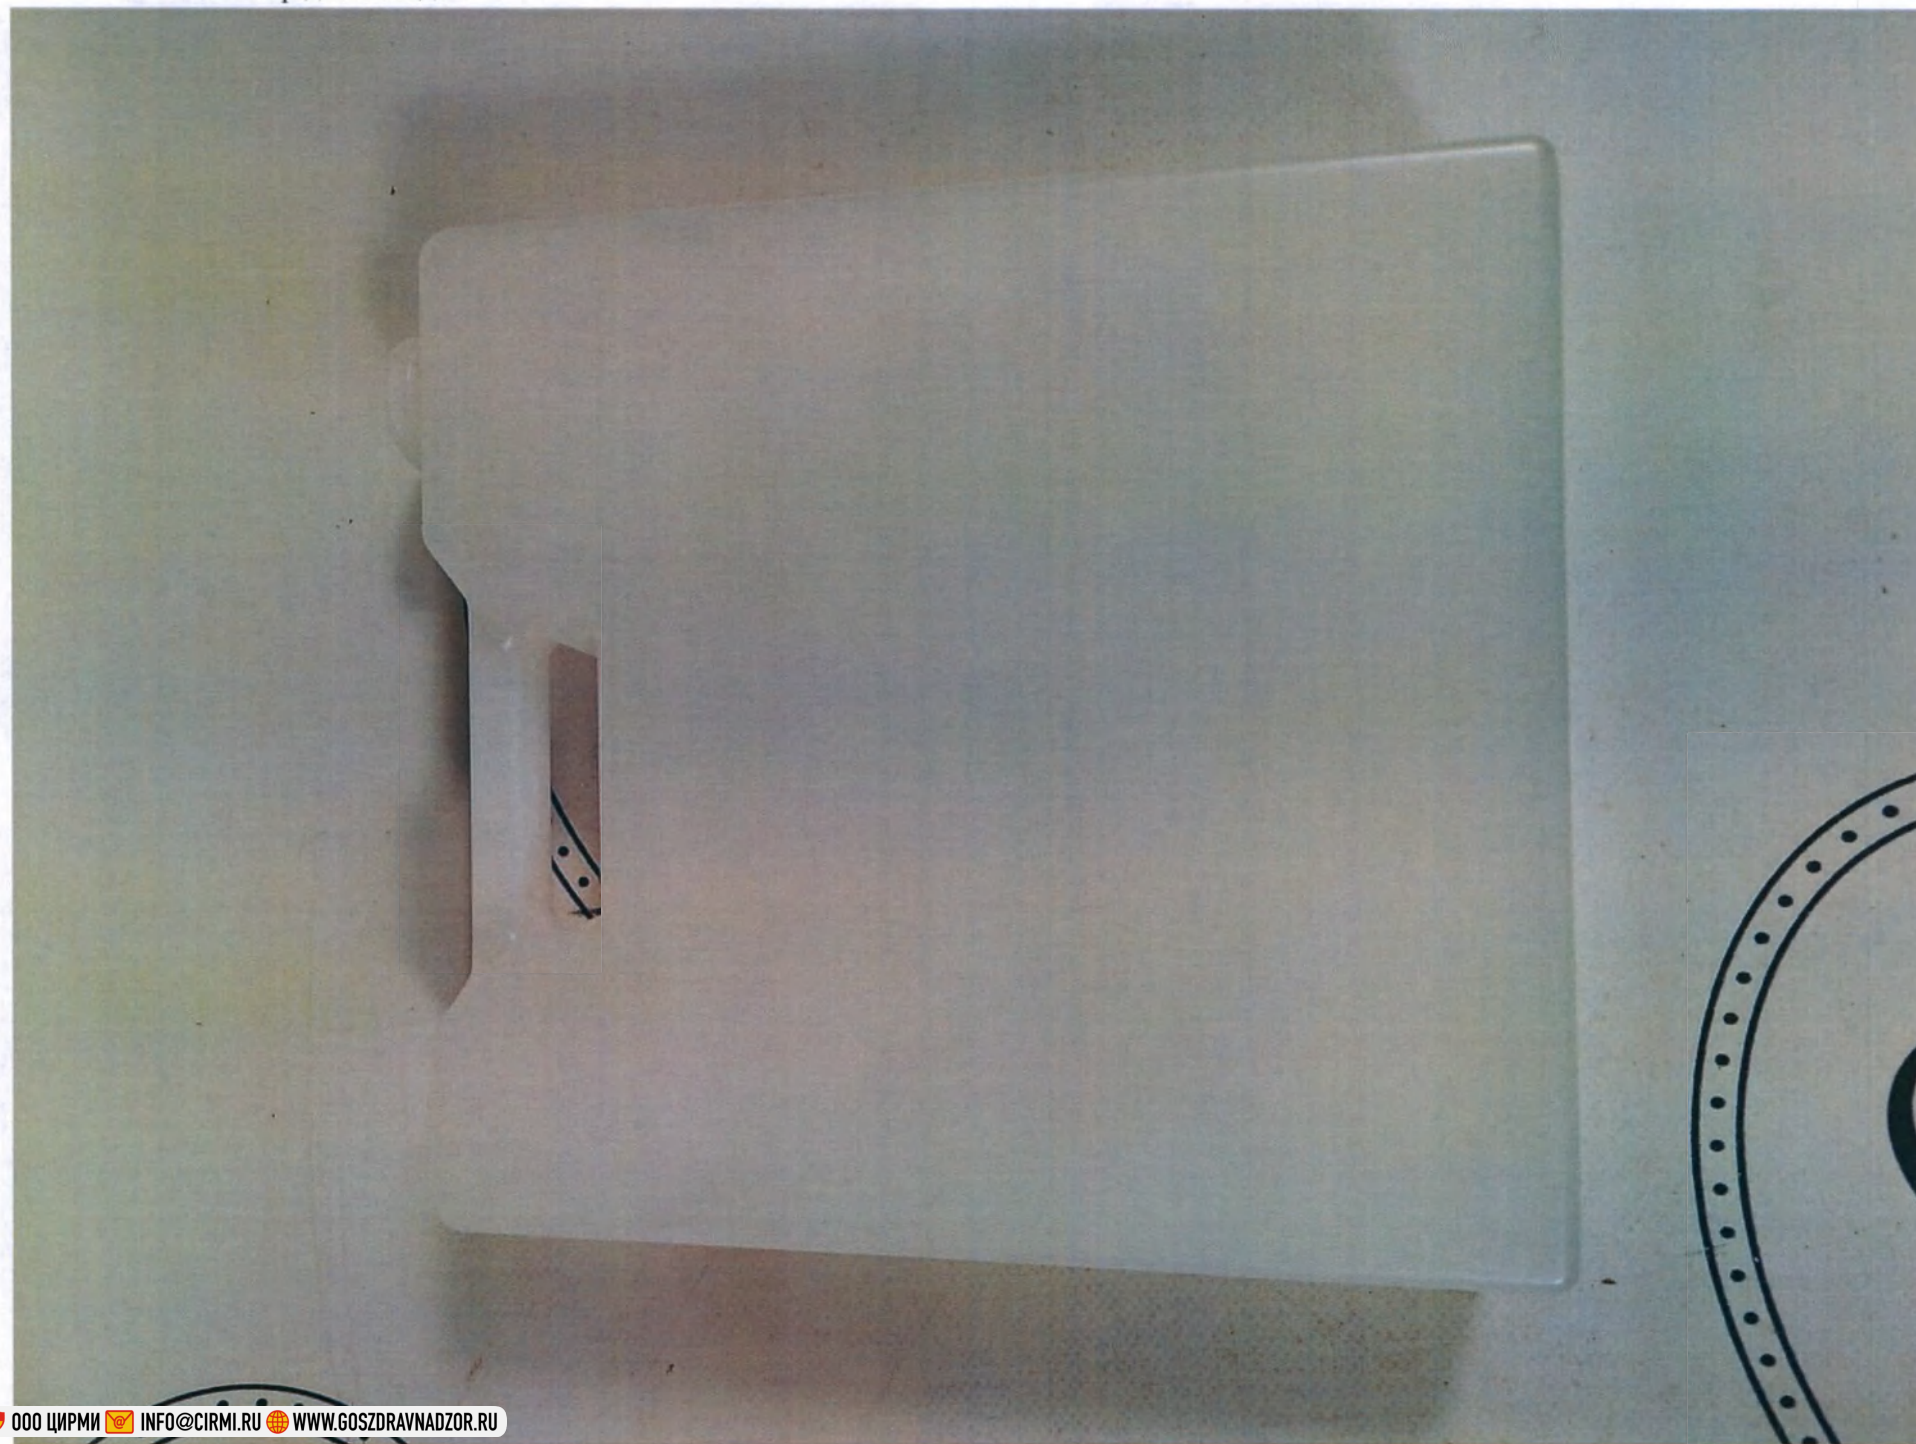


12. Трубка насоса в сборе






14. Крышка отсека для реагентов

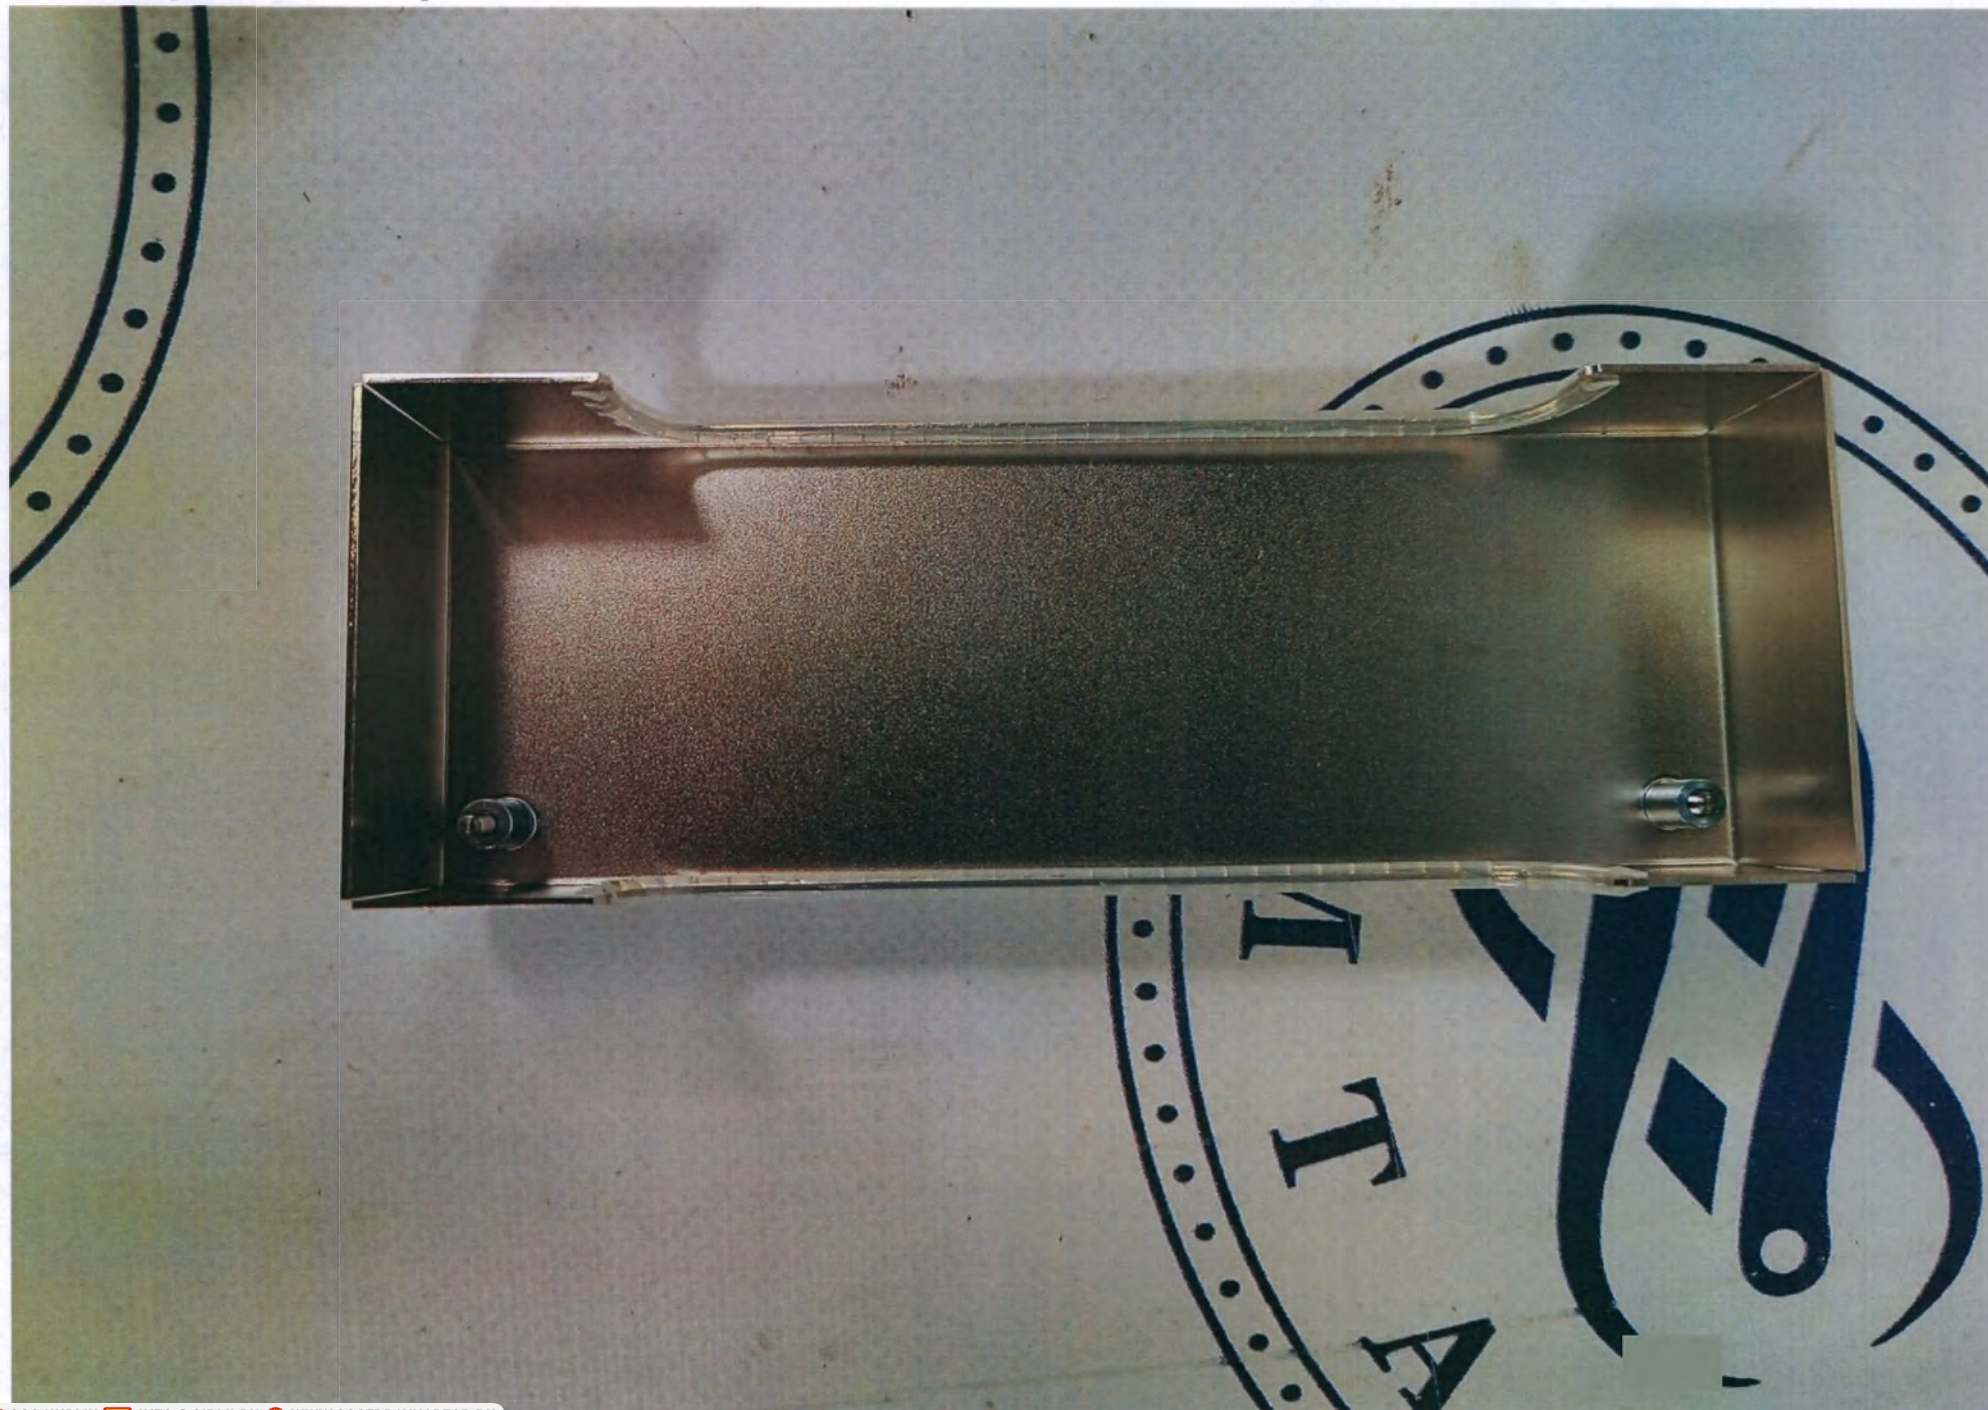

- 15. Трубка дилуэнта (с синей манжетой) (для дилуэнта ISOTONAC•3/ISOTONAC•4) (см. Рис. 6)
- 16. Трубка детергента (с зеленой манжетой) (для детергента CLEANAC•710) (см. Рис. 7)
- 17. Трубка в сборе (для детергента CLEANAC•710) (см. Рис. 7)

18. Трубка в сборе 3л (для детергента CLEANAC•710)

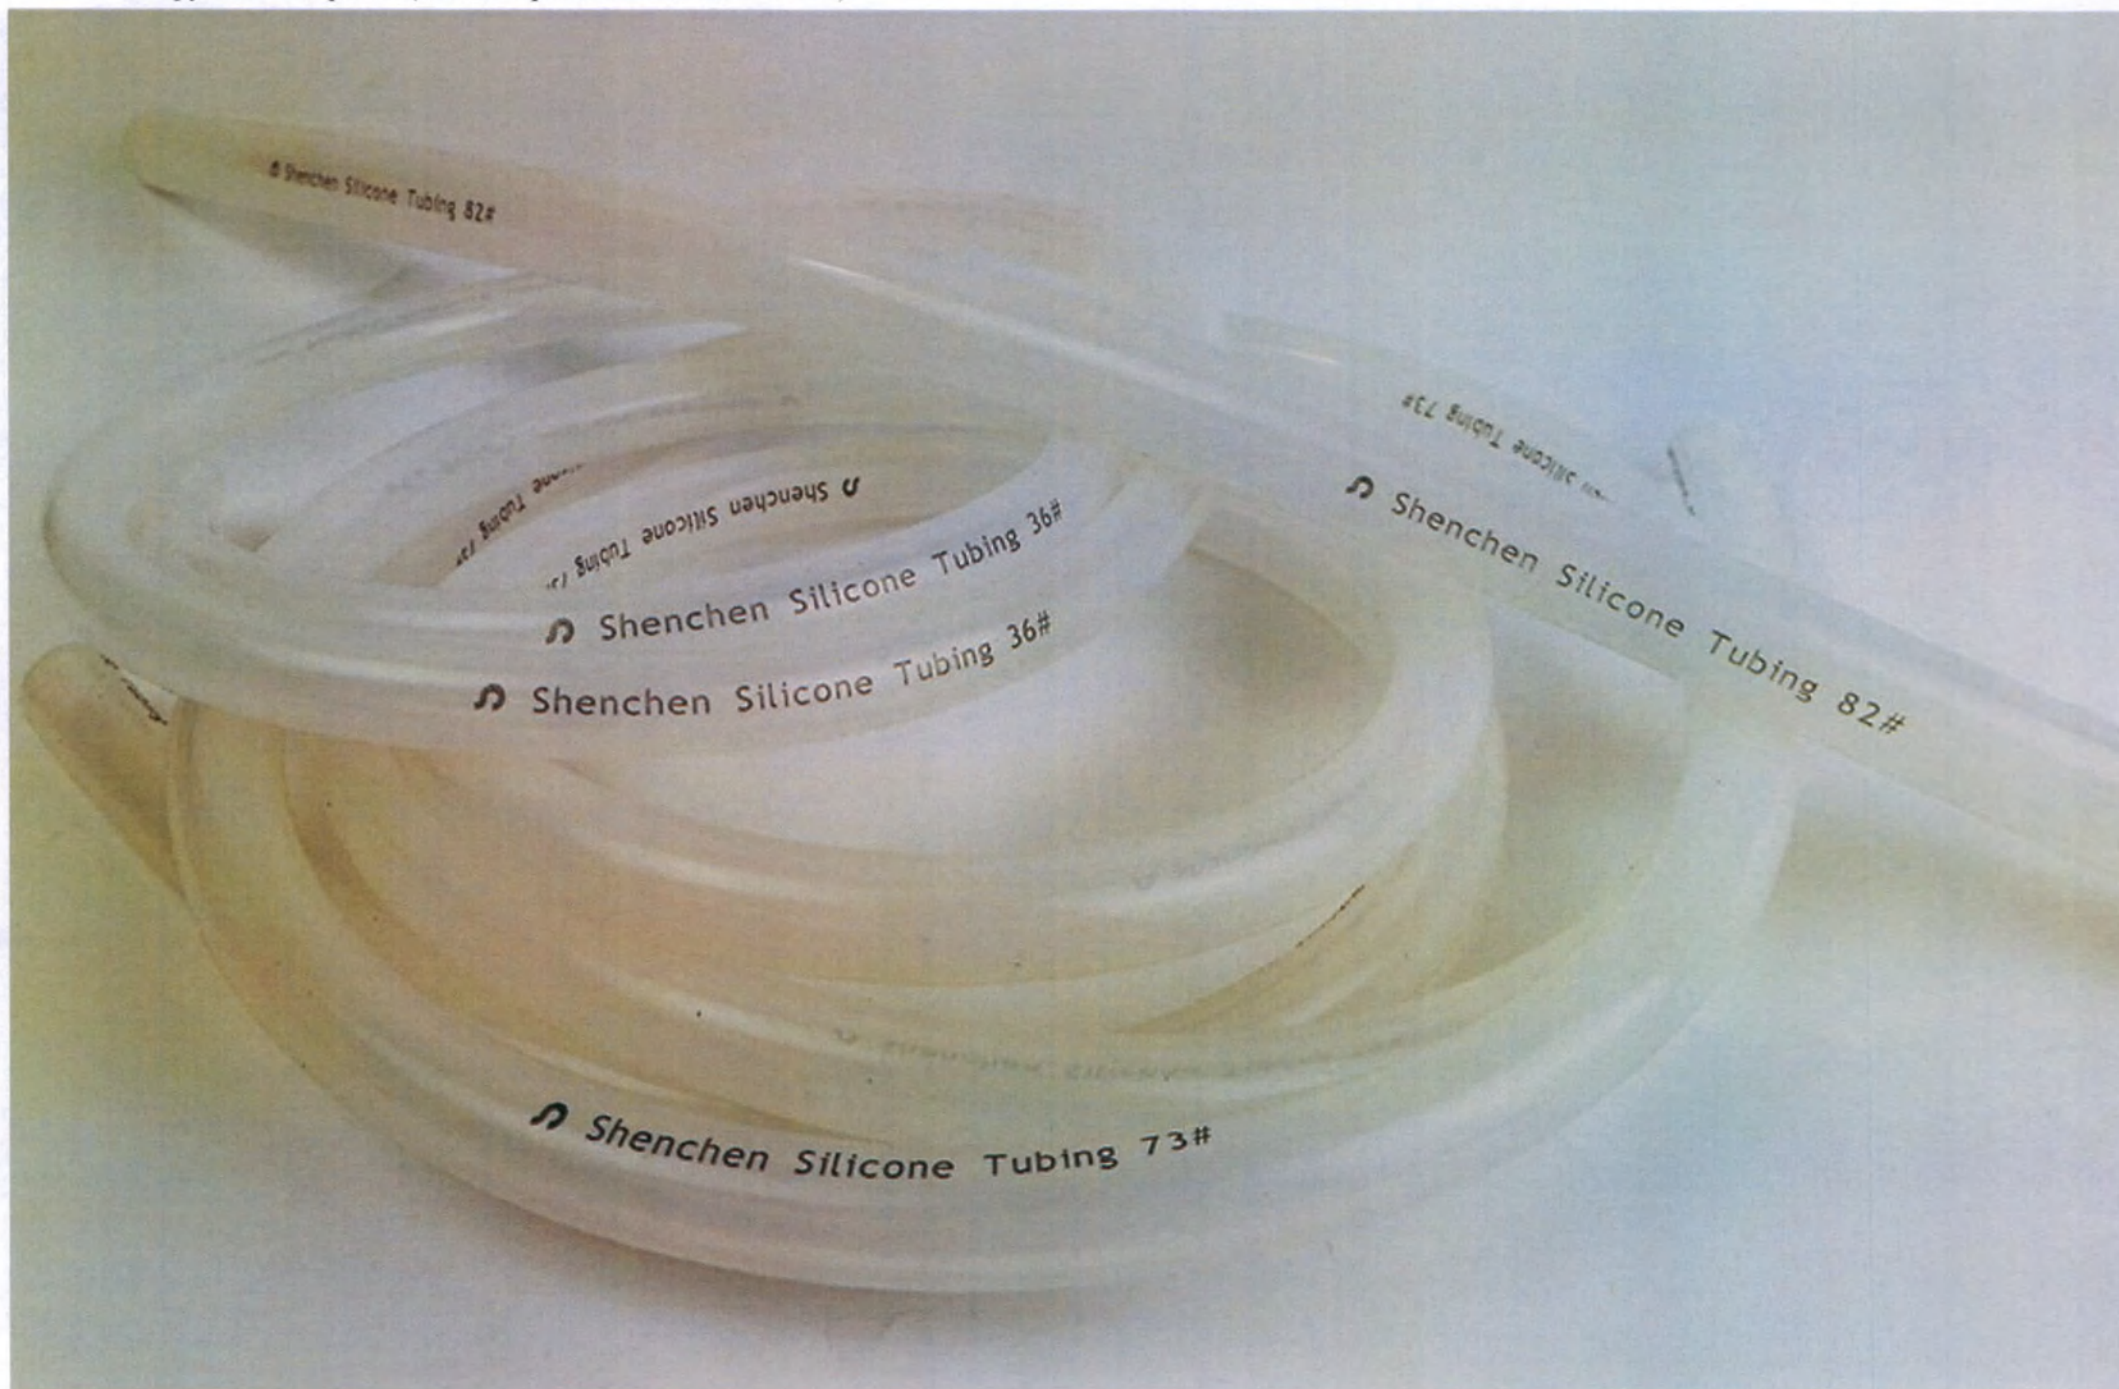

- 19. Трубка для отходов (с красными манжетами) (см. Рис. 10)
- 20. Трубка детергента (с белой манжетой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
- 21. Трубка в сборе 500 мл (с крышкой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
- 22. Трубка в сборе 1 л (с крышкой) (для детергента CLEANAC•3) (см. Рис. 8)
- 23. Трубка реагента HEMOLYNAC•310 (цвет соединения: оранжевый) (см. Рис. 9)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие**


**«Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения
МЕК-1305»**

**производства NIHON KONDEN CORPORATION (Нихон Кондэн
Корпорейшн), Япония**

Принадлежности:

1. Крышка контейнера для отходов (крышка бака для отходов) – см. Рис 10.
2. Крышка (для дилюента ISOTONAC•3 / ISOTONAC•4) – см. Рис 6.
3. Крышка МЕК (для детергента CLEANAC•710) – см. Рис 7.
4. Крышка реагента HEMOLYNAC•310 (оранжевая) – см. Рис 9.

5. Штатив для реагентов

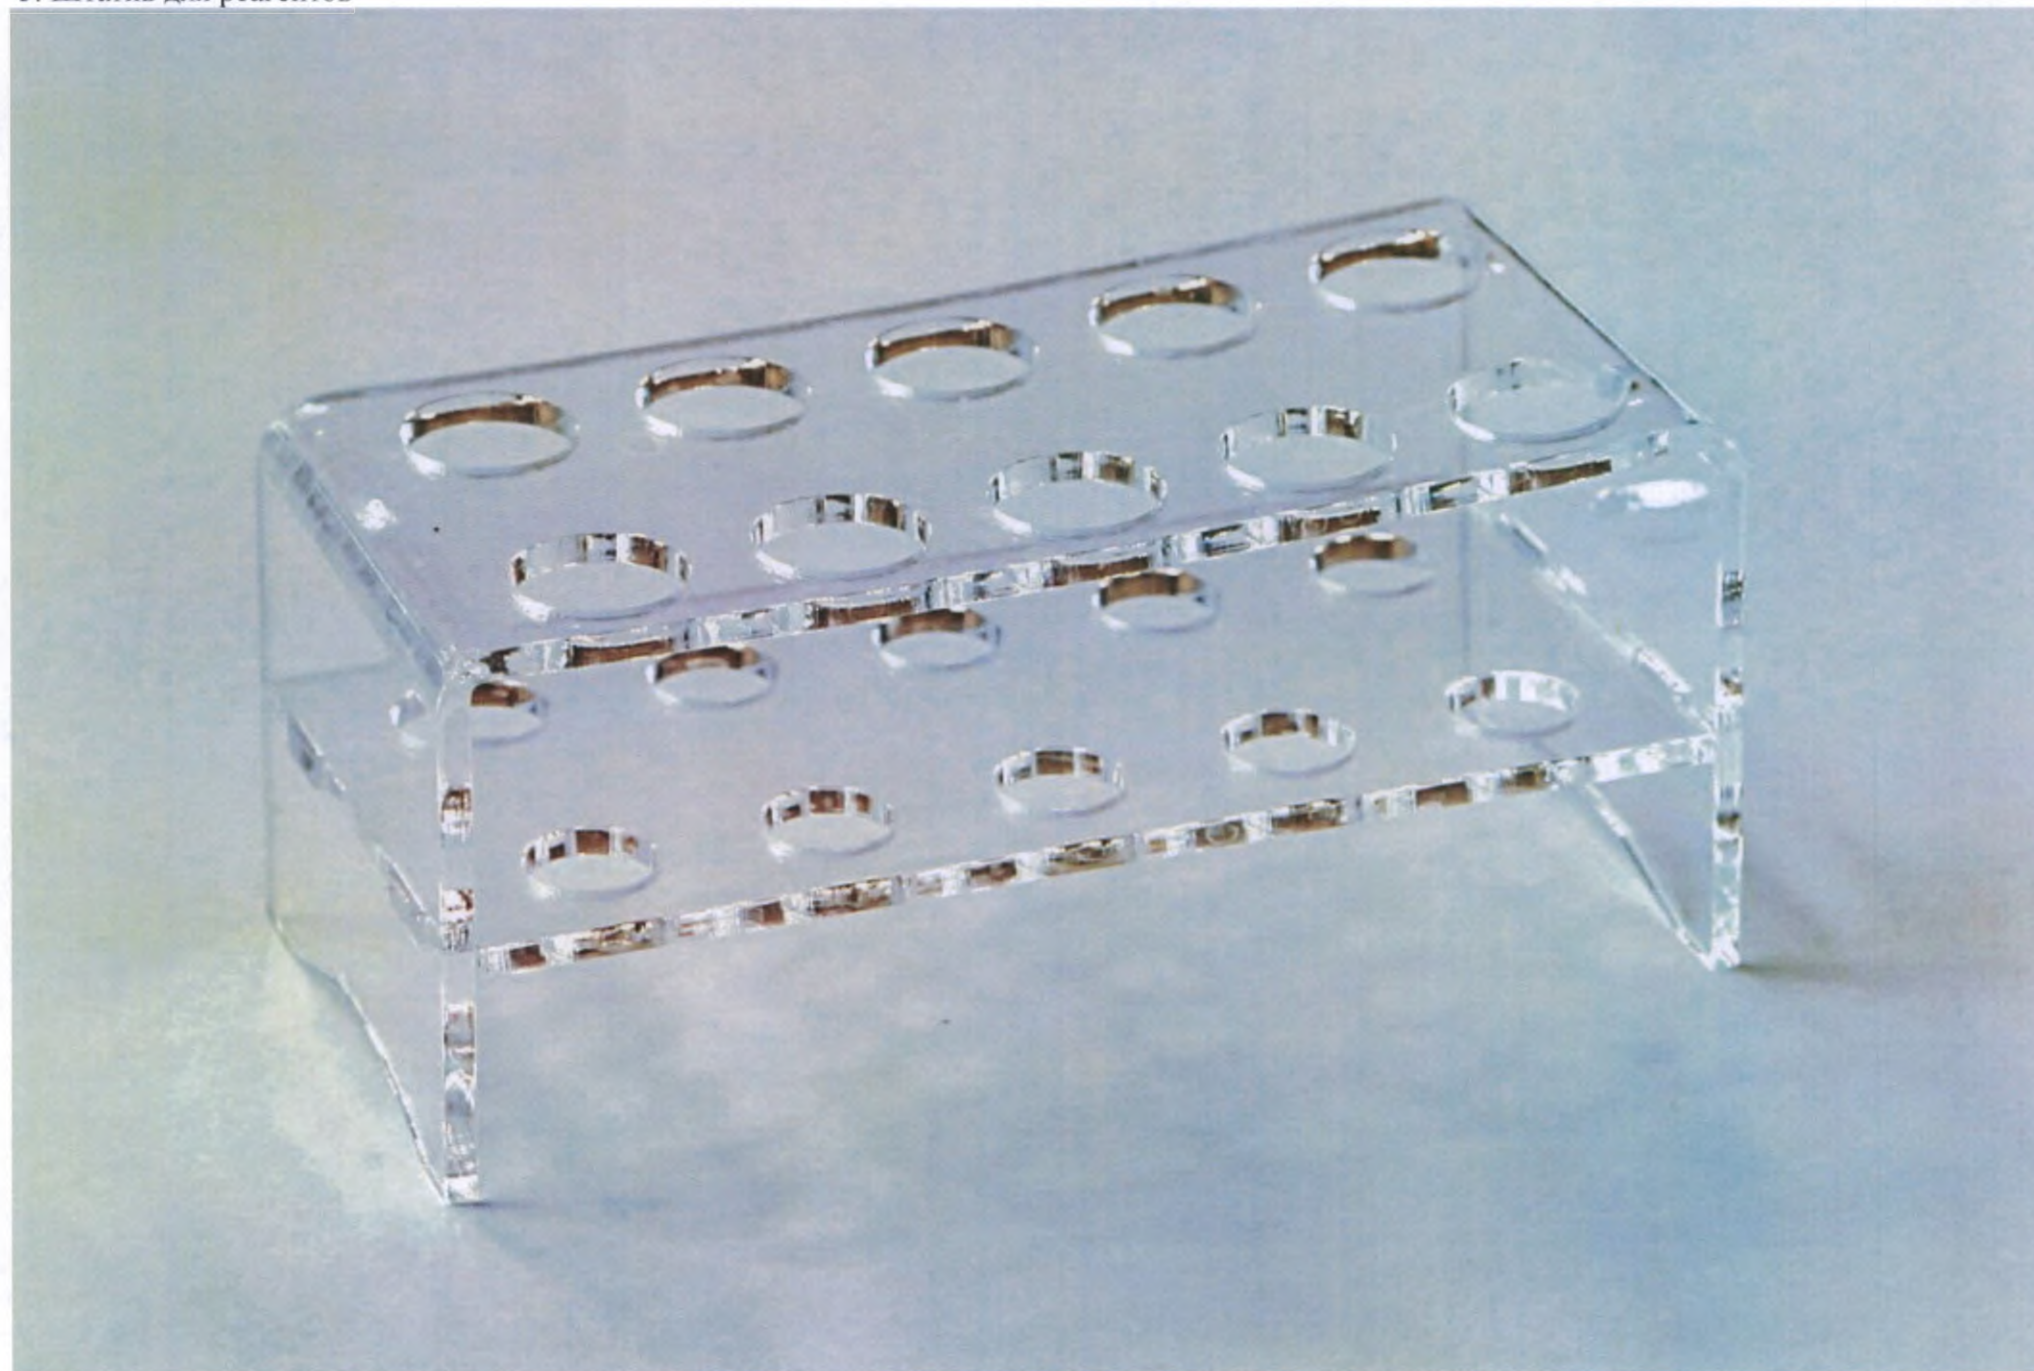

6. Бумажная лента




7. Компактный принтер




8. Кабель USB



9. Последовательный перекрестный кабель D9-D9

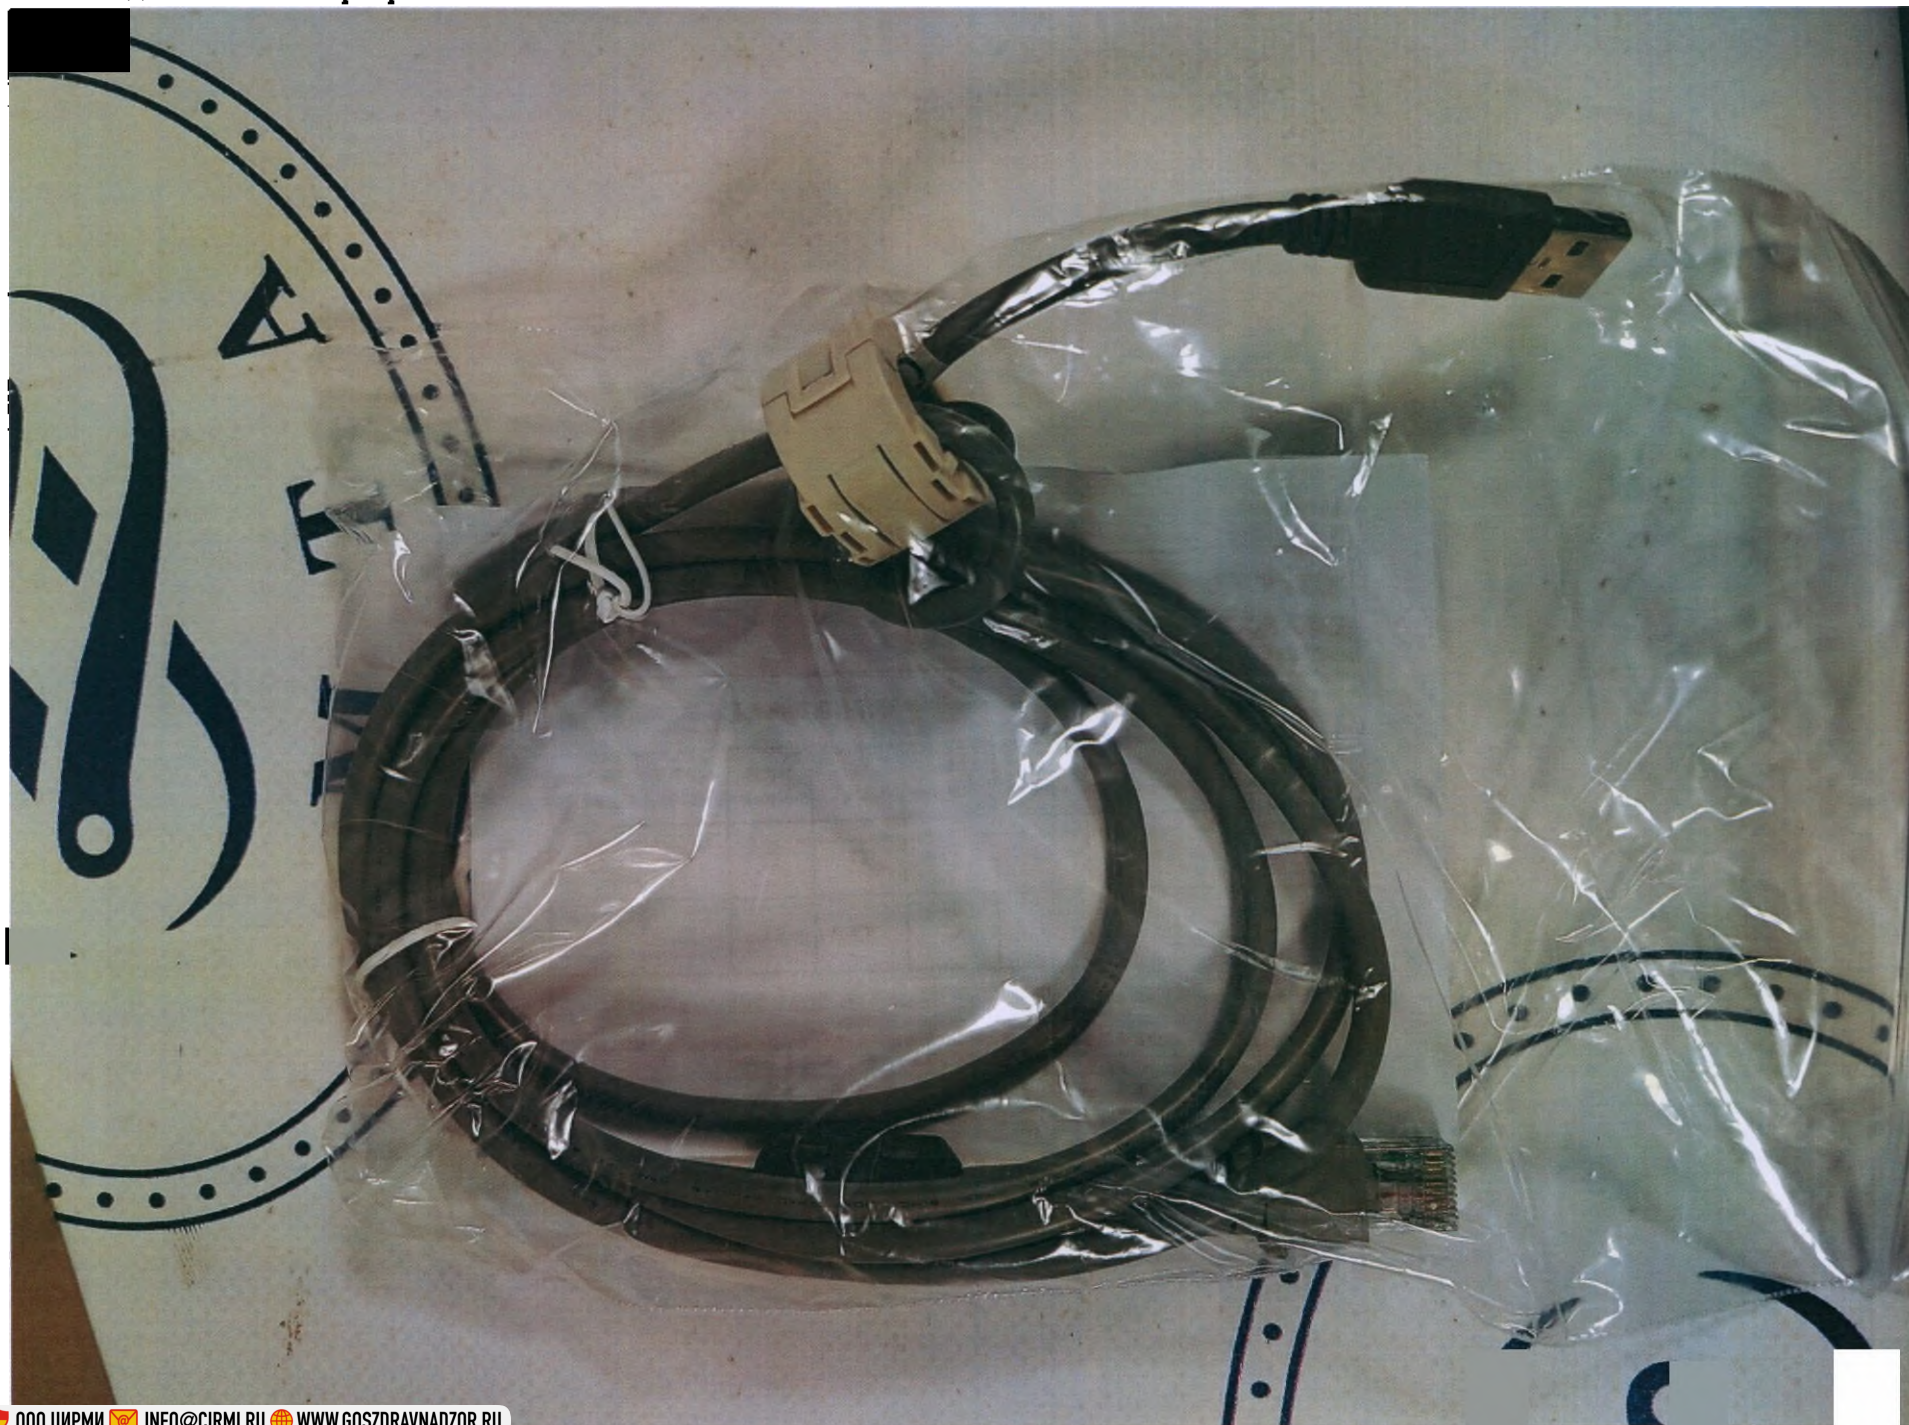

10. Кабель LAN

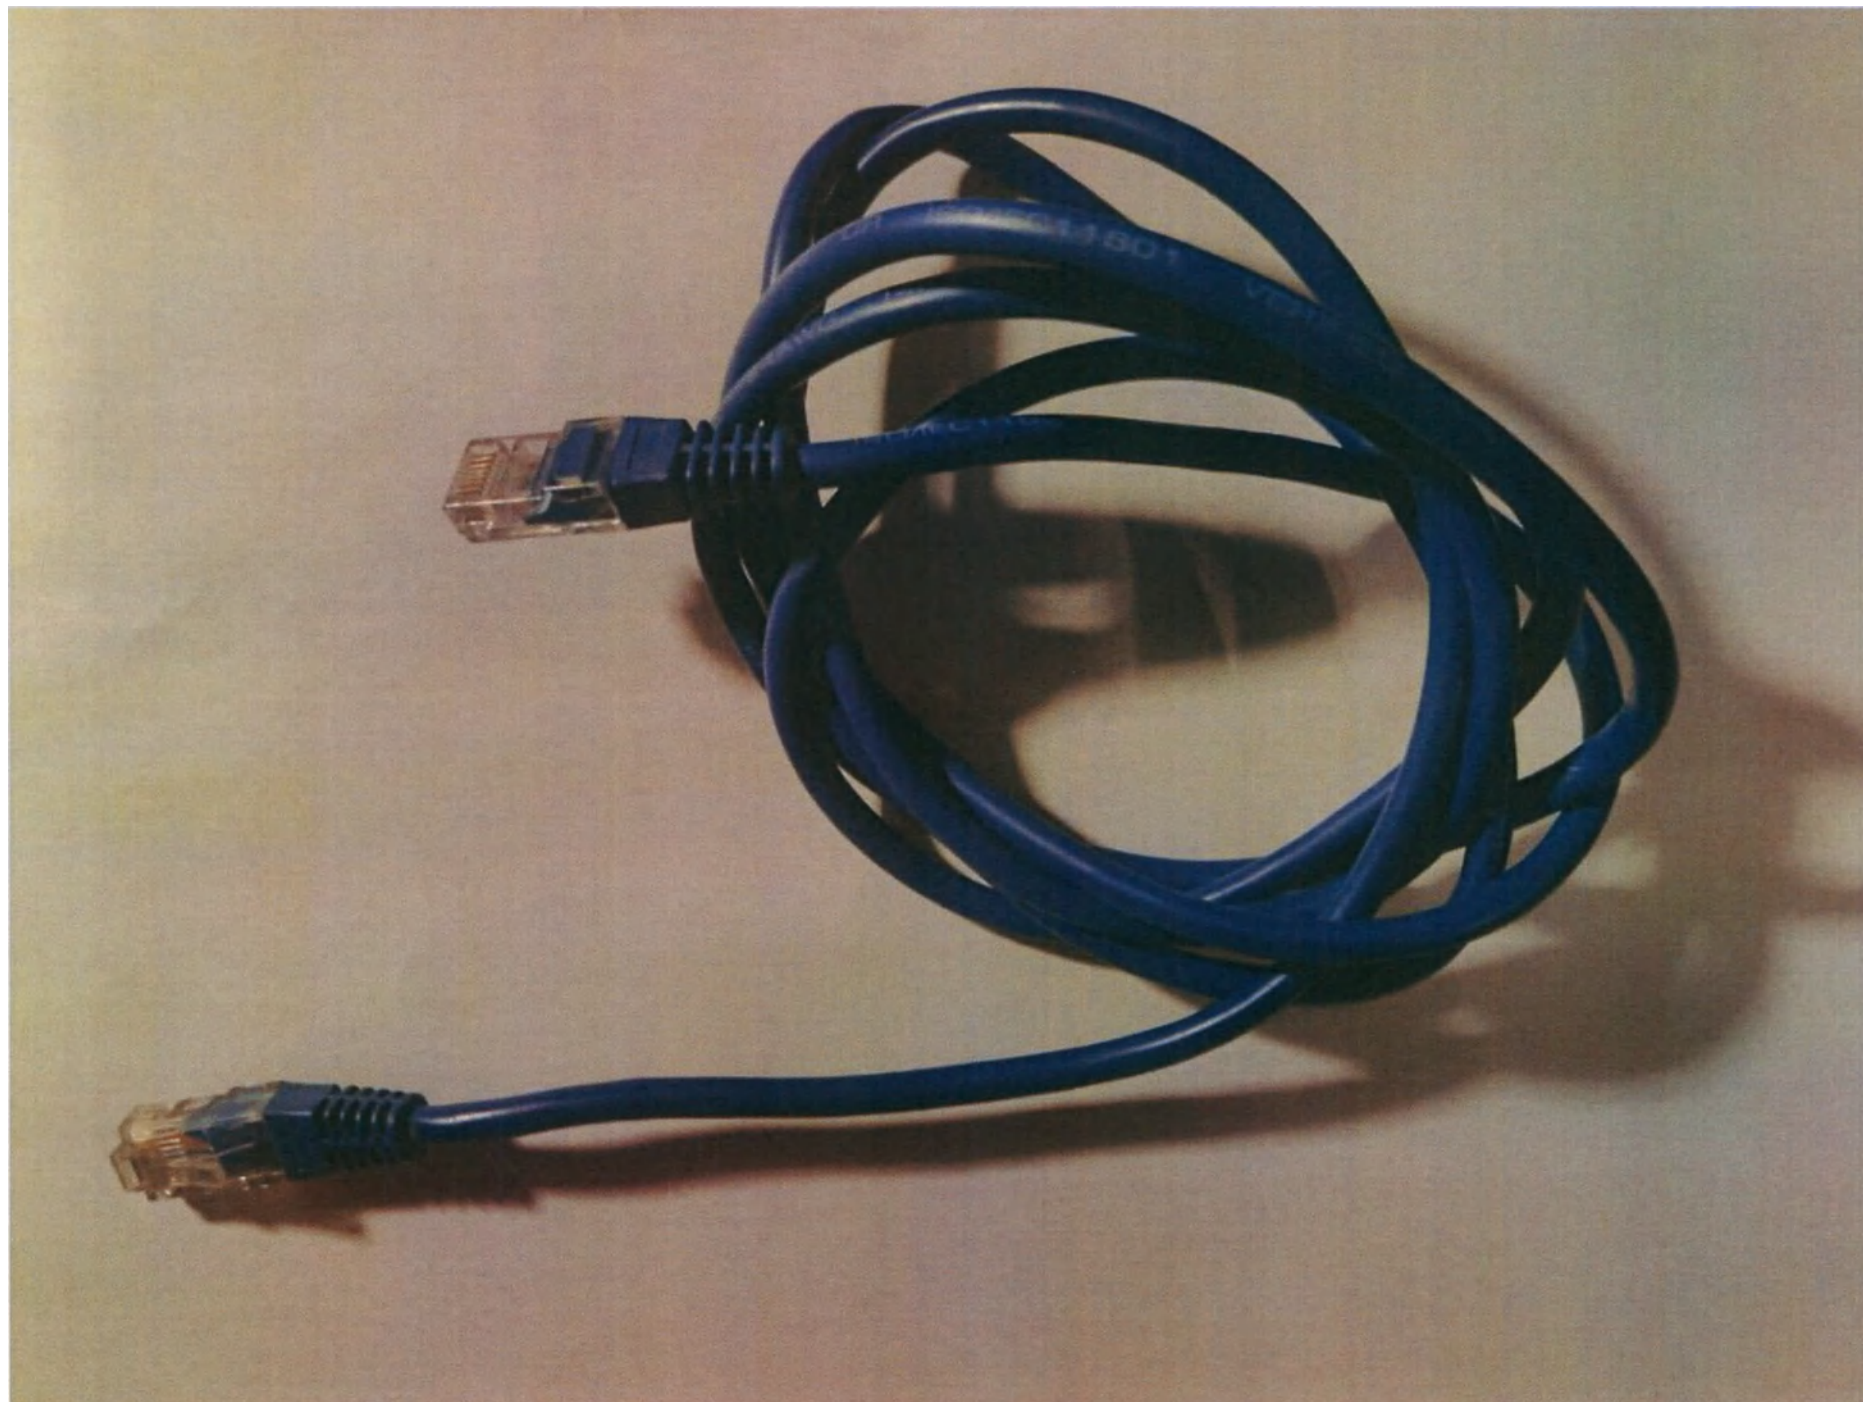

11. Пакет программного обеспечения



12. Комплект адаптера для капилляра (10 мкл) :


- Адаптер для капилляра (10 мкл)
- Сборочное устройство (10 мкл)




13. Капилляр (20 мкл)





14. Капилляр (10 мкл)

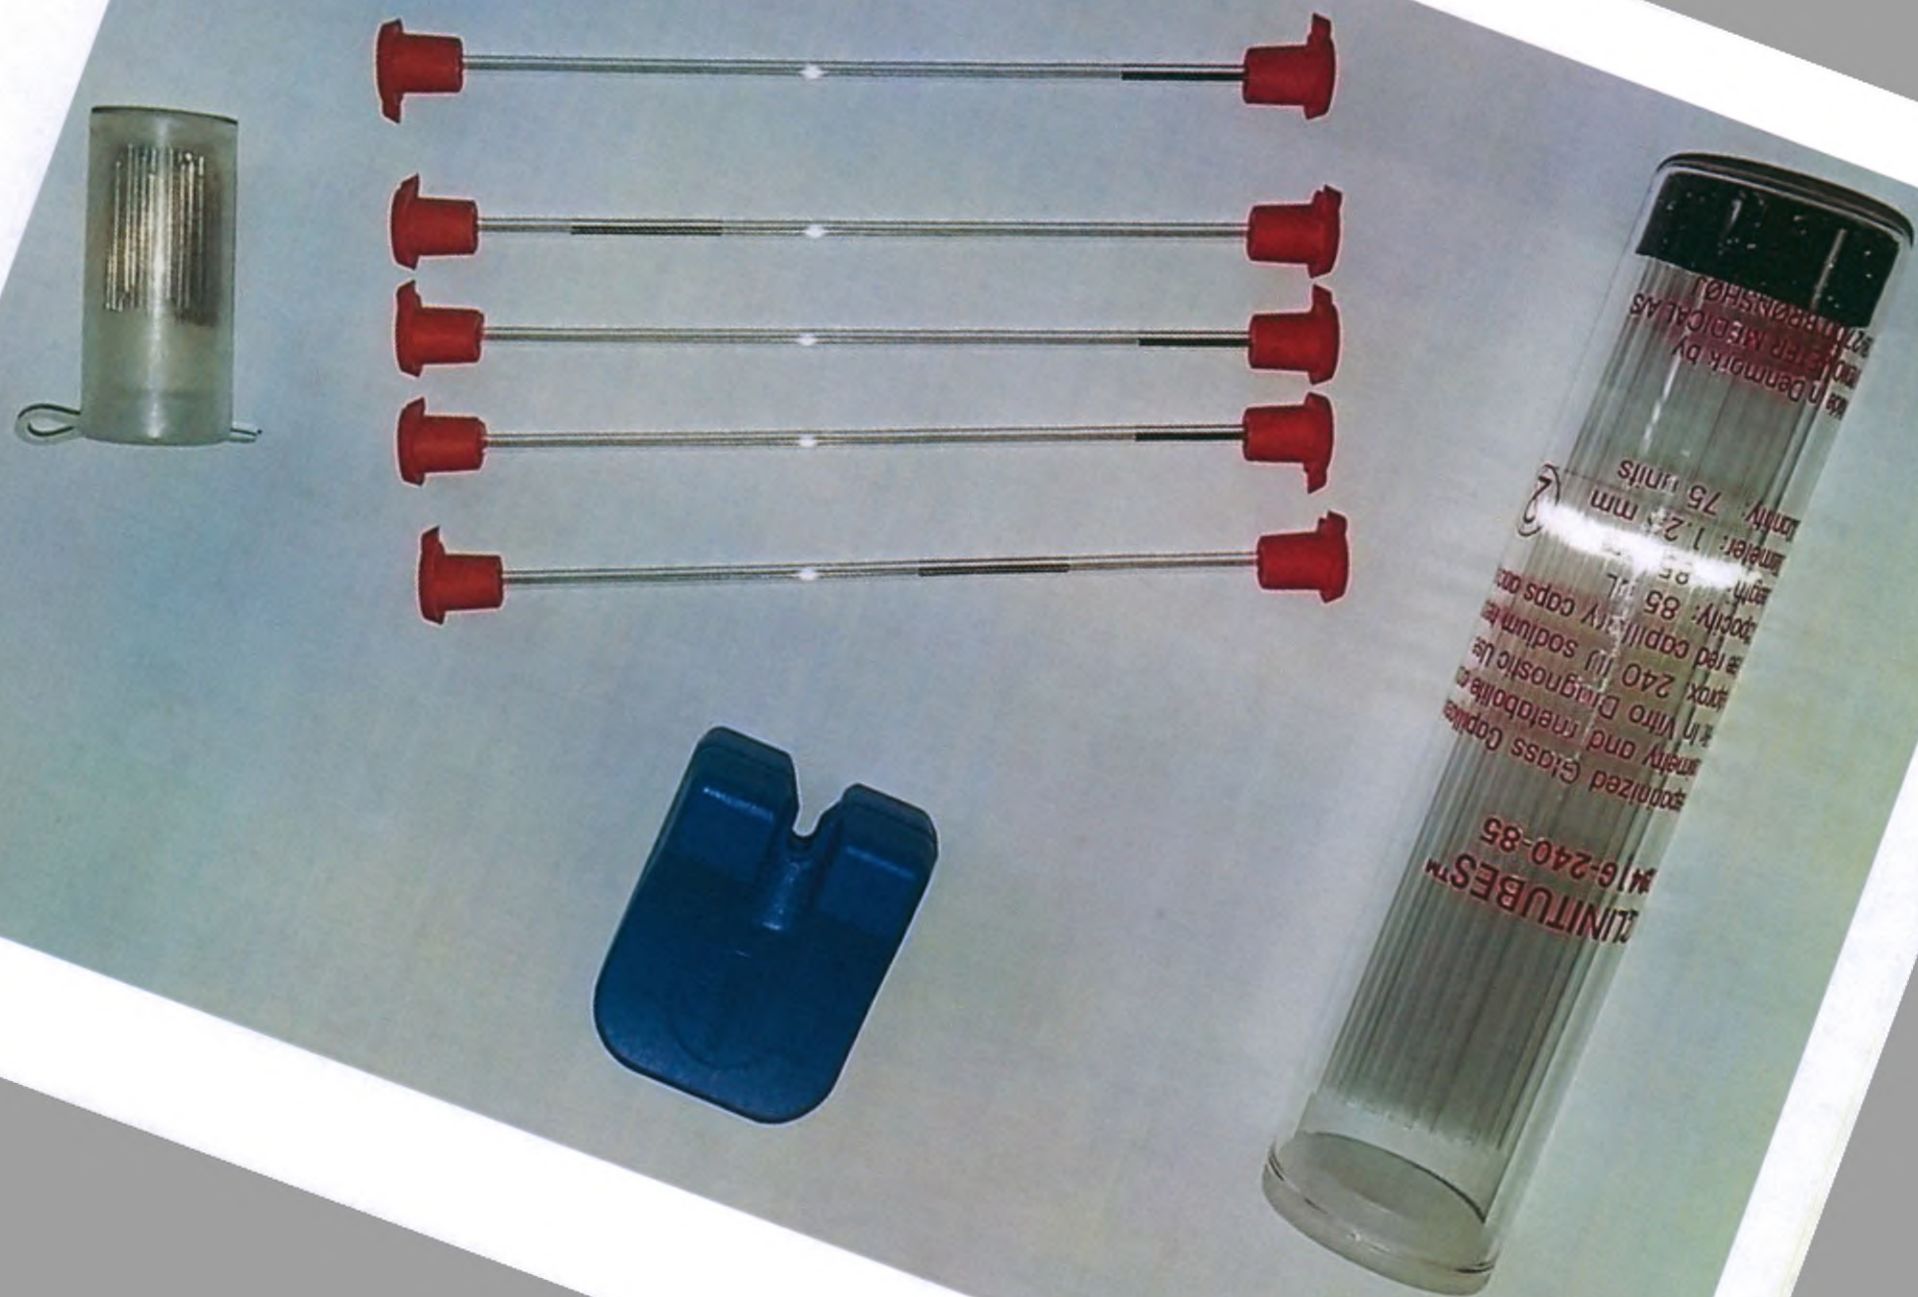


15. Микропробирка, 500 шт./уп.

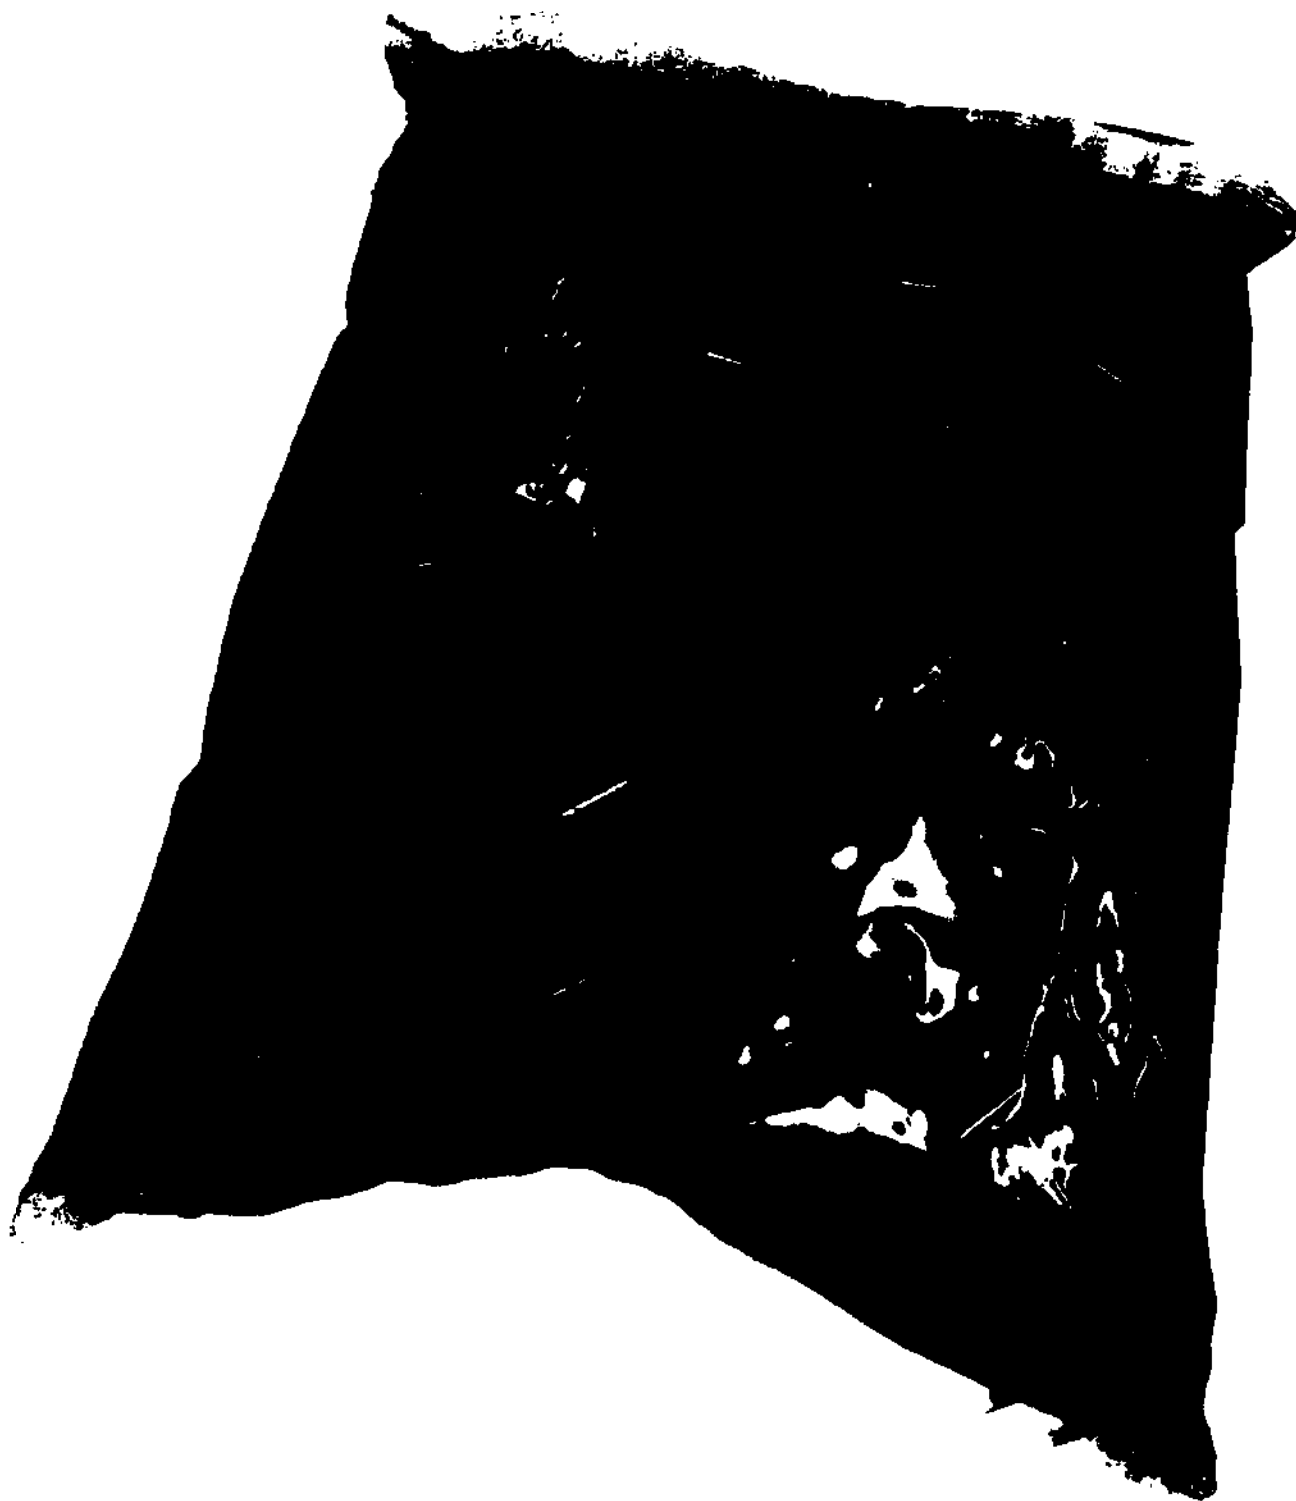

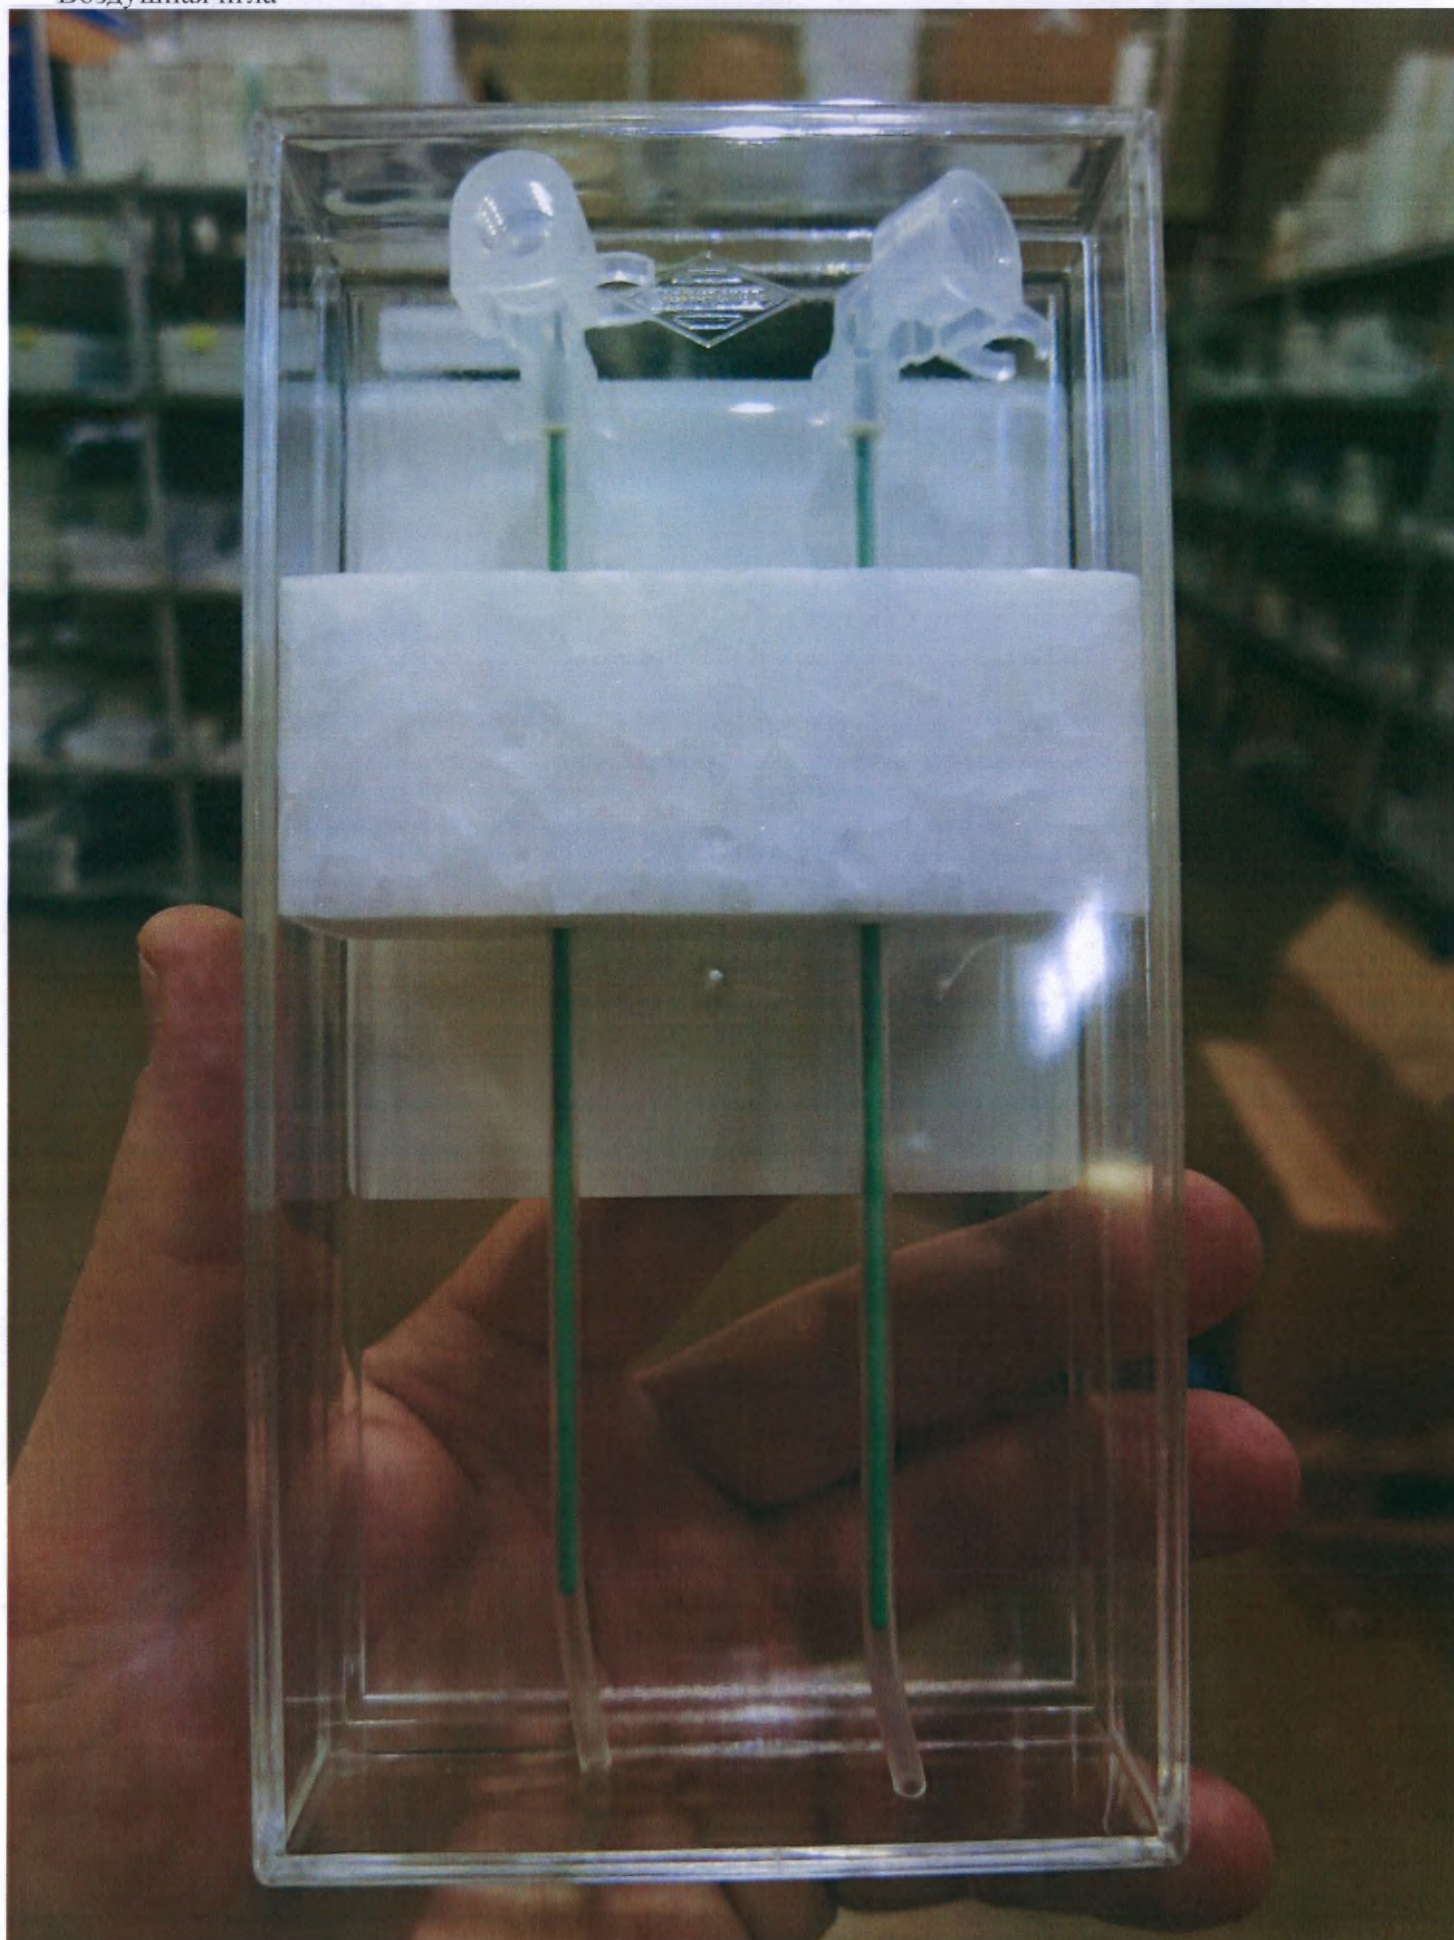


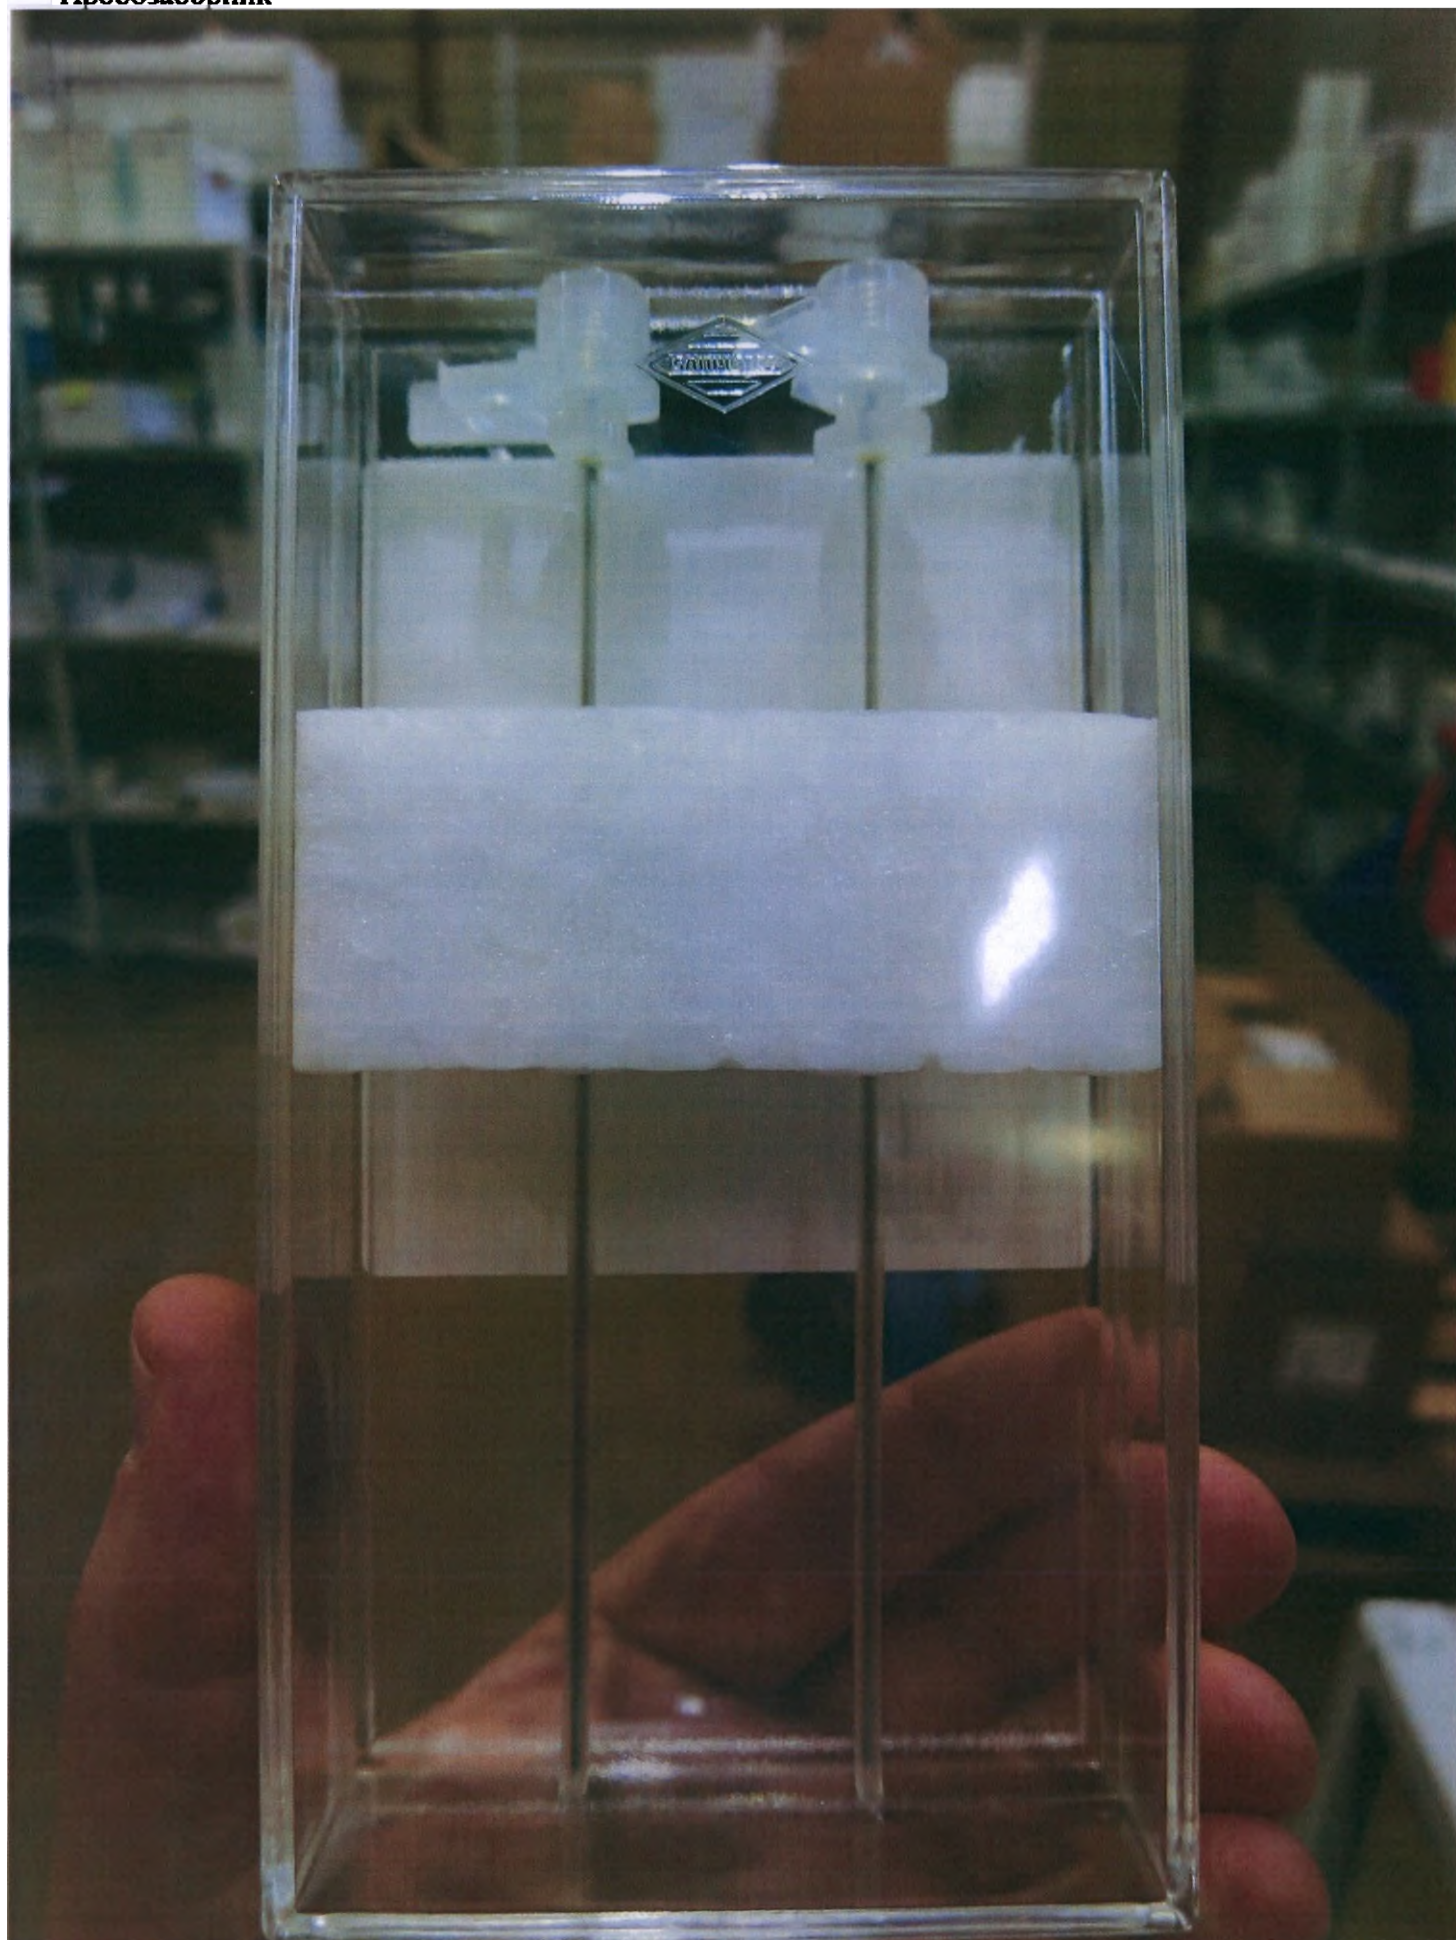

Контейнер для отходов (10 л) при необходимости)

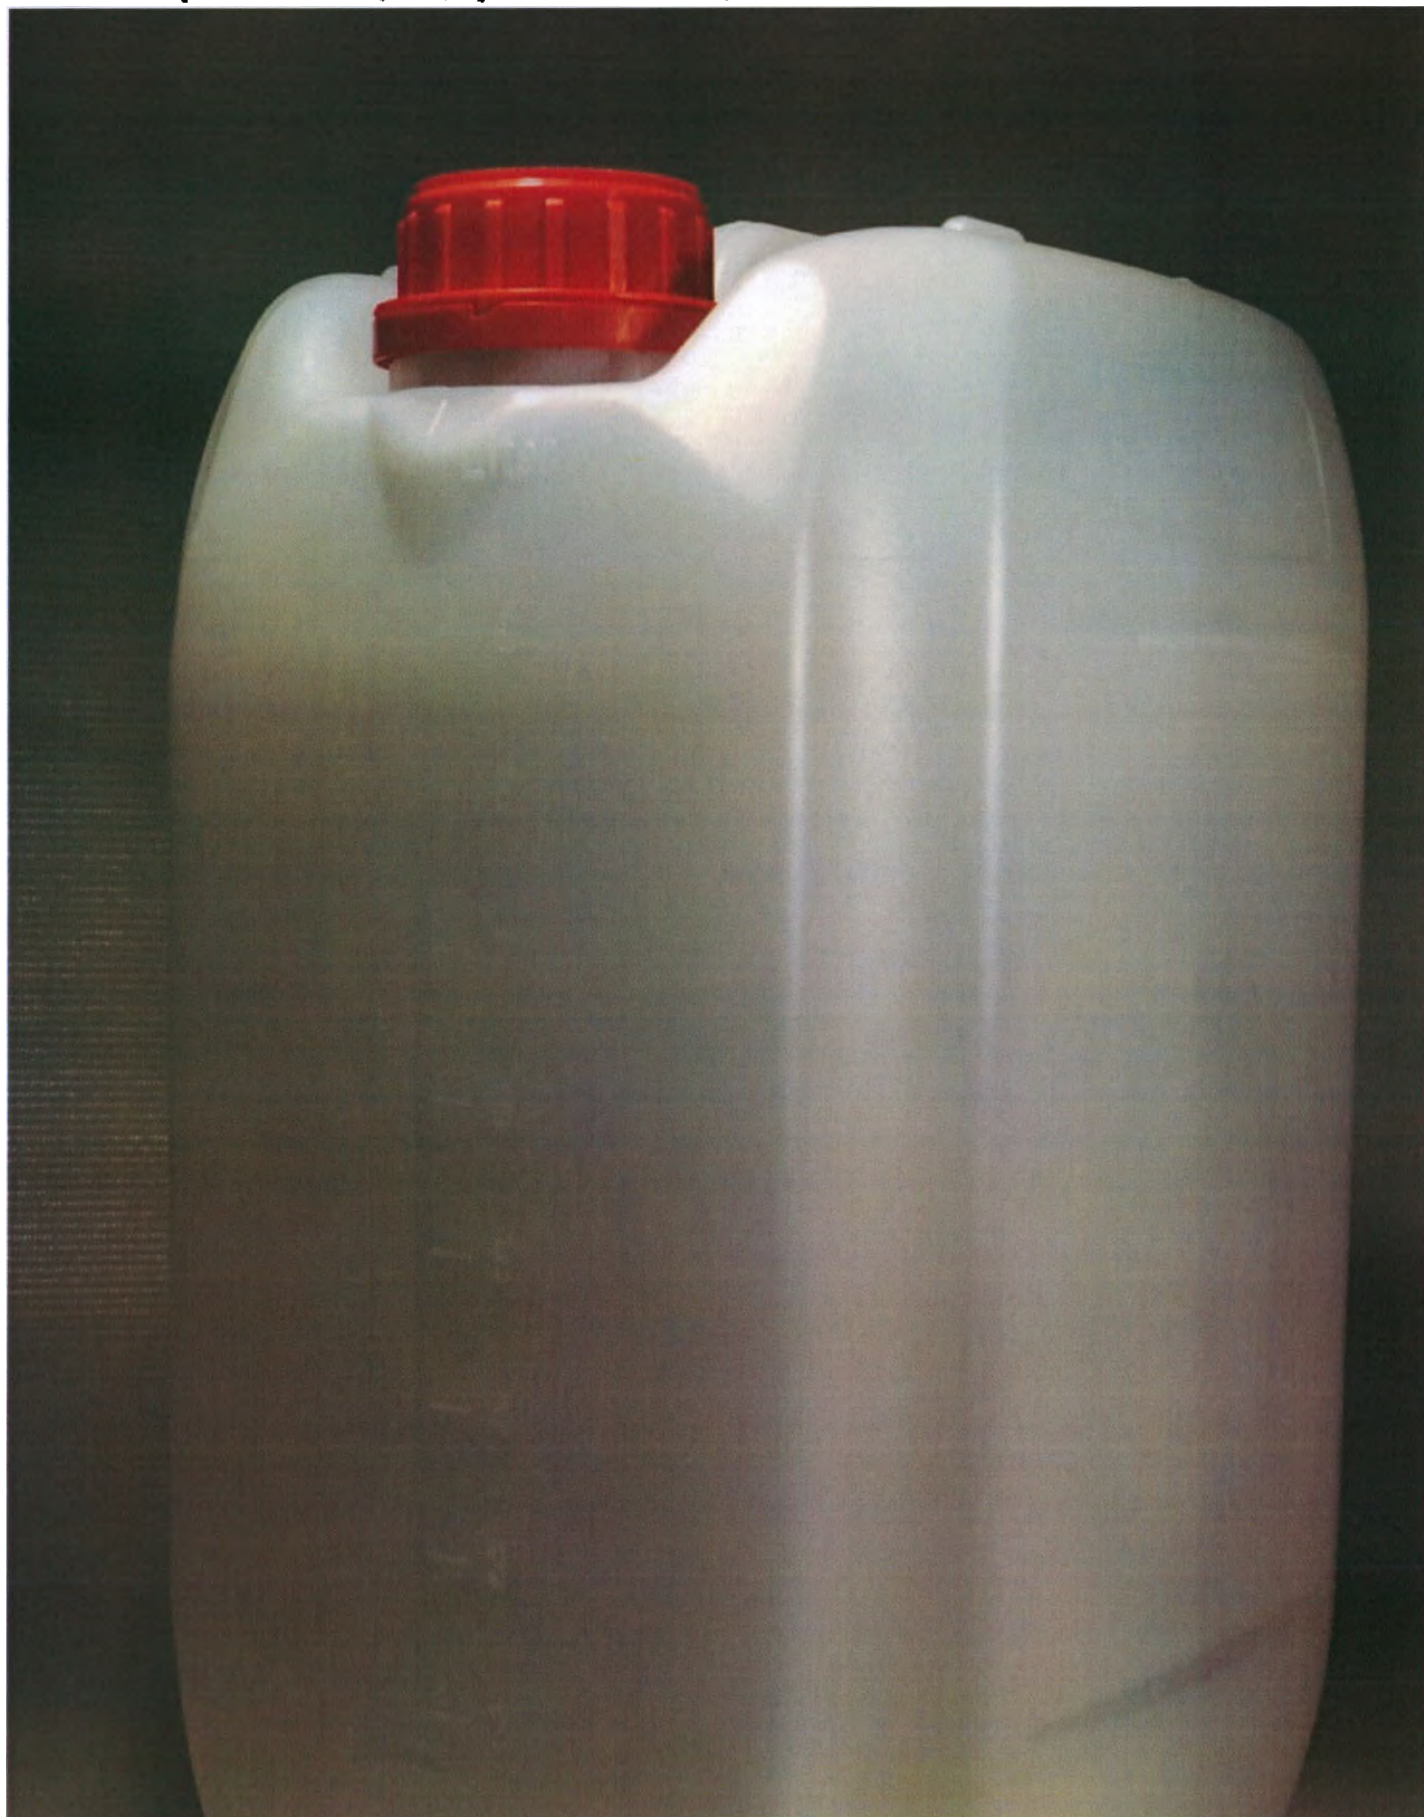


19. Датчик отходов – 1 шт.

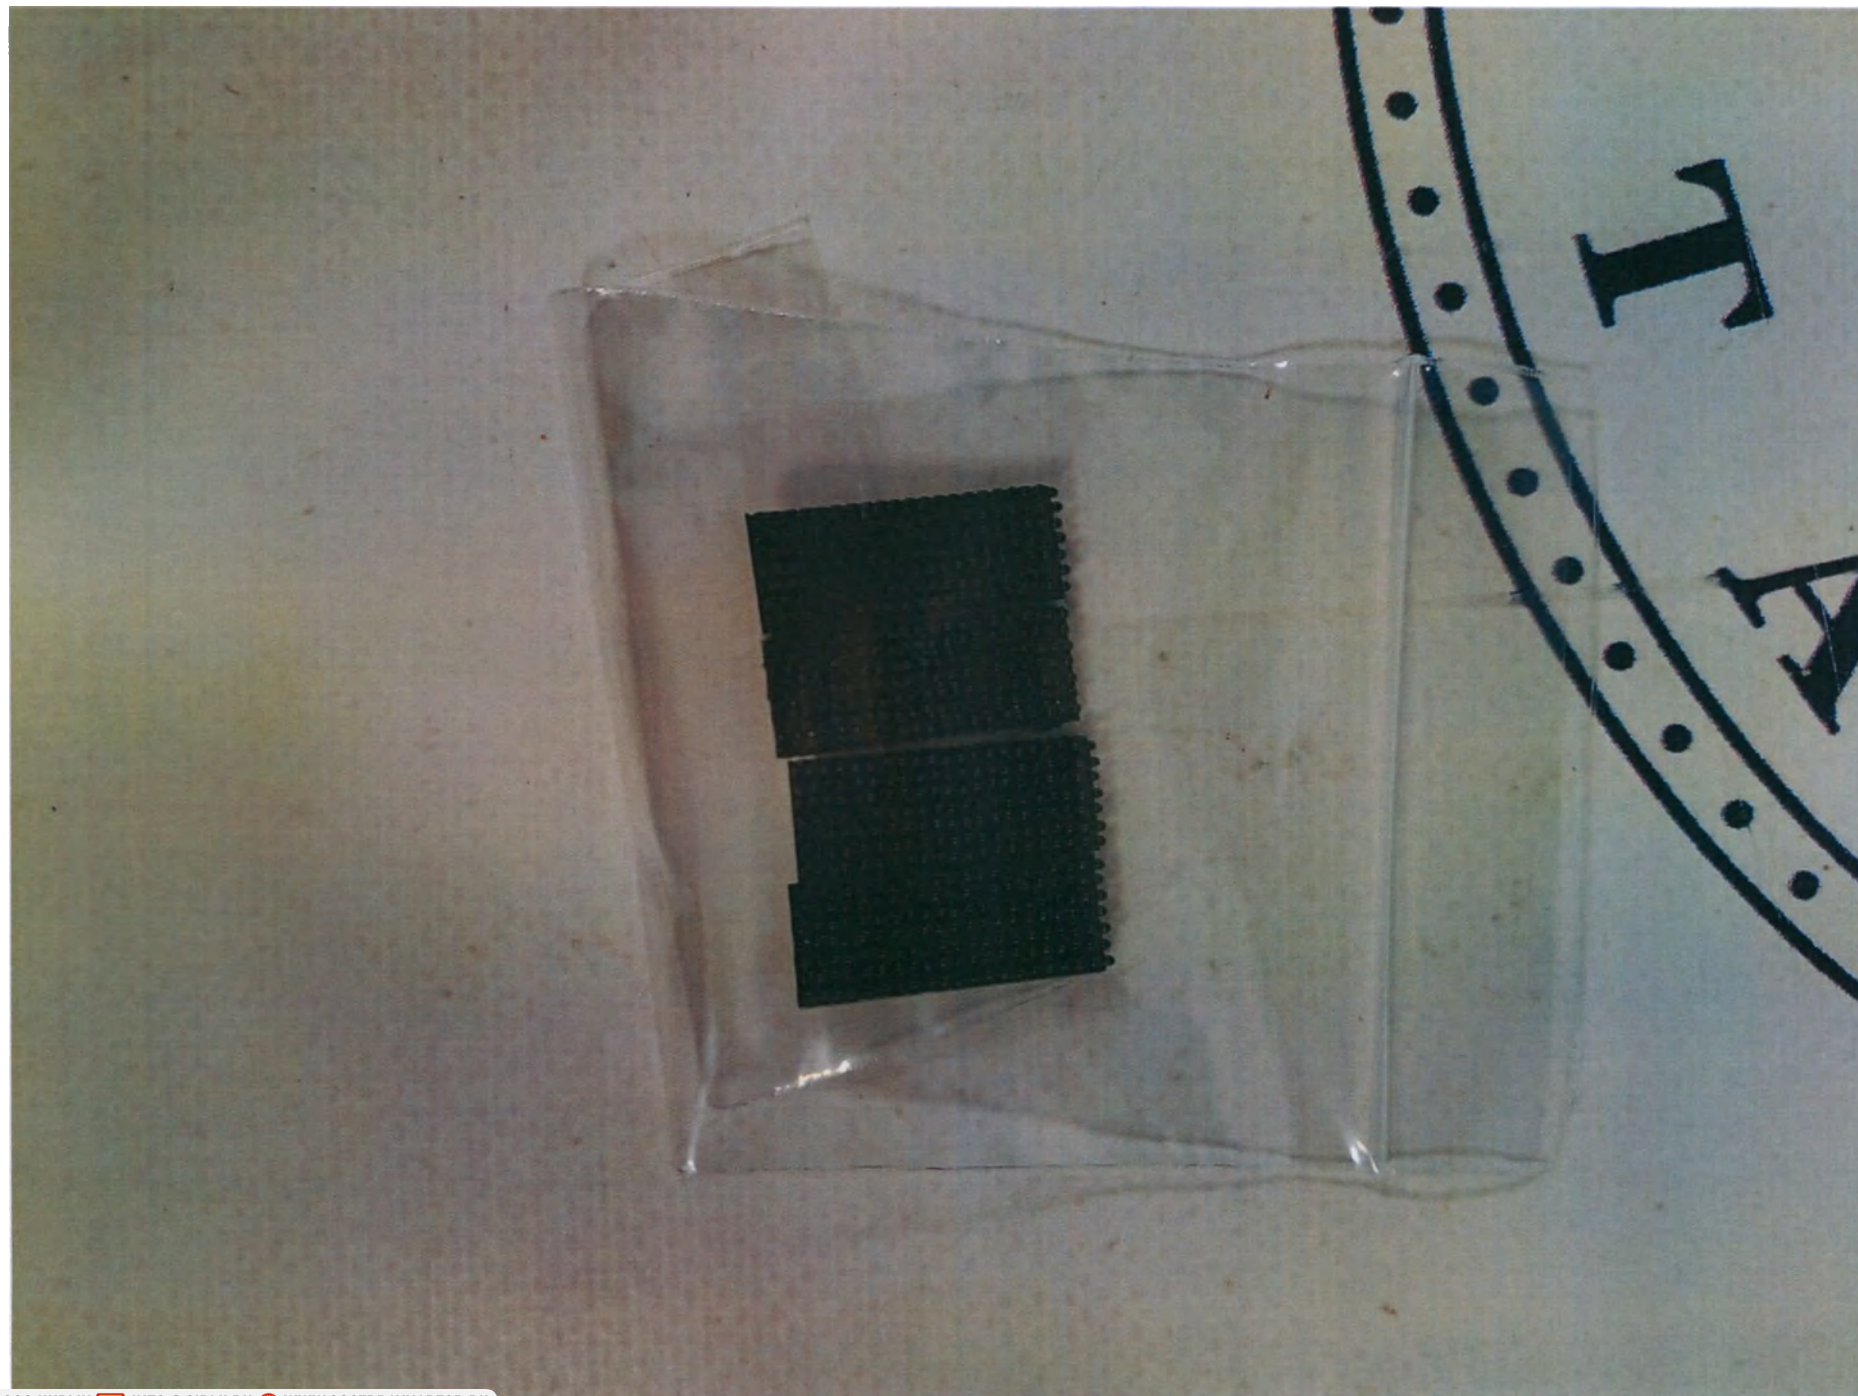







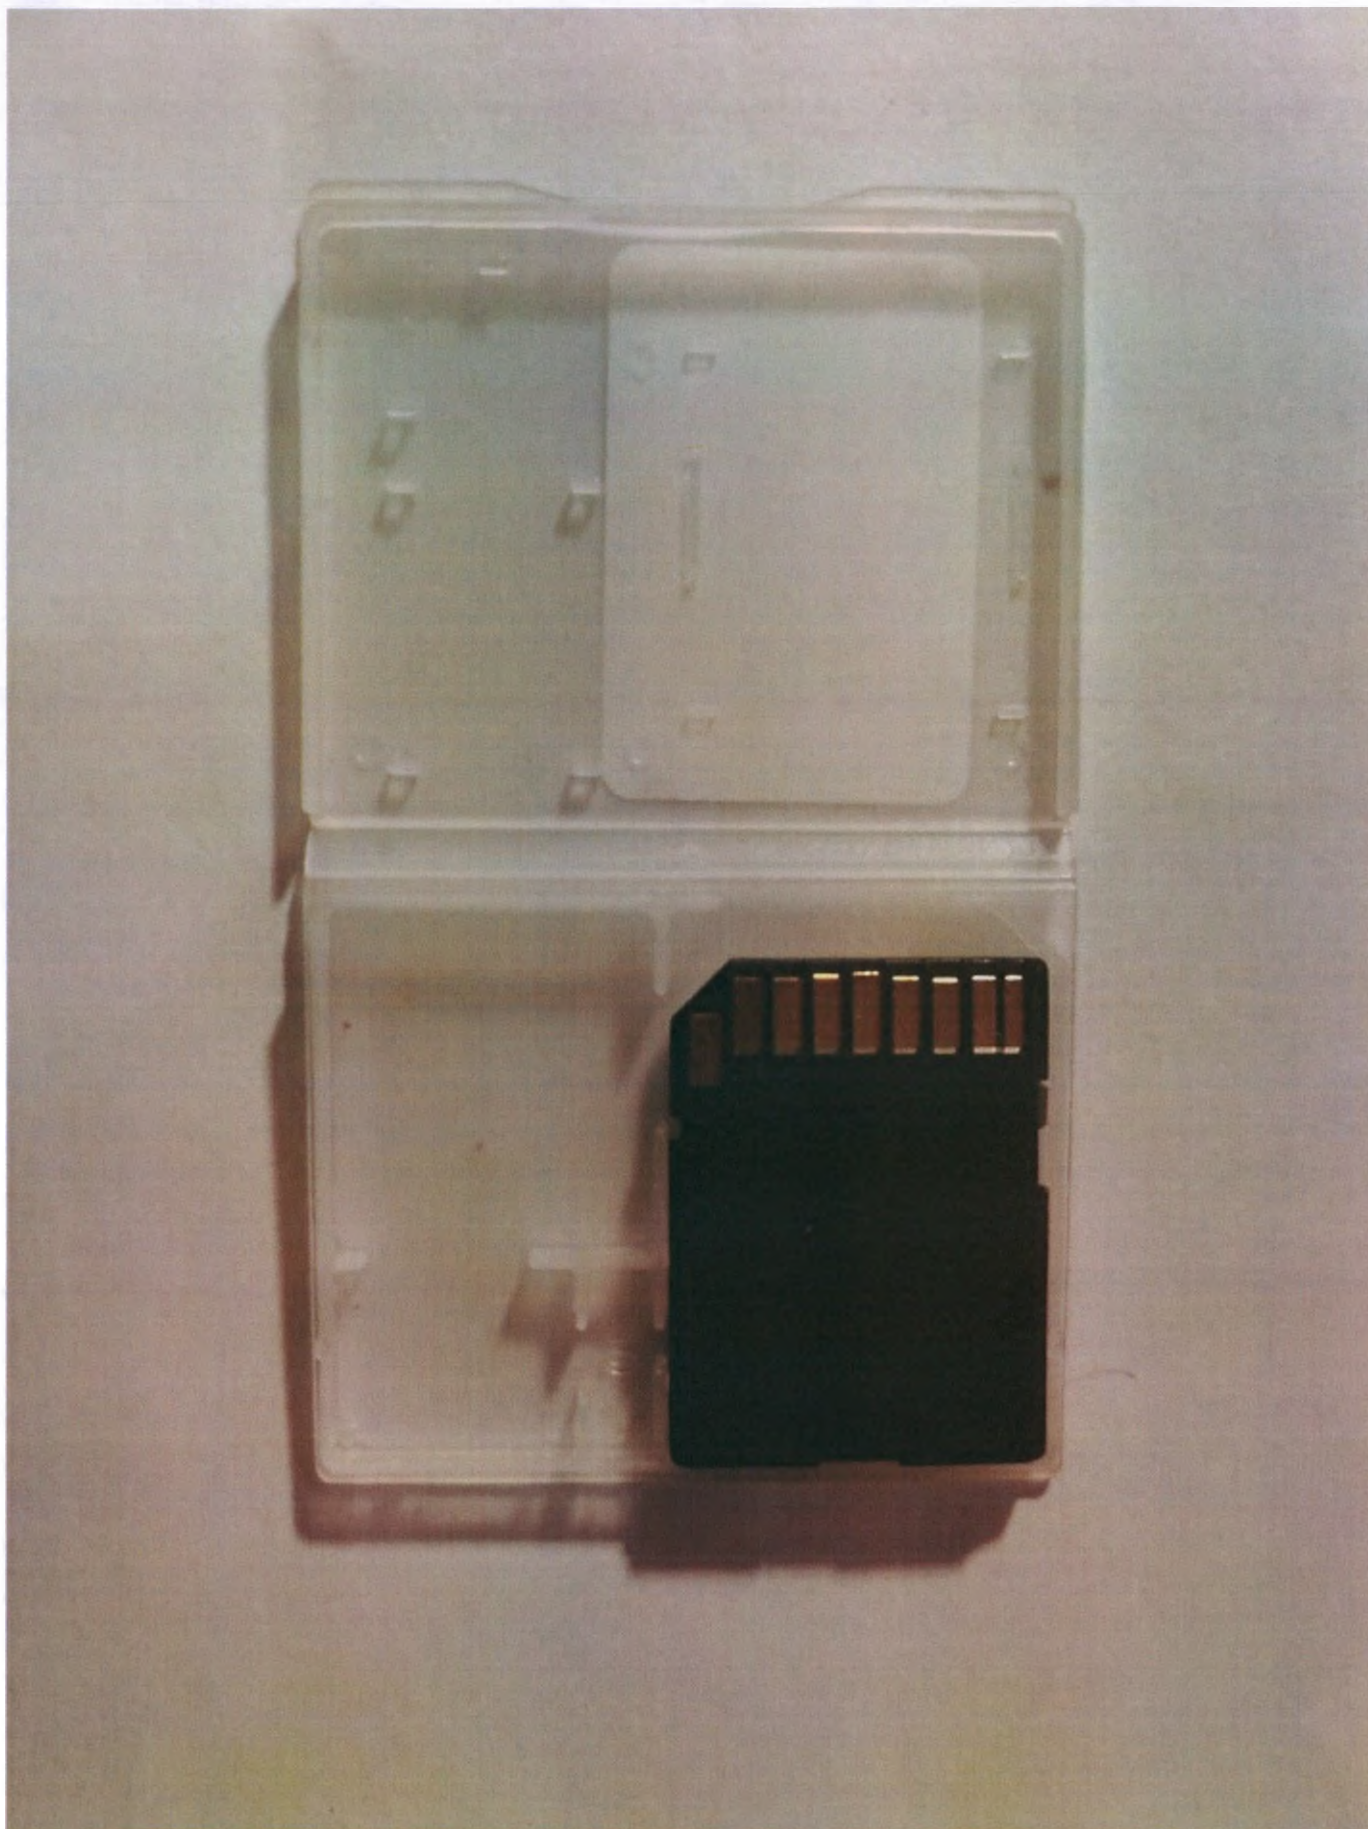

23. Карта SD (2 Гб)

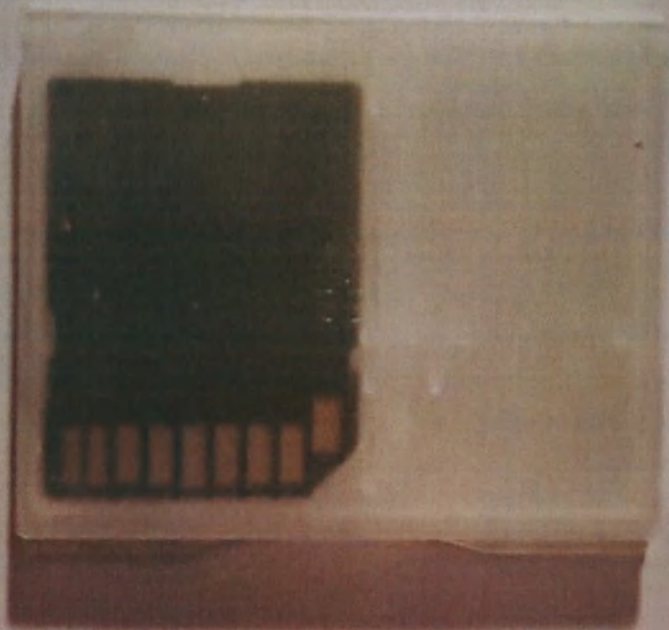

24.Трубка насоса ESR

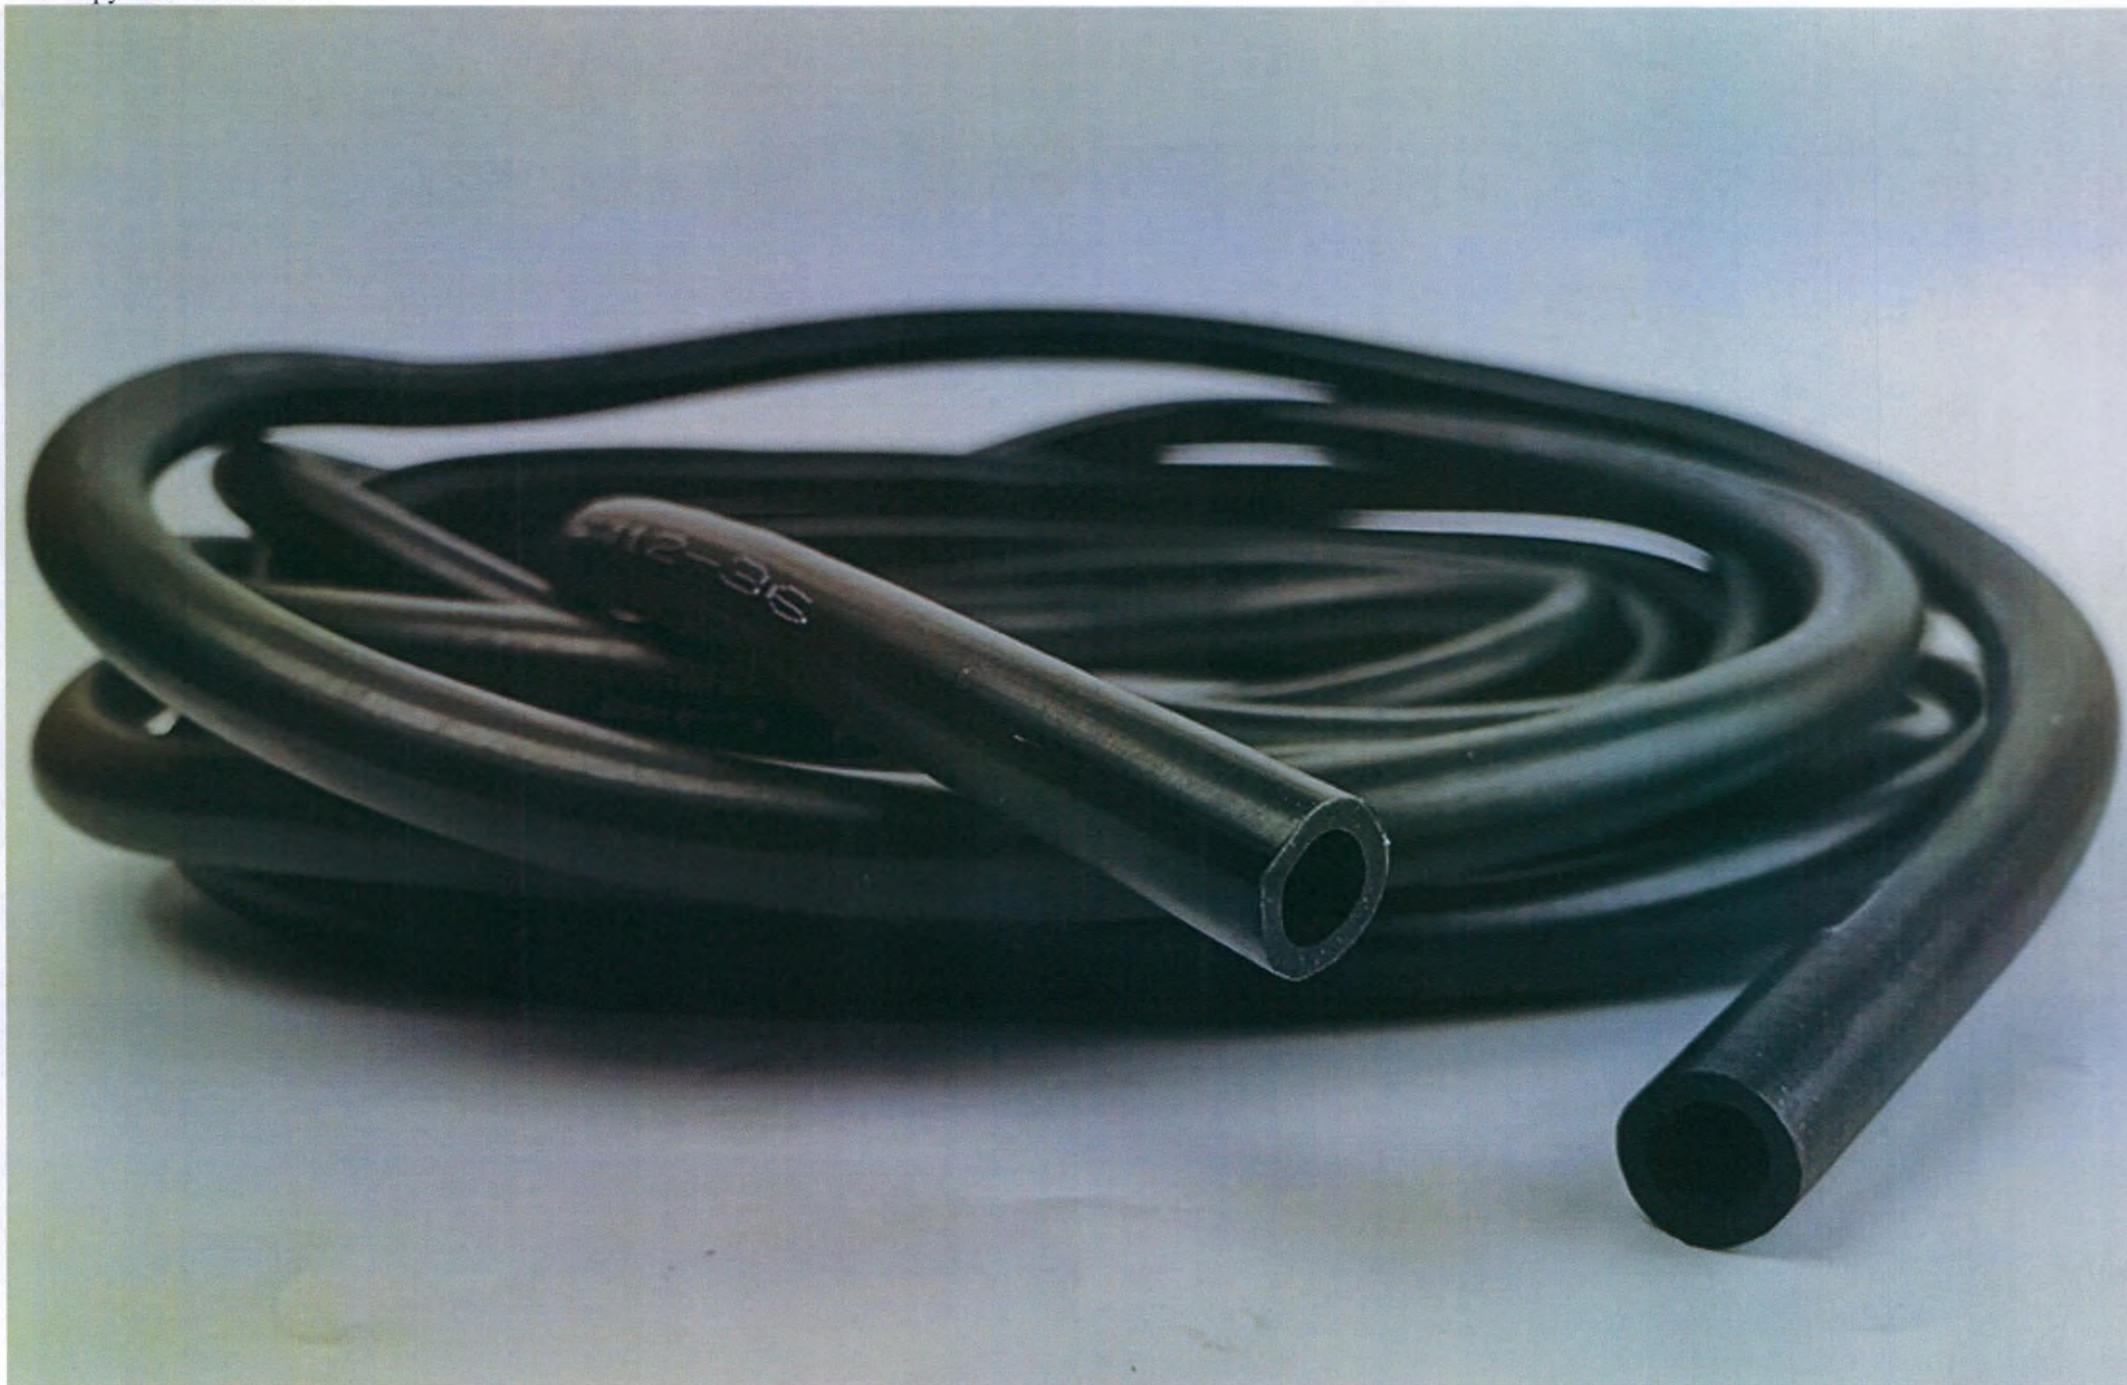

25.Трубка клапана ESR



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 125

(Стр. 1 из 1)
листое. Генеральный директор

Н.А.Ворошилов

