

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия
для диагностики in vitro

«Анализатор автоматический sciREADER CL2
для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2XI»
производства

Scienion GmbH (Саенион ГмбХ), Турция
Volmerstraße 7b 12489 Berlin, Germany
(Волмерштрассе 7б 12489 Берлин, Германия)

Утверждено:

Полное имя: Федотов И.В.

Должность: Генеральный директор ООО «Дельрус»

Название компании: ООО «Дельрус»

Подпись:

Дата: 27.12.2021.

Печать:



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 638 от 25.10.2021
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМ
М В КУЛЯС



Транспортная упаковка изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2X»



Транспортная упаковка изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2X»




Транспортная упаковка изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2X»




Транспортная упаковка изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2X»



Общий вид медицинского изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2XI»

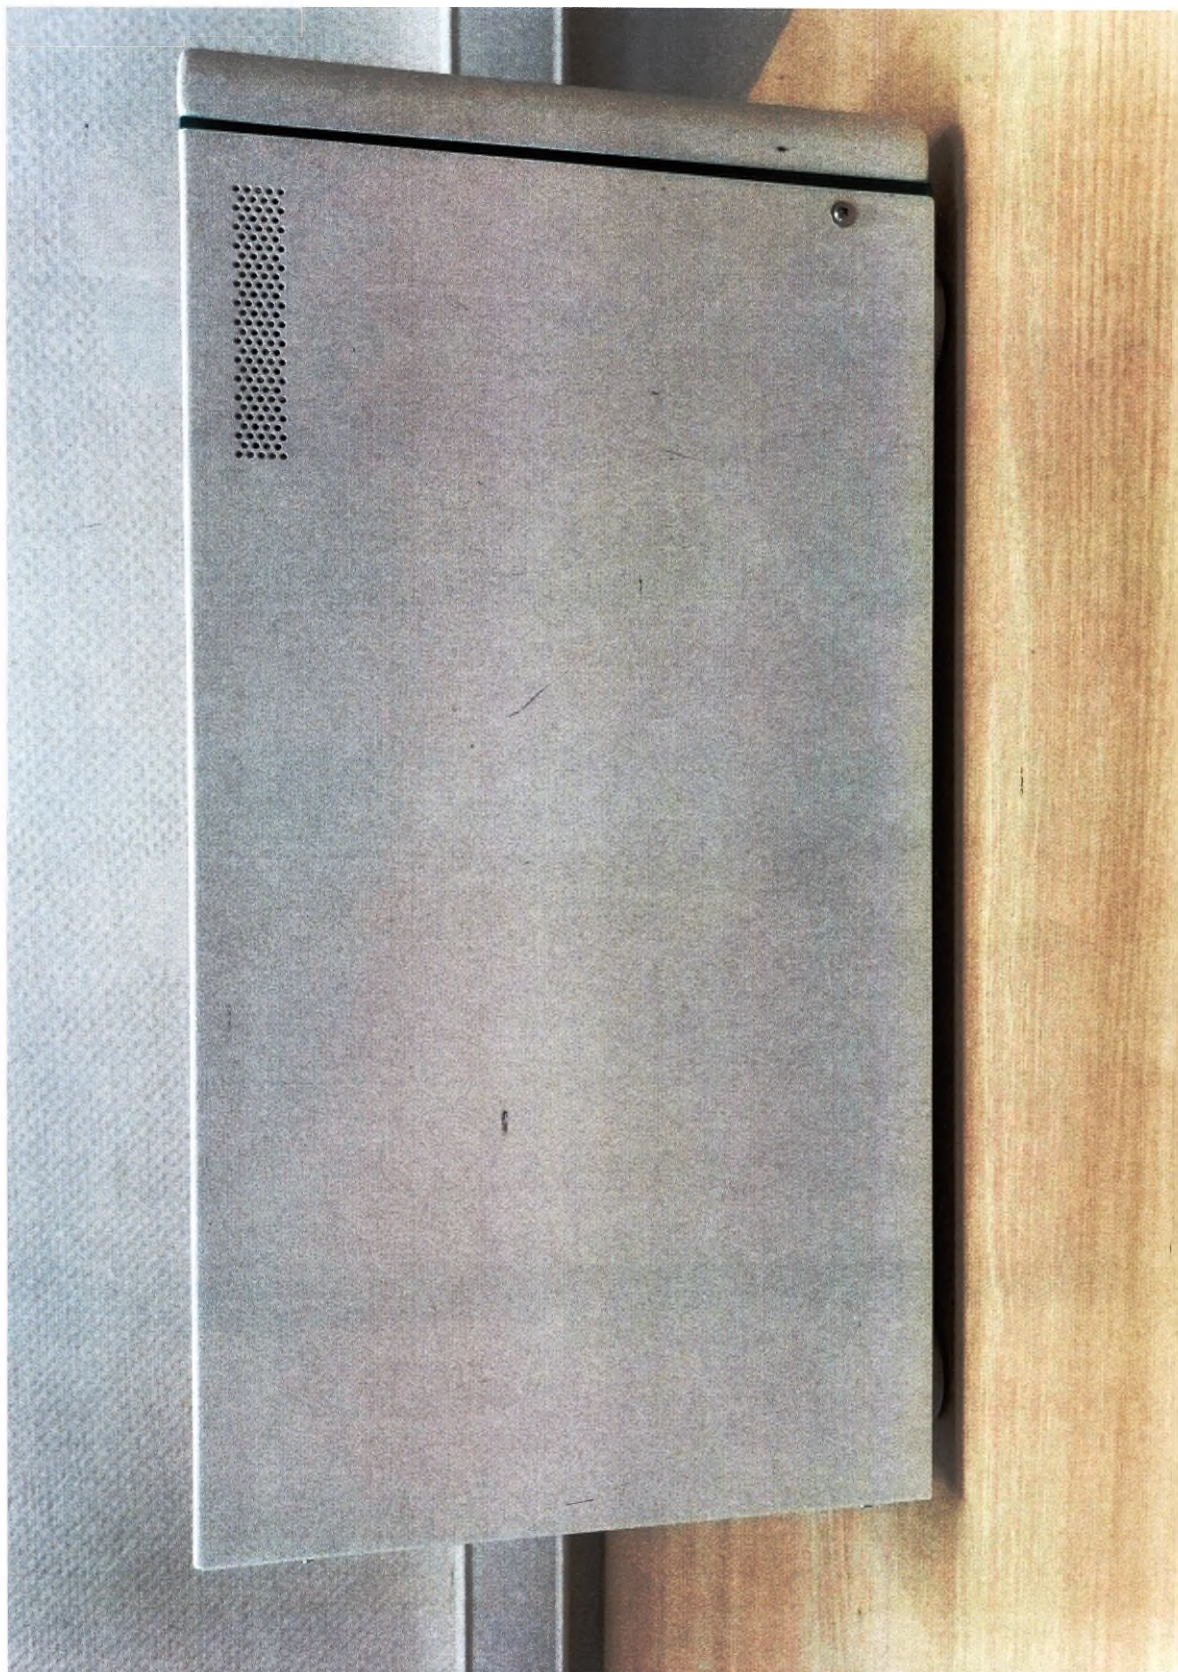

Общий вид медицинского изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2XI»

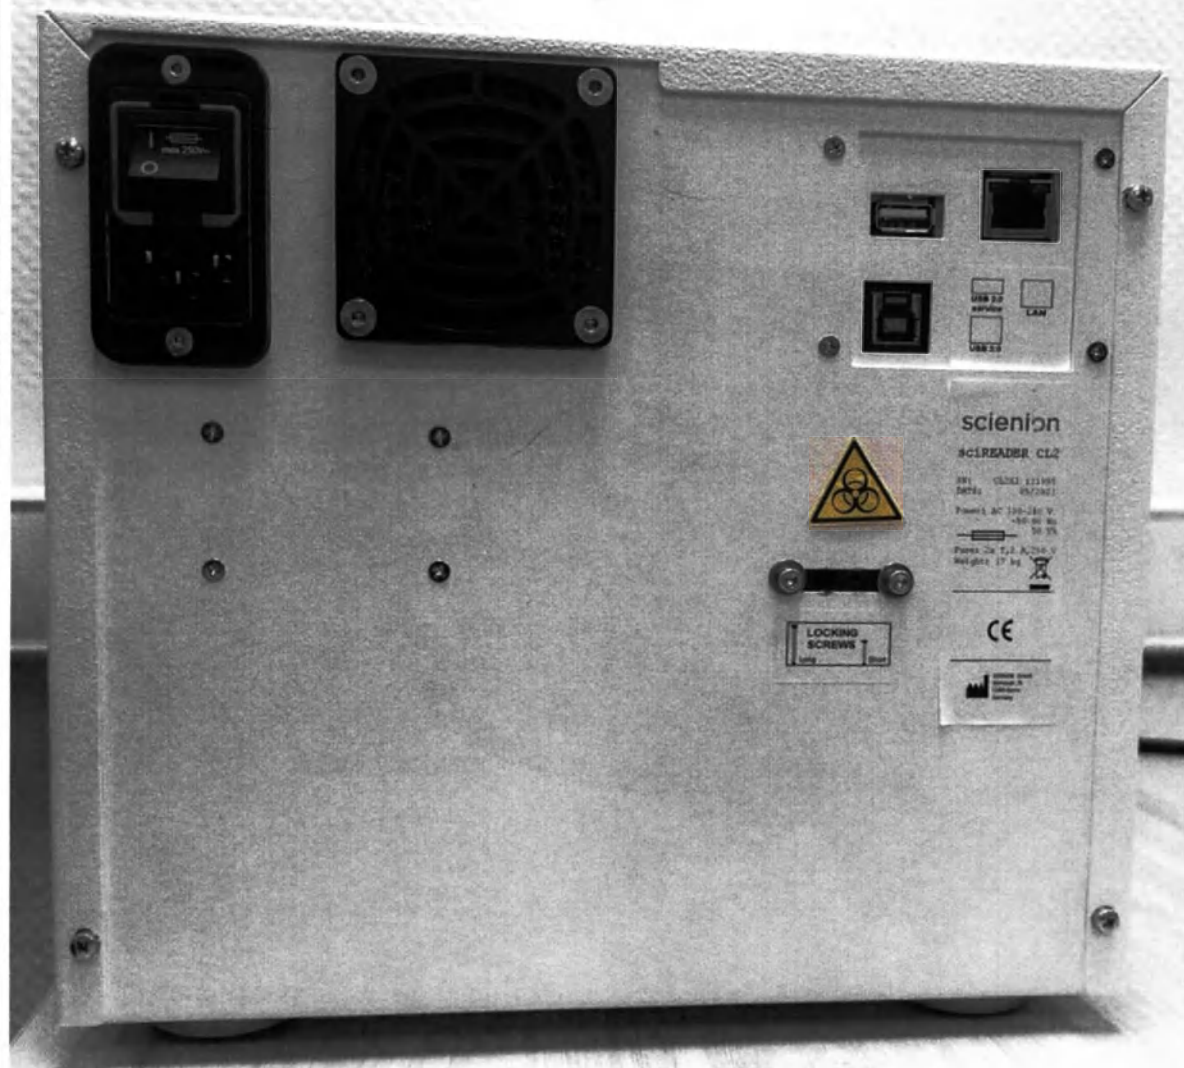


Общий вид медицинского изделия «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2XI»




Кабель питания




Кабель USB для подключения к компьютеру

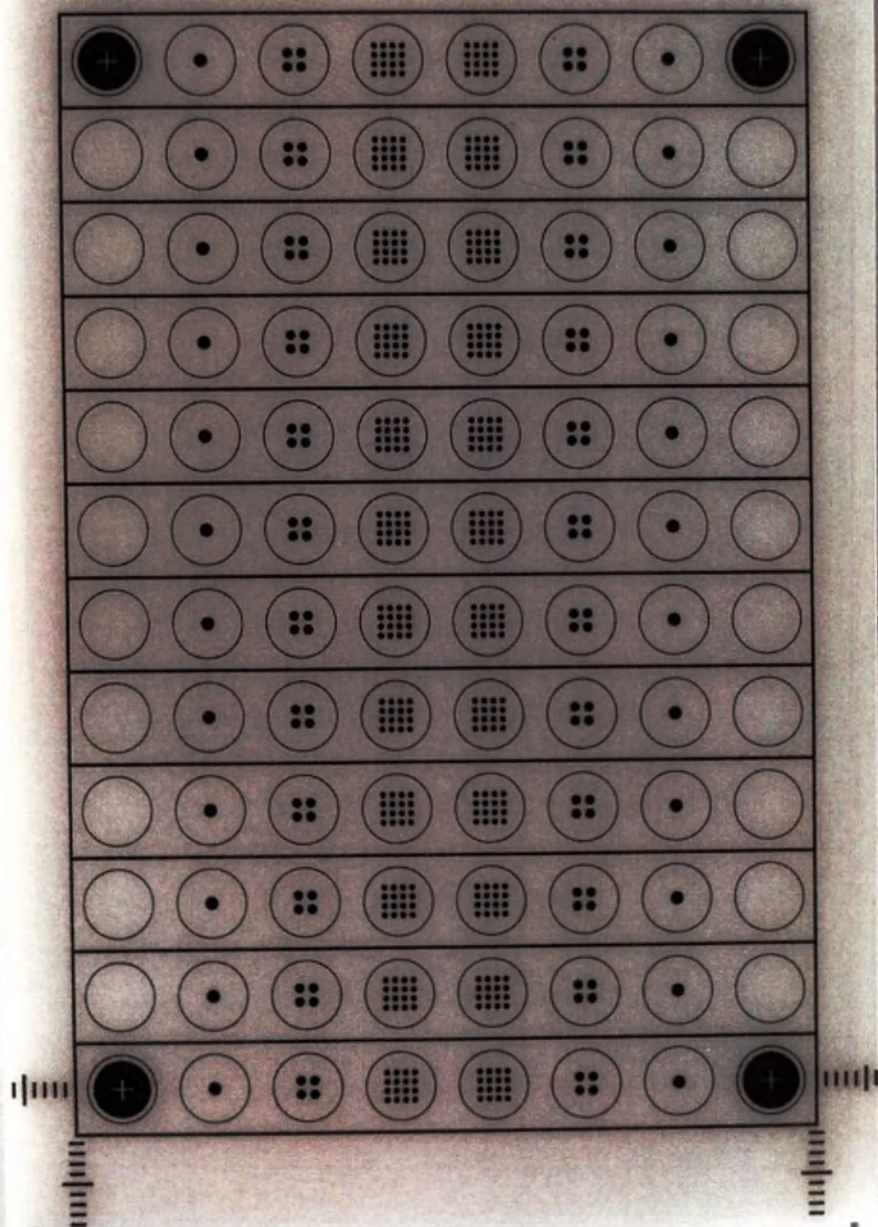

Планшет калибровочный матовый

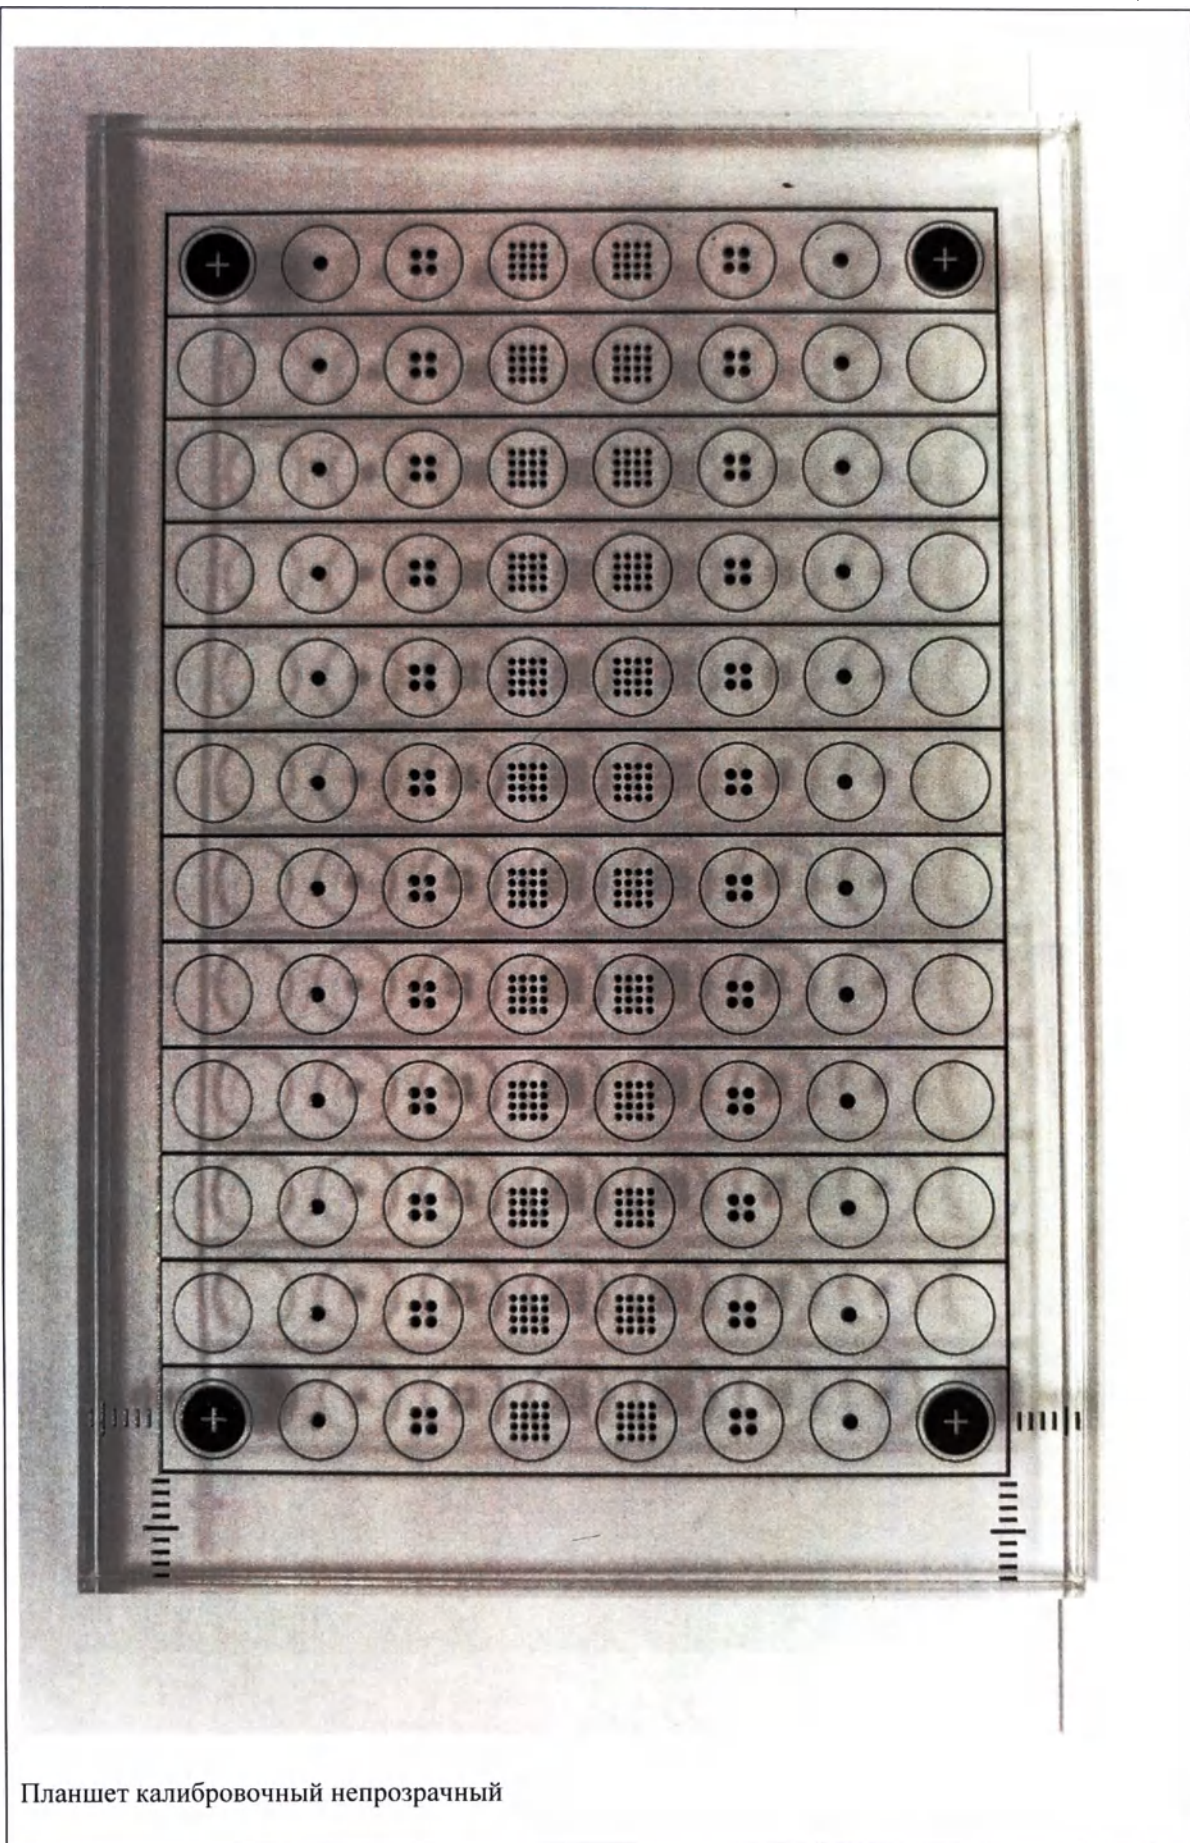

Планшет калибровочный непрозрачный

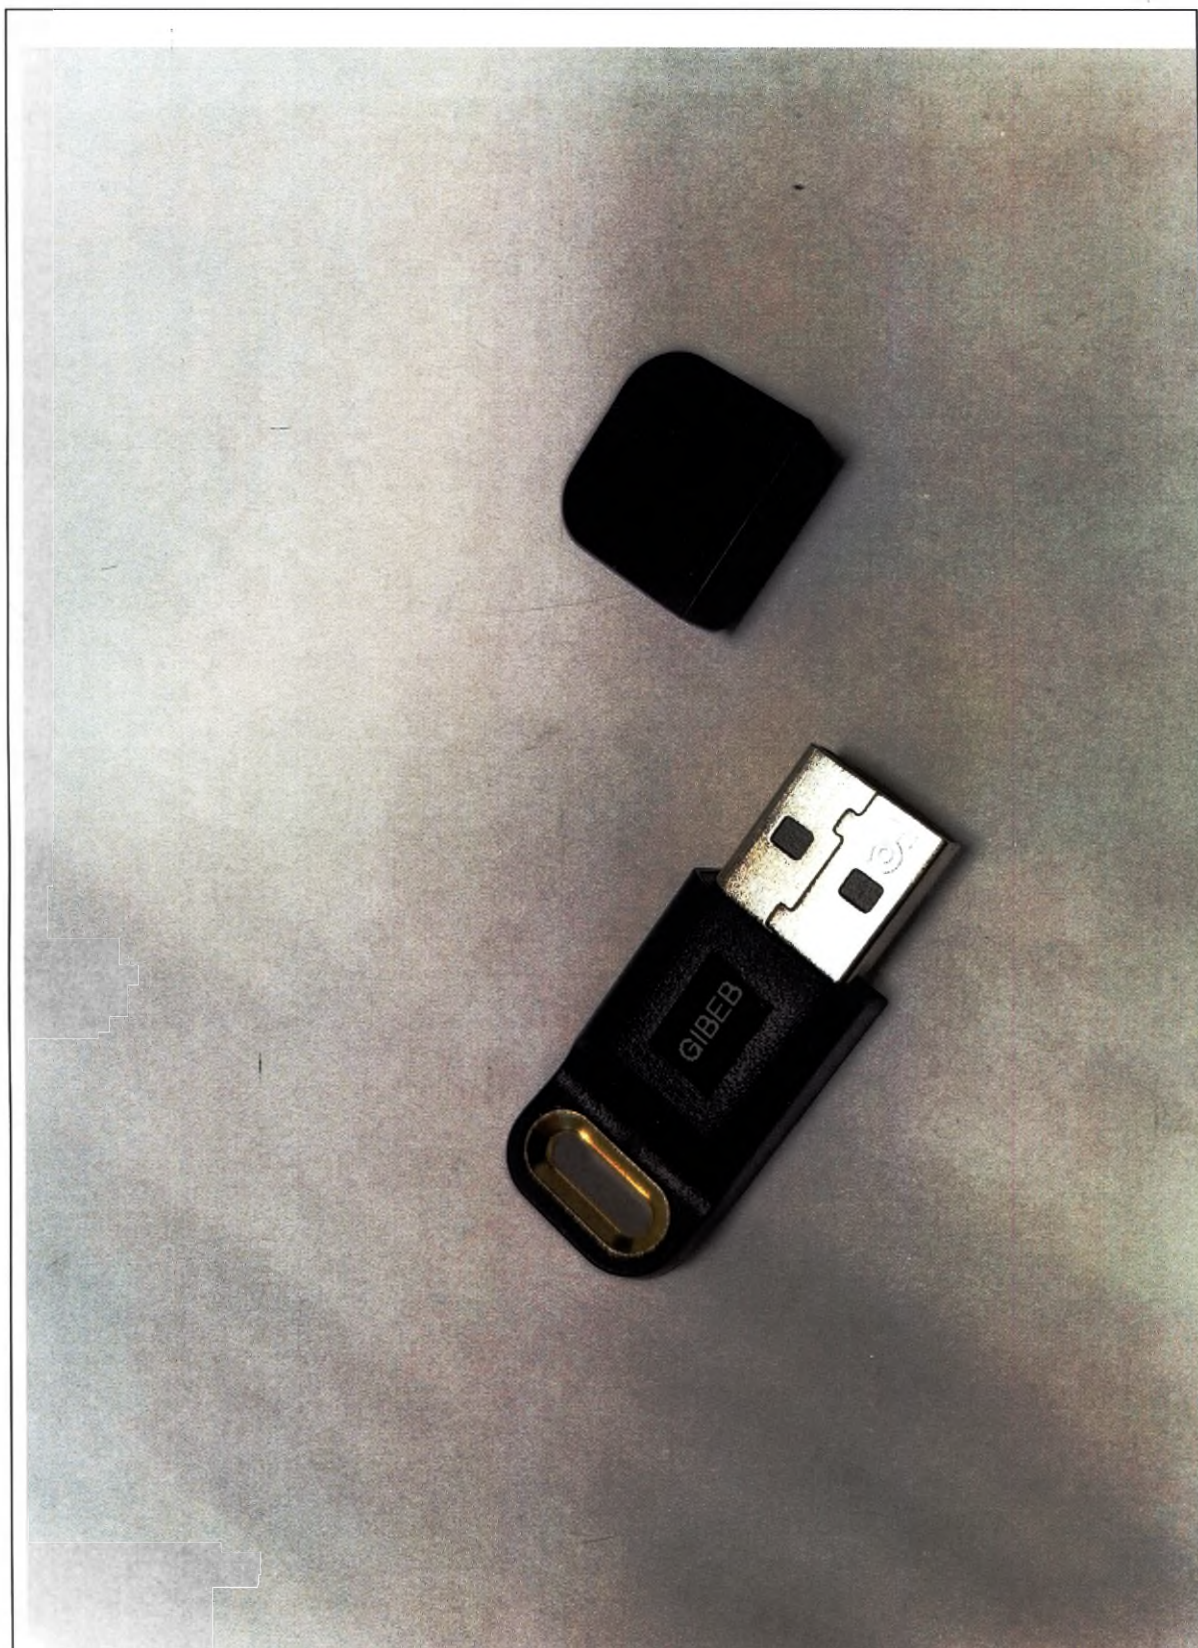

Ключ аппаратный на одну лицензию на ПО

scienion

sciREADER CL2

SN: CL2XI 121995

DATE: 05/2021

Power: AC 100-240 V
~50-60 Hz
50 VA

Fuse: 2x T, 2 A, 250 V

Case: IP31

Weight: 17 kg



CE




SCIENTION GmbH
Vollmerstr. 30
12489 Berlin
Germany

Маркировка медицинского изображения «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультиплексного анализа in vitro, модель CL2XI»



Маркировка медицинского изображения «Анализатор автоматический sciREADER CL2 для мультимплексного анализа in vitro, модель CL2XI»

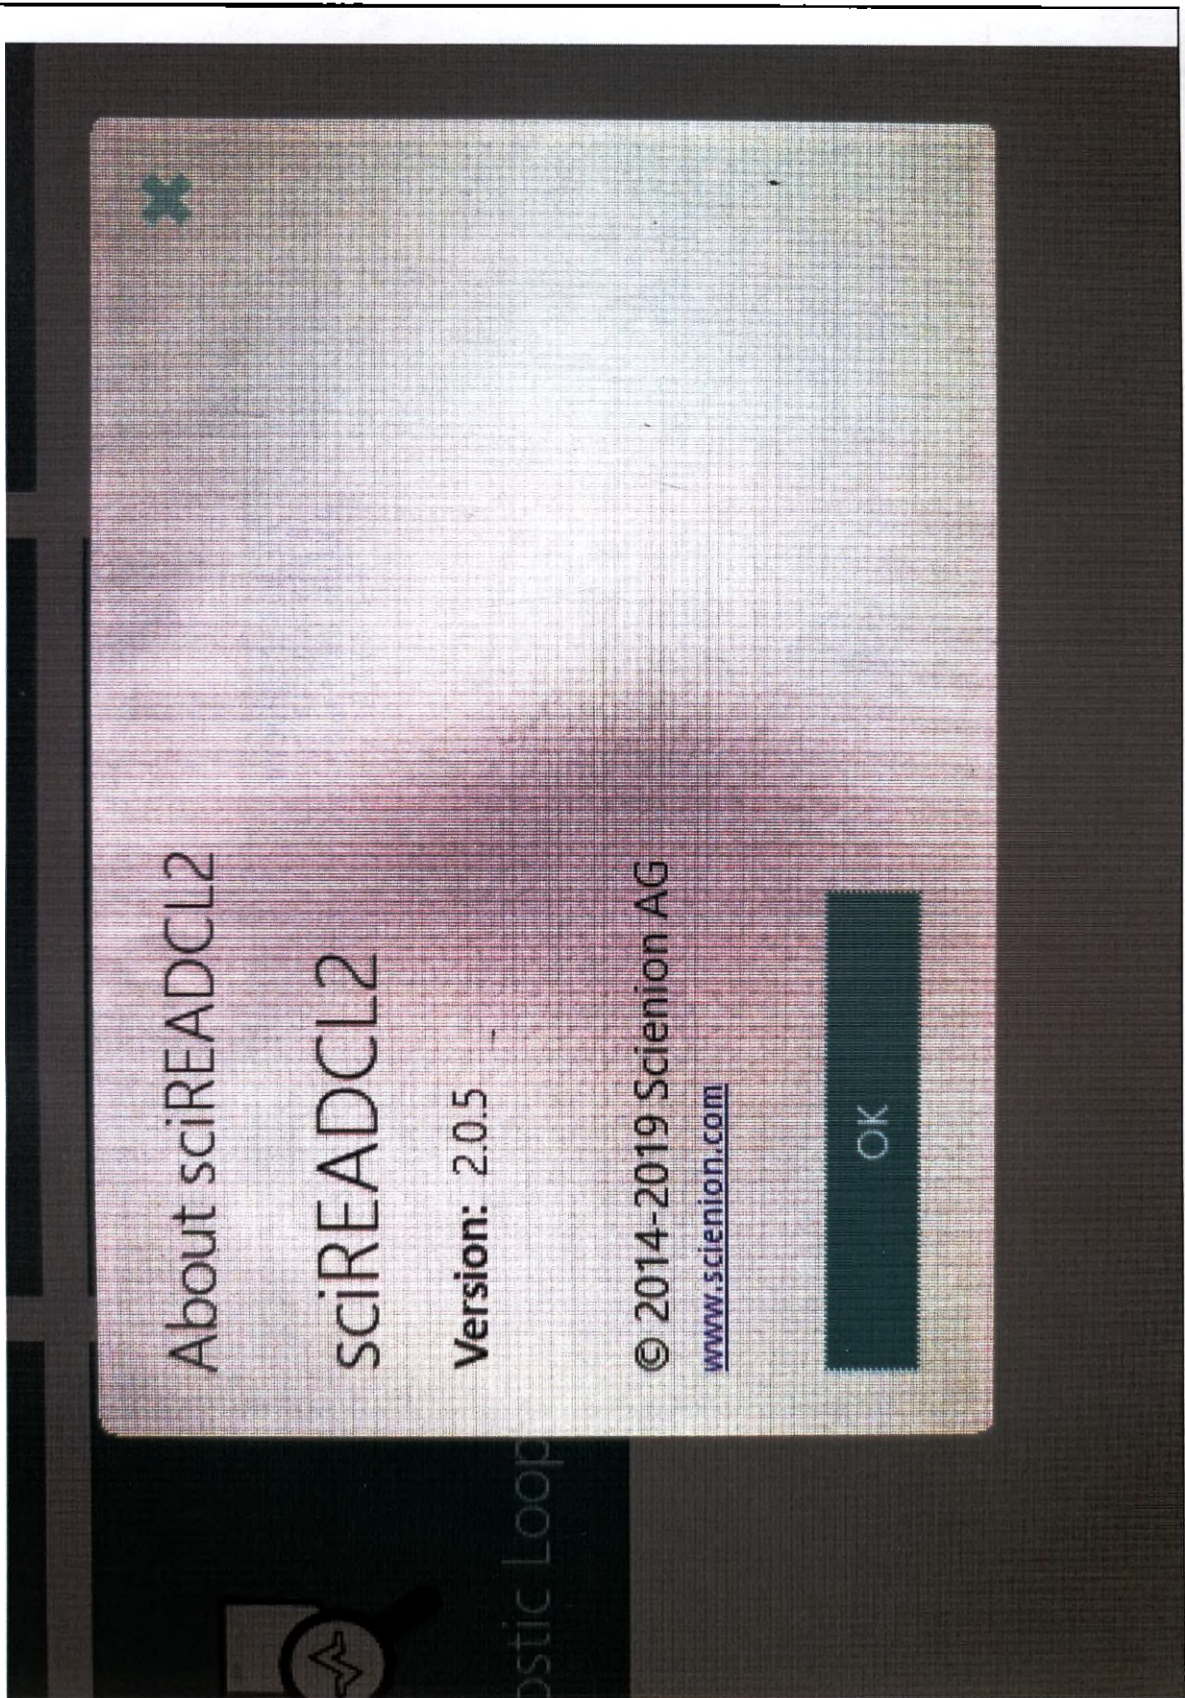

Версия программного обеспечения



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 16
(шестнадцать) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус» И.В. Федотов

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 638 от 25.10.2021
РУКОВОДИТЕЛЬНОМ
М В КУЛАС