



ООО «БиоЛайн»

197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Е


тел.: (812) 320-49-49, факс: (812) 320-49-40, e-mail: main@bioline.ru

ИНН 7813118690 / КПП 781301001 / ОГРН 1037804011453

Генеральный директор

ООО «БиоЛайн»

Семенов А.В.

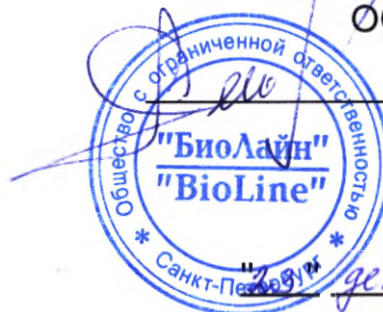

декабрь 2021г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Система ThermoBrite для денатурации и гибридизации на предметных стеклах (ThermoBrite Slide Denaturation/Hybridization System)

г. Москва, 2021


Оглавление

Система ThermoBrite для денатурации и гибридизации на предметных стеклах (ThermoBrite Slide Denaturation/Hybridization System) в составе:


1. Устройство ThermoBrite для денатурации и гибридизации на предметных стеклах (ThermoBrite Slide Denaturation/Hybridization System).....	3
2. Кабель сетевой (Line Cord)	4
3. Полоска контроля влажности (Humidity Card).....	5
4. Руководство пользователя (Operator's Manual).....	6



1. Устройство ThermoBrite для денатурации и гибридизации на предметных стеклах
(ThermoBrite Slide Denaturation/Hybridization System)

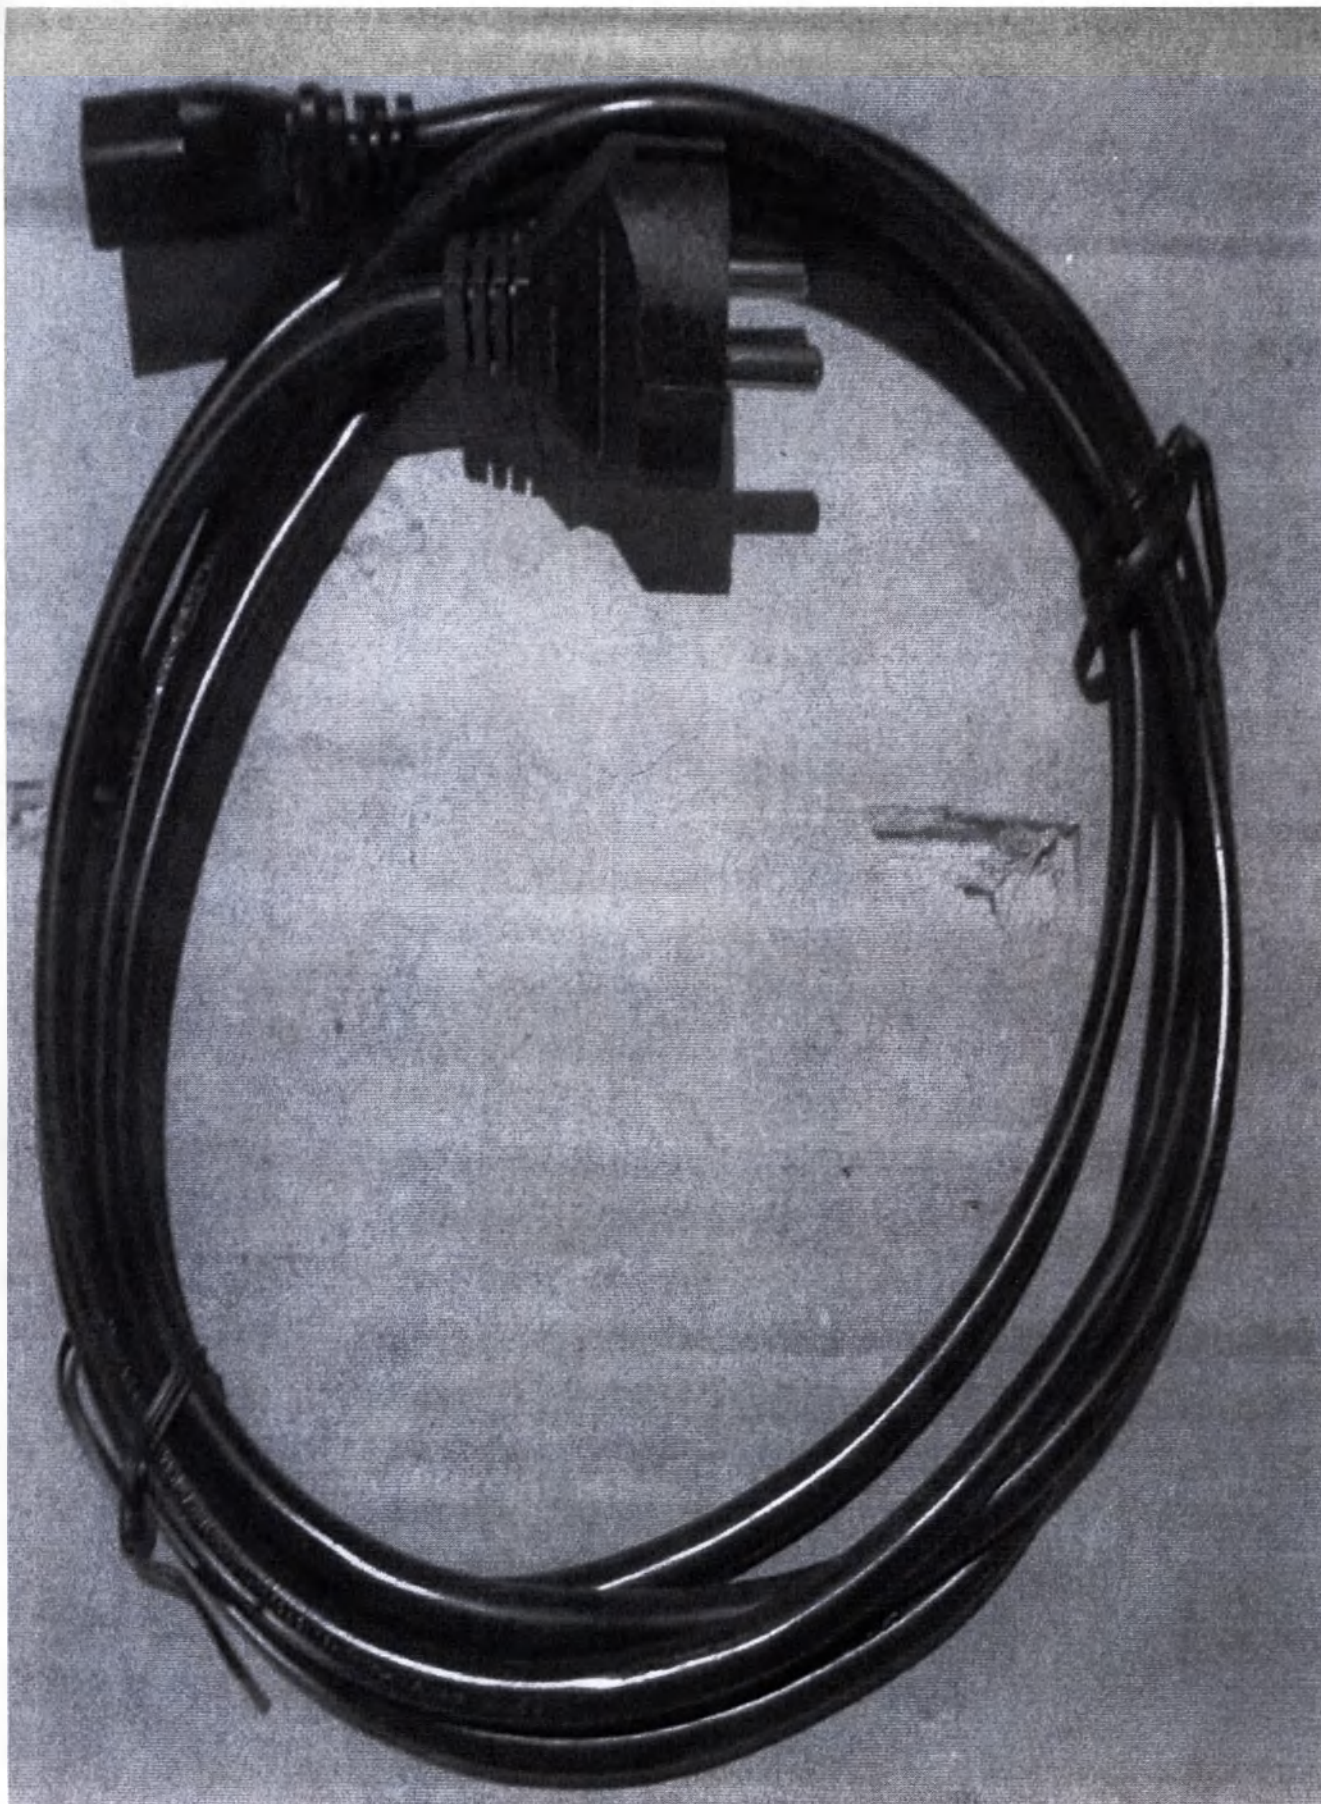

2. Кабель сетевой (Line Cord)

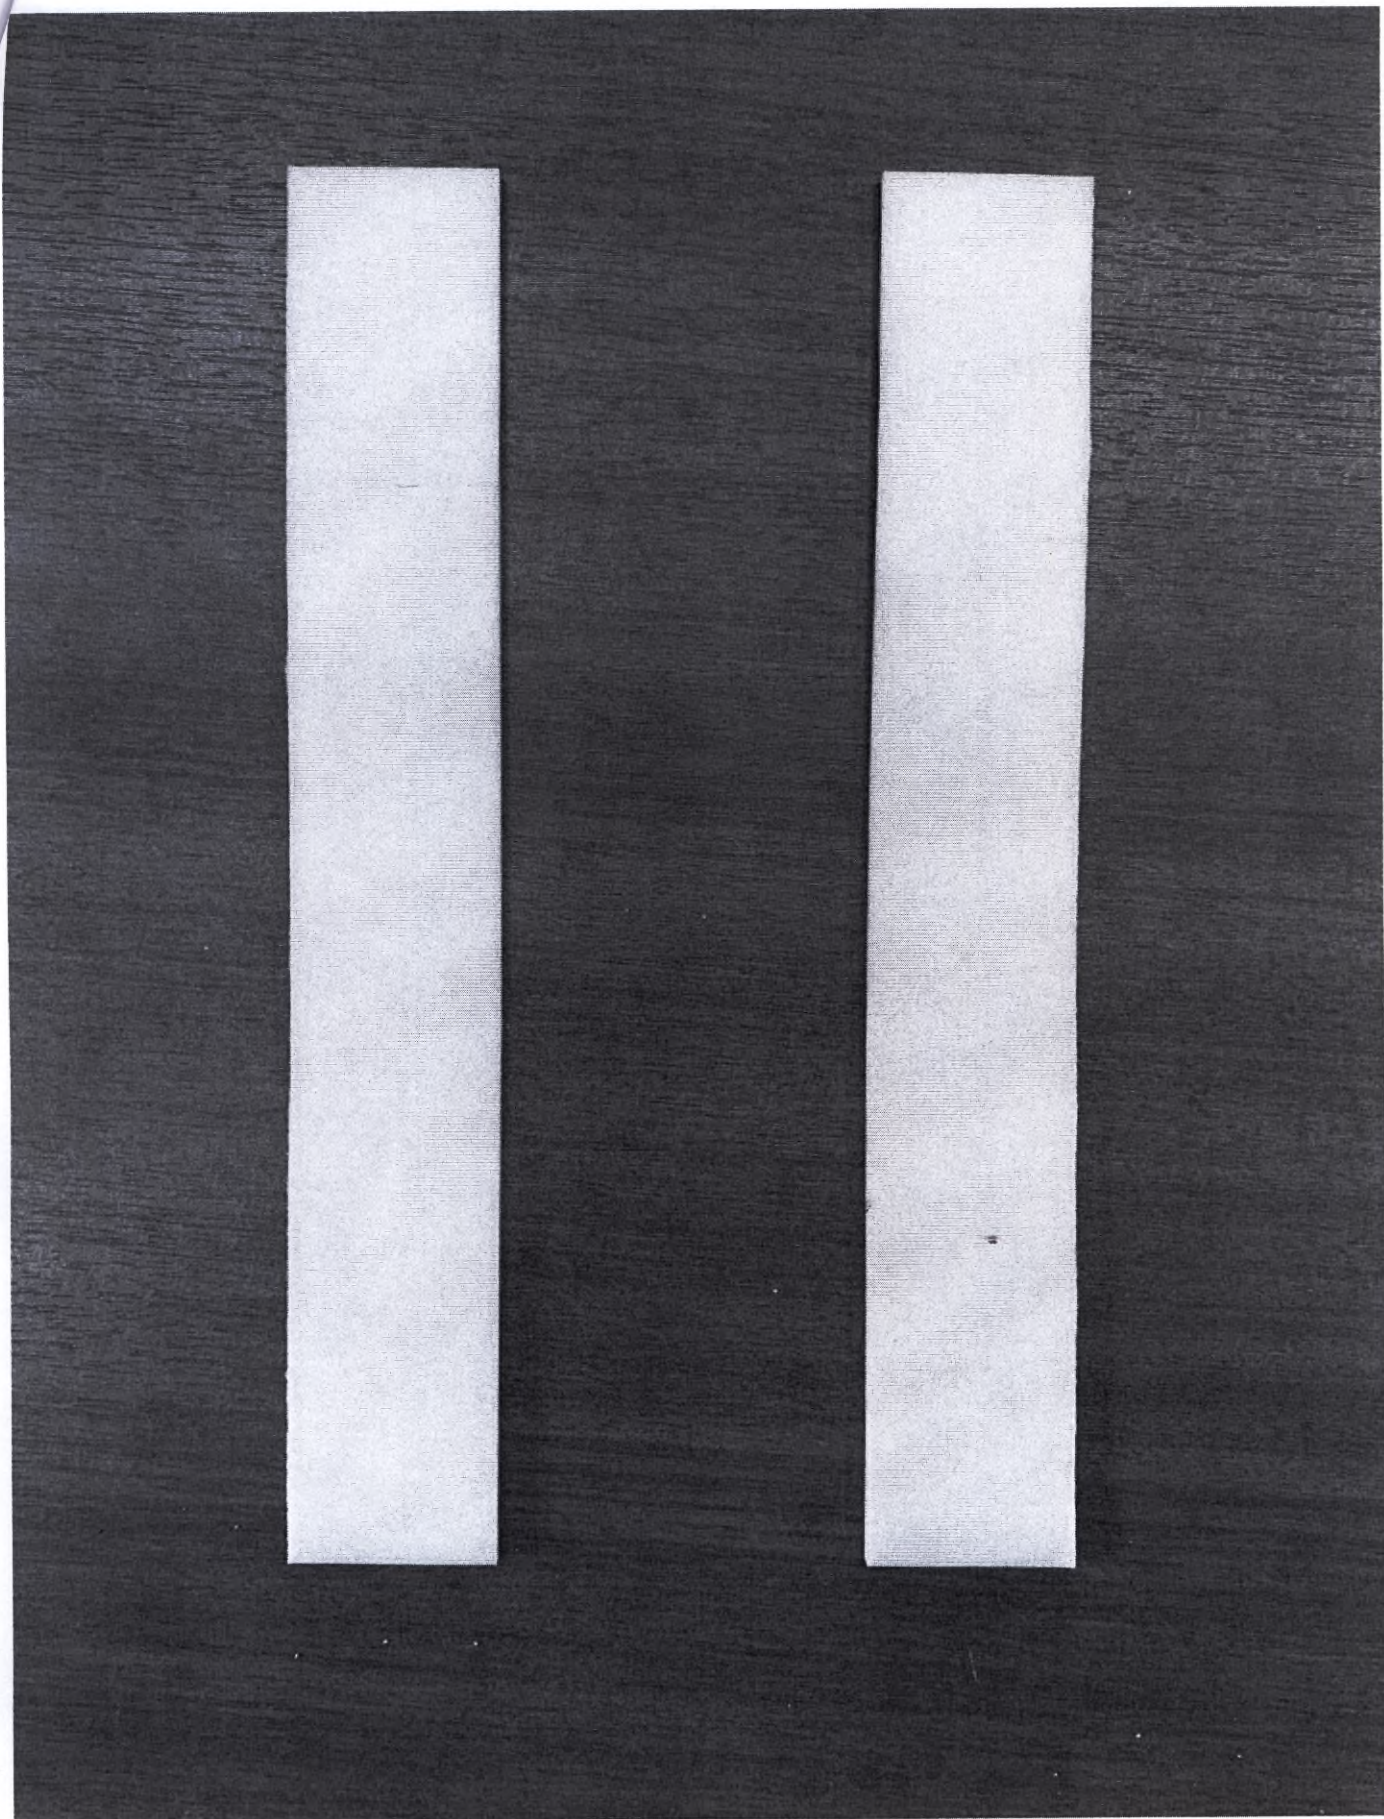


3. Полоска контроля влажности (Humidity Card)

Руководство пользователя предназначено только для пользователей Российской Федерации

ThermoBrite

Система для денатурации и гибридизации на предметных стеклах

Руководство пользователя

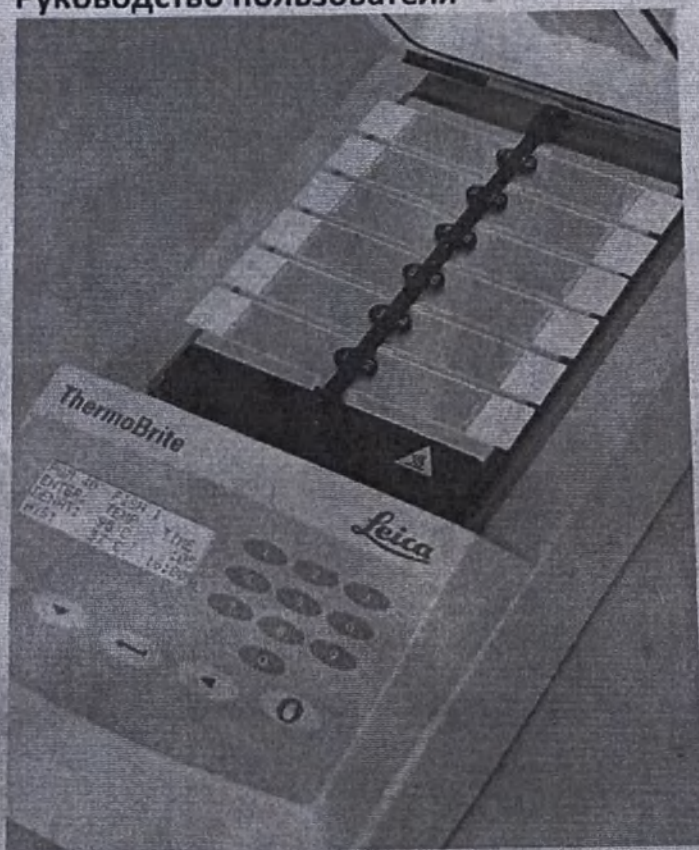

Leica
BIOSYSTEMS

Confidential - Company Proprietary

4. Руководство пользователя

пронумеровано 6 лист 8
Генеральный директор ООО «БиоЛайн»

Семенов А.В.

