

**Фотографические изображения
медицинского изделия in vitro:
Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
(«СРБ ТУРБИ-АБРИС +») по ТУ 9398-048-27428909-2010**

- Комплектация 1 (кат.№ 301.2.50) набор до вскрытия	стр. 2
- Комплектация 1 (кат.№ 301.2.50) после вскрытия упаковки	стр. 3
- Общий вид комплектации 1 (кат.№ 301.2.50)	стр. 4
- Комплектующие набора (кат.№ 301.2.50) крупным планом	стр. 5
- Комплектация 2 (кат.№ 301.2.100) набор до вскрытия	стр. 6
- Комплектация 2 (кат.№ 301.2.100) после вскрытия упаковки	стр. 7
- Общий вид комплектации 2 (кат.№ 301.2.100)	стр. 8
- Комплектующие набора (кат.№ 301.2.100) крупным планом	стр. 9
- Комплектация 3 (кат.№ 301.2.200) набор до вскрытия	стр. 10
- Комплектация 3 (кат.№ 301.2.200) после вскрытия упаковки	стр. 11
- Общий вид комплектации 3 (кат.№ 301.2.200)	стр. 12
- Комплектующие набора (кат.№ 301.2.200) крупным планом	стр. 13
- Информация на коробке	стр. 14,15

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
24.02.2022



Марковский В.М.









6



±









НПФ **АБРИС+** REF 301.2.200


СРБ ТУРБИ-АБРИС+
Набор реагентов для определения
концентрации С-реактивного белка в
сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Состав набора. Нормализация 5.

Реагент 1	2 x 80 мл
Реагент 2	2 x 20 мл
Калибратор	1 x 1 мл

ТУ 9398-048-27428909-2010
РУ № ФСР 2011/10406
от XX.XX.XXXX IVD

2°C
Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

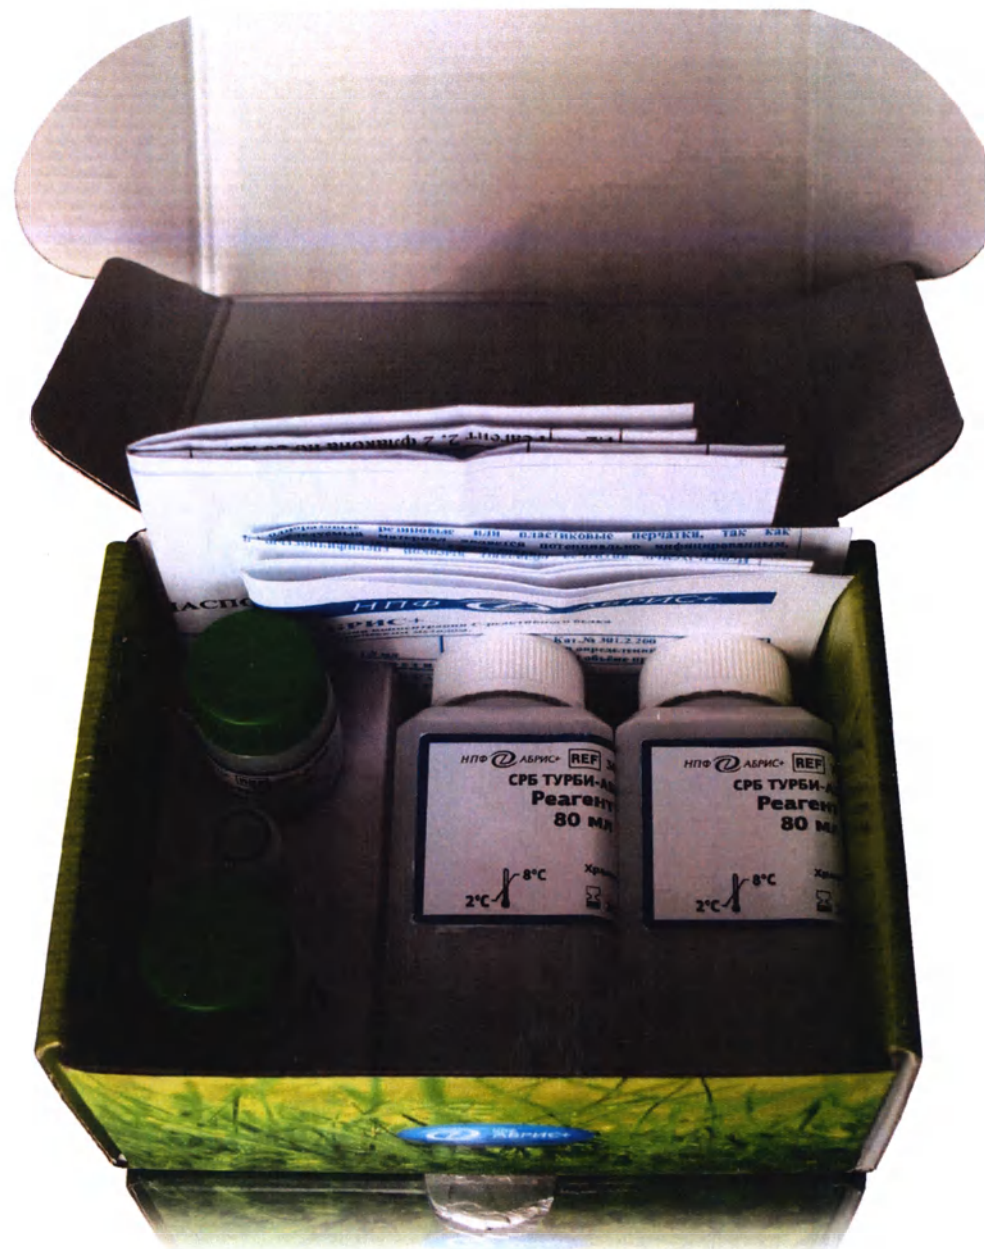





A green rectangular box with a textured surface featuring a pattern of tall grass. The box is positioned on a reddish-brown surface.

Сделано в России

ООО "НПФ "АБРИС+"

196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д.16, лит. М, 2-й этаж



Прошито и пронумеровано
17 лист 068
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский



Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в
сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
(«СРБ ТУРБИ-АБРИС +»)
по ТУ 9398-048-27428909-2010

- Комплектация 1 – лист 2,
- Комплектация 2 – лист 3,
- Комплектация 3- лист 4,

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС +»
24.02.2022



Марковский В.М.

Комплектация 1 (кат № 301.2.50)

НПФ АБРИС+ REF 301.2.50

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Состав набора. Комплектация 1.

Реагент 1	2 x 20 мл
Реагент 2	2 x 5 мл
Калибратор	1 x 1 мл

ТУ 9398-048-27428909-2010
ПУ № ФСР 2011/10406
от XX.XX.XXXX IVD

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу Гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT 004 2021-12 2022-12

С-реактивный белок, иммунотурбидиметрический метод

НПФ АБРИС+ REF 301.2.50

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Калибратор, 48 мг/л

1 мл

LOT 004

2°C 8°C 2022-12

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу Гепатита С и HBsAg отсутствуют

НПФ АБРИС+ REF 301.2.50

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Реагент 2

Перед использованием перемешать
Хранить в тёмном месте

5 мл

LOT 004

2°C 8°C 2022-12 IVD

НПФ АБРИС+ REF 301.2.50

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Реагент 1

20 мл

LOT 004

Хранить в тёмном месте!

2°C 8°C 2022-12 IVD

Комплектация 2 (кат № 301.2.100)

НПФ **АБРИС+** REF 301.2.100

СРБ ТУРБИ-АБРИС+
С-реактивный белок,
иммунотурбидиметрический метод

СРБ ТУРБИ-АБРИС+
Набор реагентов для определения
концентрации С-реактивного белка в
сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Состав набора. Комплектация 2.

Реагент 1	2 x 40 мл
Реагент 2	2 x 10 мл
Калибратор	1 x 1 мл

ТУ 9398-048-27428909-2010
РУ № ФСР 2011/10406
от XX.XX.XXXX IVD

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу Гепатита С и HBsAg отсутствуют

НПФ **АБРИС+** REF 301.2.100

СРБ ТУРБИ-АБРИС+
Калибратор, 48 мг/л
1 мл

LOT 004
8°C
2022-12 IVD

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу Гепатита С и HBsAg отсутствуют

НПФ **АБРИС+** REF 301.2.100

СРБ ТУРБИ-АБРИС+
Реагент 2
Перед использованием перемешать
Хранить в тёмном месте
10 мл

LOT 004
8°C
2022-12 IVD

НПФ **АБРИС+** REF 301.2.100

СРБ ТУРБИ-АБРИС+
Реагент 1
40 мл

LOT 004

8°C
2022-12 IVD

Хранить в тёмном месте!

Комплектация 3 (кат № 301.2.200)

НПФ АБРИС+ REF 301.2.200

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Состав набора. Комплектация 3.

Реагент 1	2 x 80 мл
Реагент 2	2 x 20 мл
Калибратор	1 x 1 мл



8°C
2°C

ТУ 9398-048-27428909-2010
 РУ № ФСР 2011/10406
 от XX.XX.XXXX IVD

Для профессионального применения
 Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу Гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT 004
 С-реактивный белок,
 иммунотурбидиметрический метод
 2021-12
 2022-12

НПФ АБРИС+ REF 301.2.200

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Реагент 1

80 мл

LOT 004


8°C
2°C

Хранить в тёмном месте!

2022-12 IVD

НПФ АБРИС+ REF 301.2.200

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Реагент 2

20 мл

Перед использованием перемешать

LOT 004


8°C
2°C

Хранить в тёмном месте!

2022-12 IVD

НПФ АБРИС+ REF 301.2.200

СРБ ТУРБИ-АБРИС+

Калибратор, 48 мг/л

1 мл

LOT 004



8°C
2°C

2022-12 IVD

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу Гепатита С и HBsAg отсутствуют

Прошито и пронумеровано

4 (четыре)

лист

а

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

