

Фотографические изображения общего вида
Набор калибраторов «Alinity m HBV Cal Kit» для количественного определения ДНК вируса
гепатита В методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m


2021г.

В состав наборов входят следующие компоненты:

Набор пробирок с калибратором А (Калиб. А)



Набор пробирок с калибратором В (Калиб. В)

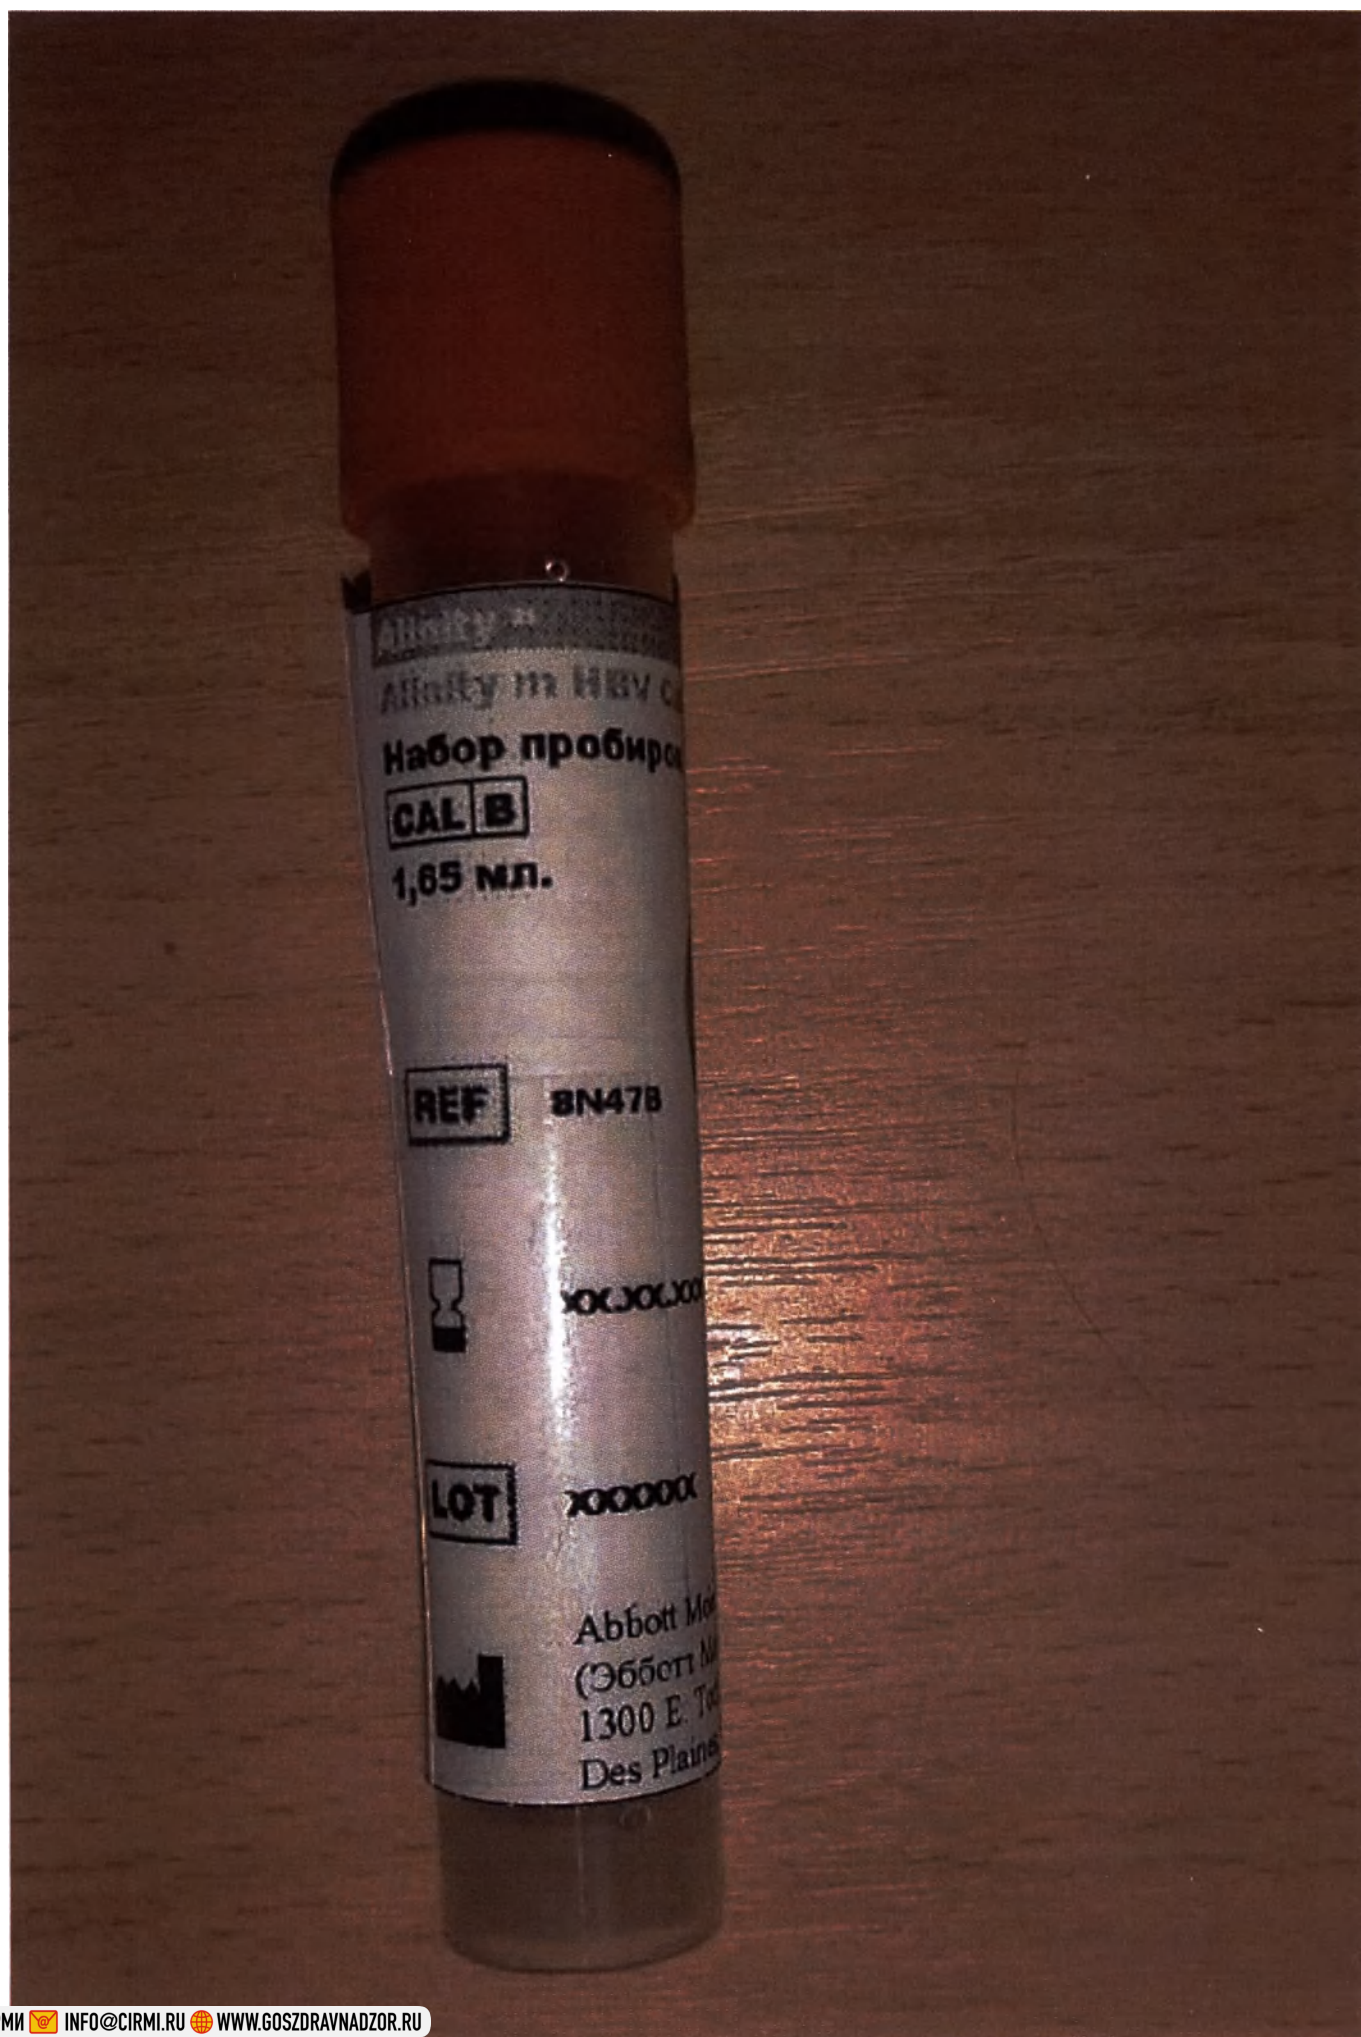

Alinity m

HBV CAL Kit

Редакция: апрель 2019 г.

Примечание: См. выделенные изменения

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА: ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ АВВОТТ

Необходимо точно следовать данной инструкции по применению. При отклонении от инструкции по применению надежность результатов теста не гарантируется.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В случае возникновения серьезных инцидентов при использовании данного изделия необходимо сообщить об этом изготовителю и в соответствующую полномочную организацию государства, на территории которого зарегистрирован пользователь и/или пациент. Контактную информацию для направления сообщений изготовителю см. в разделе "Техническая поддержка" данной инструкции по применению.

НАИМЕНОВАНИЕ

Набор калибраторов Alinity m HBV CAL Kit

НАЗНАЧЕНИЕ

Калибраторы Alinity m HBV предназначены для калибровки теста Alinity m HBV на автоматическом анализаторе Alinity m System при использовании для количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV). Калибраторы предназначены для использования с тестом Alinity m HBV. Дополнительную информацию см. в инструкции по применению к тесту.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Тест Alinity m HBV предназначен для использования лаборантами

Набор калибраторов «Alinity m HBV Cal Kit» общий вид



Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»



Е.Р. Коничева

Handwritten signature in blue ink

Сшито и заверено печатью 6
(мск) лист 06

Руководитель подразделения молекулярной диагностики
по России ООО Эбботт Лэбораториз
Коничева Е.Р.