

«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации

ООО «Био-Рад Лаборатории»

Специалист по регистрации Рябчук Е.В.

«29» июня 2022 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия


**Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls»
для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в
сыворотке, плазме или цельной крови человека, производства "Био-
Рад"/Bio-Rad, Франция**

V 2.0

1. Контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия
2. антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (общий вид)




Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка картонной коробки)

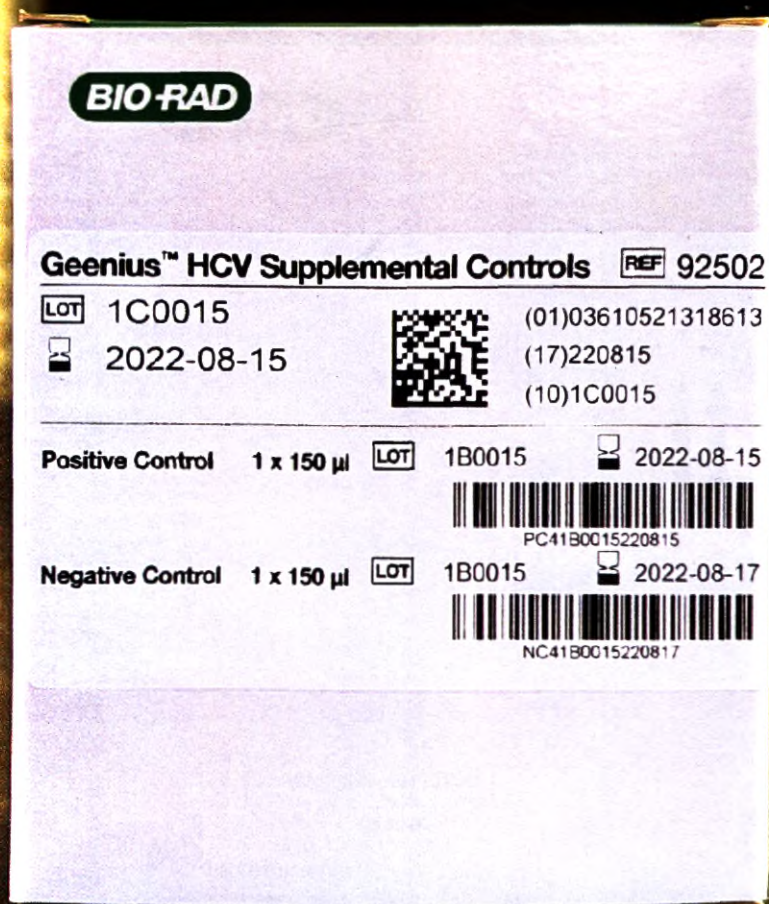

Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка картонной коробки)



Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка картонной коробки)

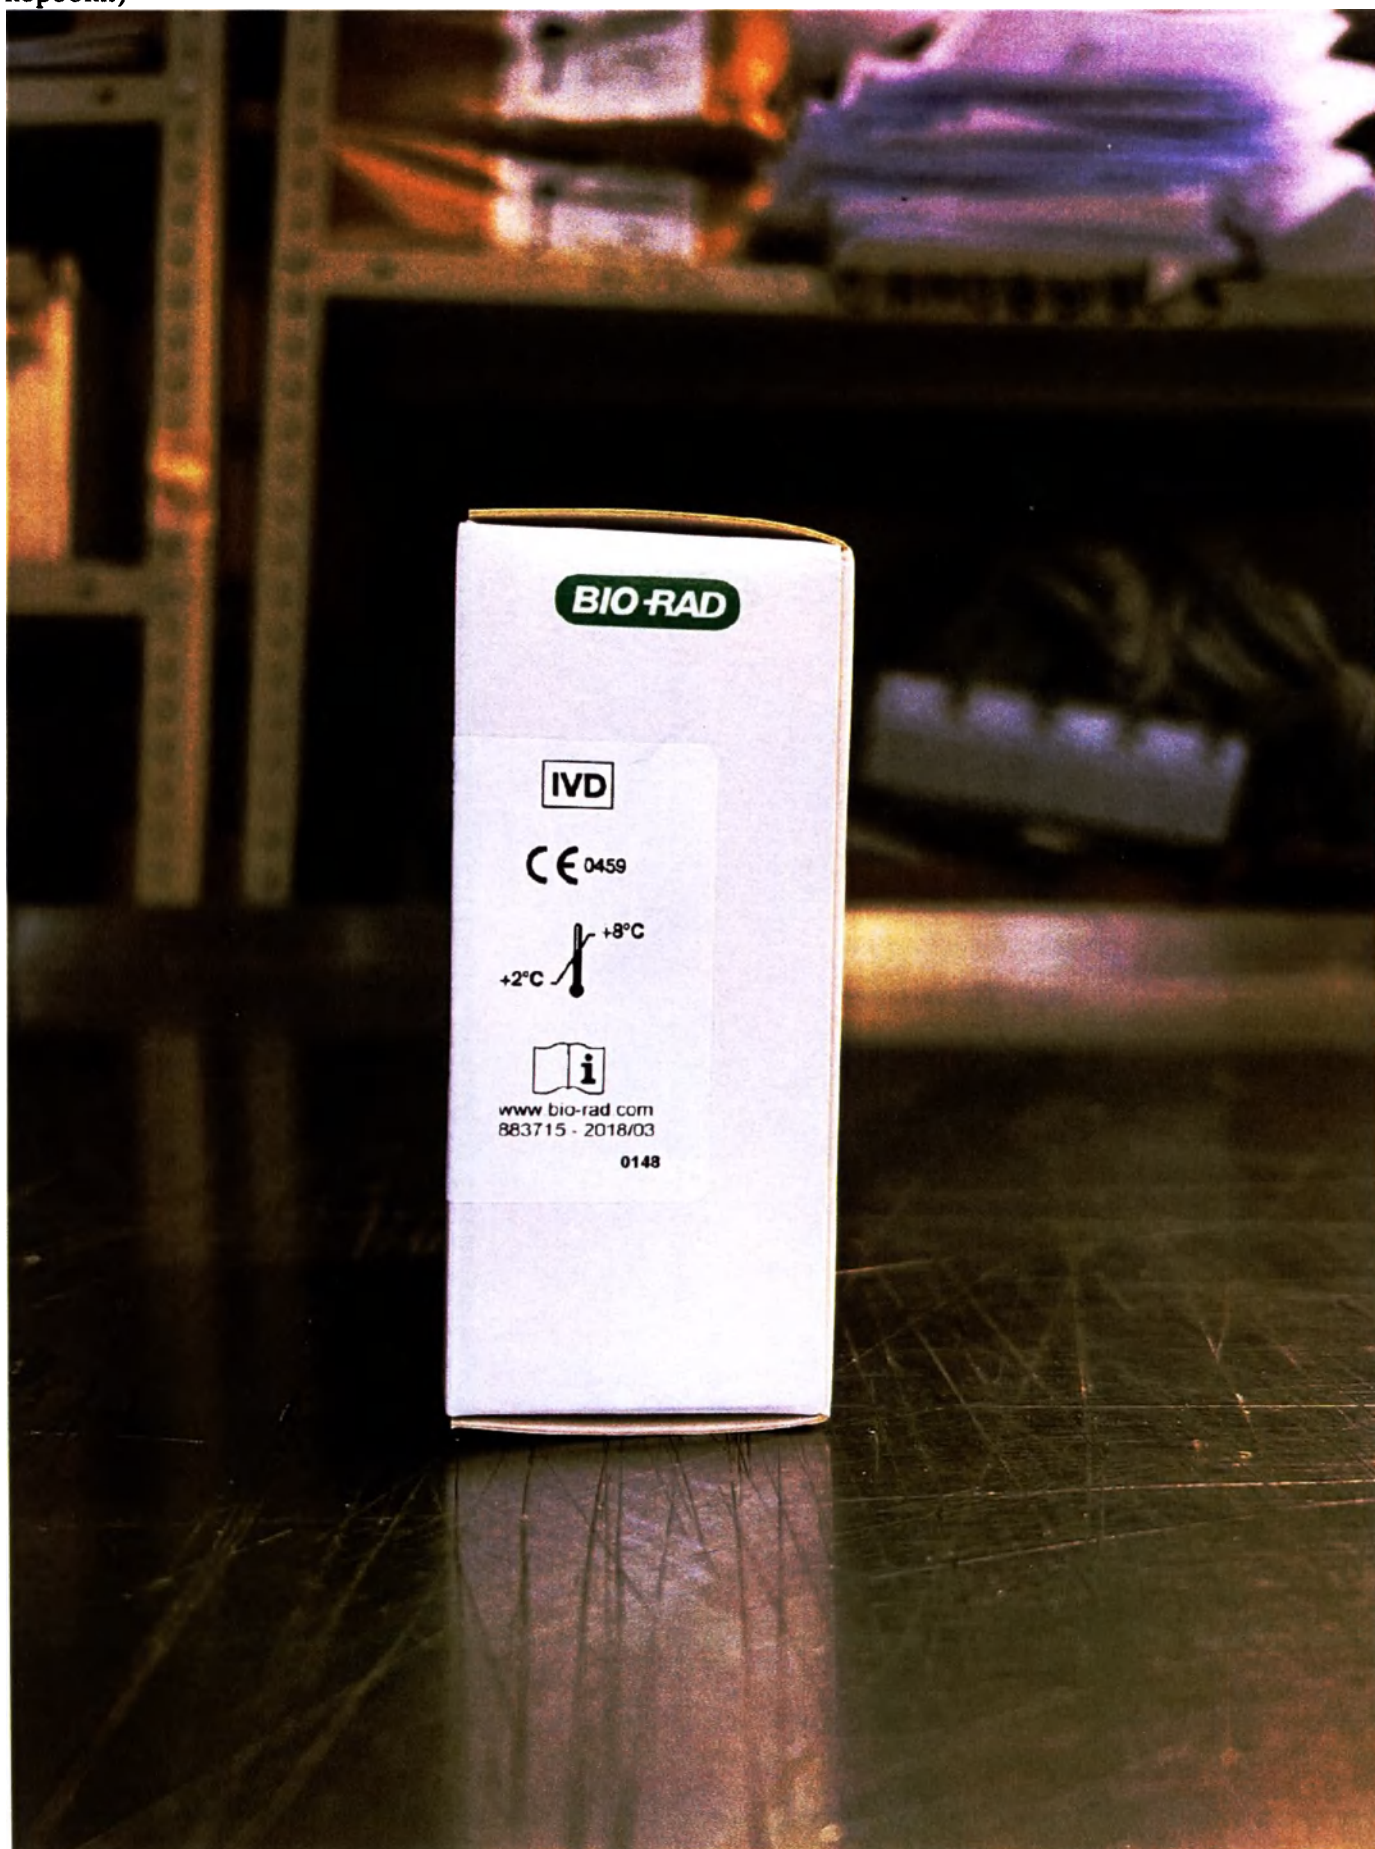

Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка картонной коробки)



Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка картонной коробки)




Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Положительного контрольного образца (Positive Control))




Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Положительного контрольного образца (Positive Control))



Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Положительного контрольного образца (Positive Control))

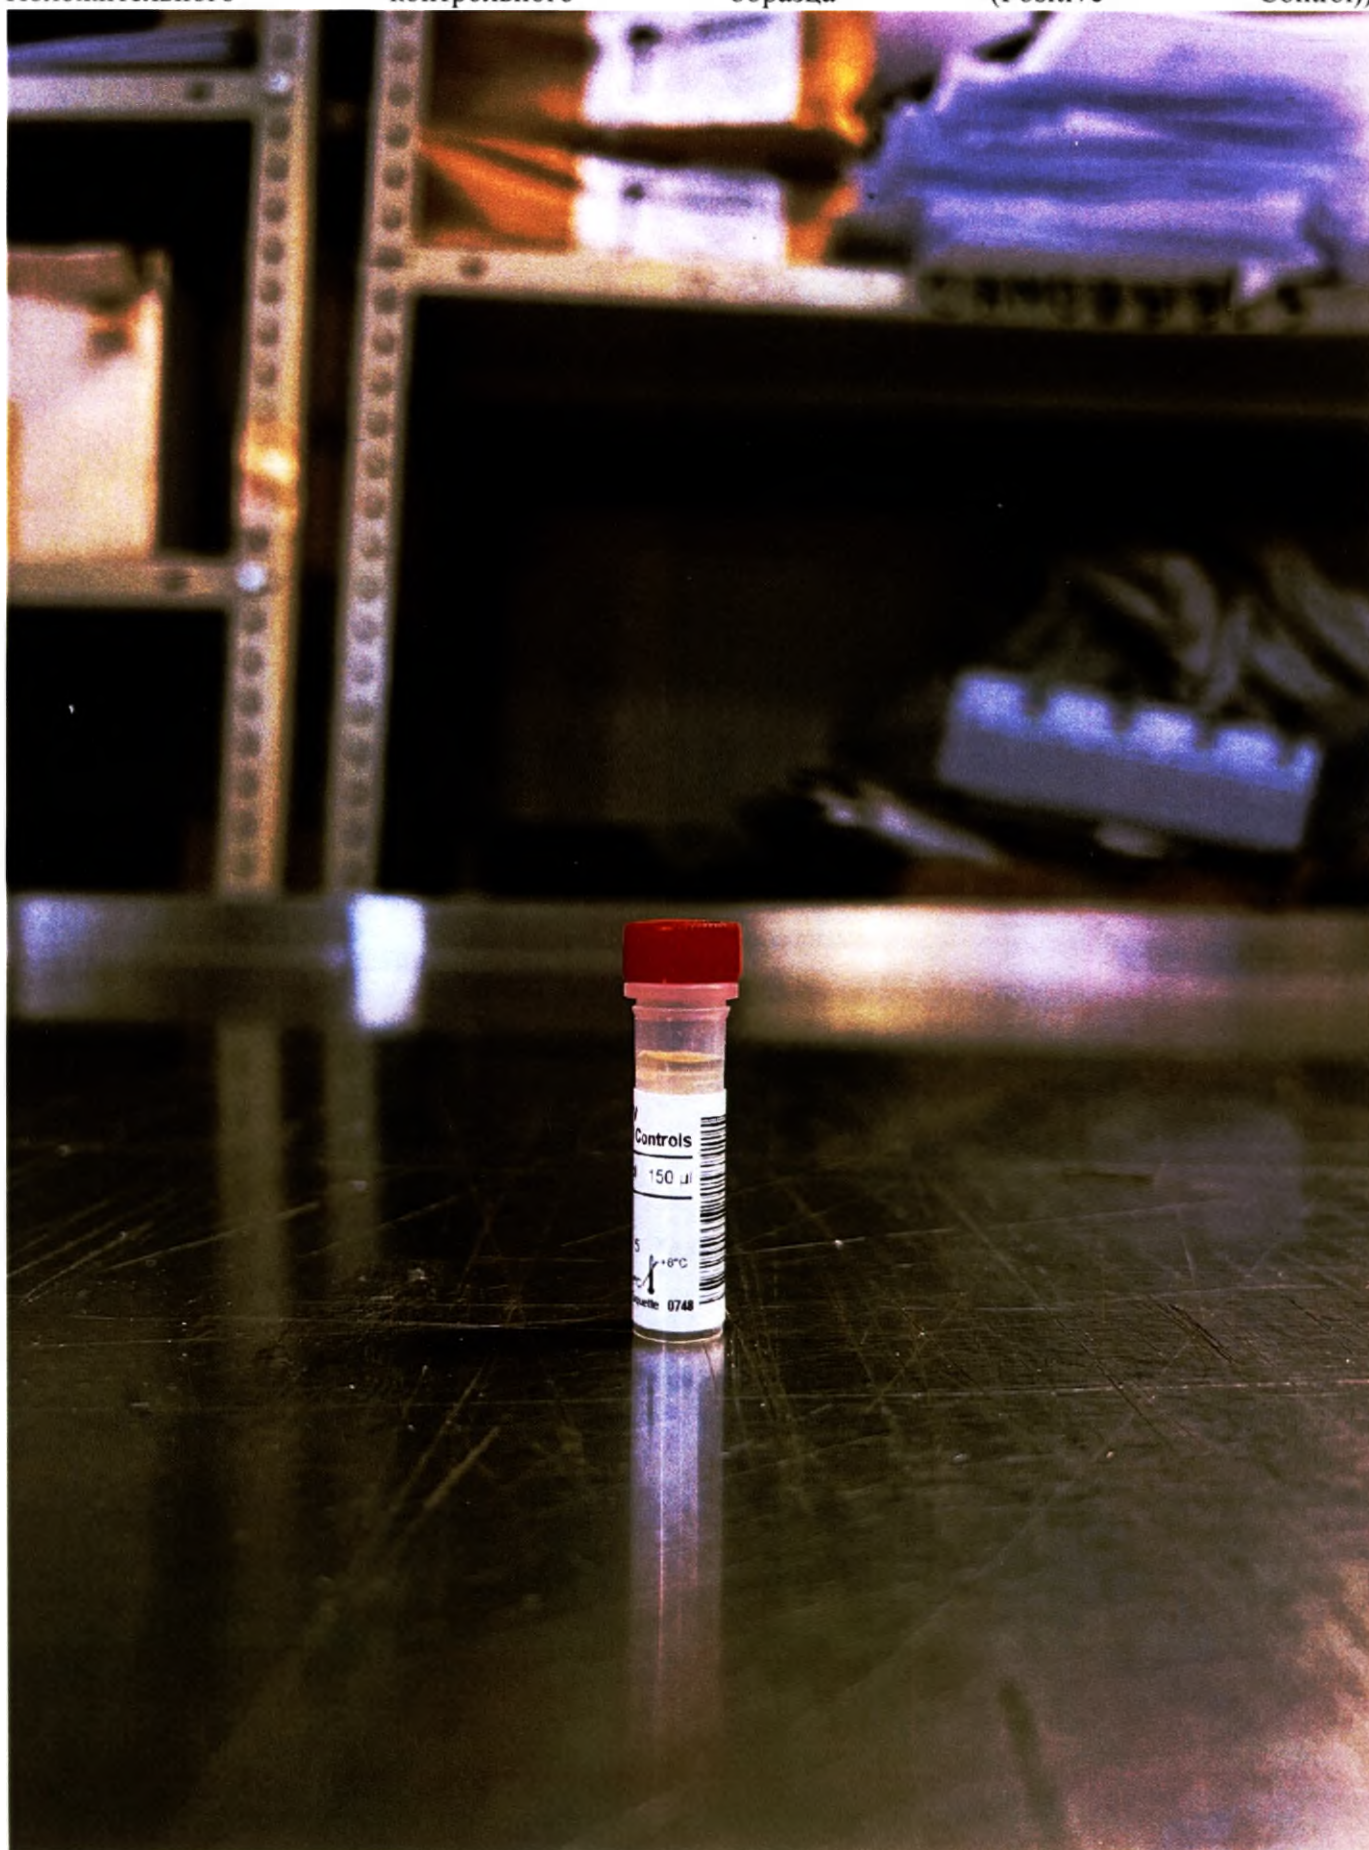


Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Положительного контрольного образца (Positive Control))

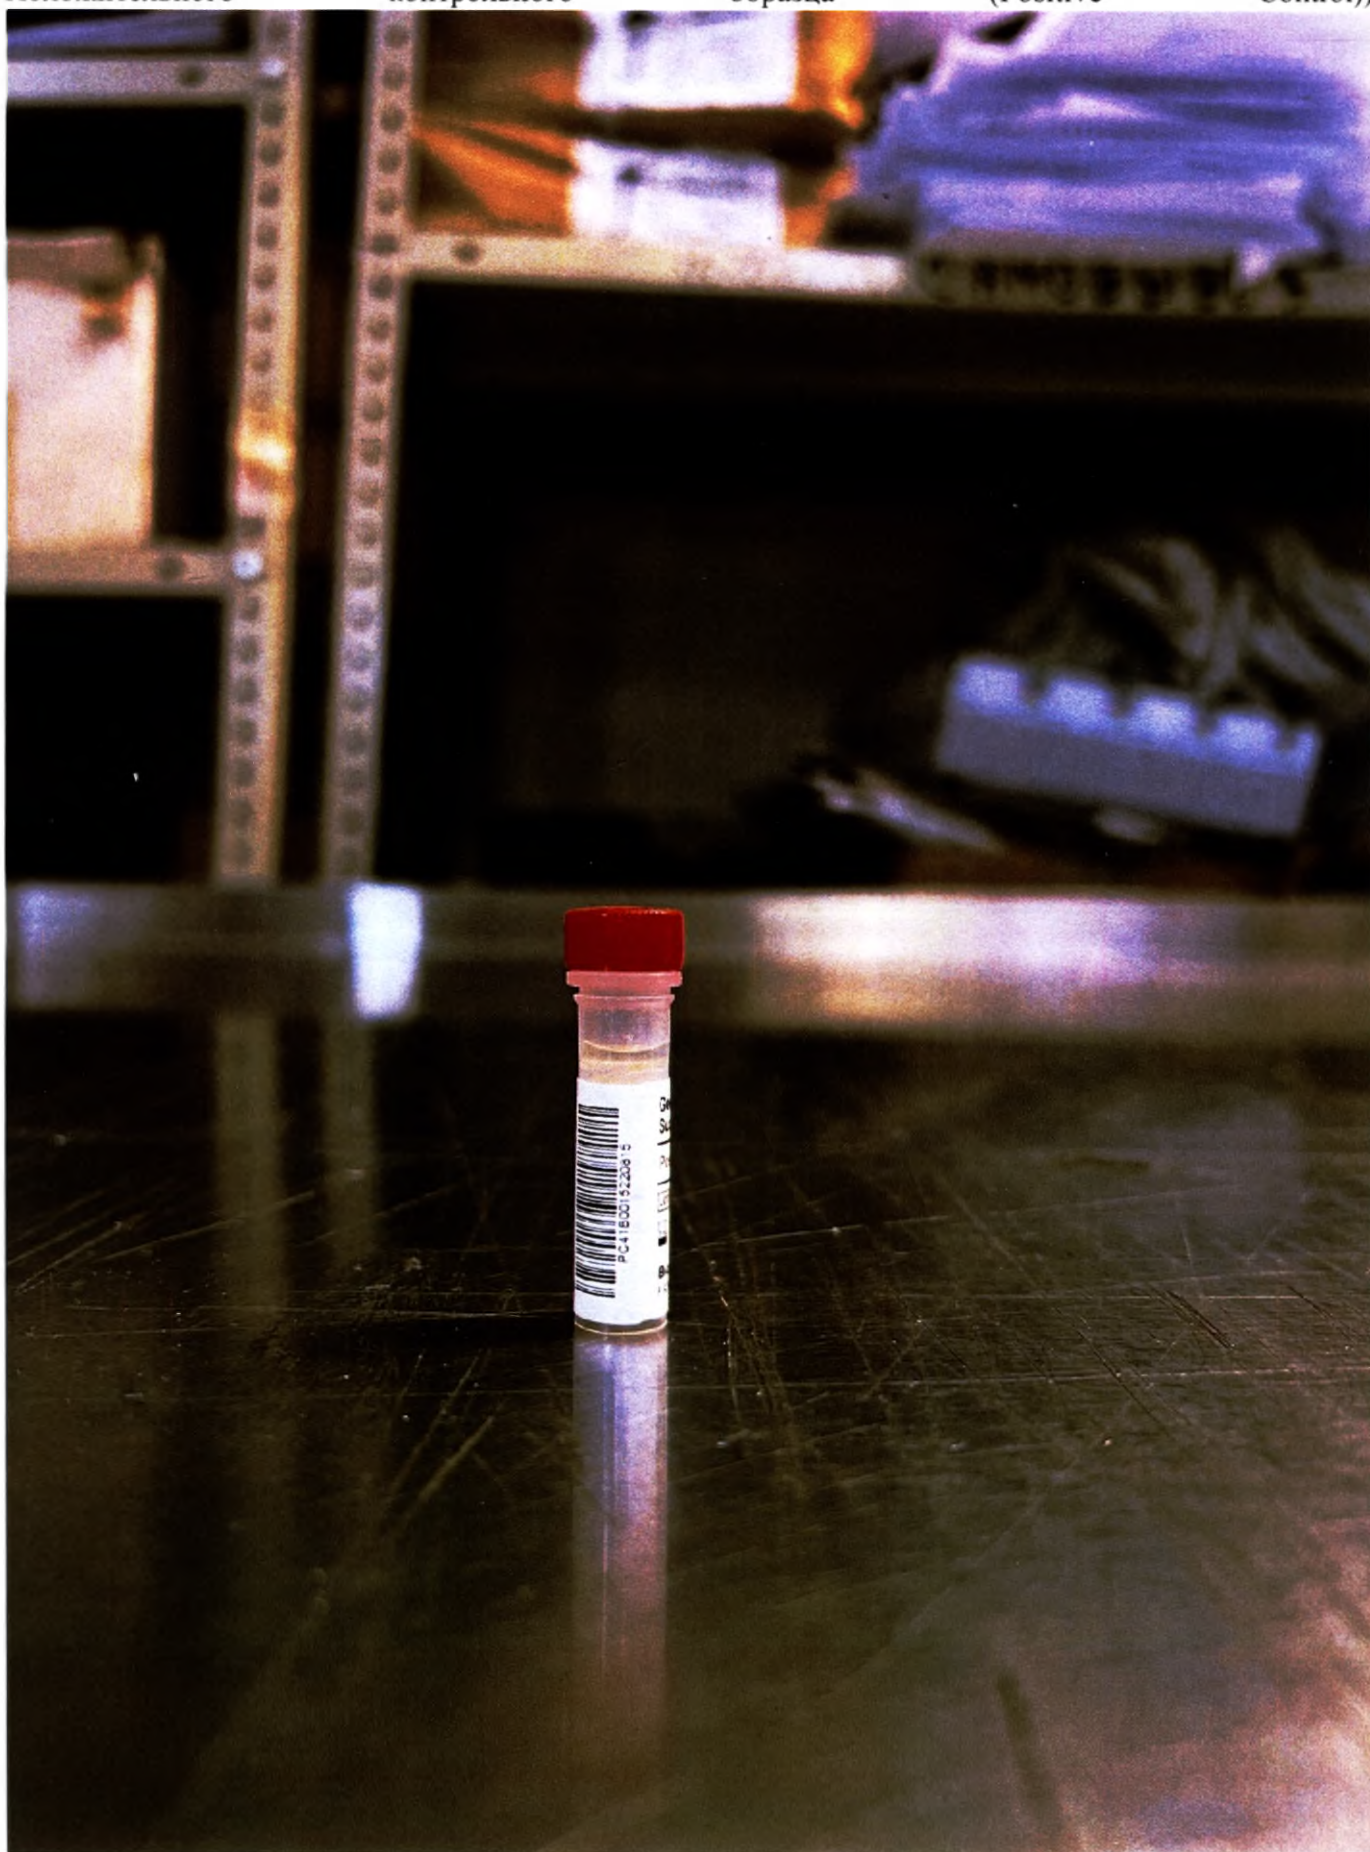

Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Отрицательного контрольного образца (Negative Control))




Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Отрицательного контрольного образца (Negative Control))

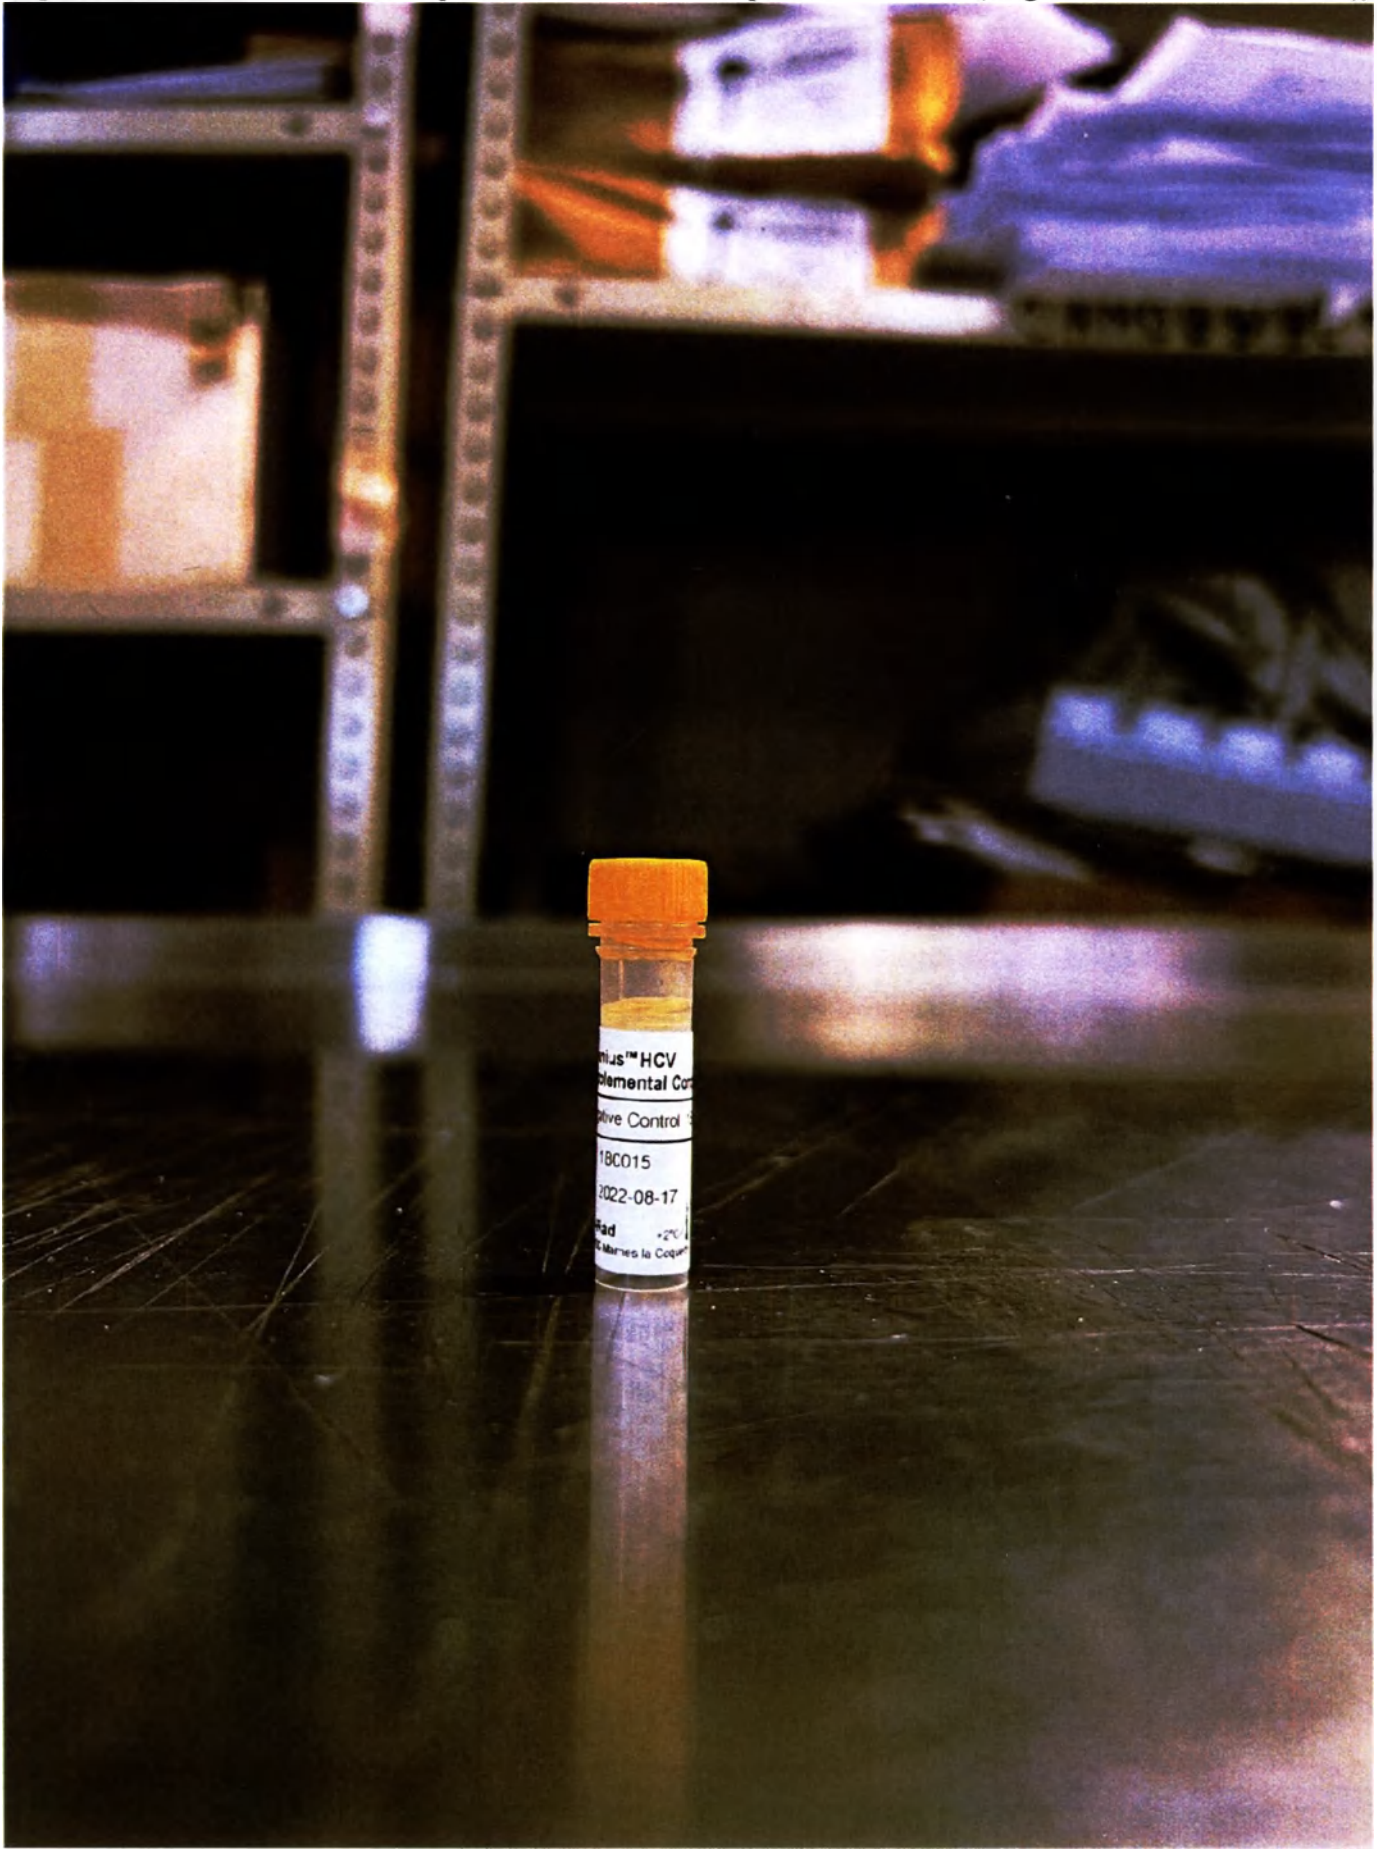


Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Отрицательного контрольного образца (Negative Control))



Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Отрицательного контрольного образца (Negative Control))

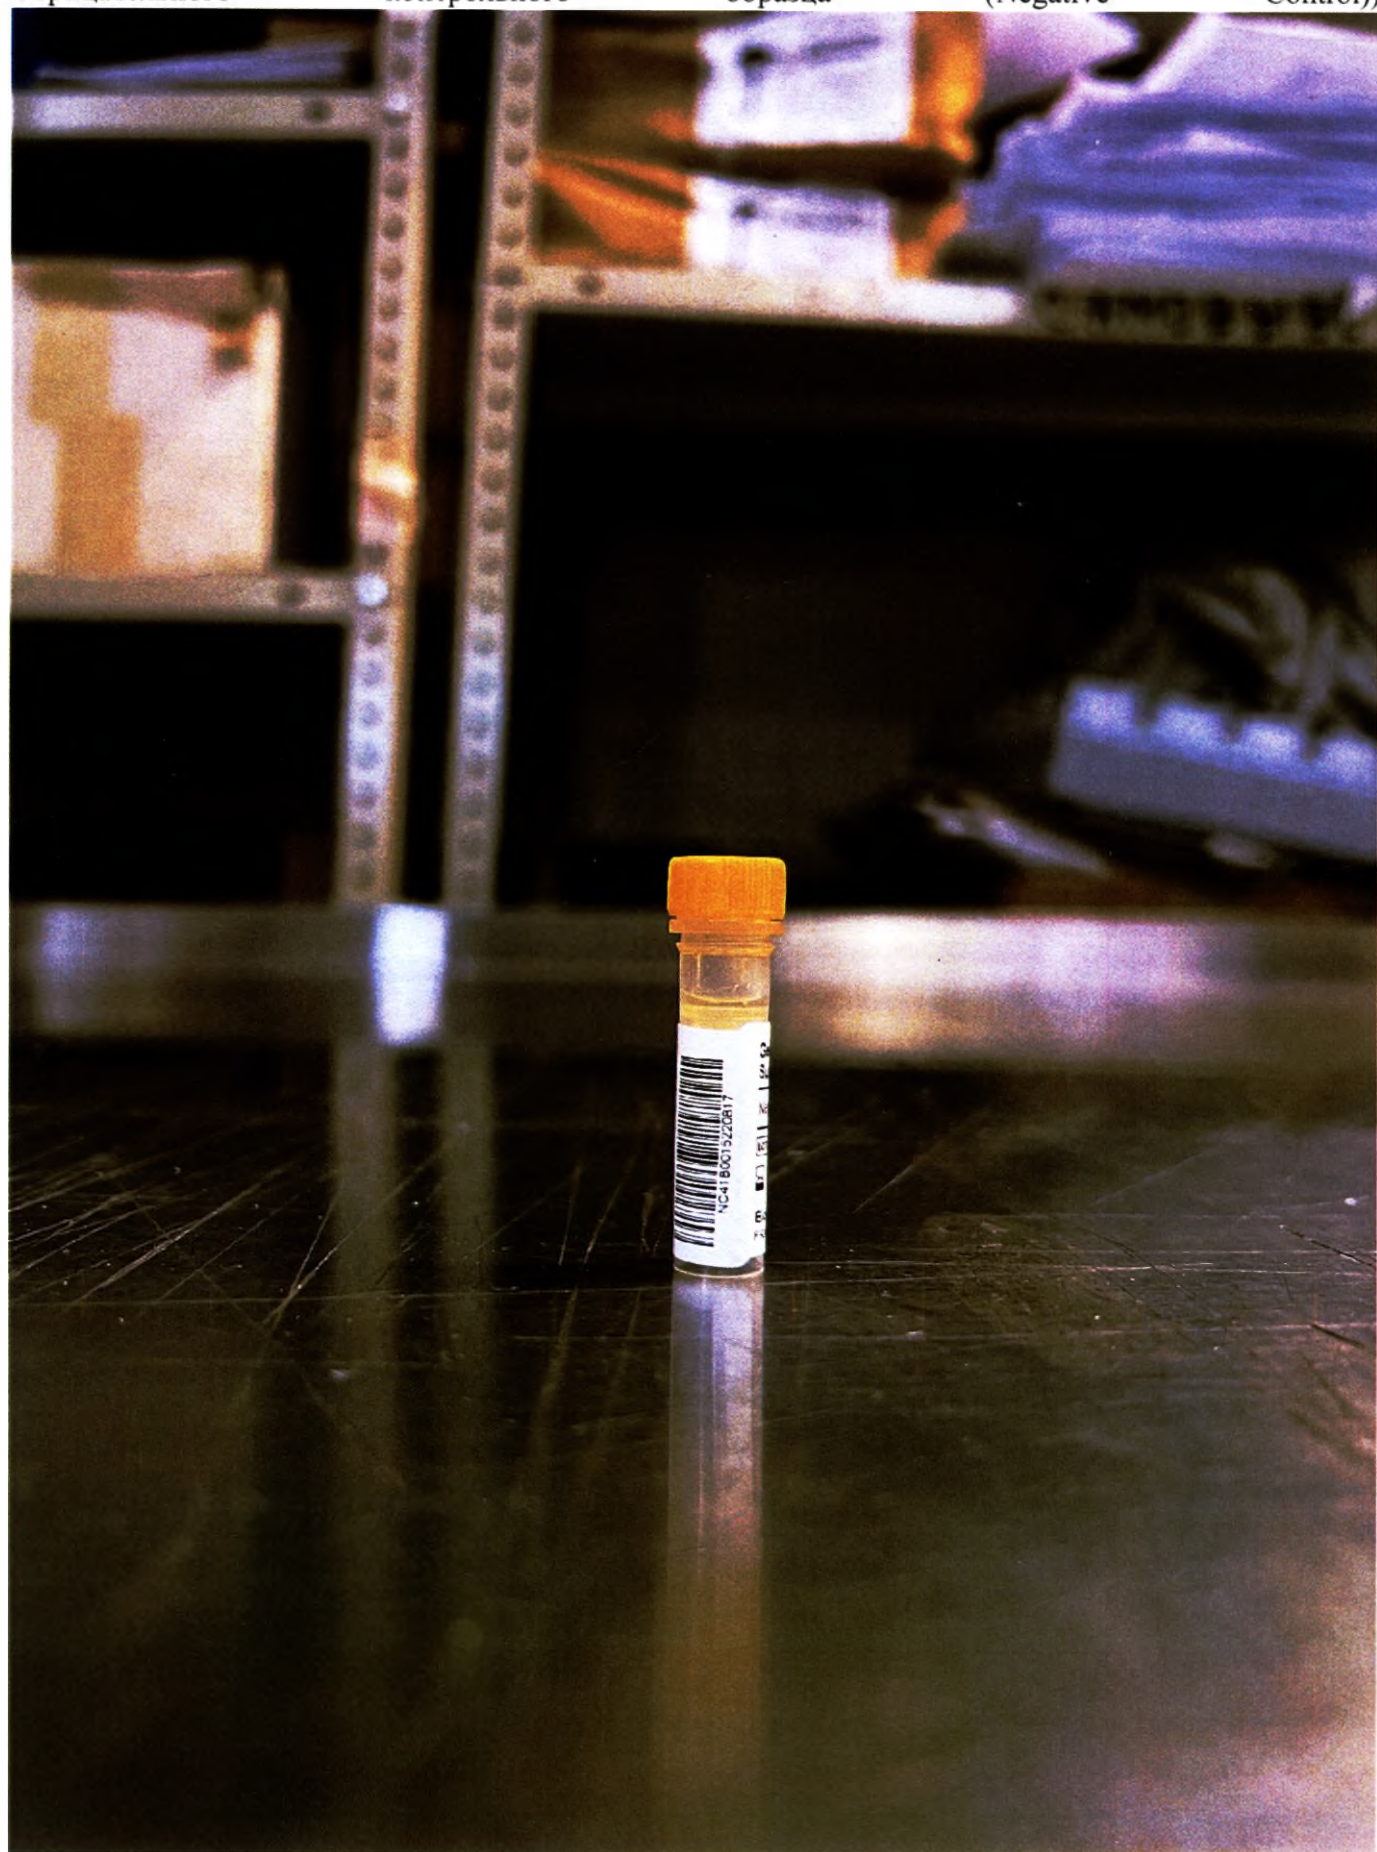


Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Штрих-кода для положительного контрольного образца (Positive Control Labels Card))

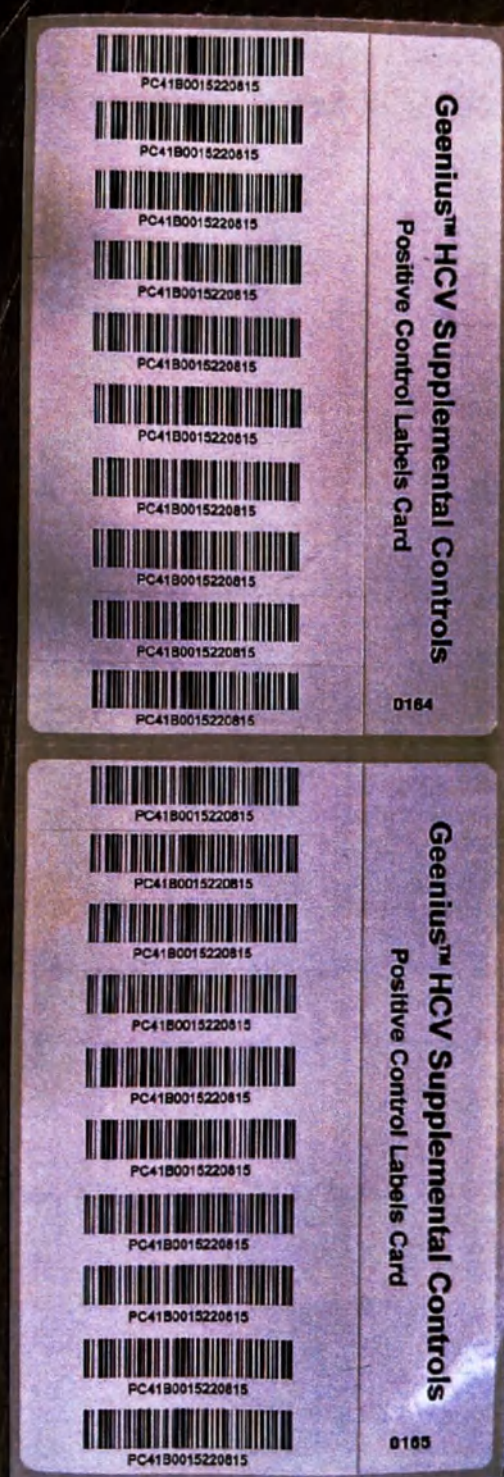


Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Штрих-кода для положительного контрольного образца (Positive Control Labels Card))



Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Штрих-кода для отрицательного контрольного образца (Negative Control Labels Card))

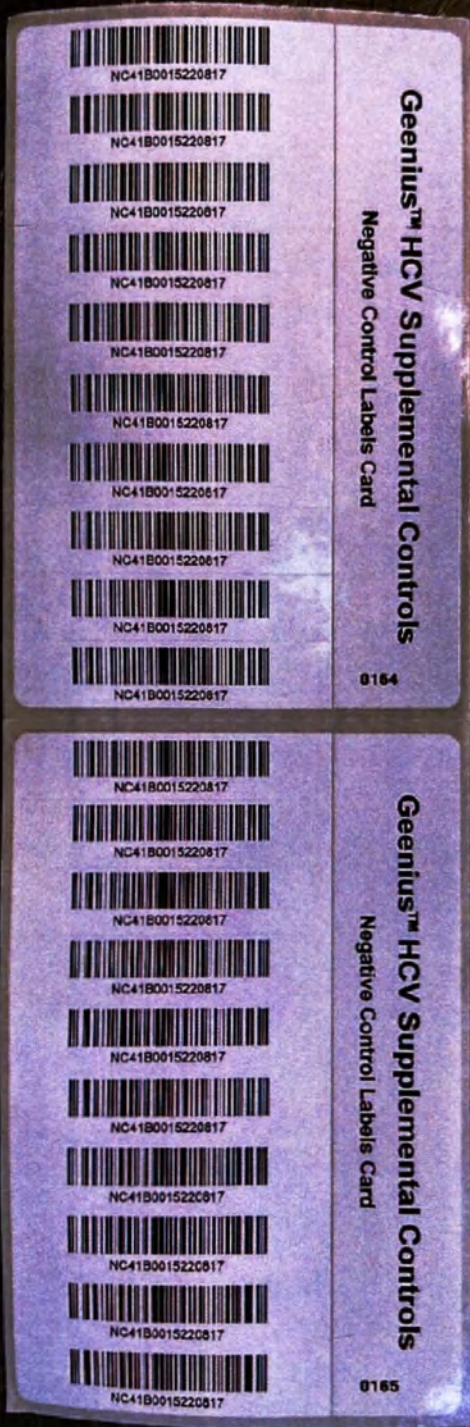

Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка Штрих-кода для отрицательного контрольного образца (Negative Control Labels Card))

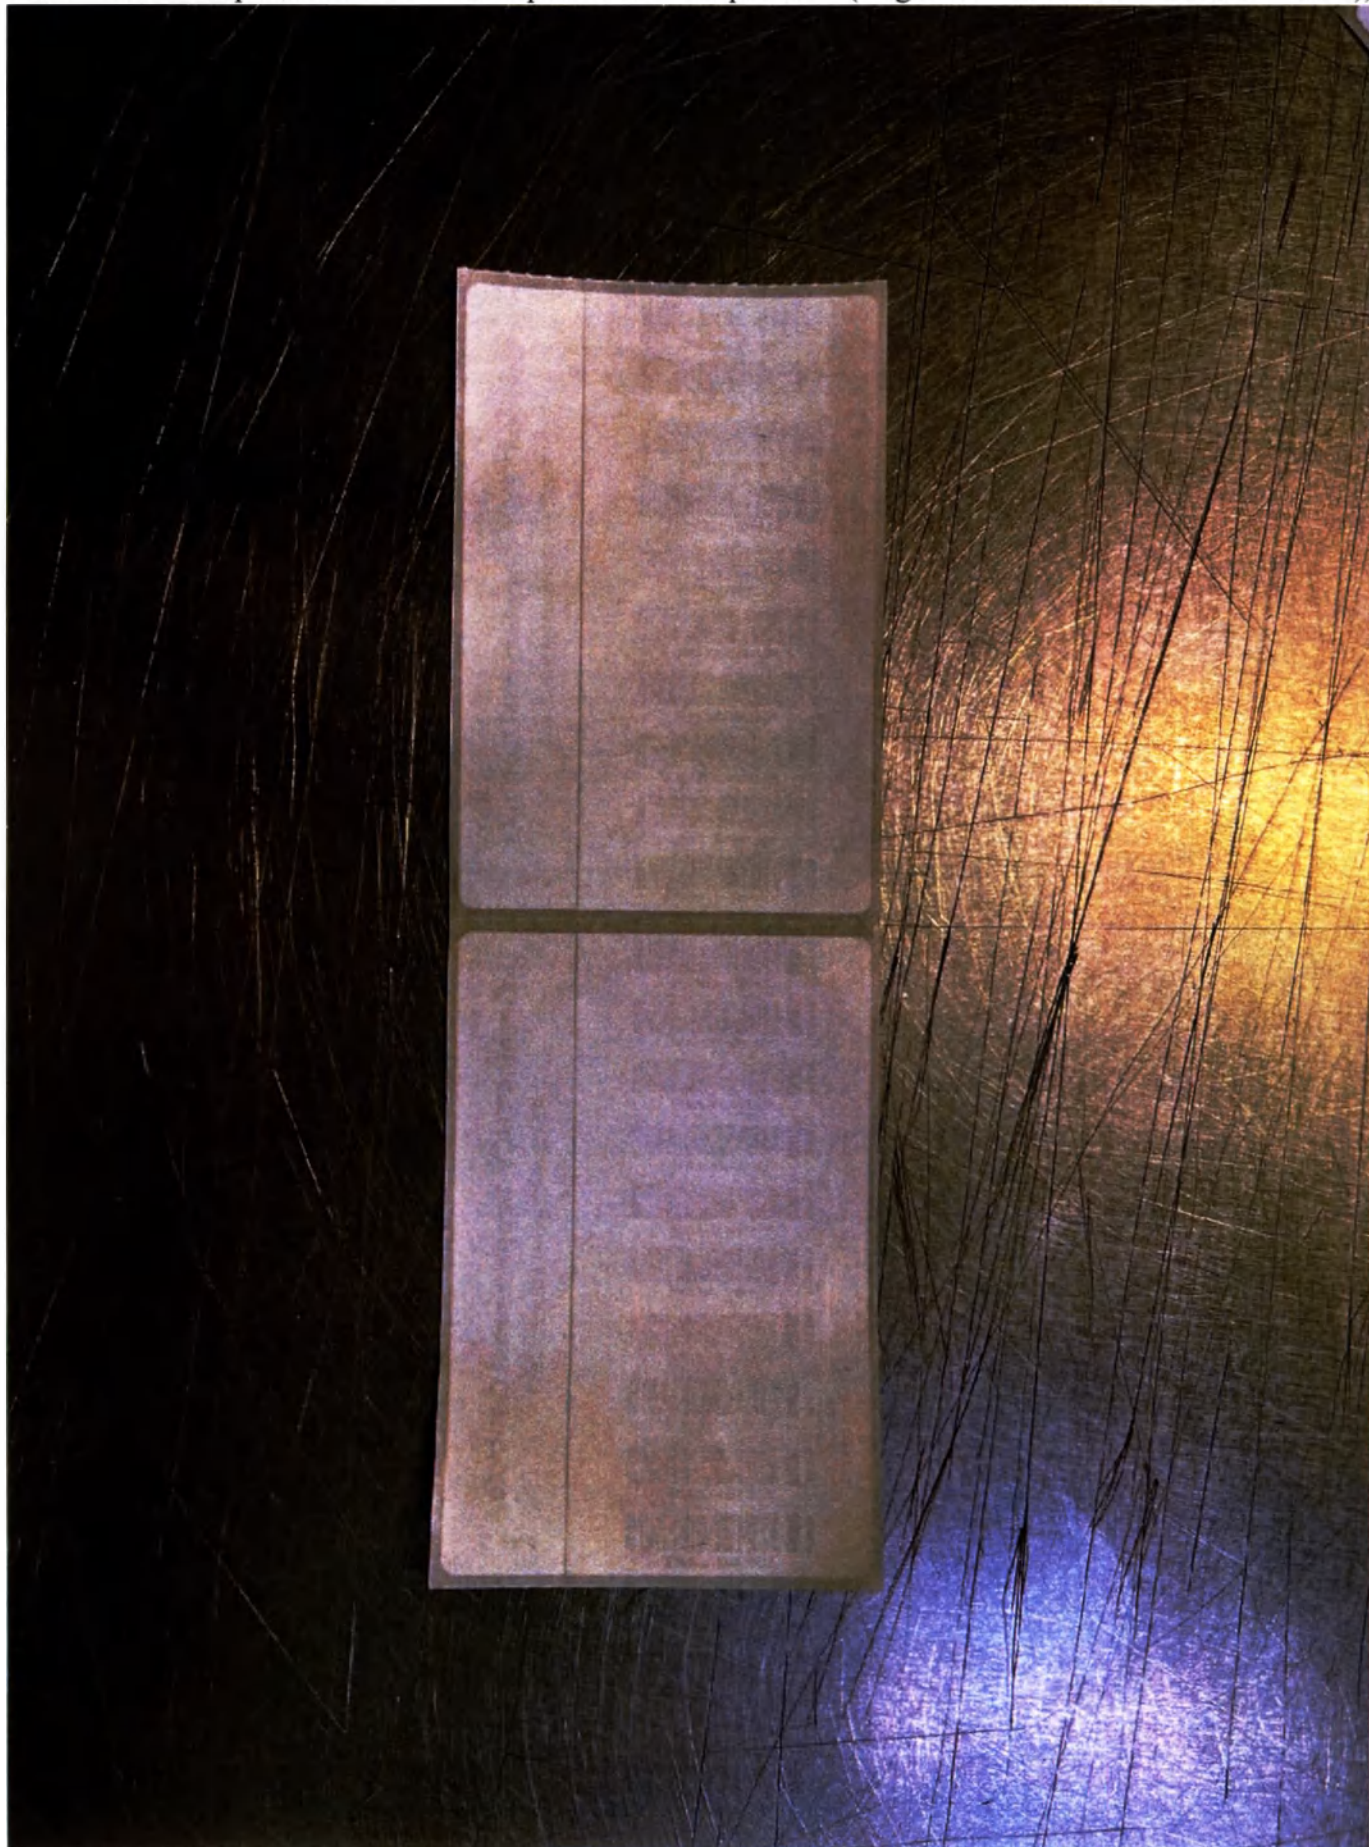

Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека (маркировка)

92502



Набор контрольных материалов «Geenius HCV Supplemental Controls» для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме или цельной крови человека

Состав:

1. Положительный контрольный образец (Positive Control) – 1x 150 мкл/флакон.
2. Отрицательный контрольный образец (Negative Control) – 1x 150 мкл/флакон.
3. Штрих-код для положительного контрольного образца (Positive Control Labels Card) – 20 шт.
4. Штрих-код для отрицательного контрольного образца (Negative Control Labels Card) – 20 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____
Номер серии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам HBsAg отсутствуют

Производитель: БИО-РАД, Франция,
3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France
Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А
Телефон: (495) 721 14 04 diag_support_rcis@bio-rad.com www.bio-rad.com
Страна происхождения: Франция



Всего пронумеровано
прошнуровано и скреплено
печатью 20 листа (ов)

