

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КС-Проф»

Евдокимов С.П.



17 мая

2022 г.

Фотографические изображения

**Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических
конструкций Ceramill, с принадлежностями**

производства Amann Girrbach AG (Аманн Гиррбах АГ), Австрия

2022 г.




Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation. Вид спереди




Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation. Вид сзади




Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation. Вид сбоку

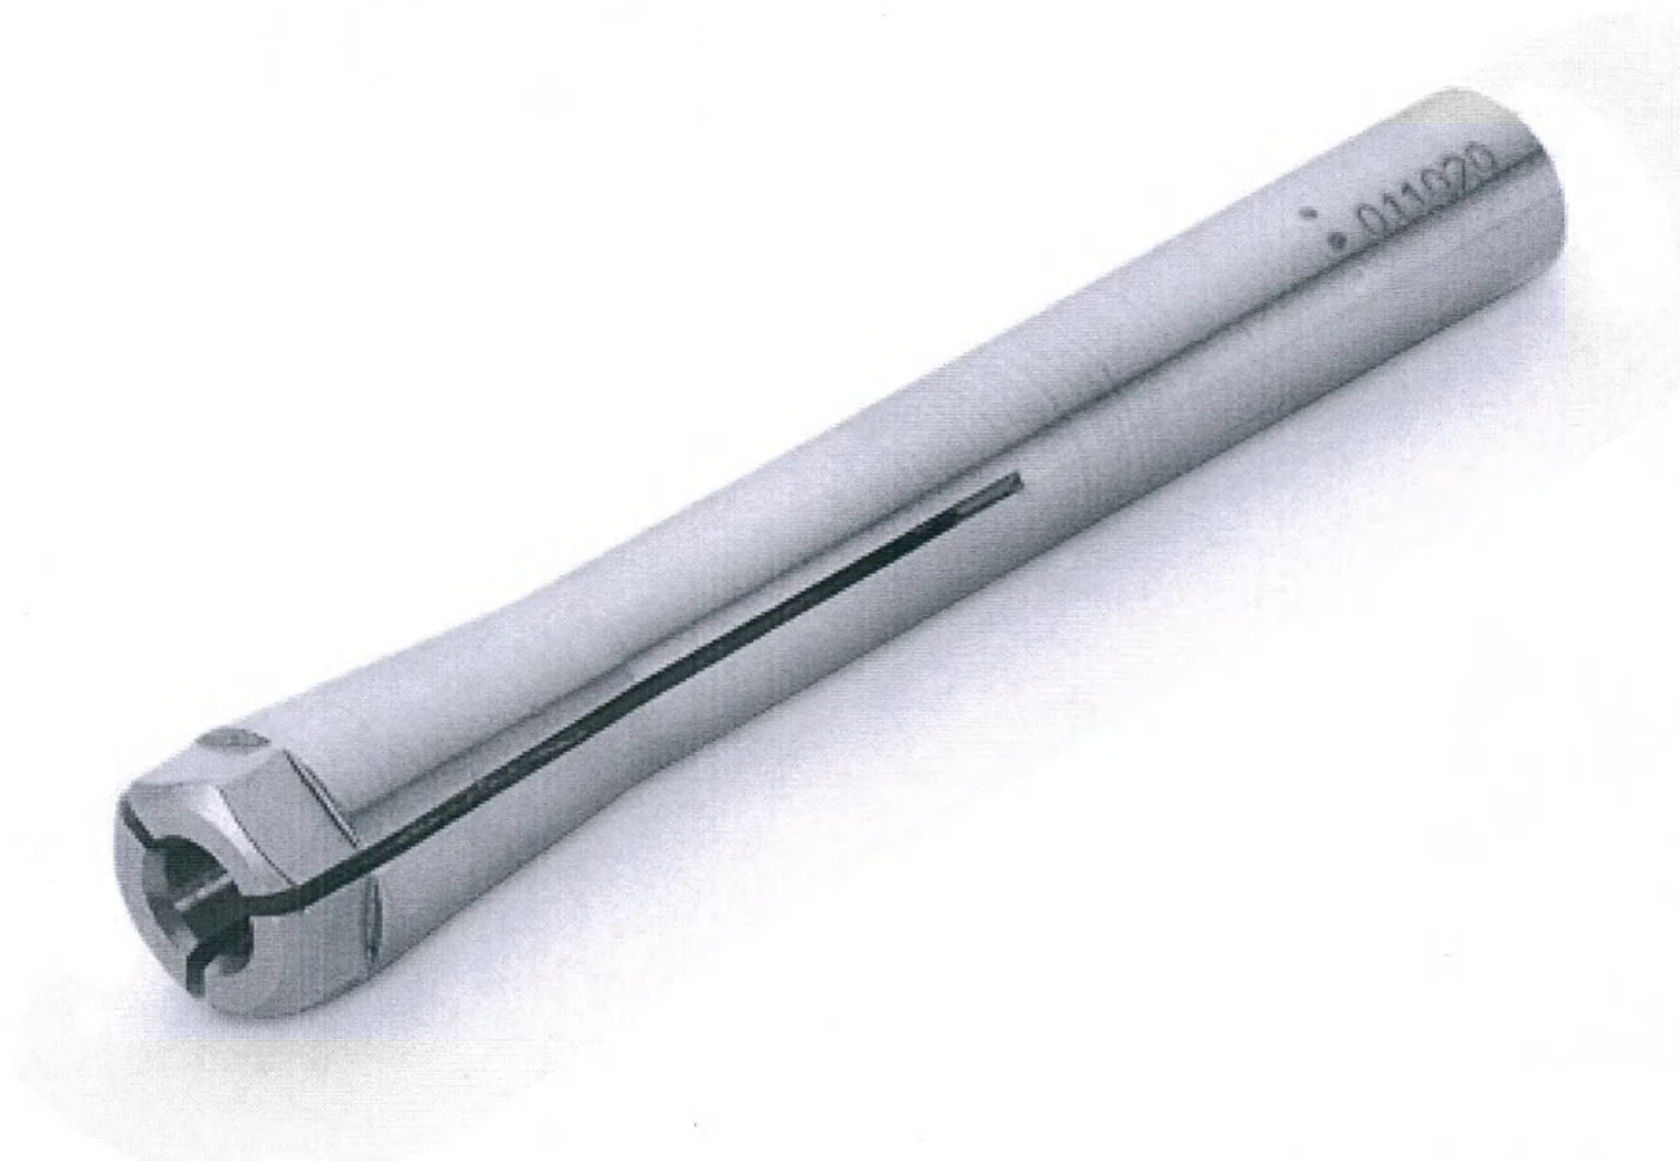

Цанга

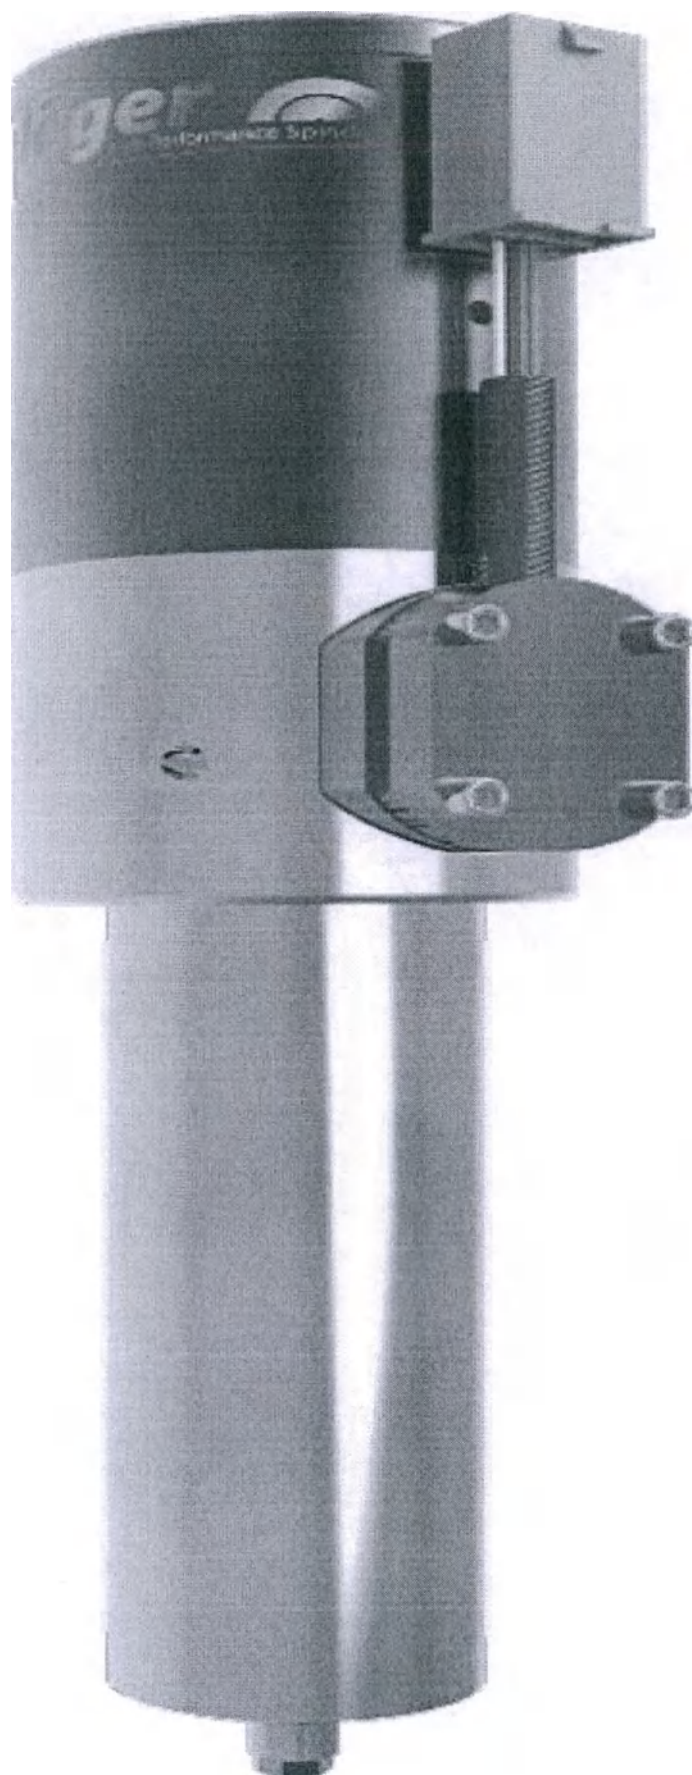


Шпиндель Jäger

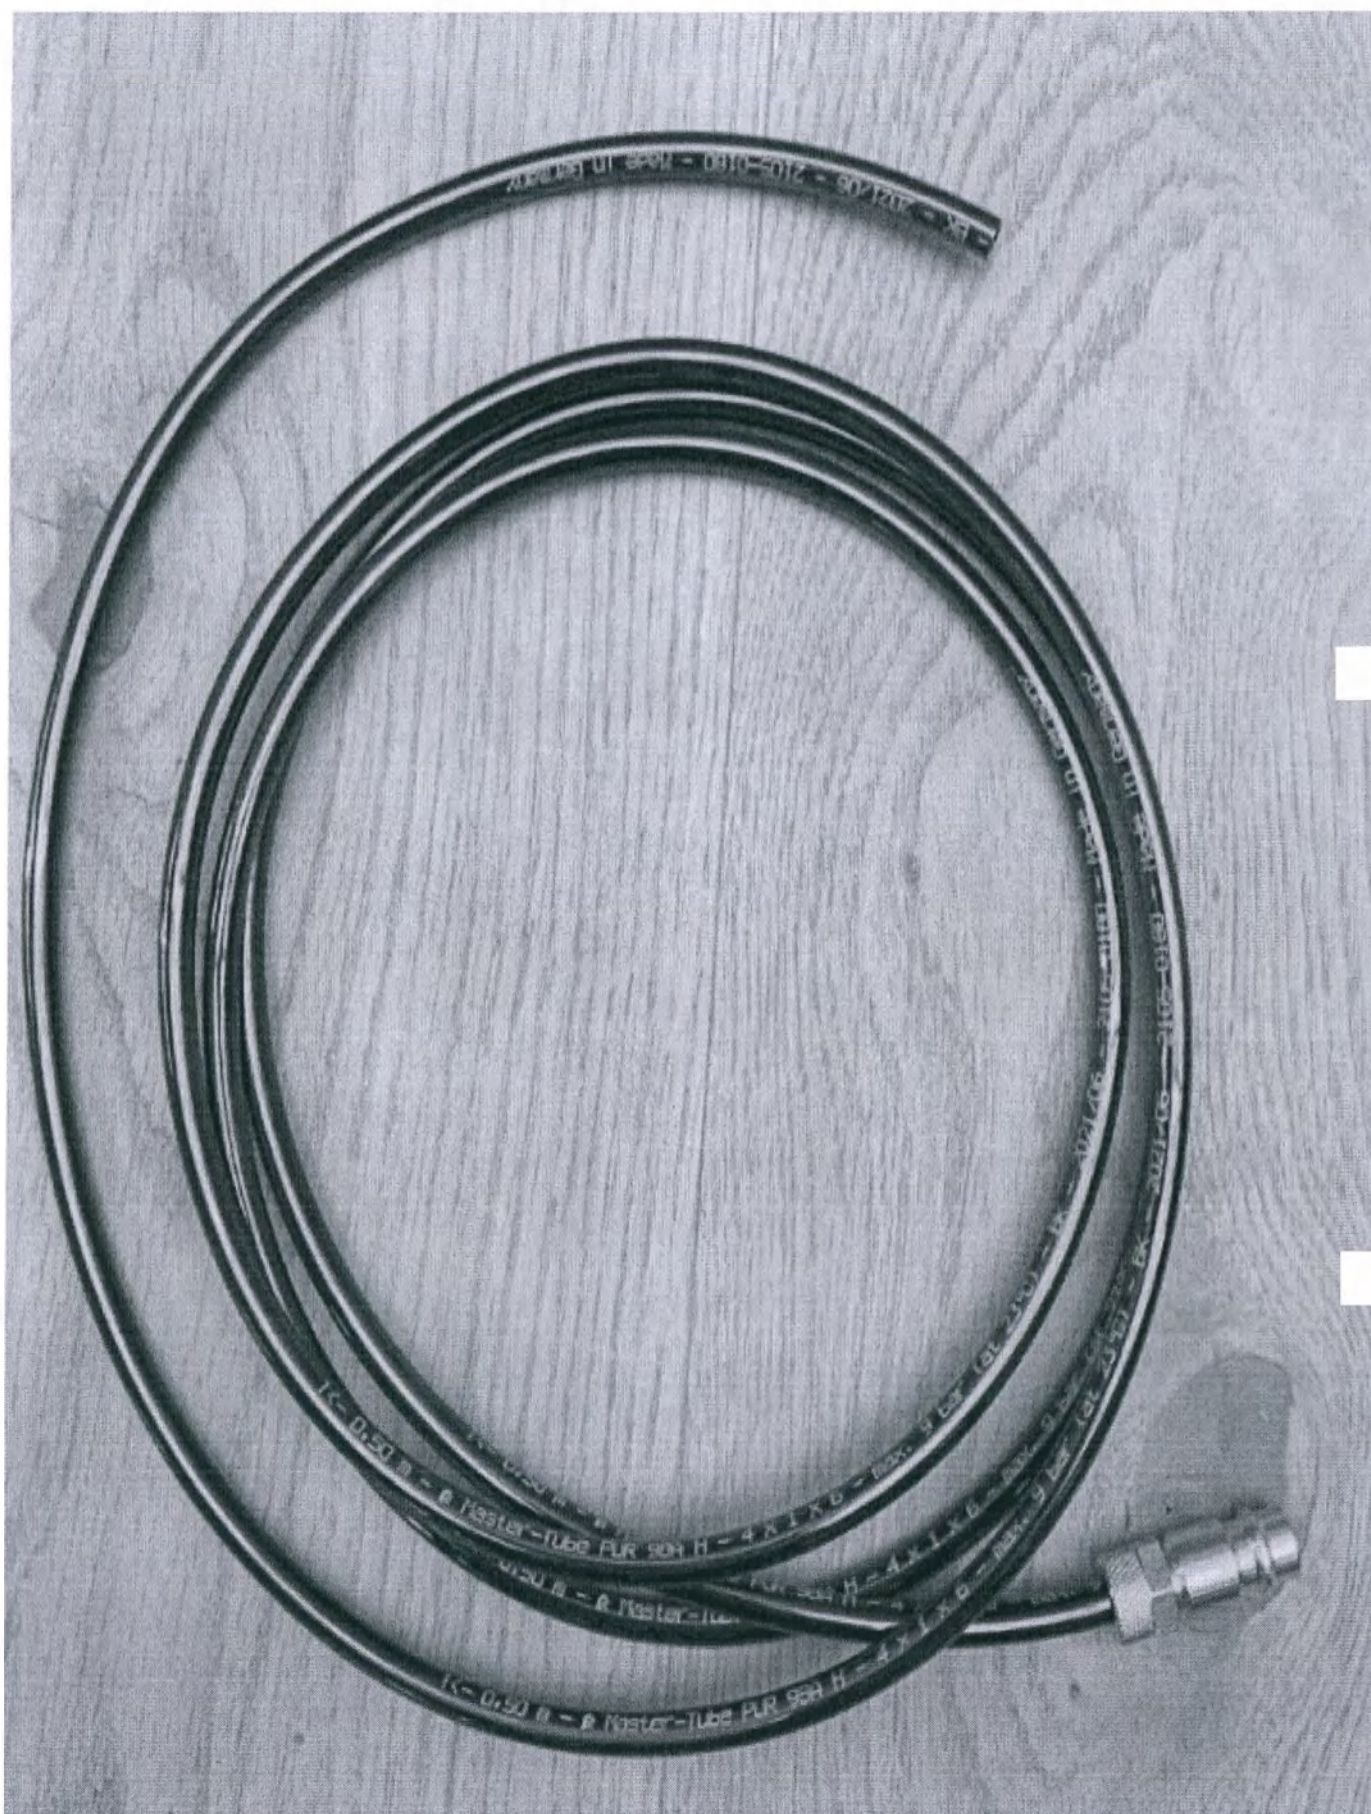


Пневматический шланг 2,5 м.




Пневматический шланг 0,3 м.

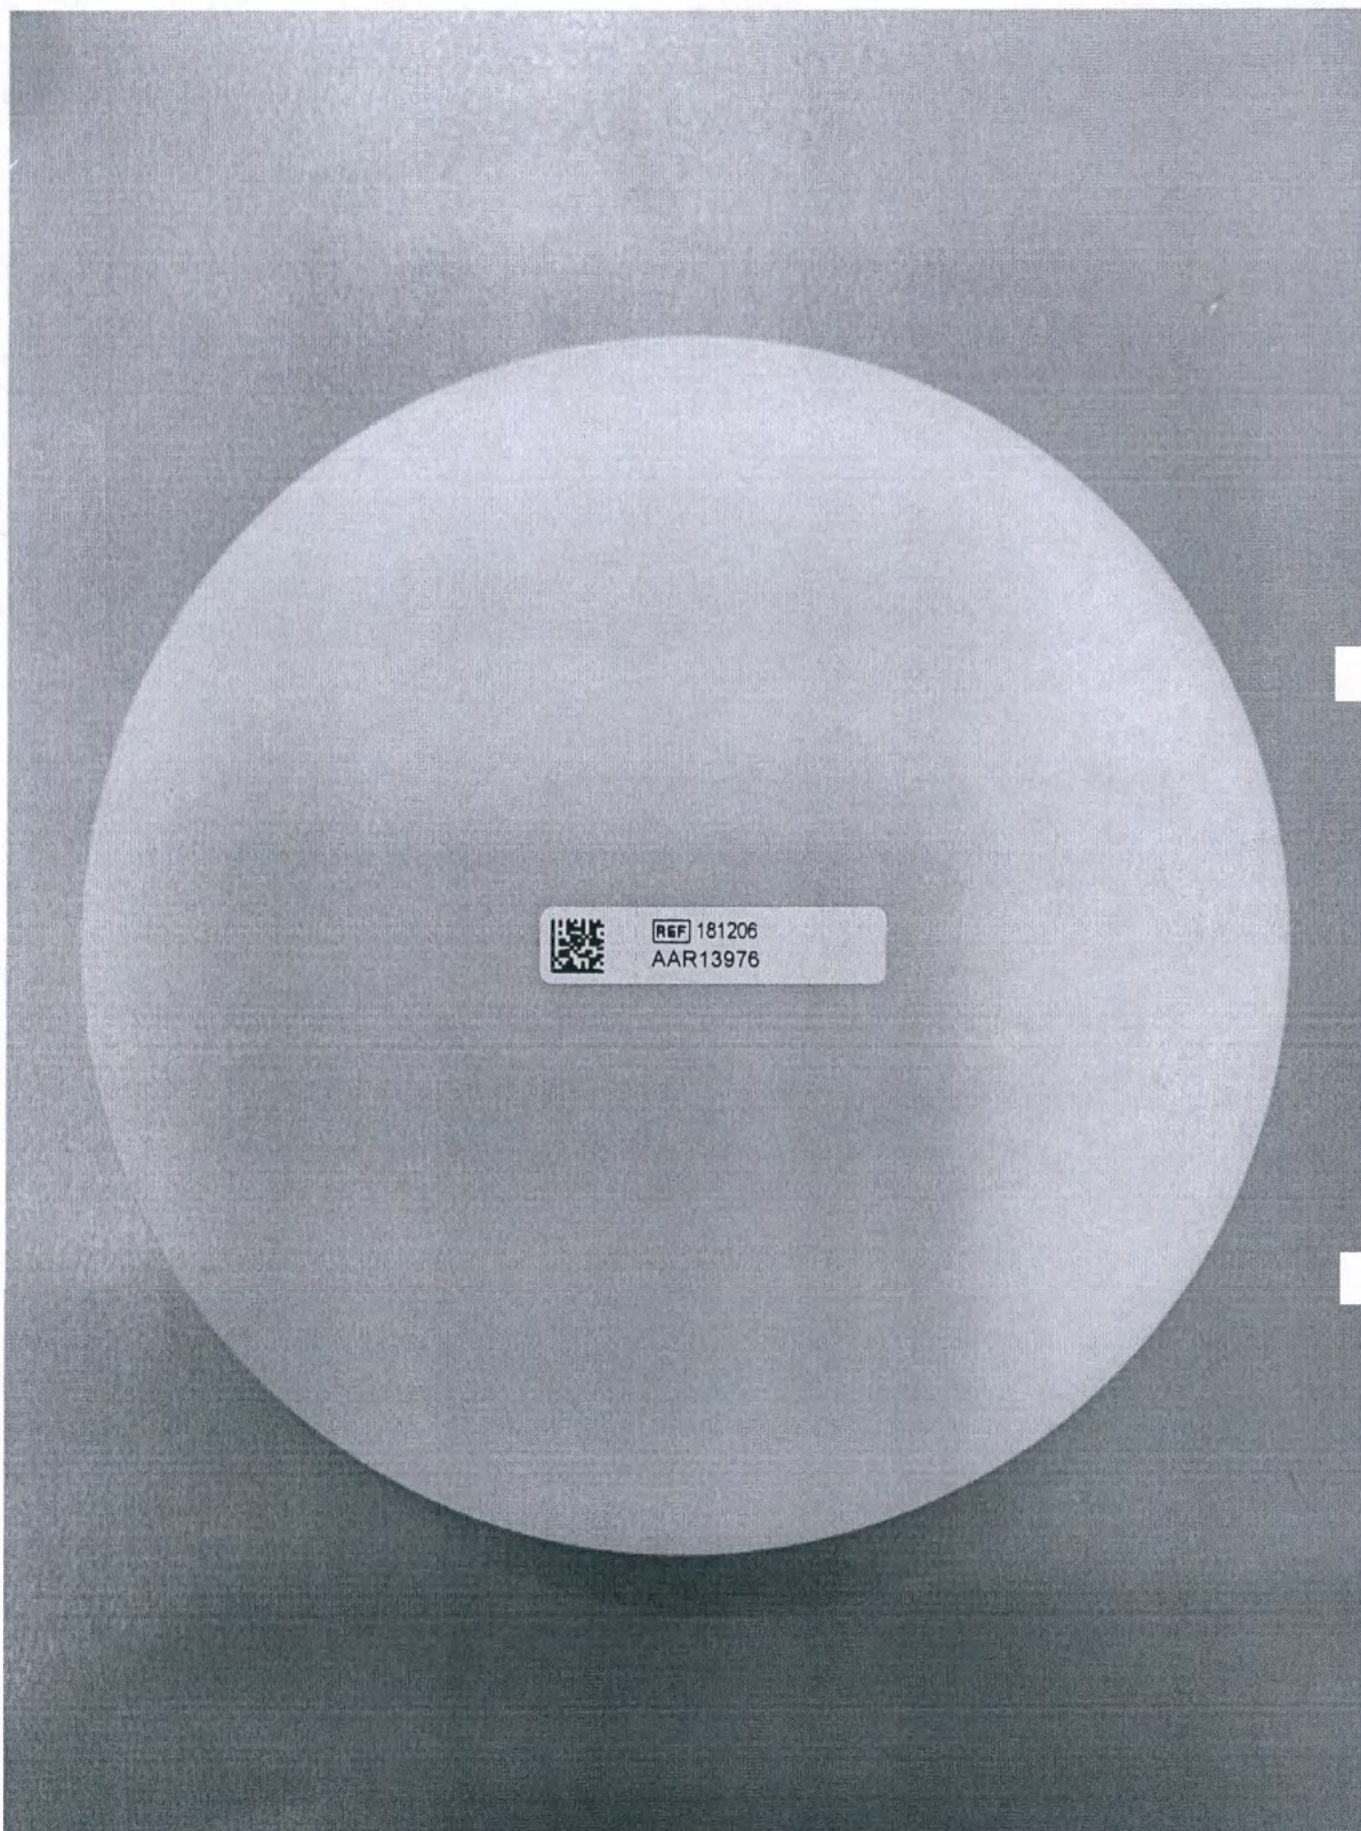


Заготовка для тестирования и калибровки $\varnothing 98$

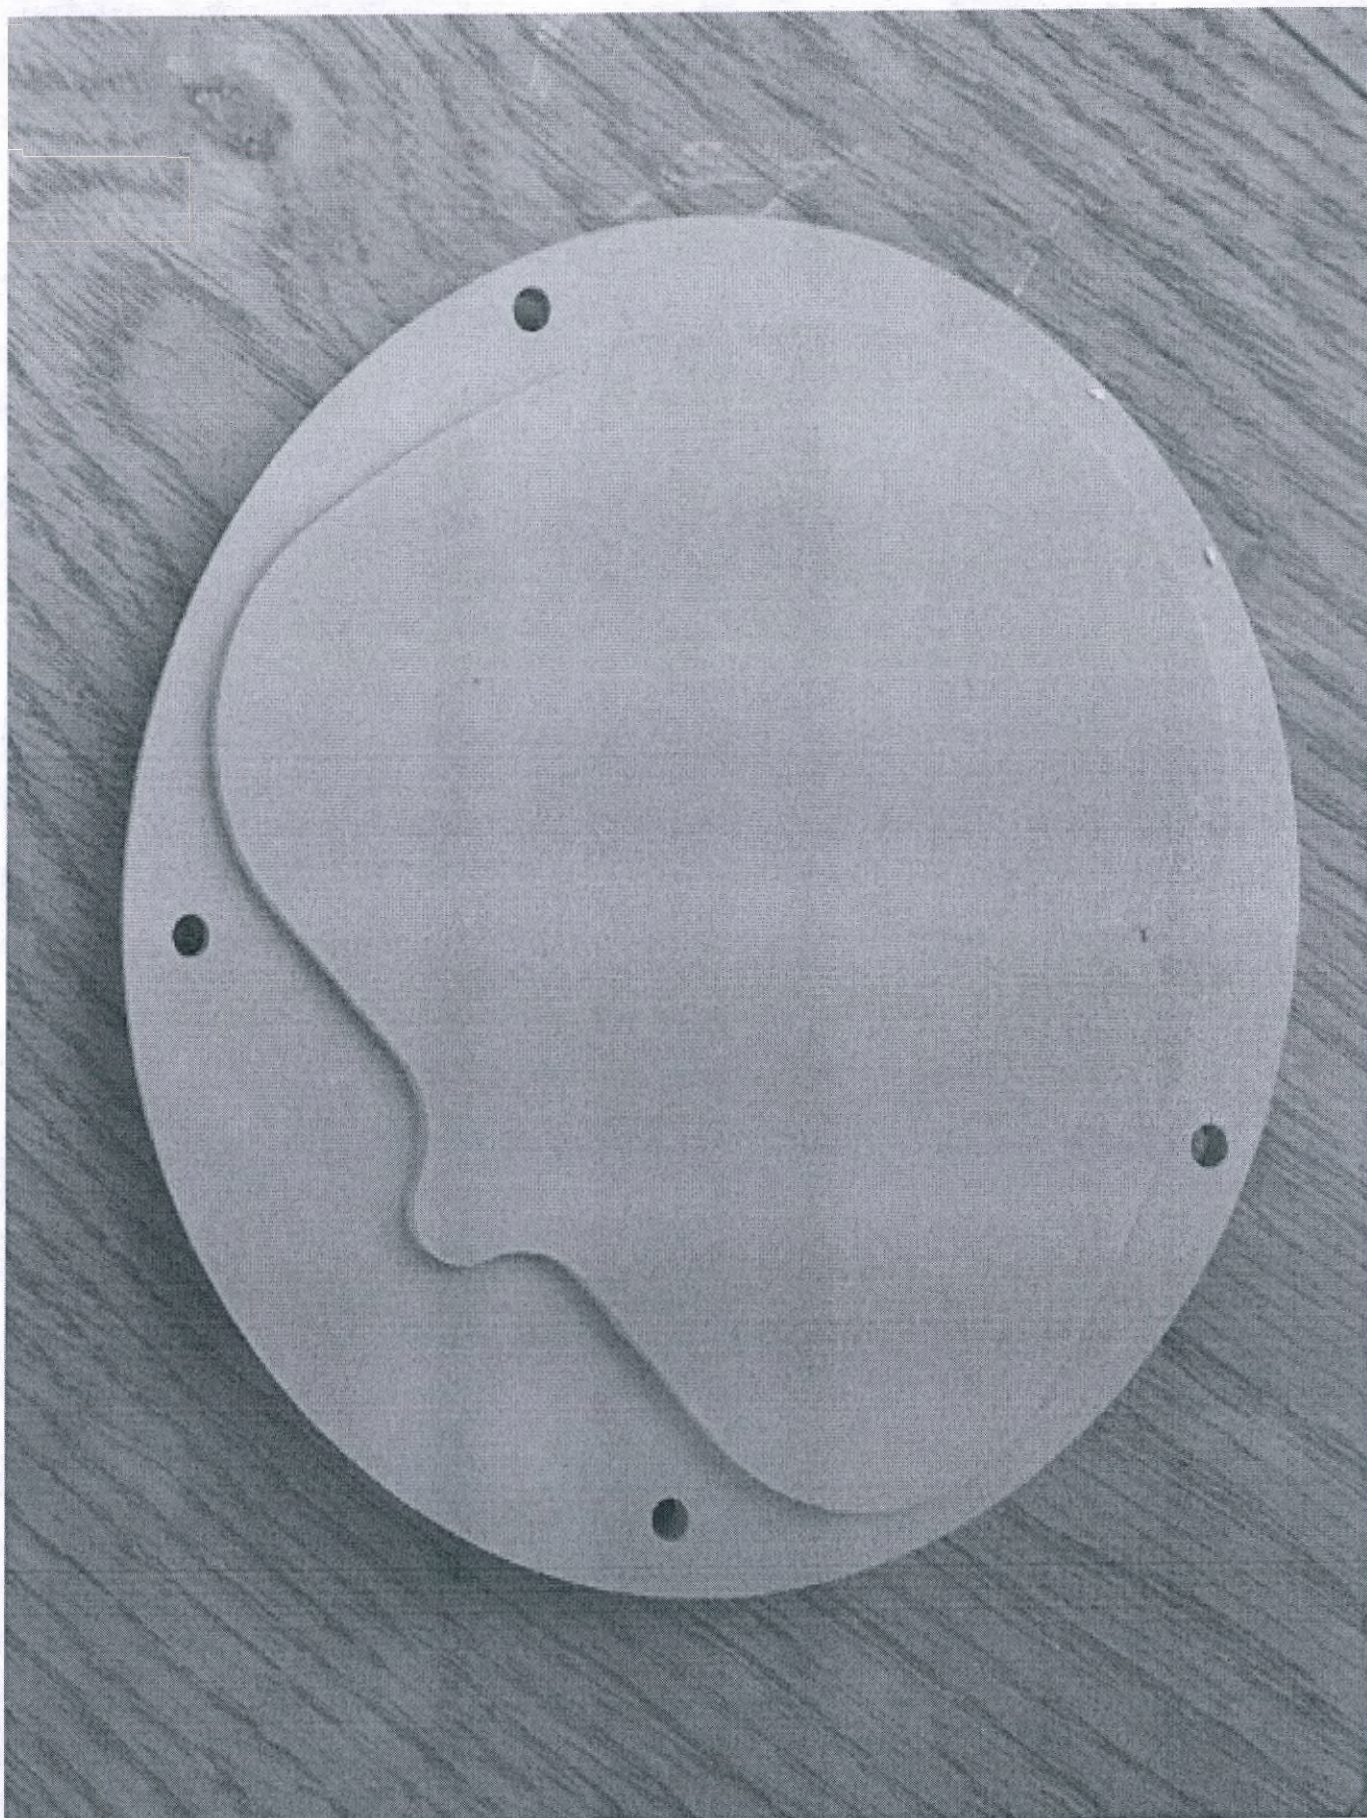


Заготовка для тестирования и калибровки $\varnothing 72$

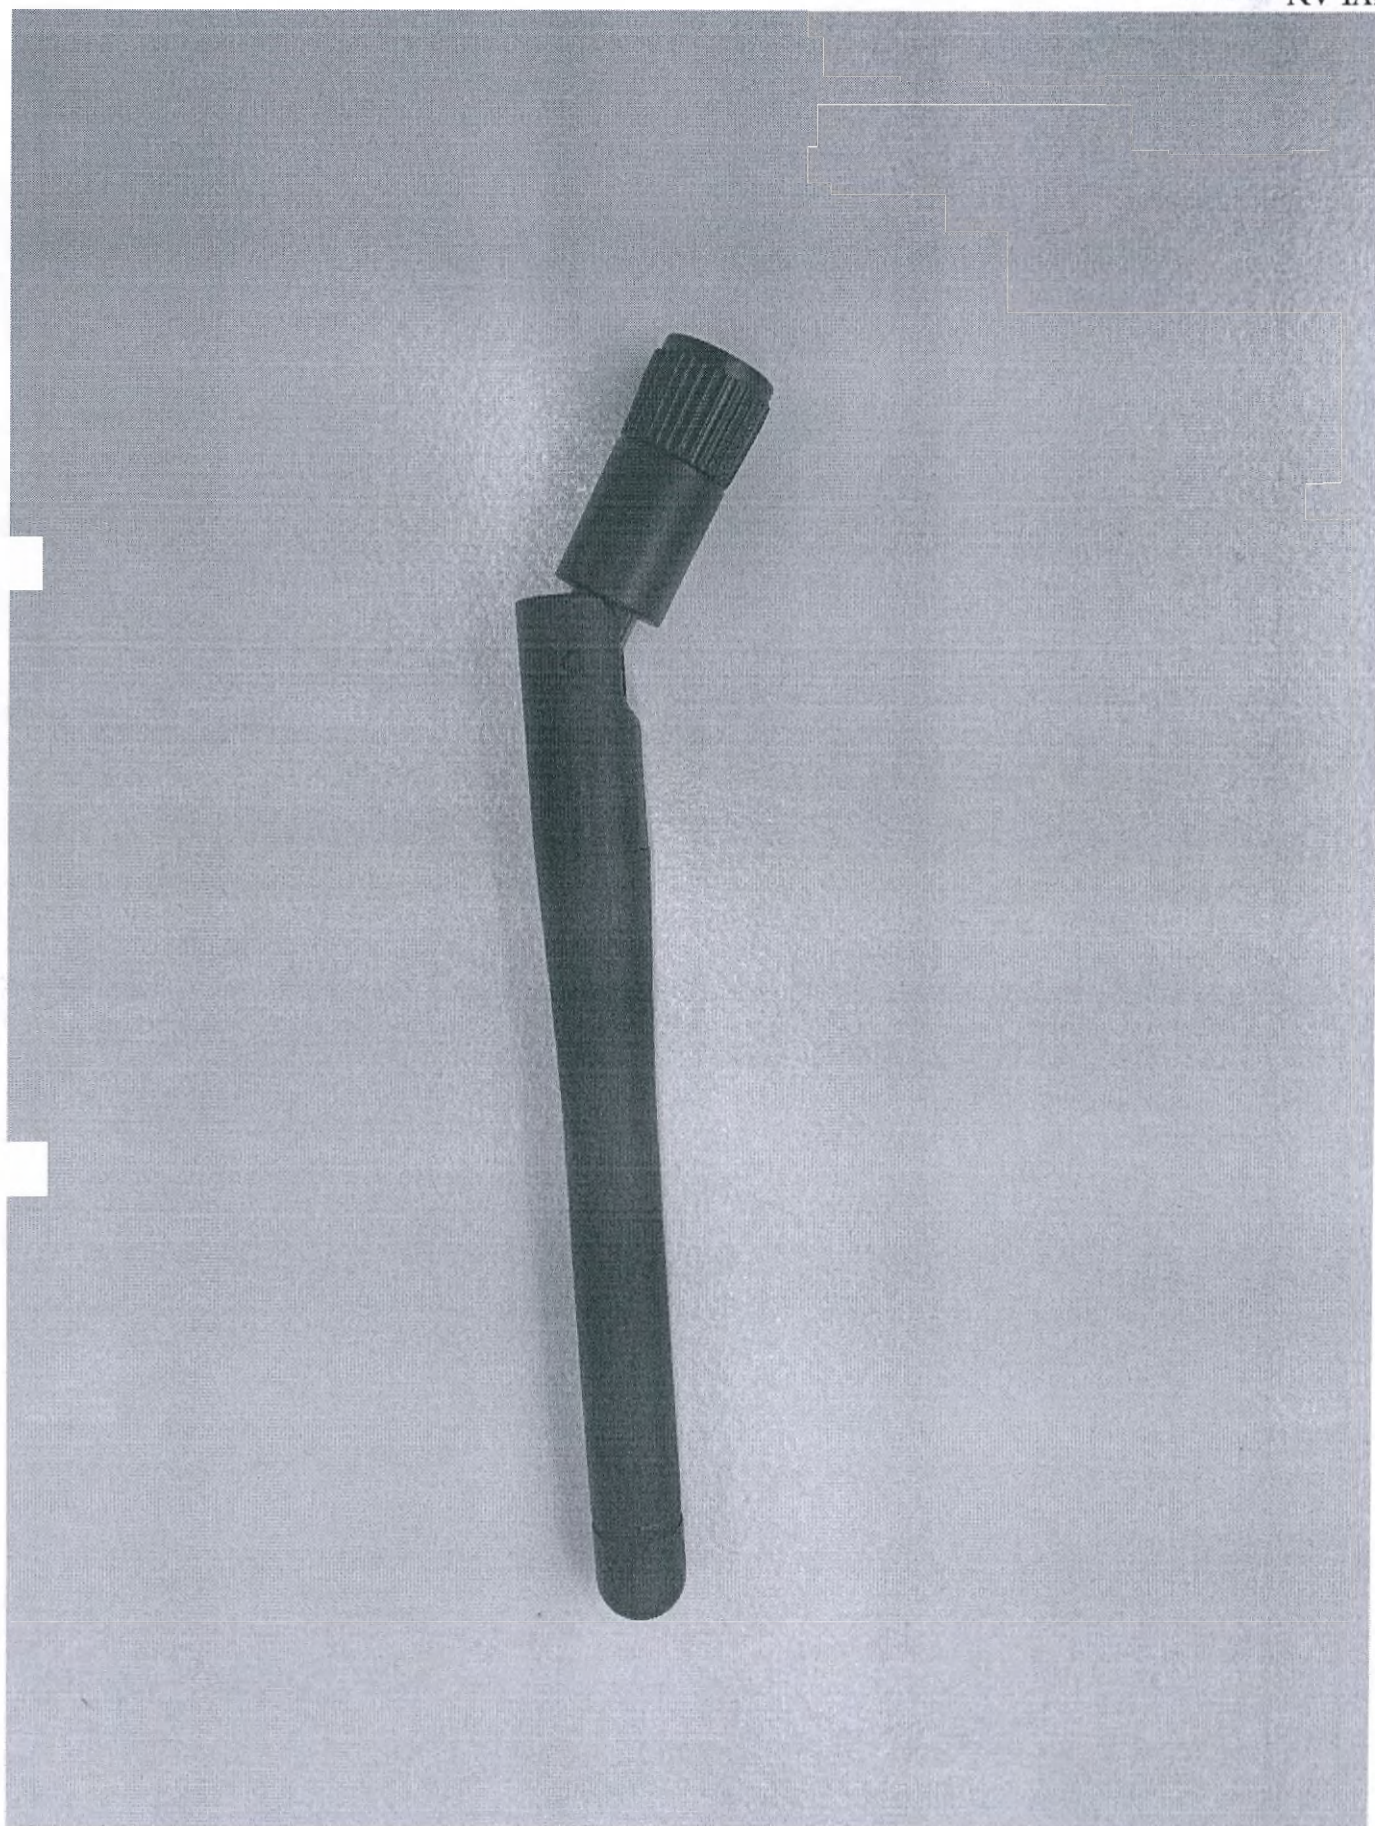


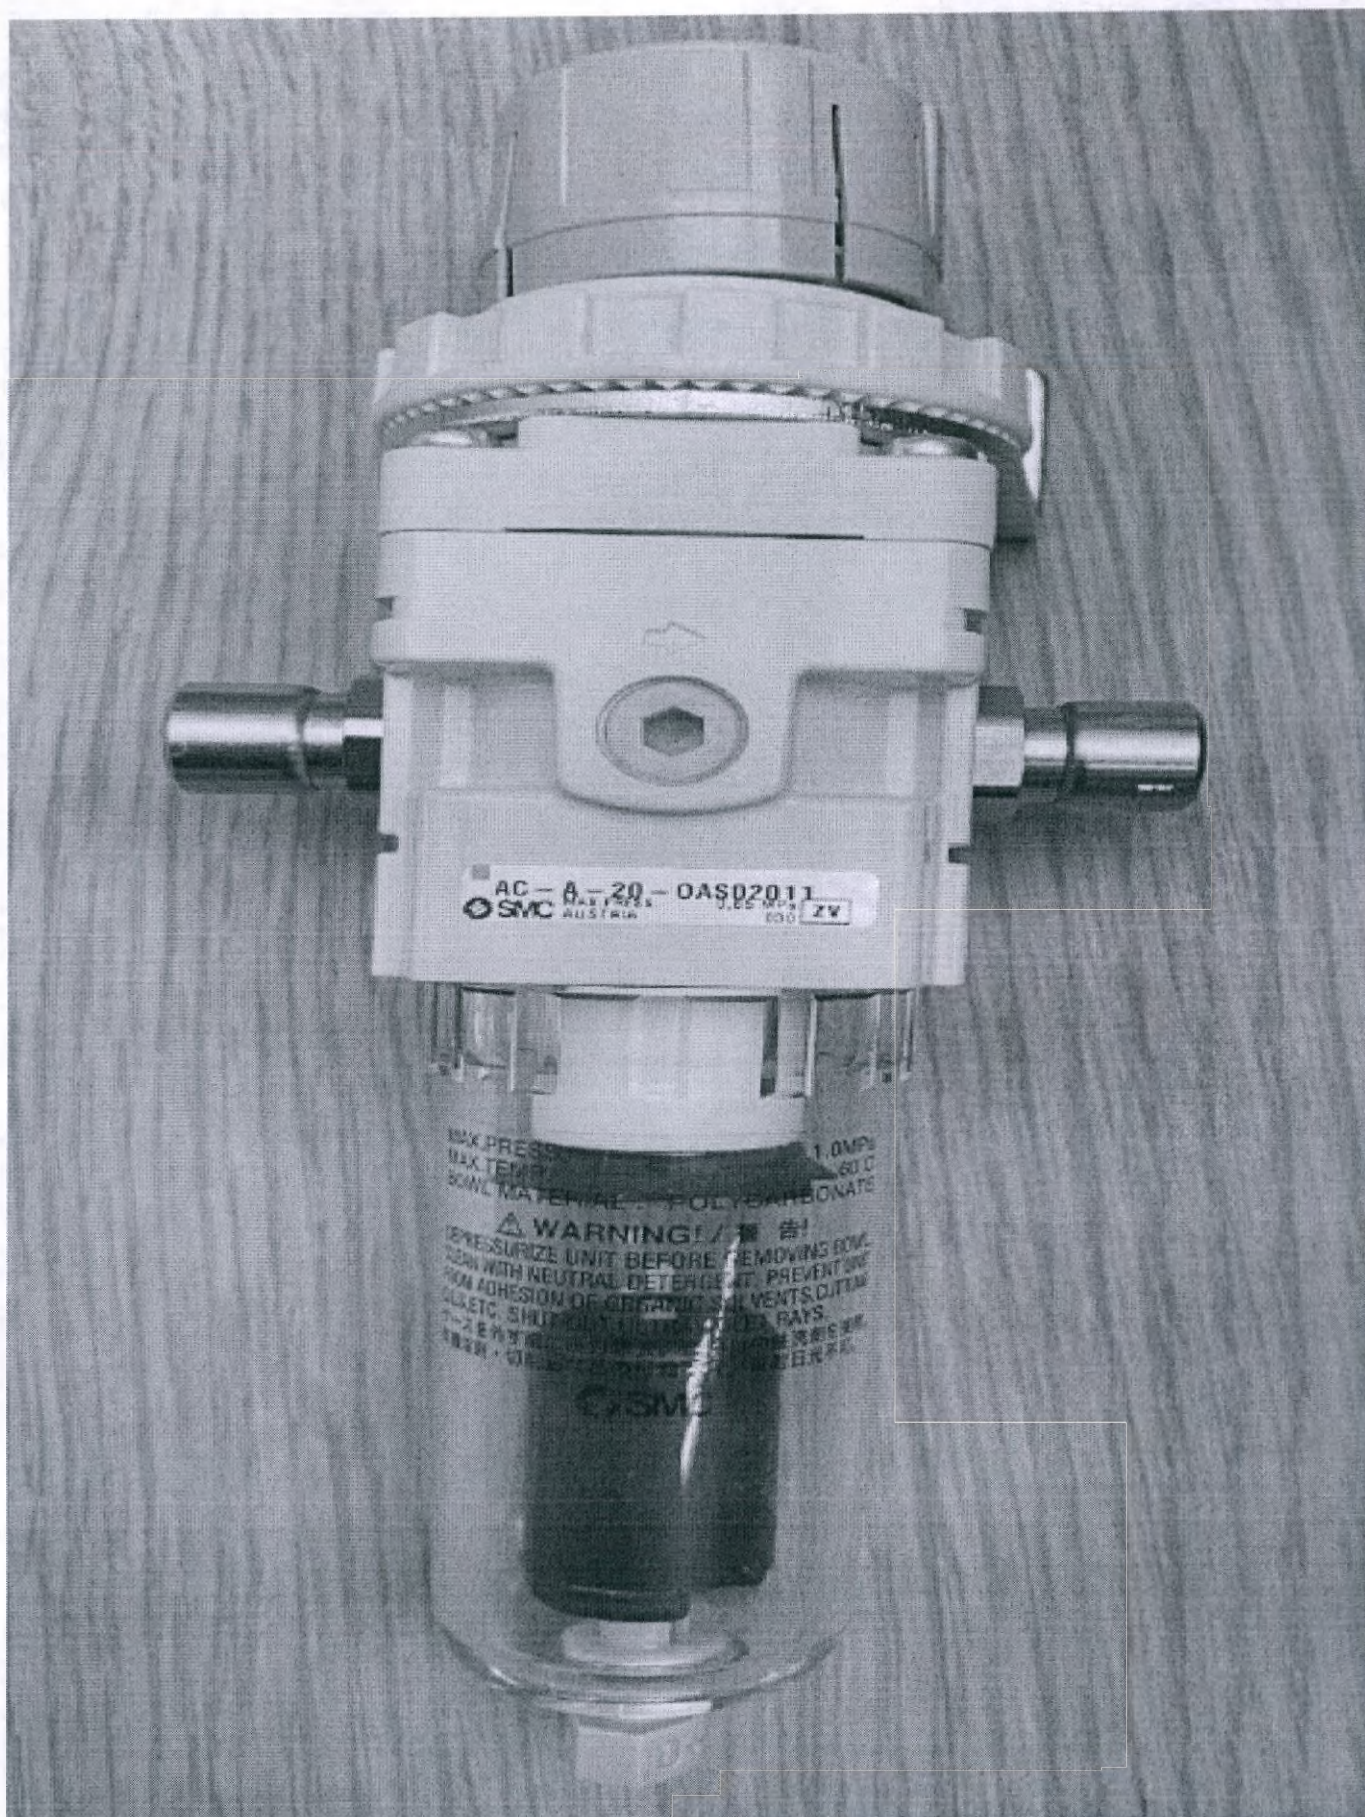


Блок для технического обслуживания

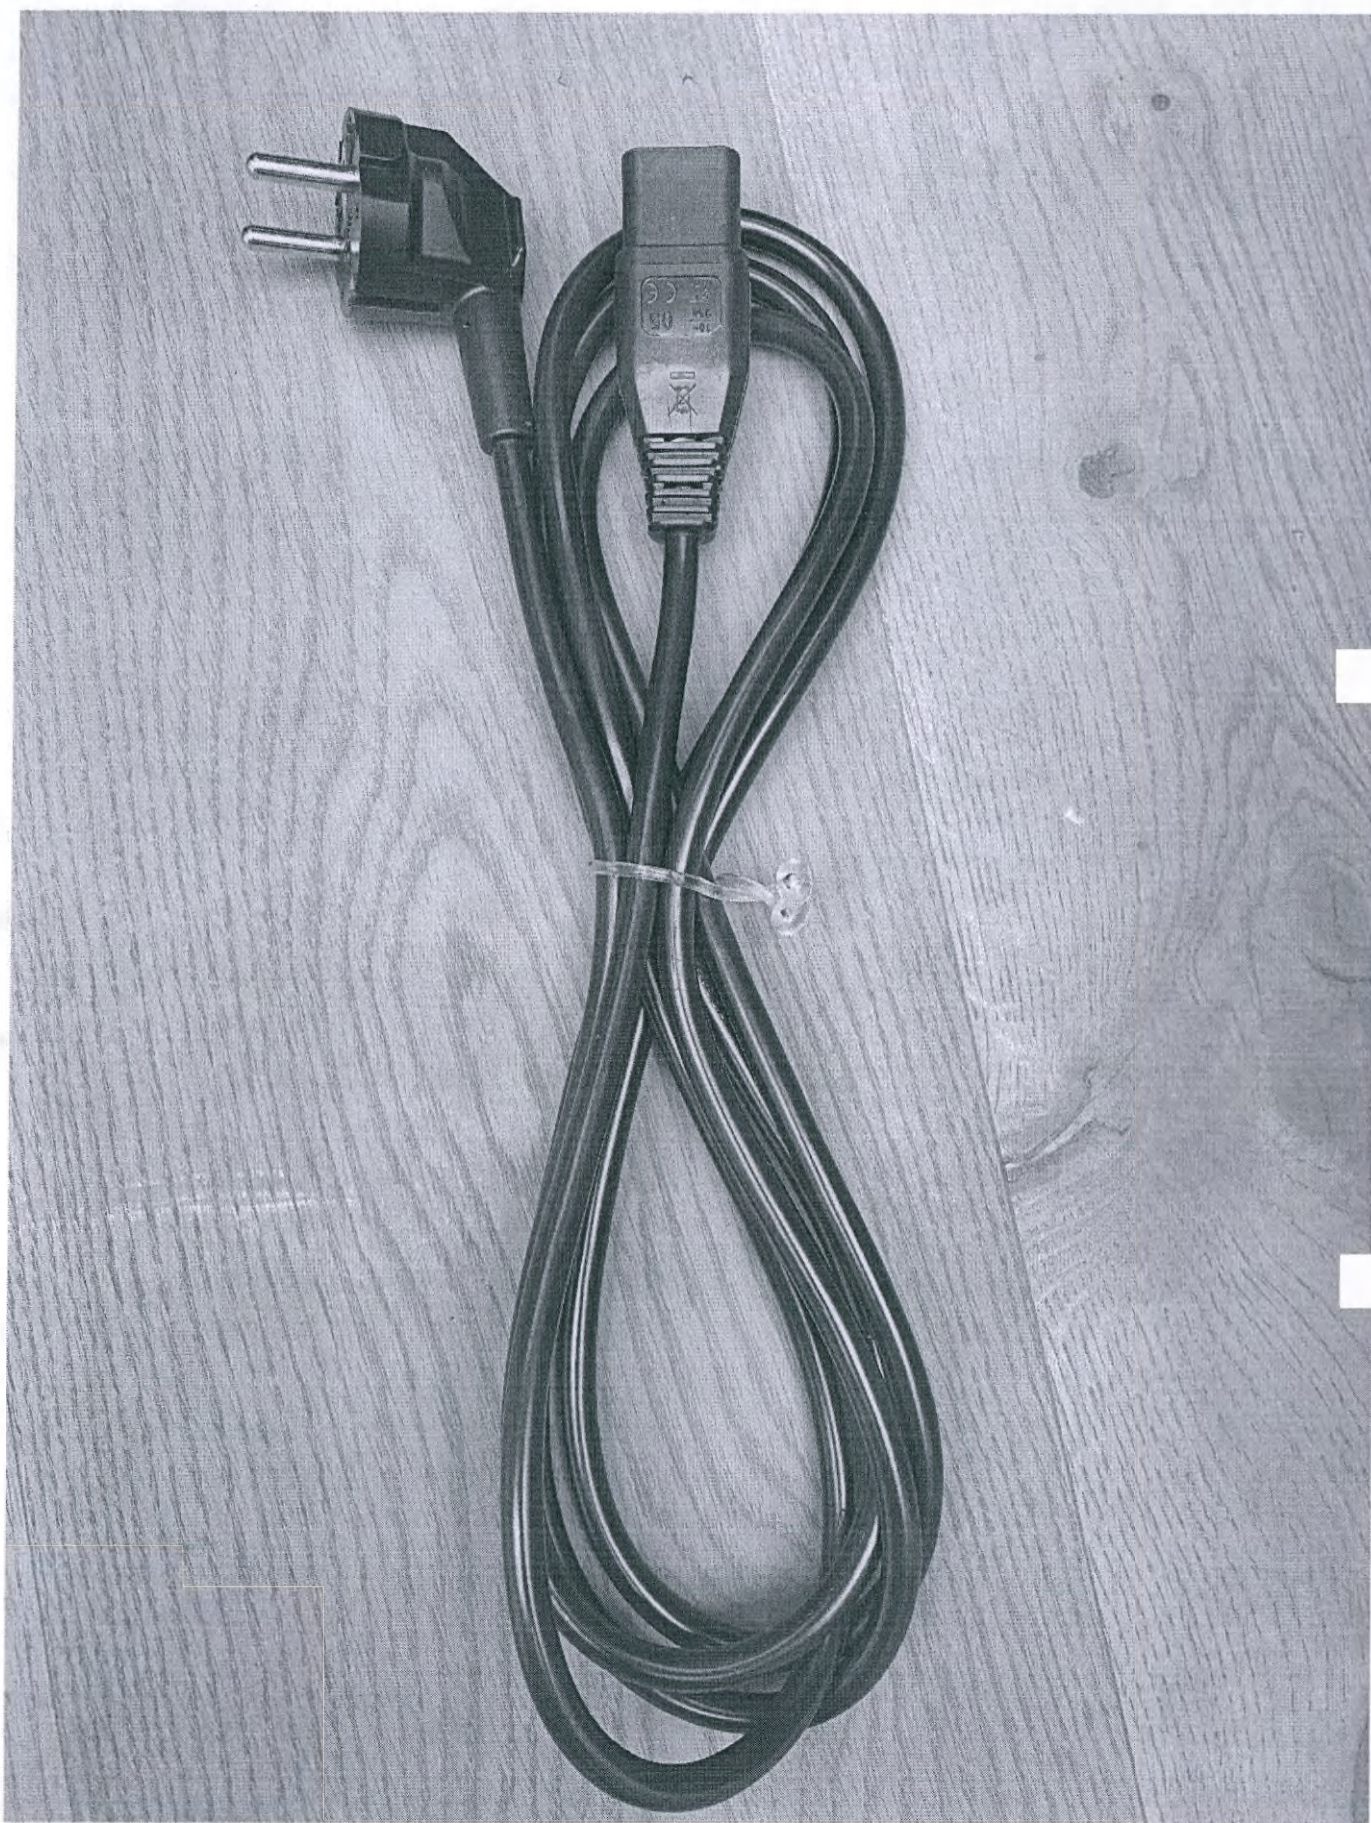


Кабель питания

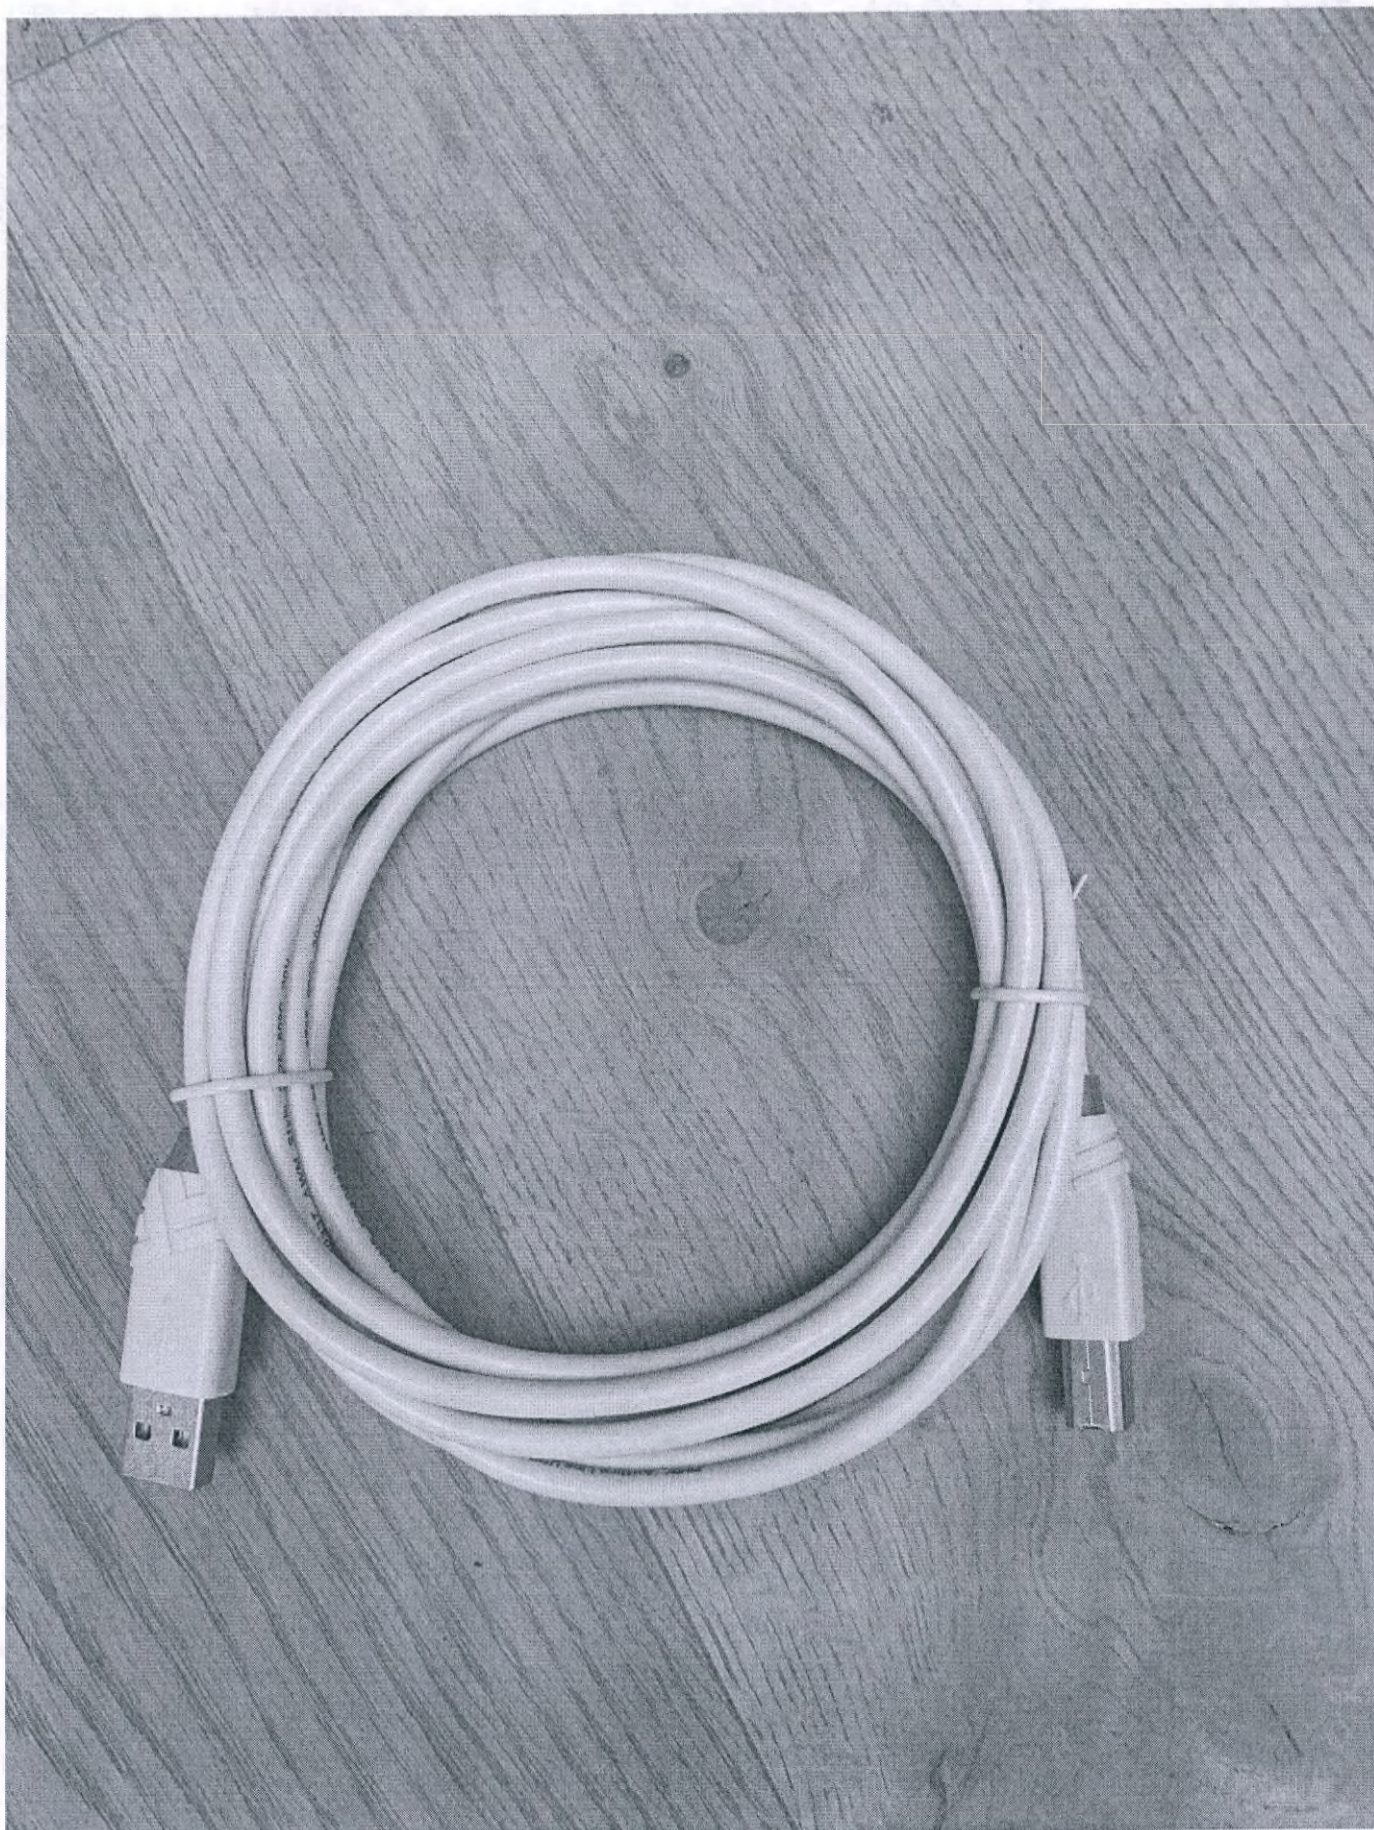


Кабель питания

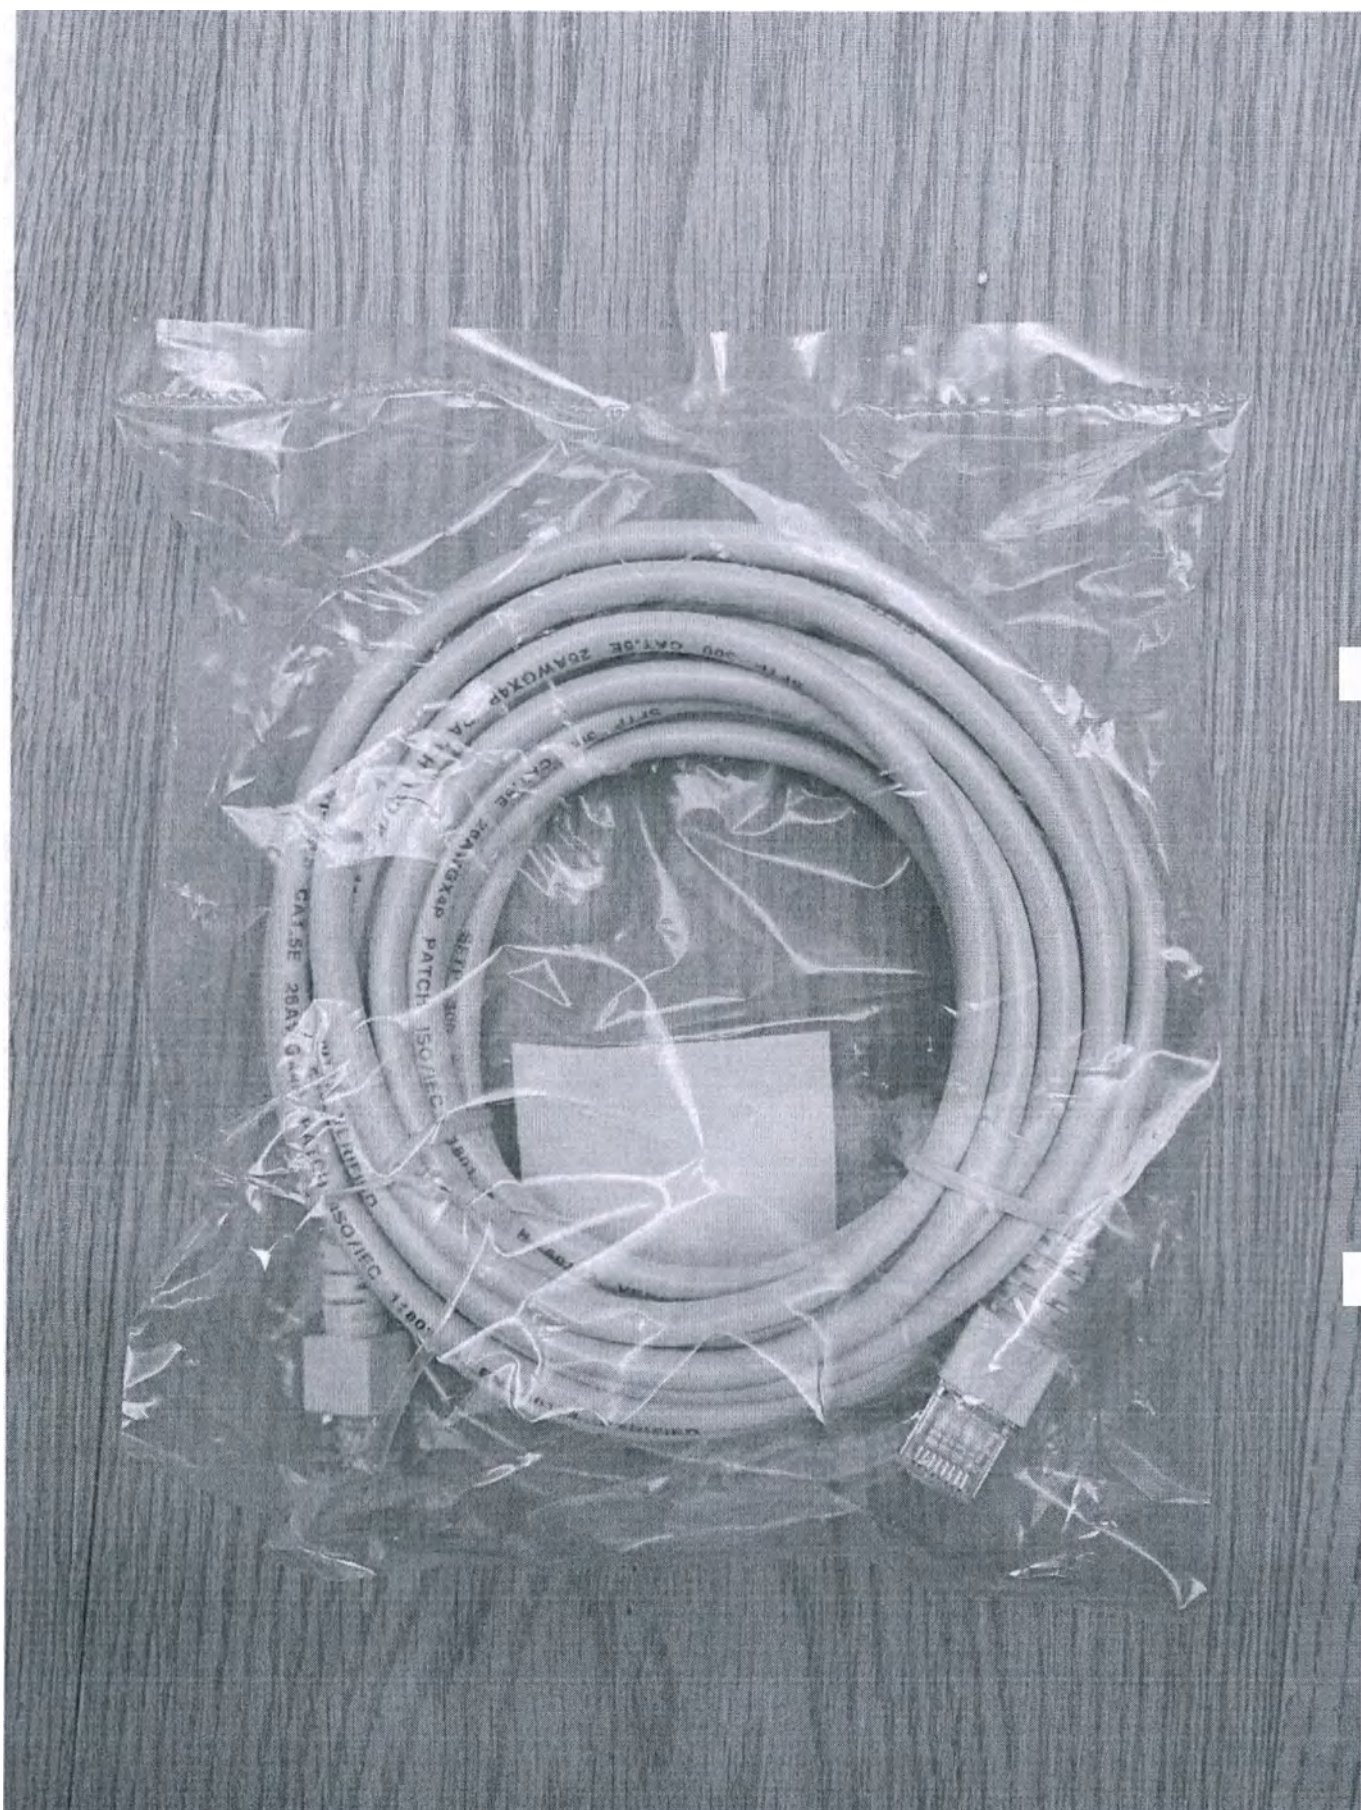


Кабель для подключения к сети

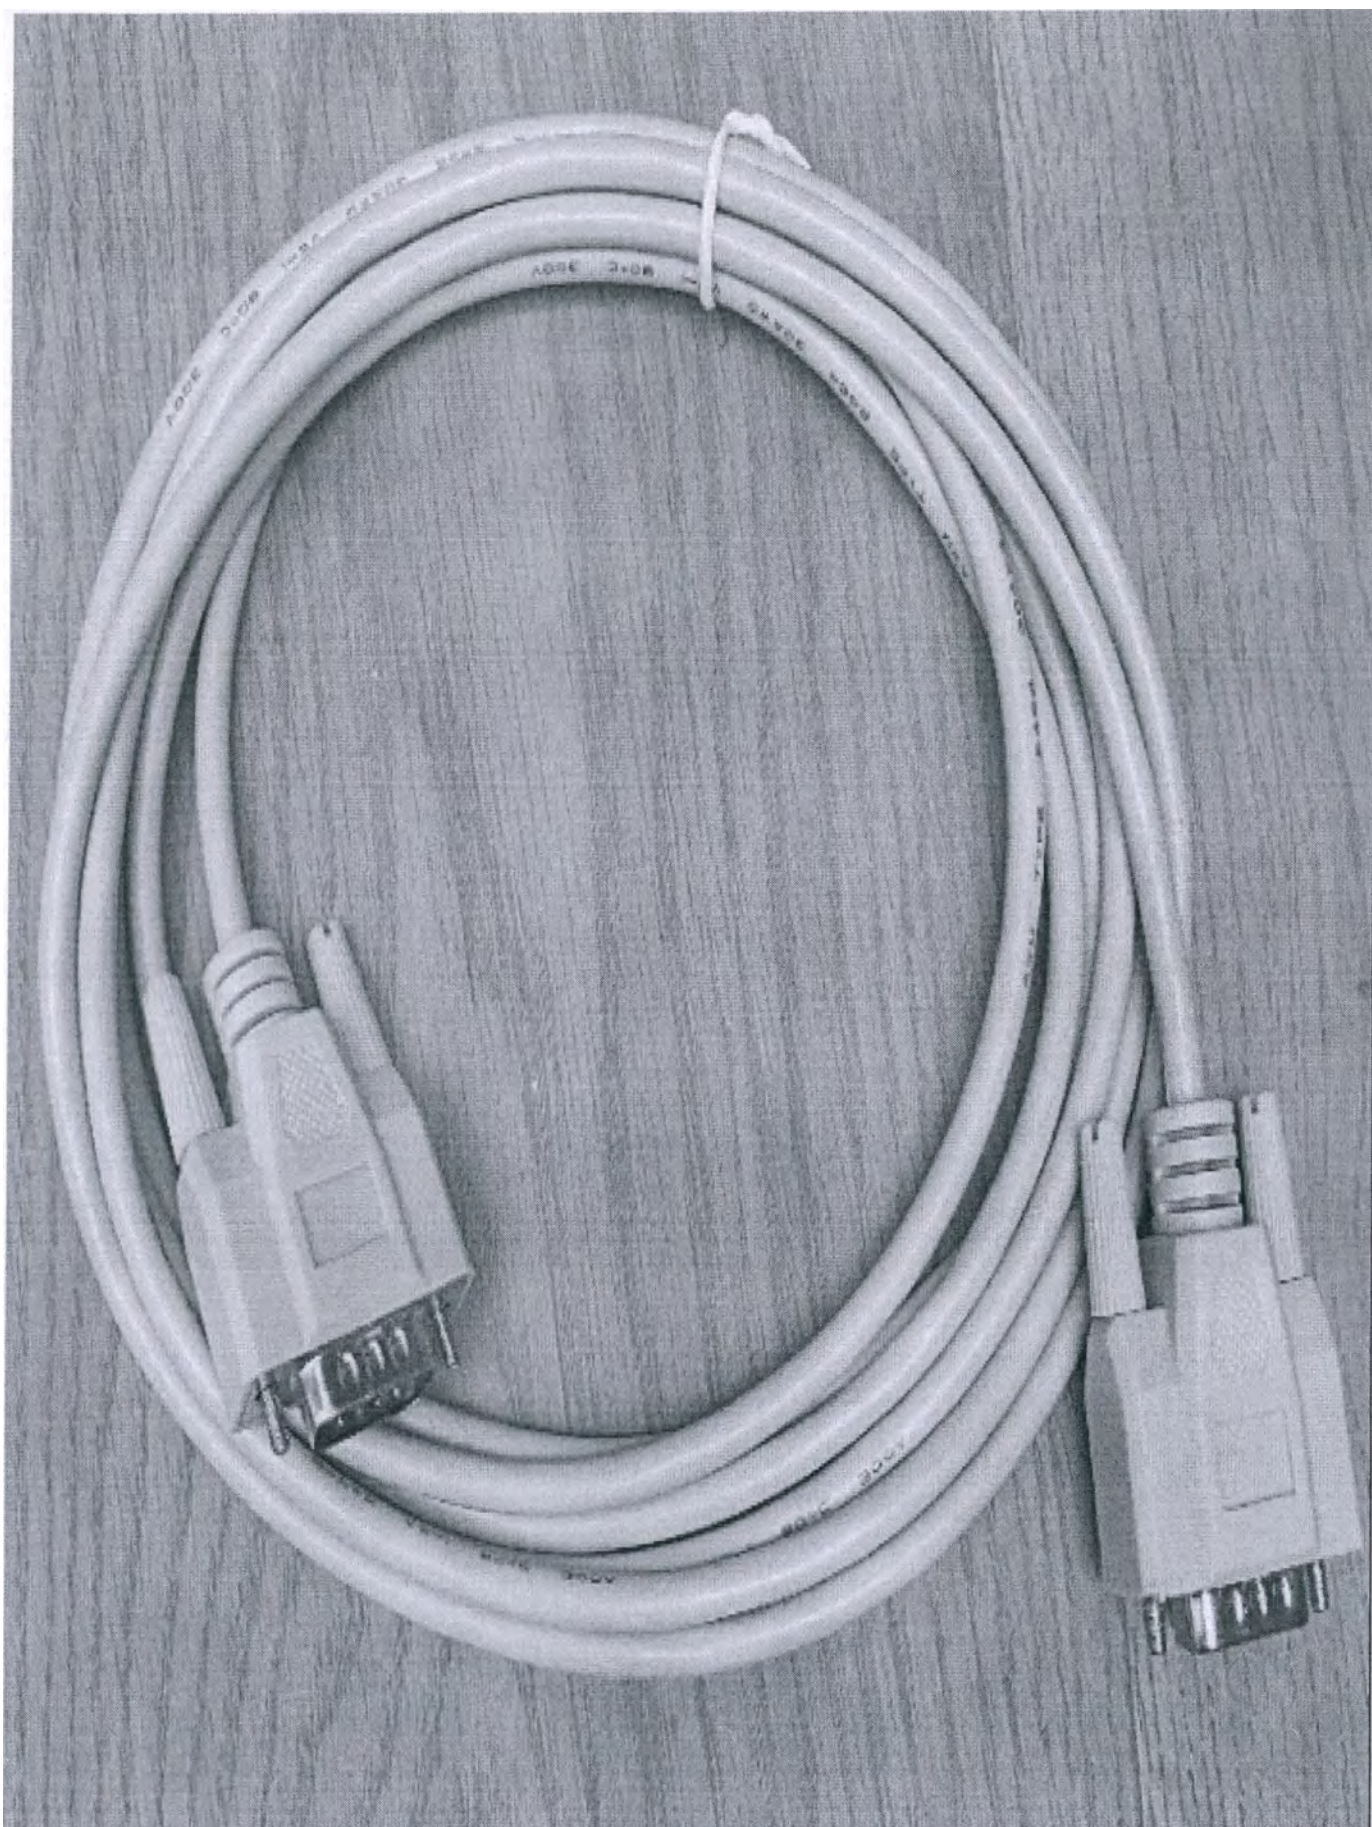


Кабель управления вытяжкой Ceramill Airstream

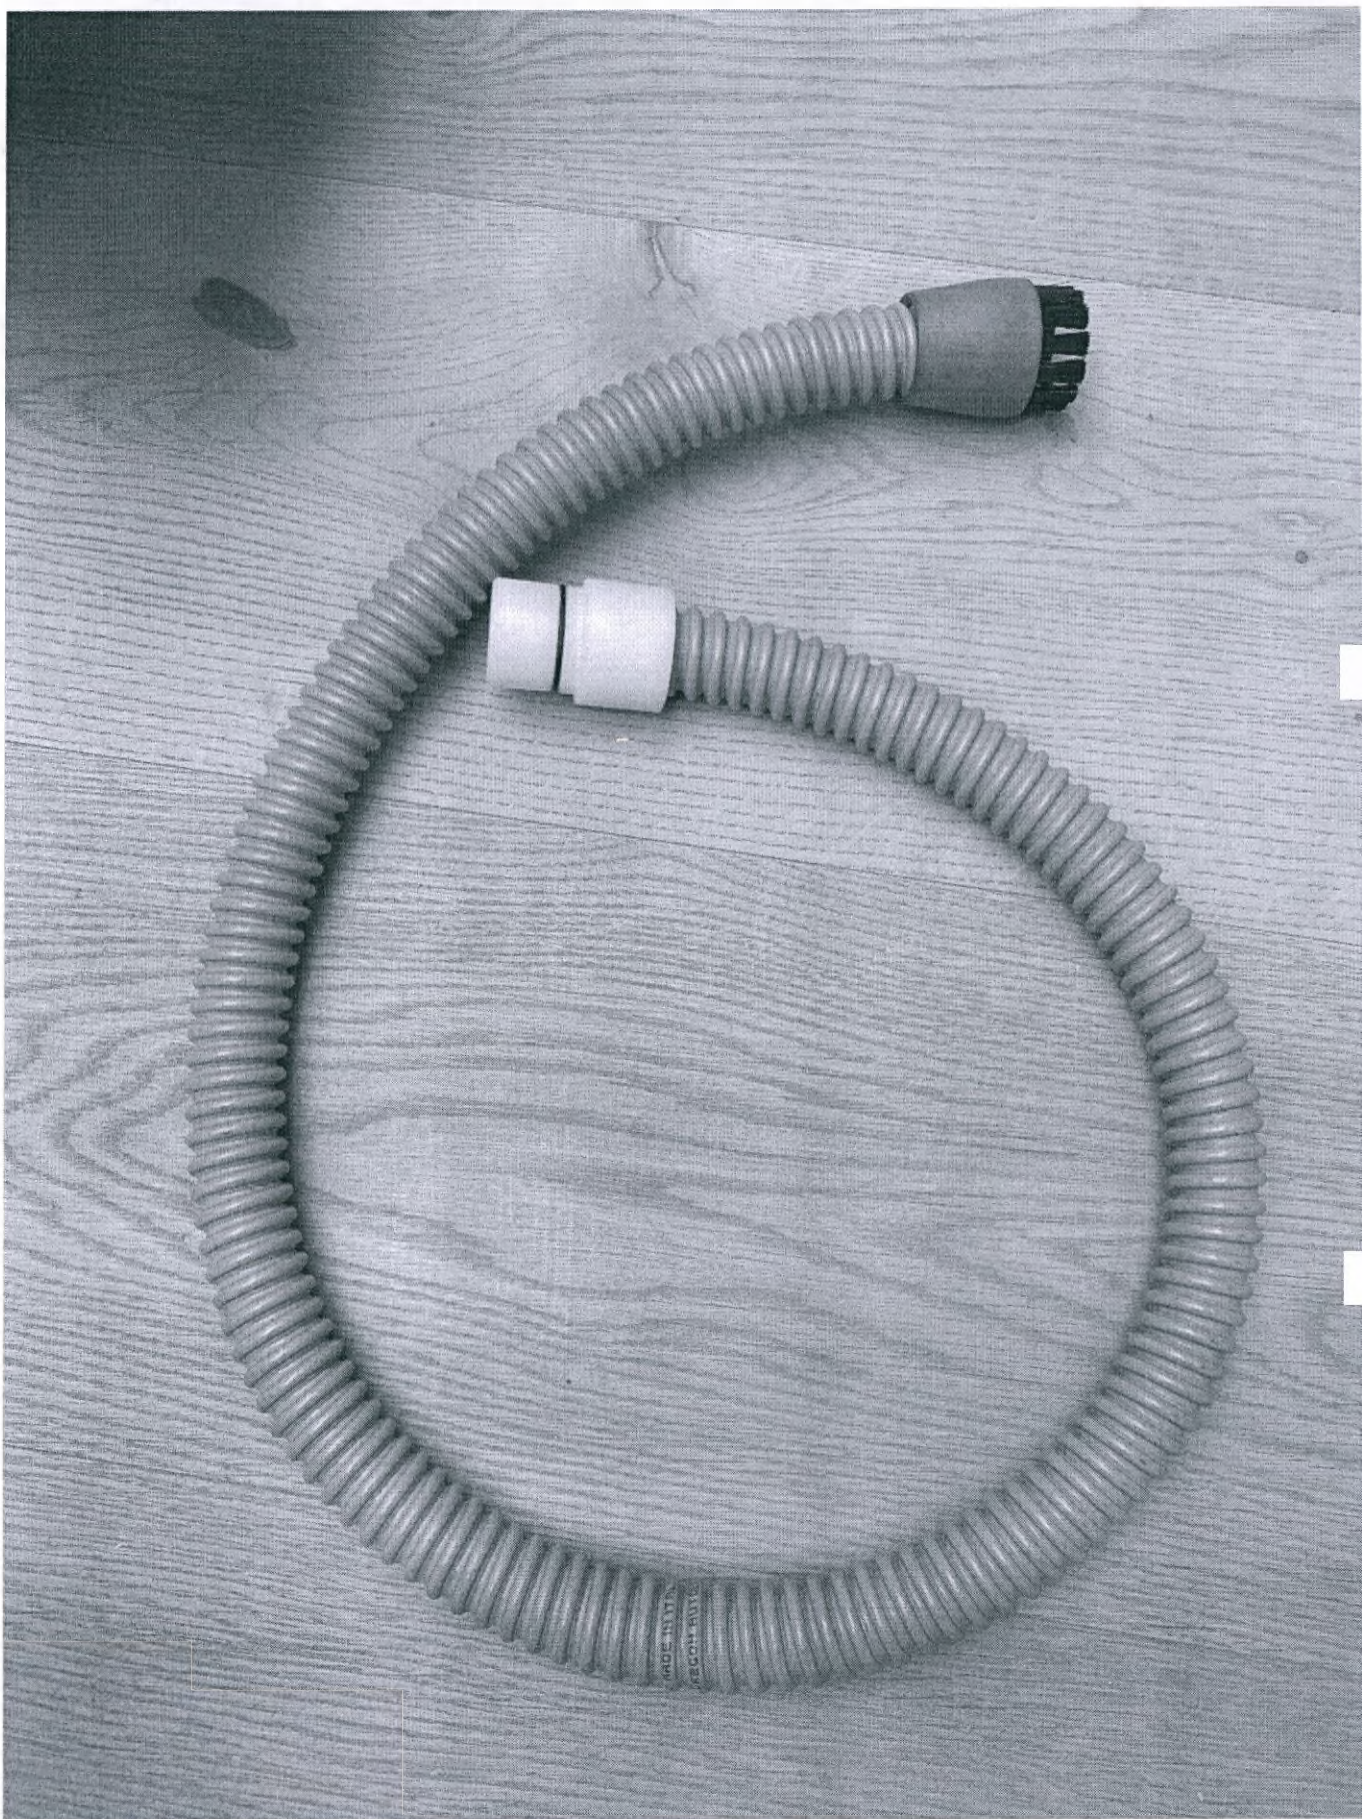


Шланг для очистки с щёткой

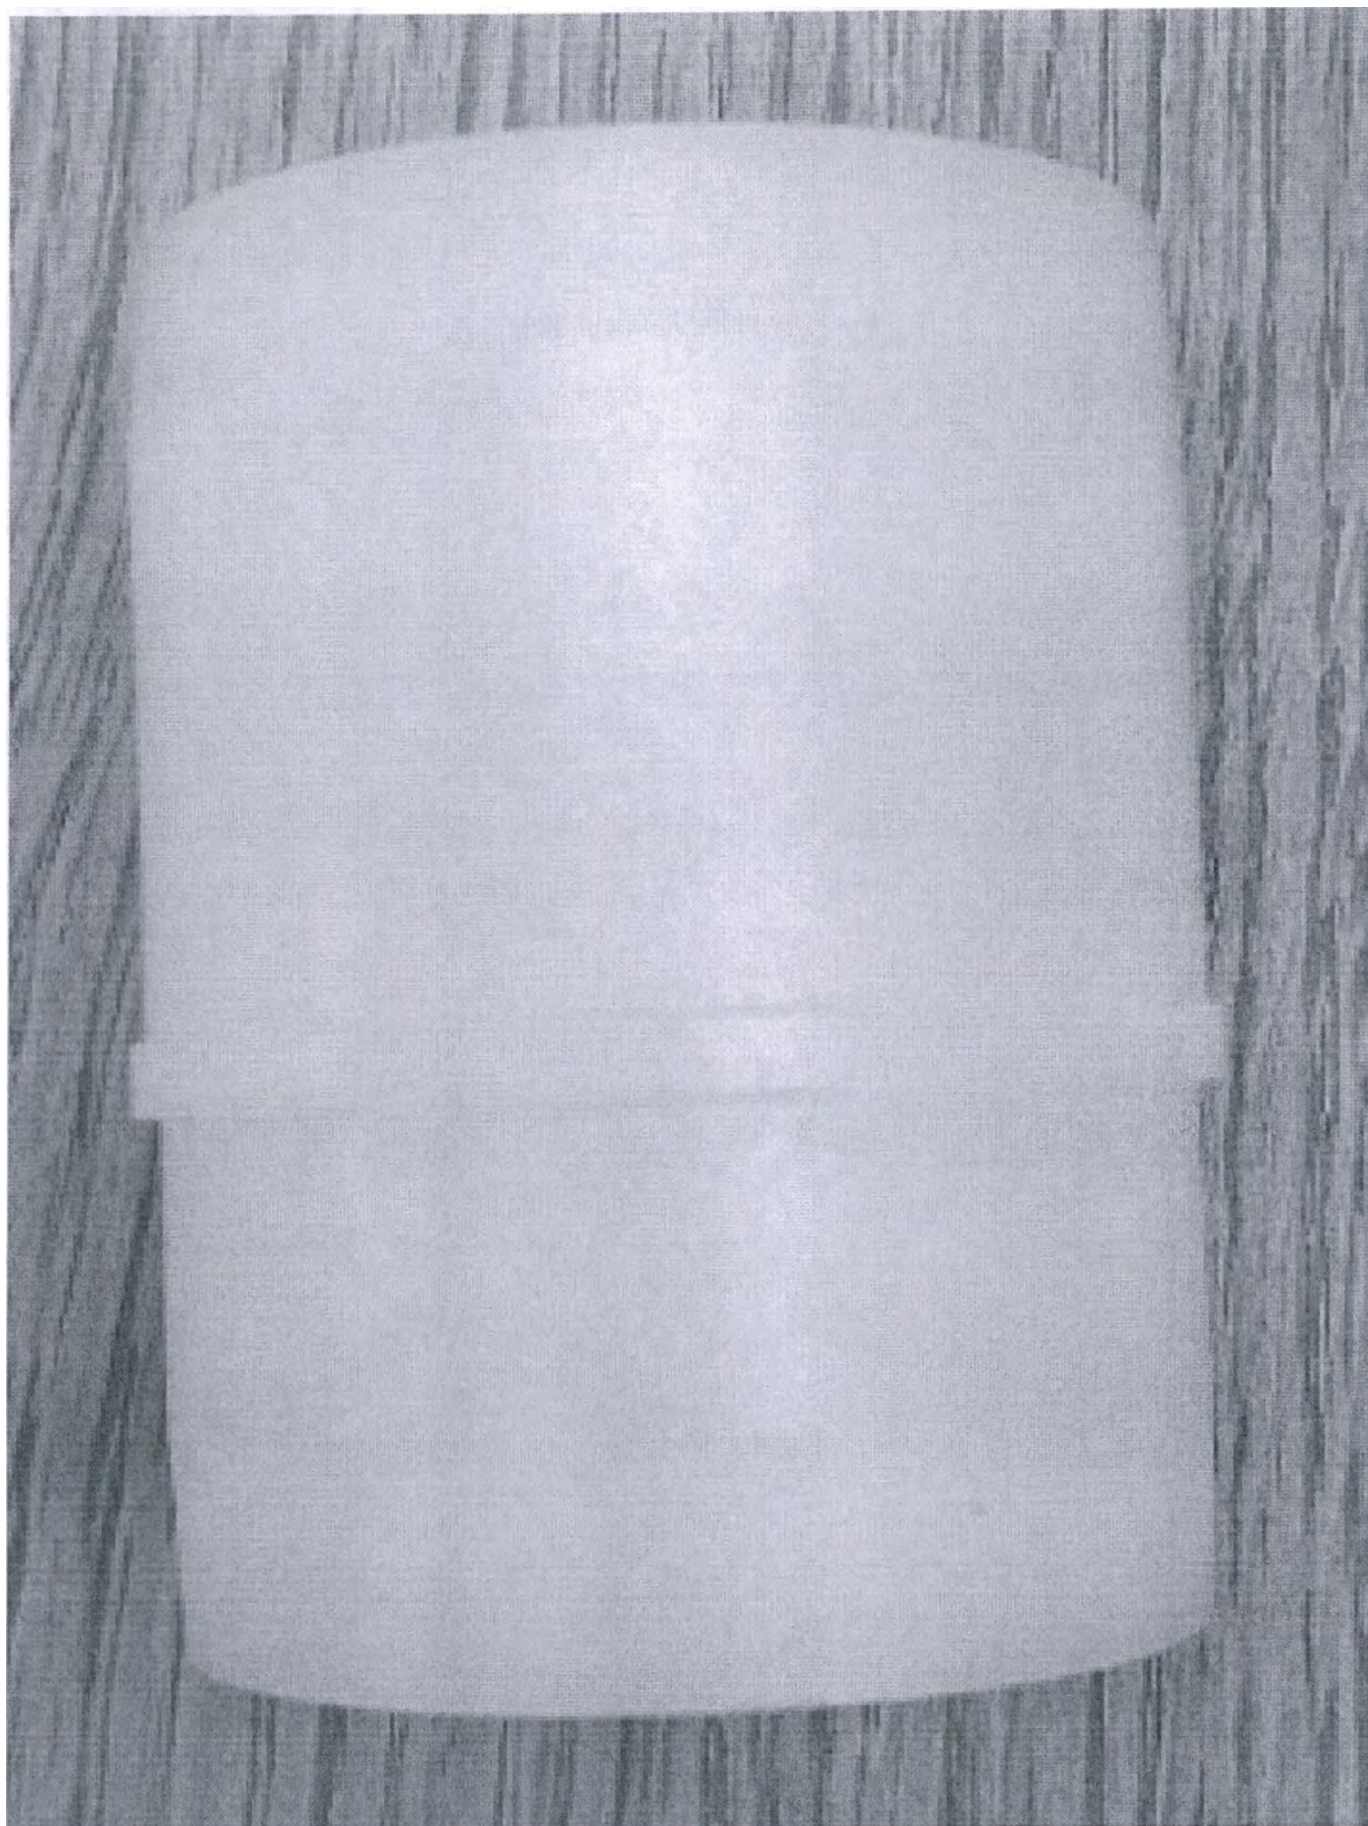

Переходник для подключения Ceramill Airstream

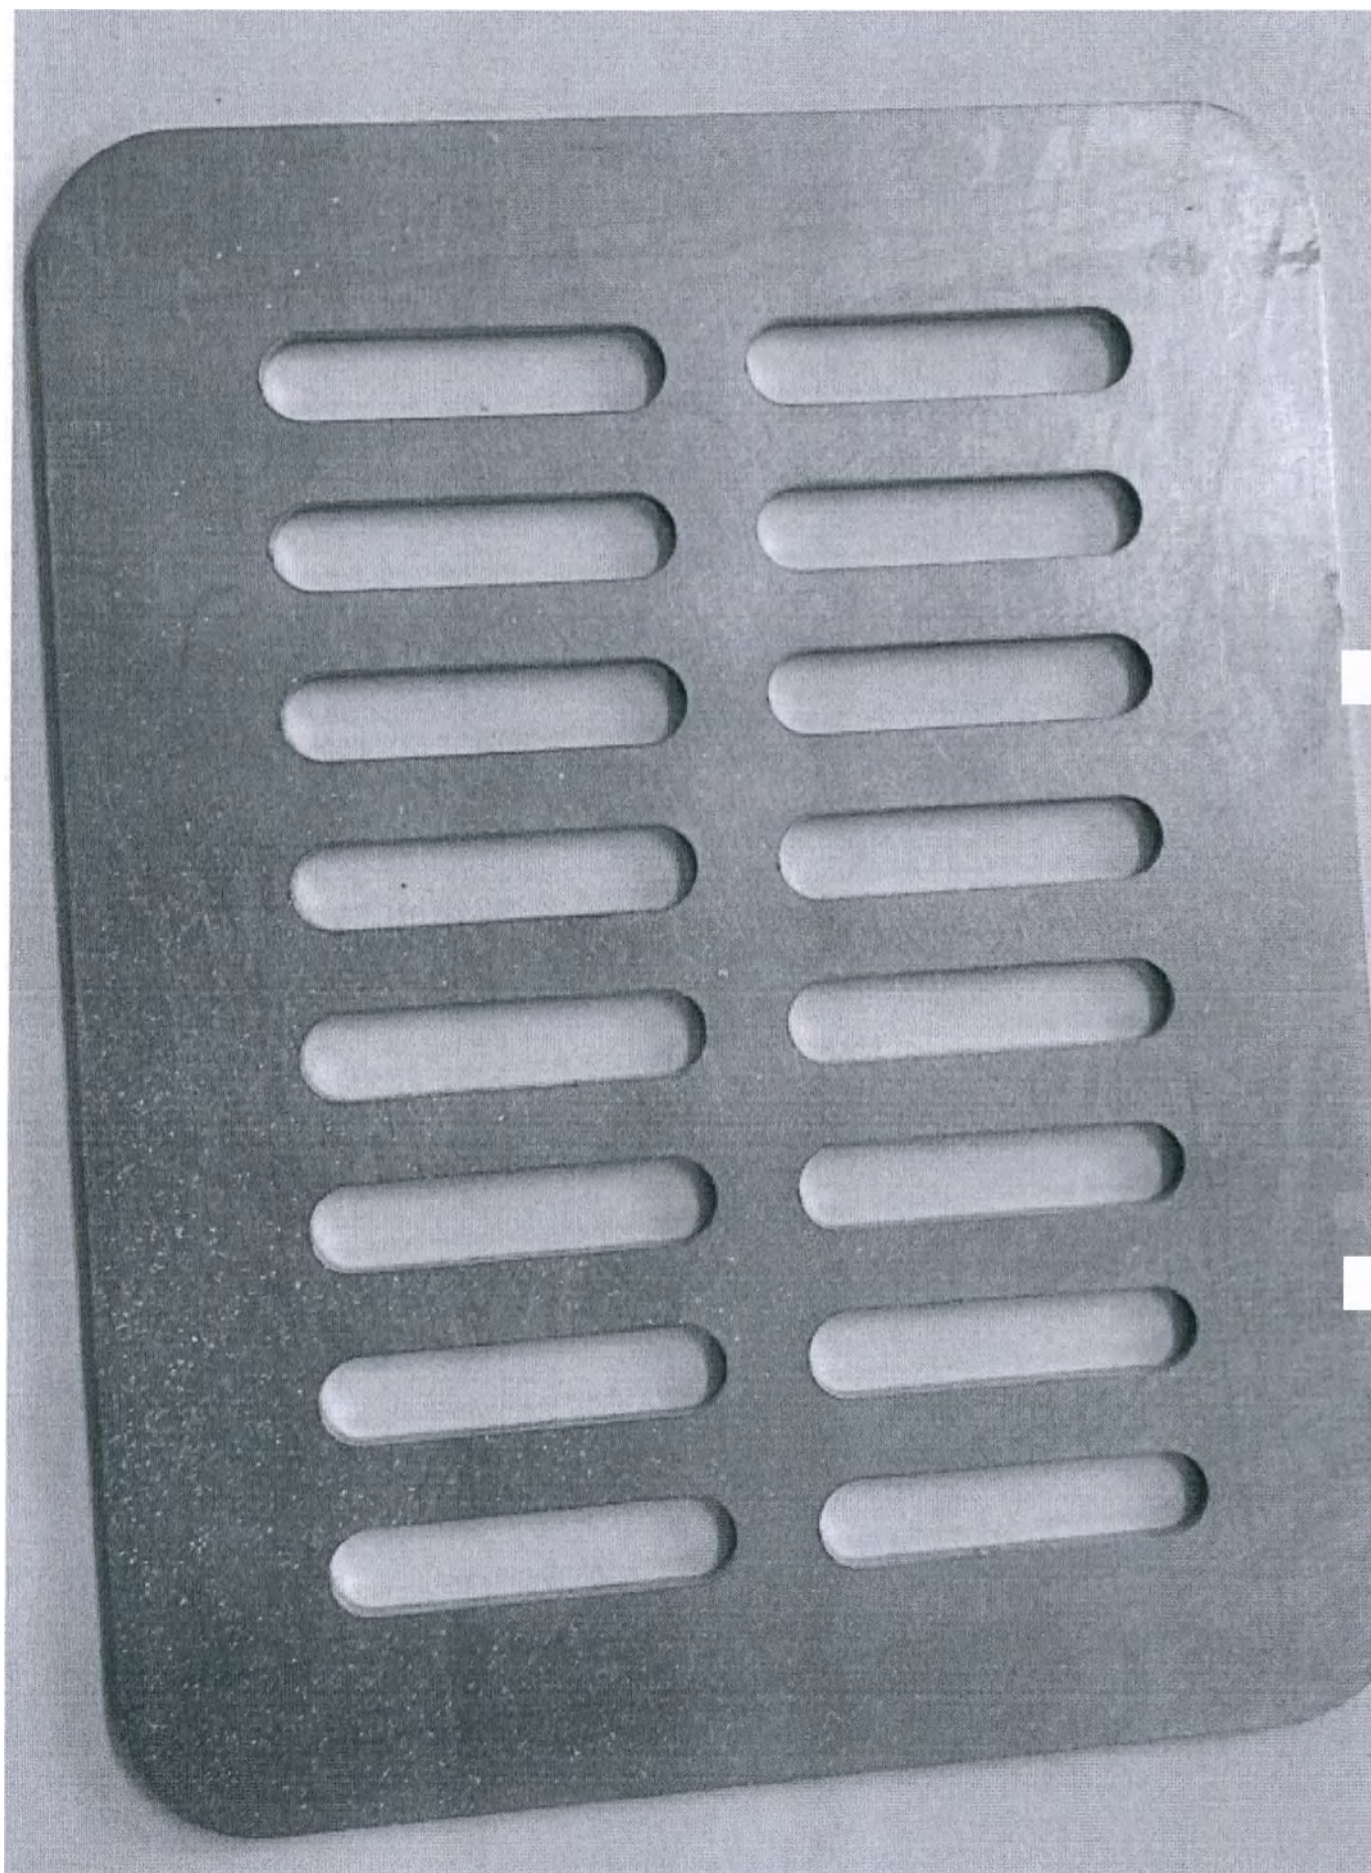

Решётка слива

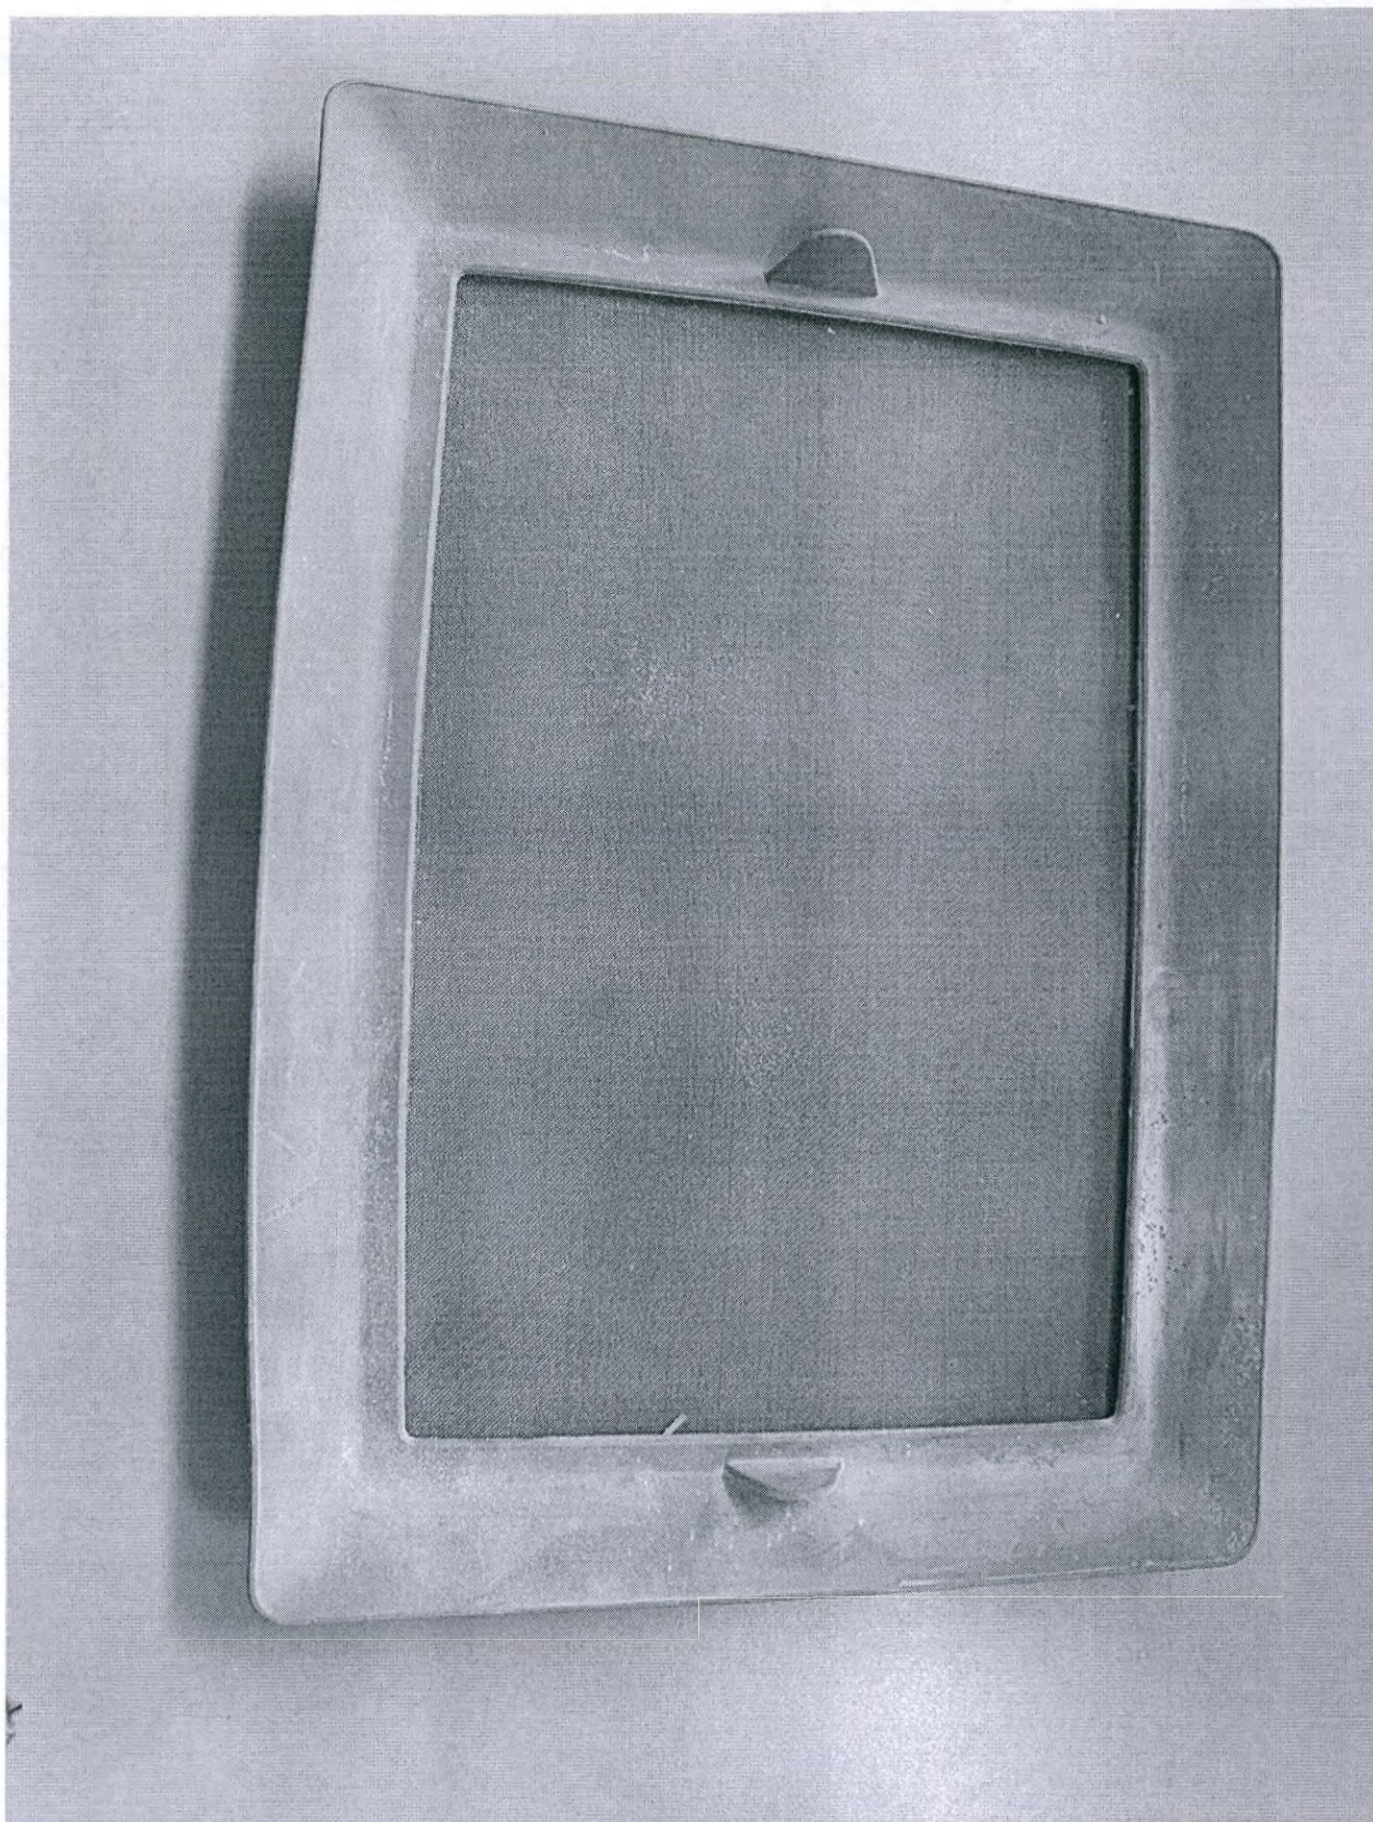

Сито для слива


Transcend

LOCK ▼



8GB


Карта памяти SD

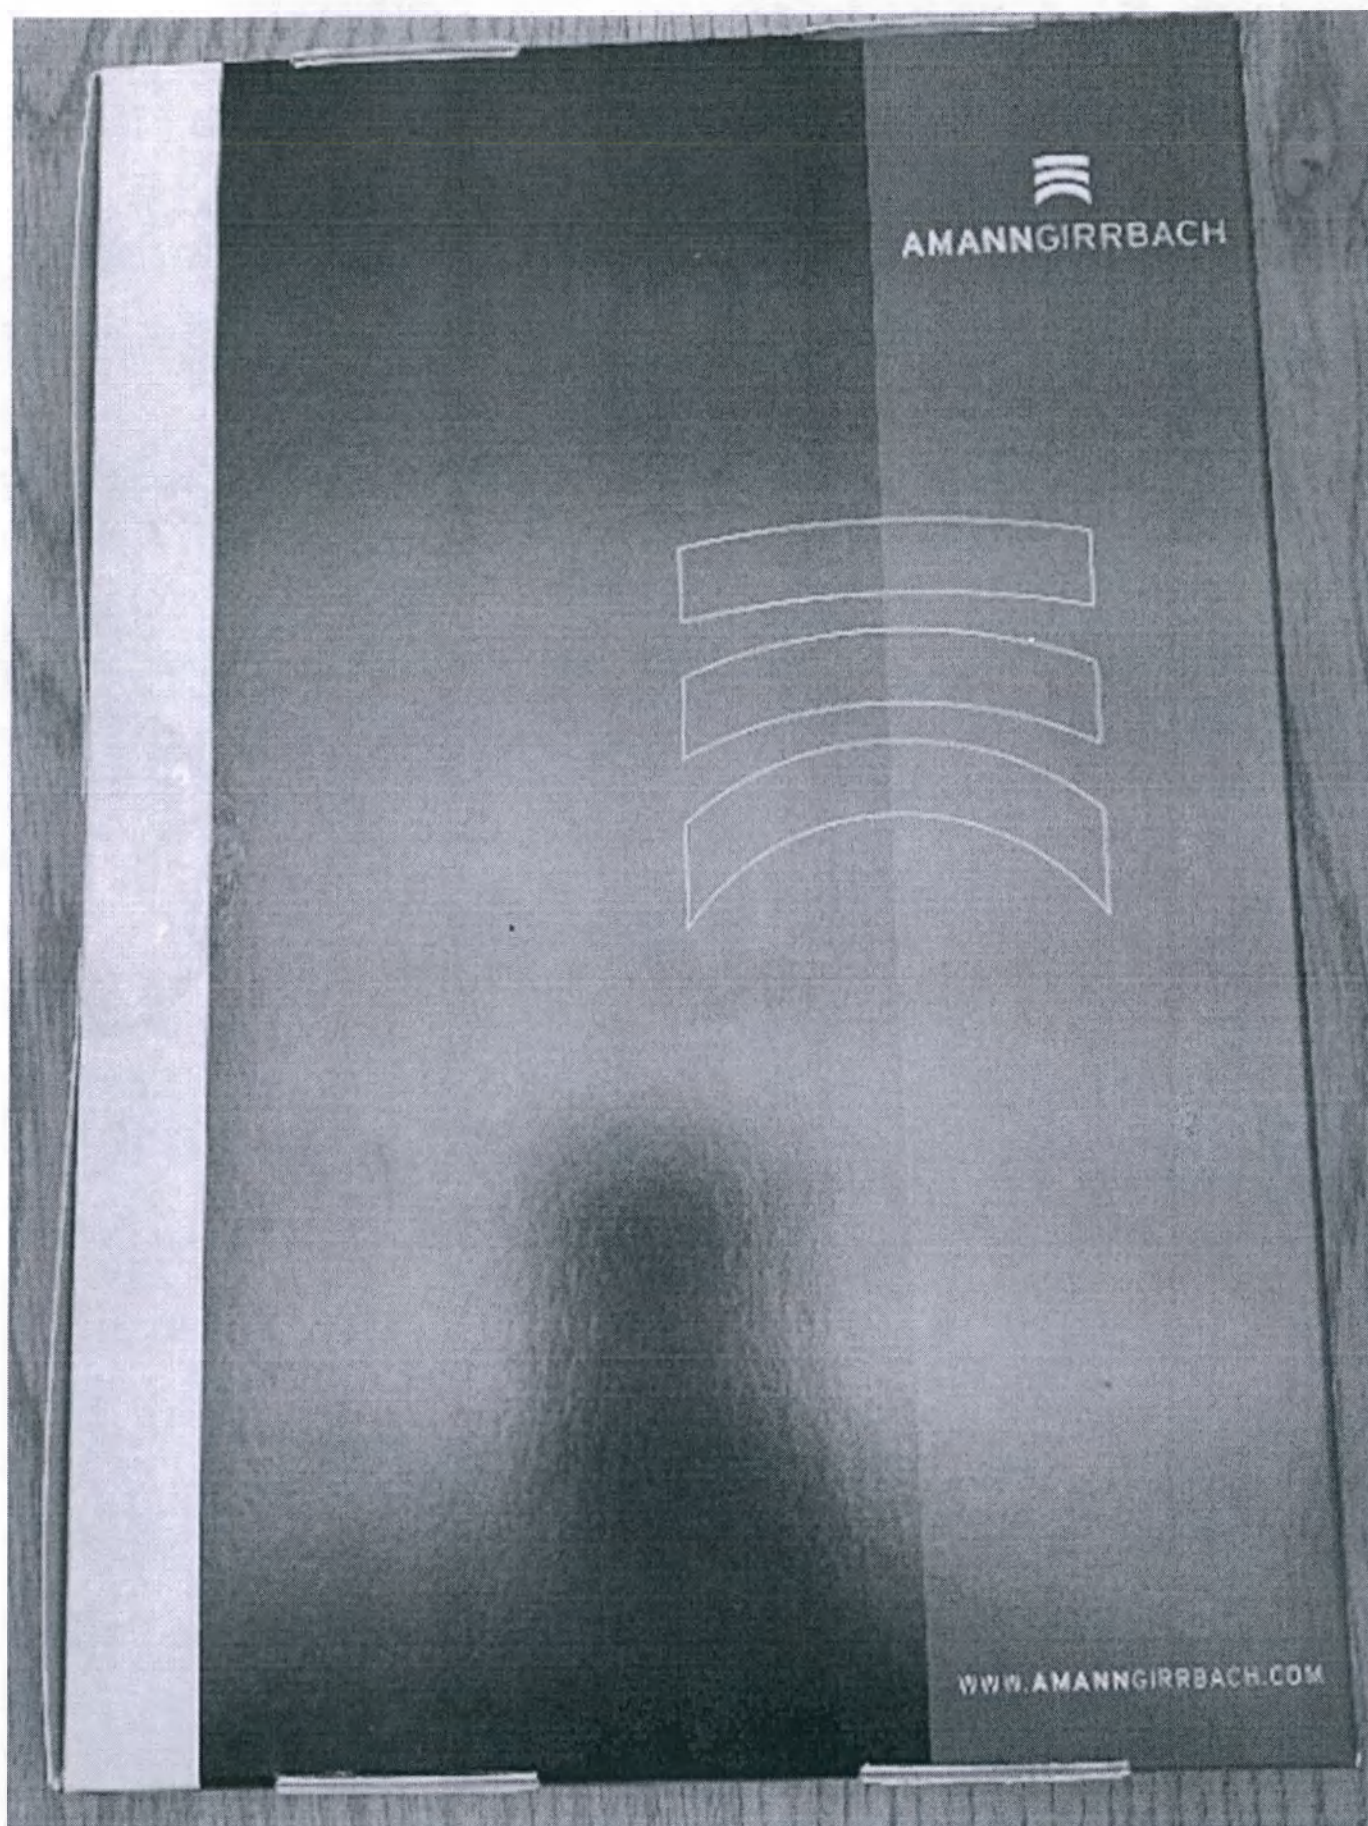


Программное обеспечение на CD диске



Сервисный набор для шпинделя Jäger

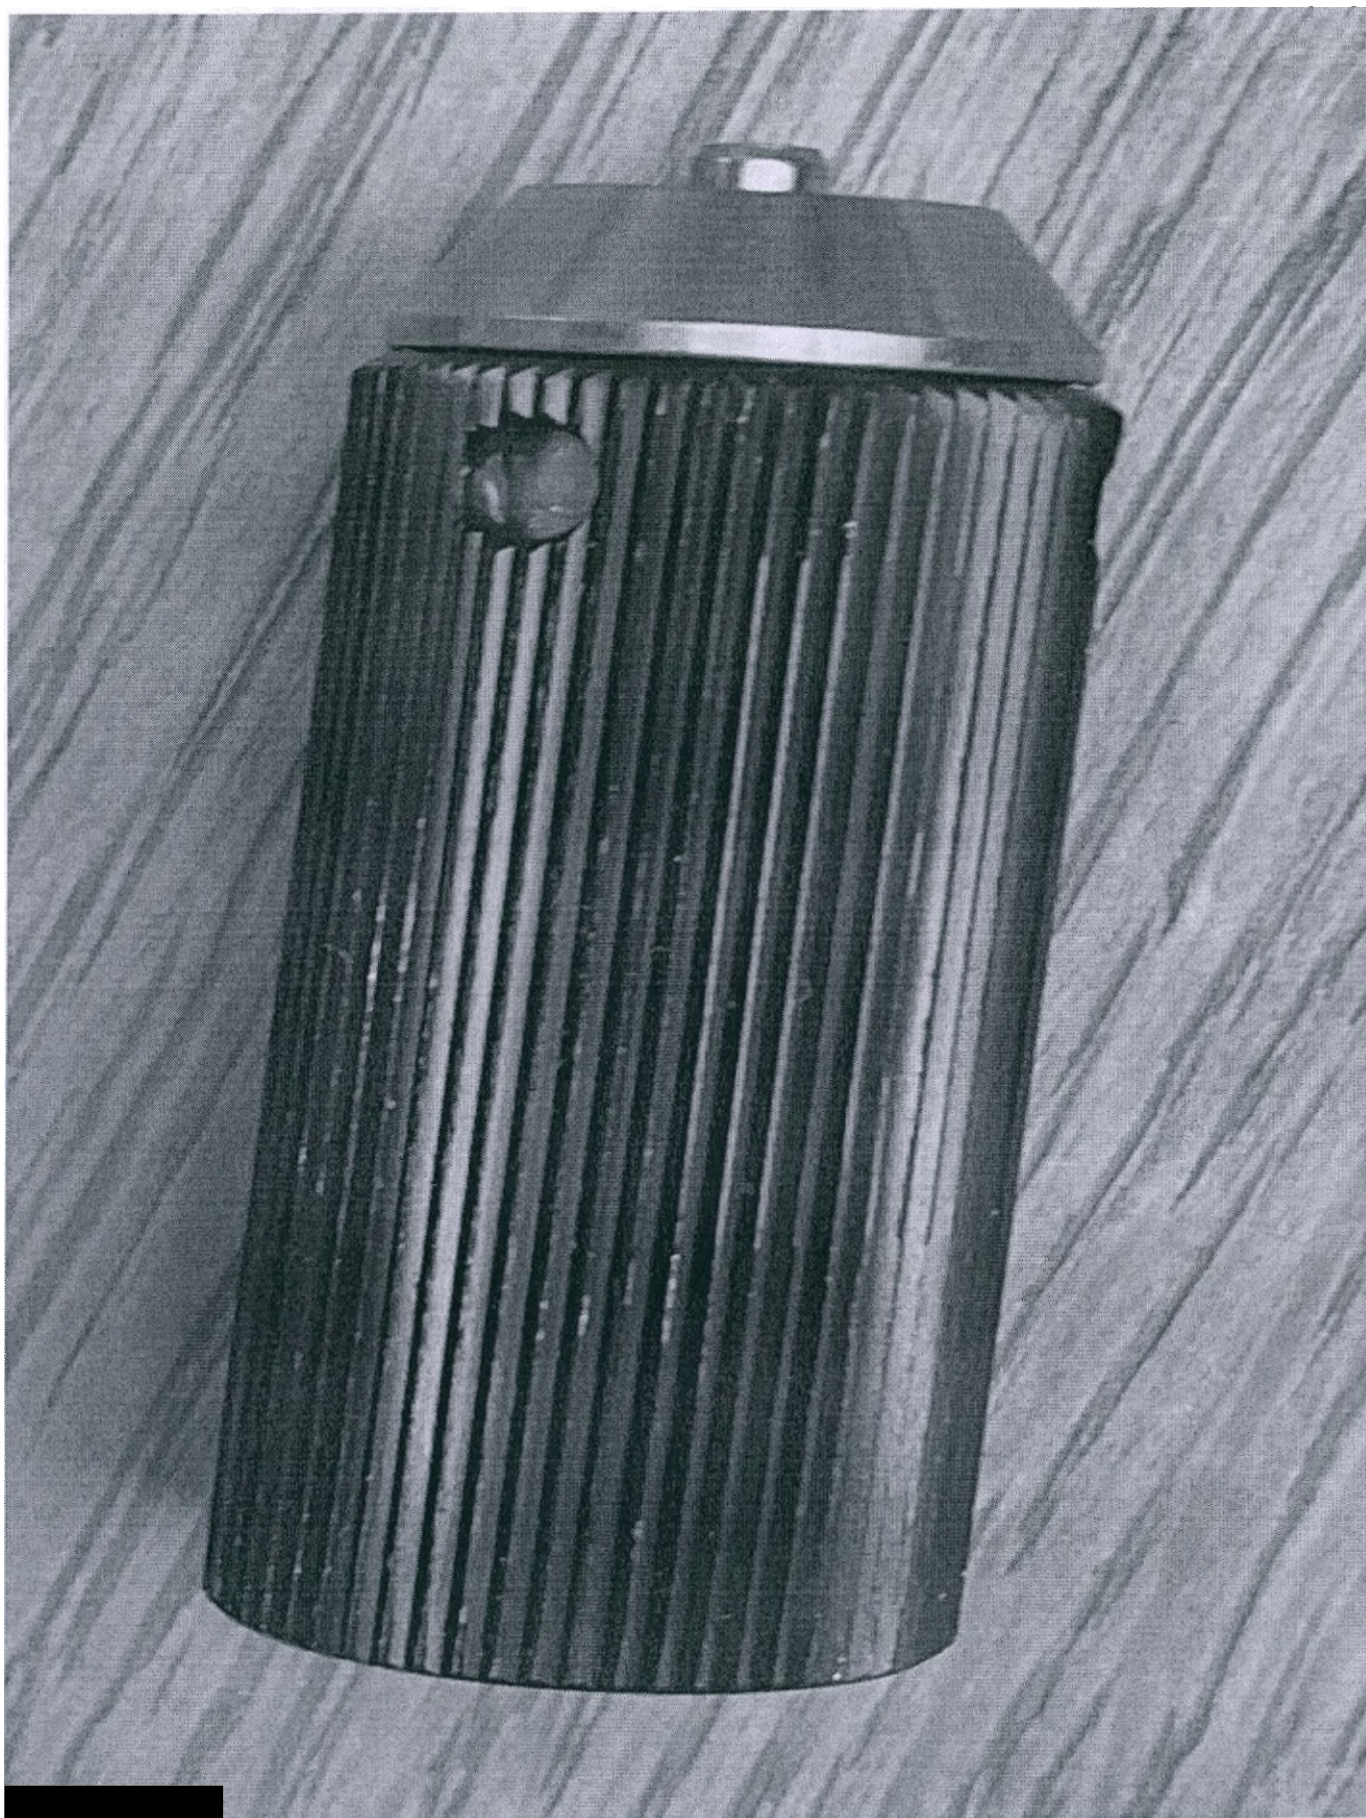


Ключ для цанги

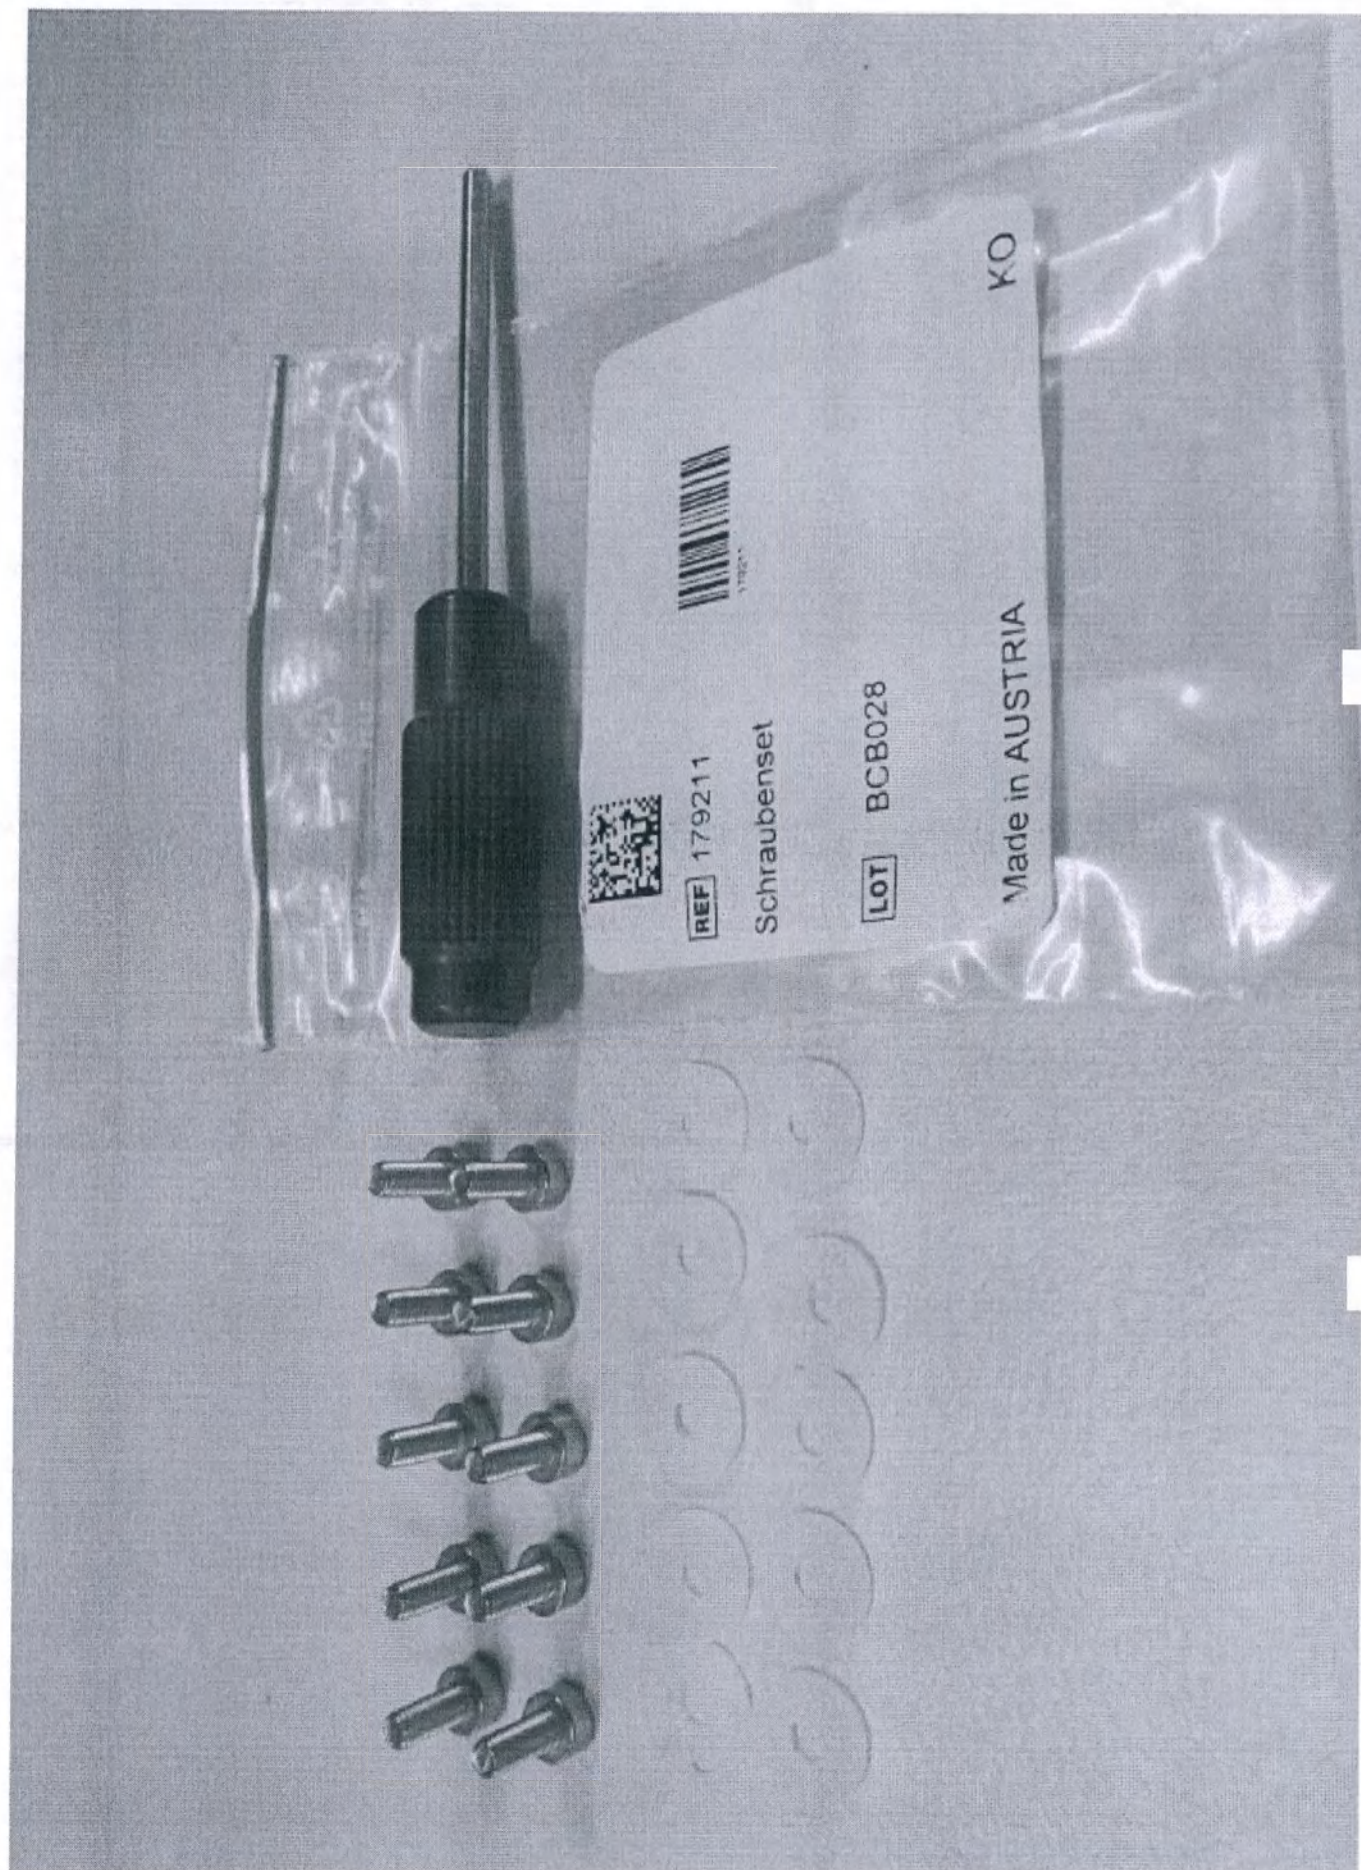


Набор для техобслуживания





Предохранитель Т 3,15 А
Предохранитель Т 6,3 А

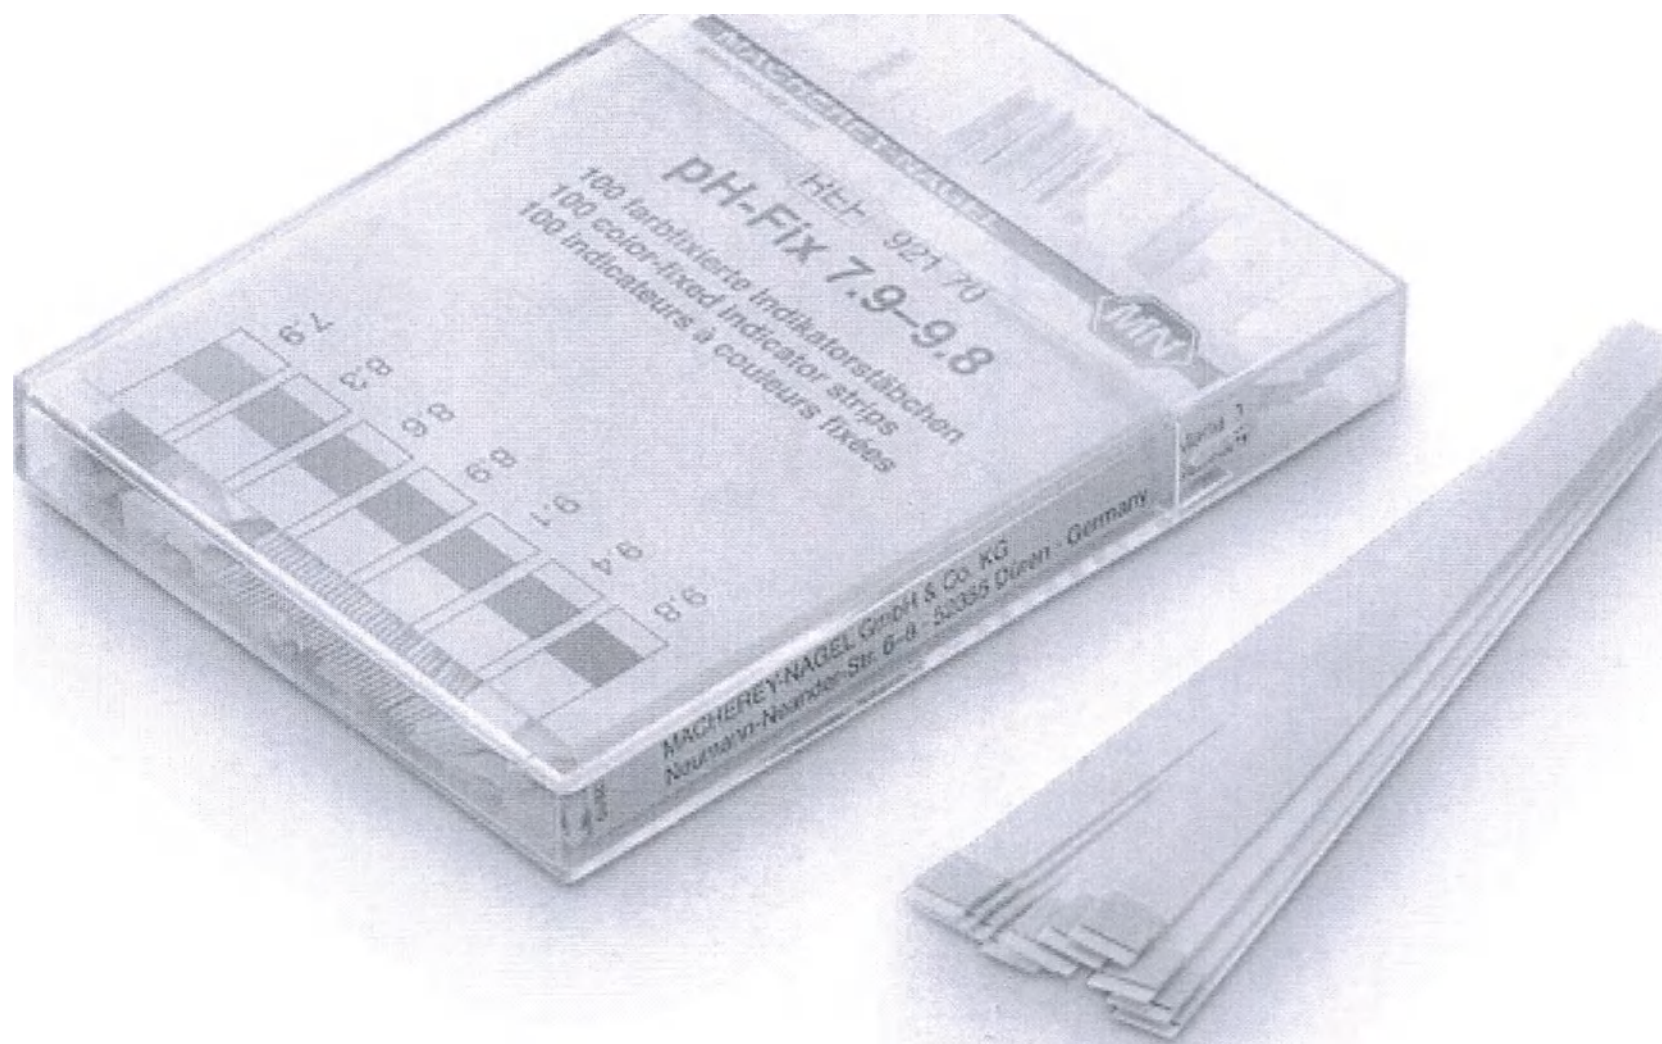

Тест на многофункциональные добавки

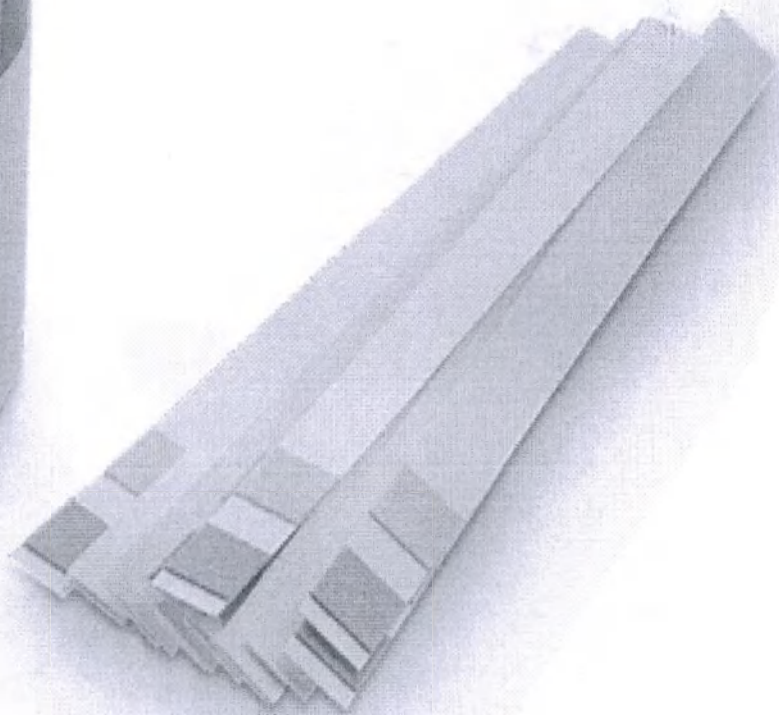


Тест pH показатель

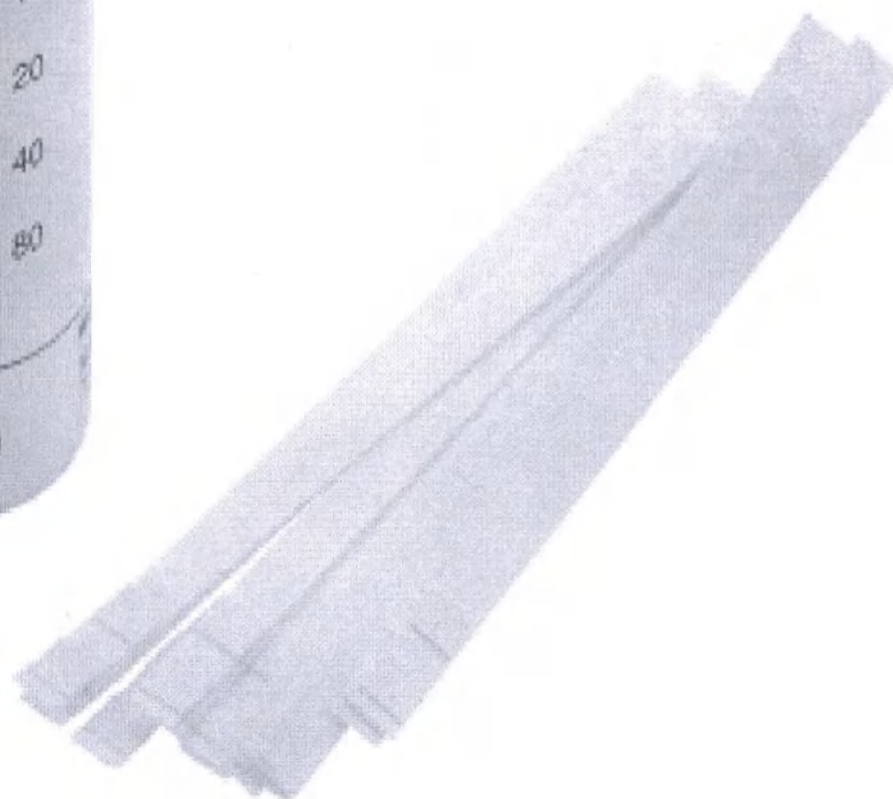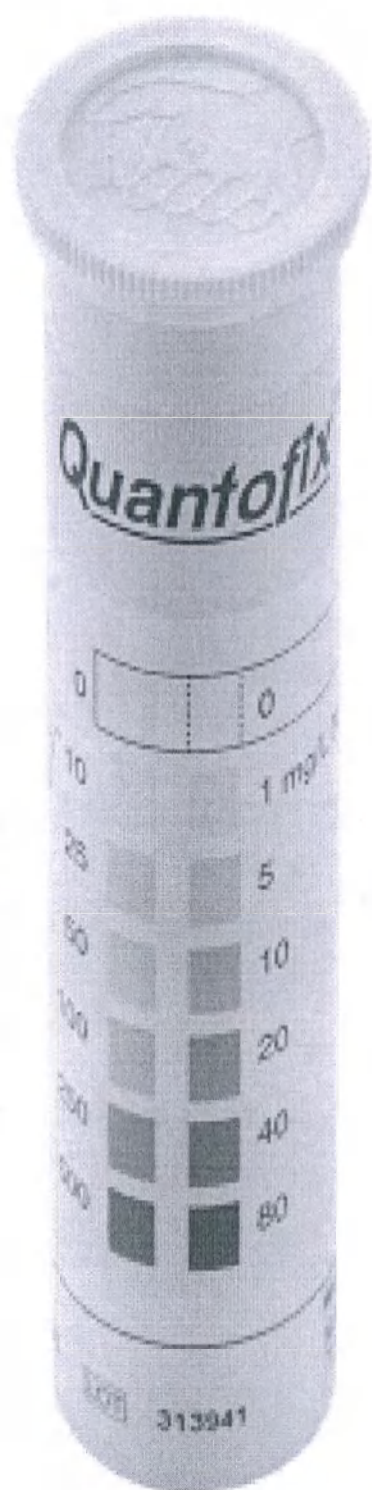


Тест на нитраты




Динамометрический отвёртка со сменяемой насадкой

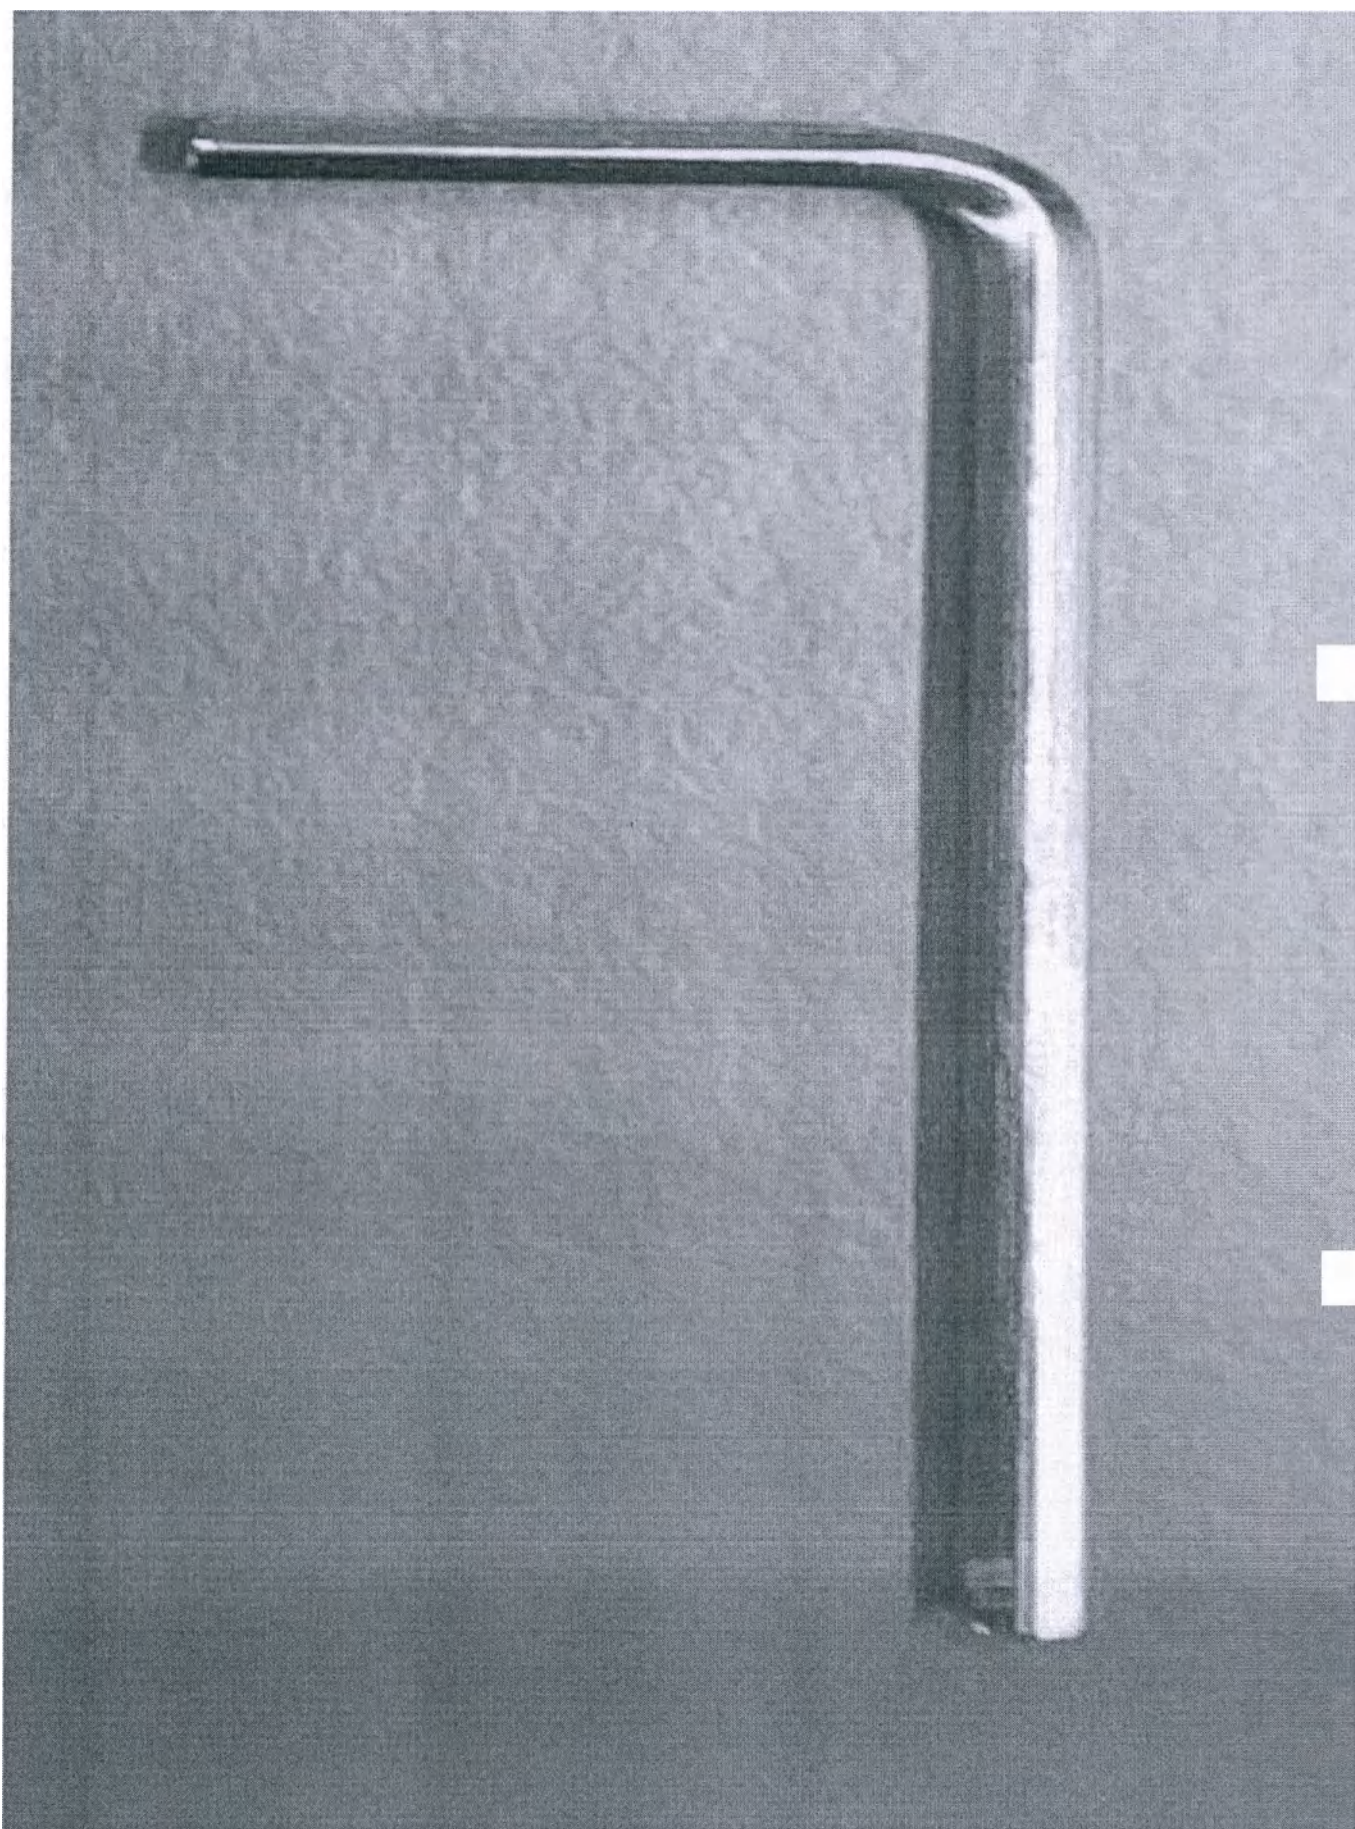


Шестигранный ключ

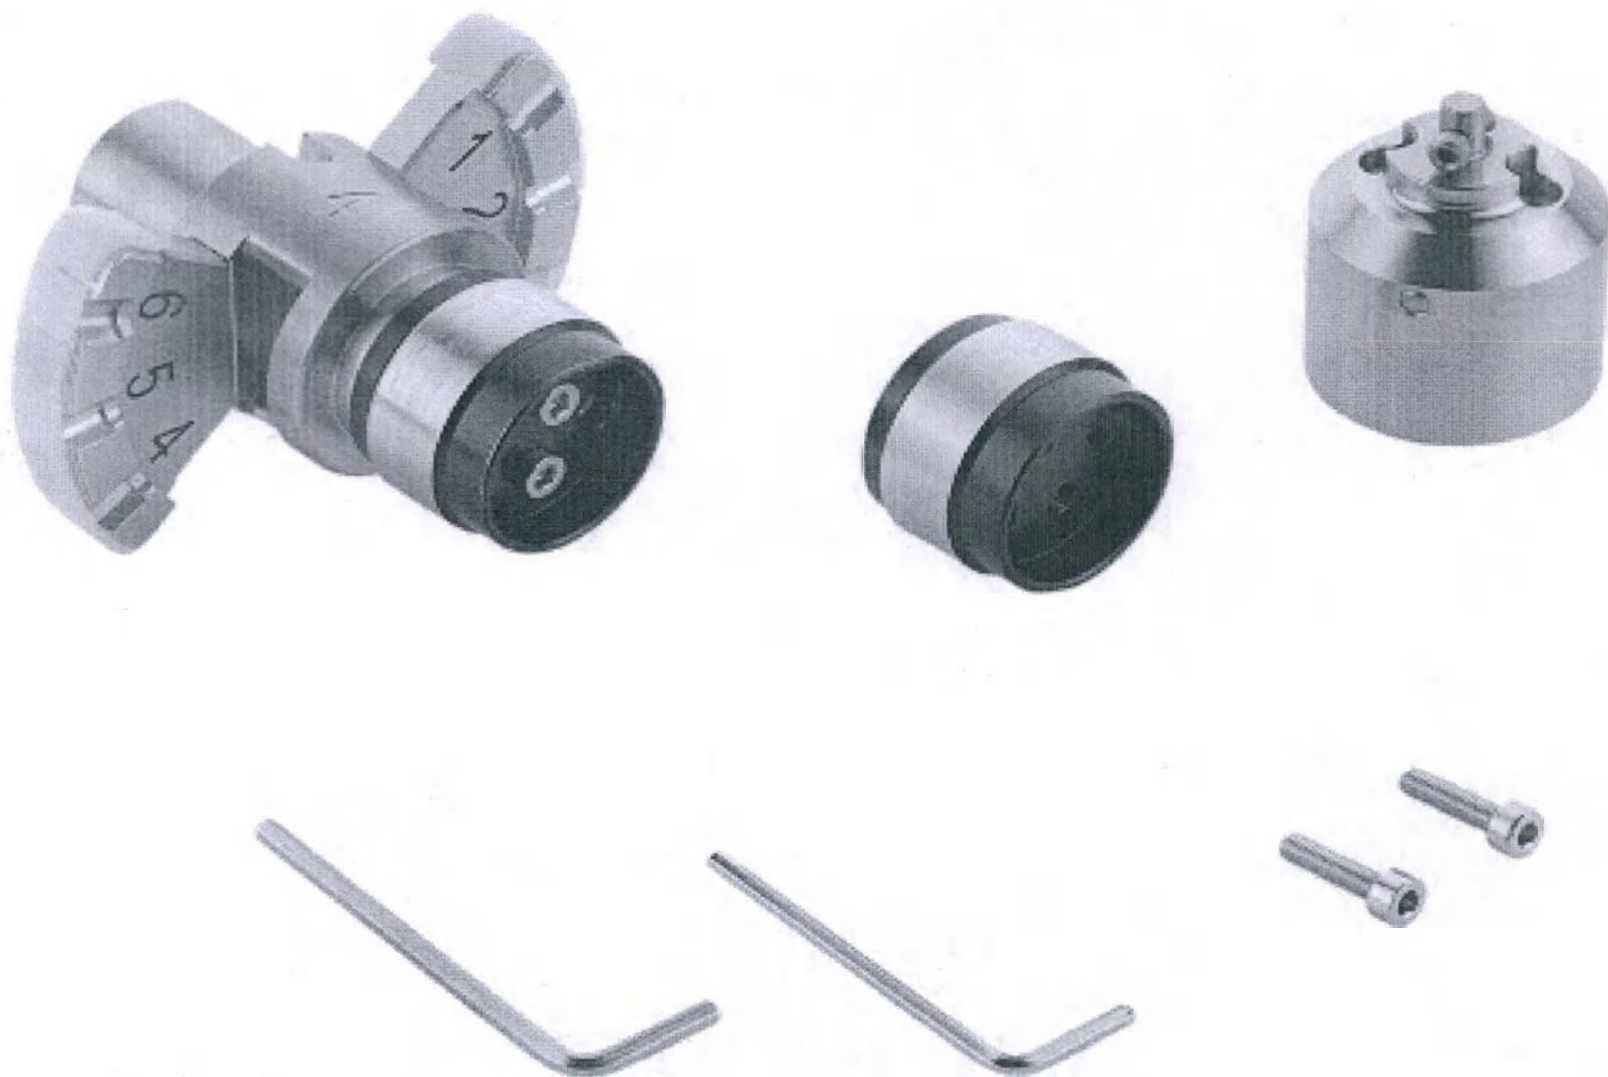

Держатель заготовок для ротационного фрезерования

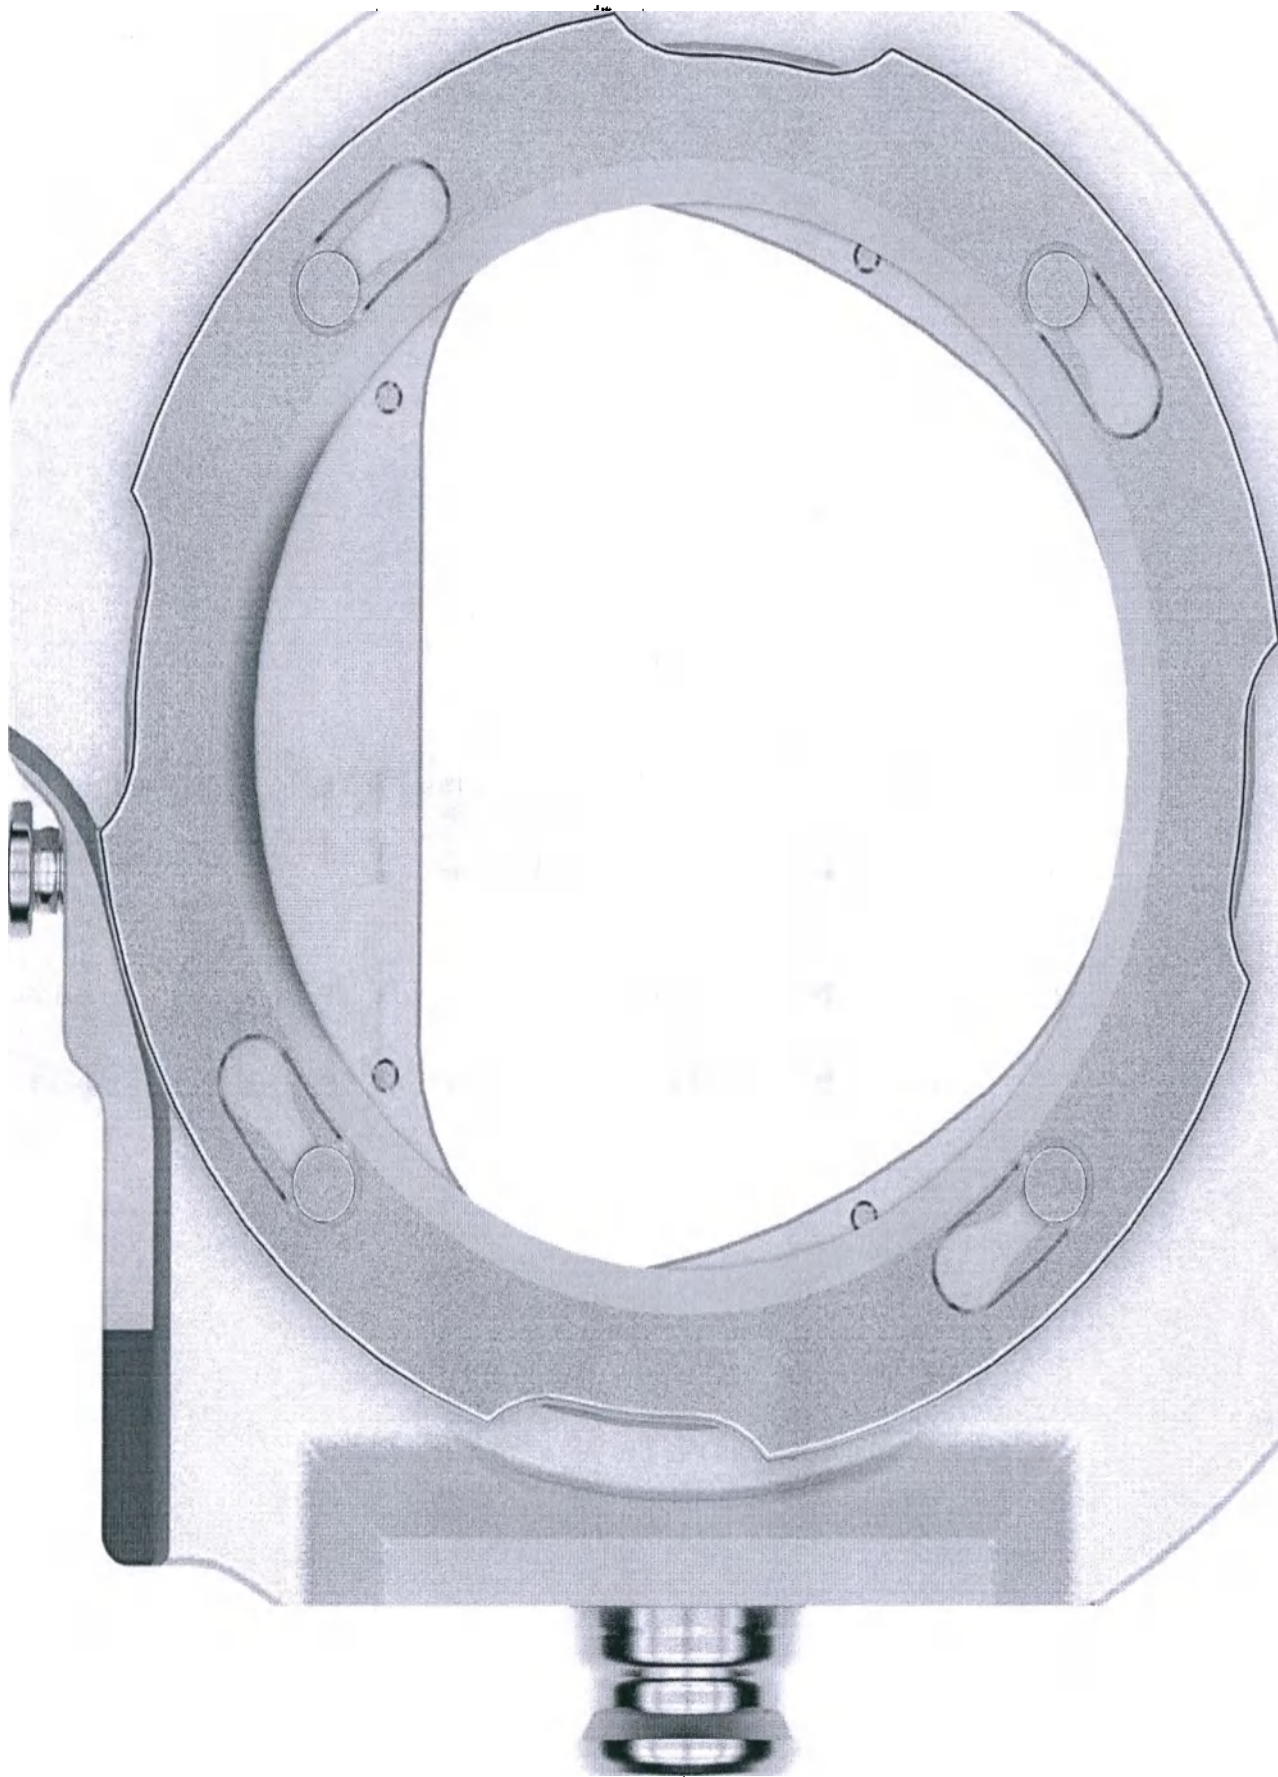


Держателей заготовок 71 181210

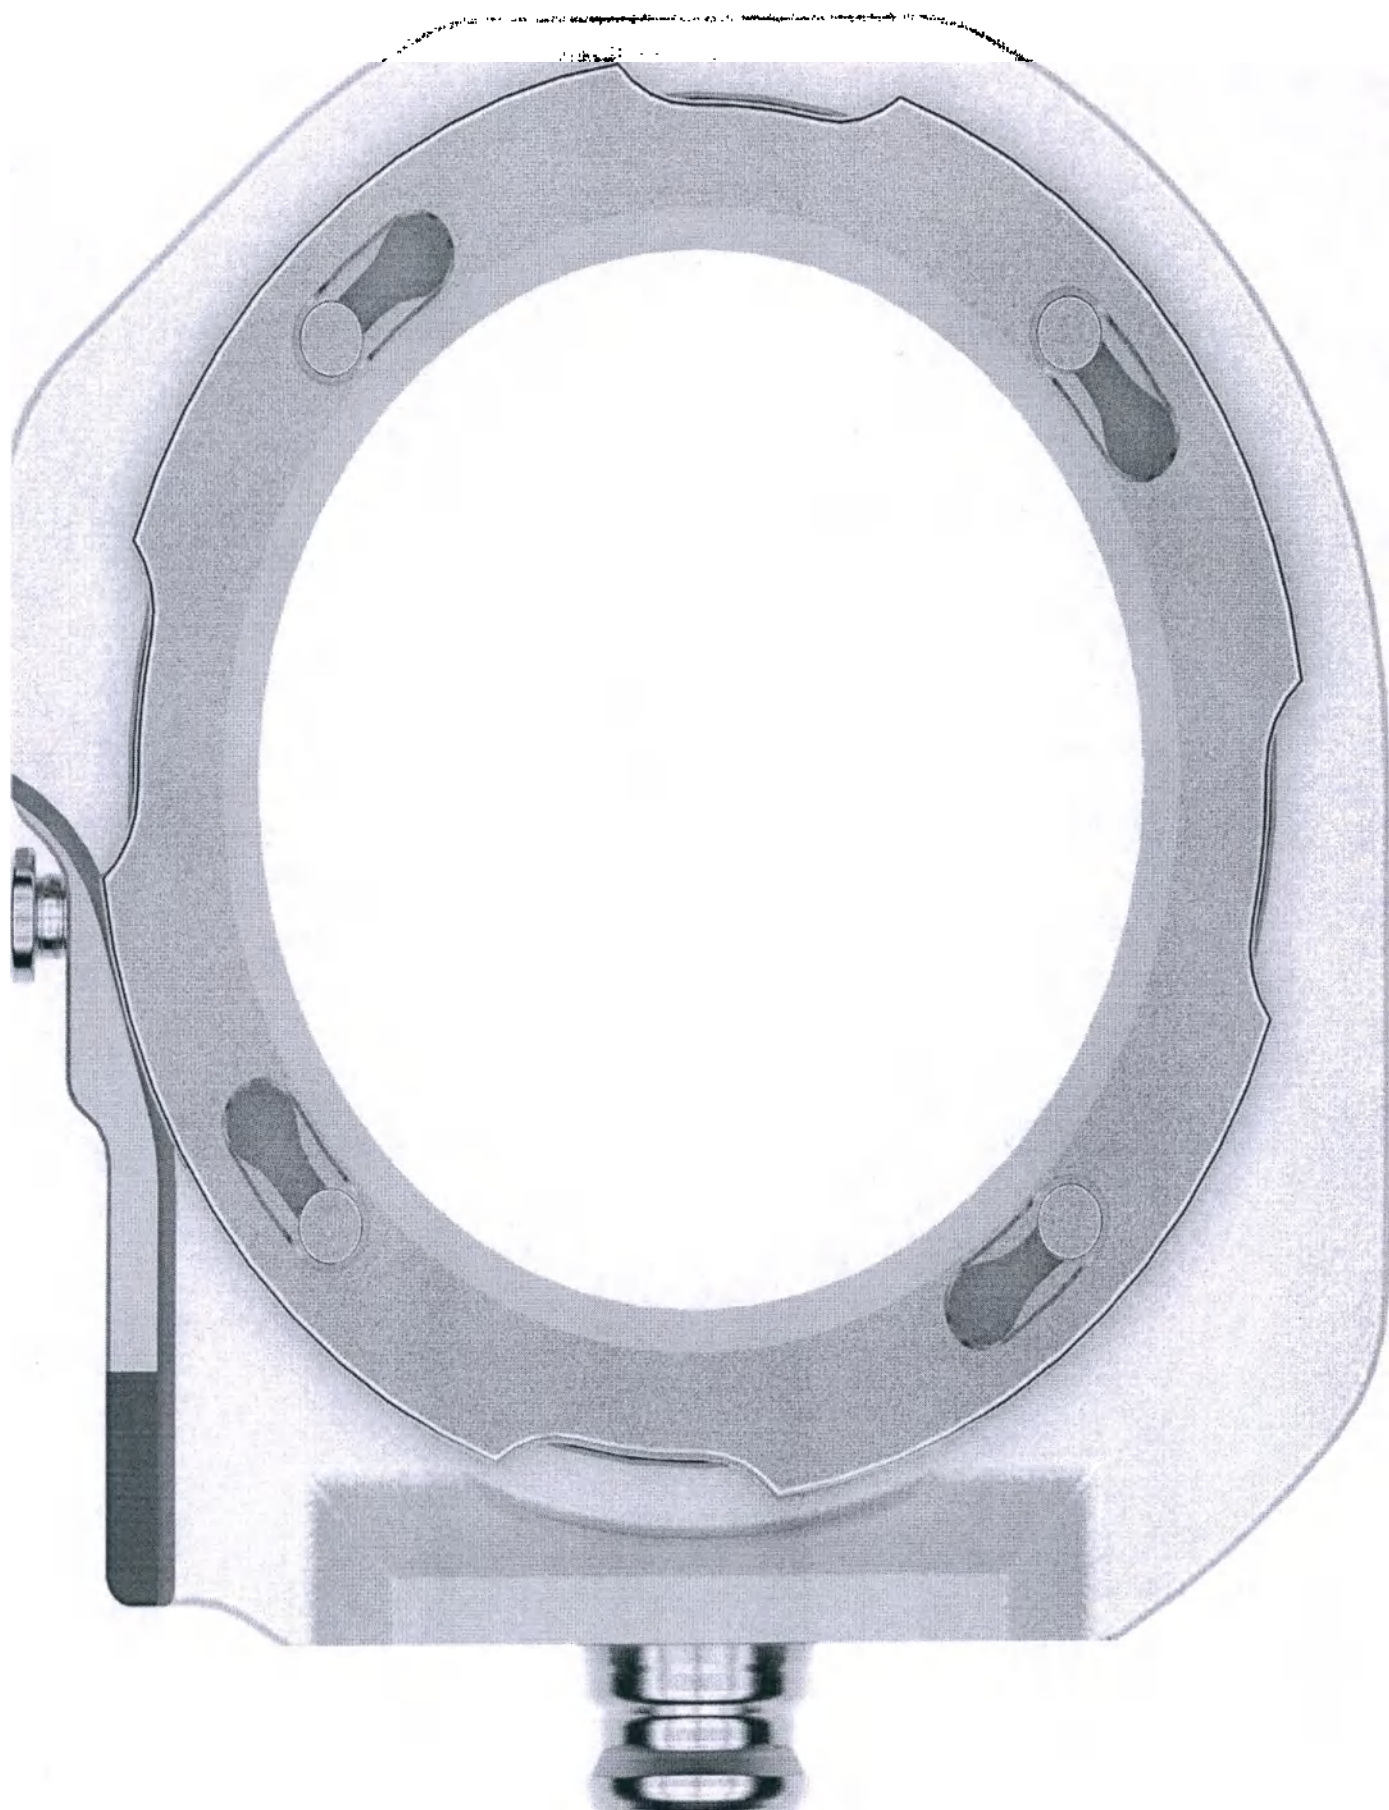


Держателей заготовок 98 181211




Держателей заготовок BD 181217

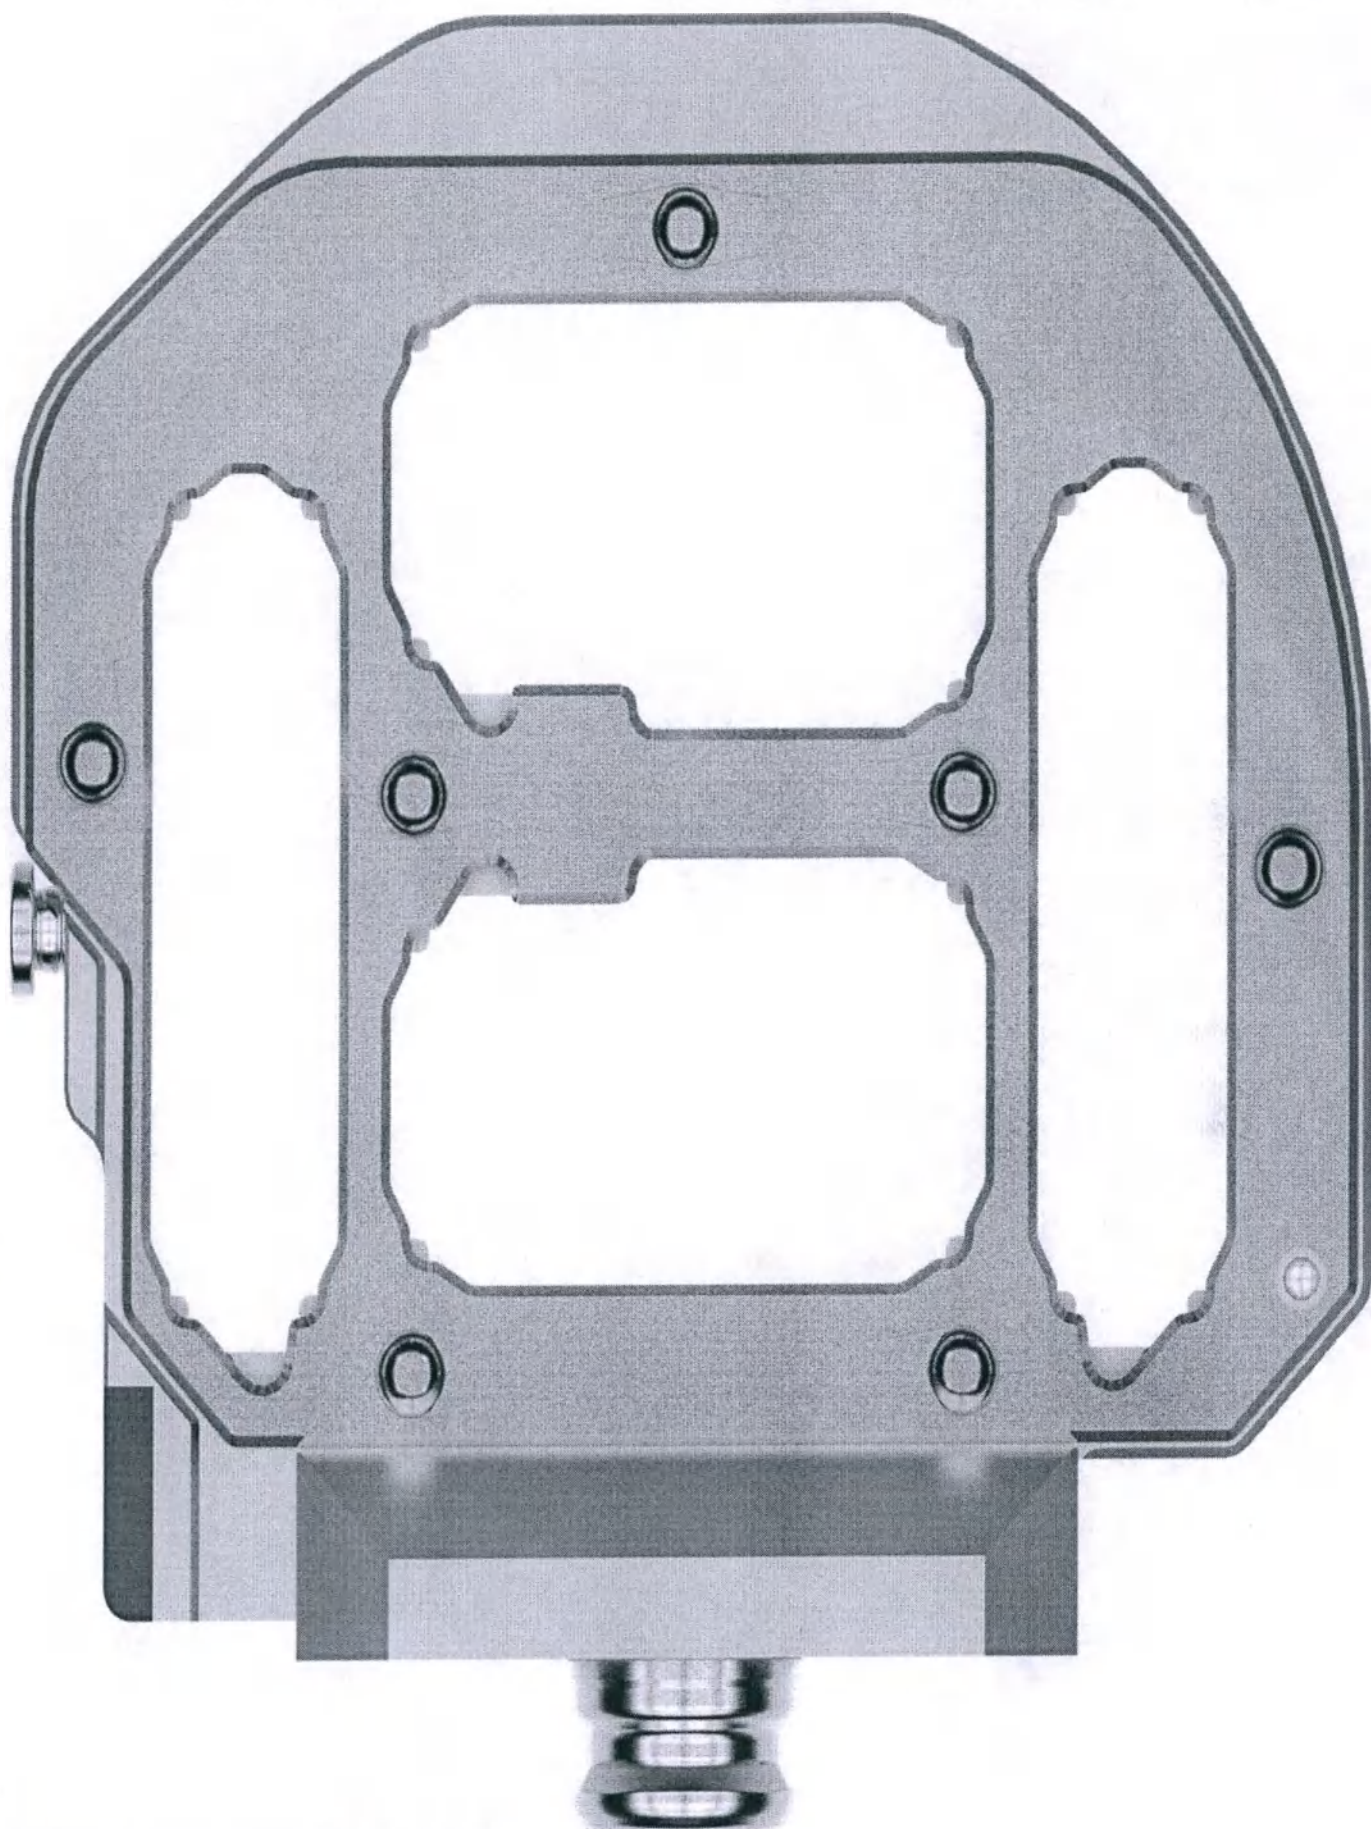


Держателей заготовок D-Set 181216

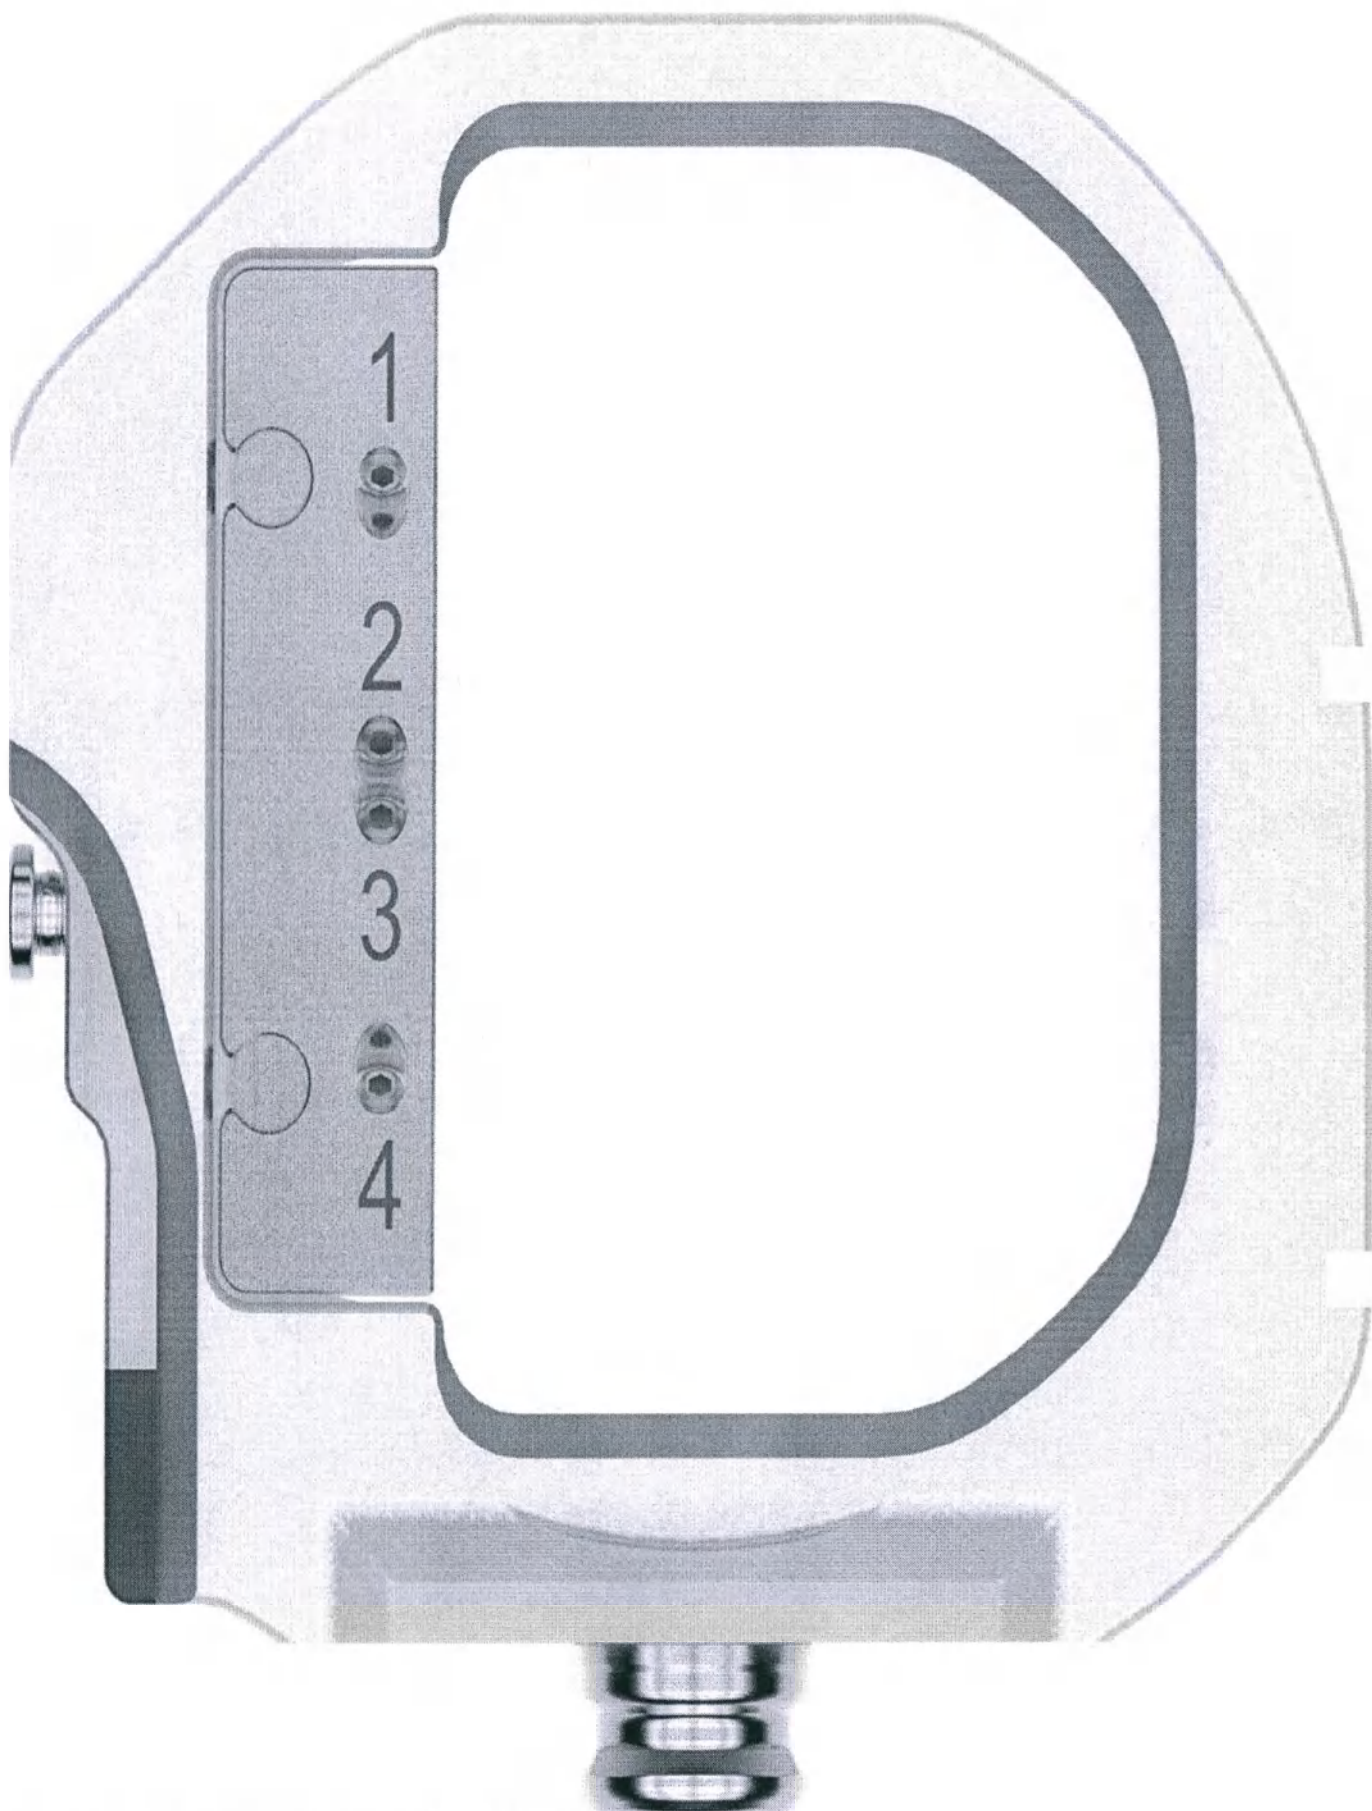


Держателей заготовок Programill 181219

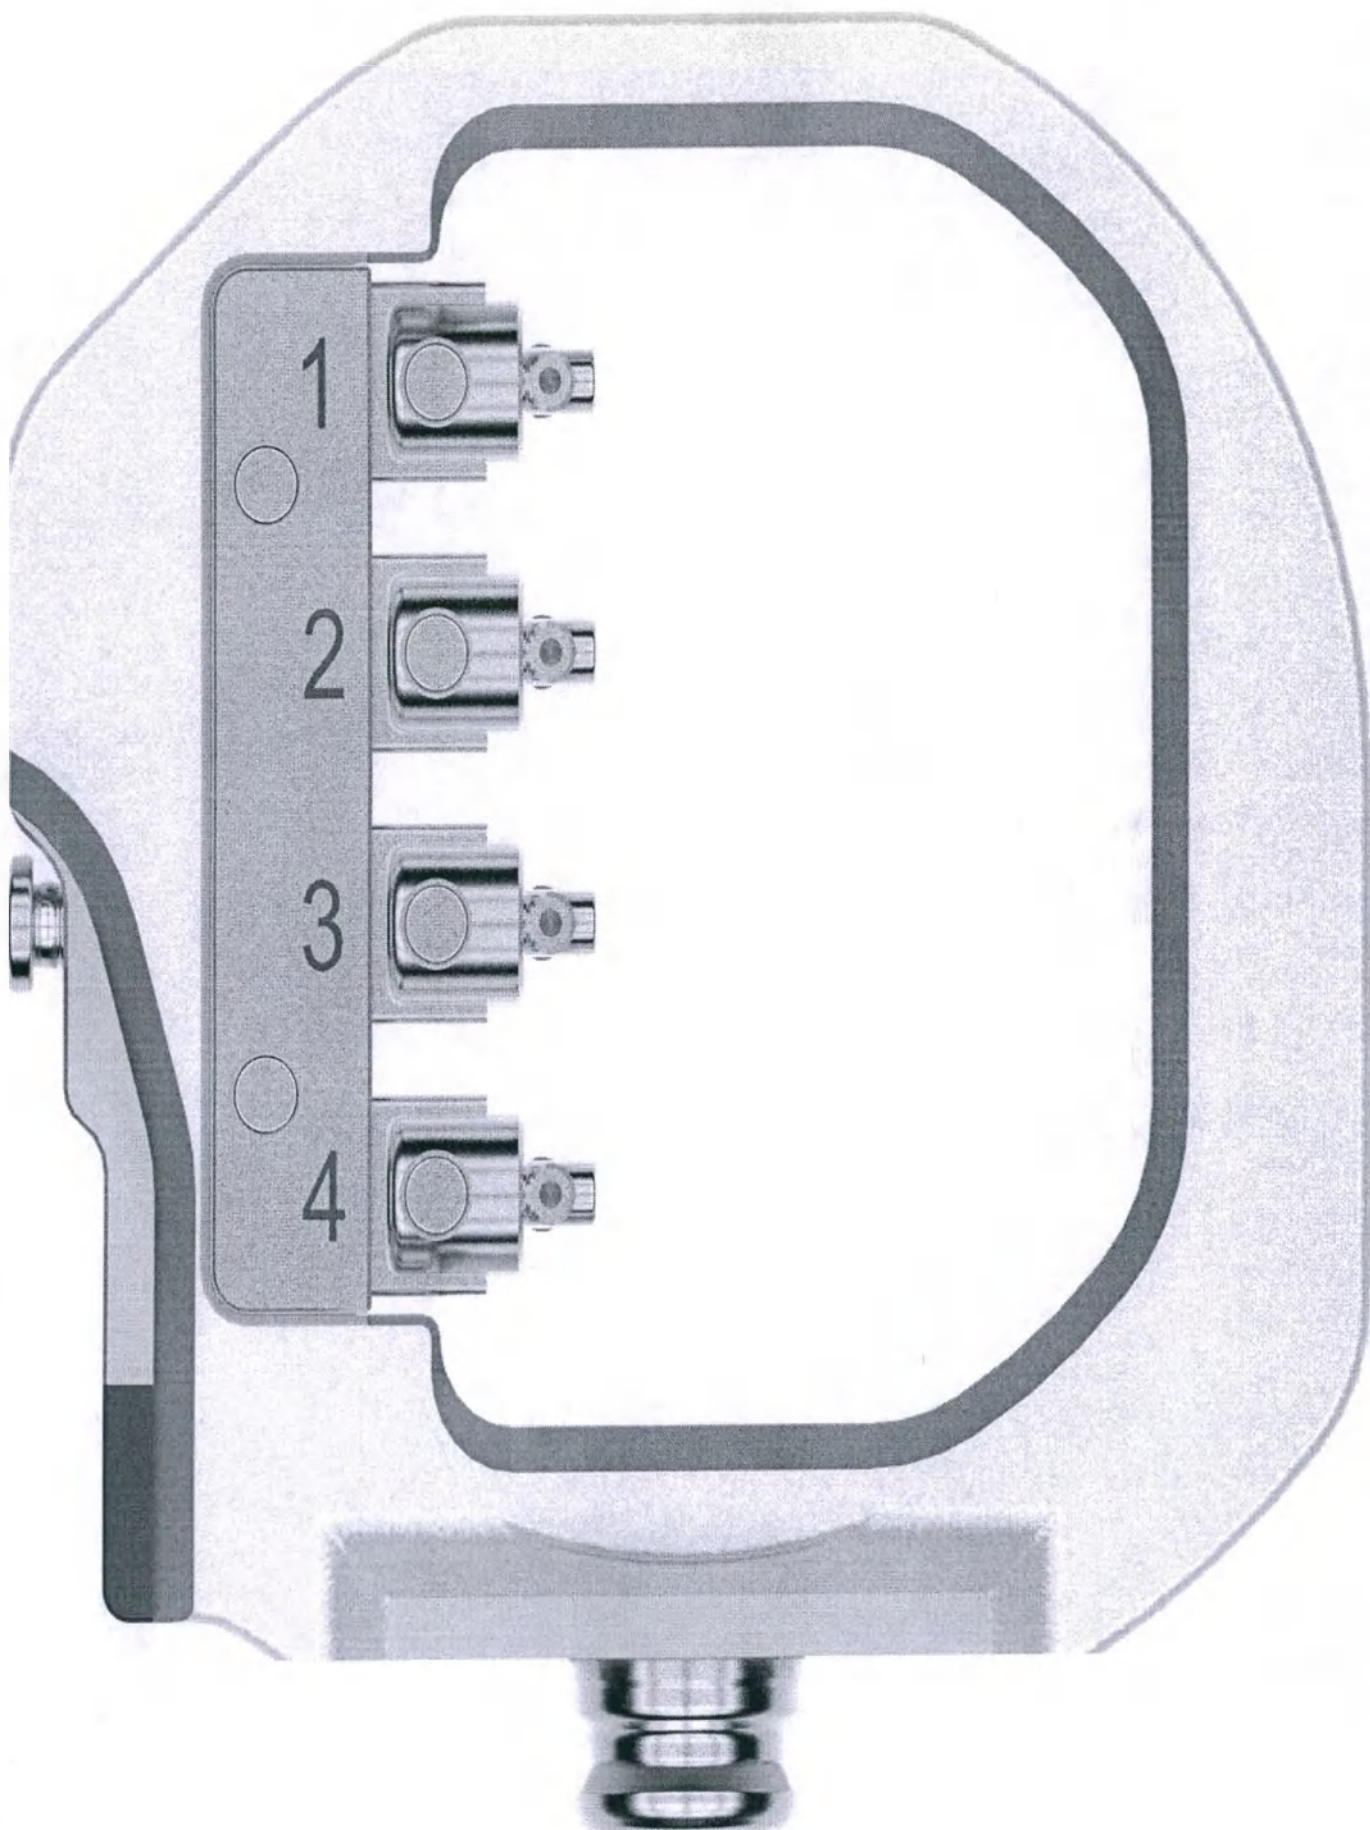


Держателей заготовок Ti-Preforms 181214

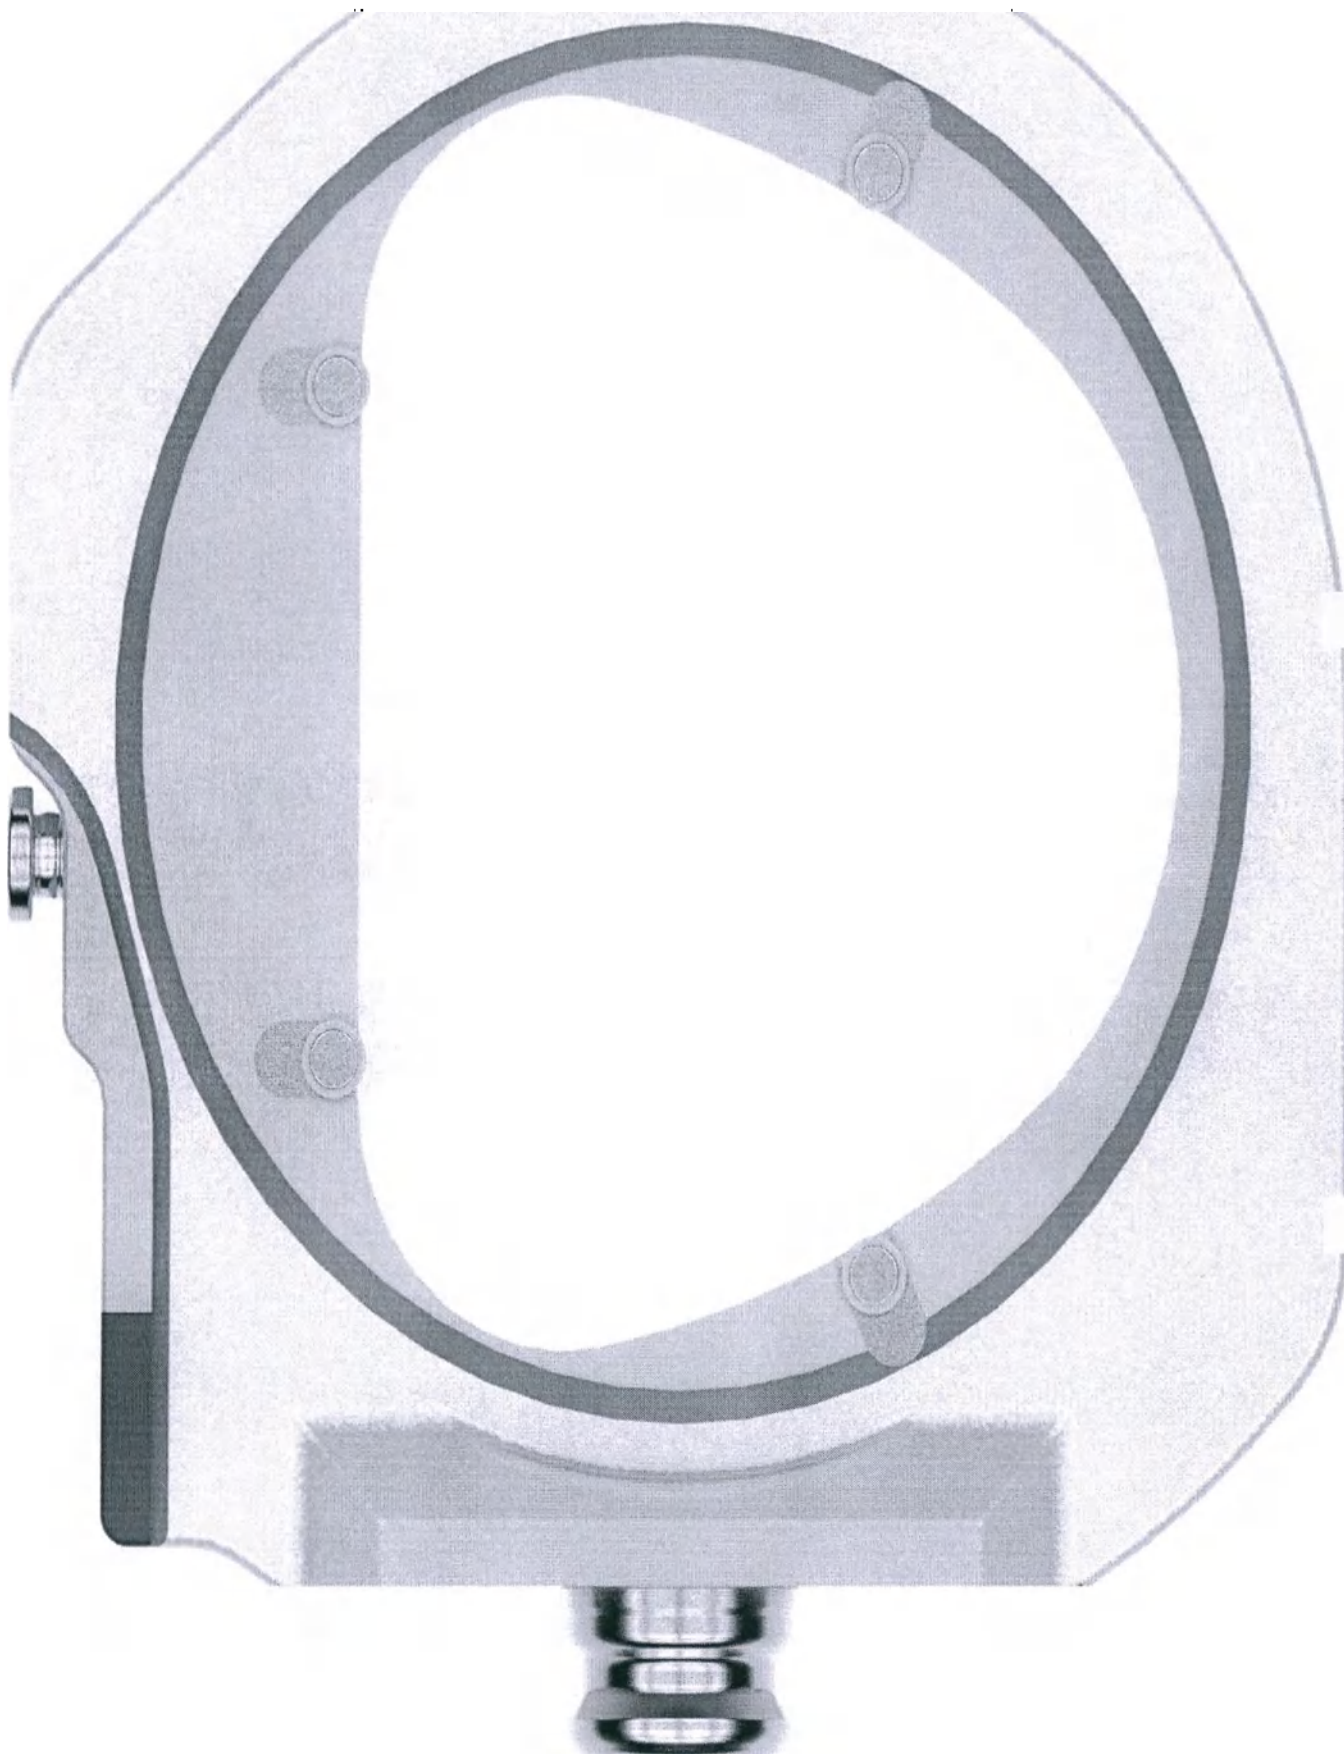


Держателей заготовок XL 181215

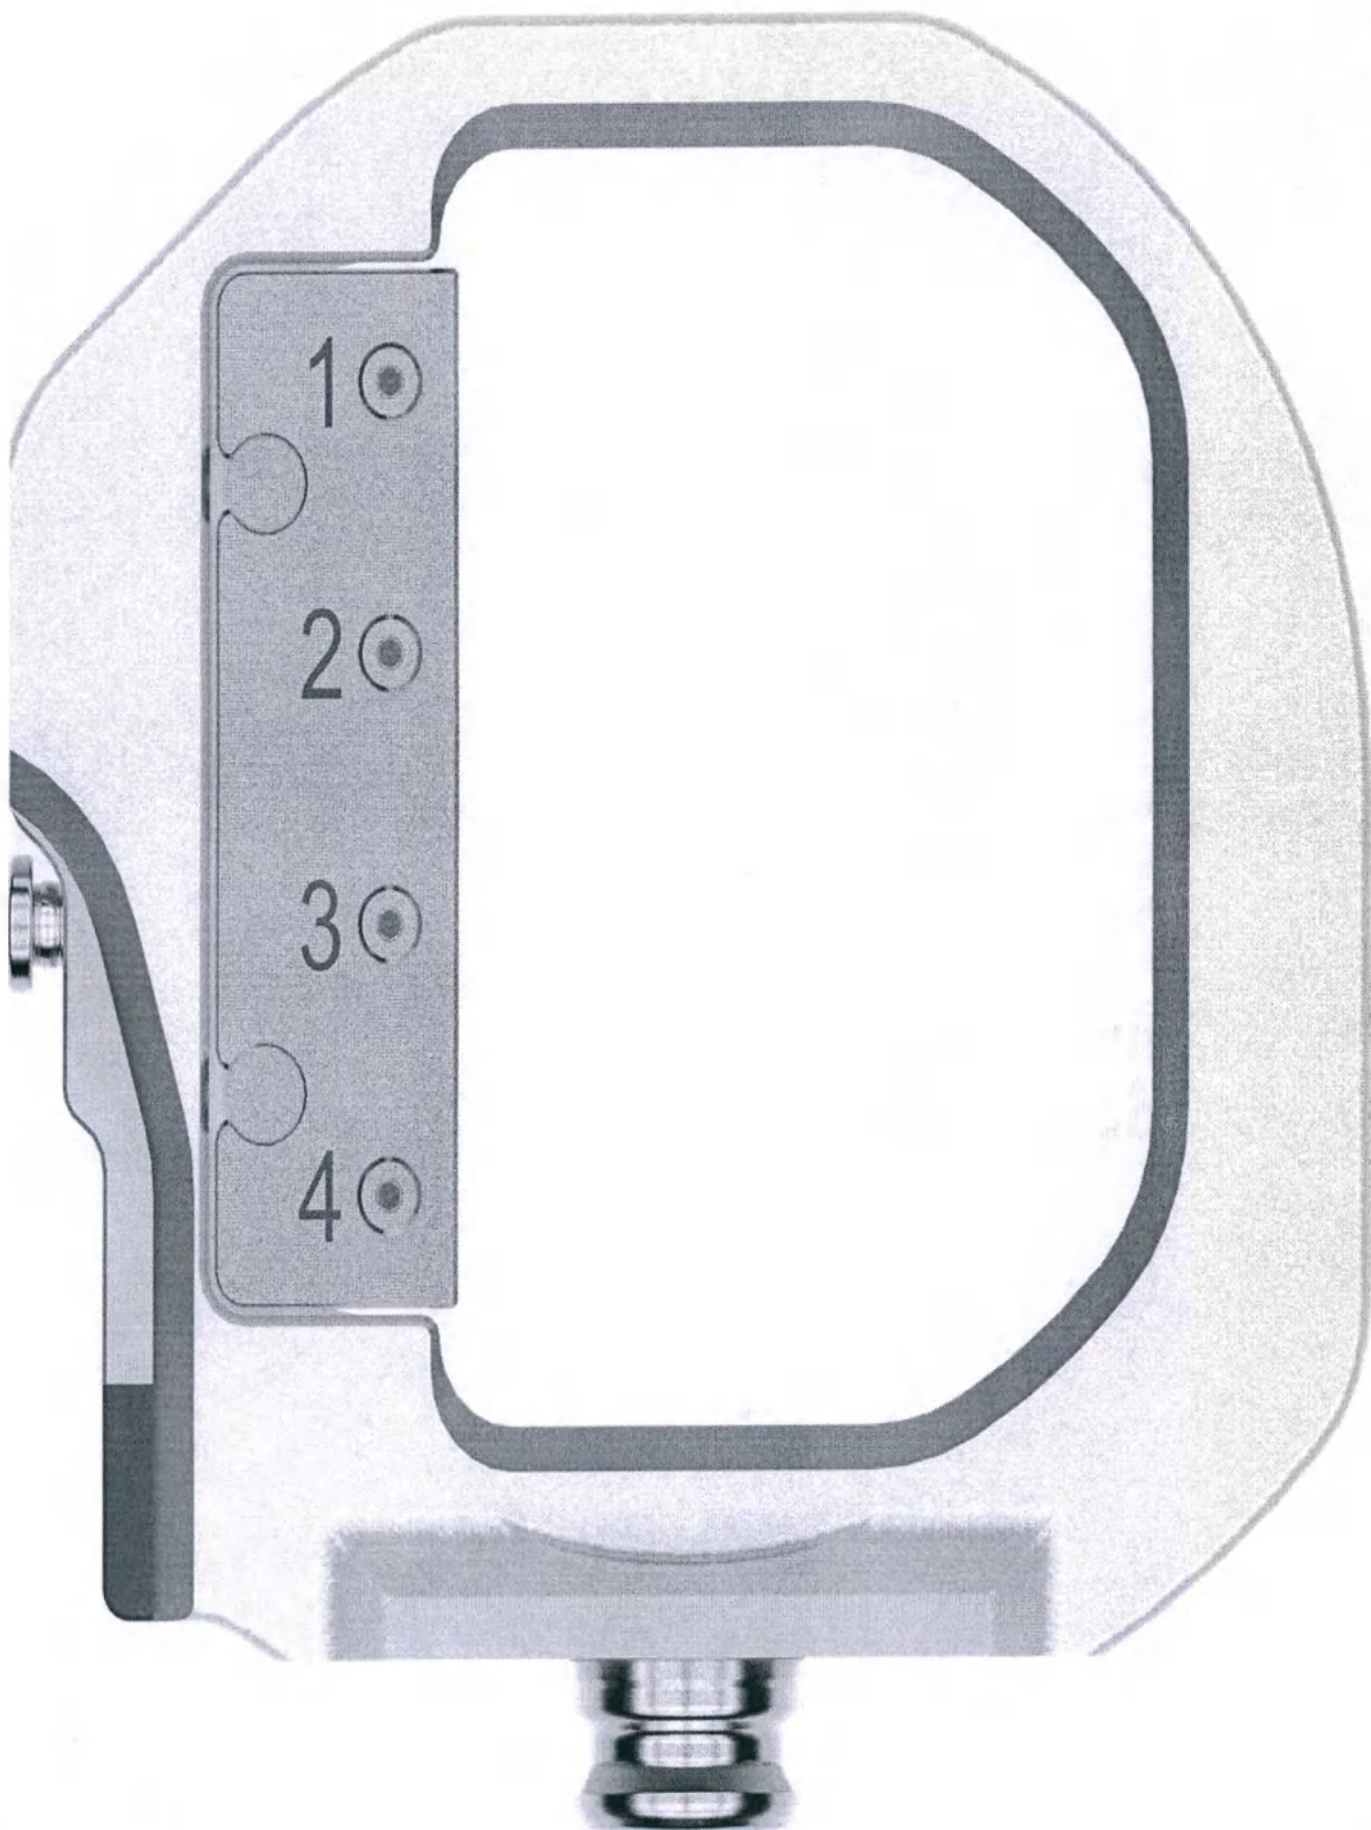


Держателей заготовок Блоки AG 181212

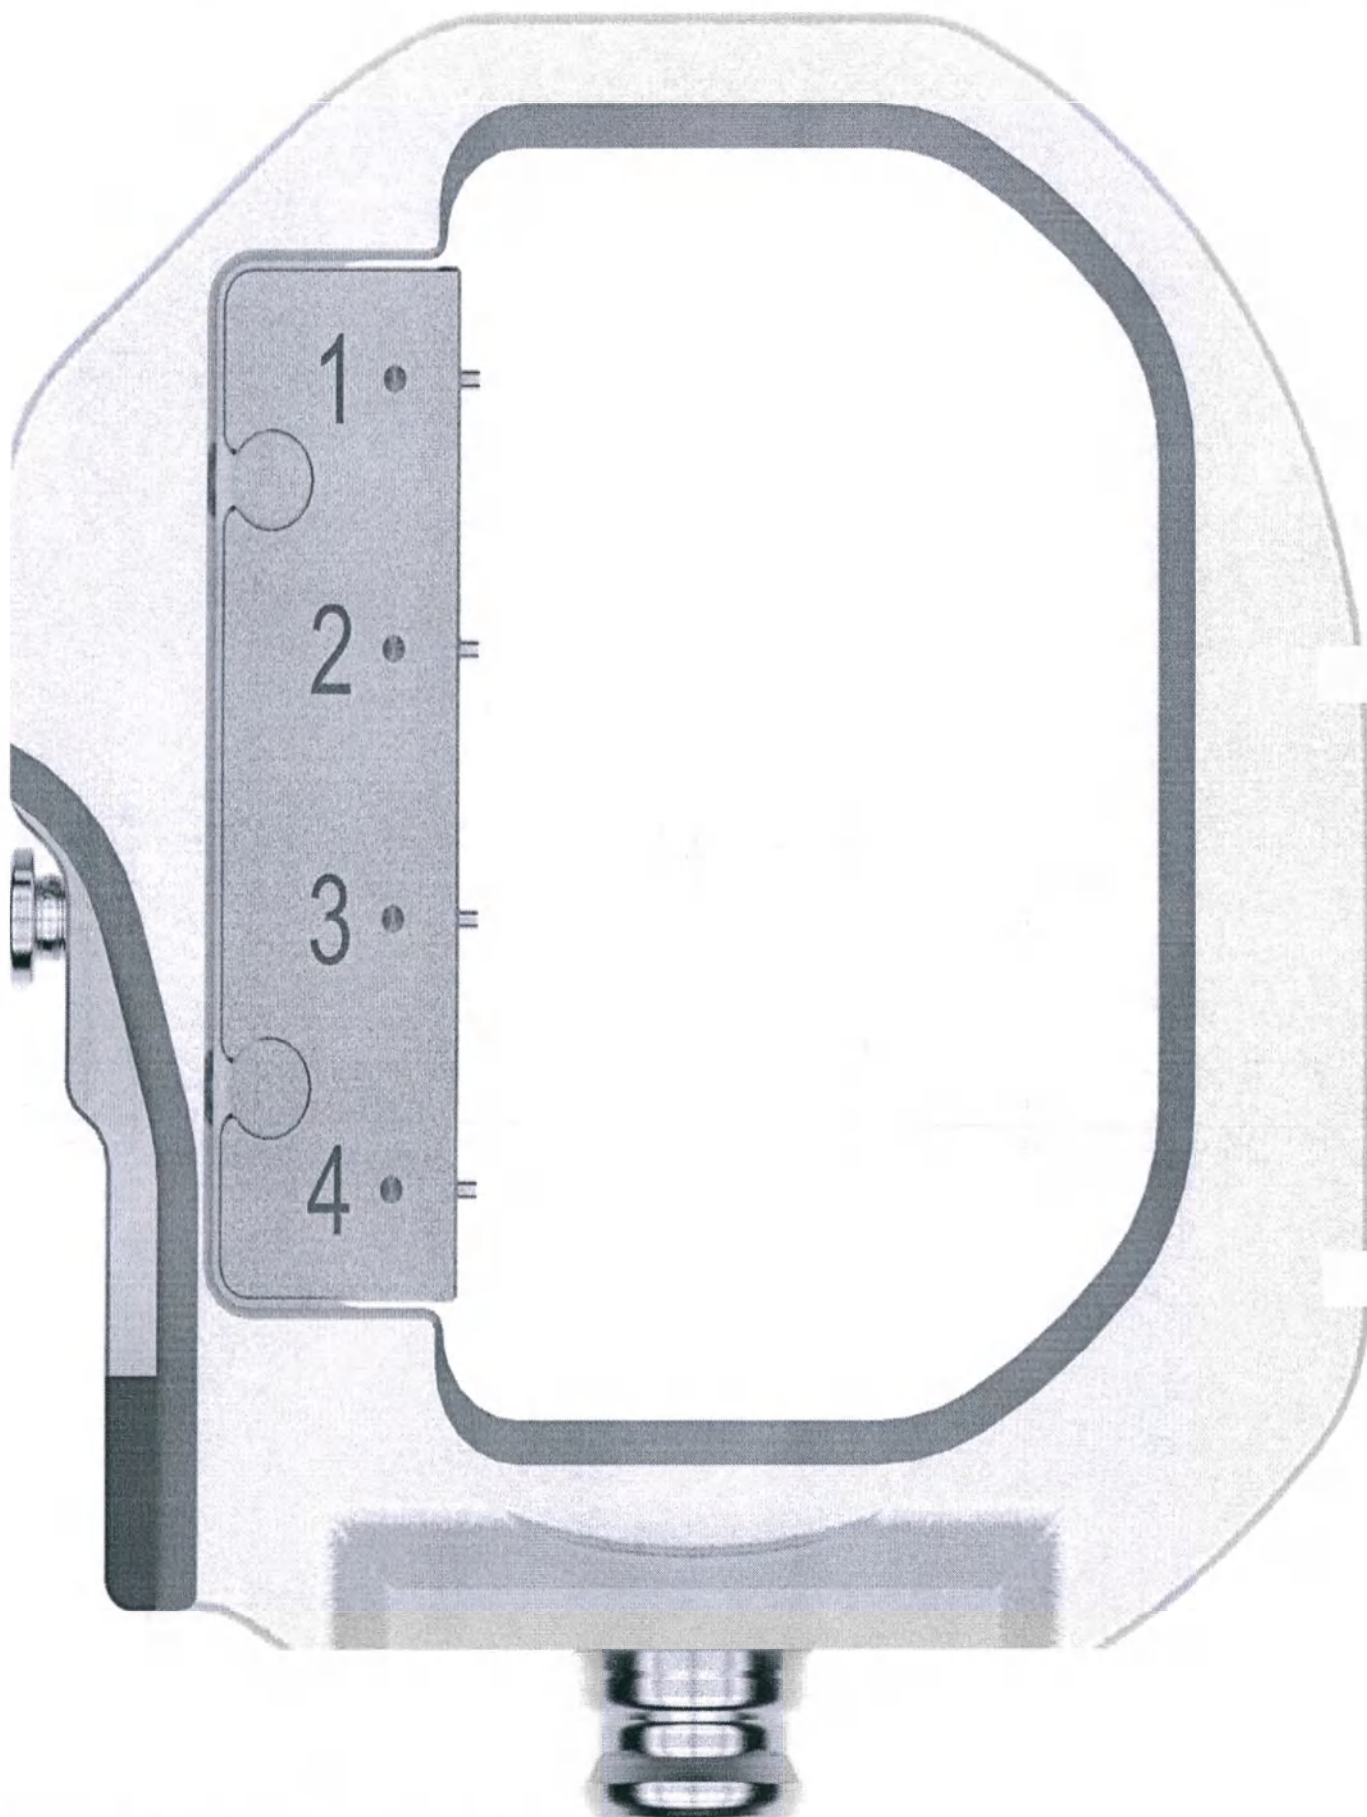


Держателей заготовок Блоки UN 181213

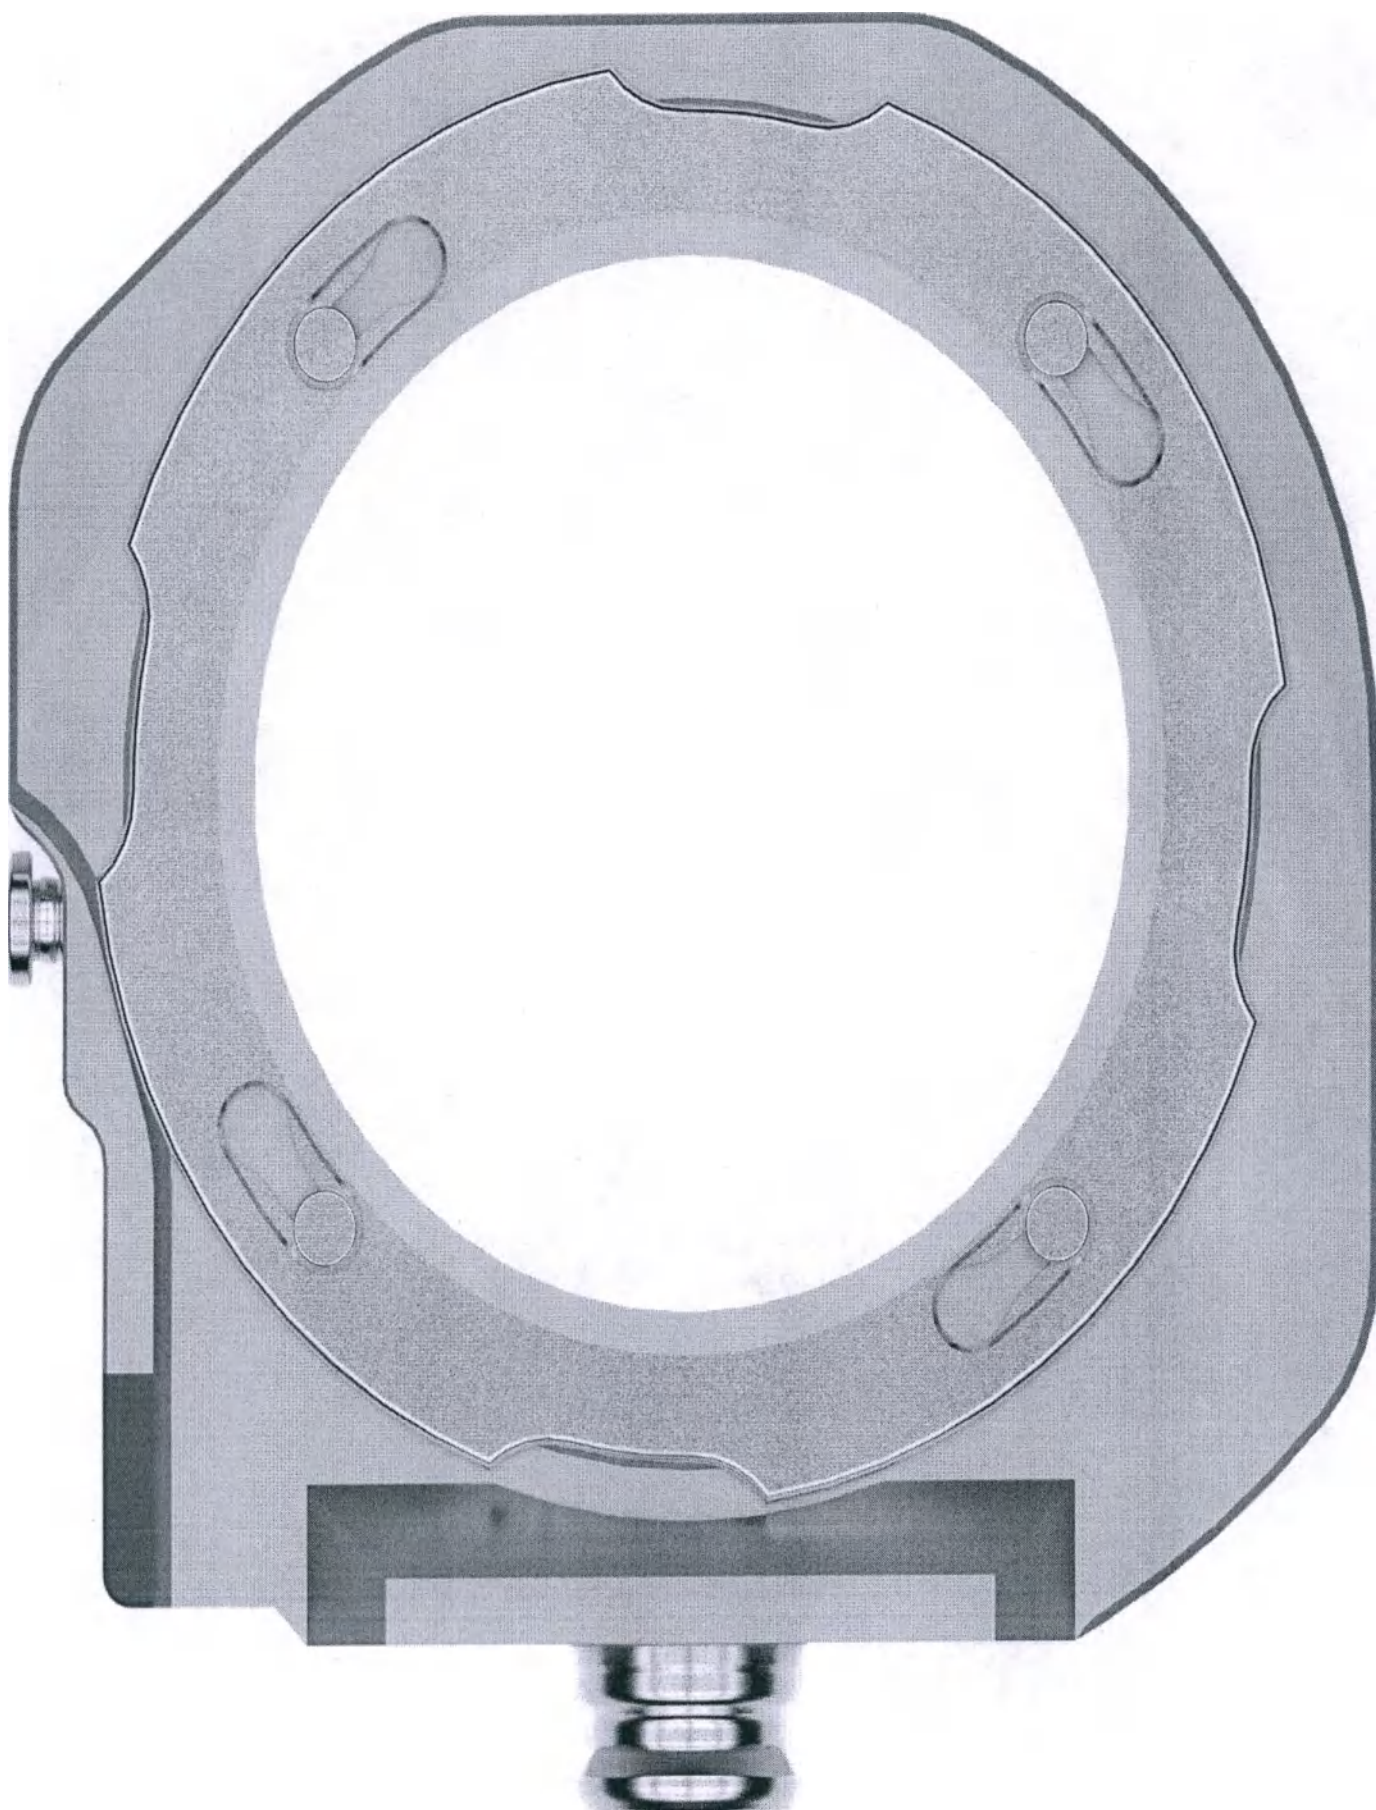

Держателей заготовок Металл 181218

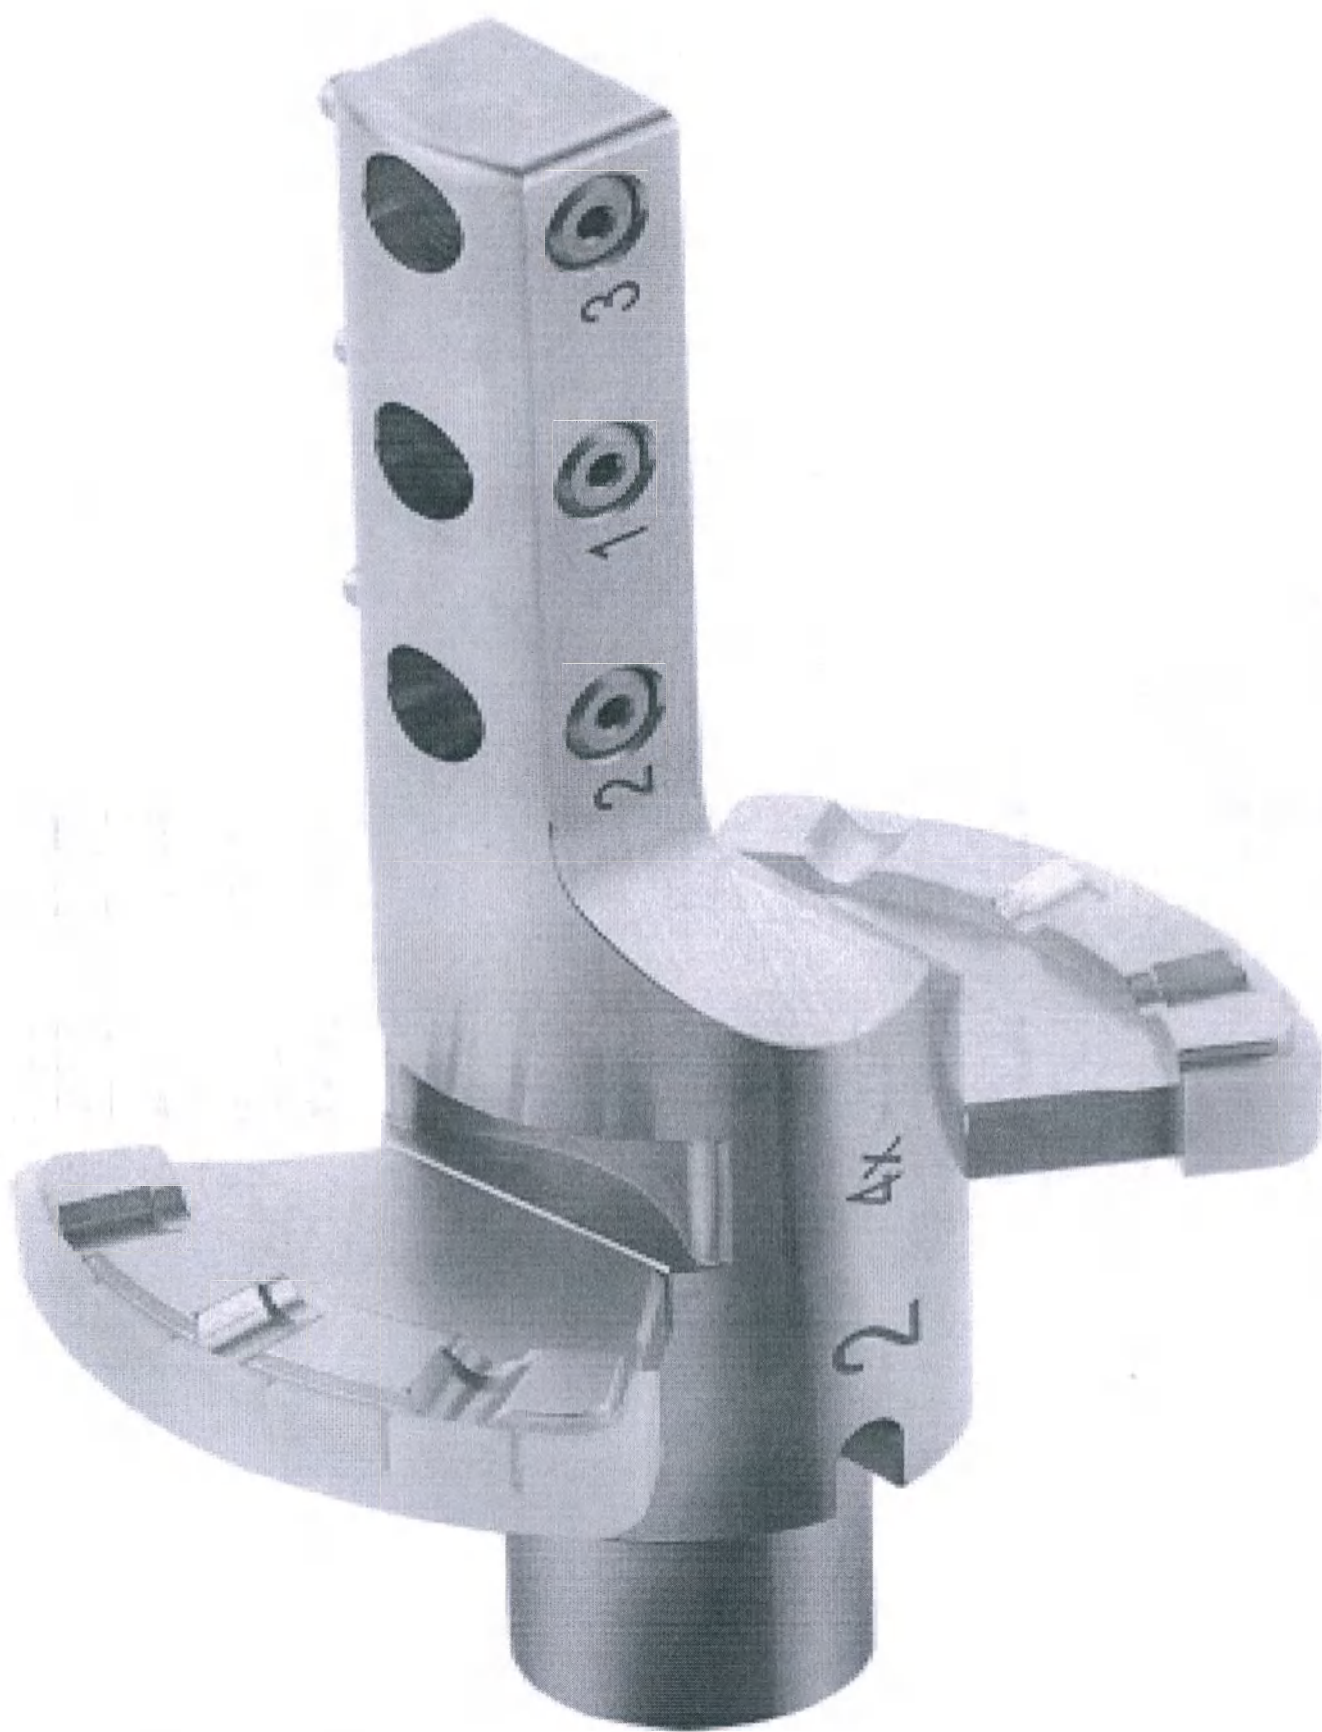

Держатель заготовок Стеклокерамика 3-х компонентный

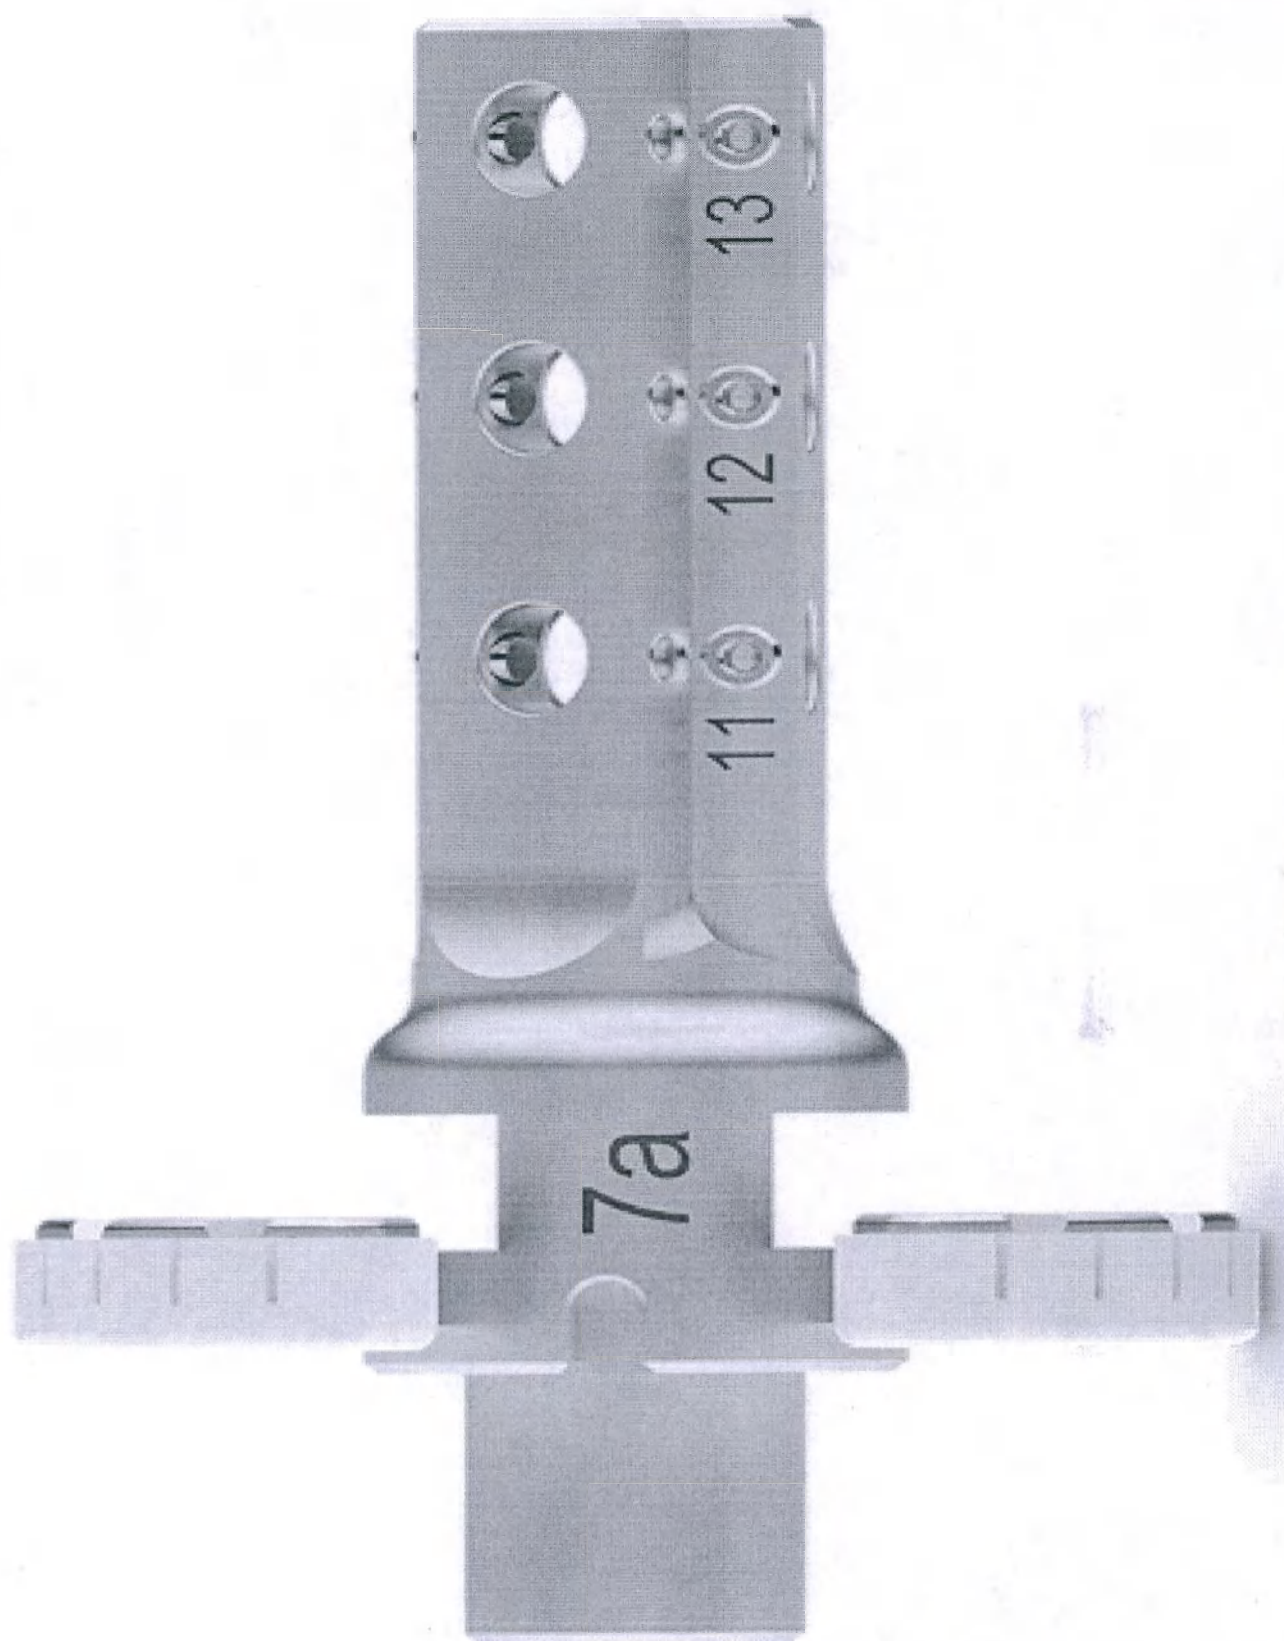

Держатель заготовок Стеклокерамика 9-ти компонентный



Держатель заготовок Стеклокерамика 12-и компонентный



Фреза Roto RFID 2,5 ZI



Фреза Roto RFID 1,0 ZI



Фреза Roto RFID 0,6 ZI



Фреза Roto RFID 0,3 ZI



Фреза Roto RFID 2,5 Sintron



Фреза Roto RFID 1,0 Sintron



Фреза Roto RFID 0,6 Sintron



Фреза Roto RFID 0,3 Sintron



Фреза Roto RFID 2,5 PMMA



Фреза Roto RFID 1,0 PMMA



Фреза Roto RFID 0,6 PMMA




Фреза Roto RFID 0,3 PMMA




Фреза Roto RFID 2,0 Ti




Фреза Roto RFID 1,0 Ti

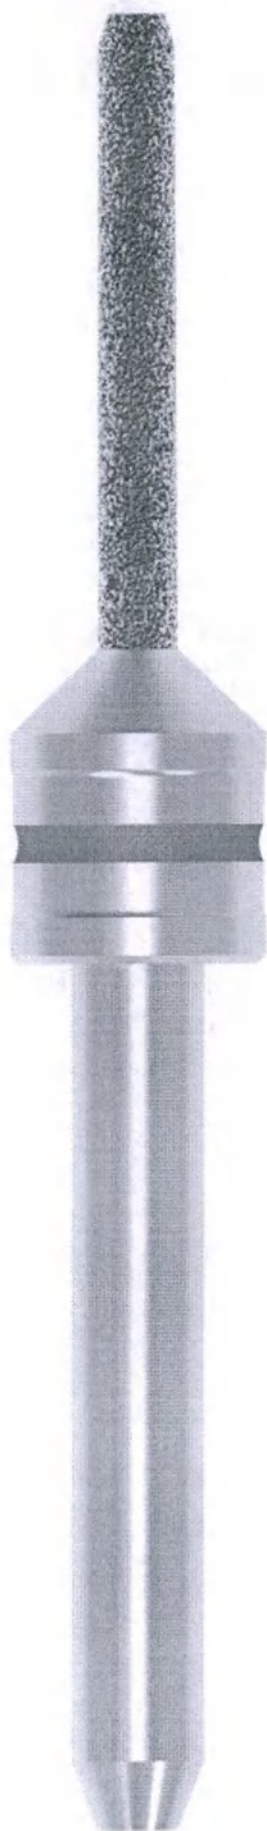


Фреза Diamond RFID 1,8

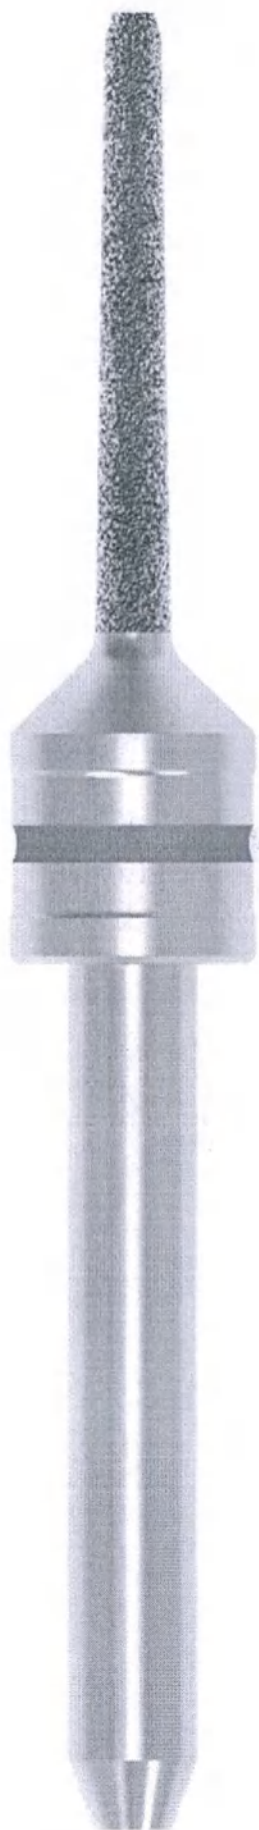

Фреза Diamond RFID 1,4

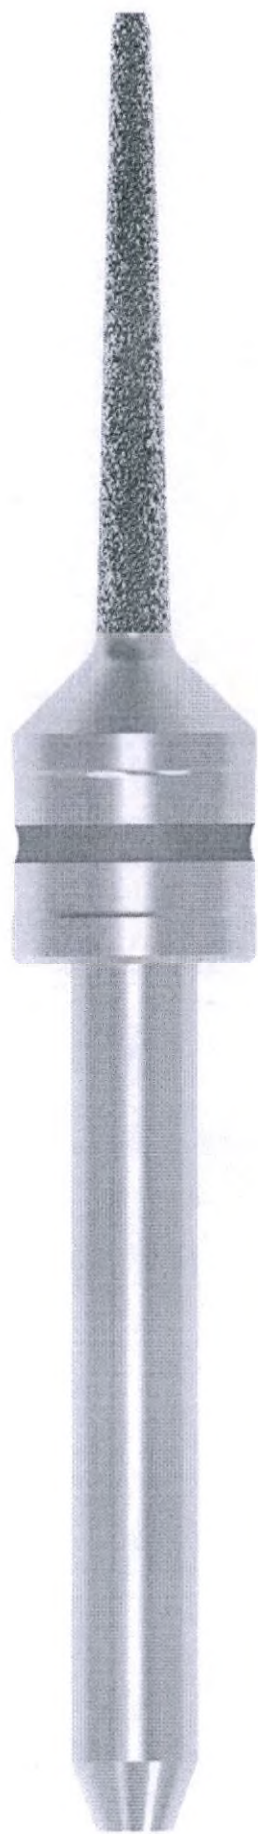

Фреза Diamond RFID 1,0

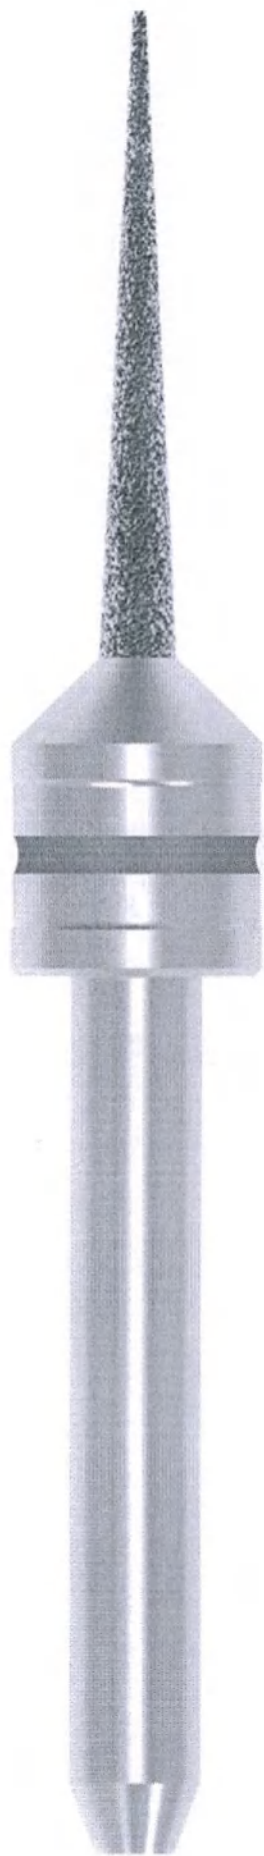

Фреза Diamond RFID 0,4



Фреза Roto RFID 2,5 SC



Фреза Roto RFID 1,0 SC



Фреза Roto RFID 0,6 SC



Фреза Roto RFID 0,3 SC



Фреза Roto RFID 2,5 DMB DC



Фреза Roto RFID 1,0 DMB DC



Фреза Roto RFID 0,6 DMB DC



Фреза Roto RFID 0,3 DMB DC



Фреза Roto RFID 2,5 PMMA Denture



Фреза Roto RFID 1,5 PMMA Denture



Фреза Roto RFID 2,5 Model



Фреза Roto RFID 2,0 Model



Фреза Roto RFID 1,2 Drill




Фреза Roto RFID 1,2 ST




Фреза Roto RFID 1,0 Wax Denture




Фреза Roto RFID 3,0 Wax Denture

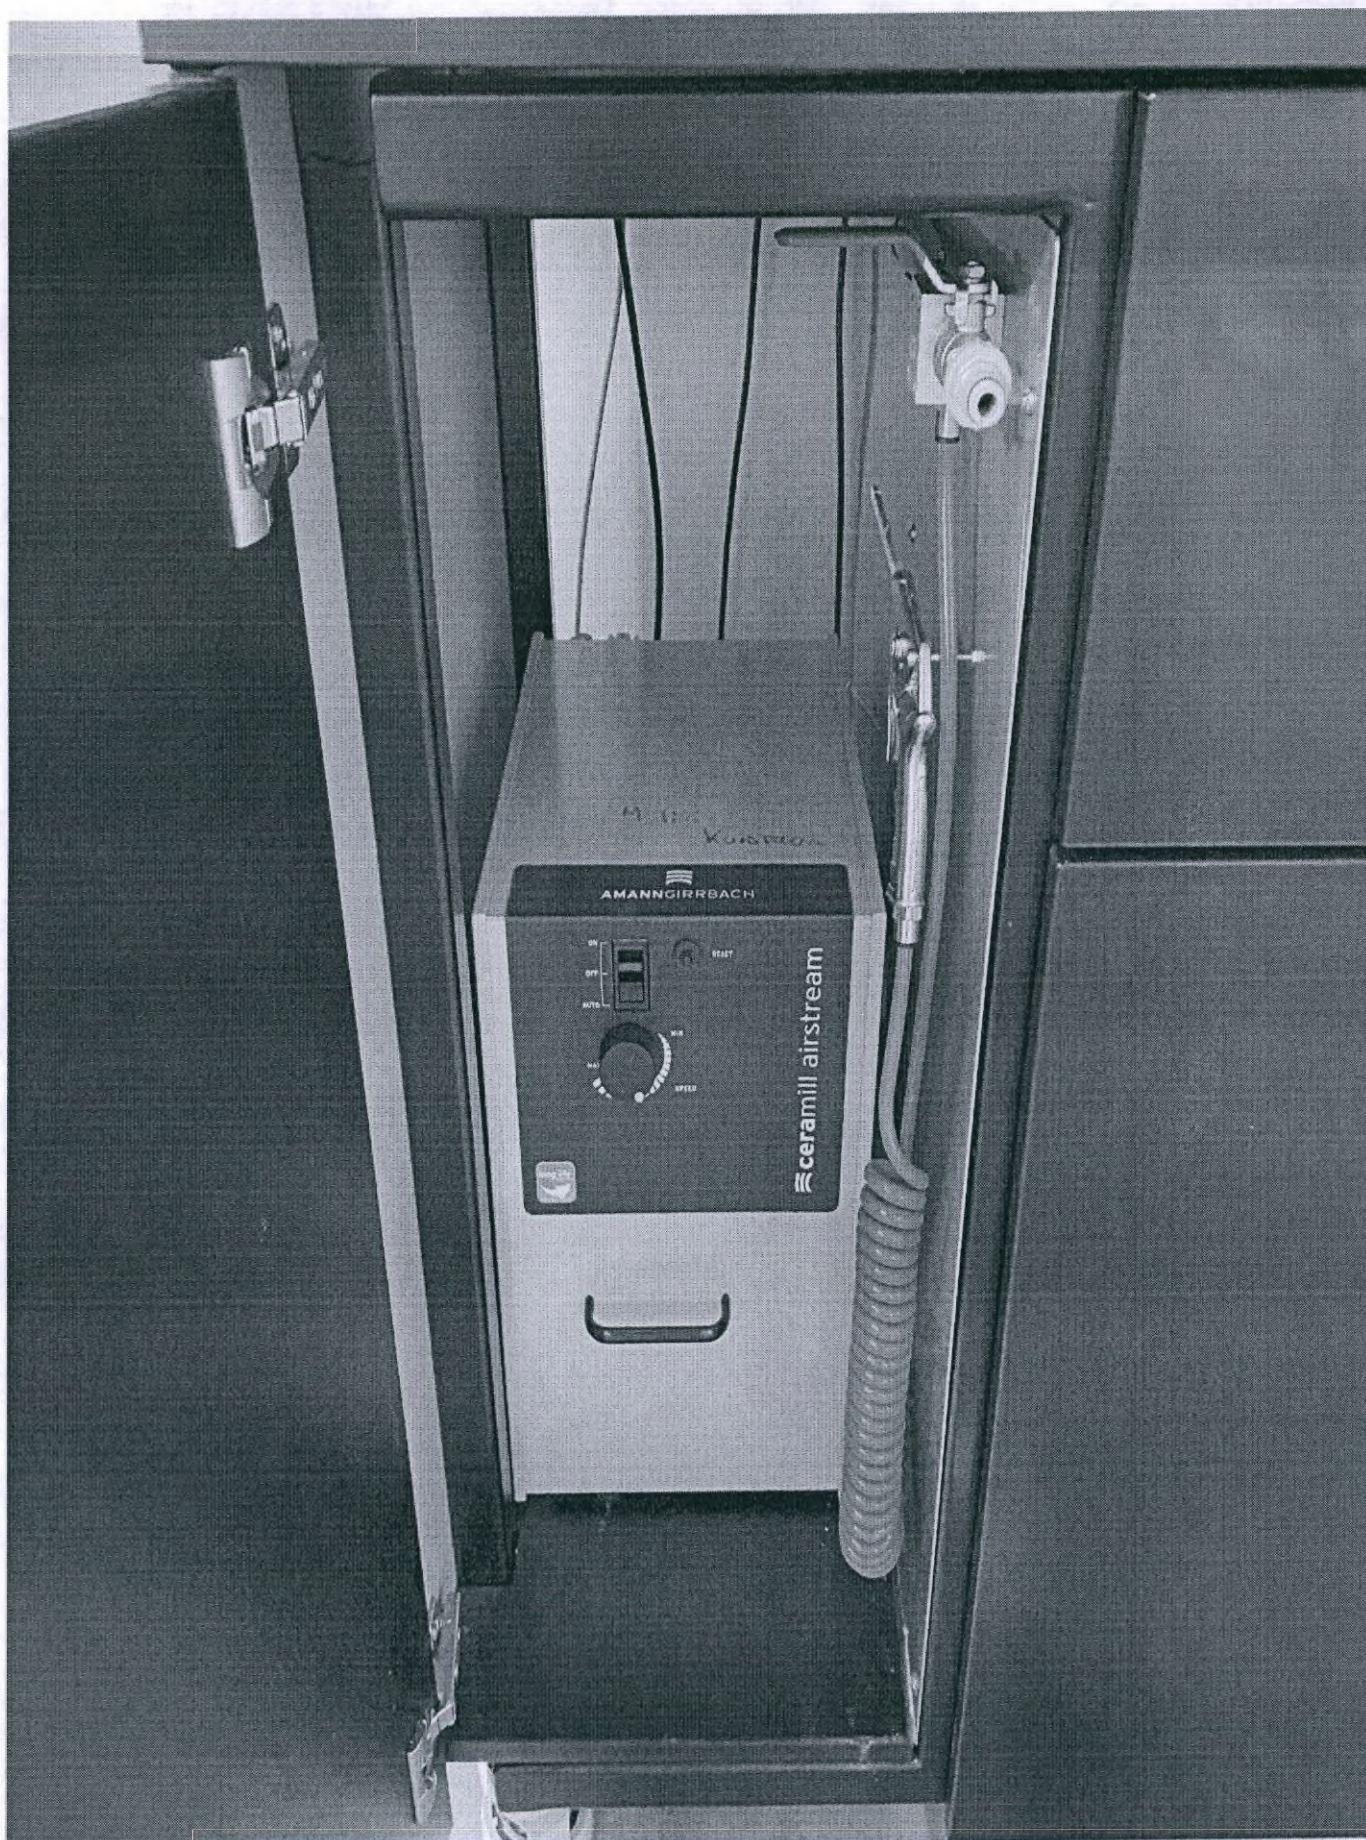

Вытяжка Ceramill Airstream. Вид спереди

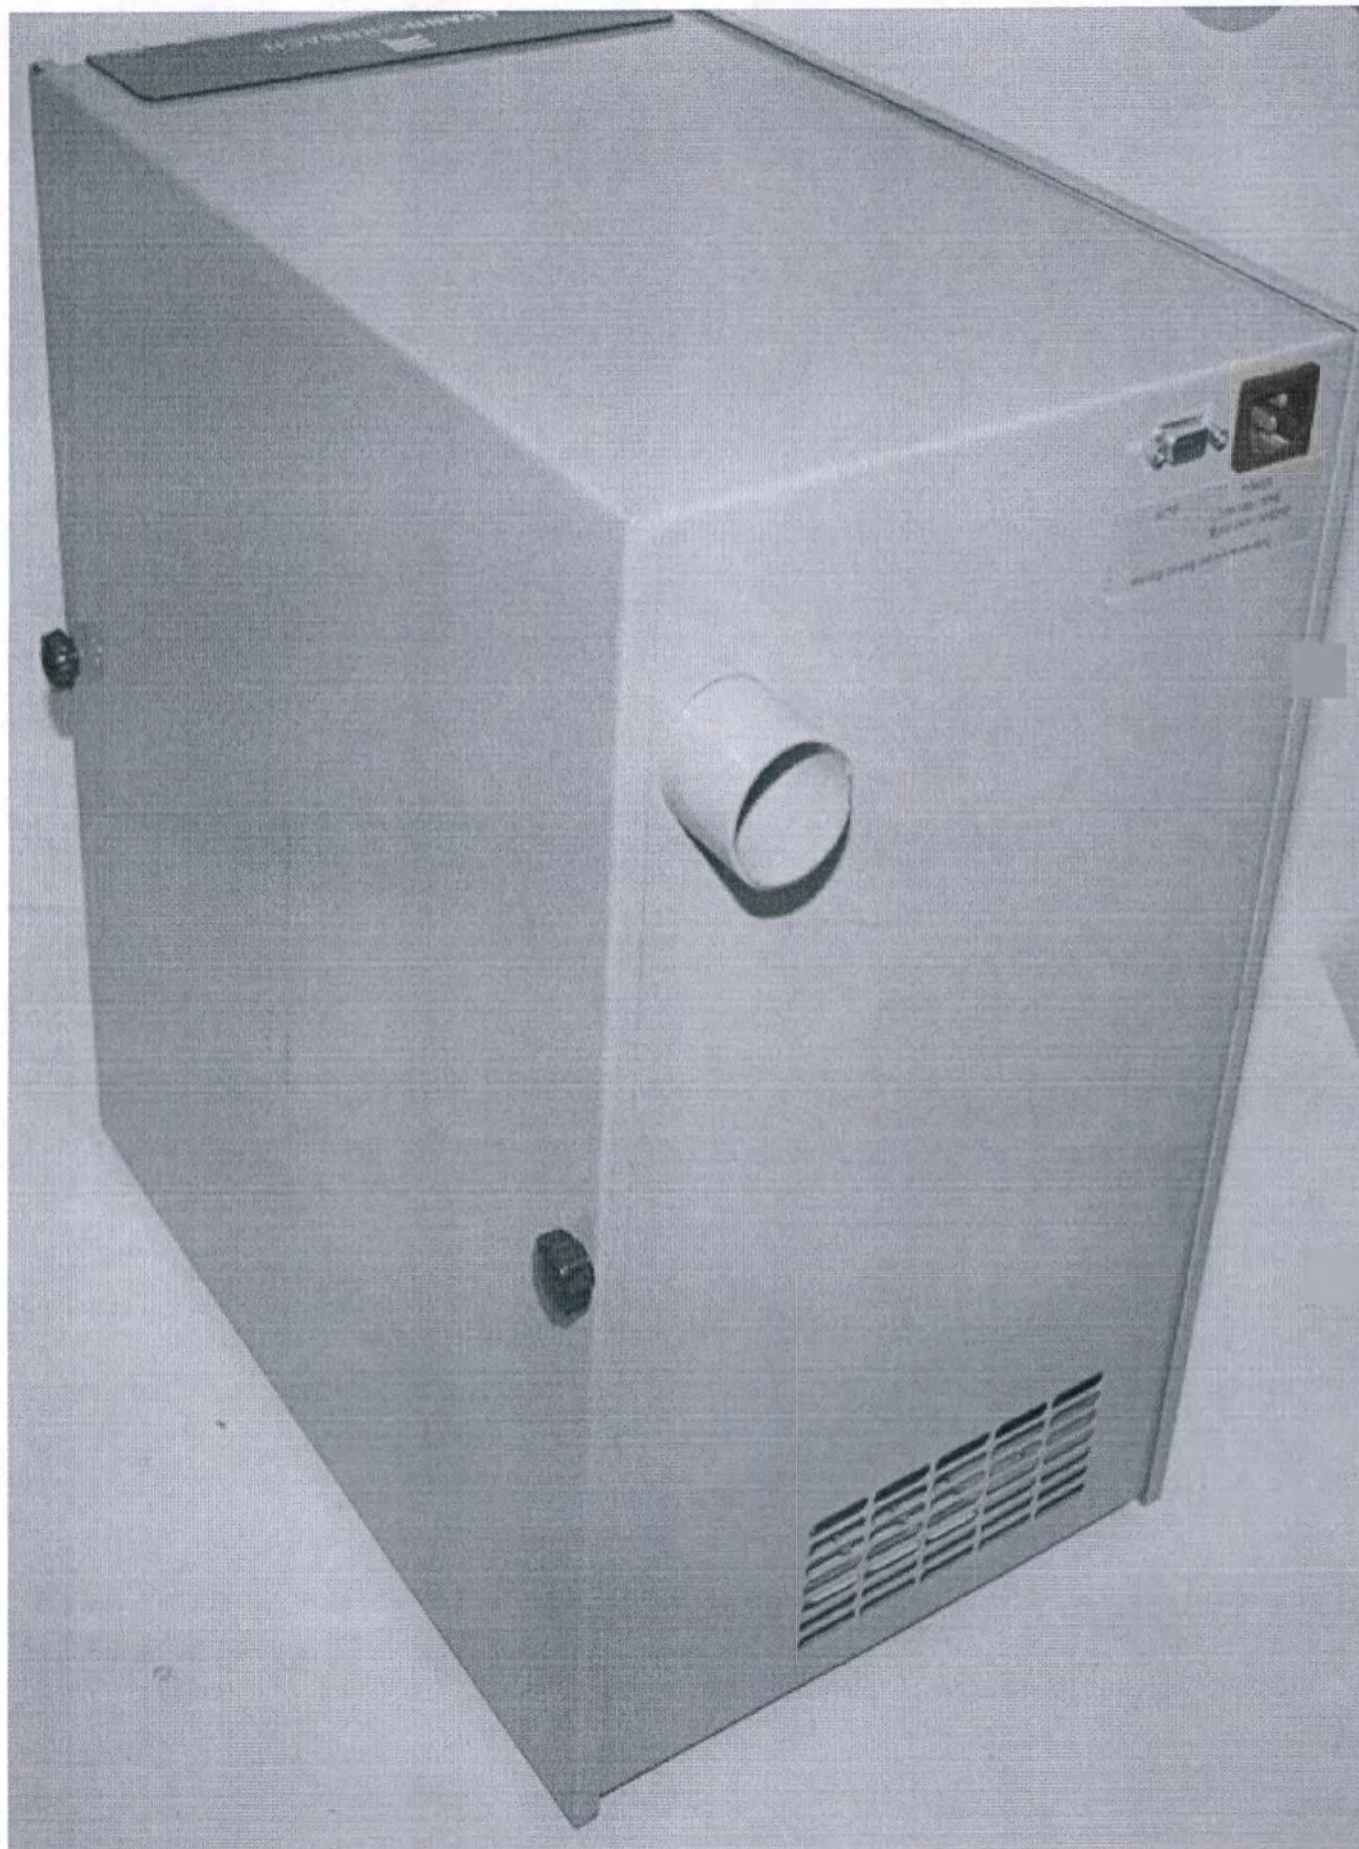

Вытяжка Ceramill Airstream. Вид сзади

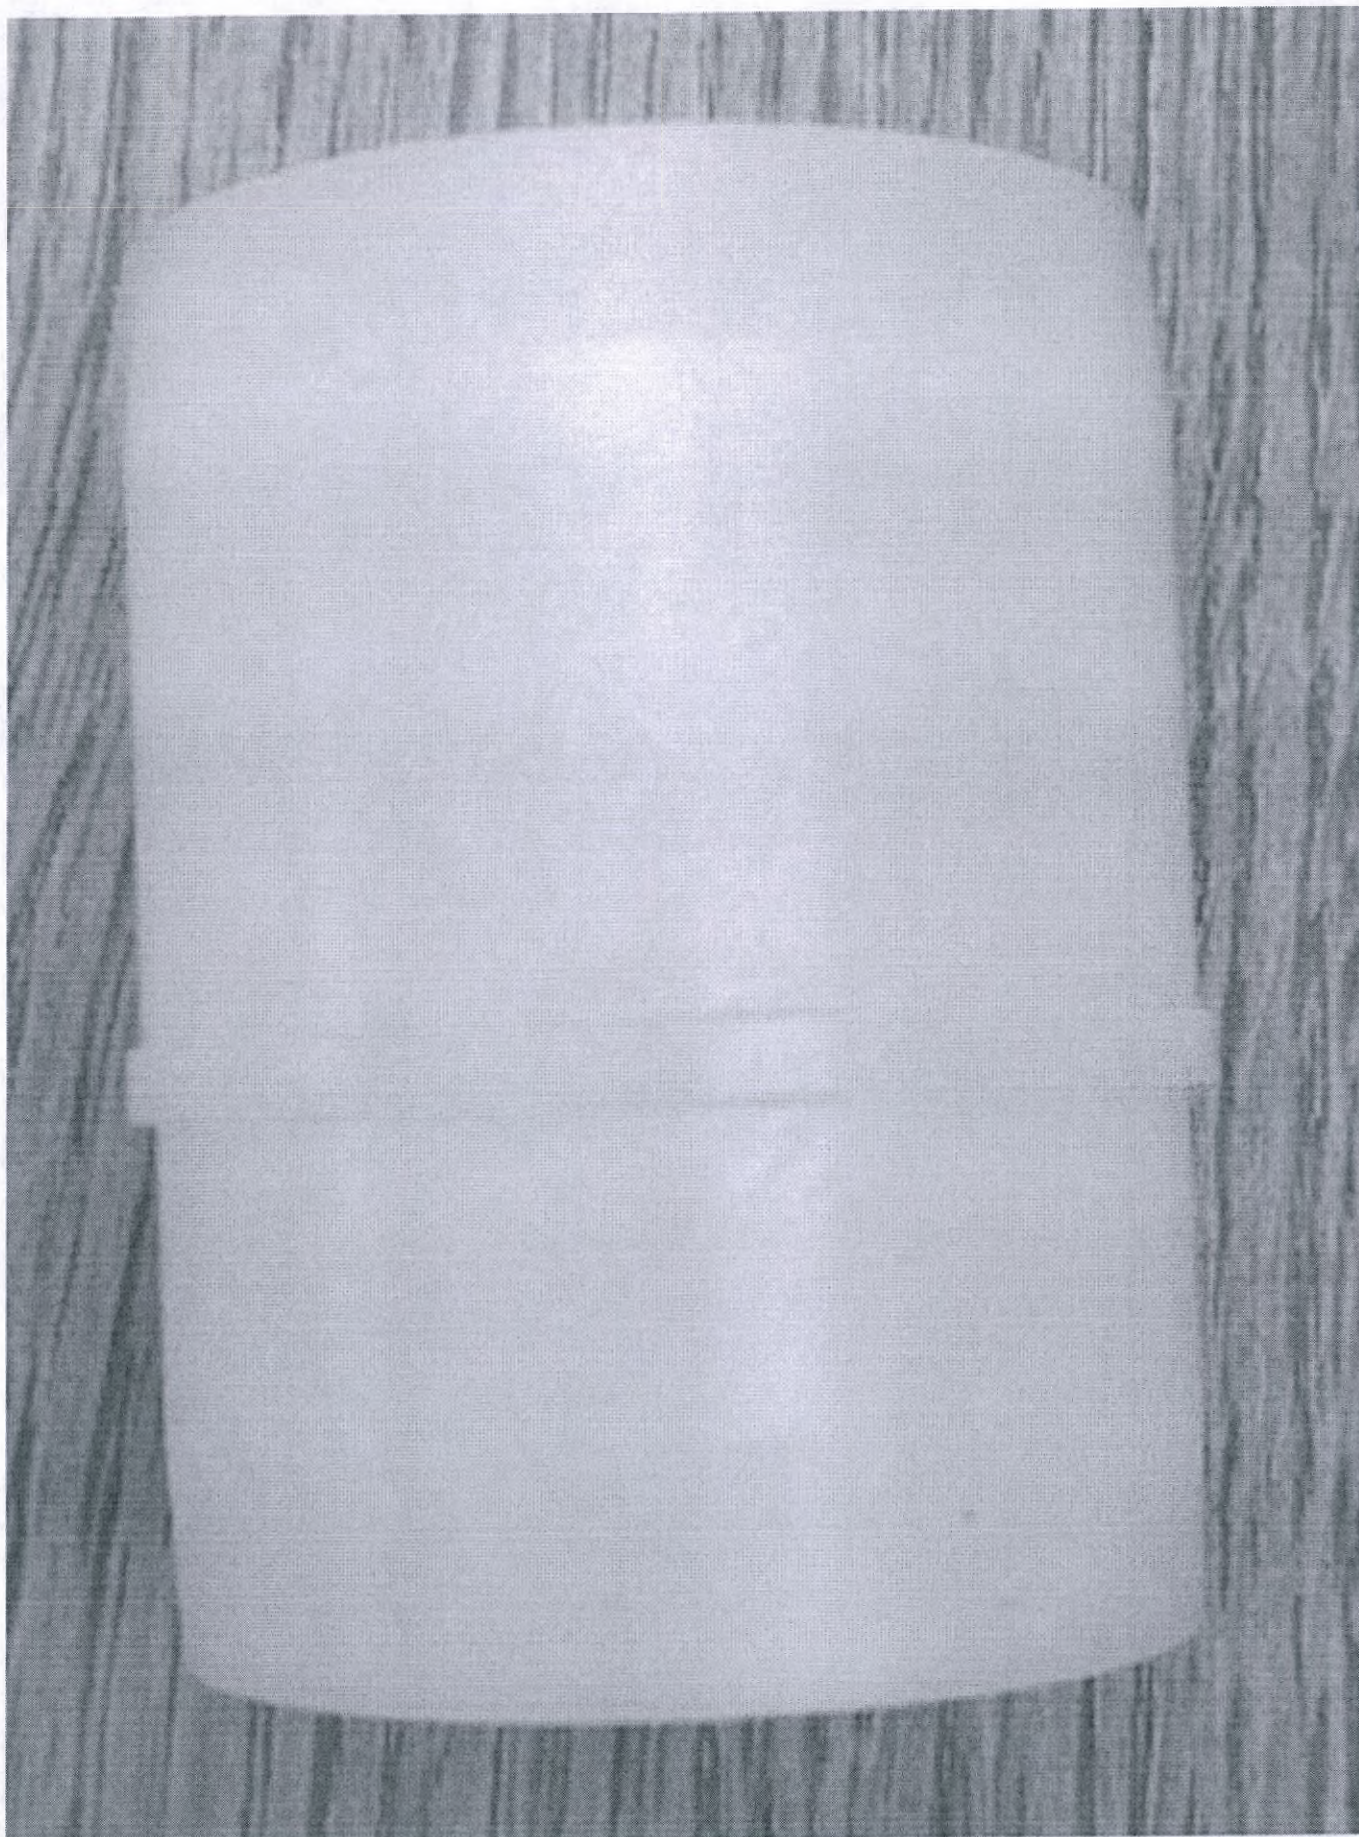

Переходник






Микрофильтр




Шланг отвода воздуха

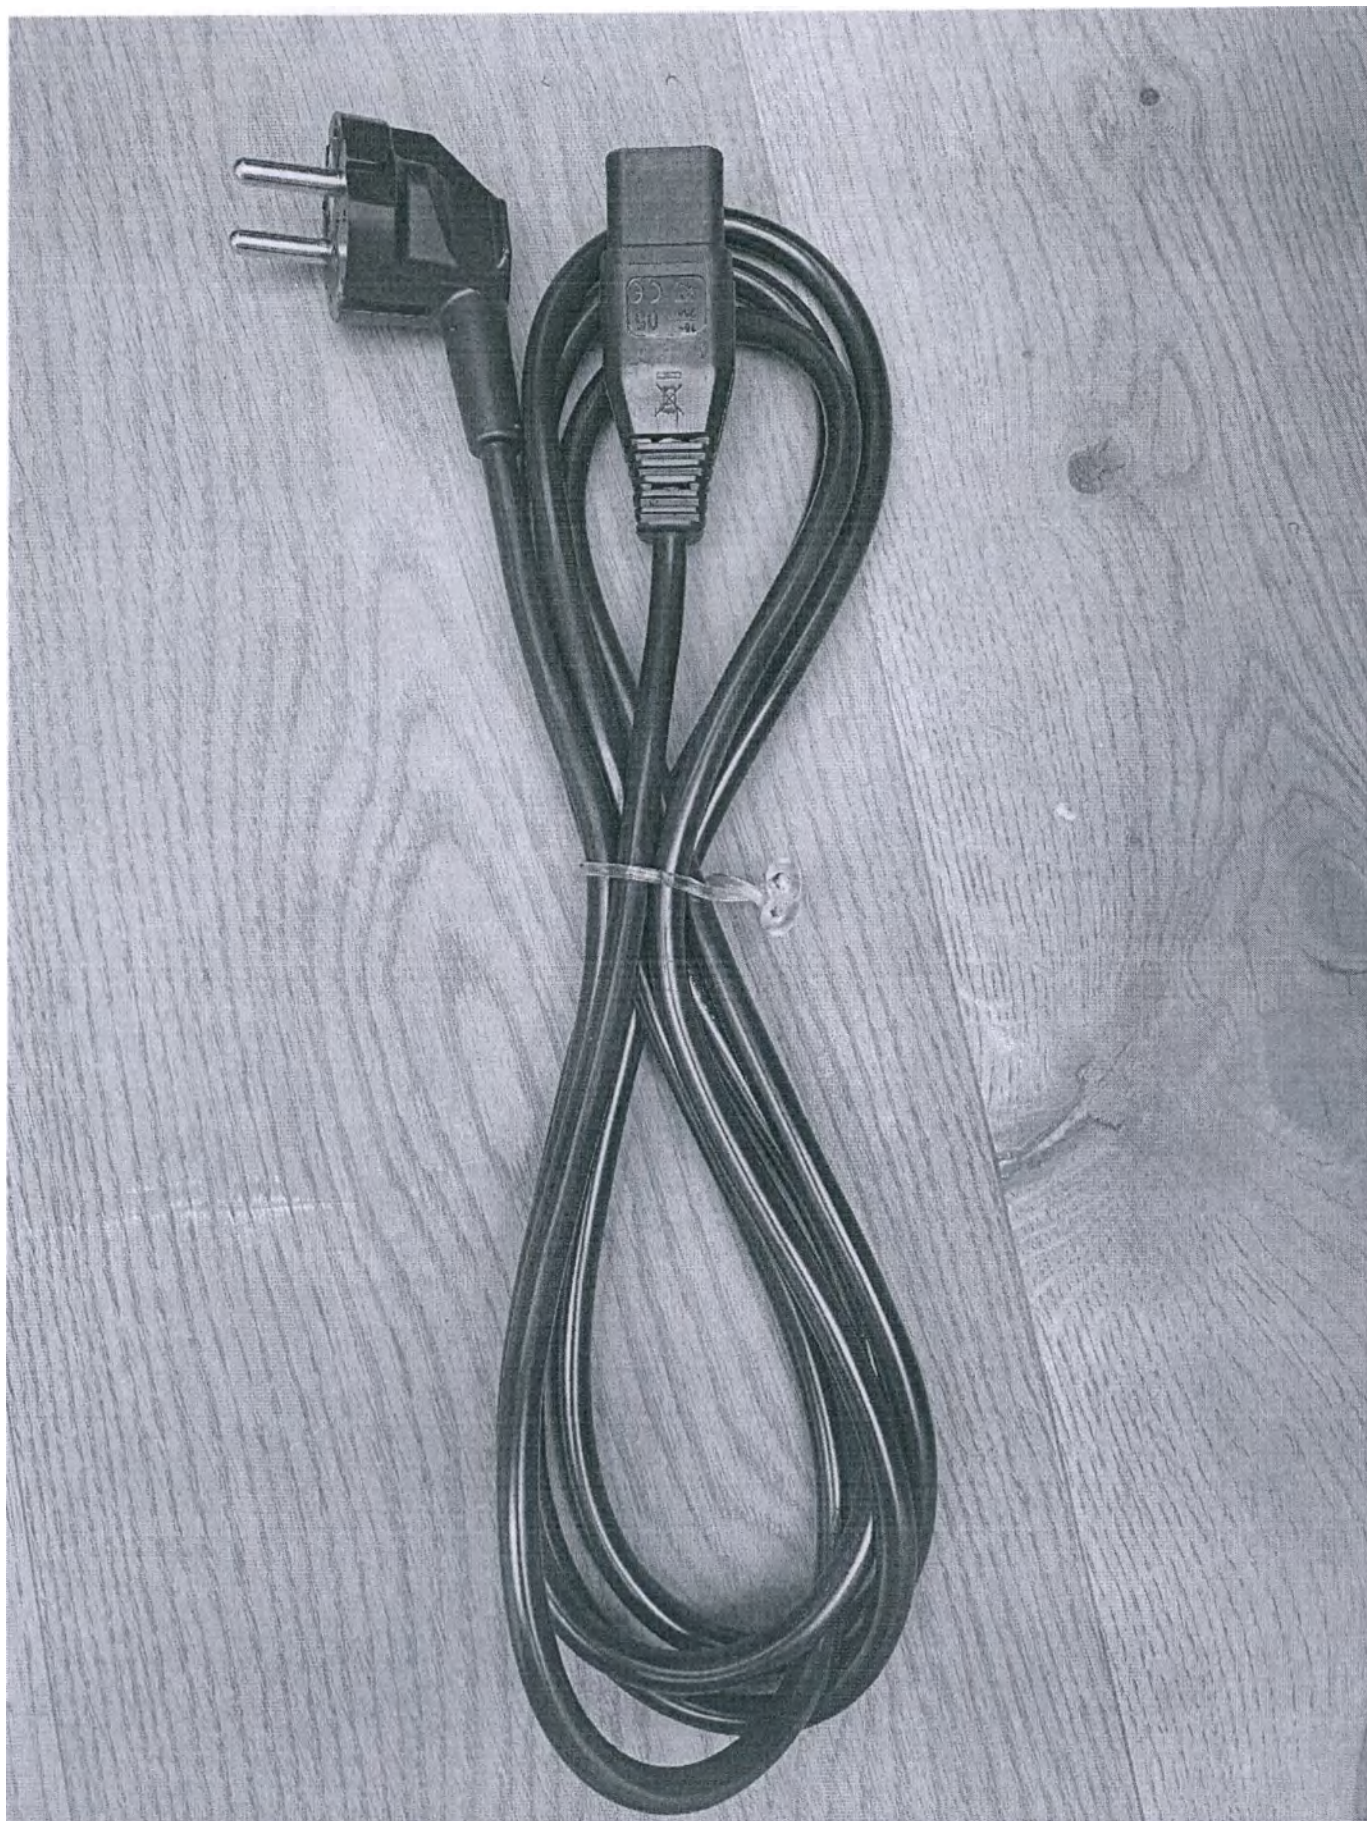

Кабель питания

Кабель питания

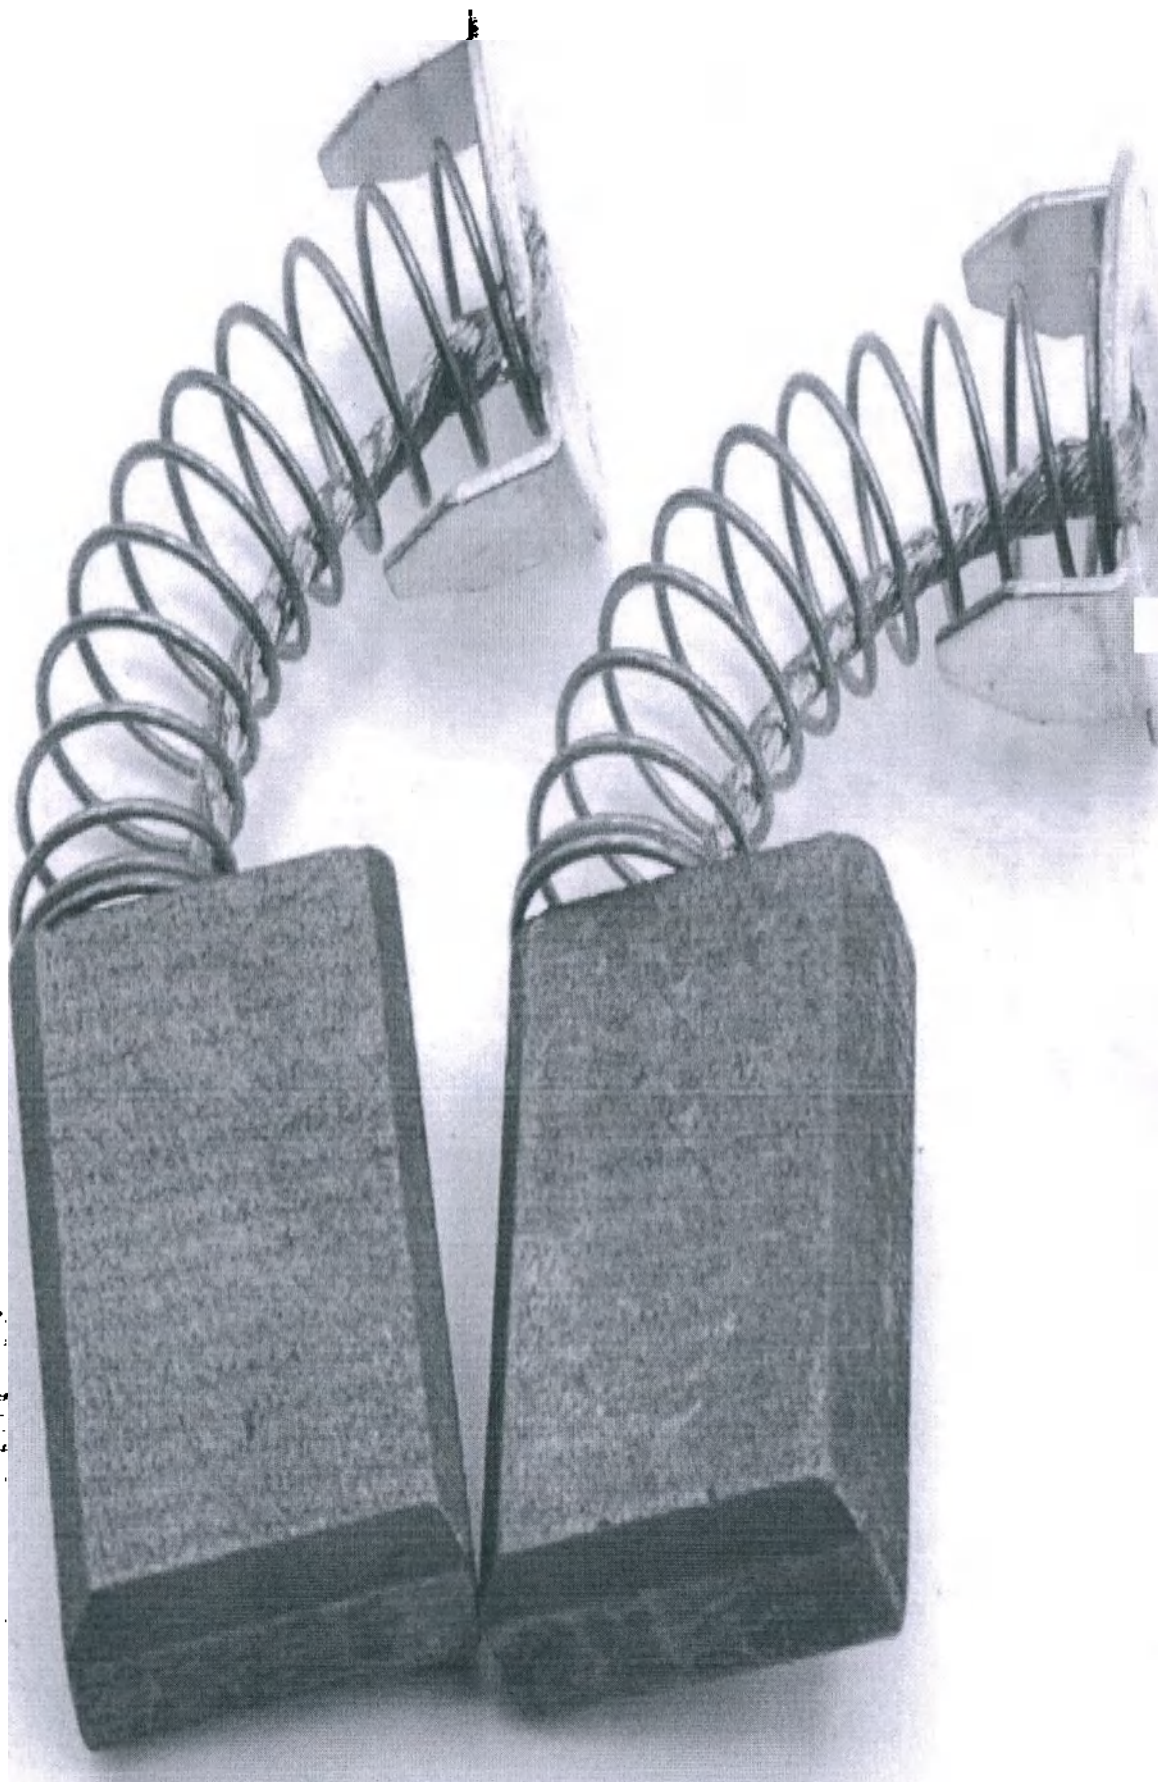

Сменные угольные щетки



Резервуар для смазочно-охлаждающей жидкости Coolstream Tank



Фильтр



Шланг для отвода смазочно-охлаждающей жидкости




Шланг для подачи смазочно-охлаждающей жидкости




Кабель управления




Смазочно-охлаждающая жидкость

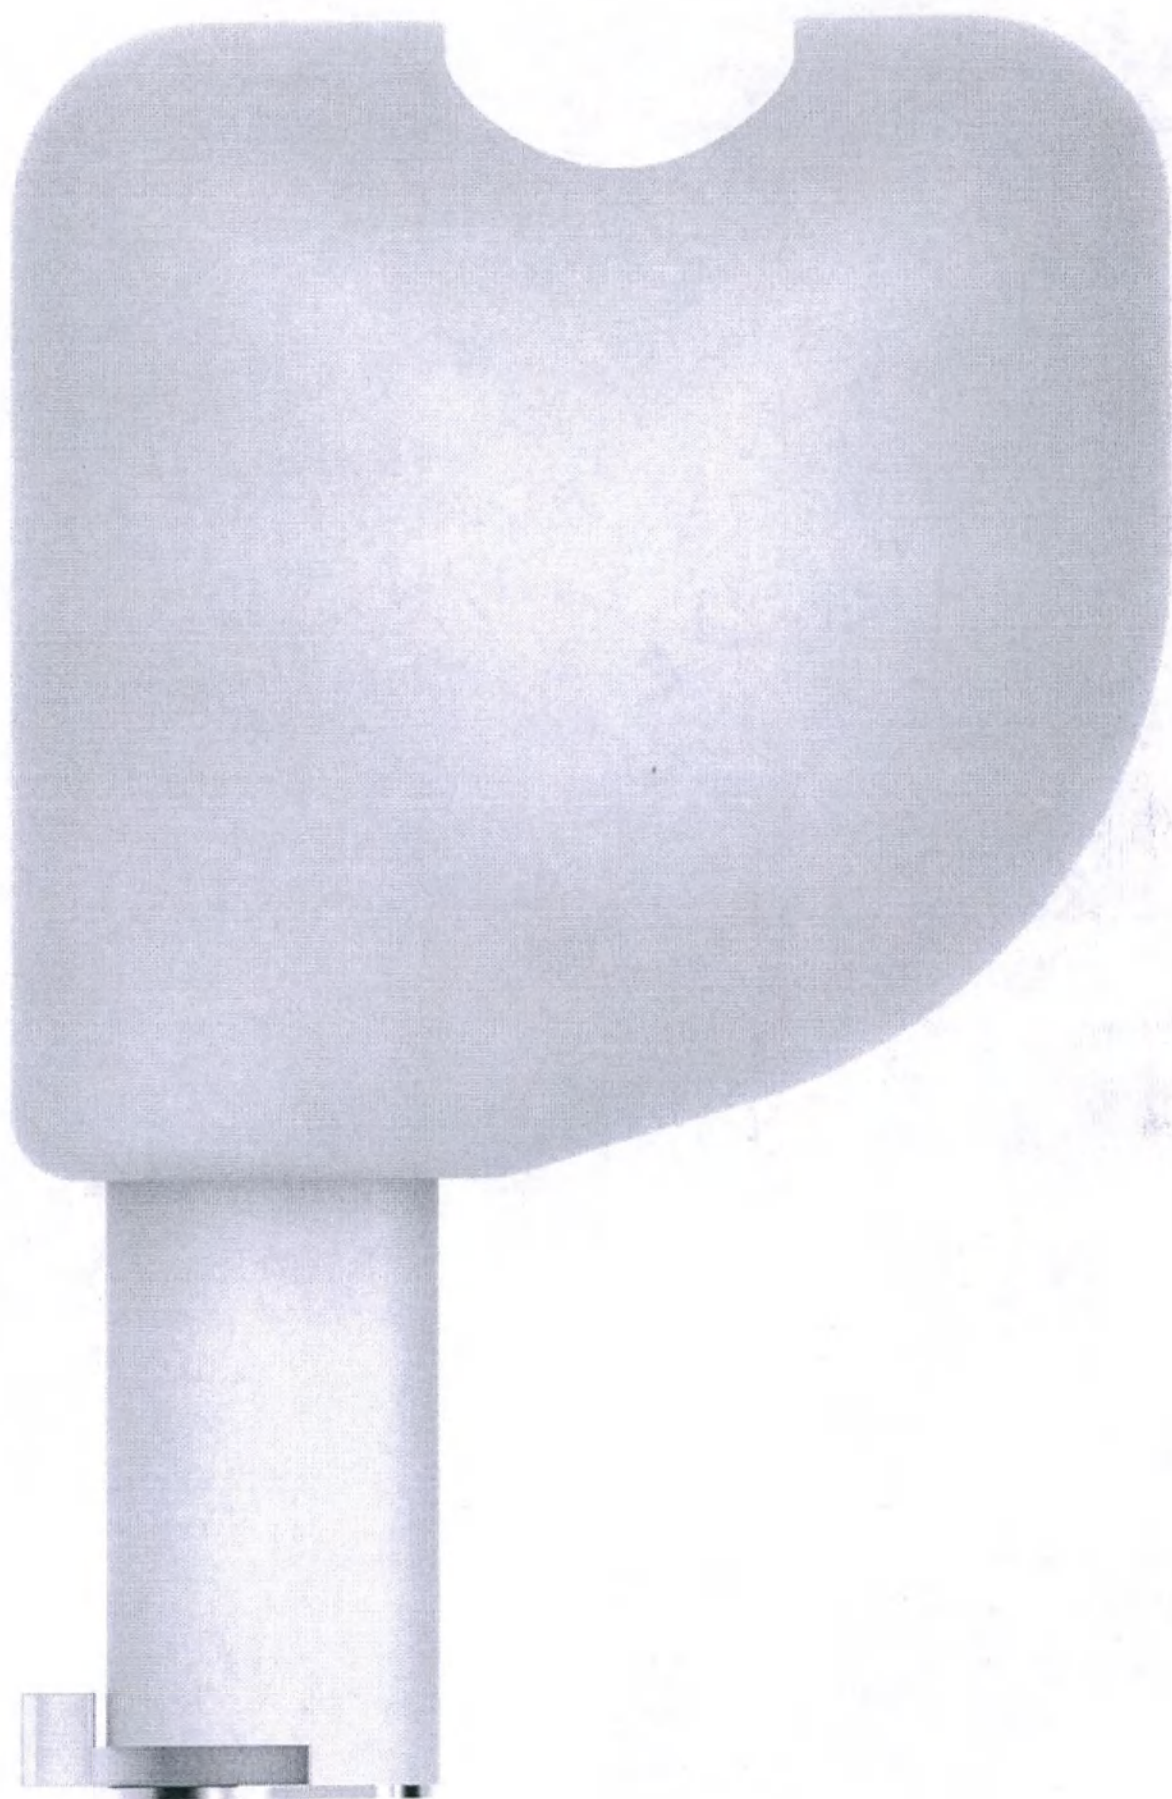


Вытяжной колпак

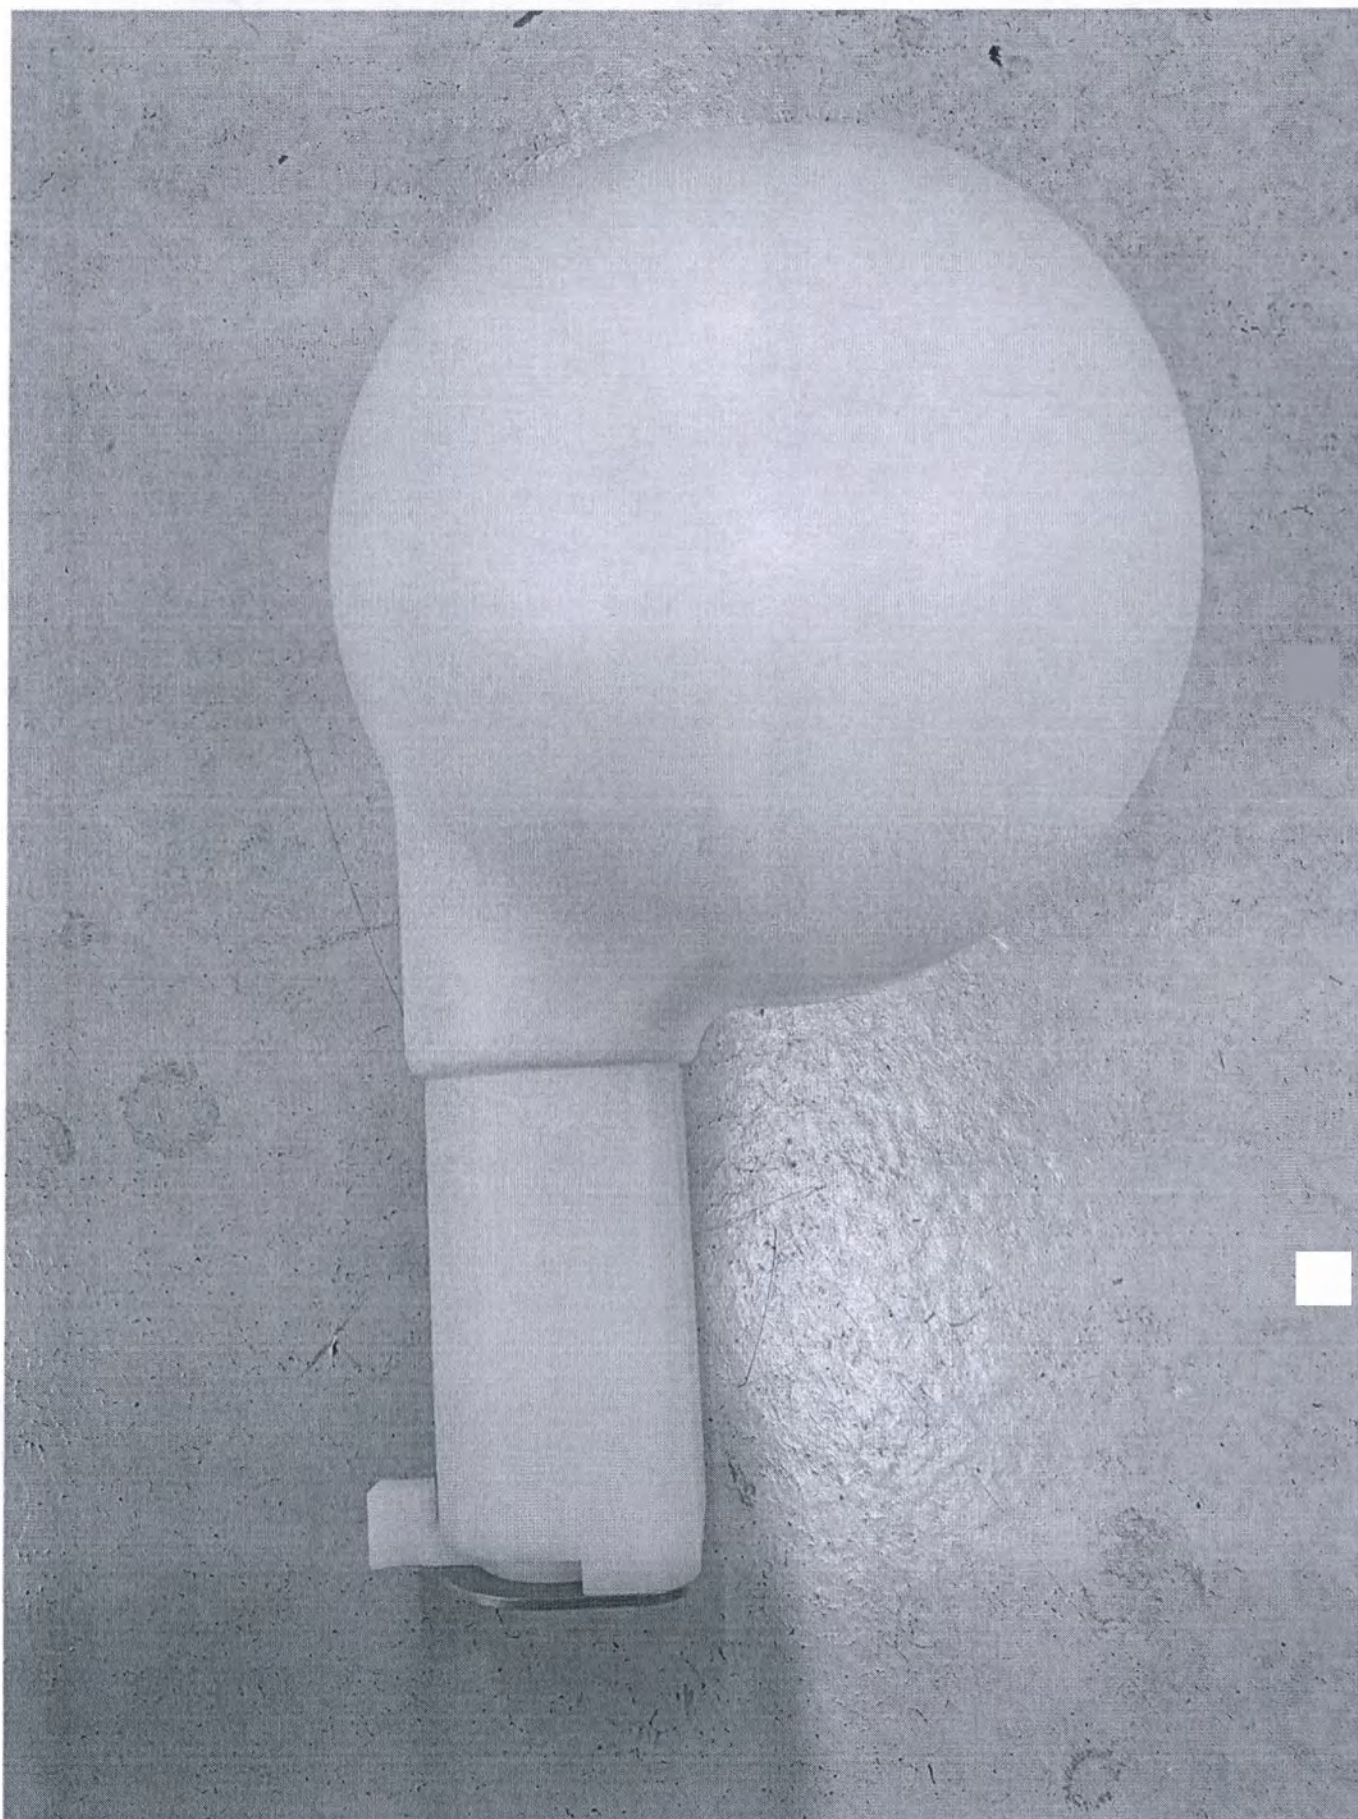

Брызговик

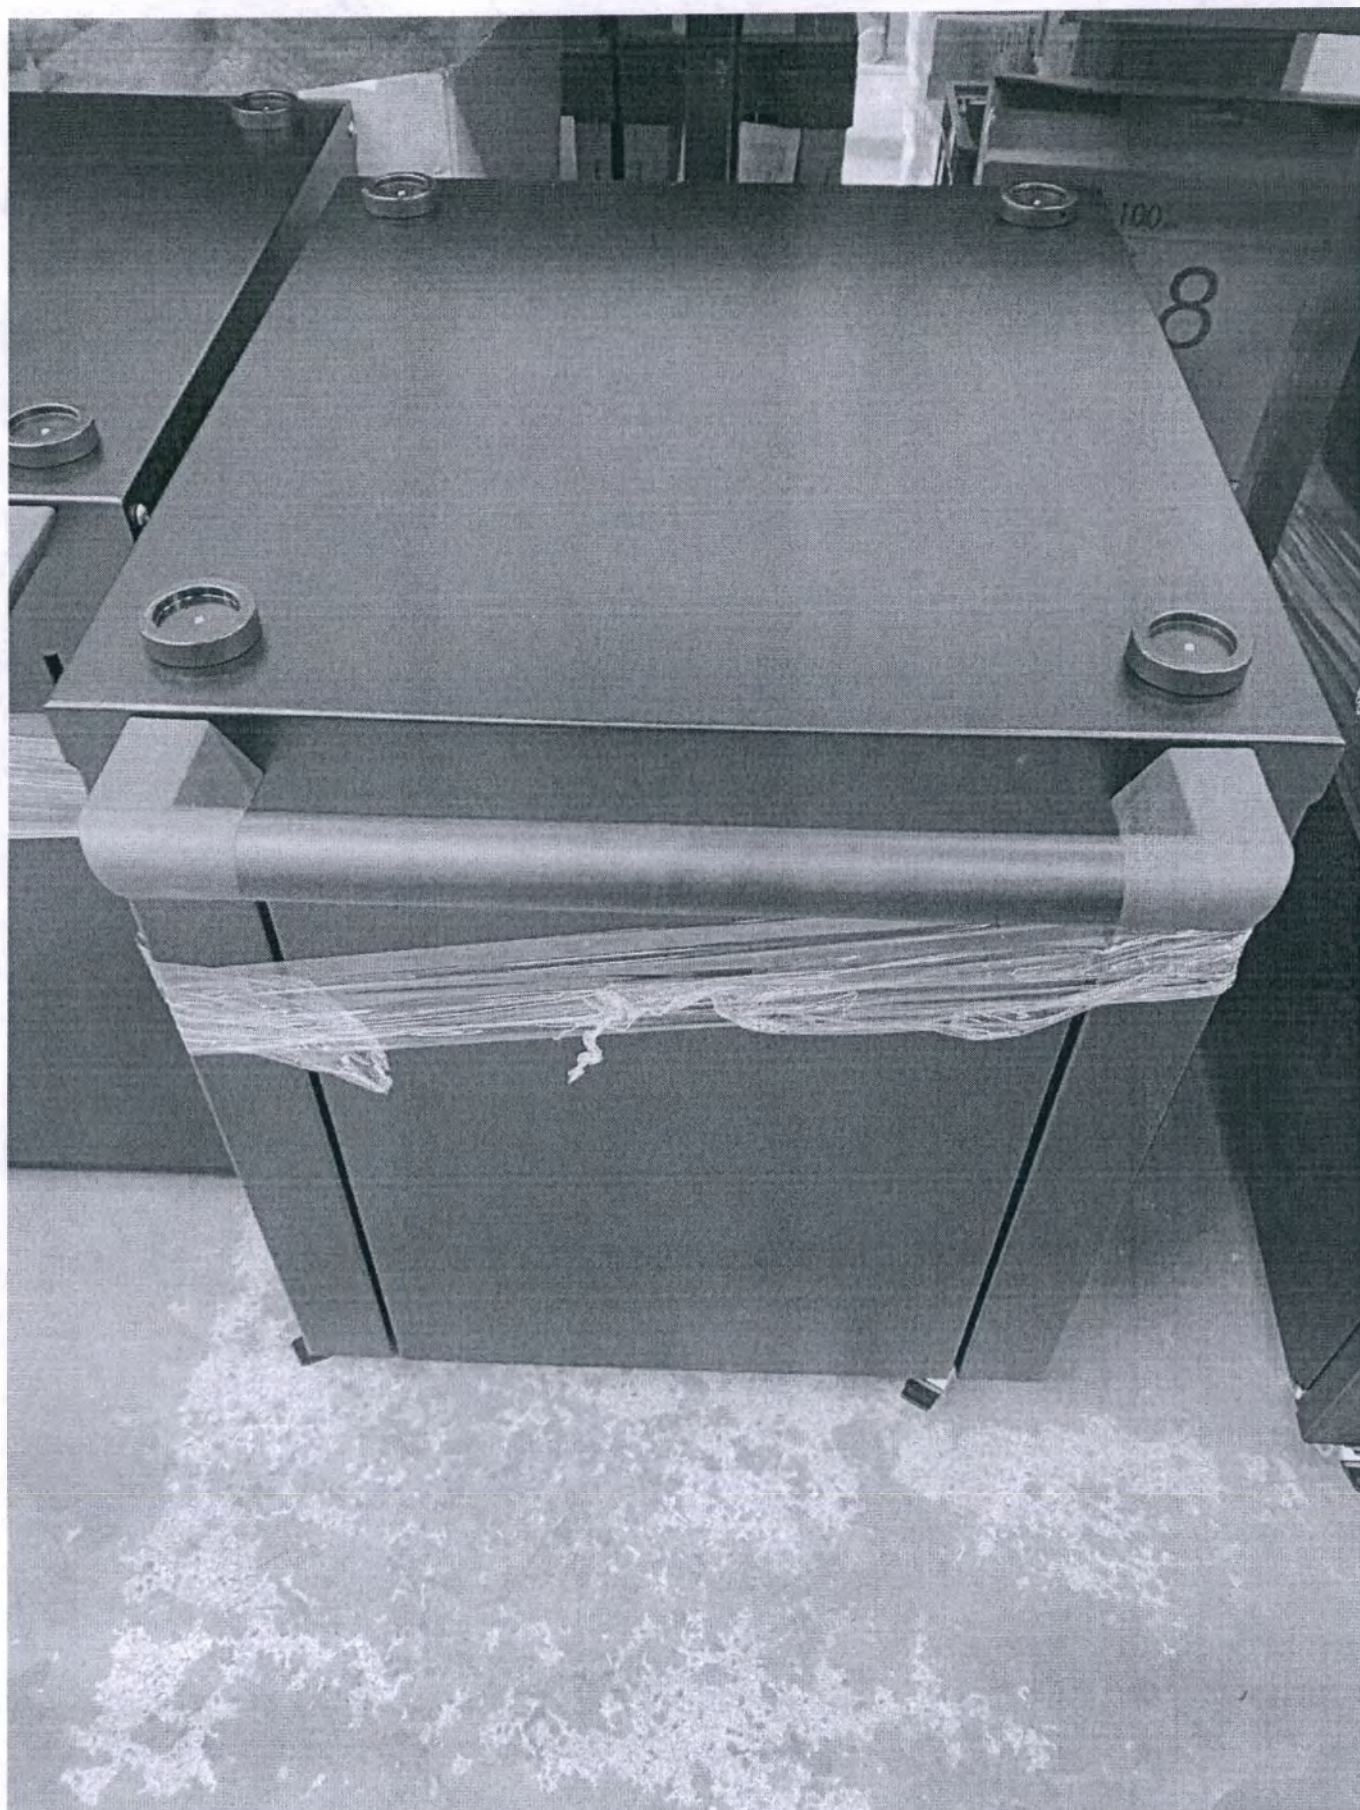


Передвижная тележка Coolstream Cart

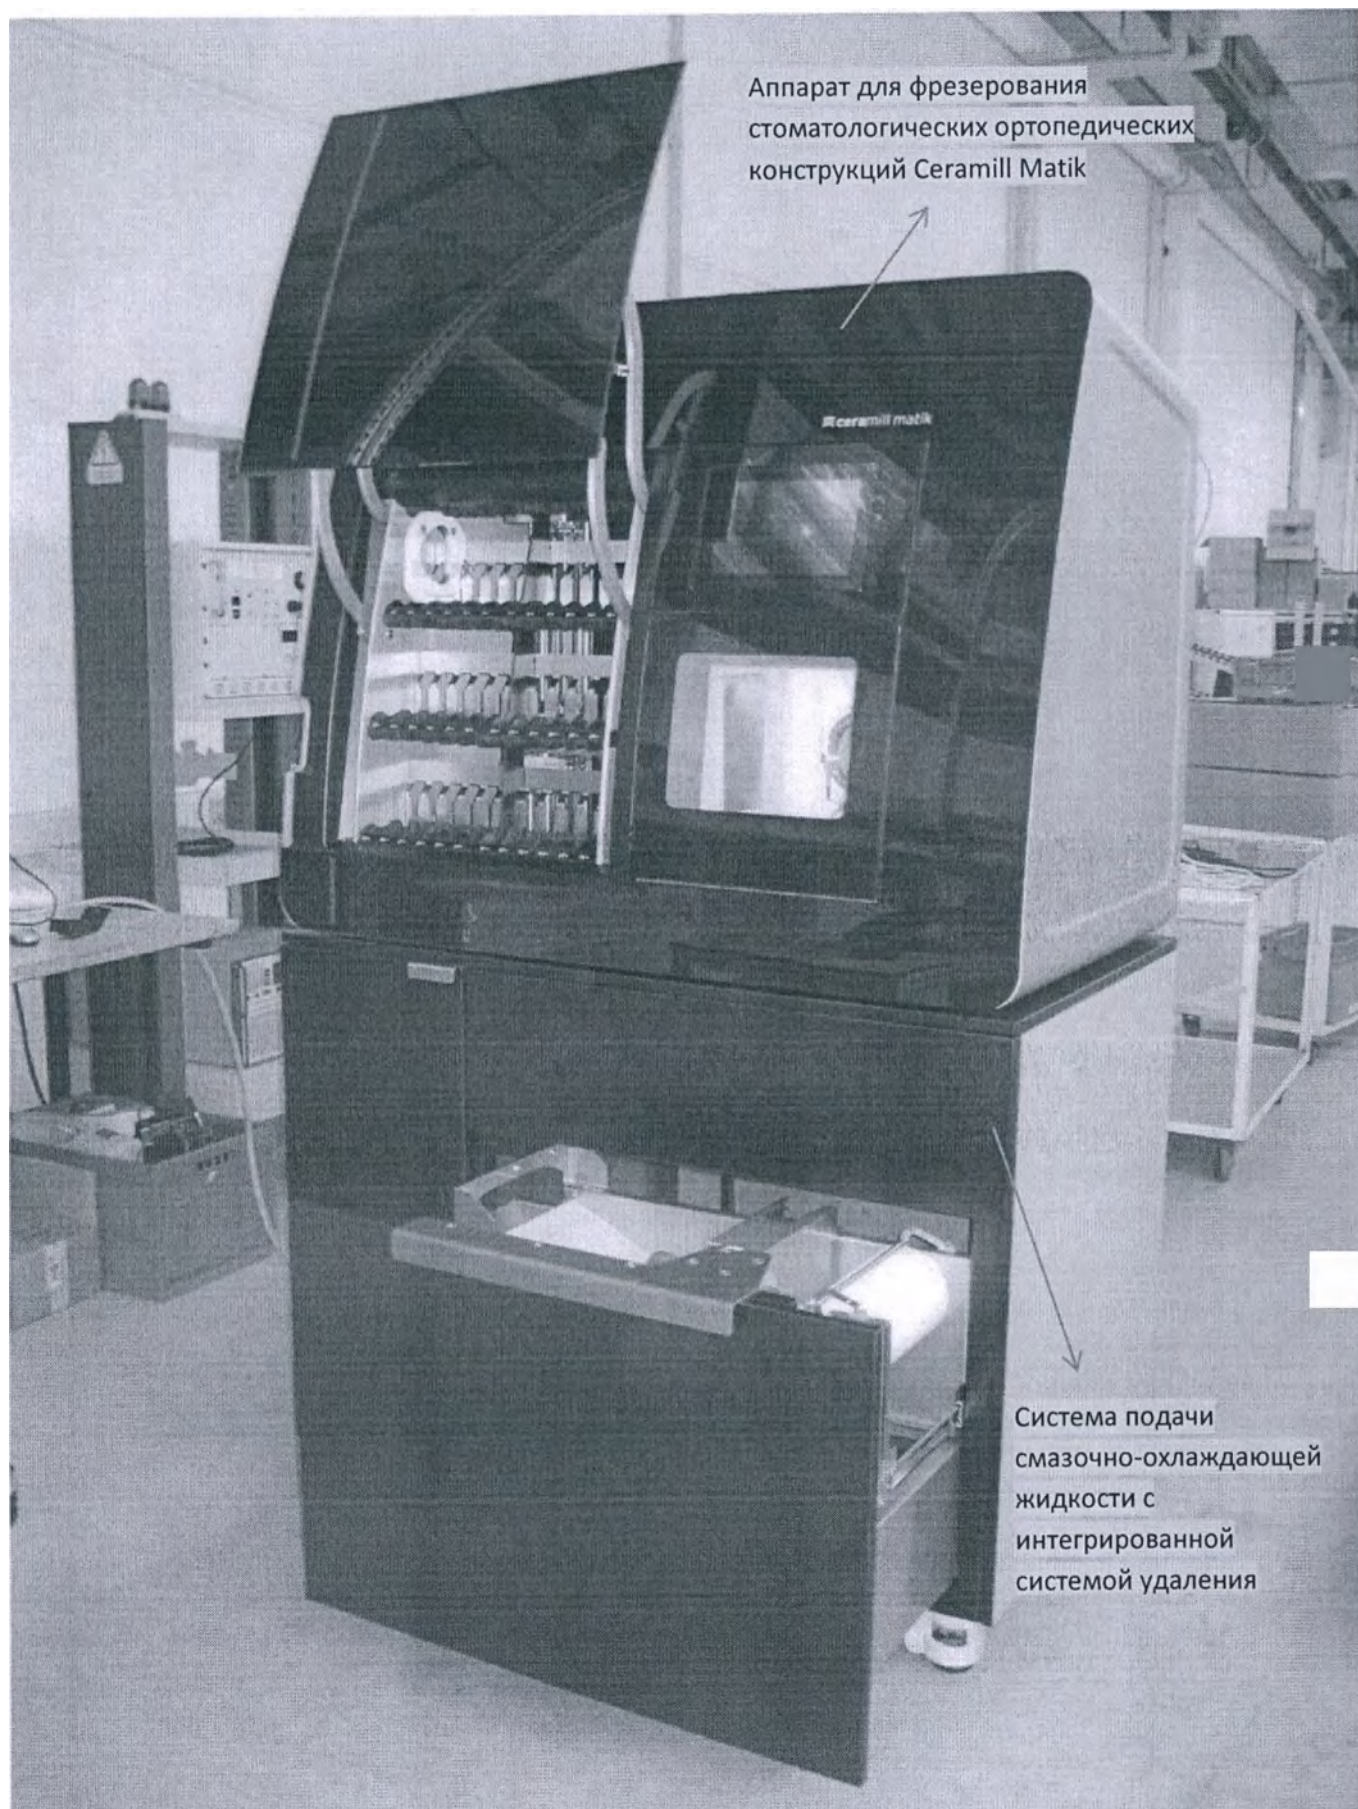

Аппарат для фрезерования
стоматологических ортопедических
конструкций Ceramill Matik

Система подачи
смазочно-охлаждающей
жидкости с
интегрированной
системой удаления


Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Matik и система подачи смазочно-охлаждающей жидкости с интегрированной системой удаления стружки Ceramill Cleanstream. Вид спереди

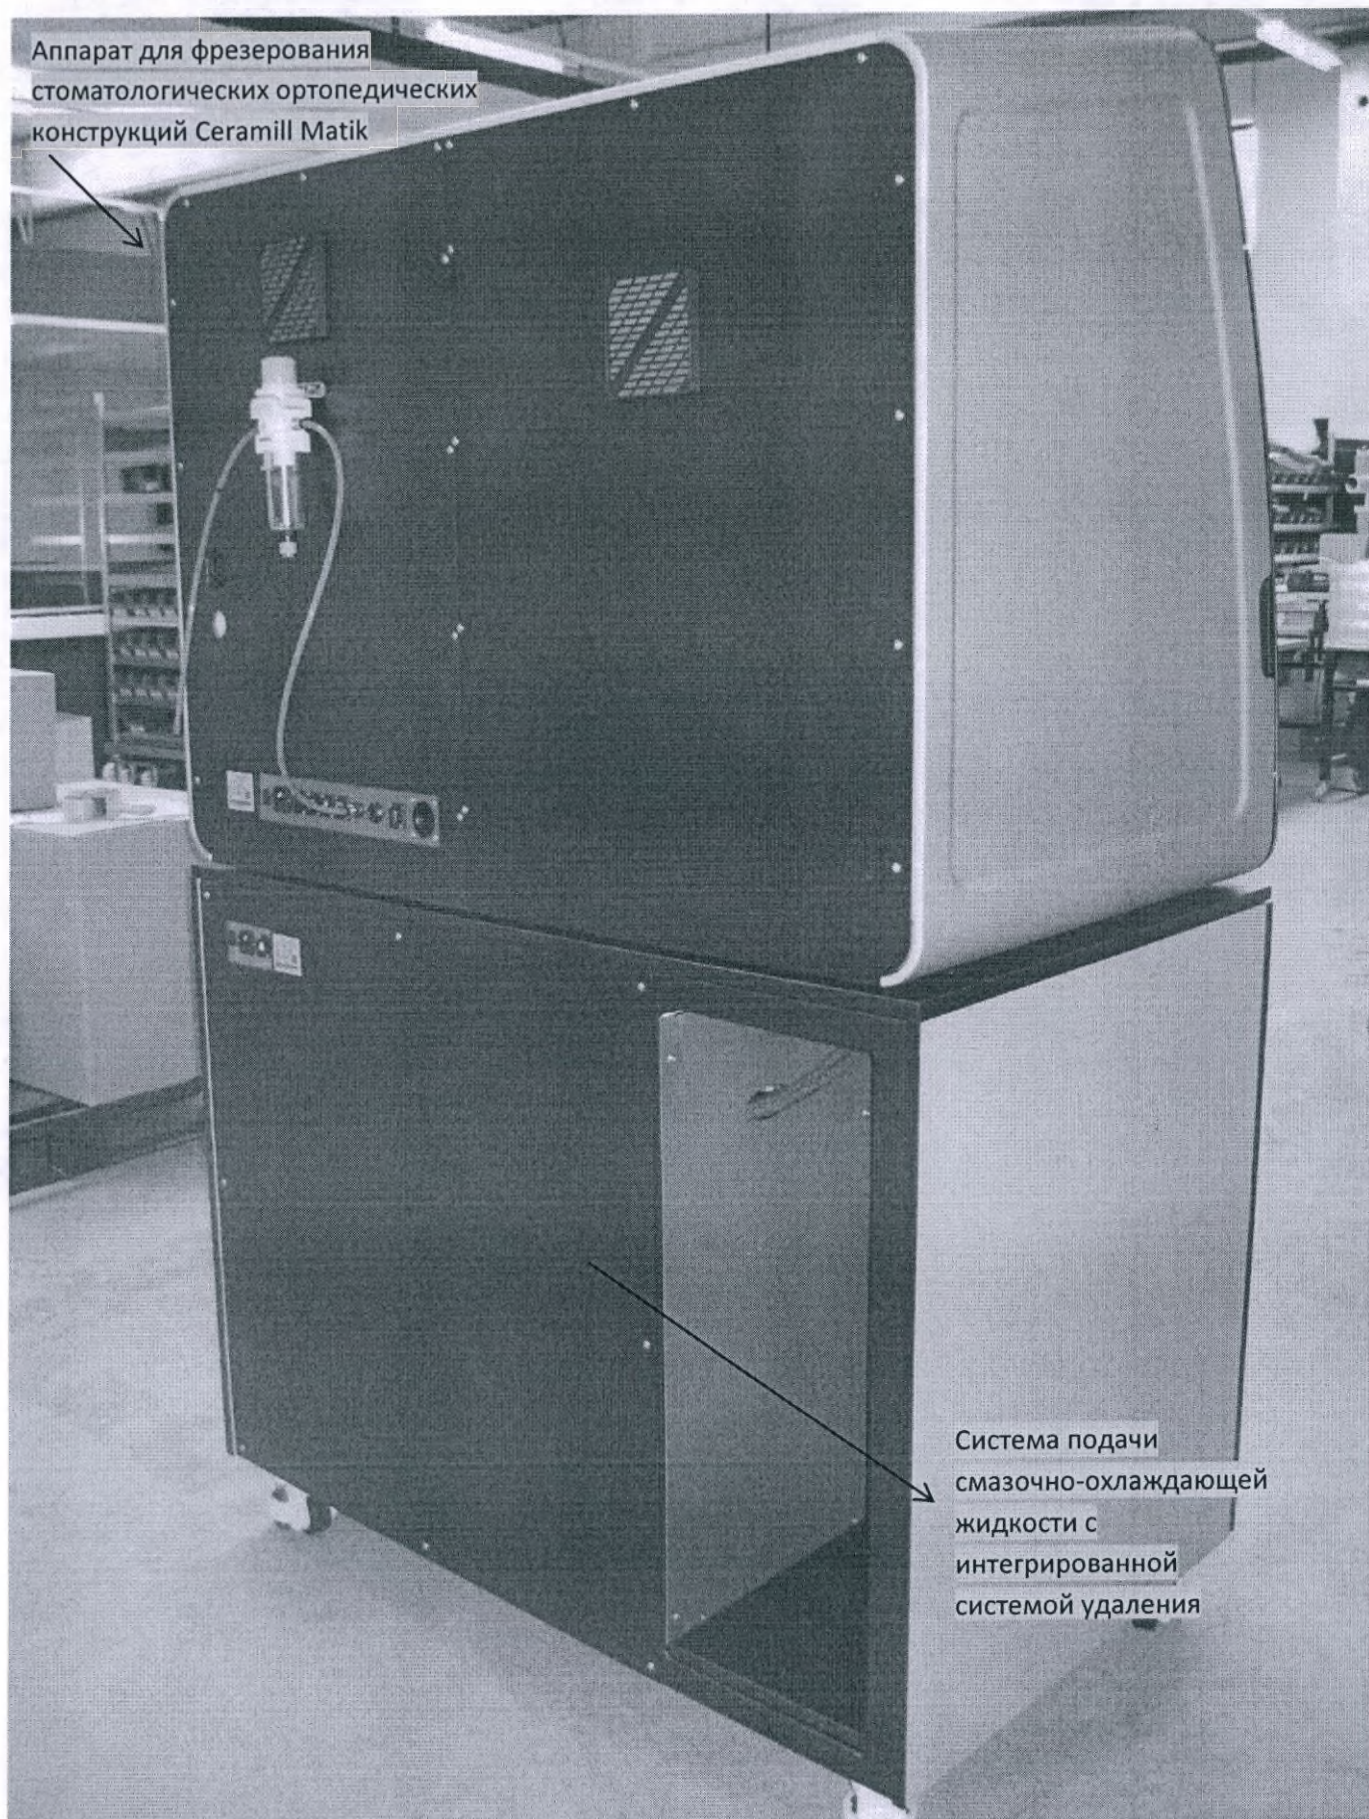


Аппарат для фрезерования
стоматологических ортопедических
конструкций Ceramill Matik

Система подачи
смазочно-охлаждающей
жидкости с
интегрированной
системой удаления


Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Matik и система подачи смазочно-охлаждающей жидкости с интегрированной системой удаления стружки Ceramill Cleanstream. Вид сзади

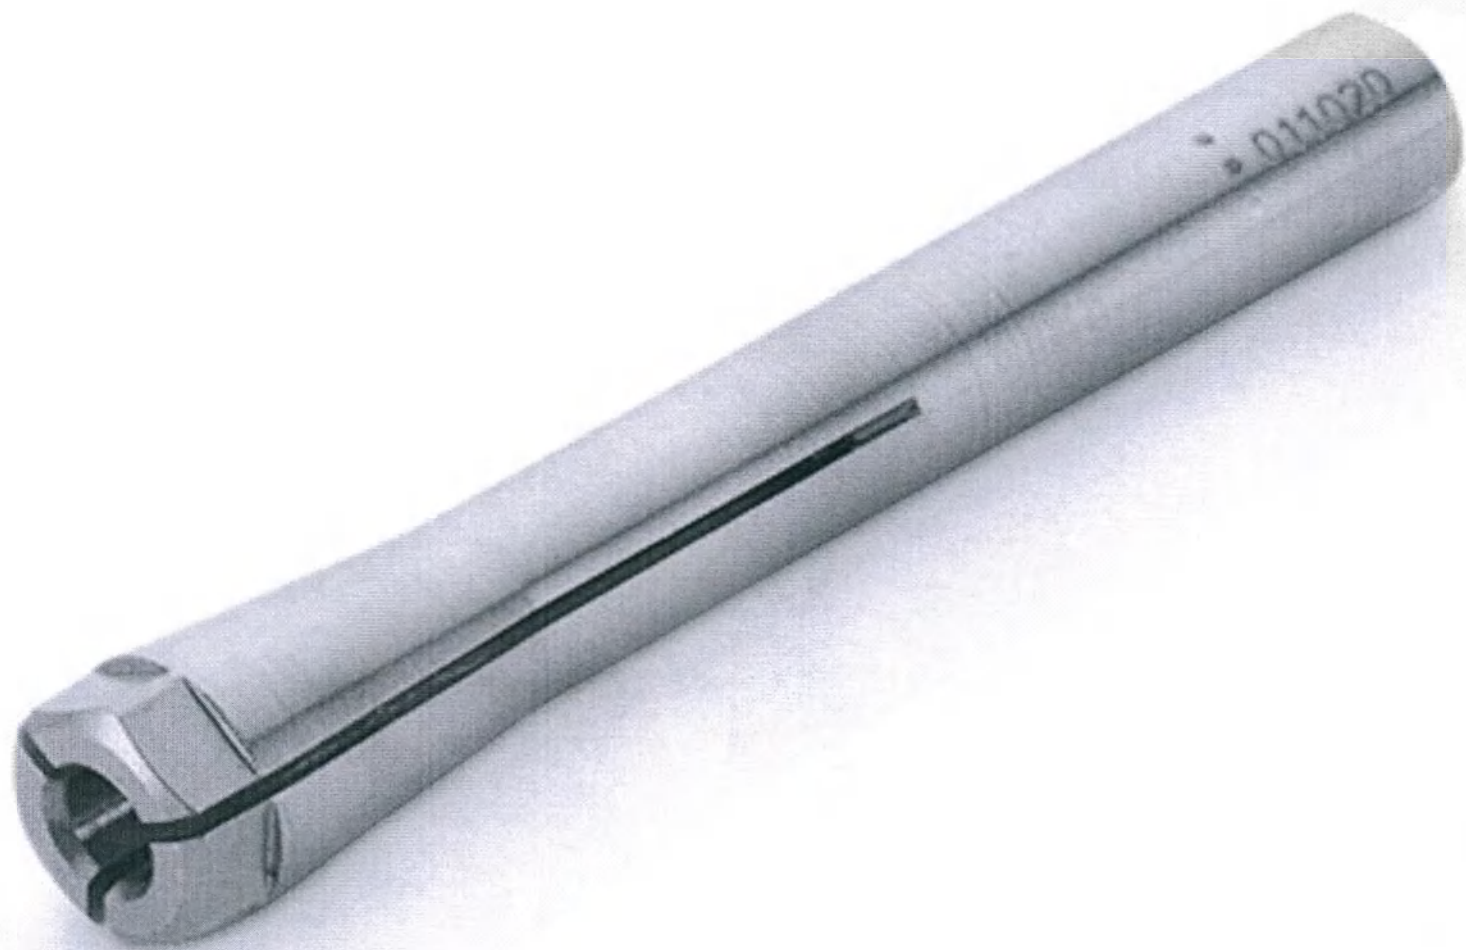

Цанга

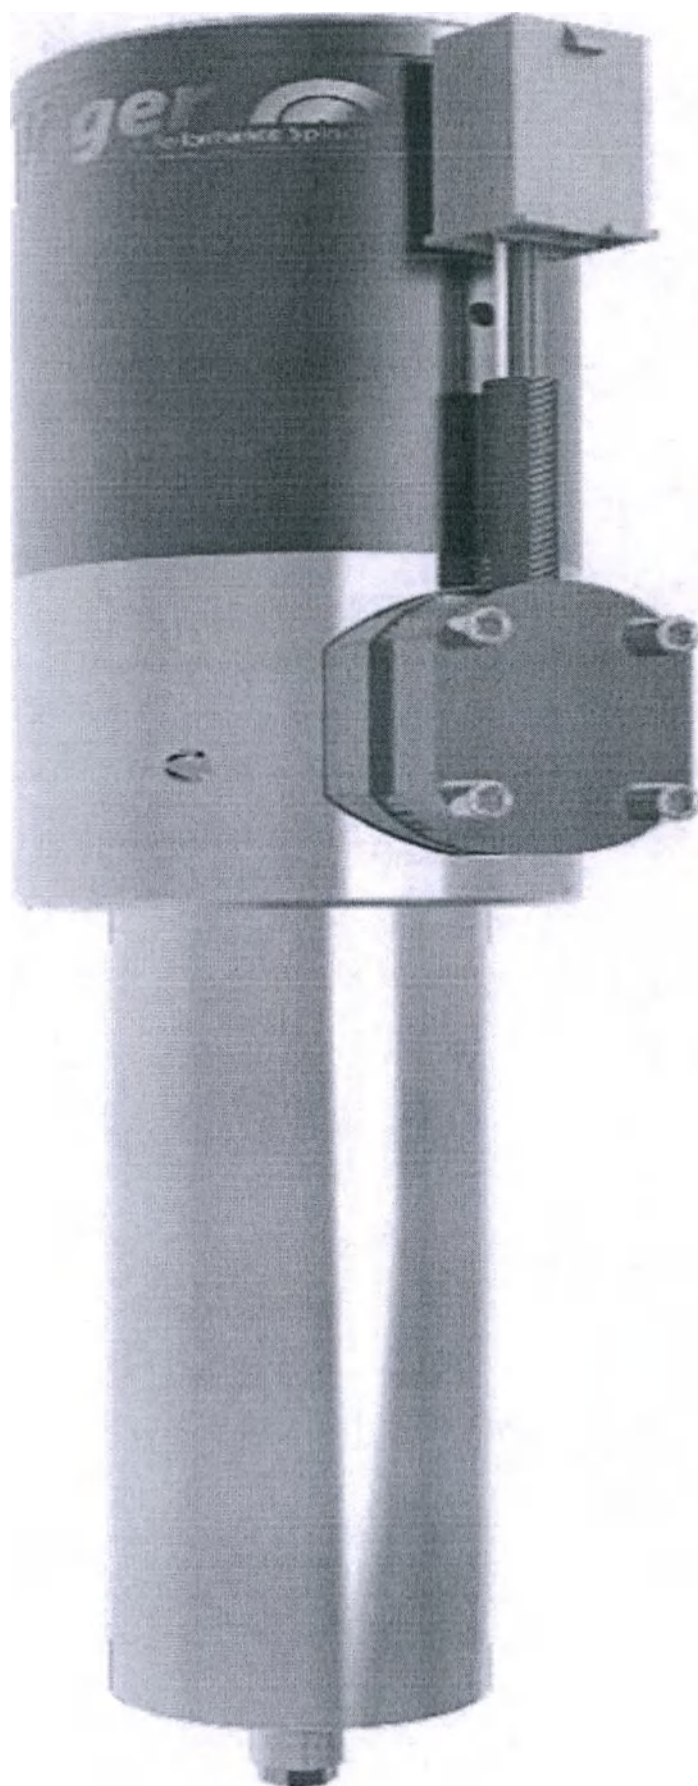


Шпиндель Jäger

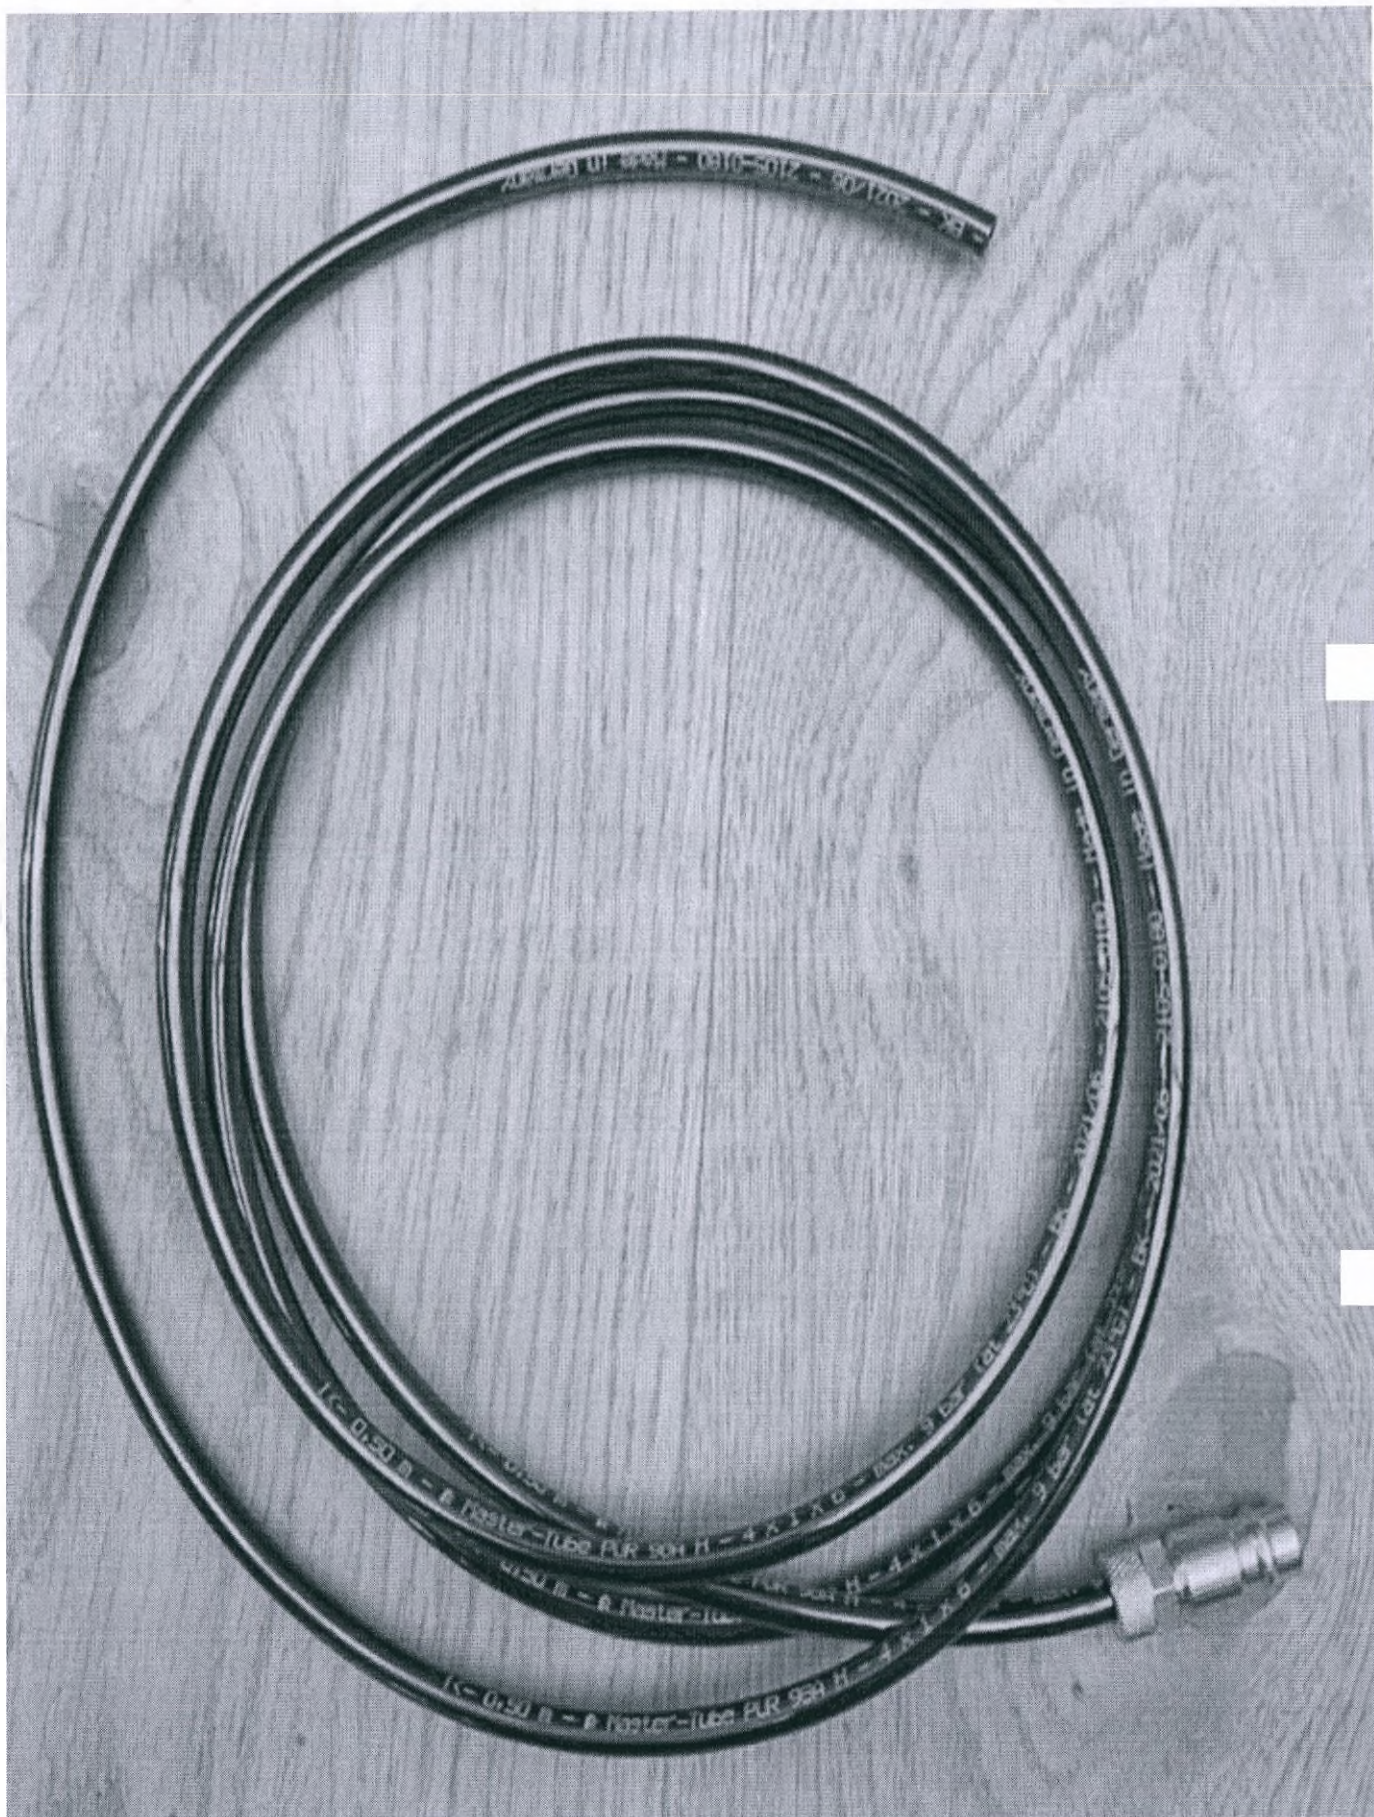


Пневматический шланг 2,5 м.




Пневматический шланг 0,3 м.

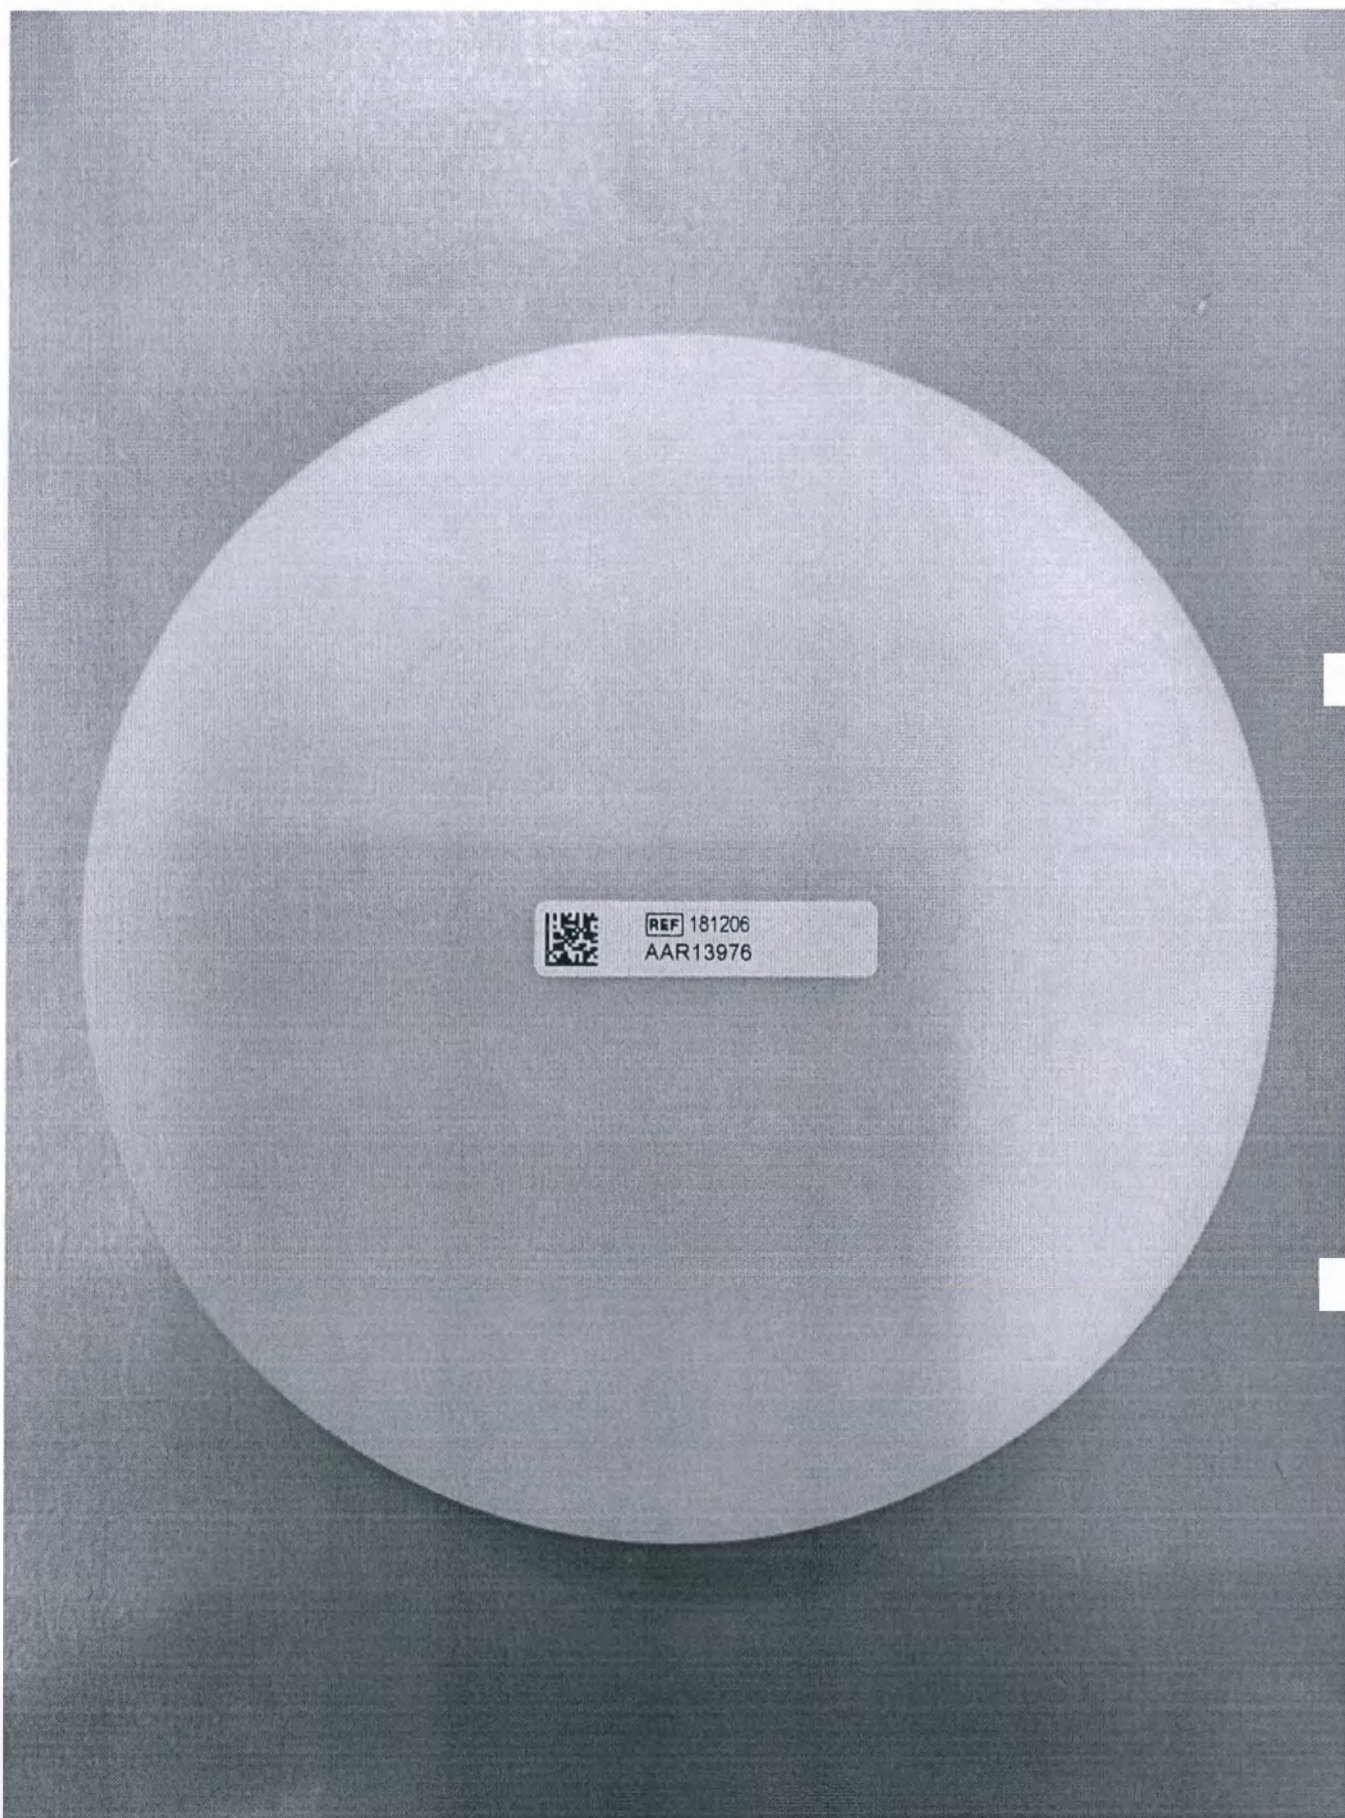


Заготовка для тестирования и калибровки $\varnothing 98$

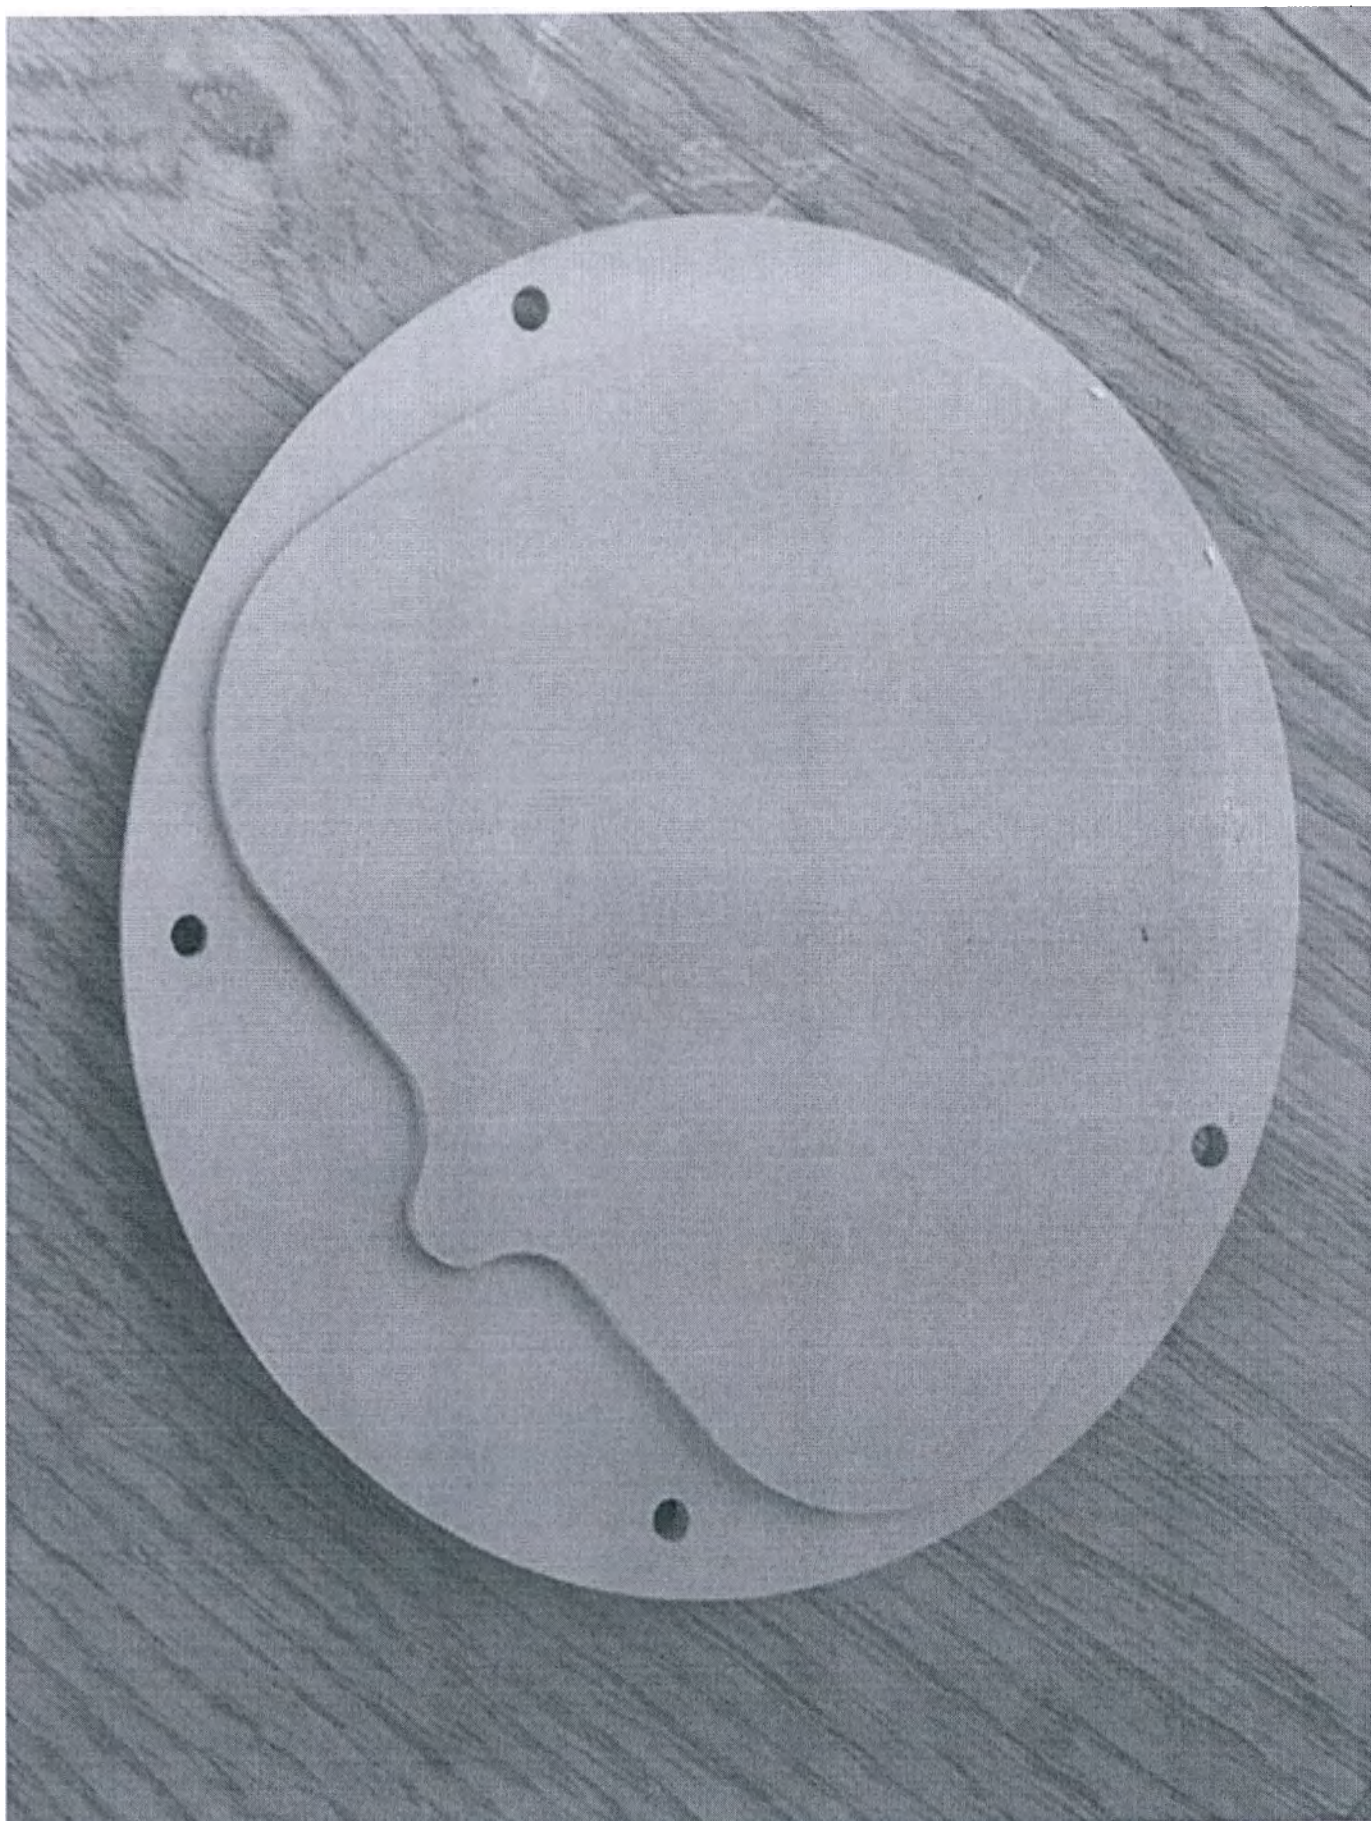


Заготовка для тестирования и калибровки $\varnothing 72$

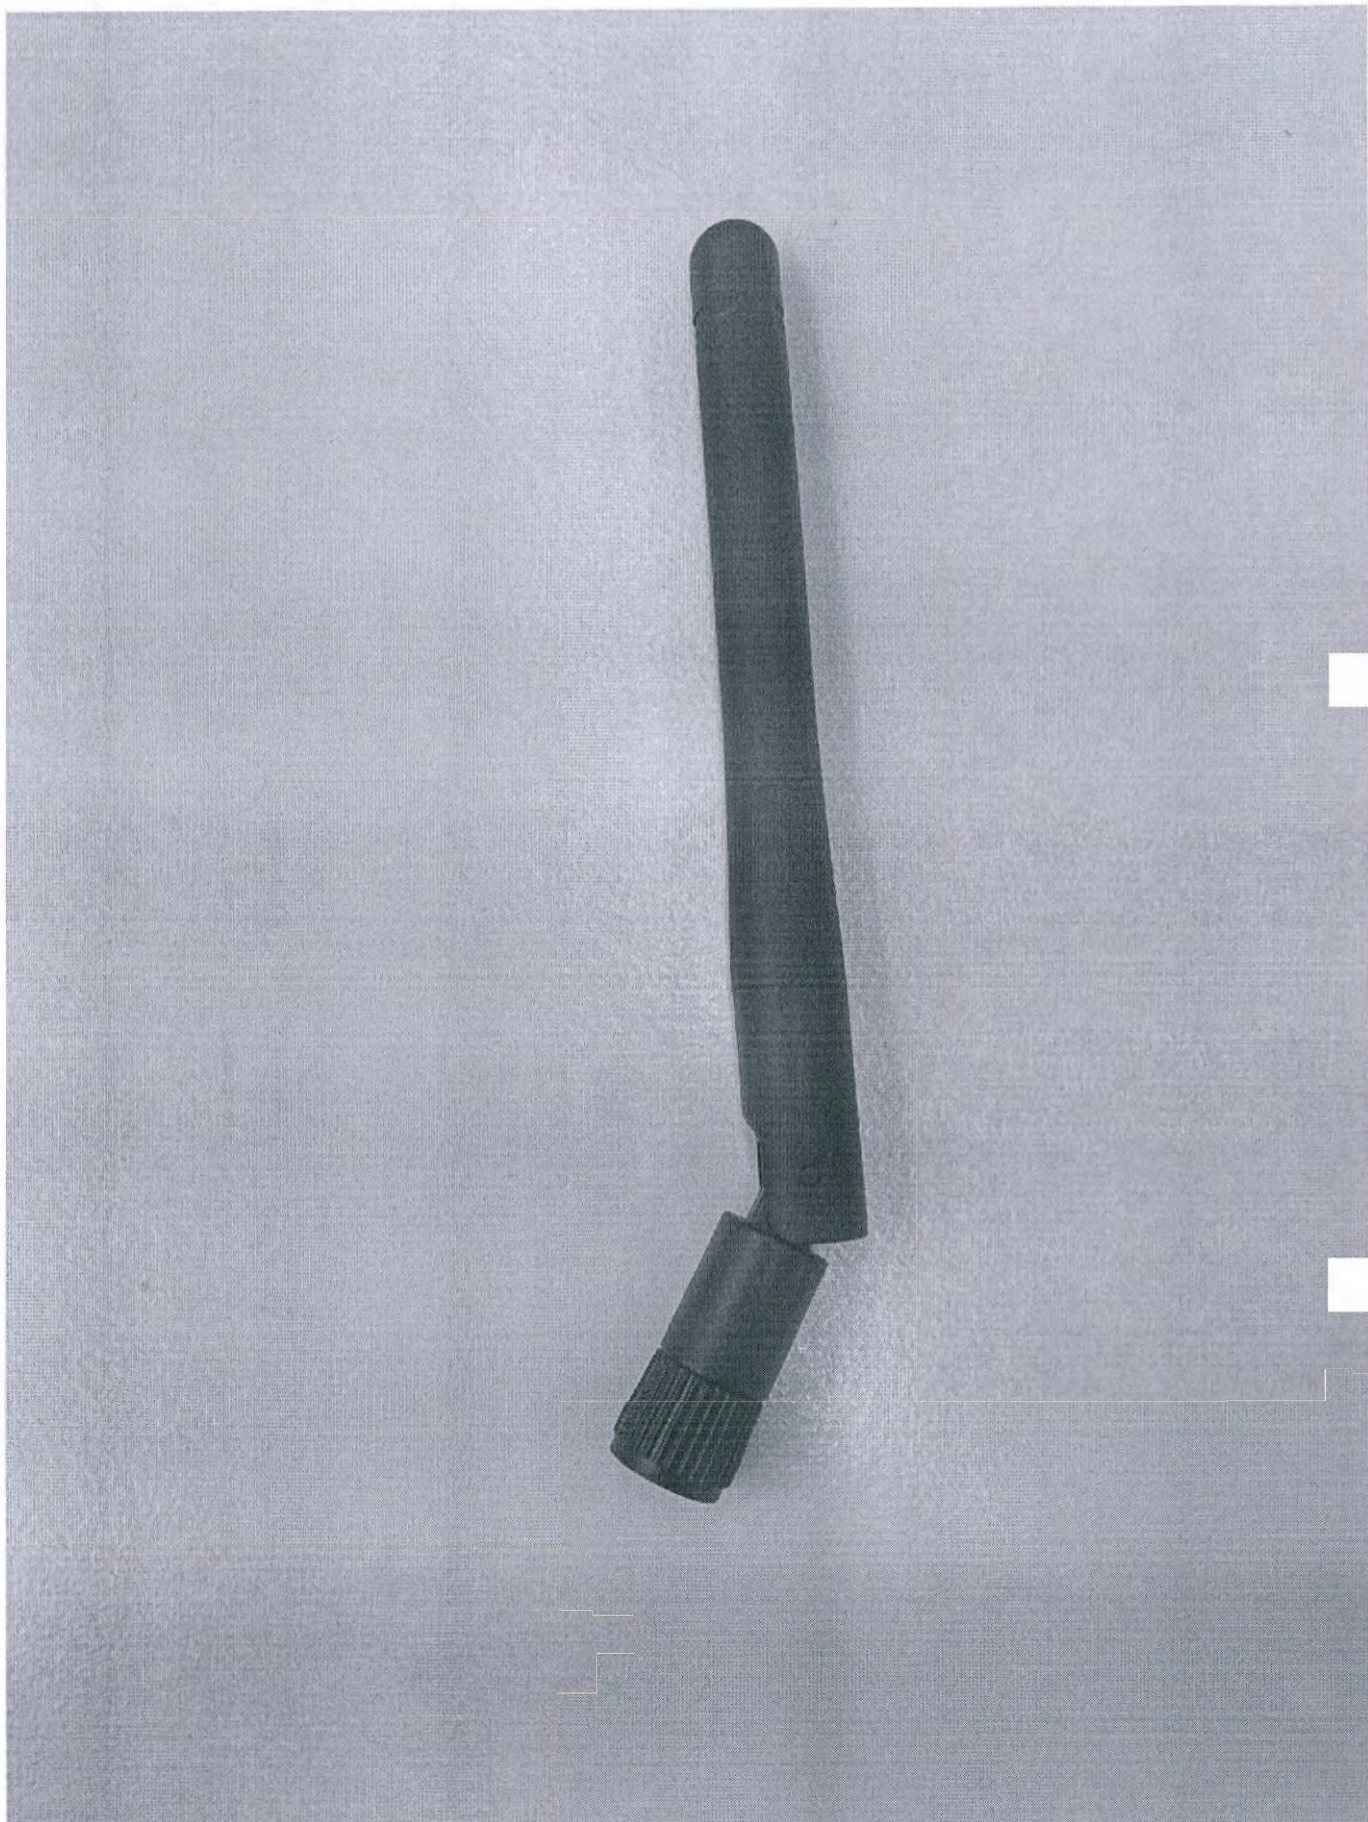


WLAN антенна

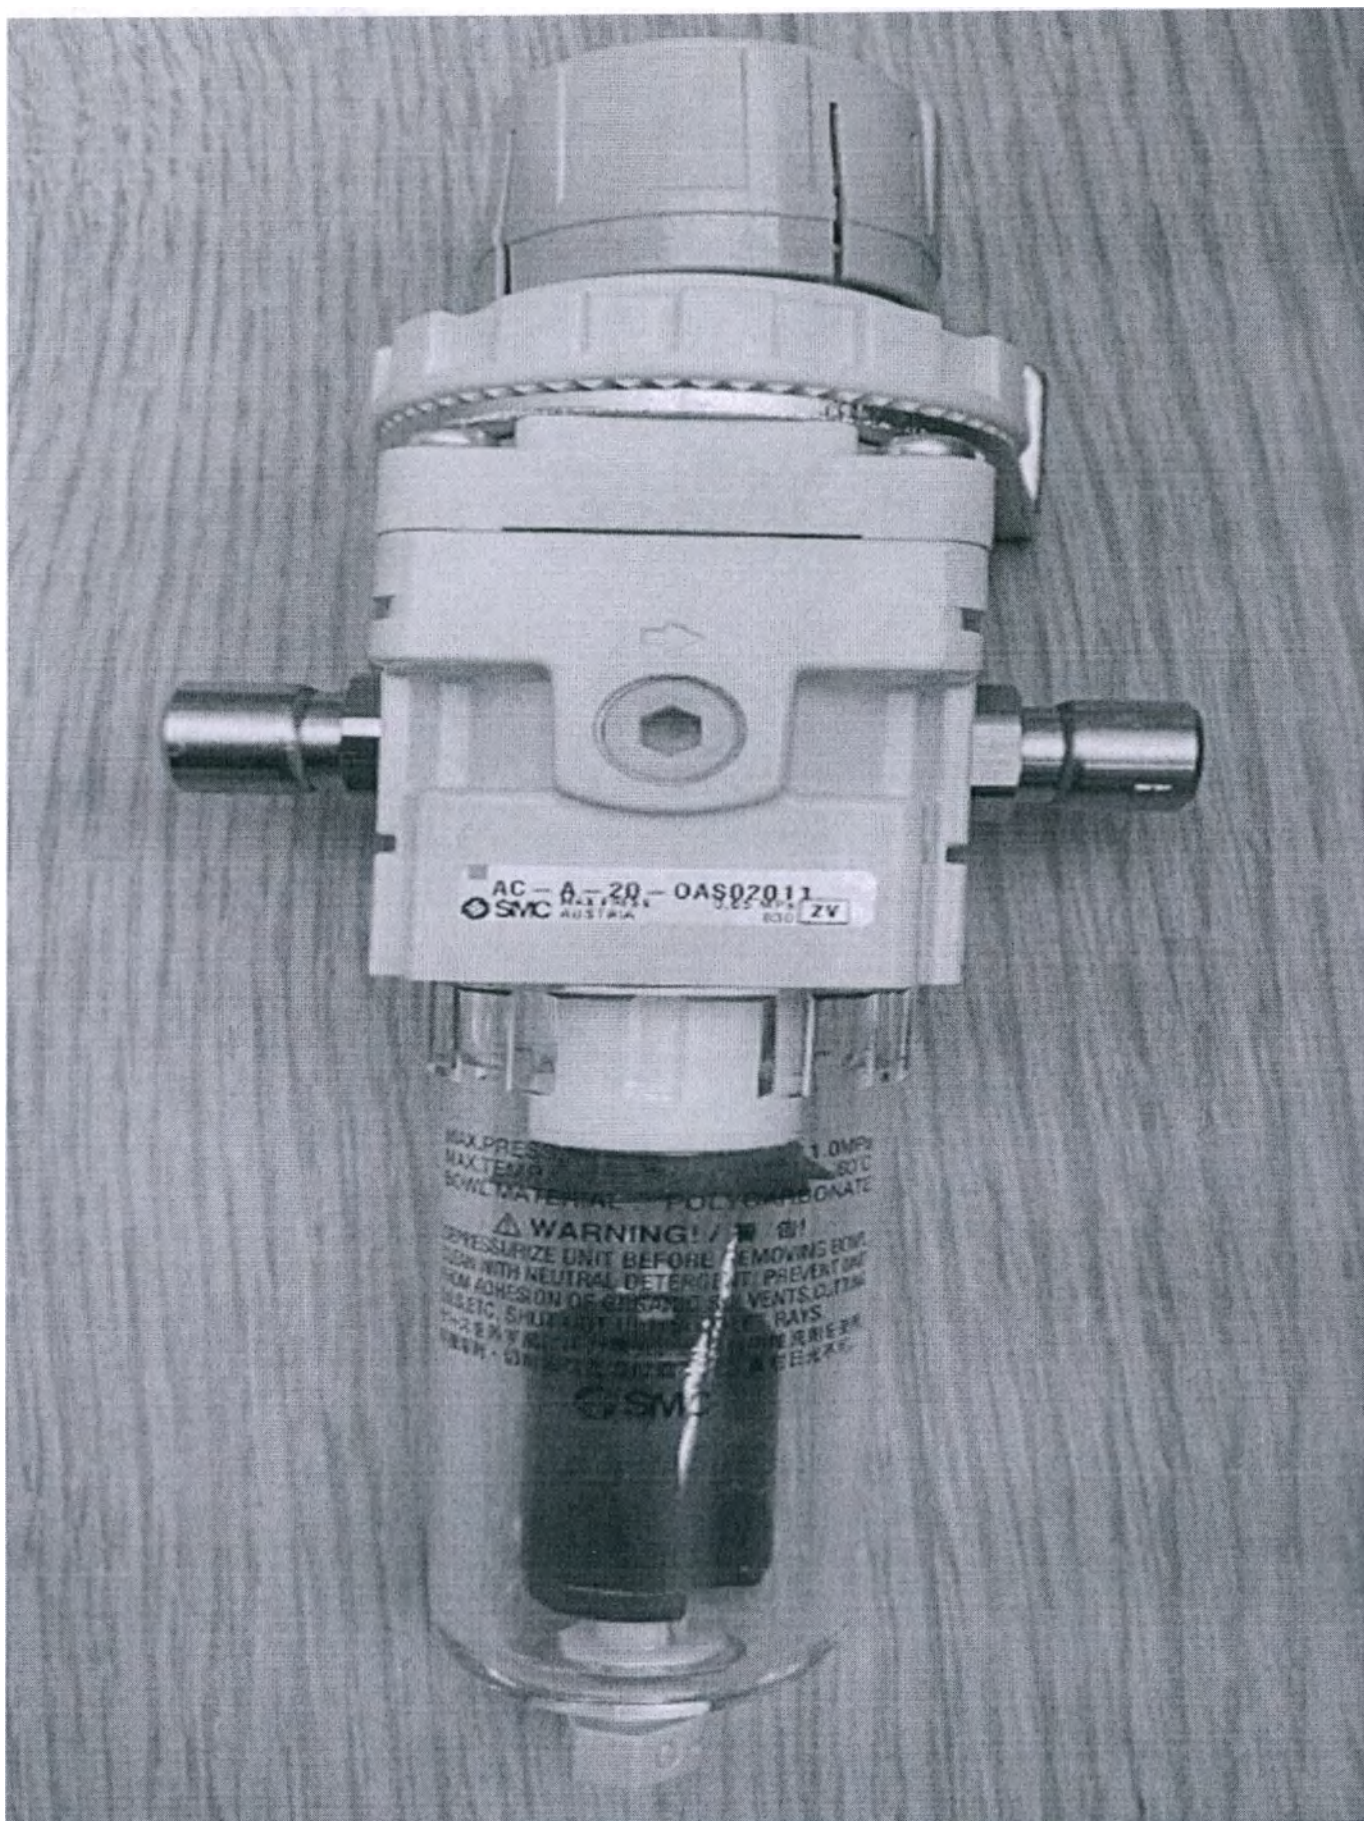


Блок для технического обслуживания

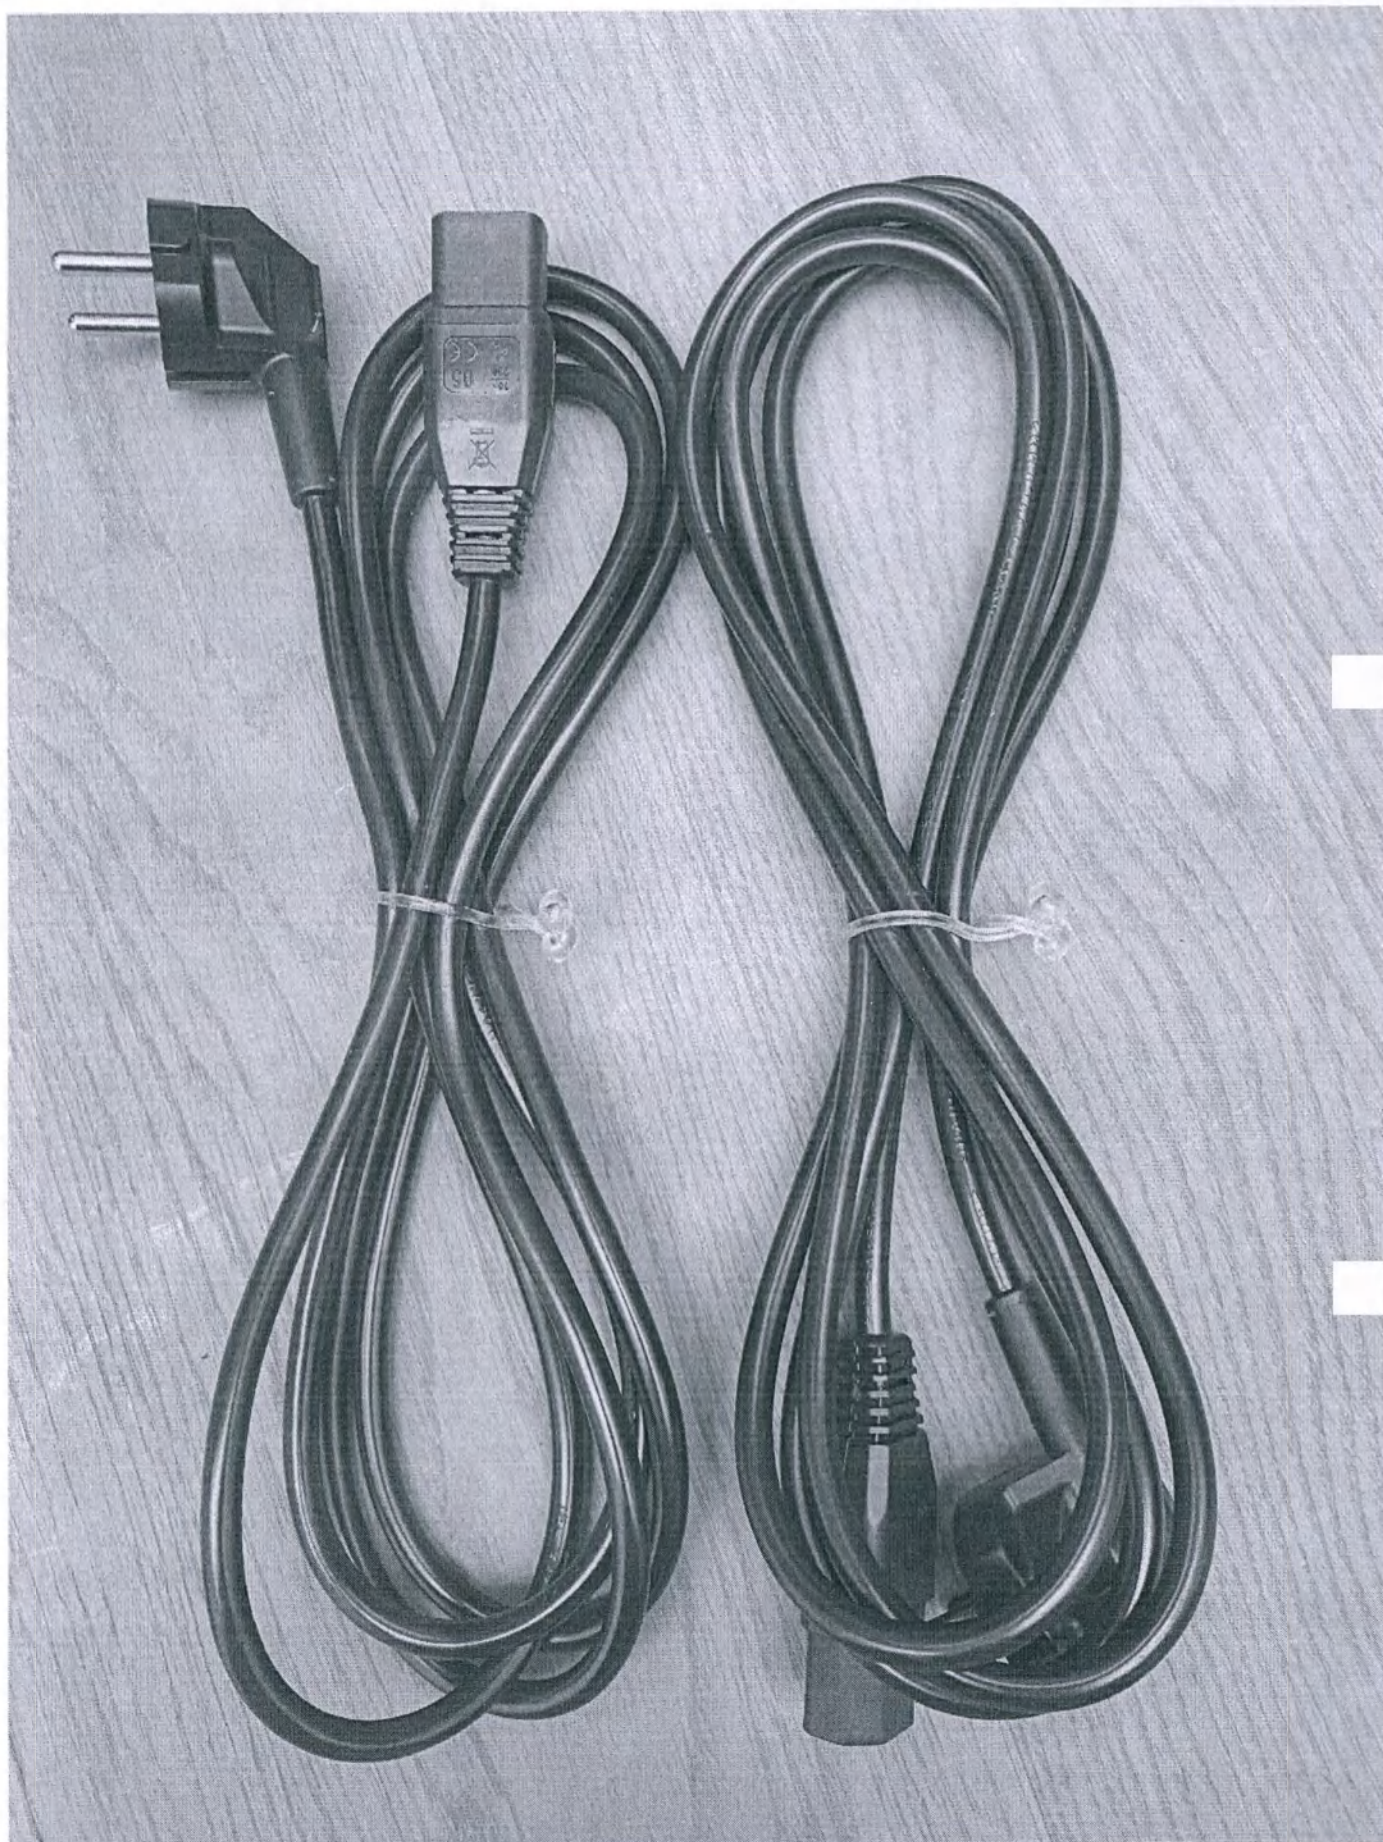


Кабель питания 5 м. и кабель питания 2,5 м.

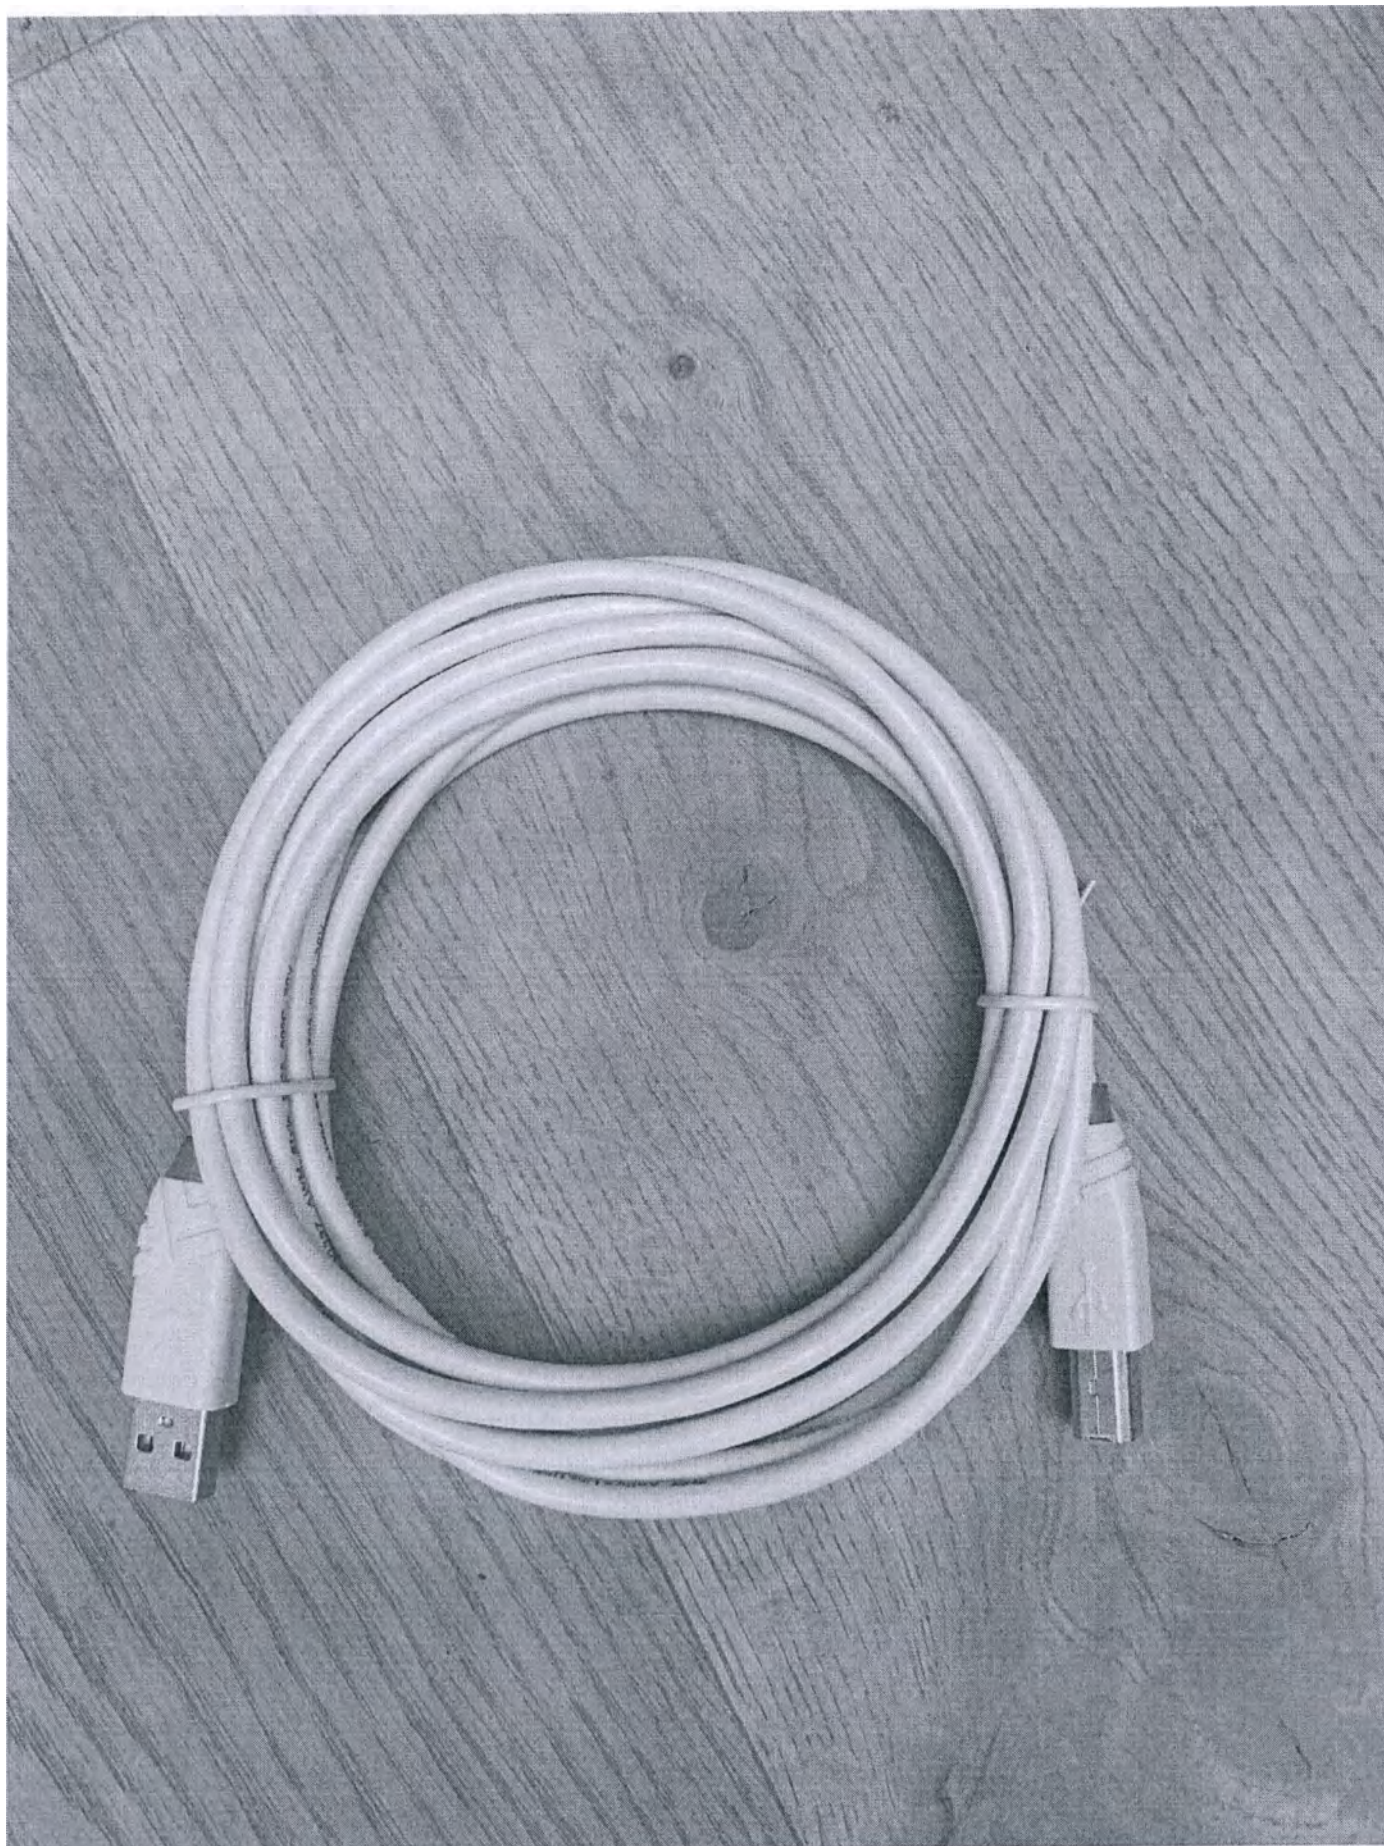


USB - кабель 3 м.

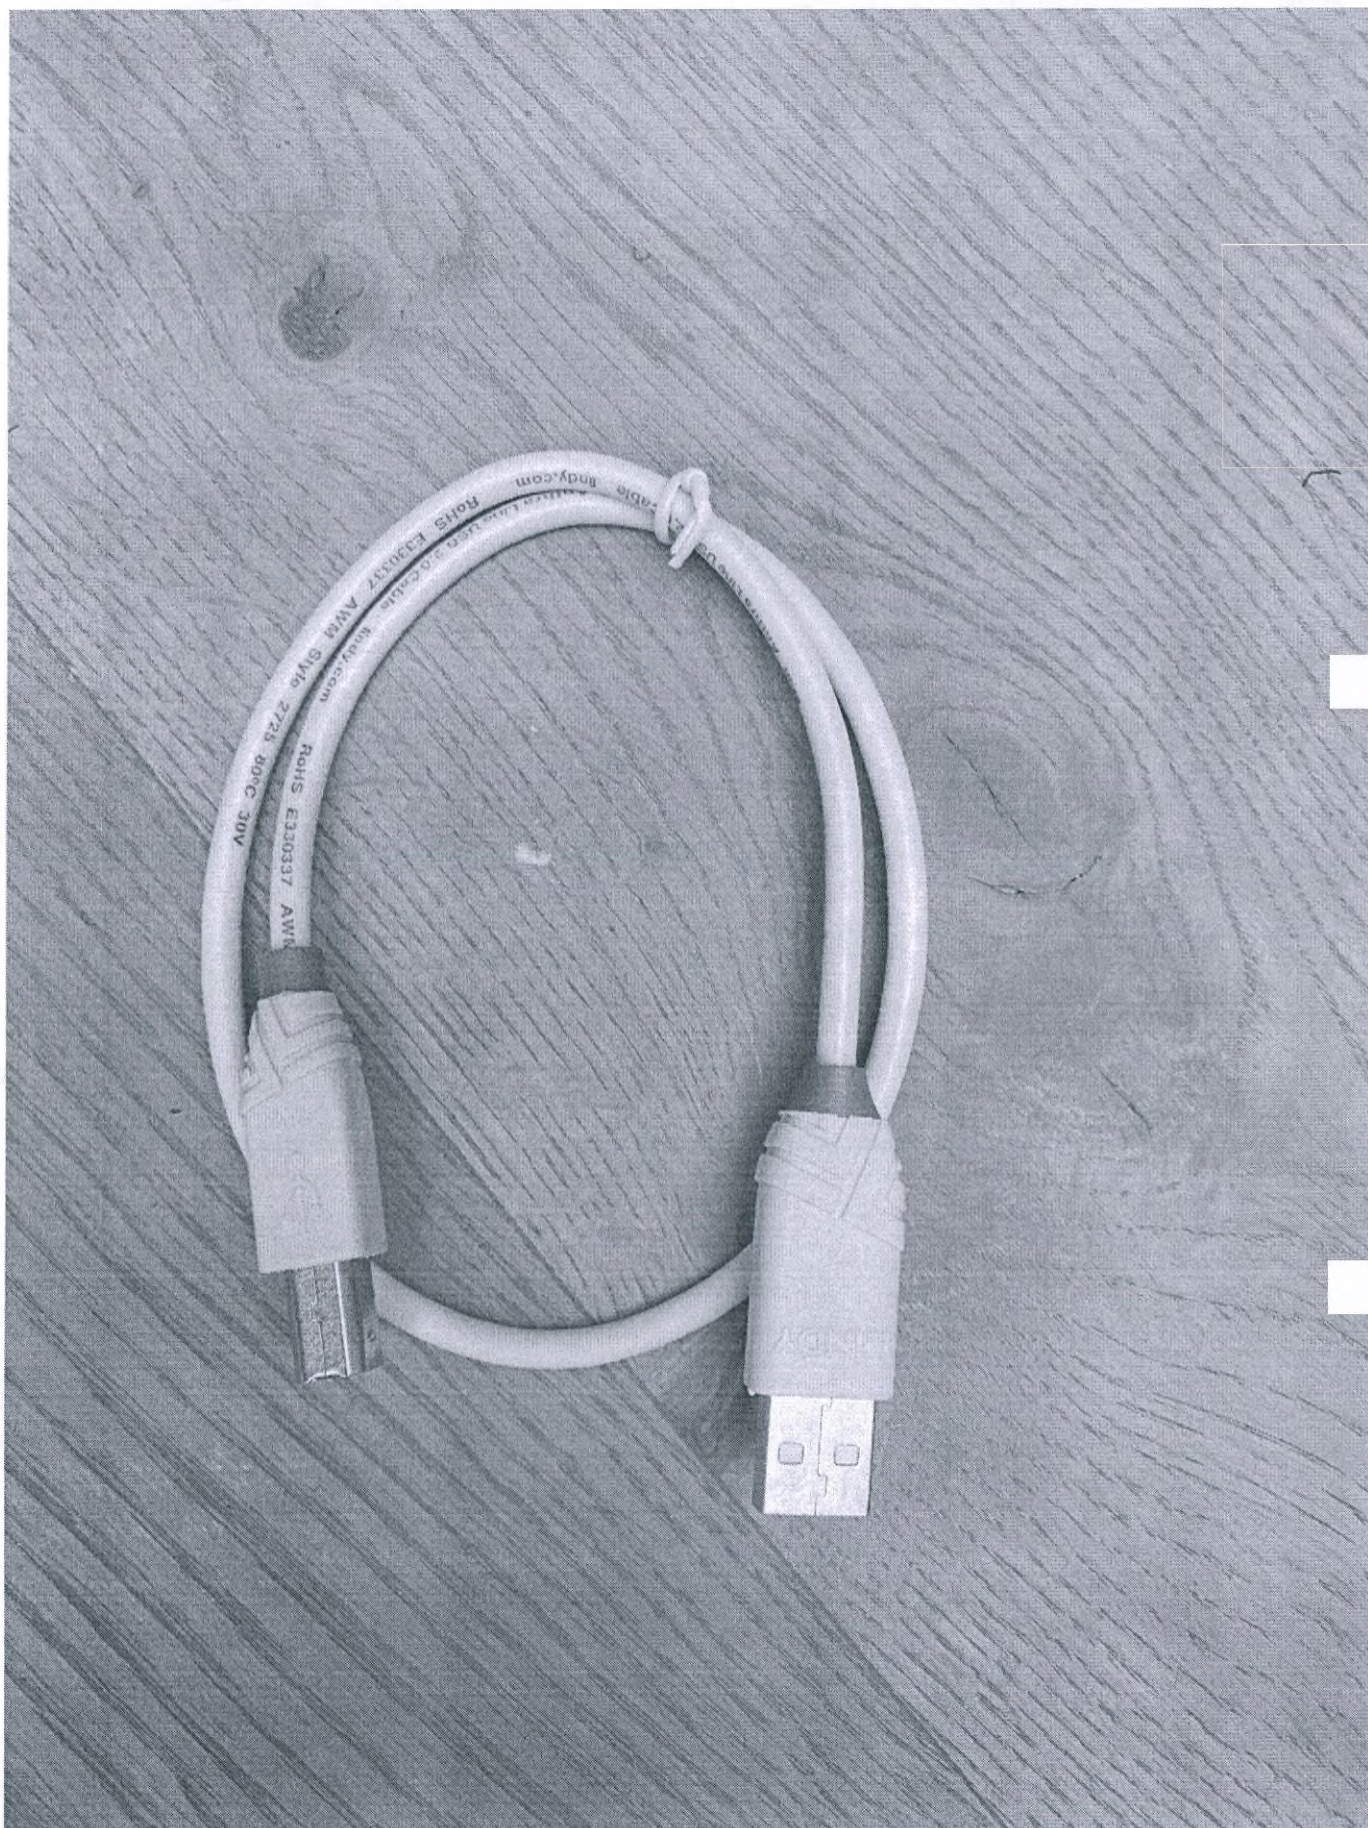


USB - кабель 0,5 м.

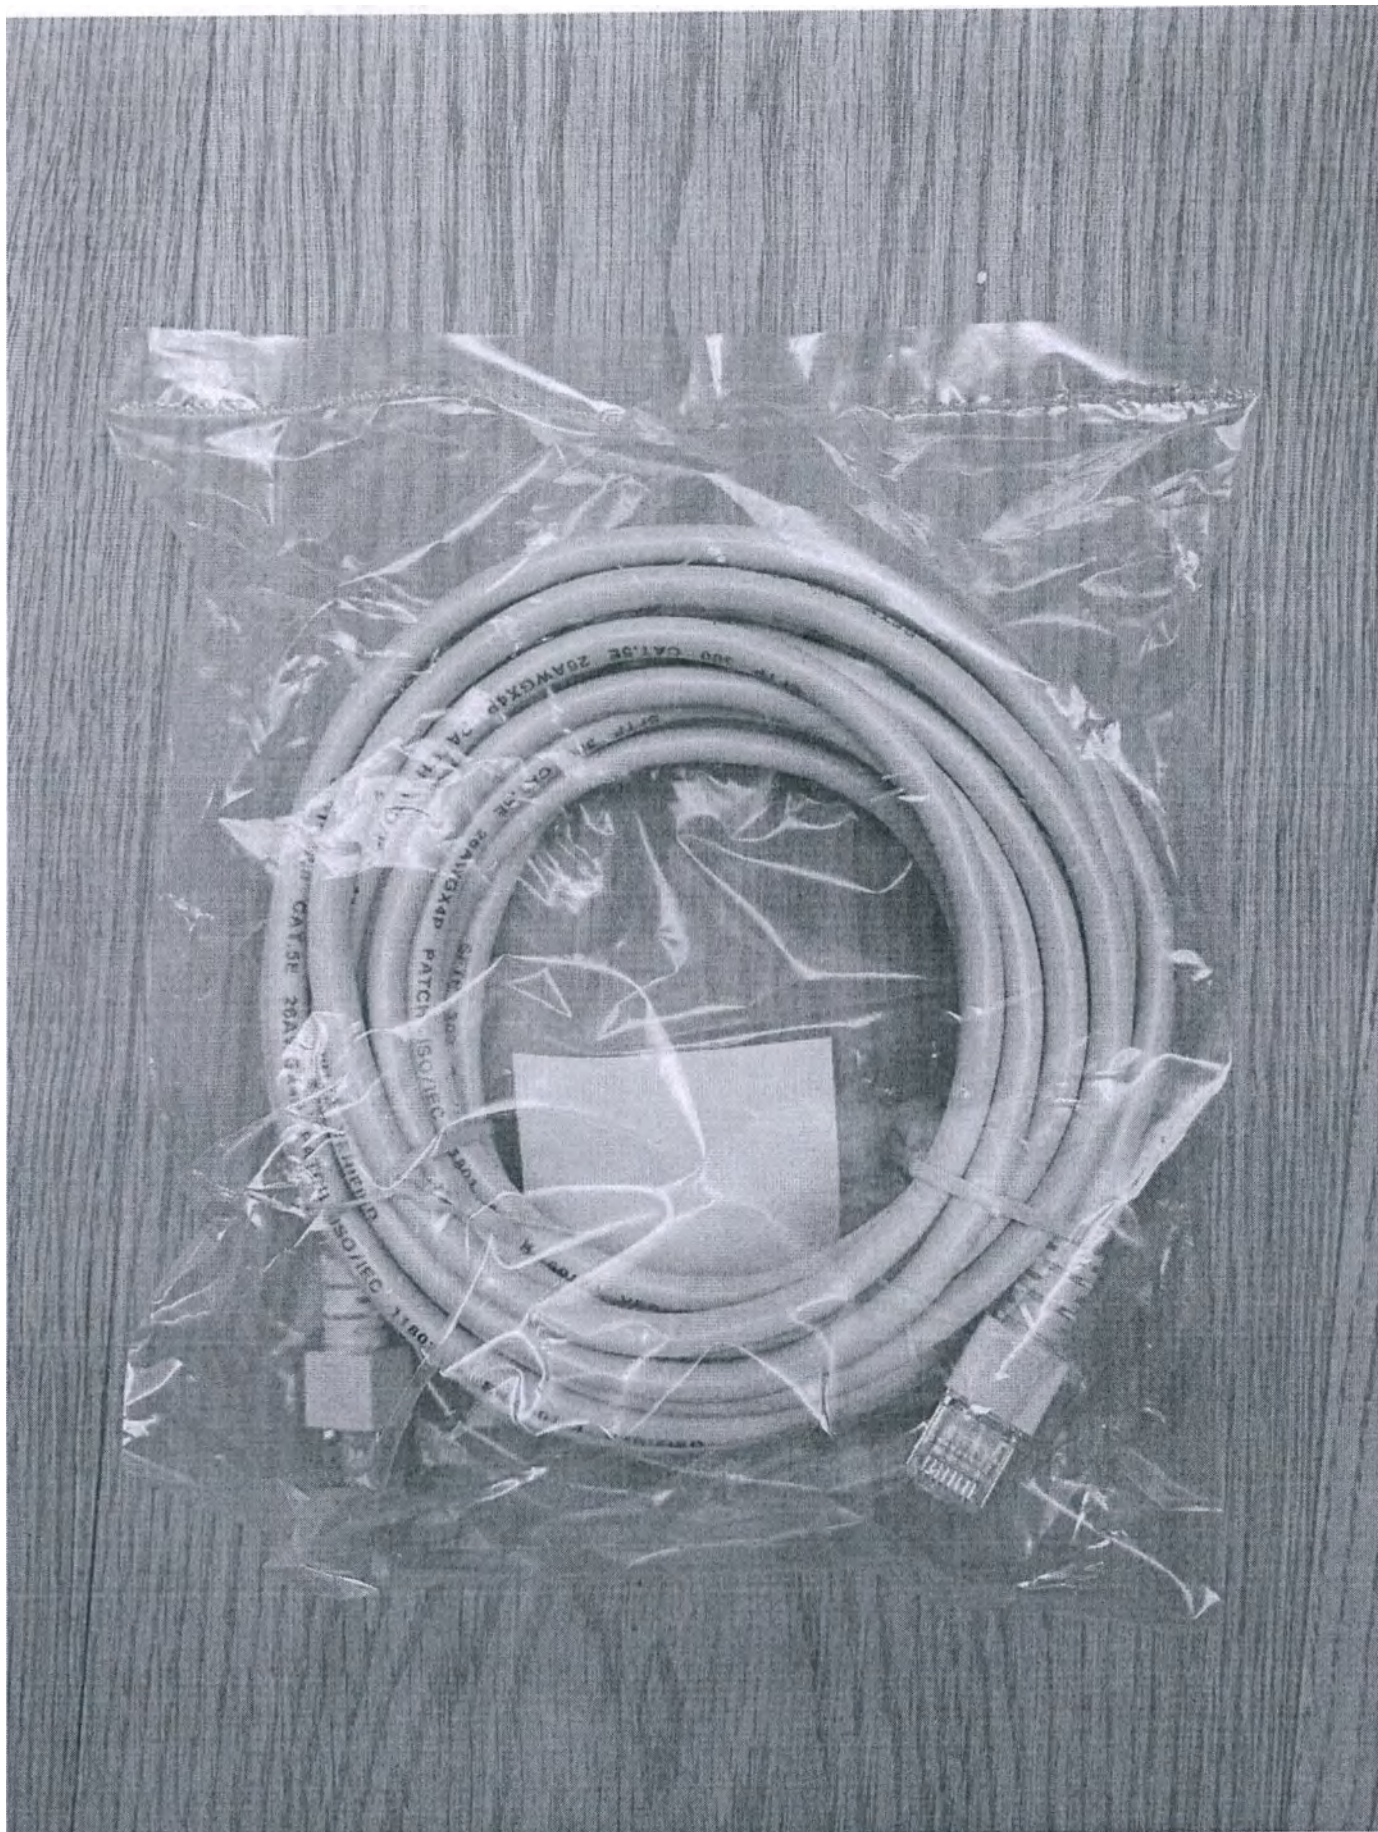


Кабель для подключения к сети

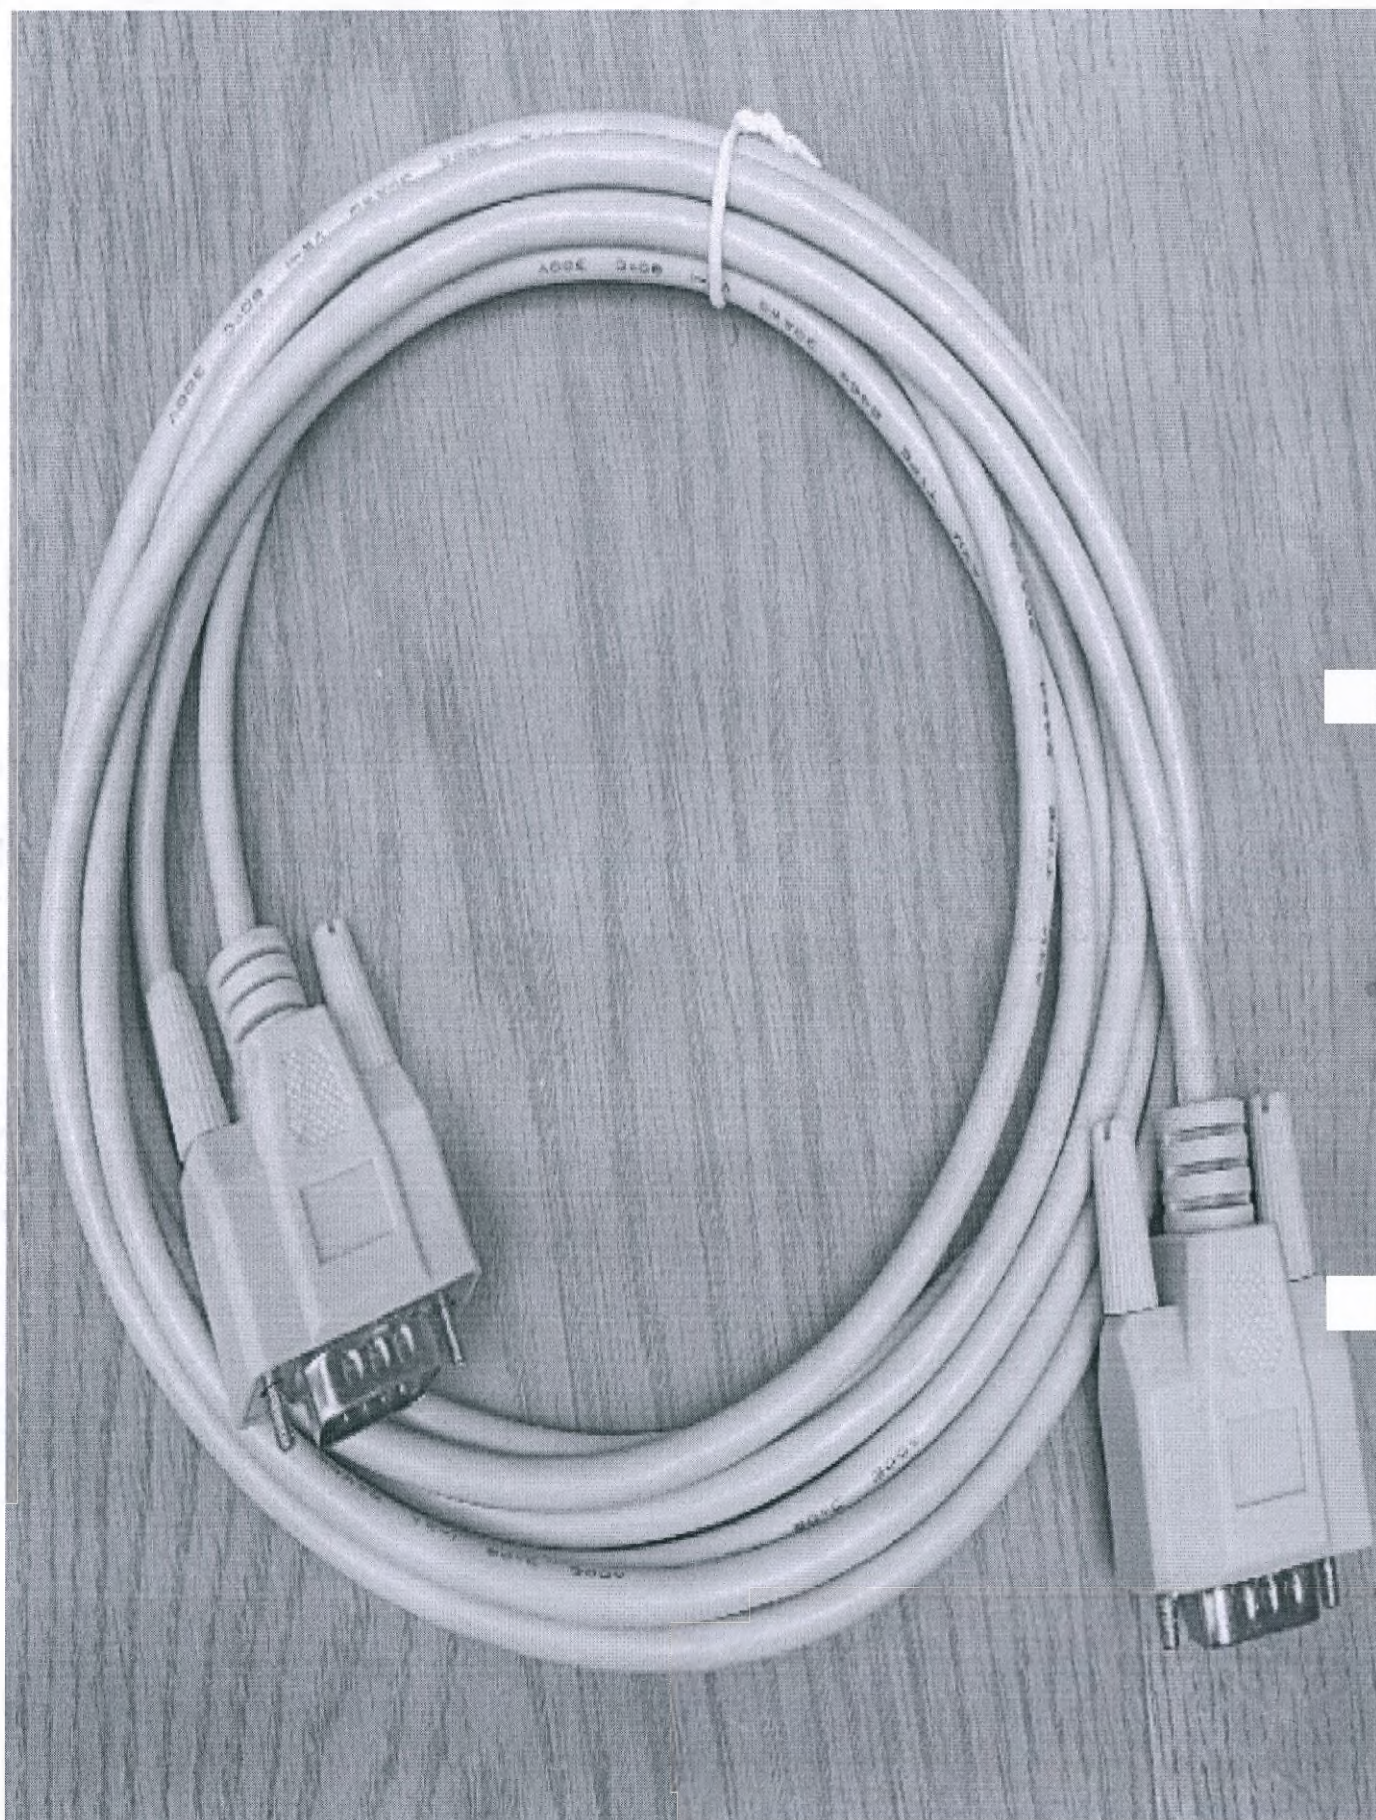


Кабель управления вытяжкой Ceramill Airstream

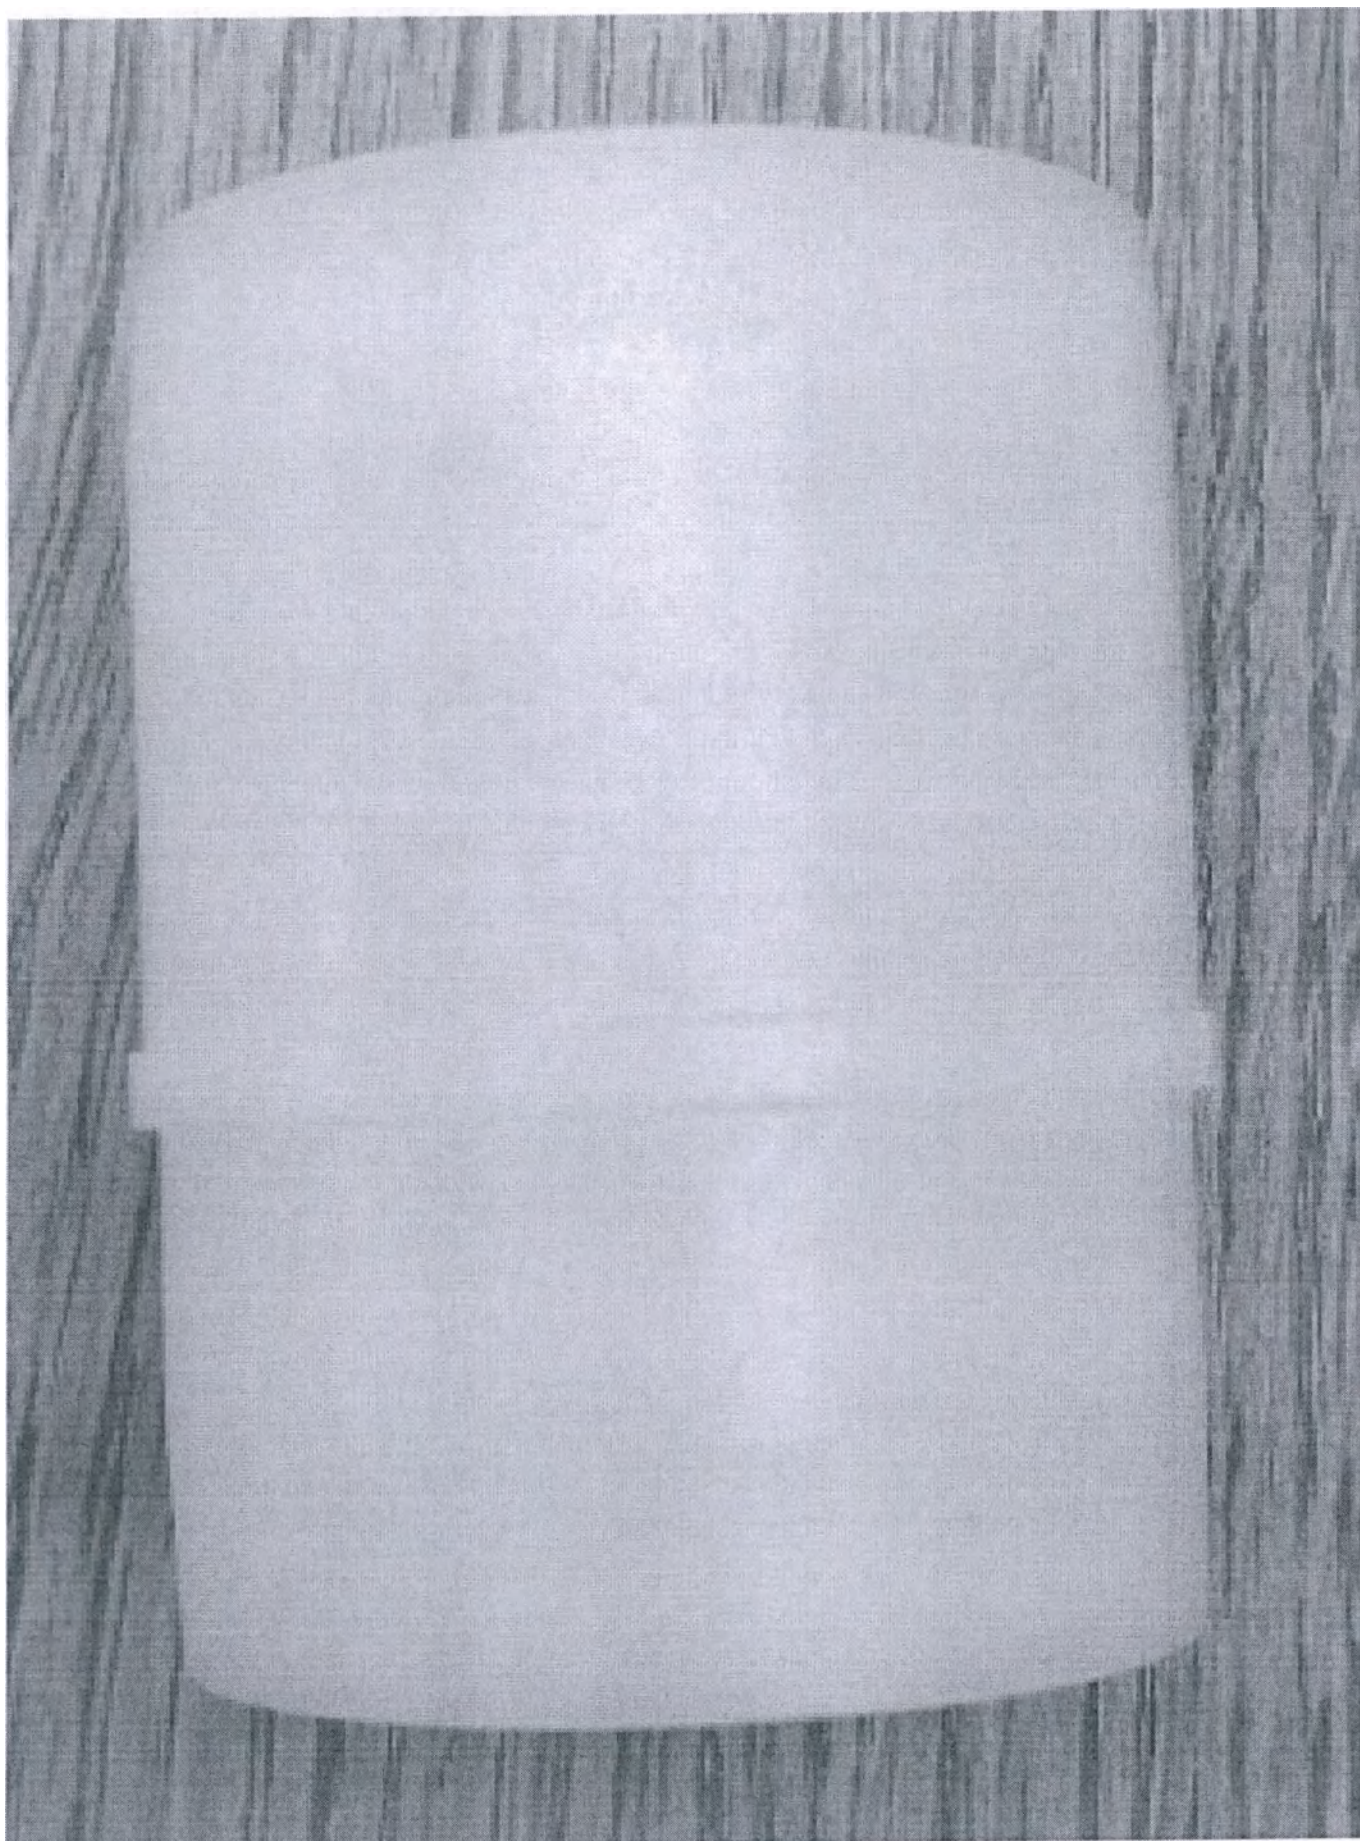


Переходник для подключения Ceramill Airstream

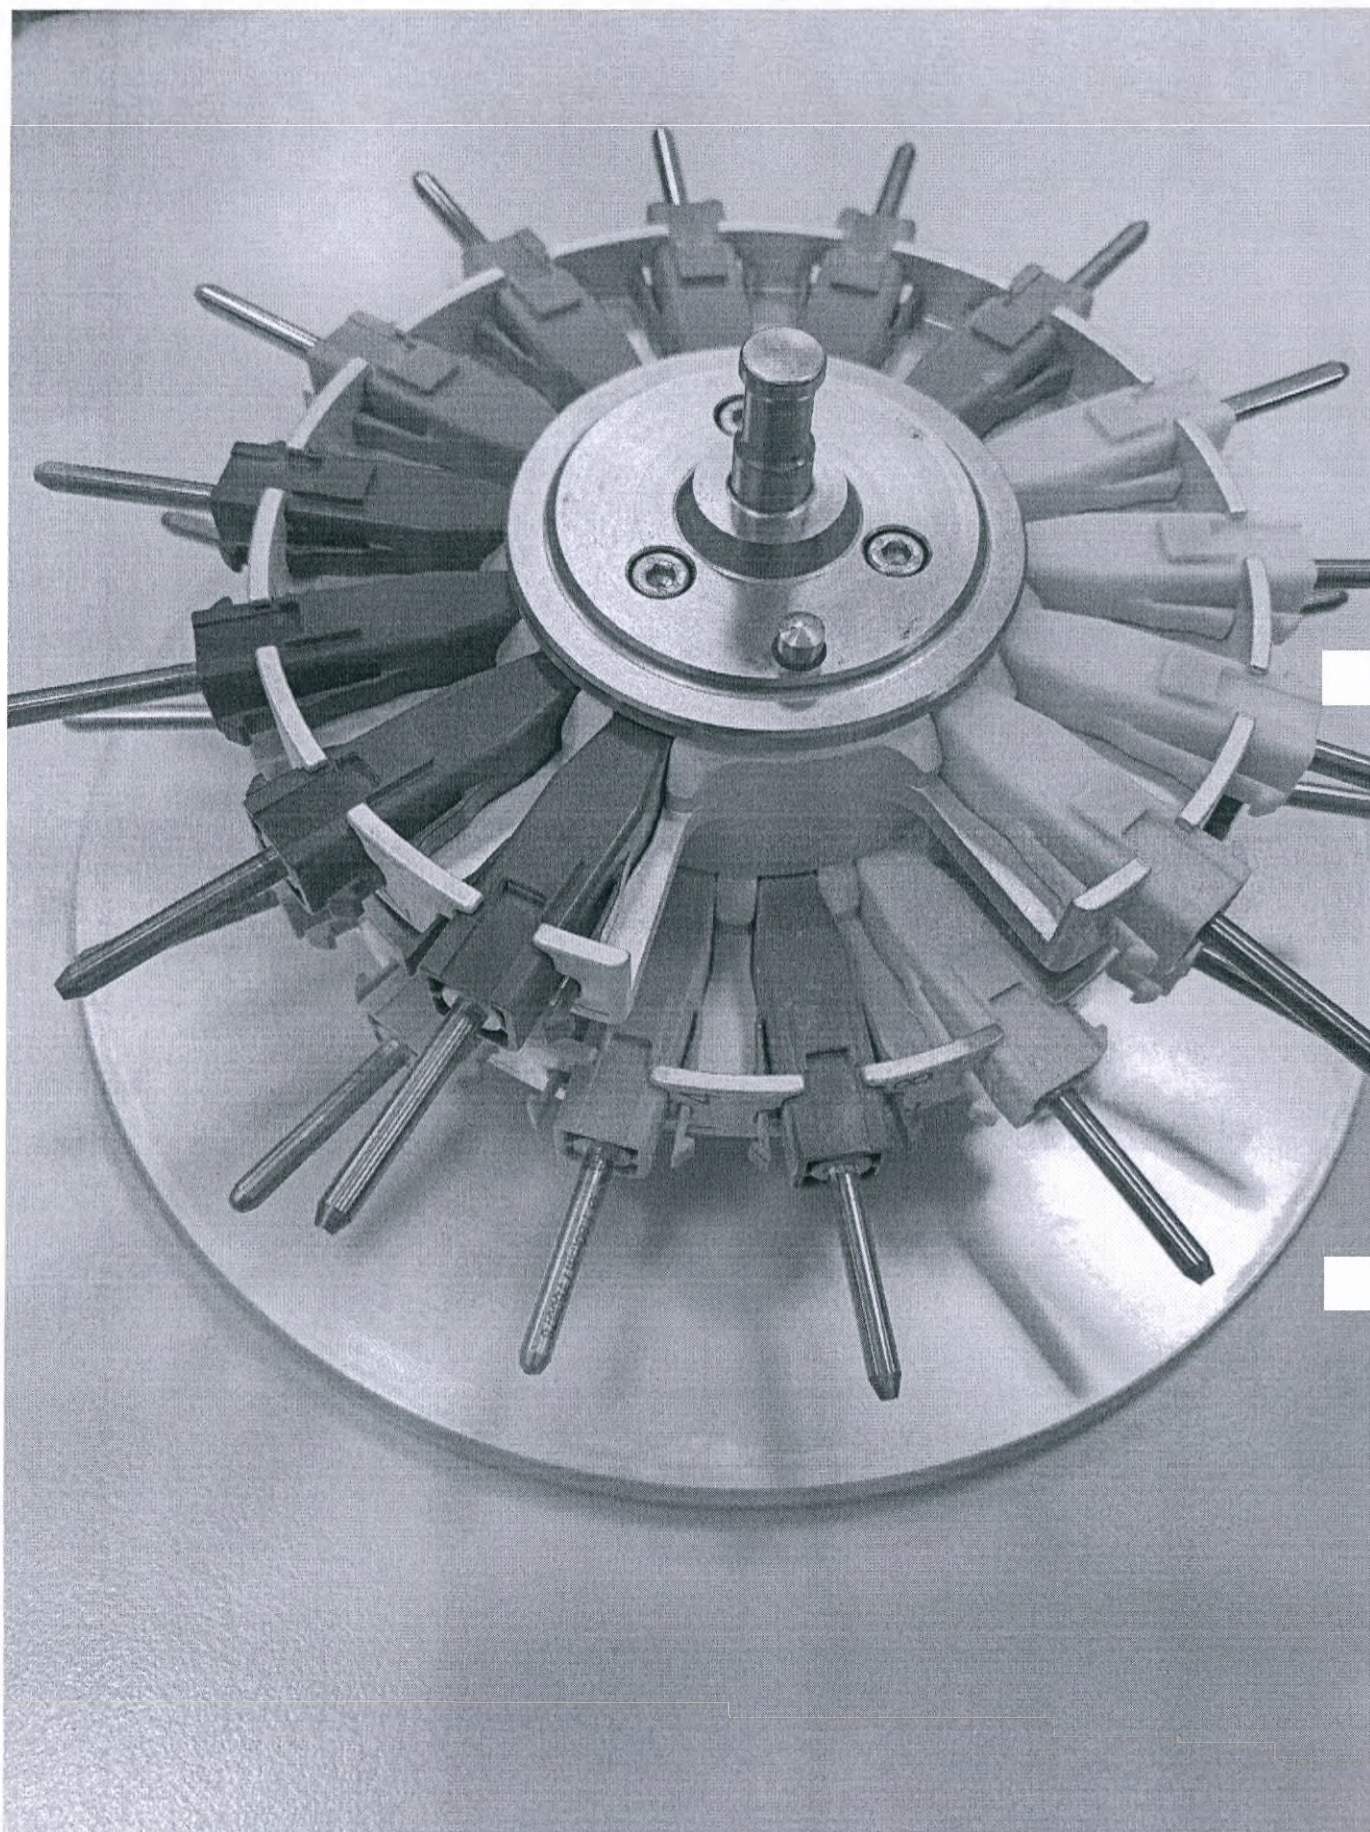

Барабан для фрезы

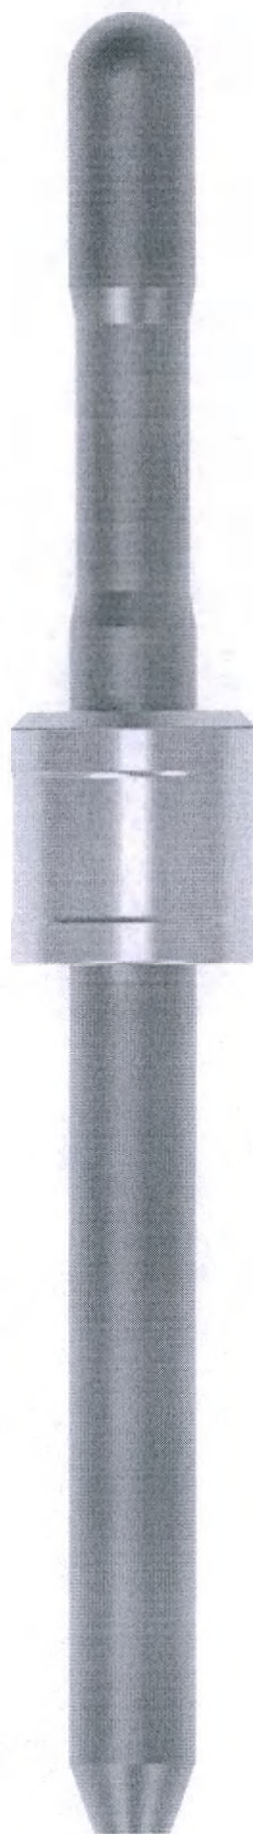

Калибровочный штифт Roto RFID

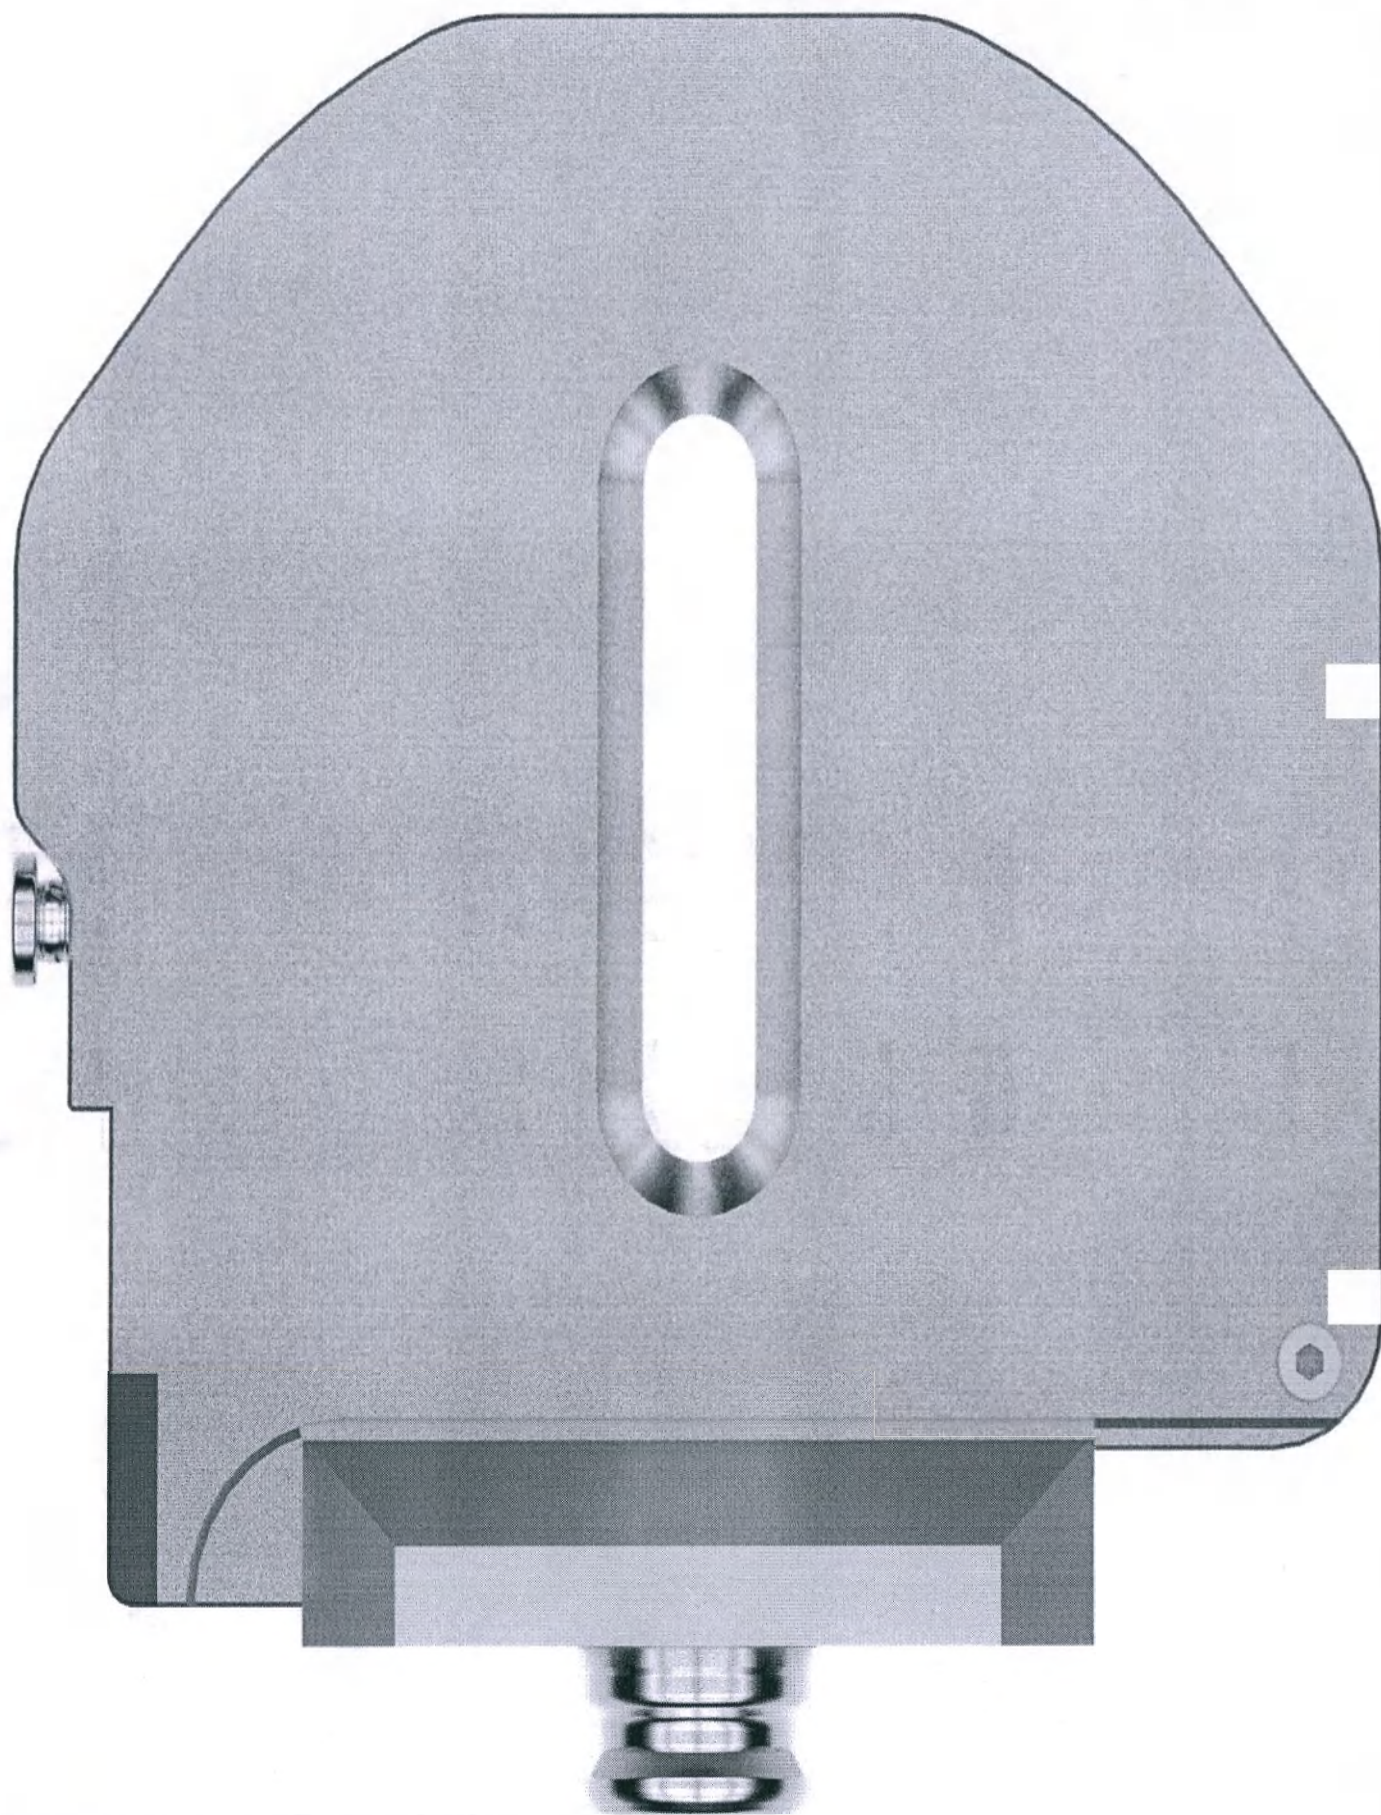

Держатель Автокалибровка 181204



Модуль Wi-Fi USB


Transcend

LOCK ▼




8GB

Карта памяти SD

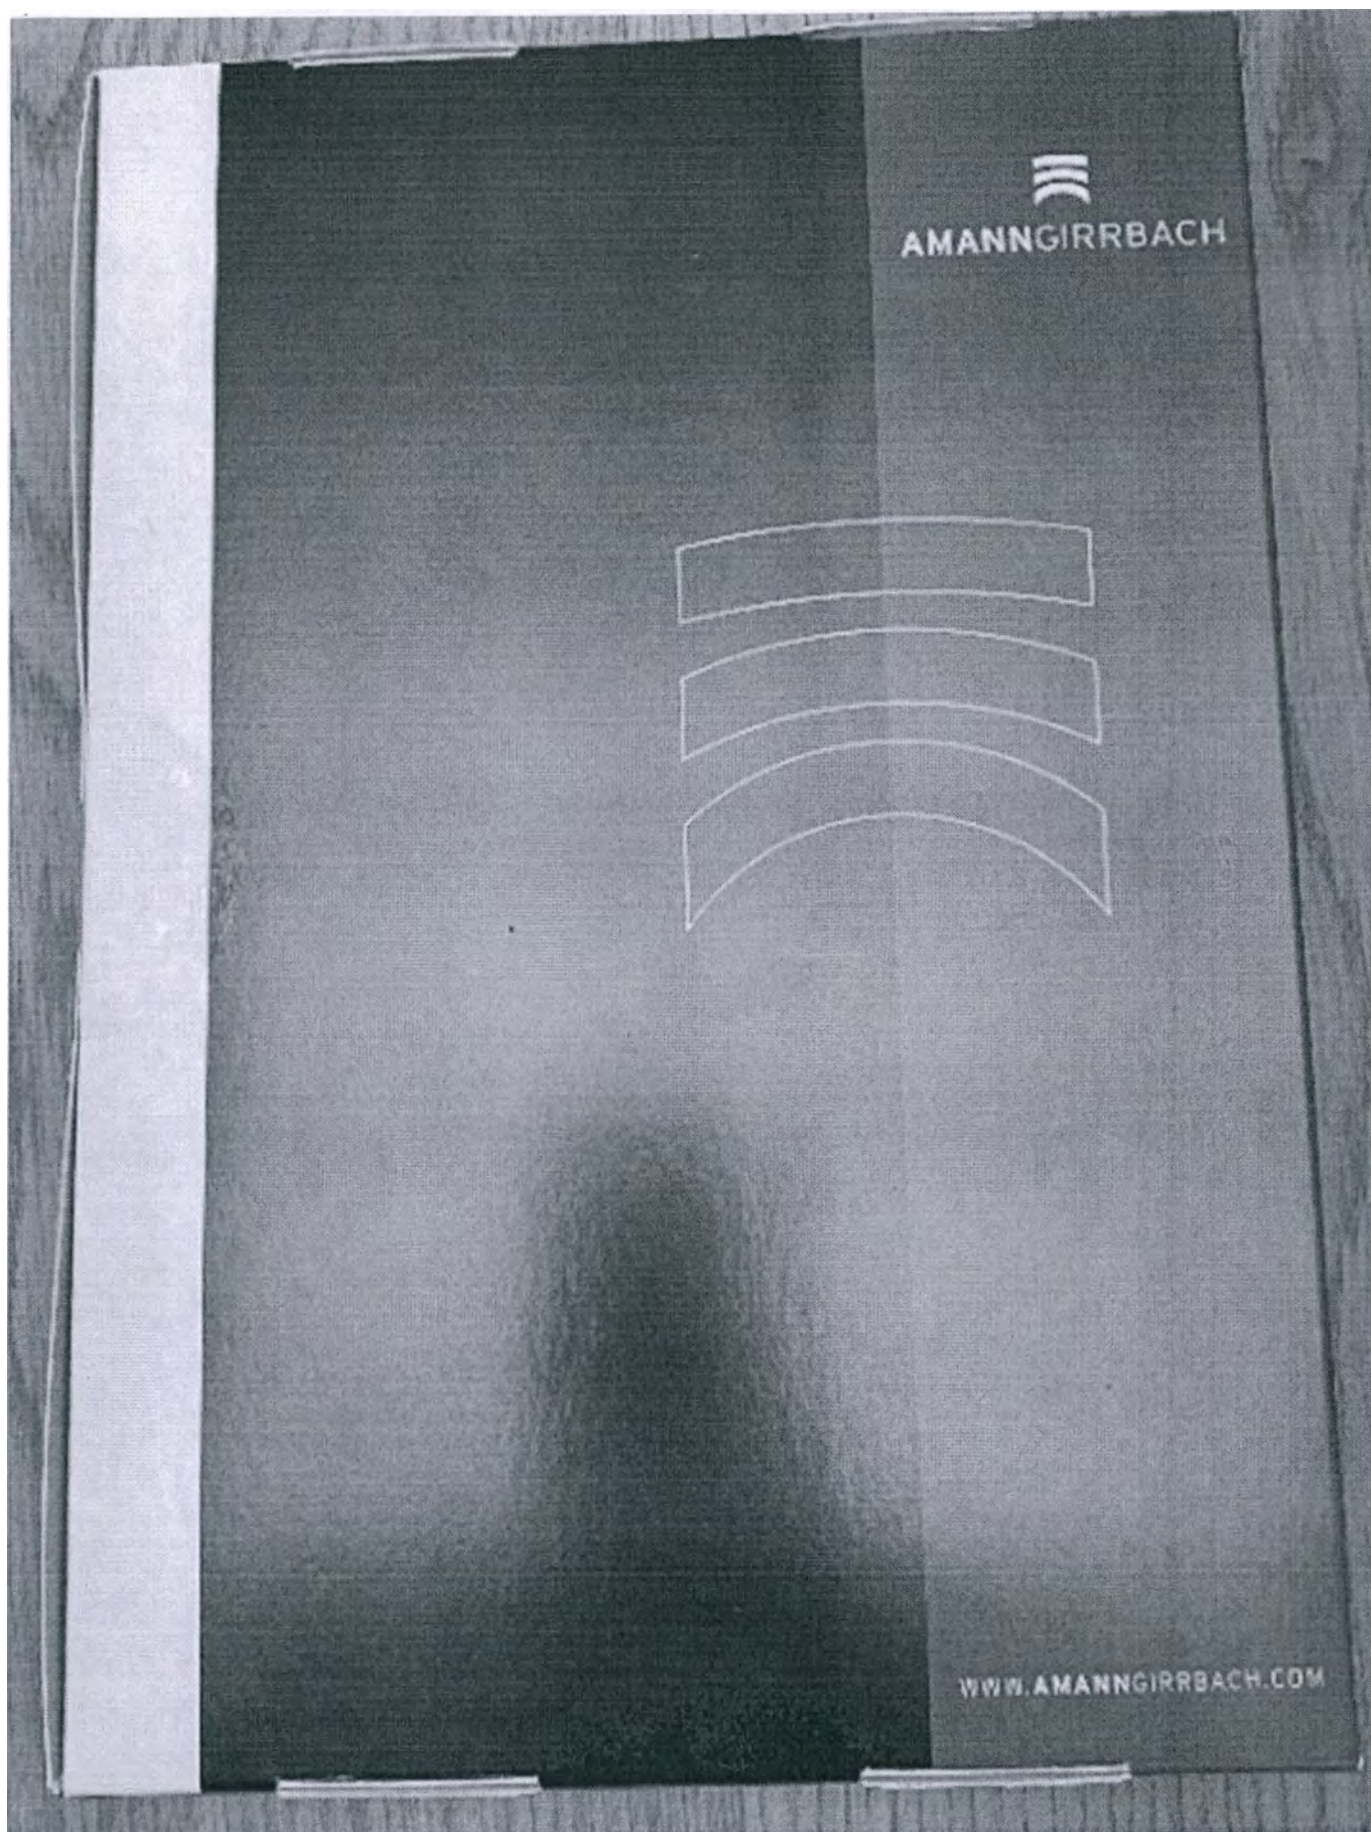

Программное обеспечение на CD диске

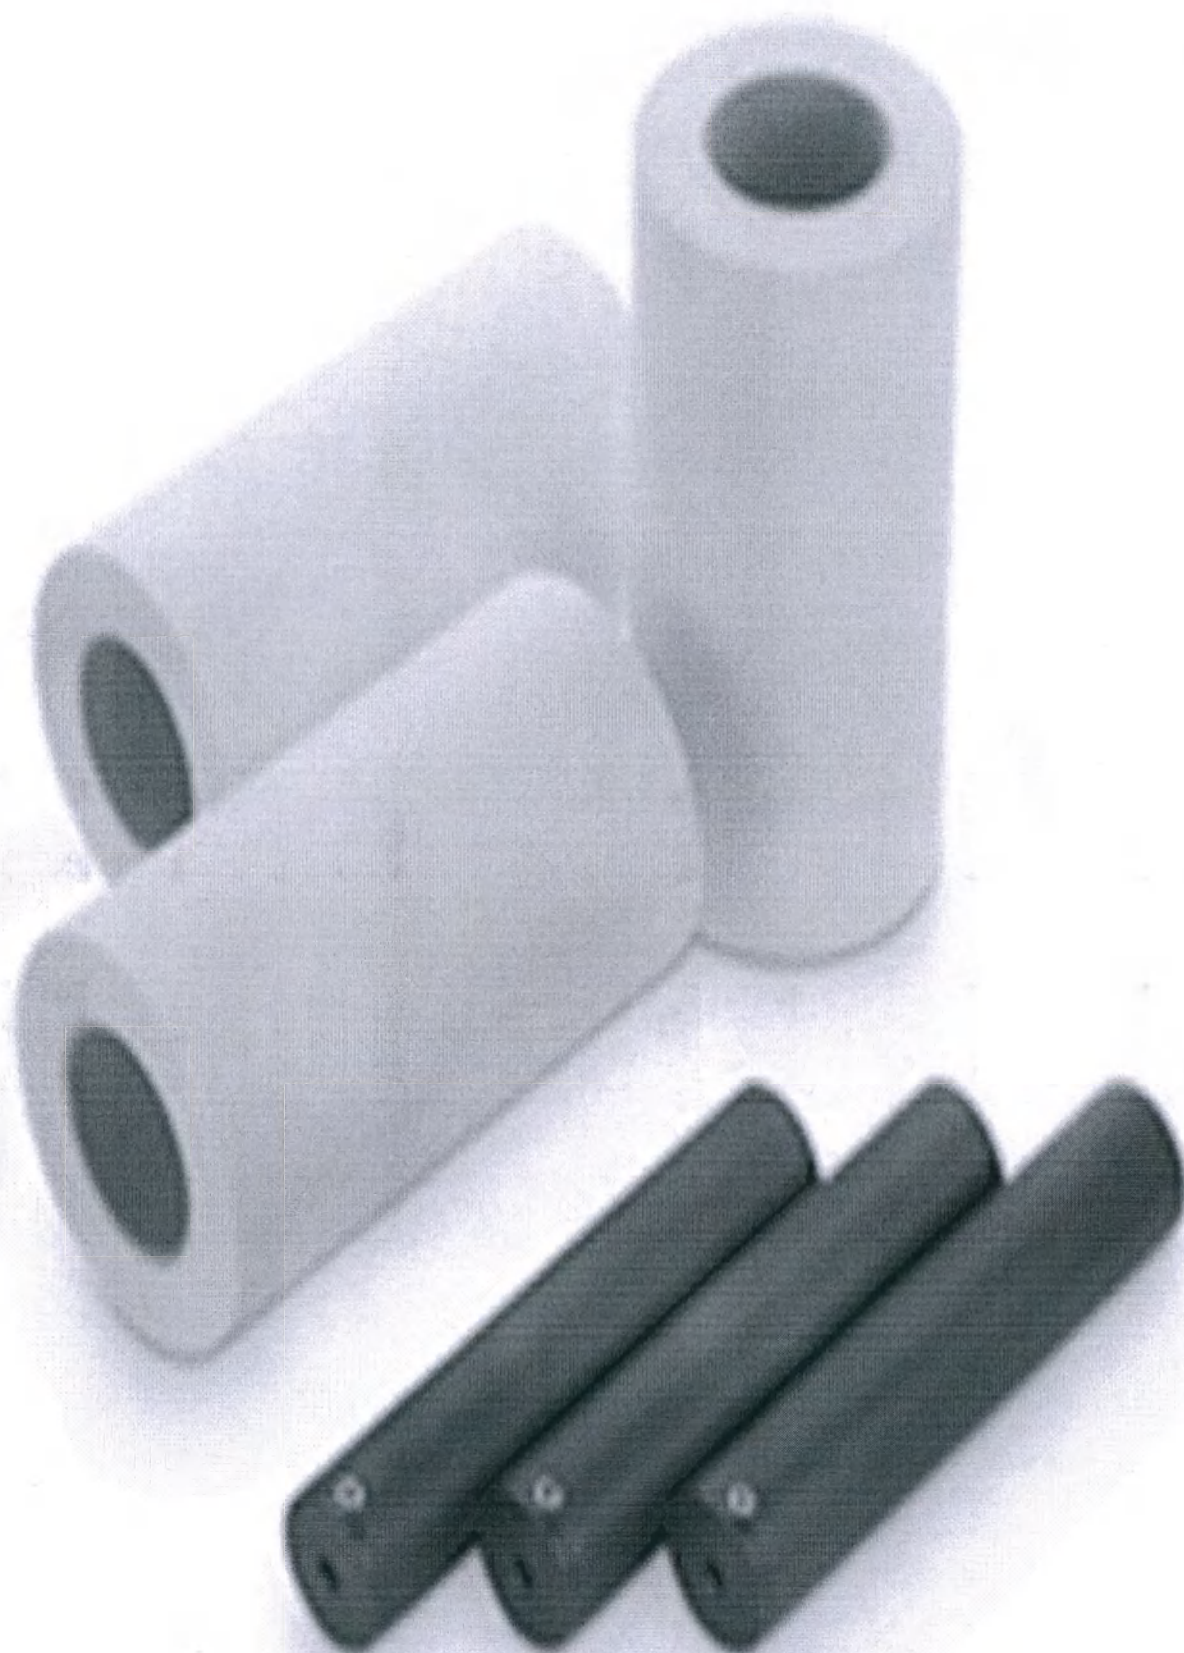


Фильтрующий флис с роликовым блоком




Фильтр с фильтрующей свечой и резиновым кольцом



Ключ для фильтра

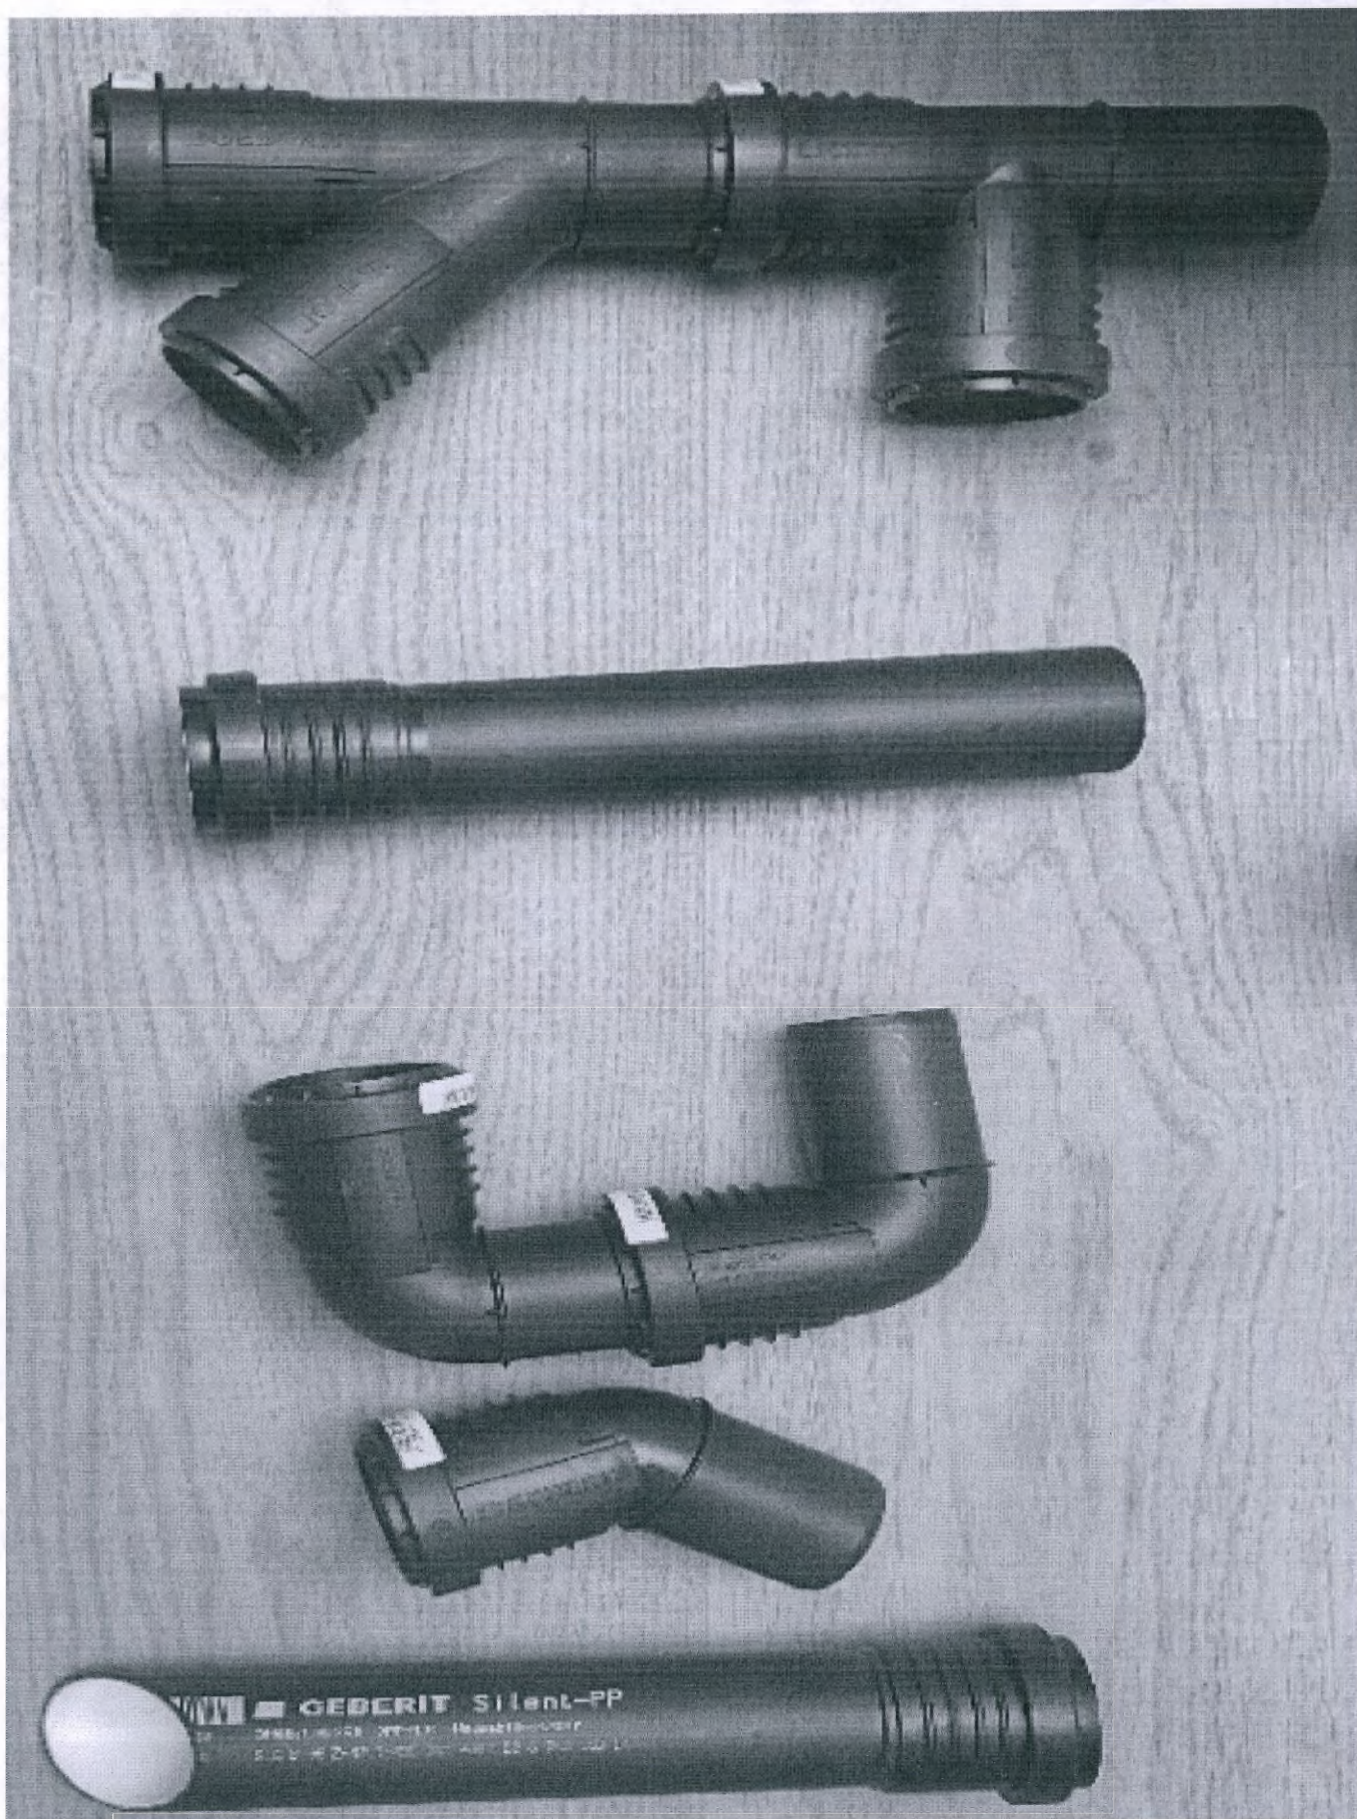


Набор пластиковых труб

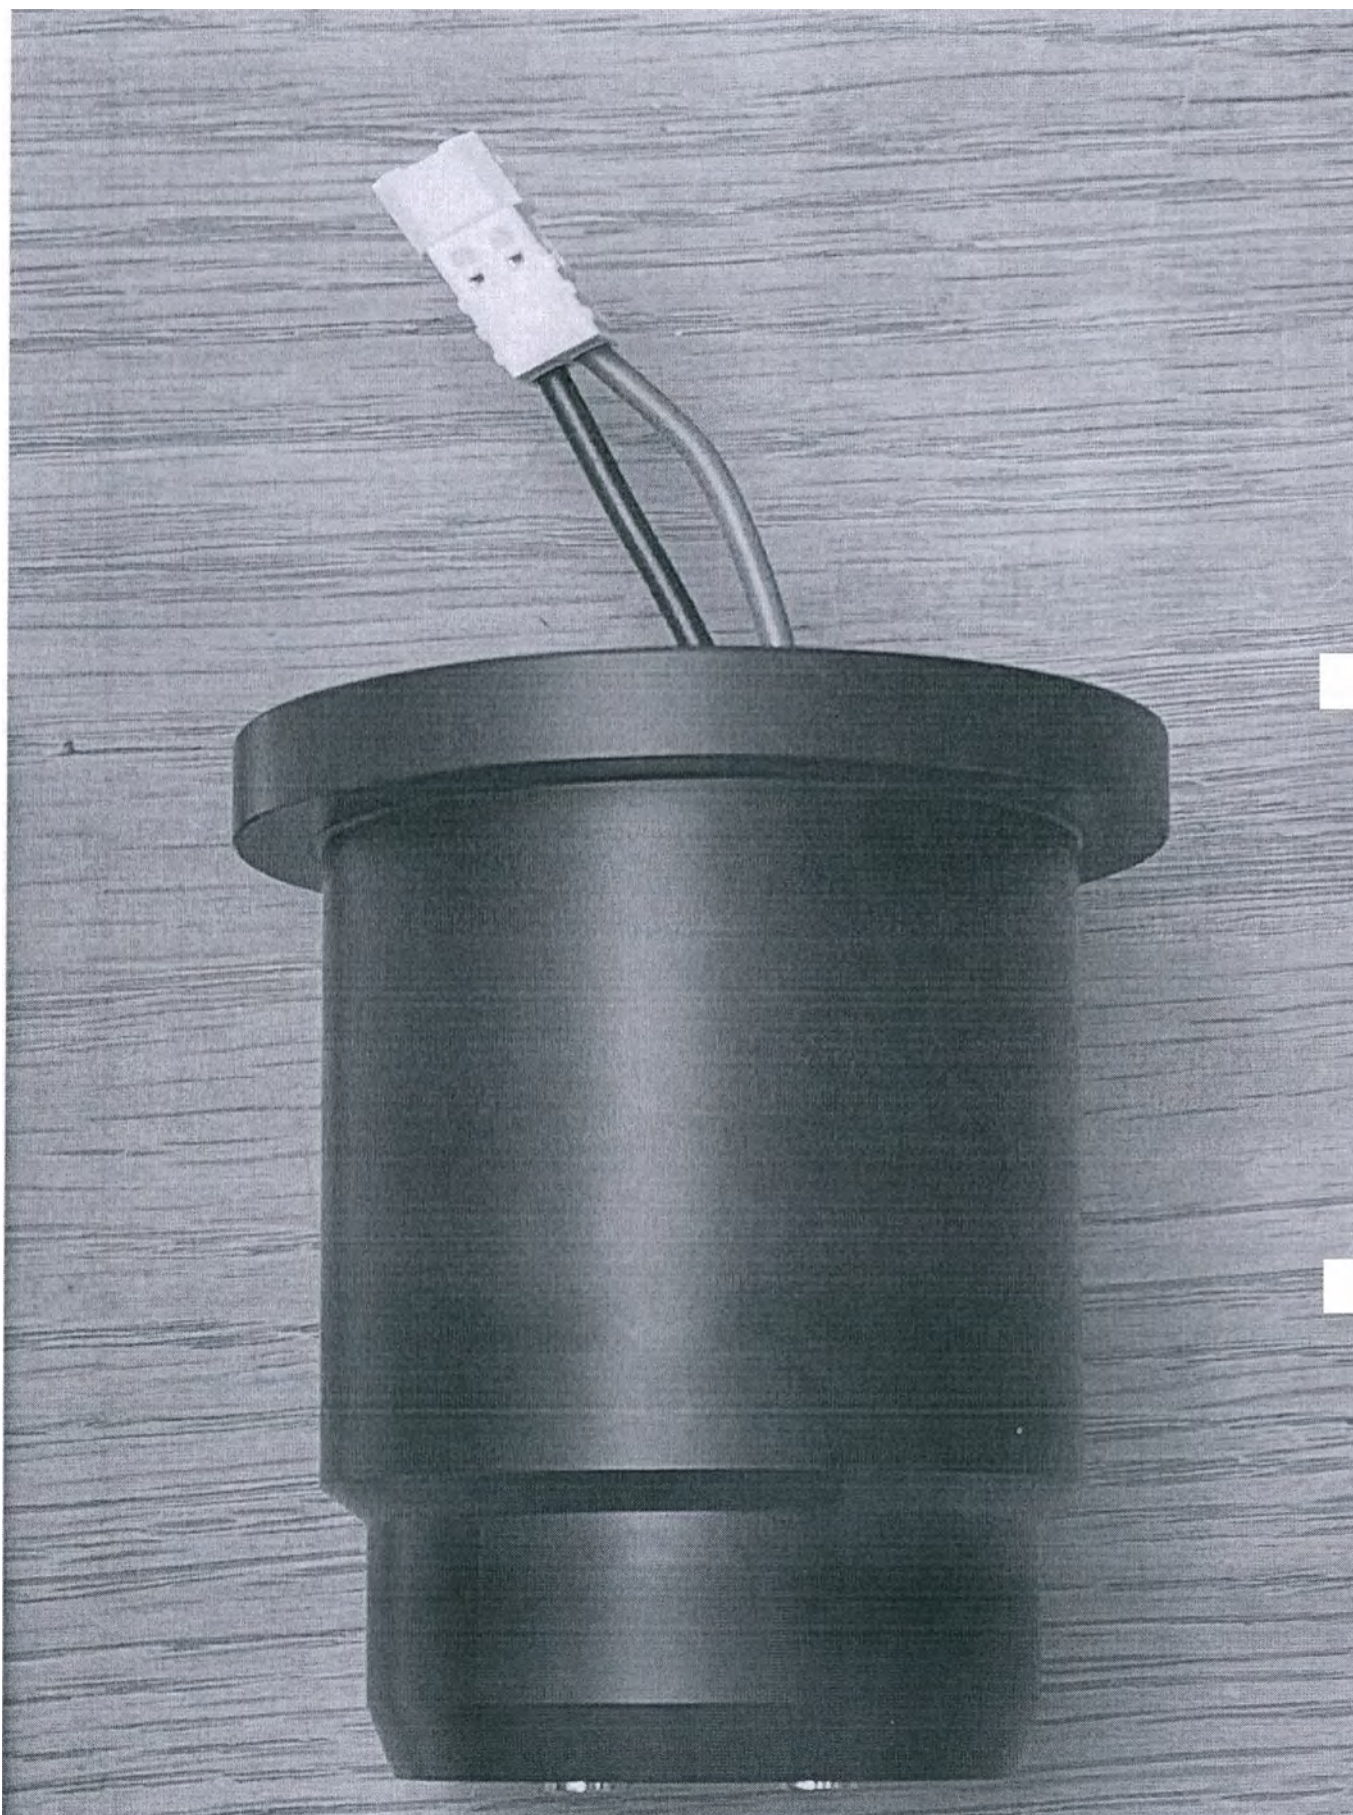


Сенсор




Смазочно-охлаждающая жидкость

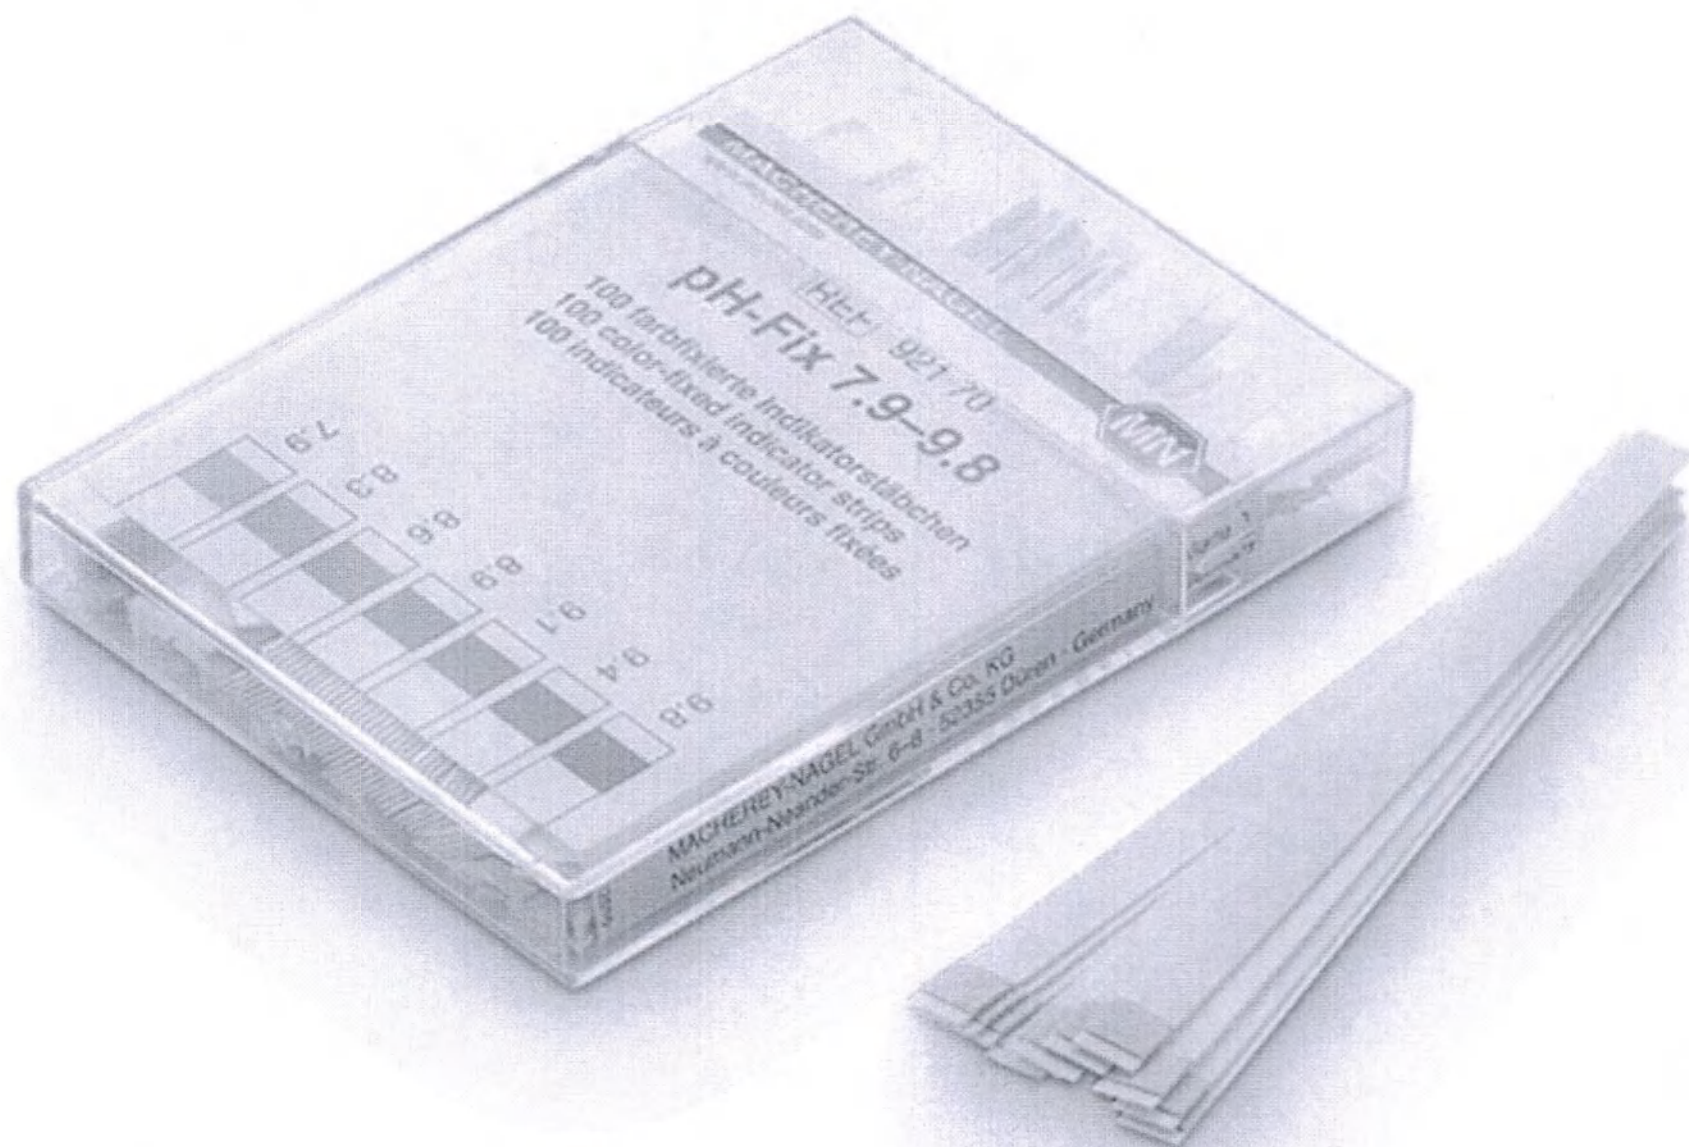

Тест на многофункциональные добавки

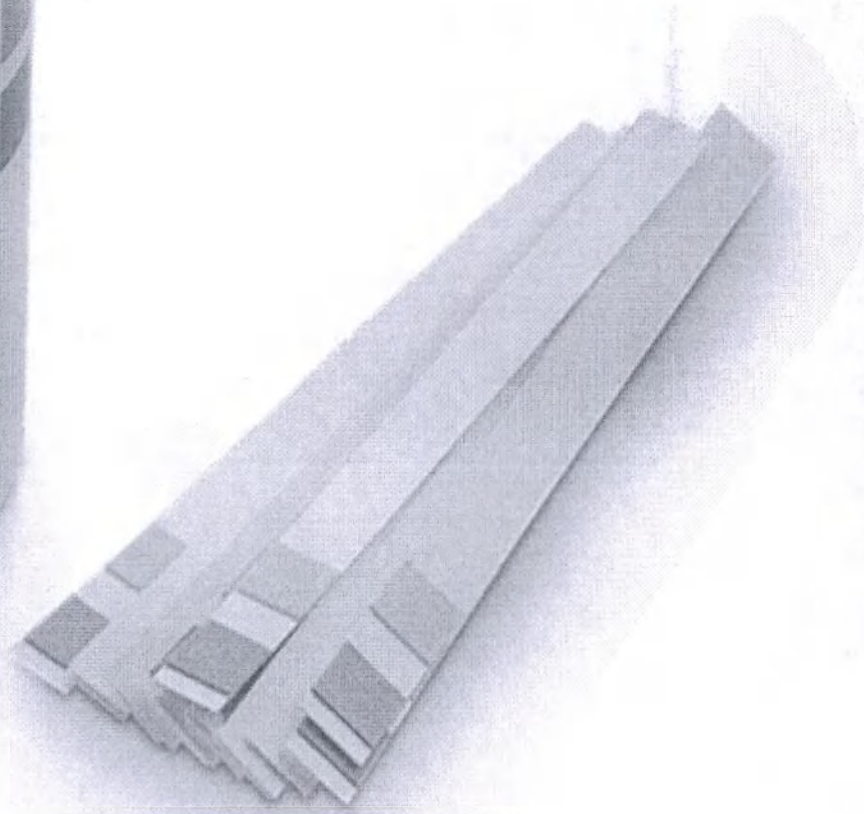


Тест рН показатель

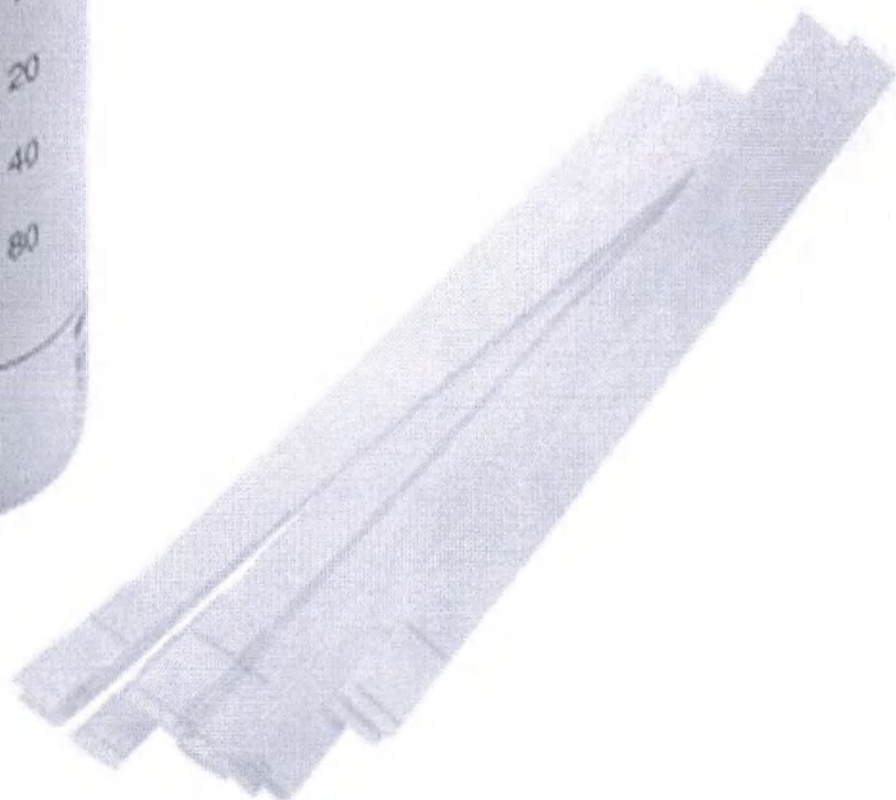

Тест на нитраты




Сервисный набор для шпинделя Jäger

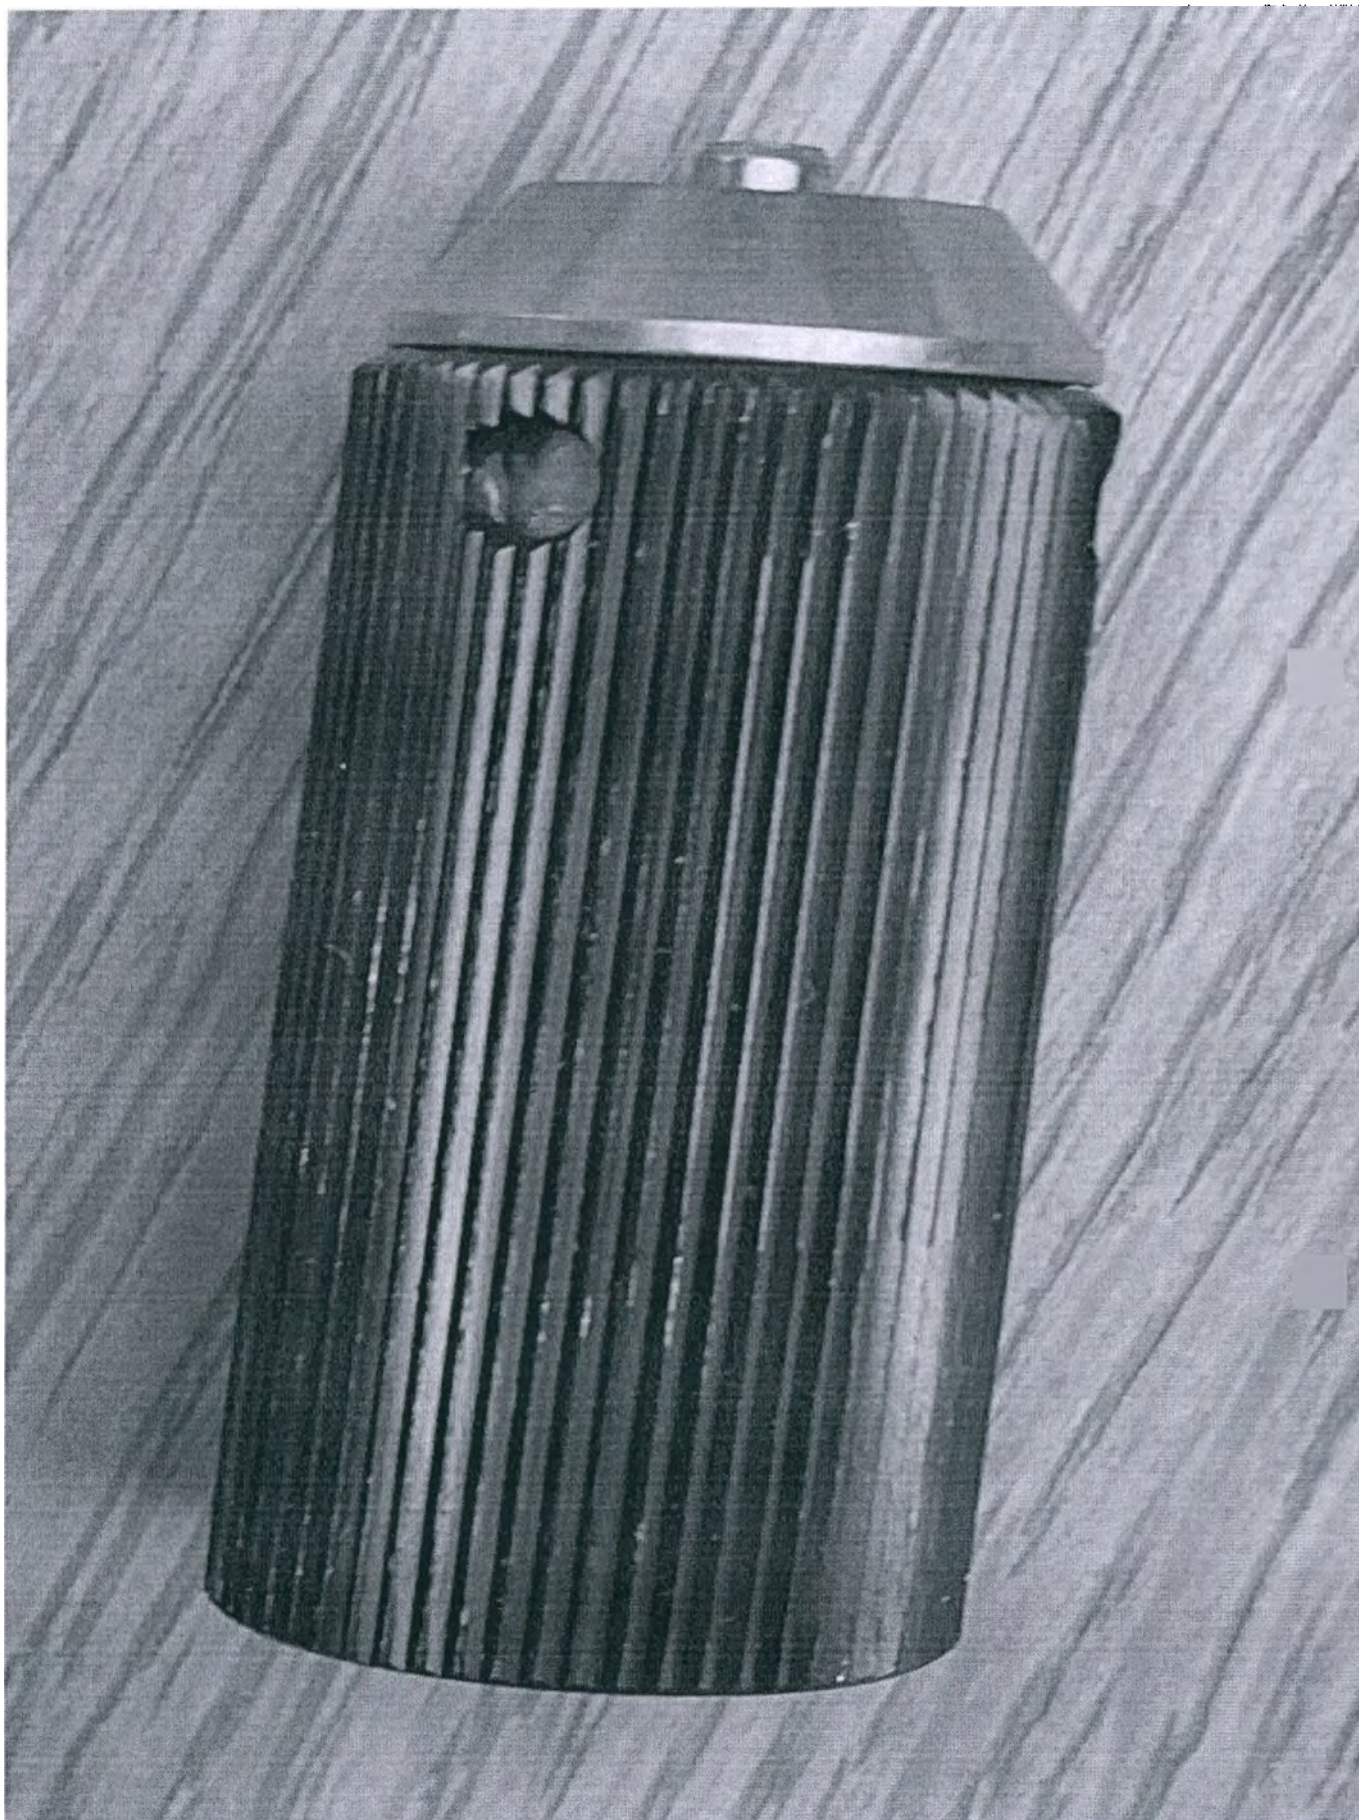

Ключ для цанги




Предохранитель Т 3,15 А
Предохранитель Т 6,3 А

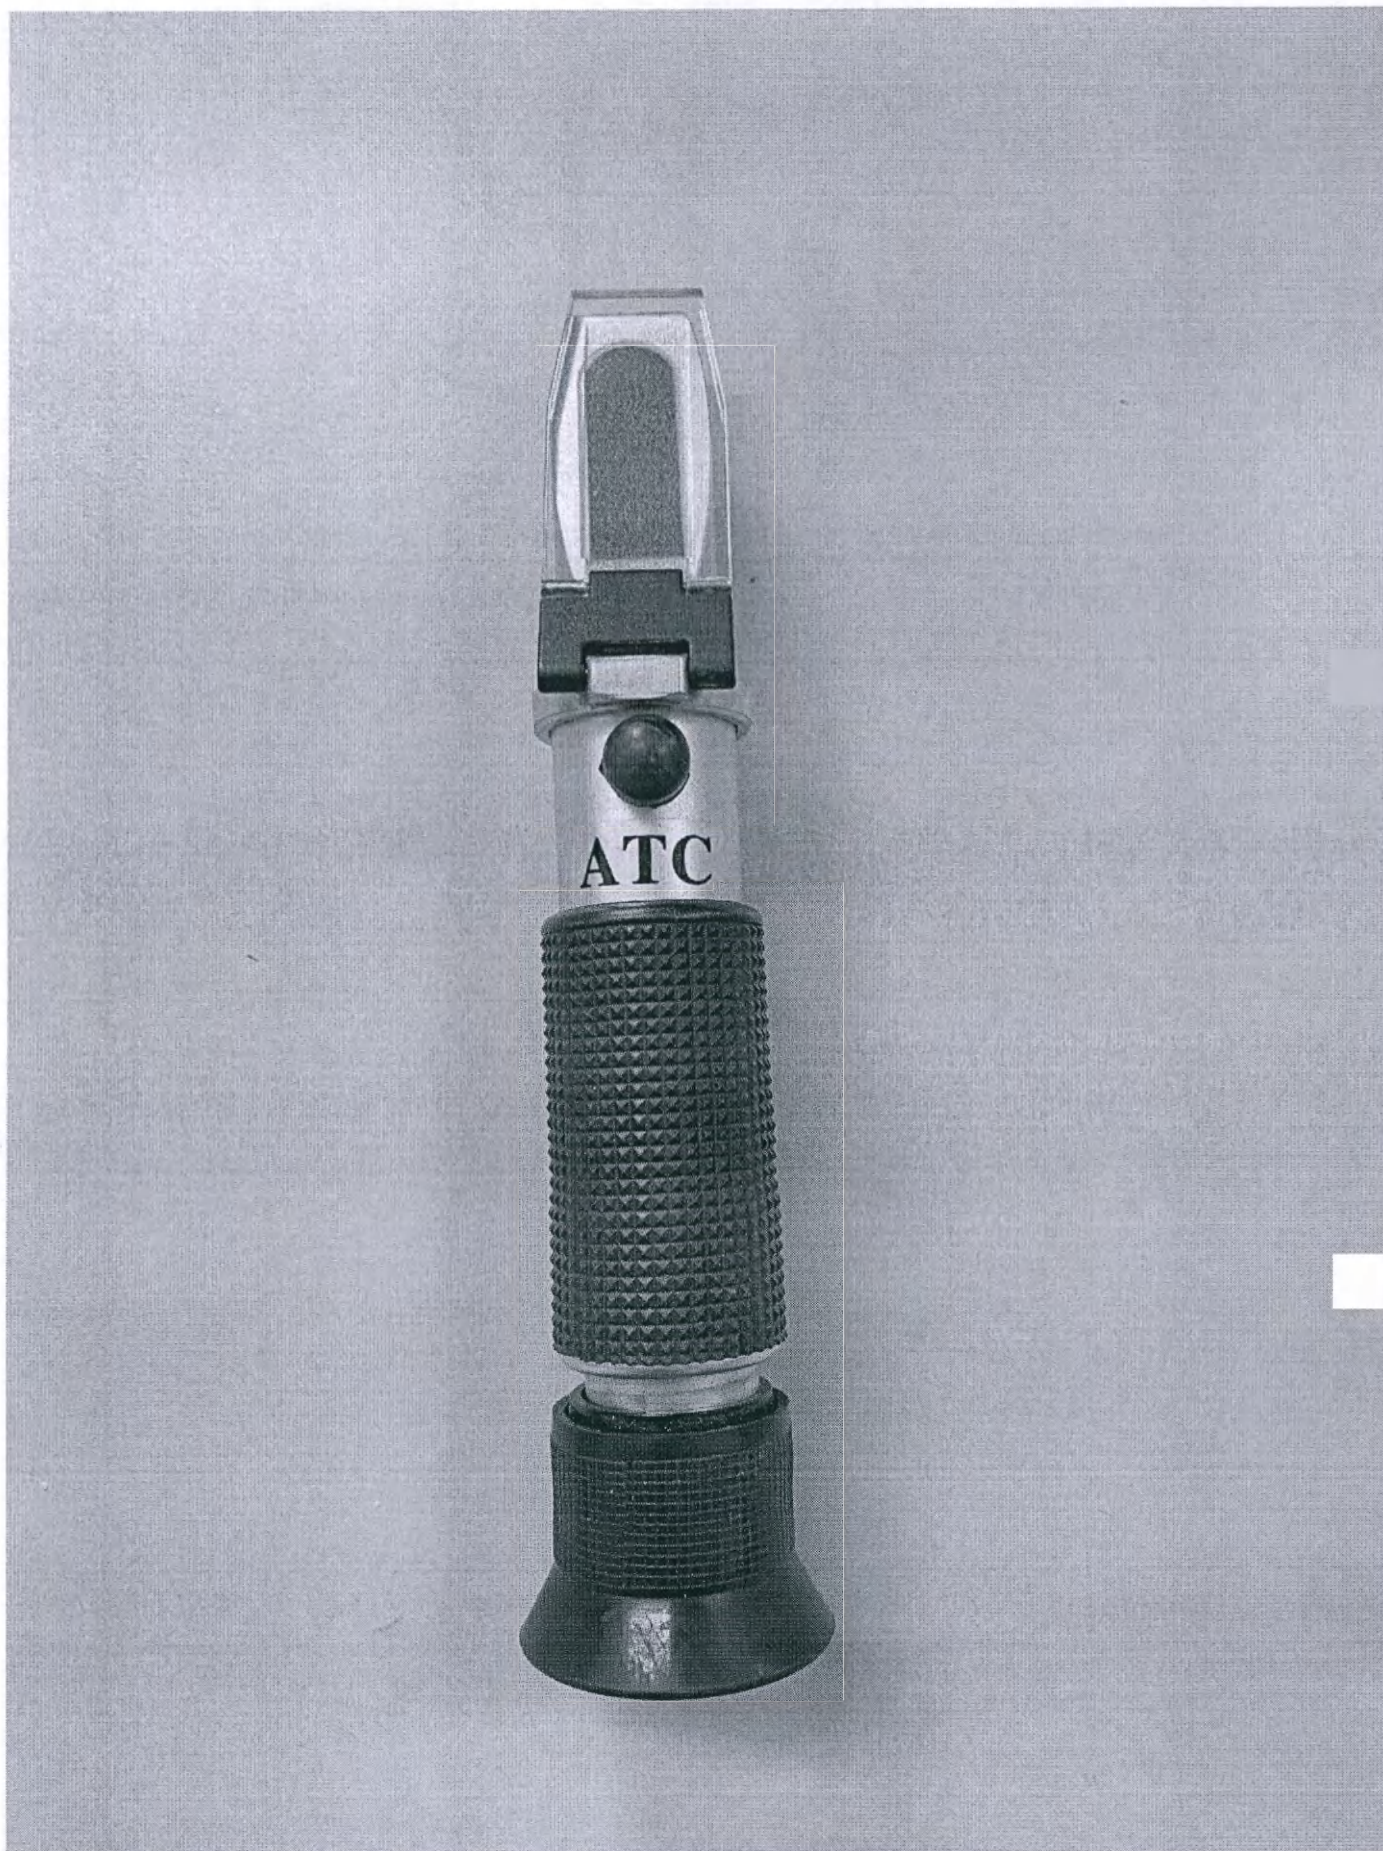

Рефрактометр для определения уровня смазочно-охлаждающей жидкости




Щетка для чистки большая

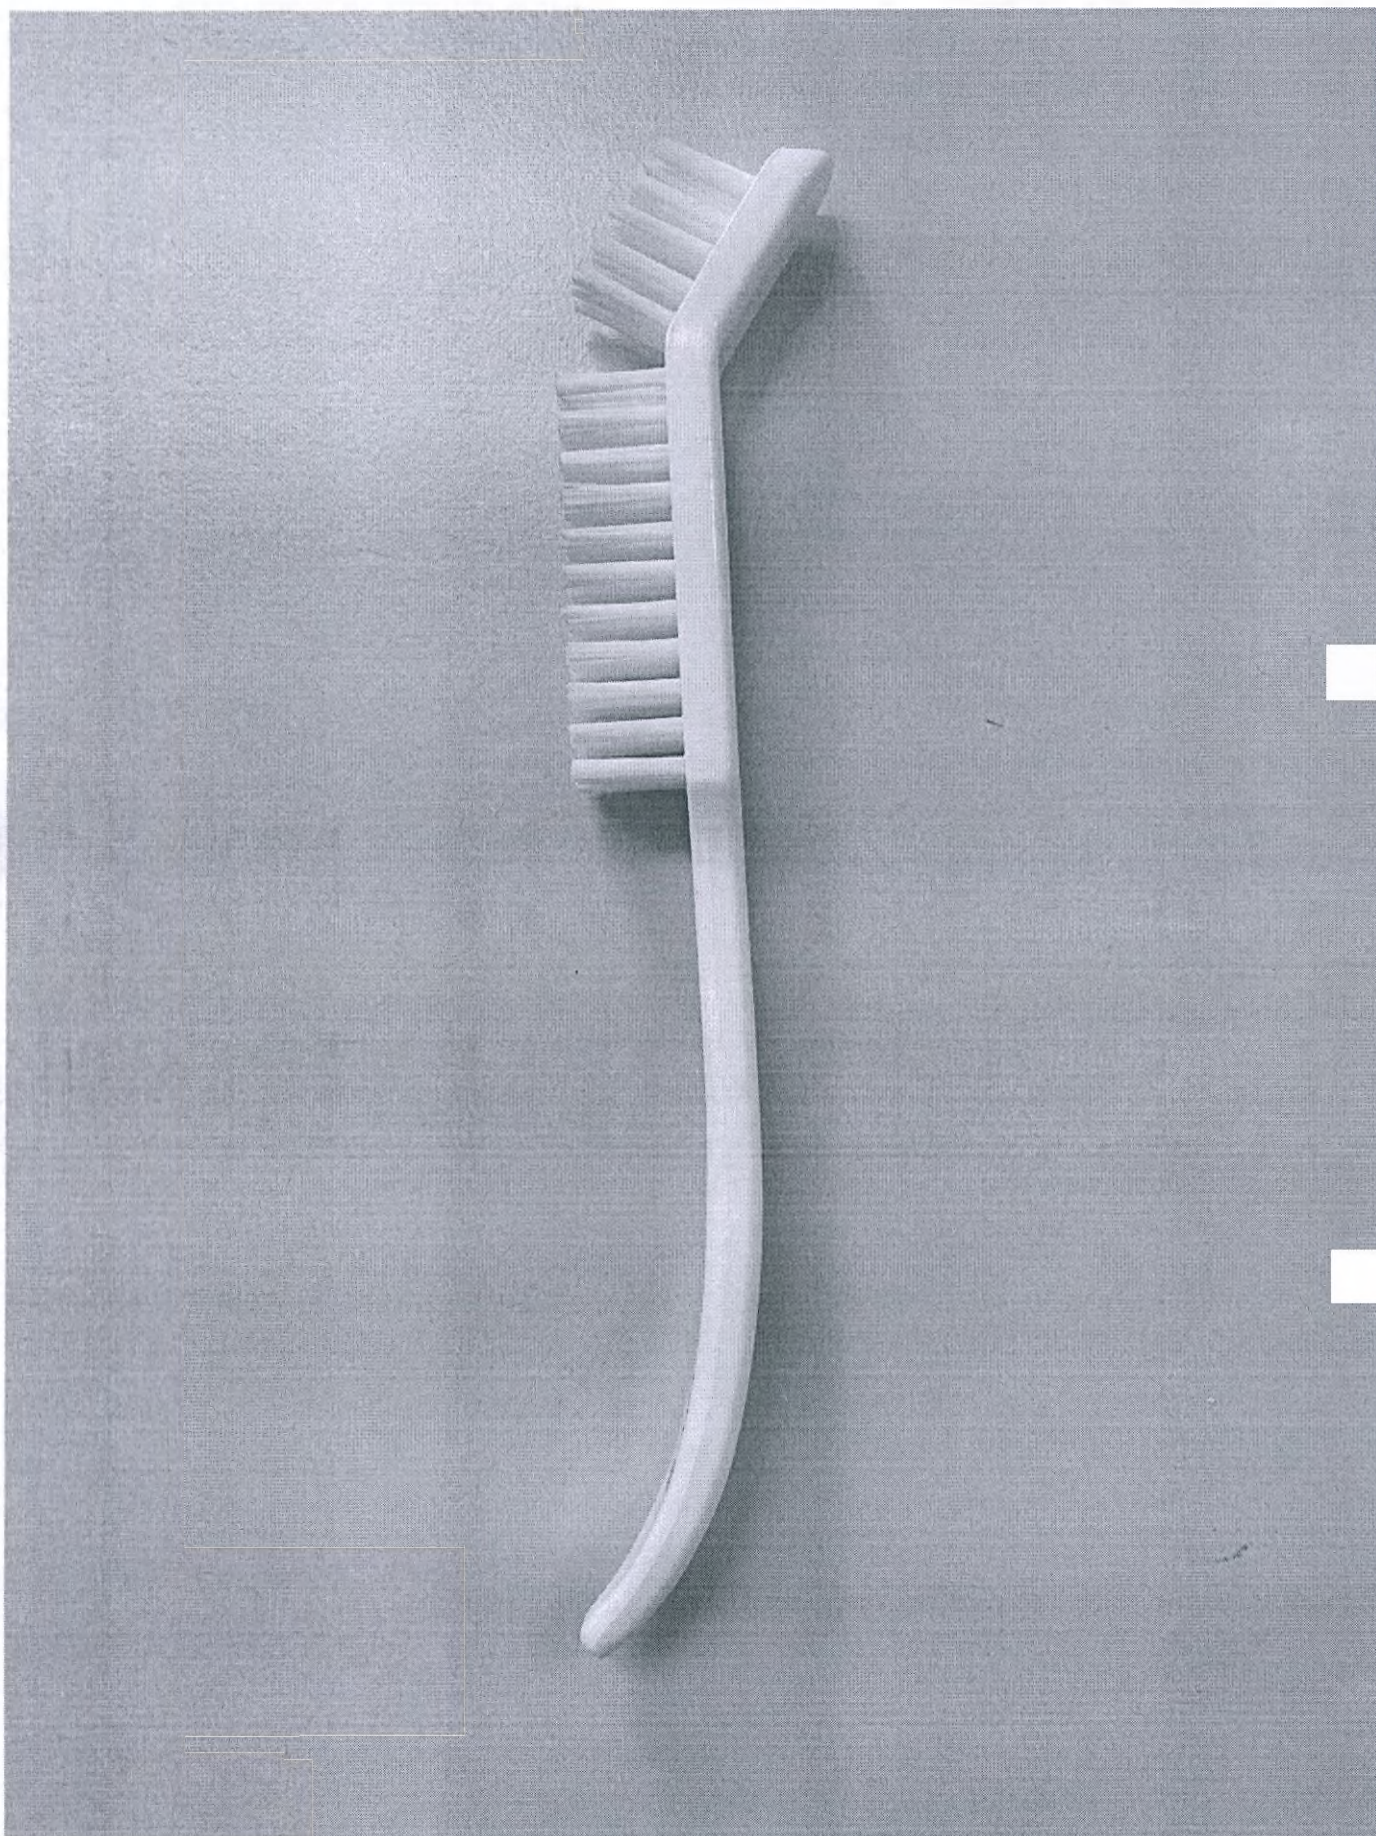

Щетка для чистки маленькая




Динамометрический отвёртка со сменяемой насадкой

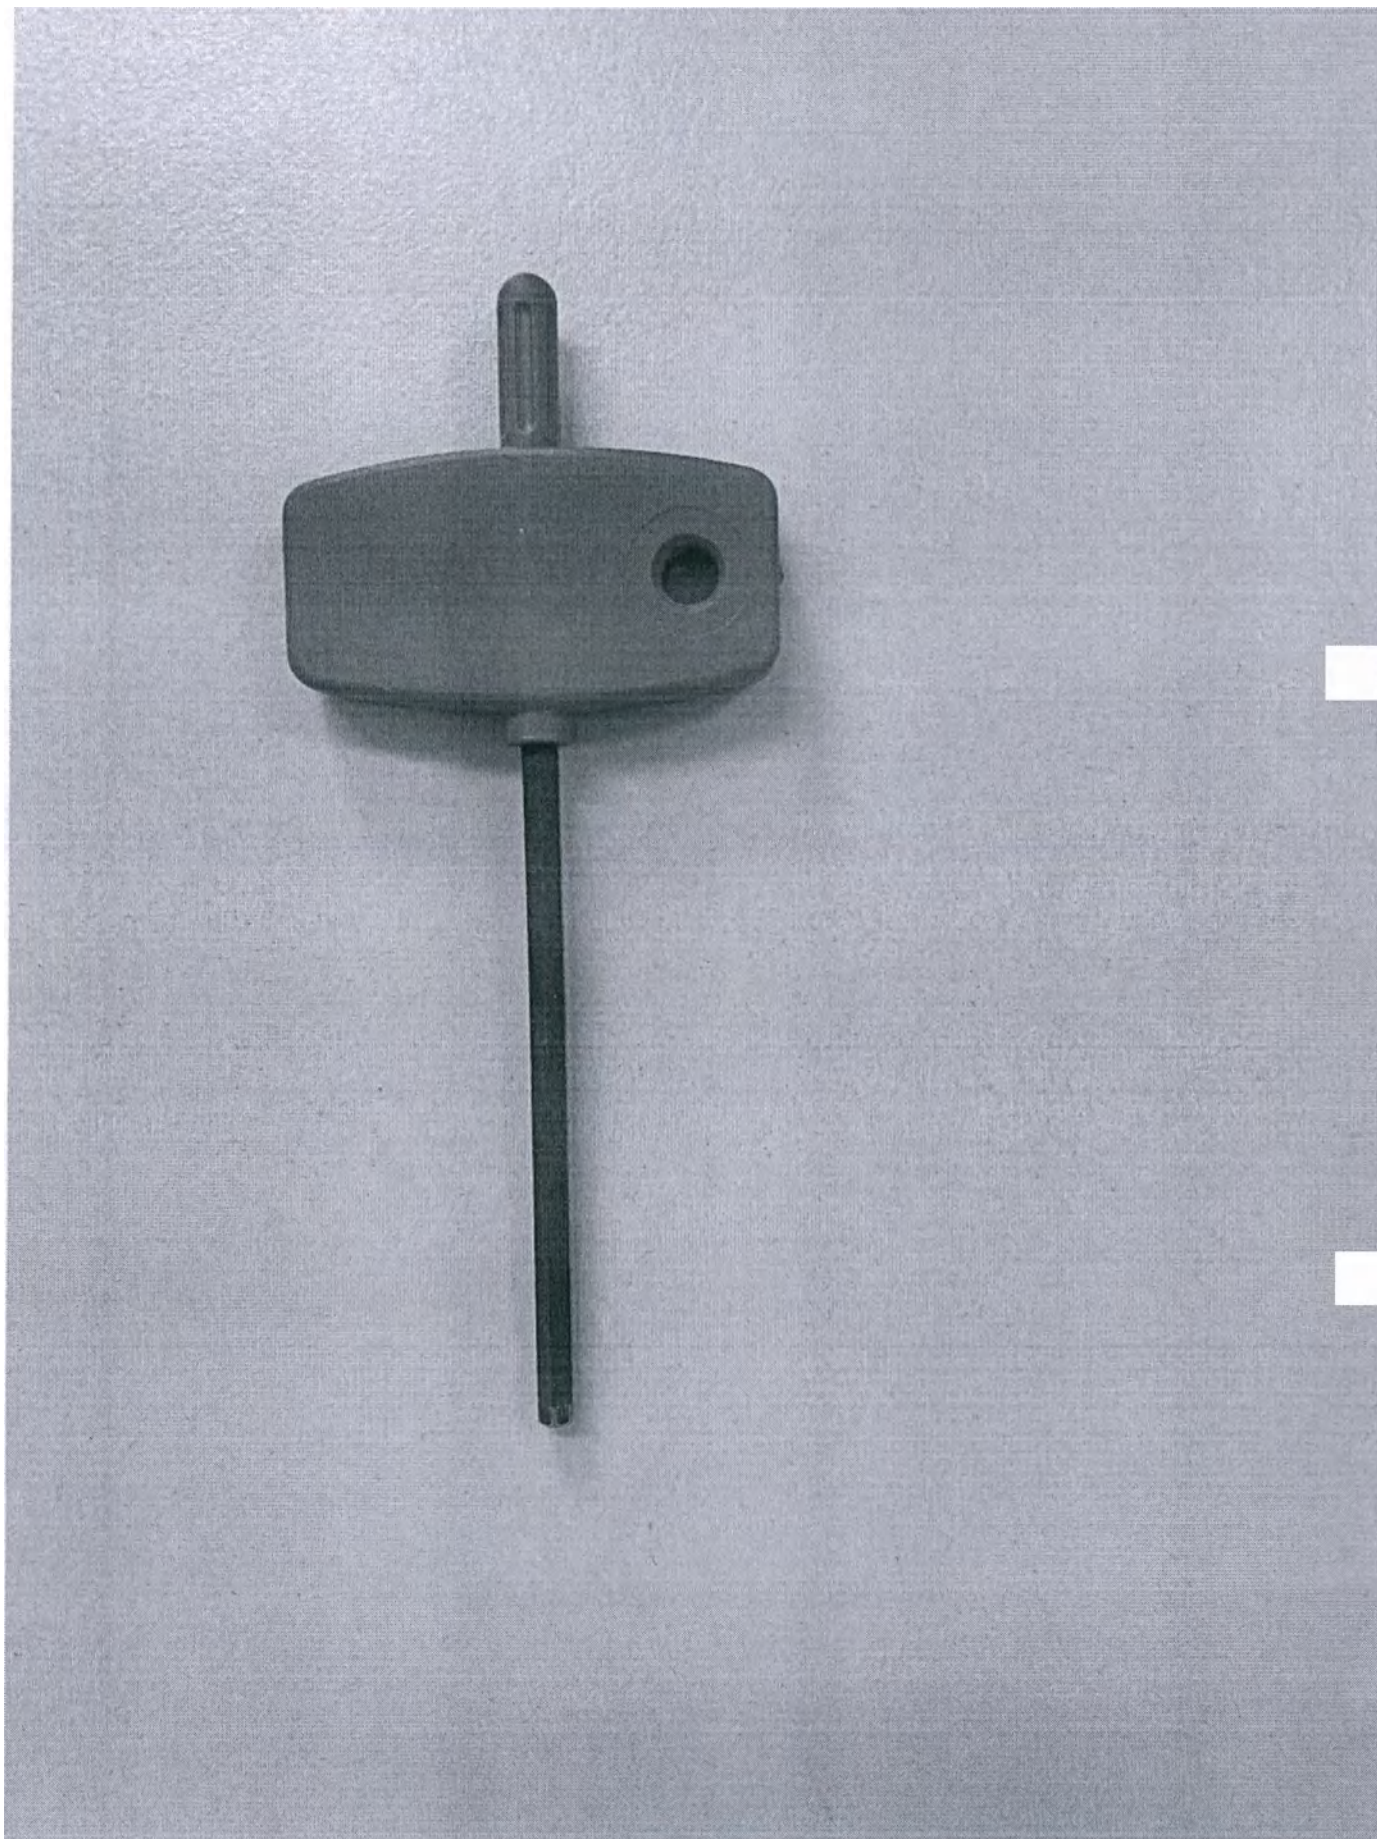


Шестигранный ключ с рукояткой




Шестигранный ключ большой

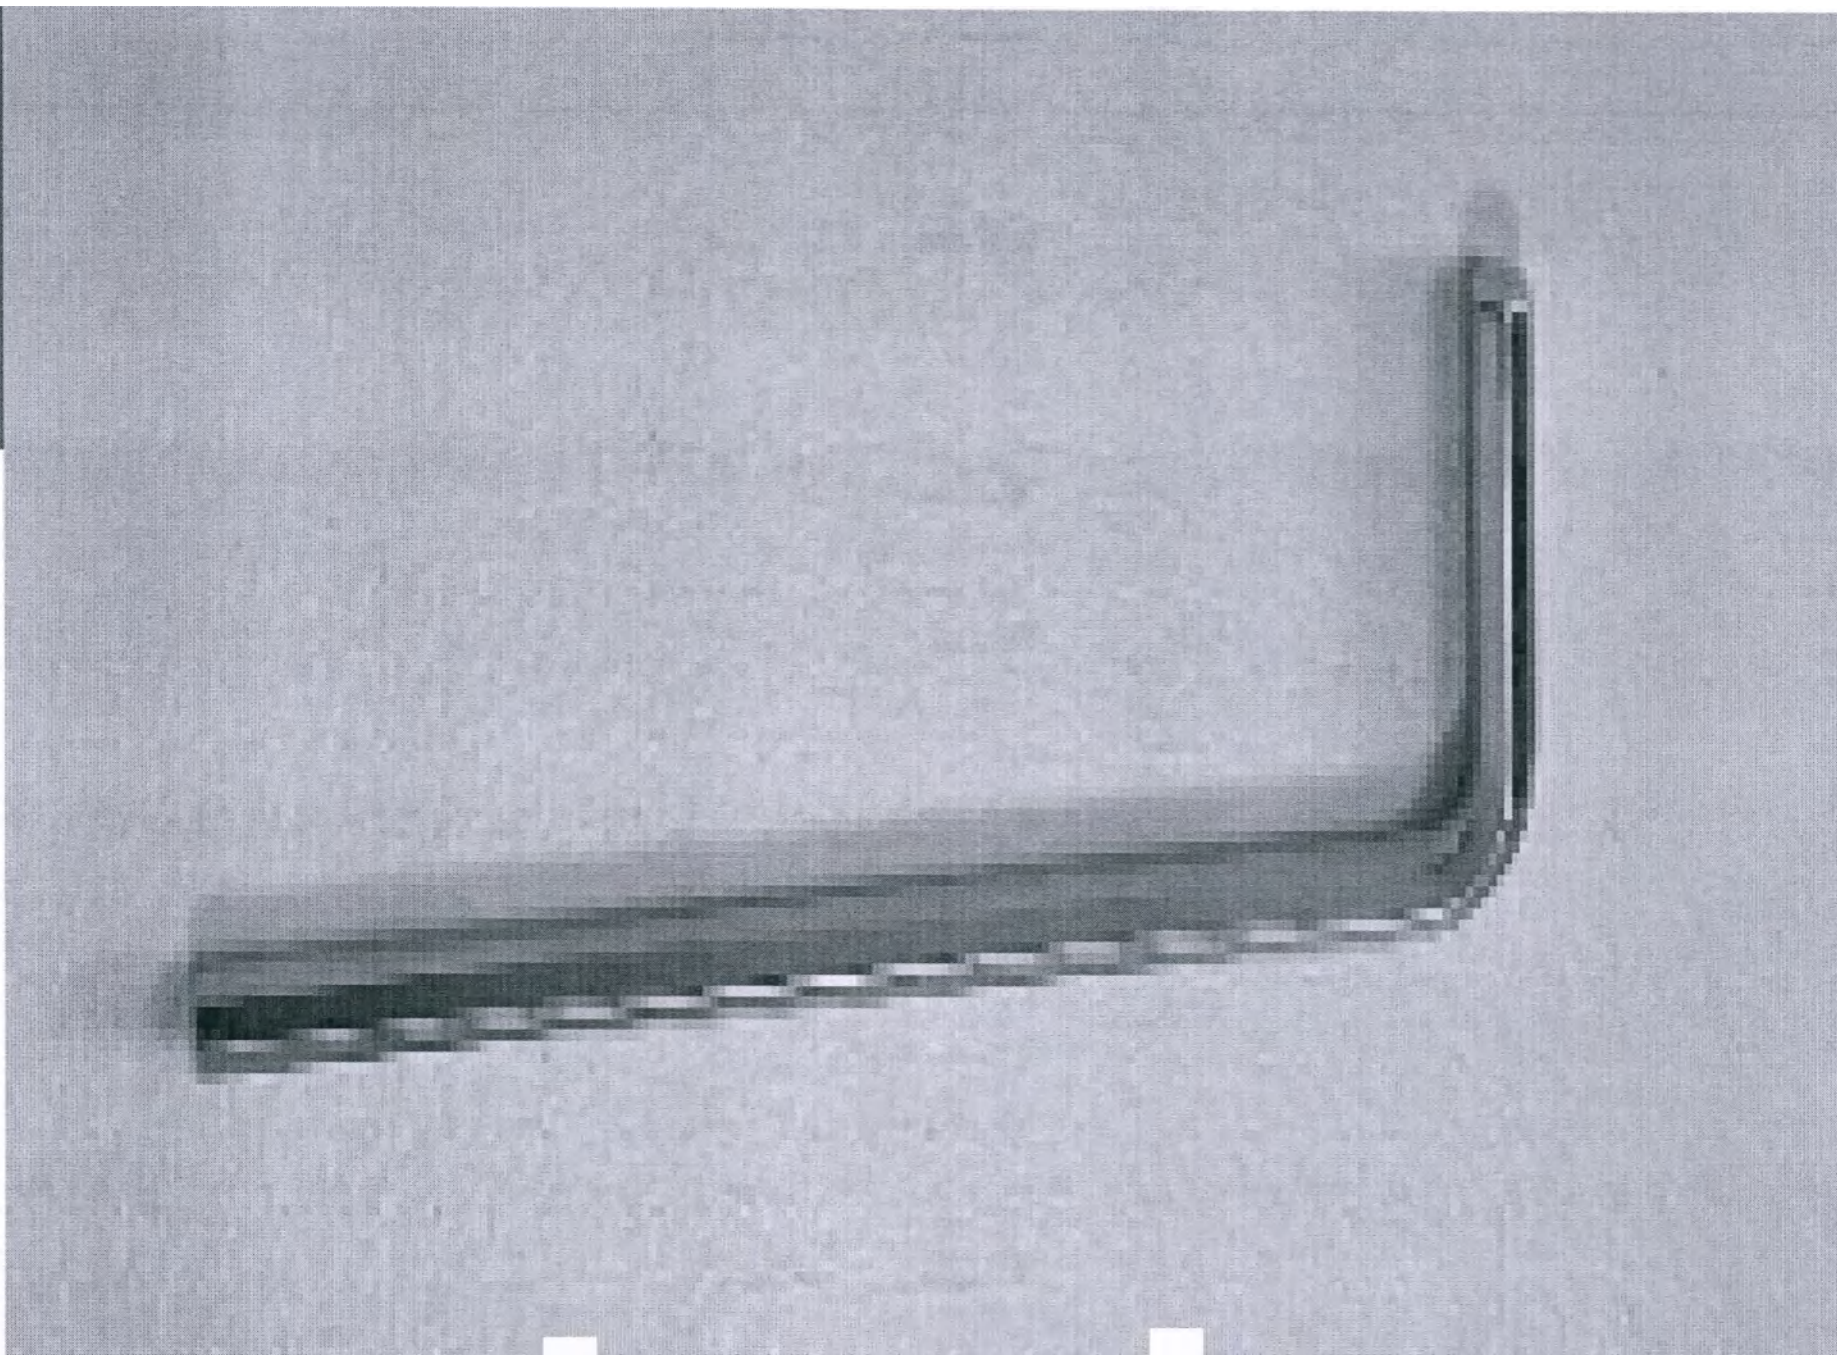


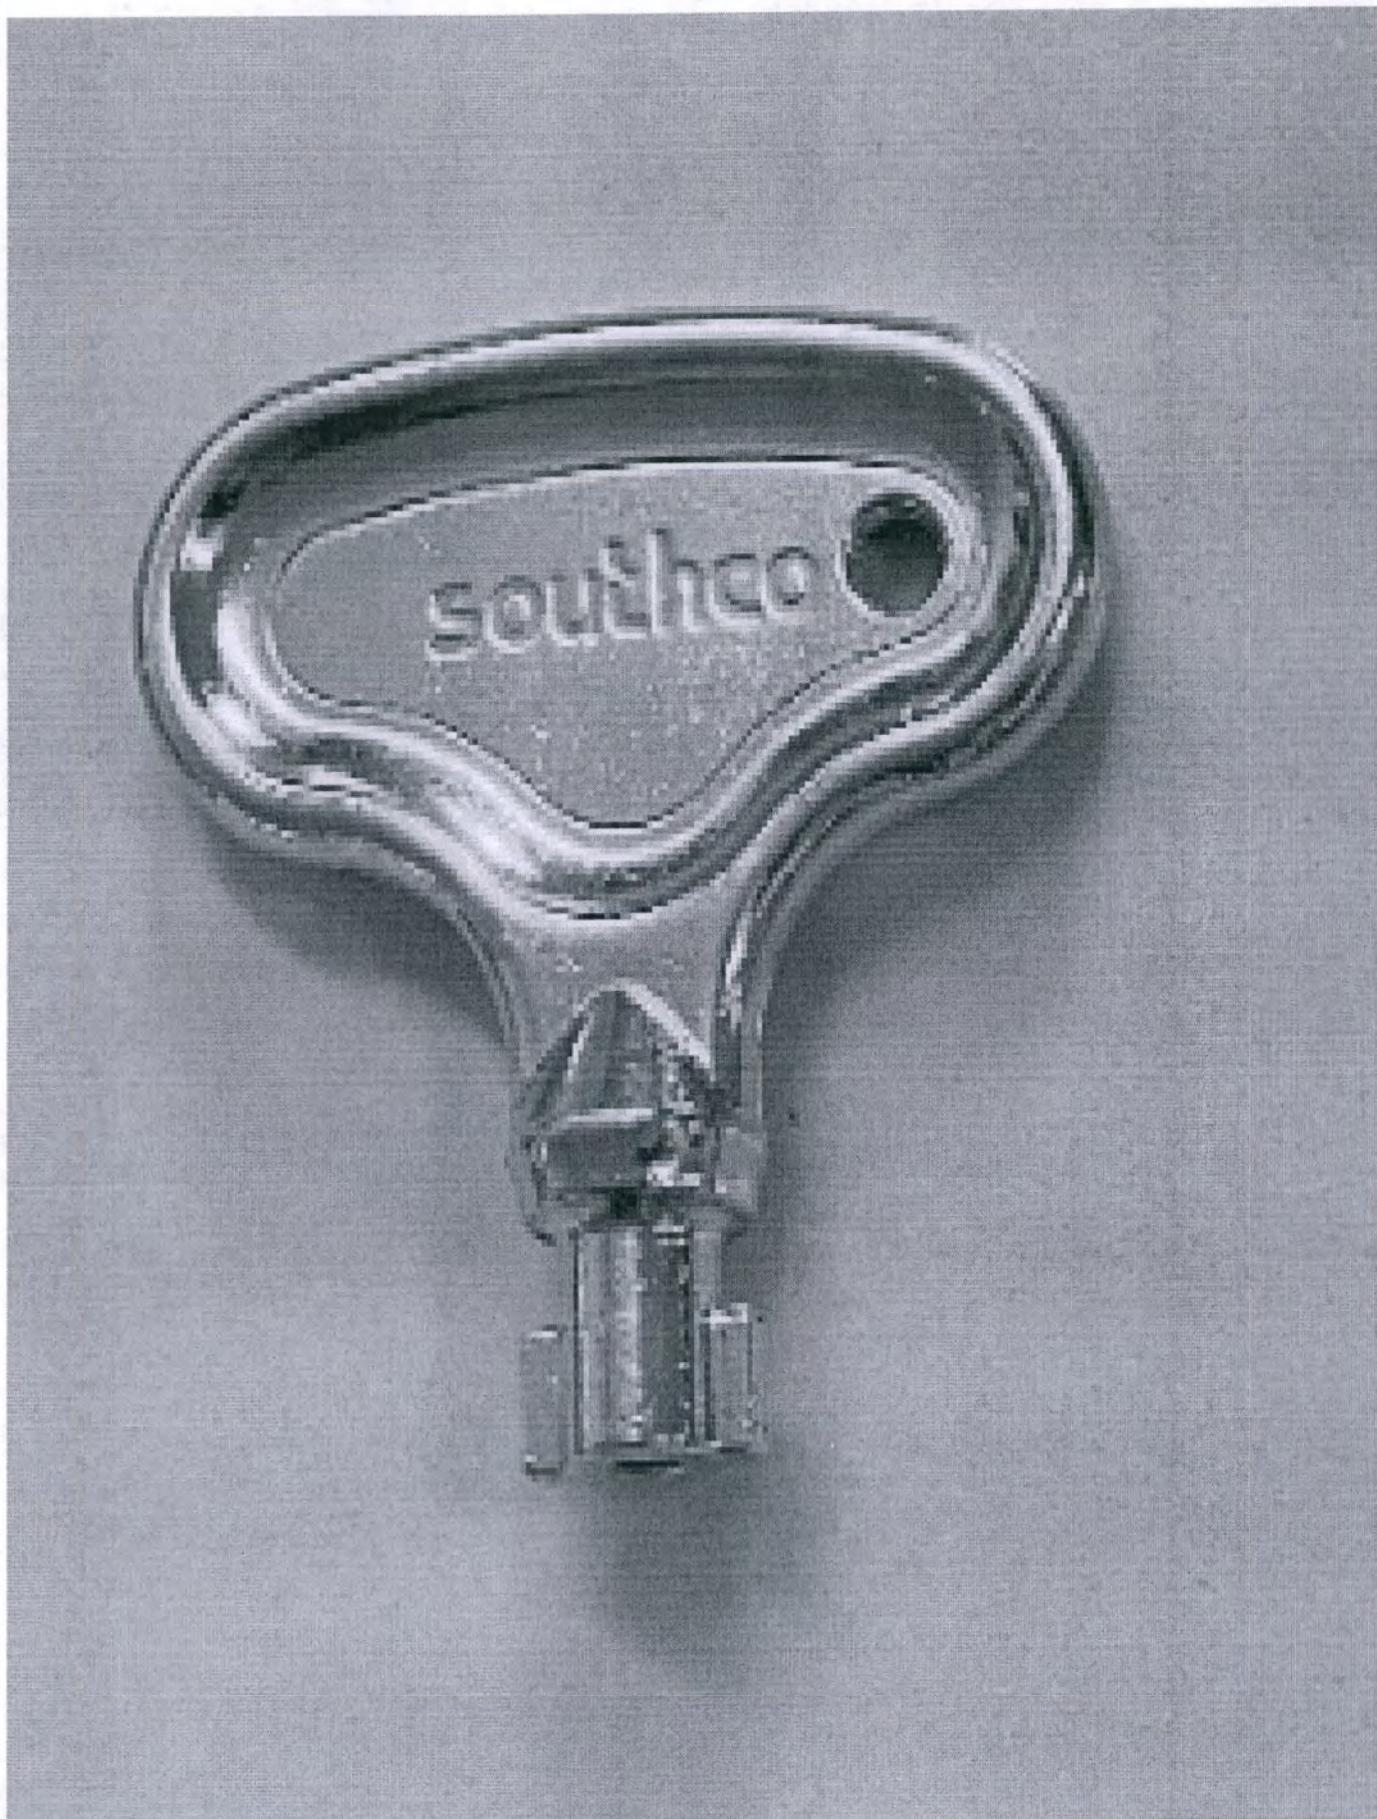

Ключ для ручной разблокировки фрезерной камеры

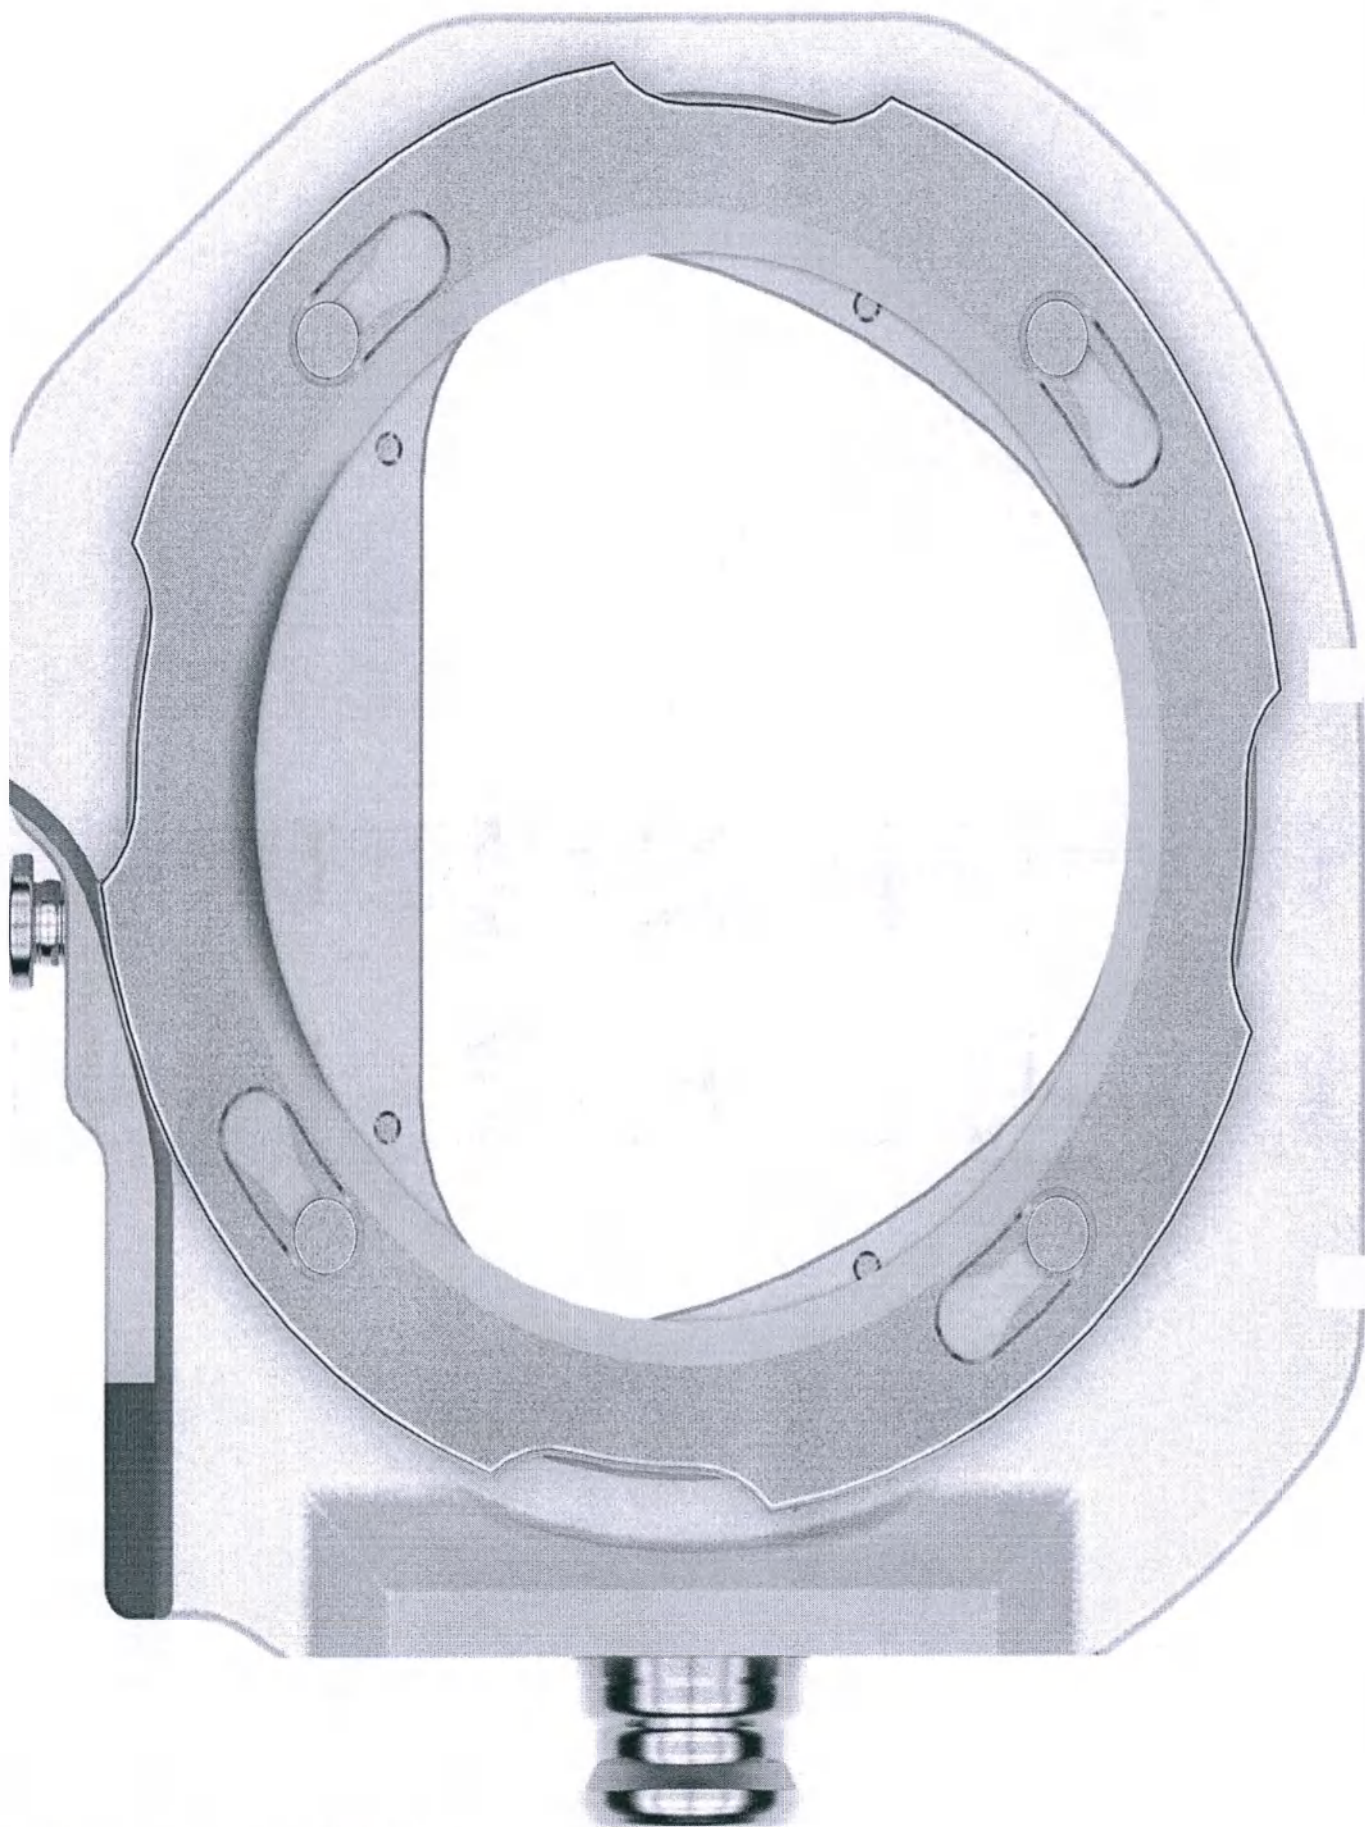


Держателей заготовок 71 181210

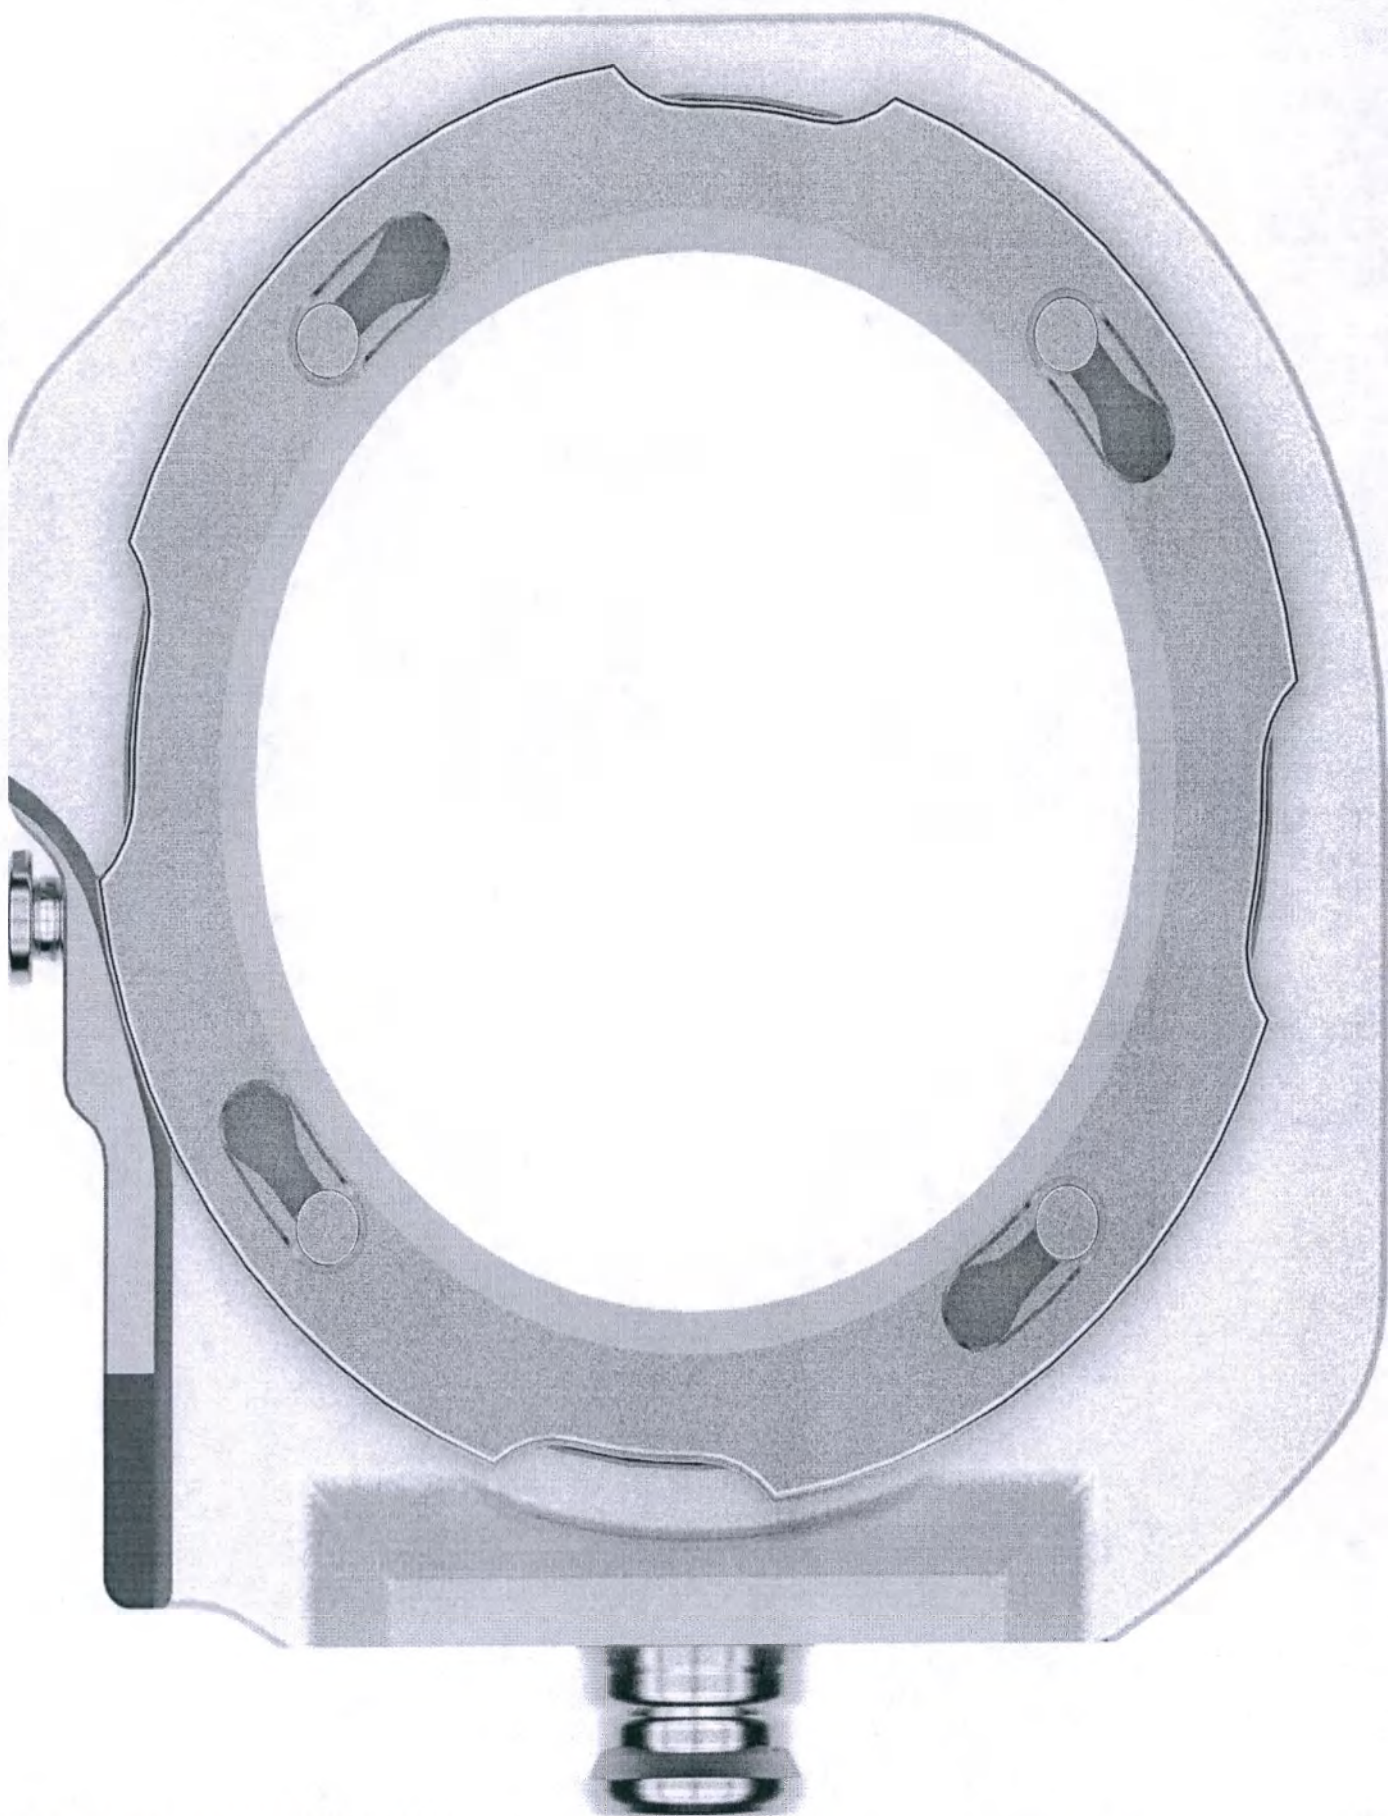


Держателей заготовок 98 181211




Держателей заготовок BD 181217

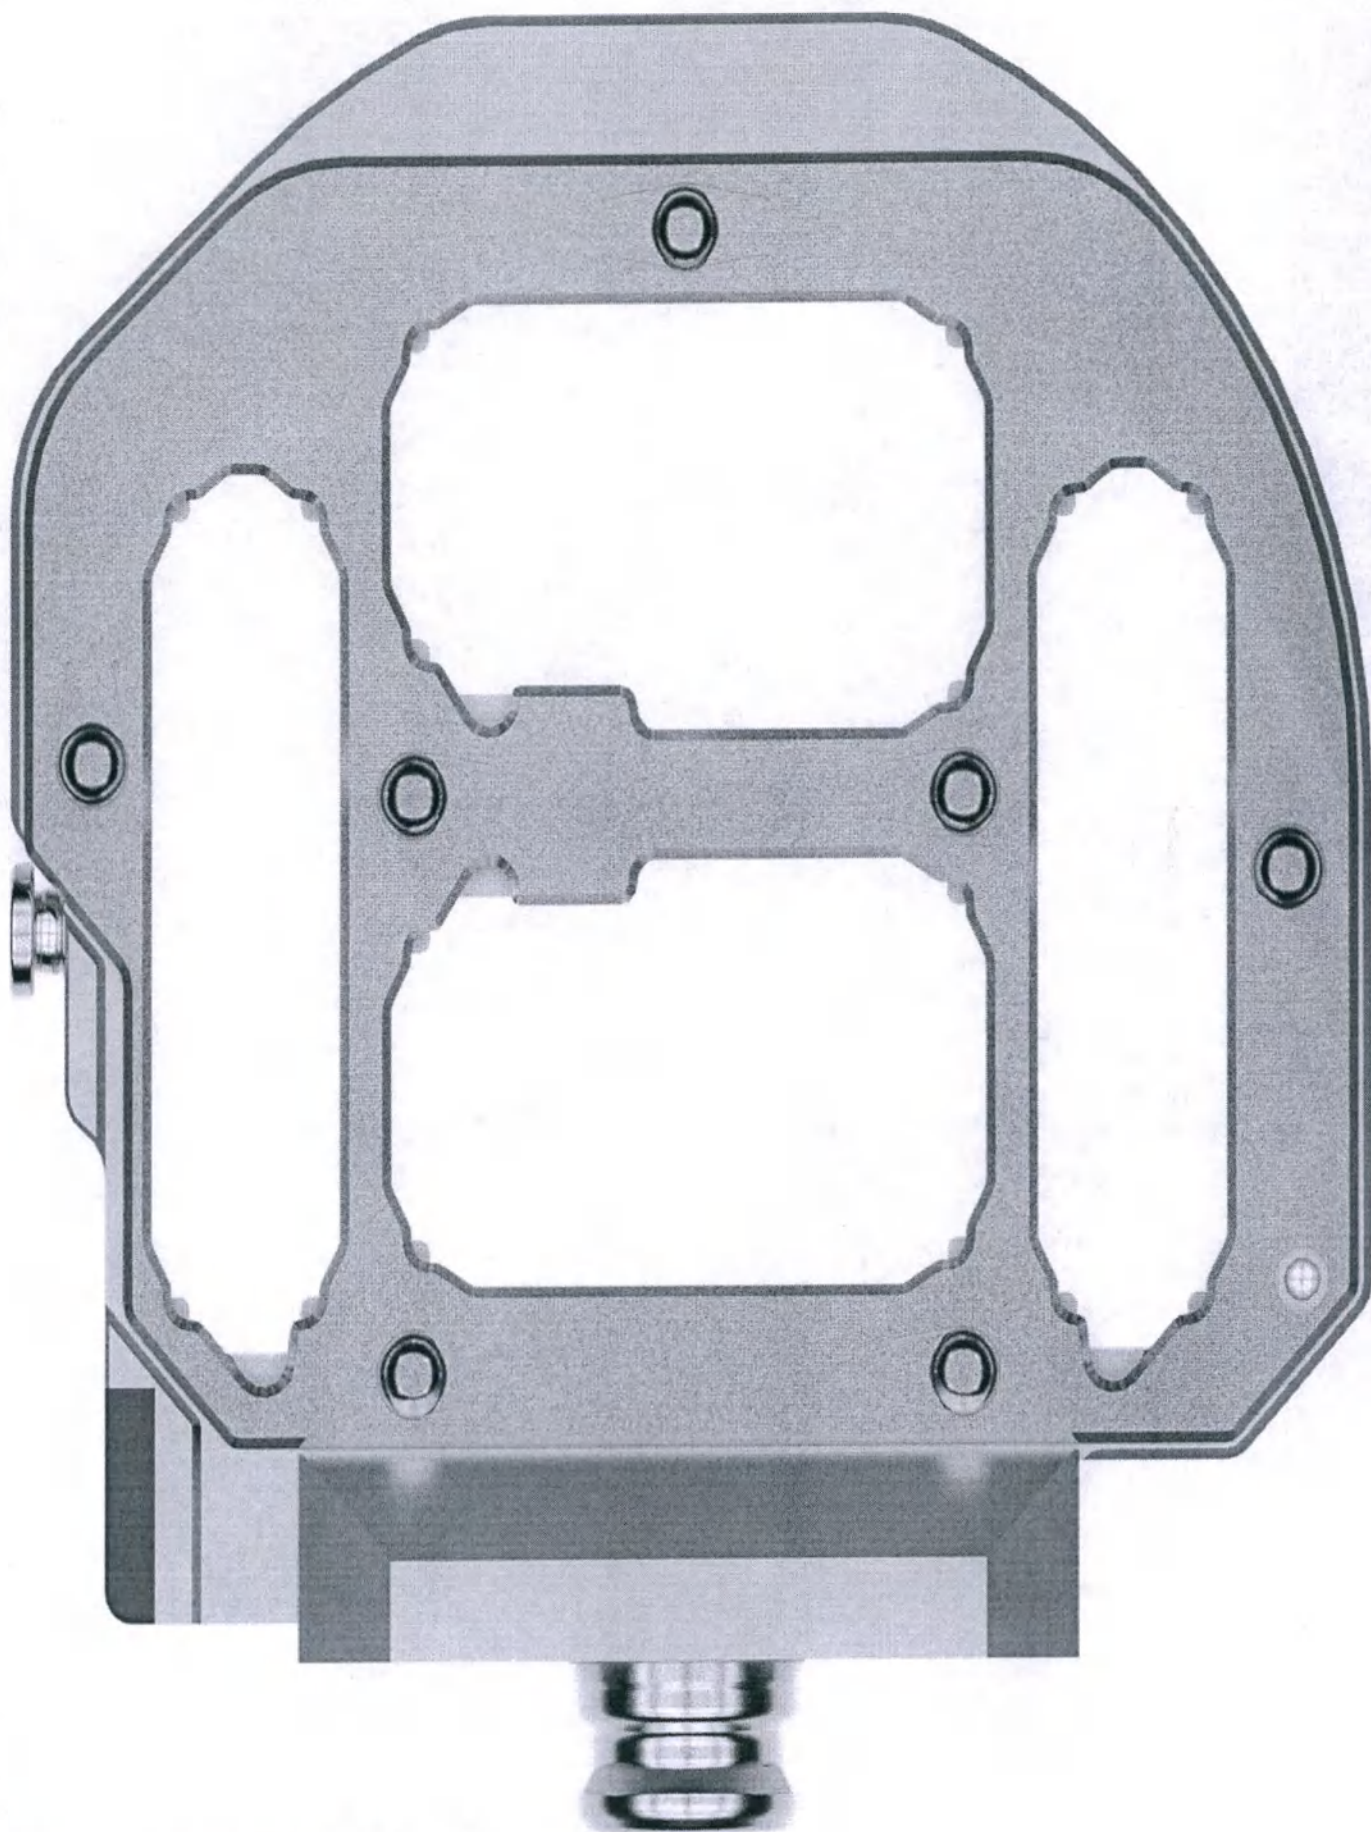


Держателей заготовок D-Set 181216

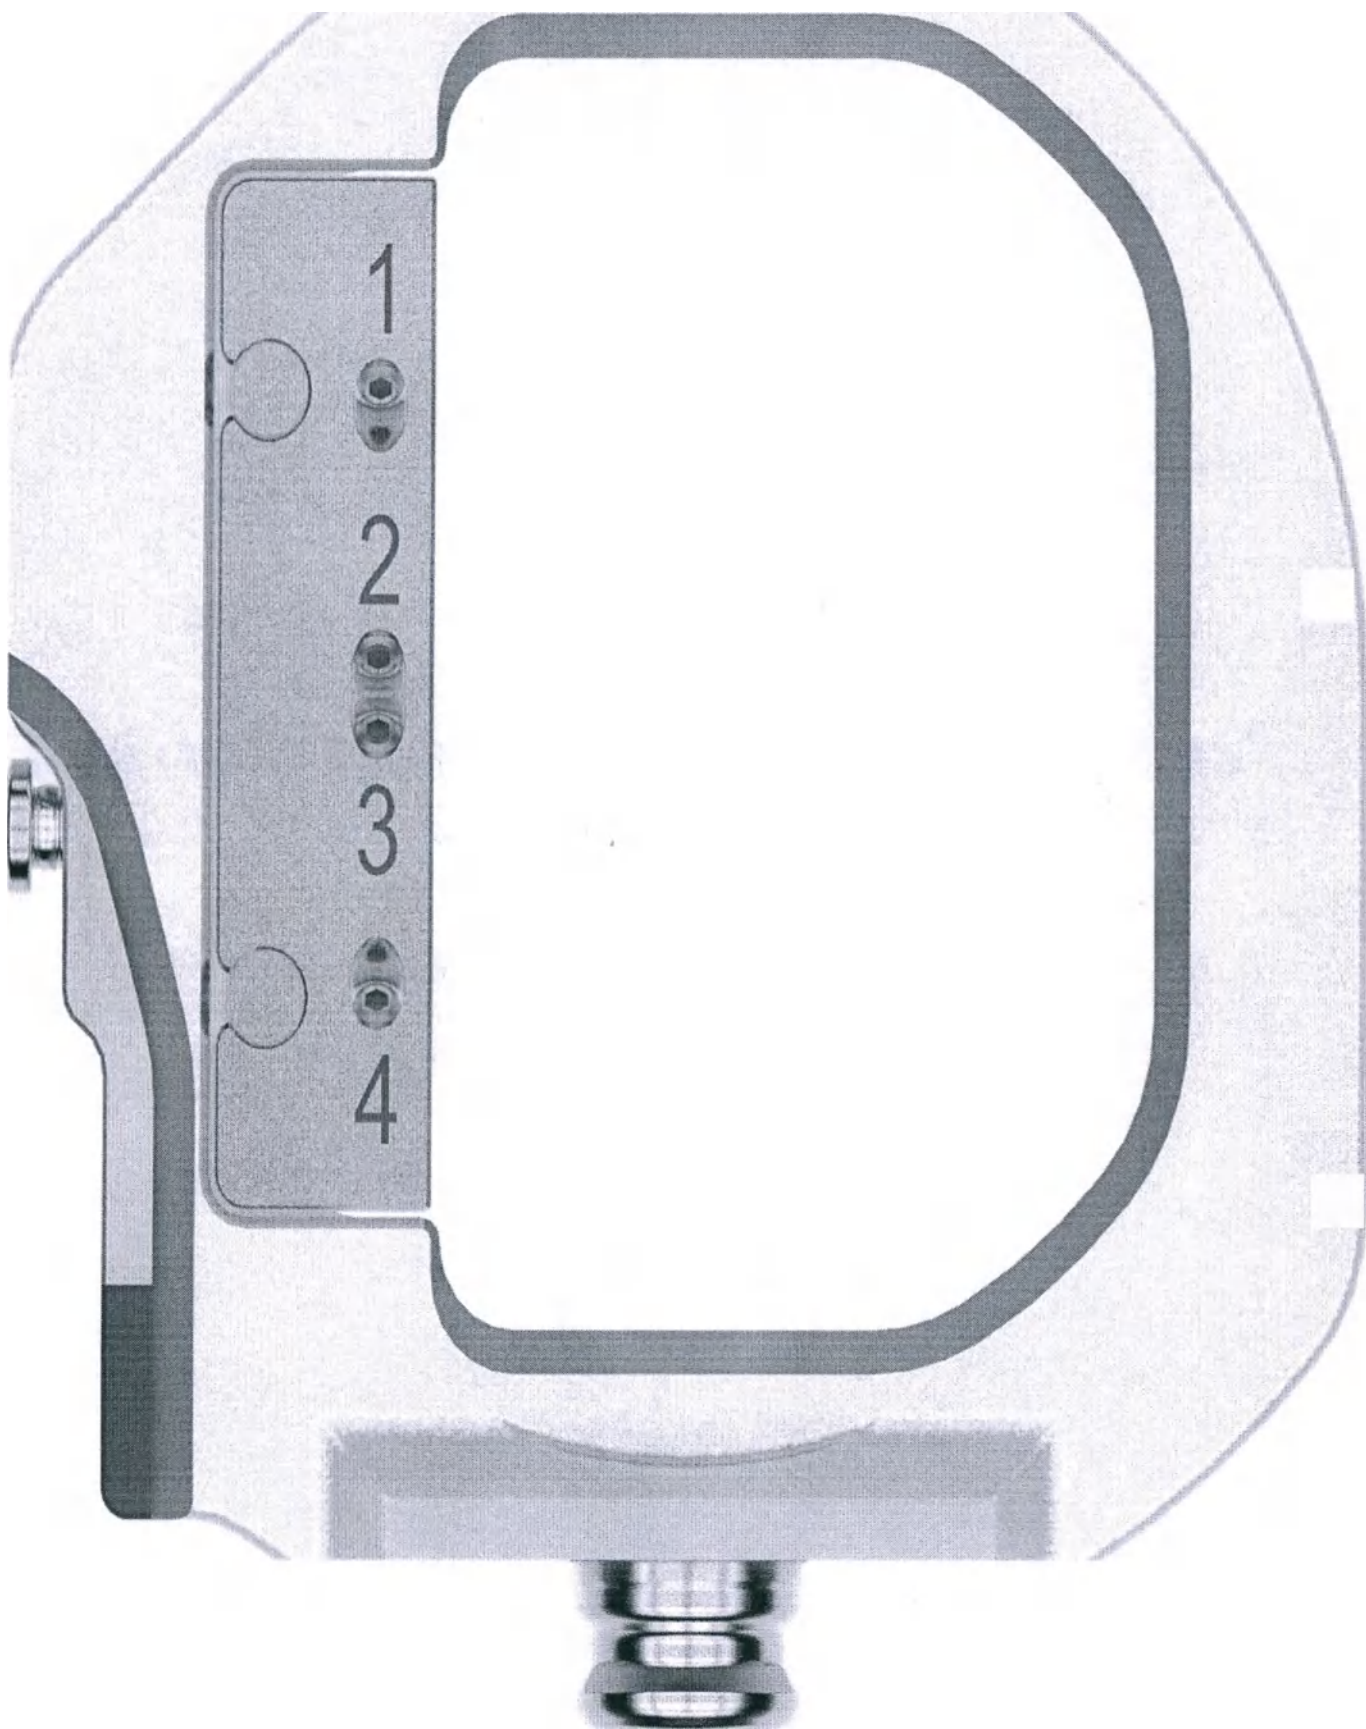


Держателей заготовок Programill 181219

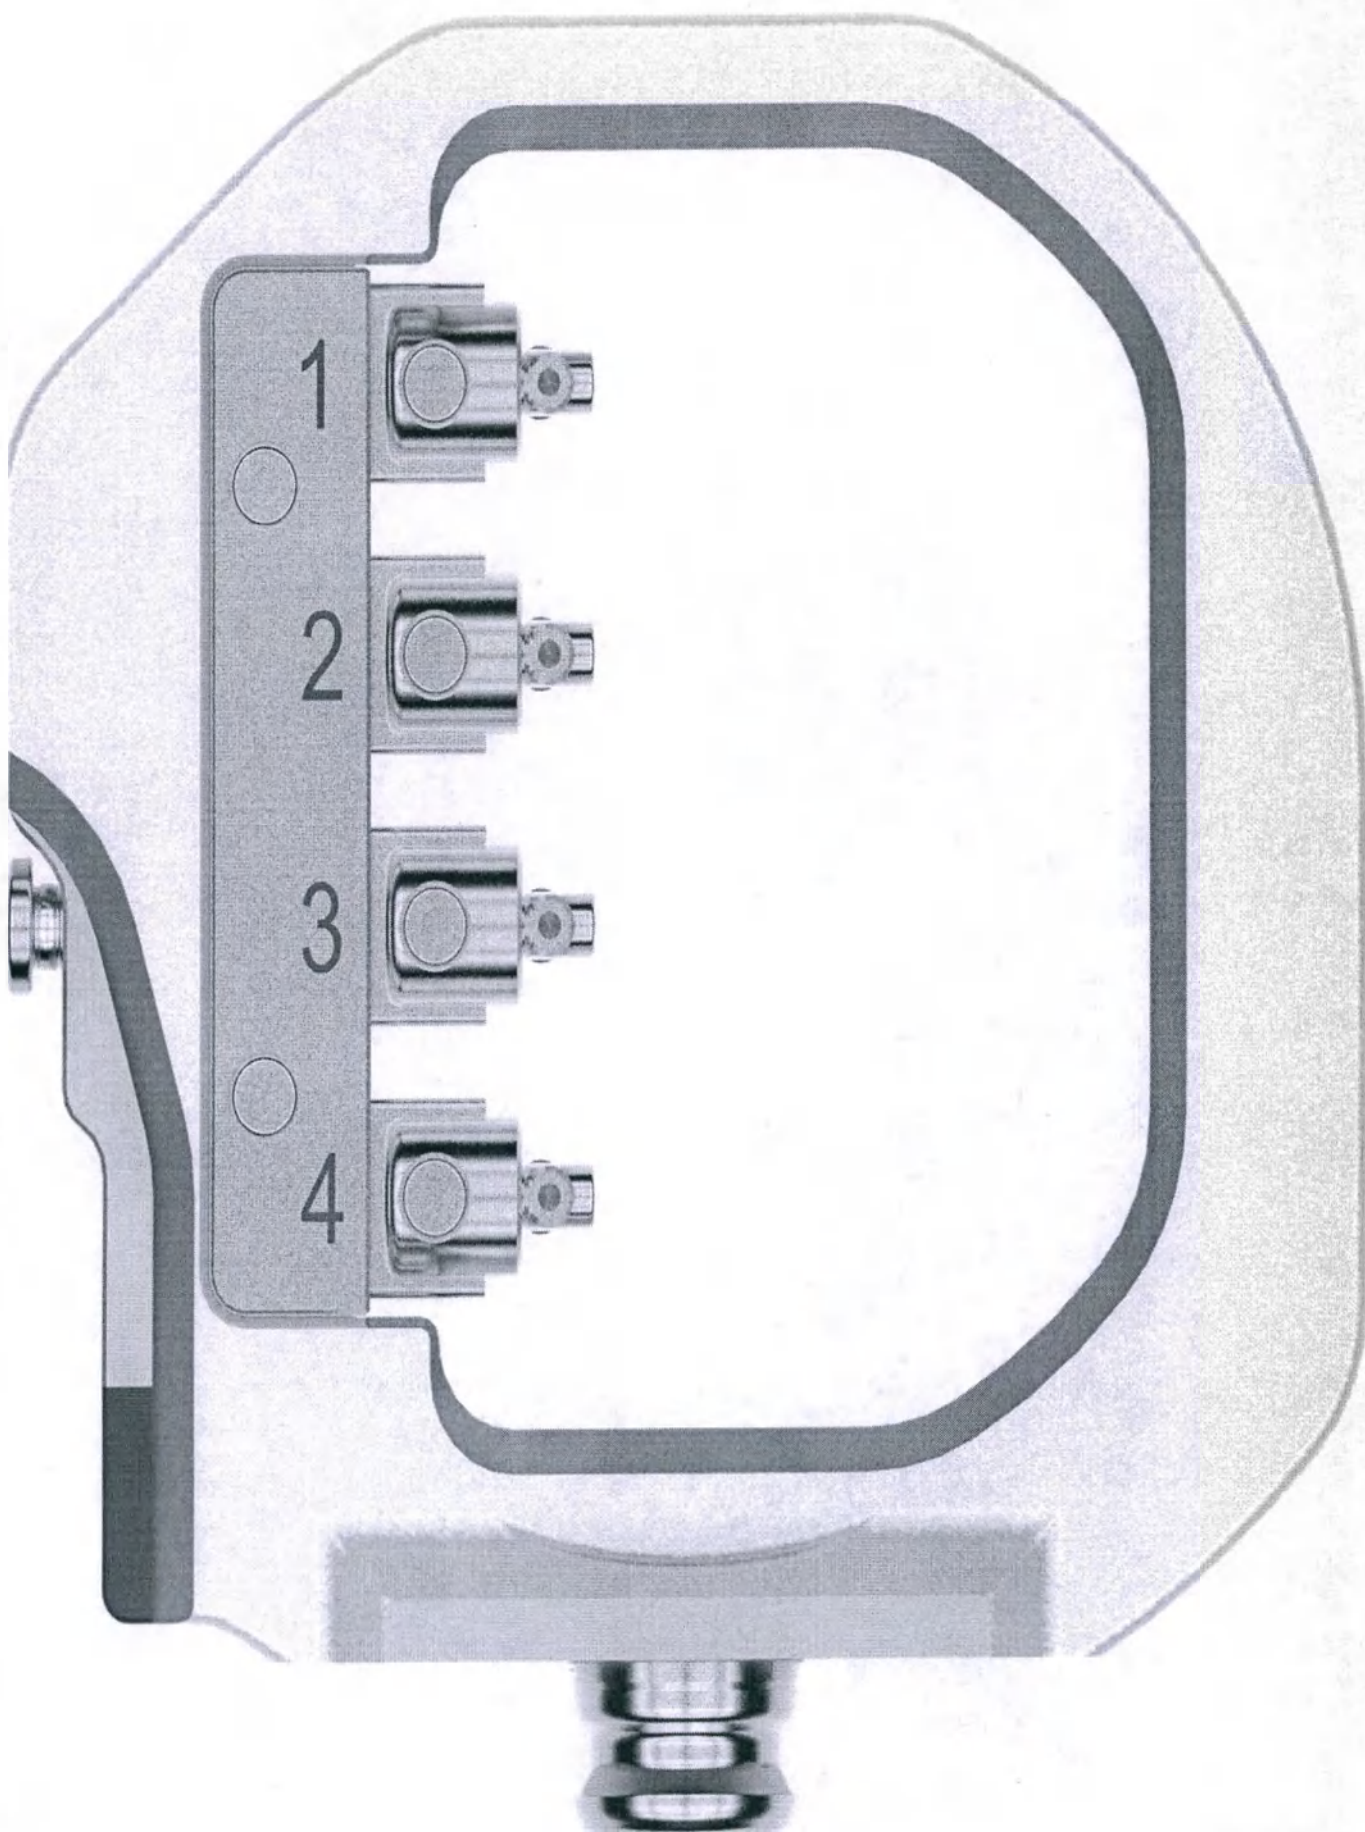


Держателей заготовок Ti-Preforms 181214

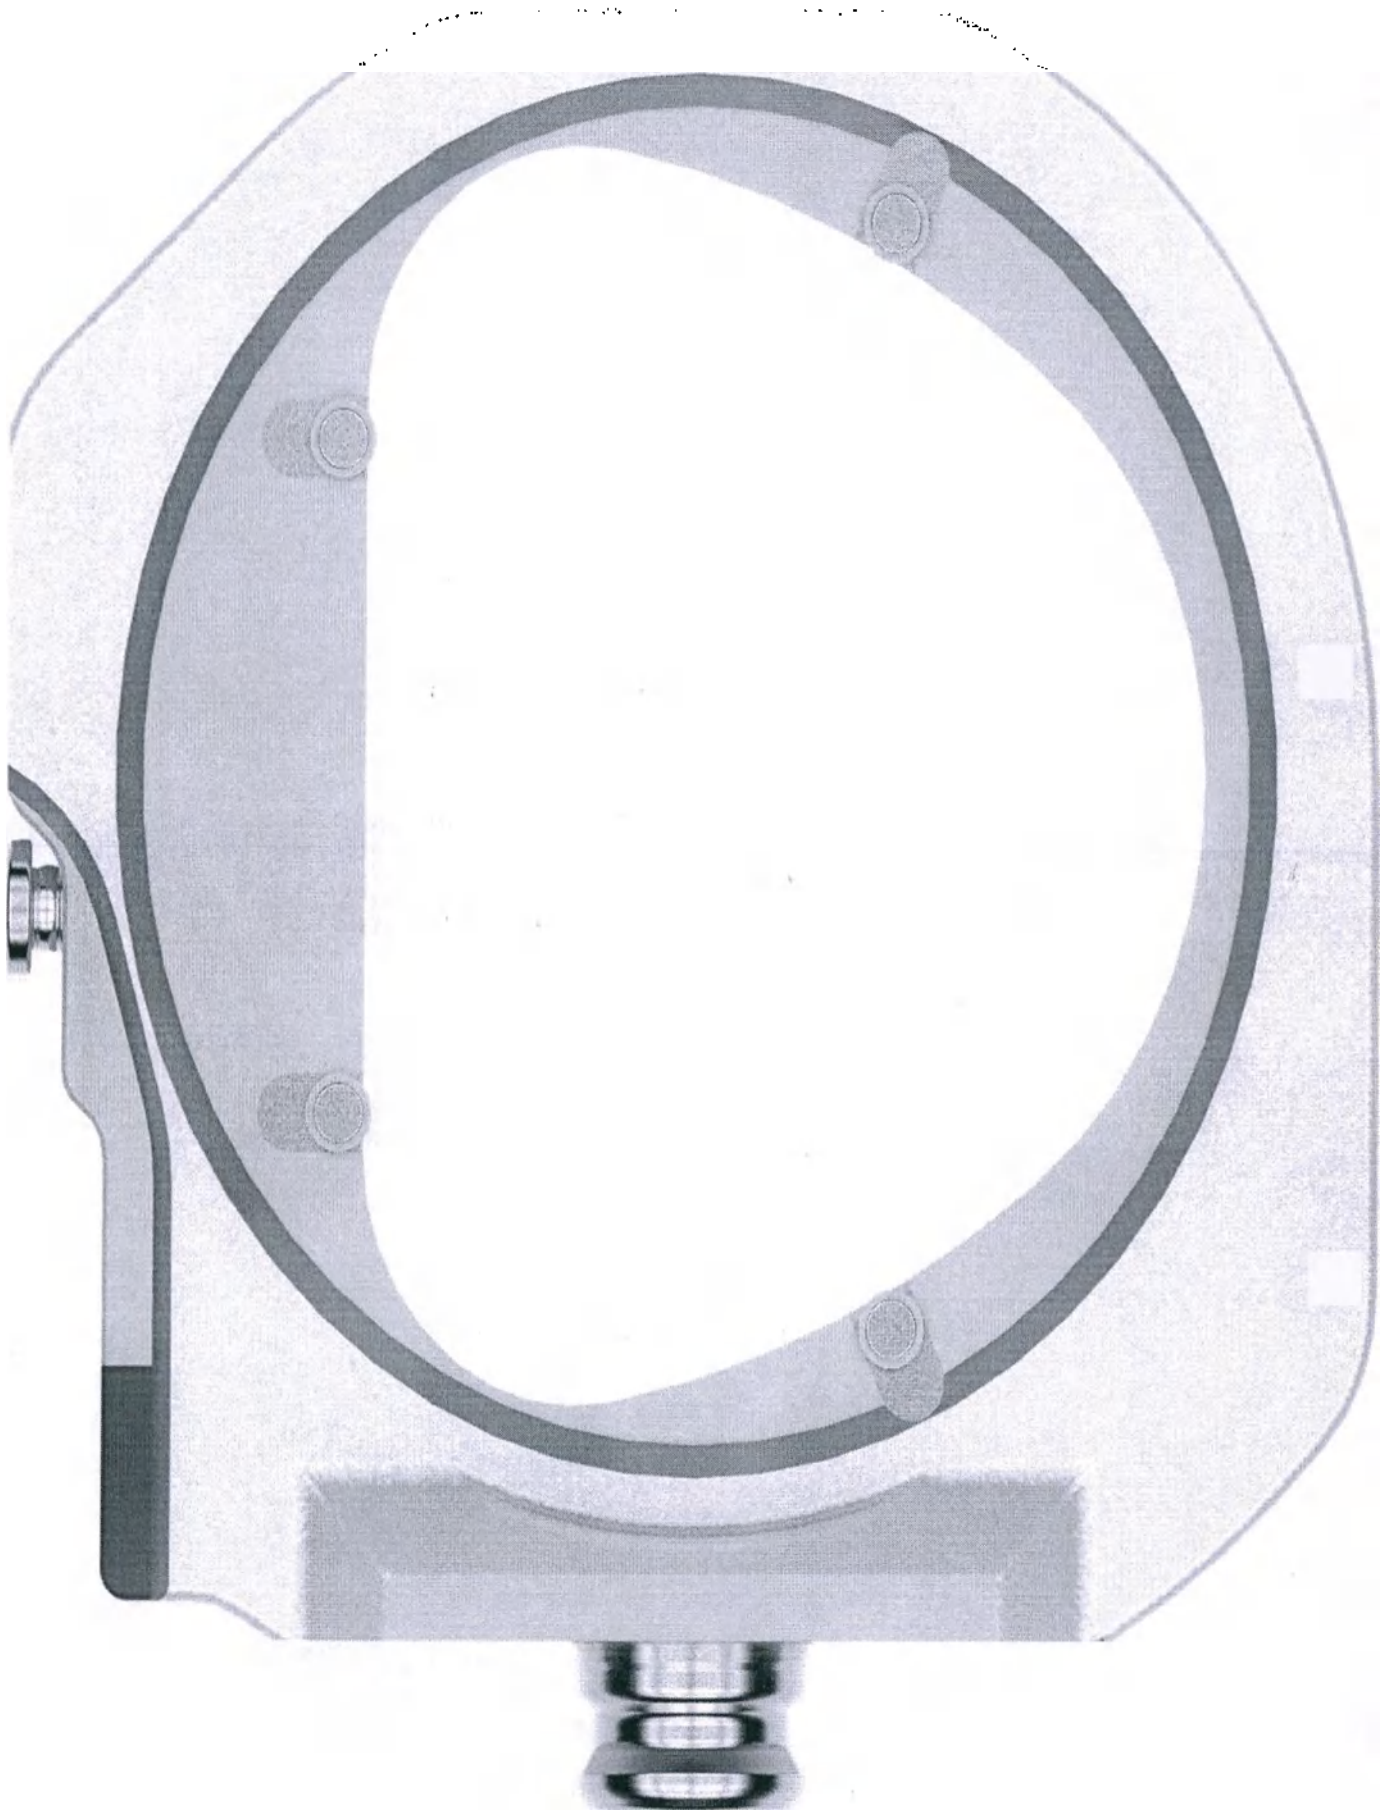


Держателей заготовок XL 181215

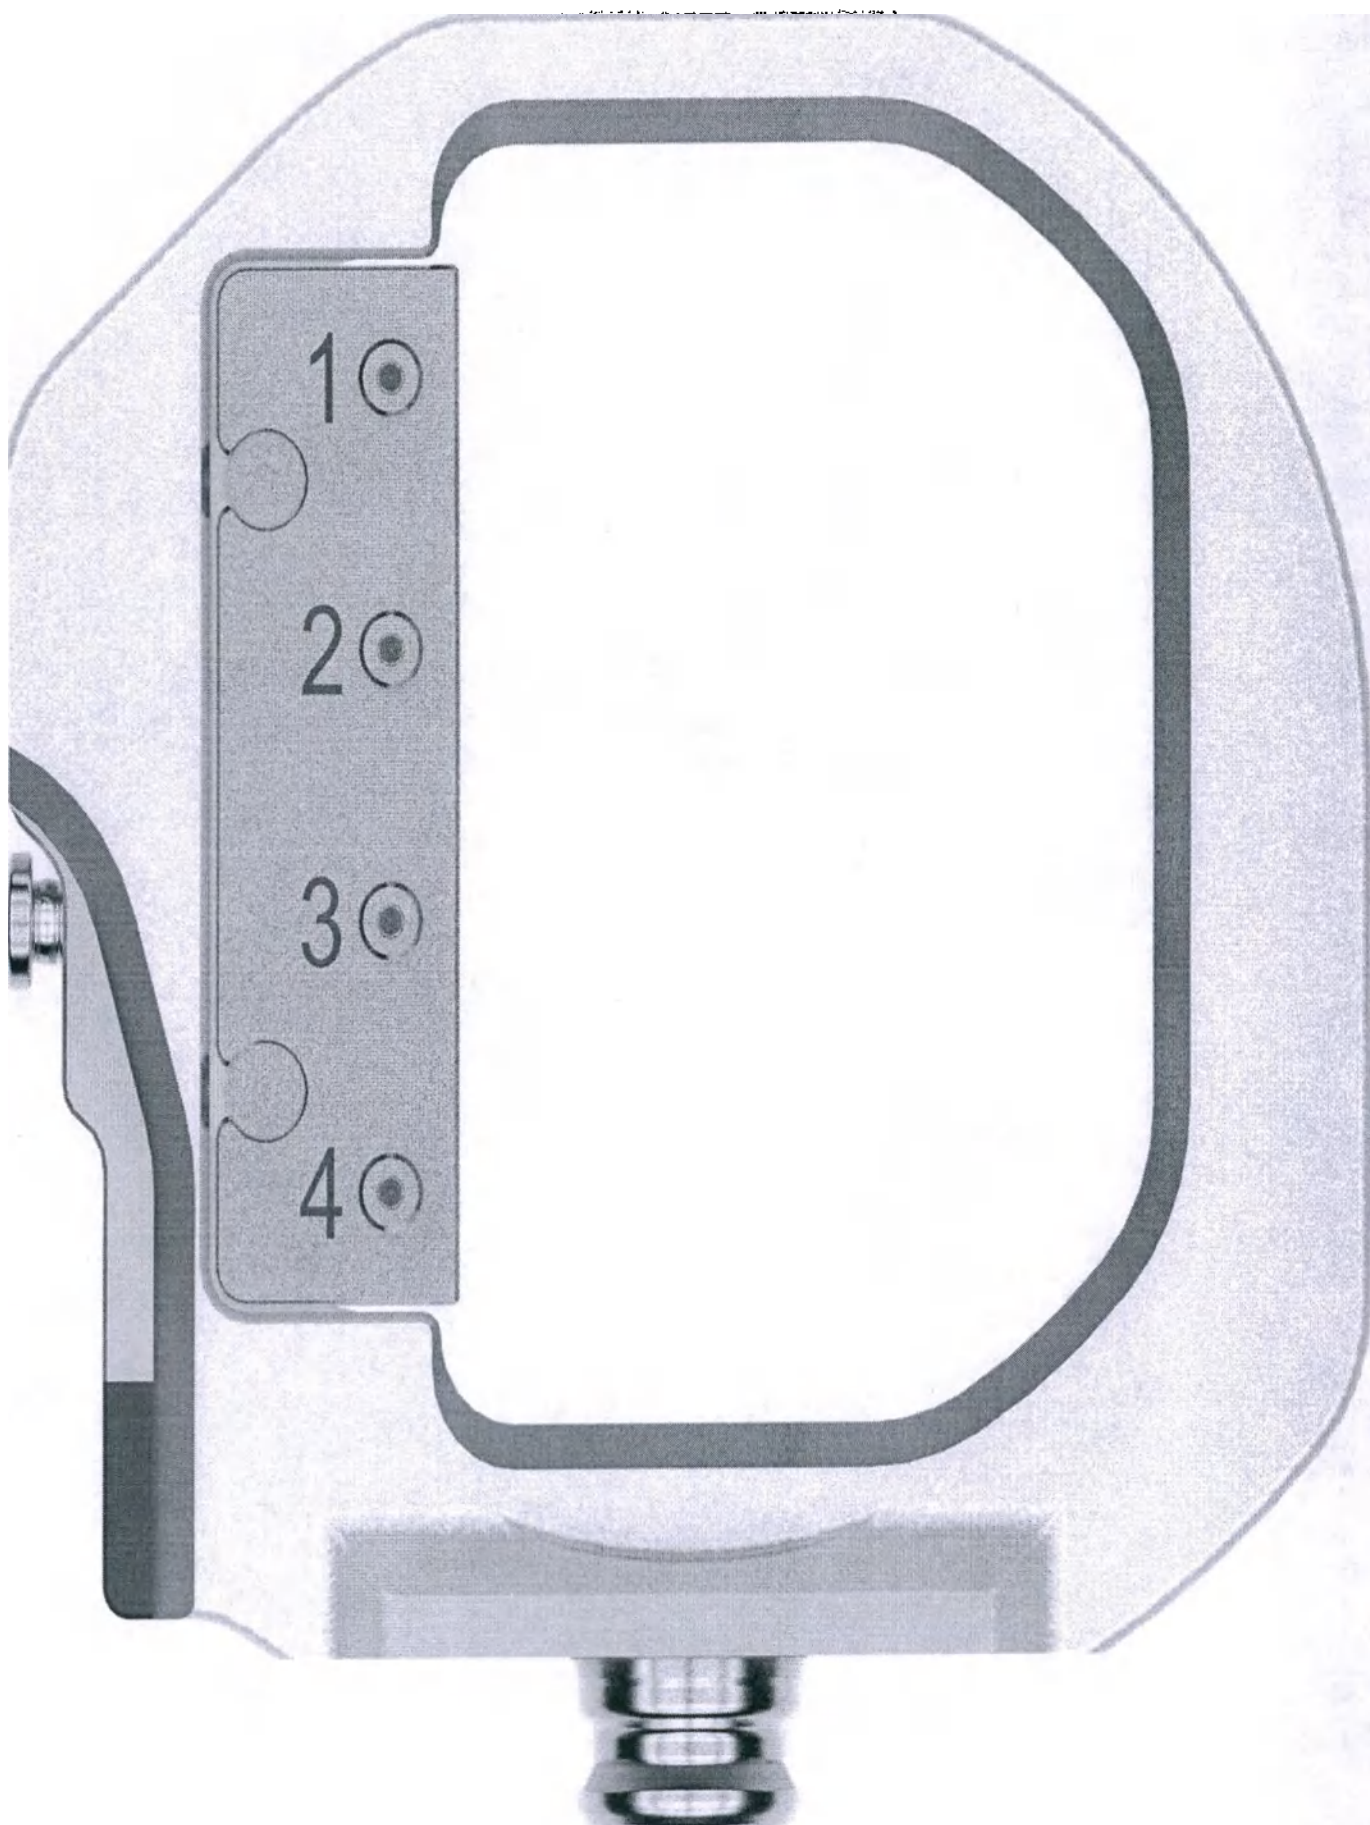

Держателей заготовок Блоки AG 181212

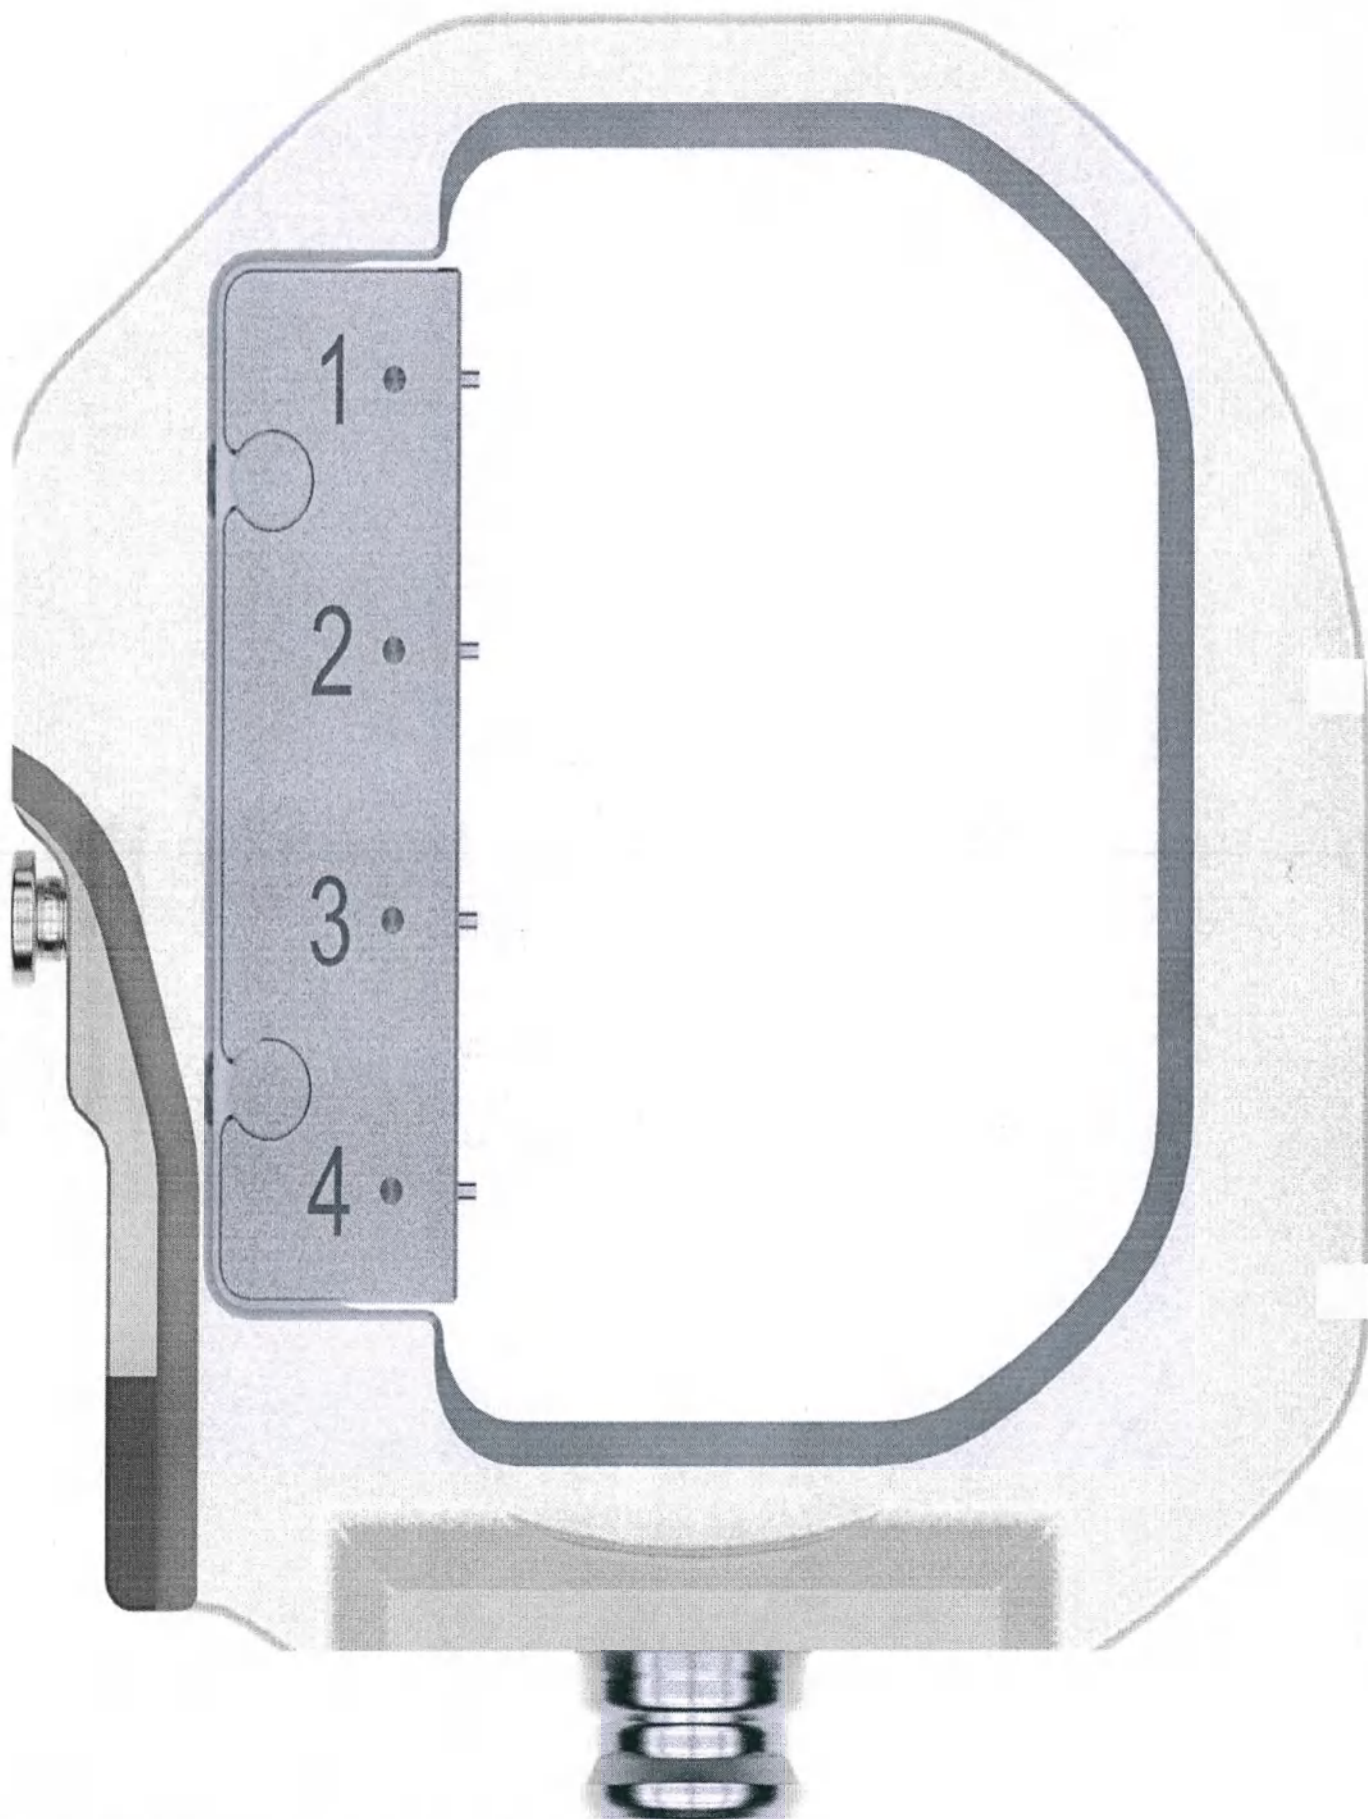

Держателей заготовок Блоки UN 181213

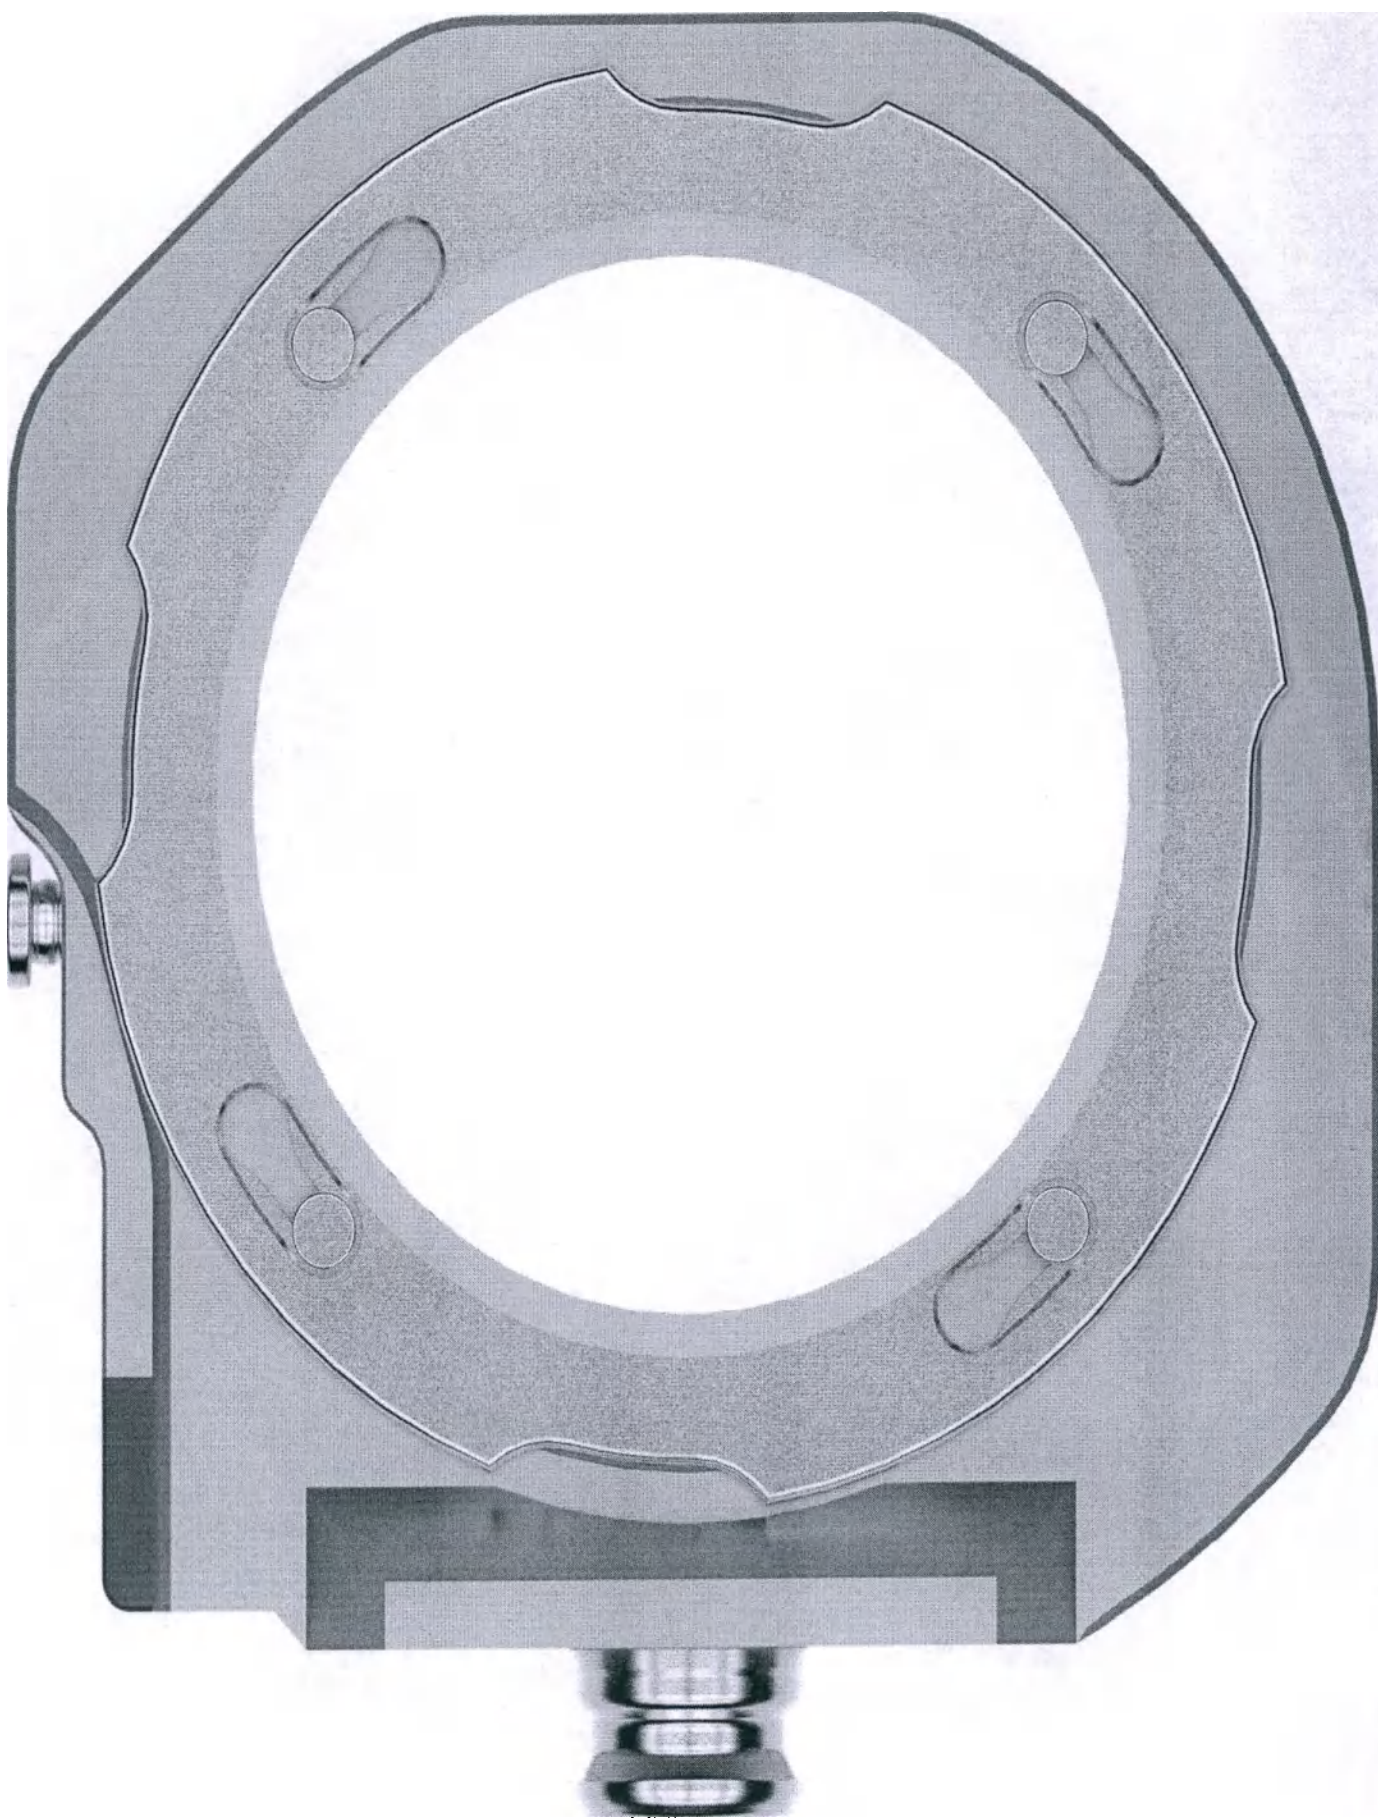

Держателей заготовок Металл 181218



Фреза Roto RFID 2,5 ZI



Фреза Roto RFID 1,0 ZI



Фреза Roto RFID 0,6 ZI



Фреза Roto RFID 0,3 ZI



Фреза Roto RFID 2,5 Sintron



Фреза Roto RFID 1,0 Sintron



Фреза Roto RFID 0,6 Sintron



Фреза Roto RFID 0,3 Sintron



Фреза Roto RFID 2,5 PMMA



Фреза Roto RFID 1,0 PMMA



Фреза Roto RFID 0,6 PMMA




Фреза Roto RFID 2,0 Ti




Фреза Roto RFID 1,0 Ti



Фреза Diamond RFID 1,8

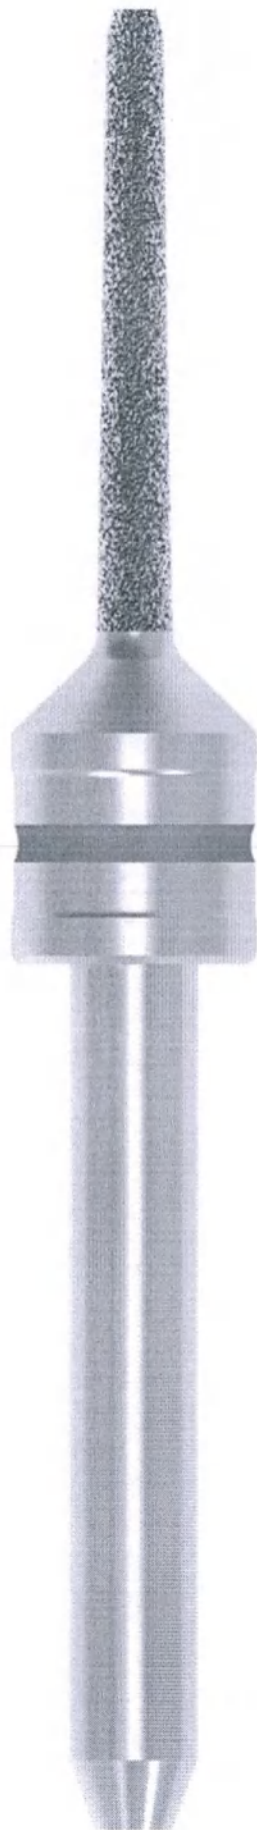

Фреза Diamond RFID 1,4

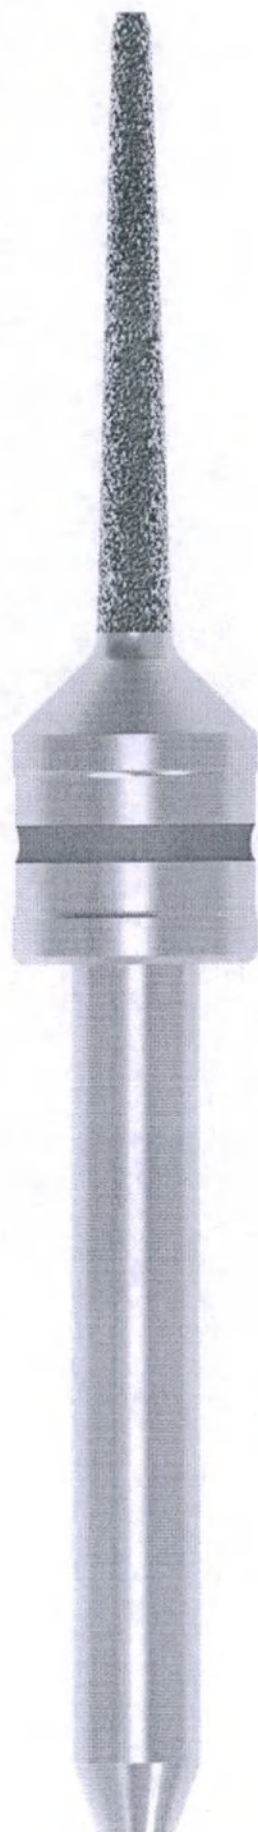

Фреза Diamond RFID 1,0



Фреза Diamond RFID 0,4



Фреза Roto RFID 2,5 SC



Фреза Roto RFID 1,0 SC



Фреза Roto RFID 0,6 SC



Фреза Roto RFID 0,3 SC



Фреза Roto RFID 2,5 COCR



Фреза Roto RFID 1,5 COCR



Фреза Roto RFID 1,0 COCR




Фреза Roto RFID 1,2 ST



Фреза Roto RFID 1,0 Wax Denture




Фреза Roto RFID 3,0 Wax Denture

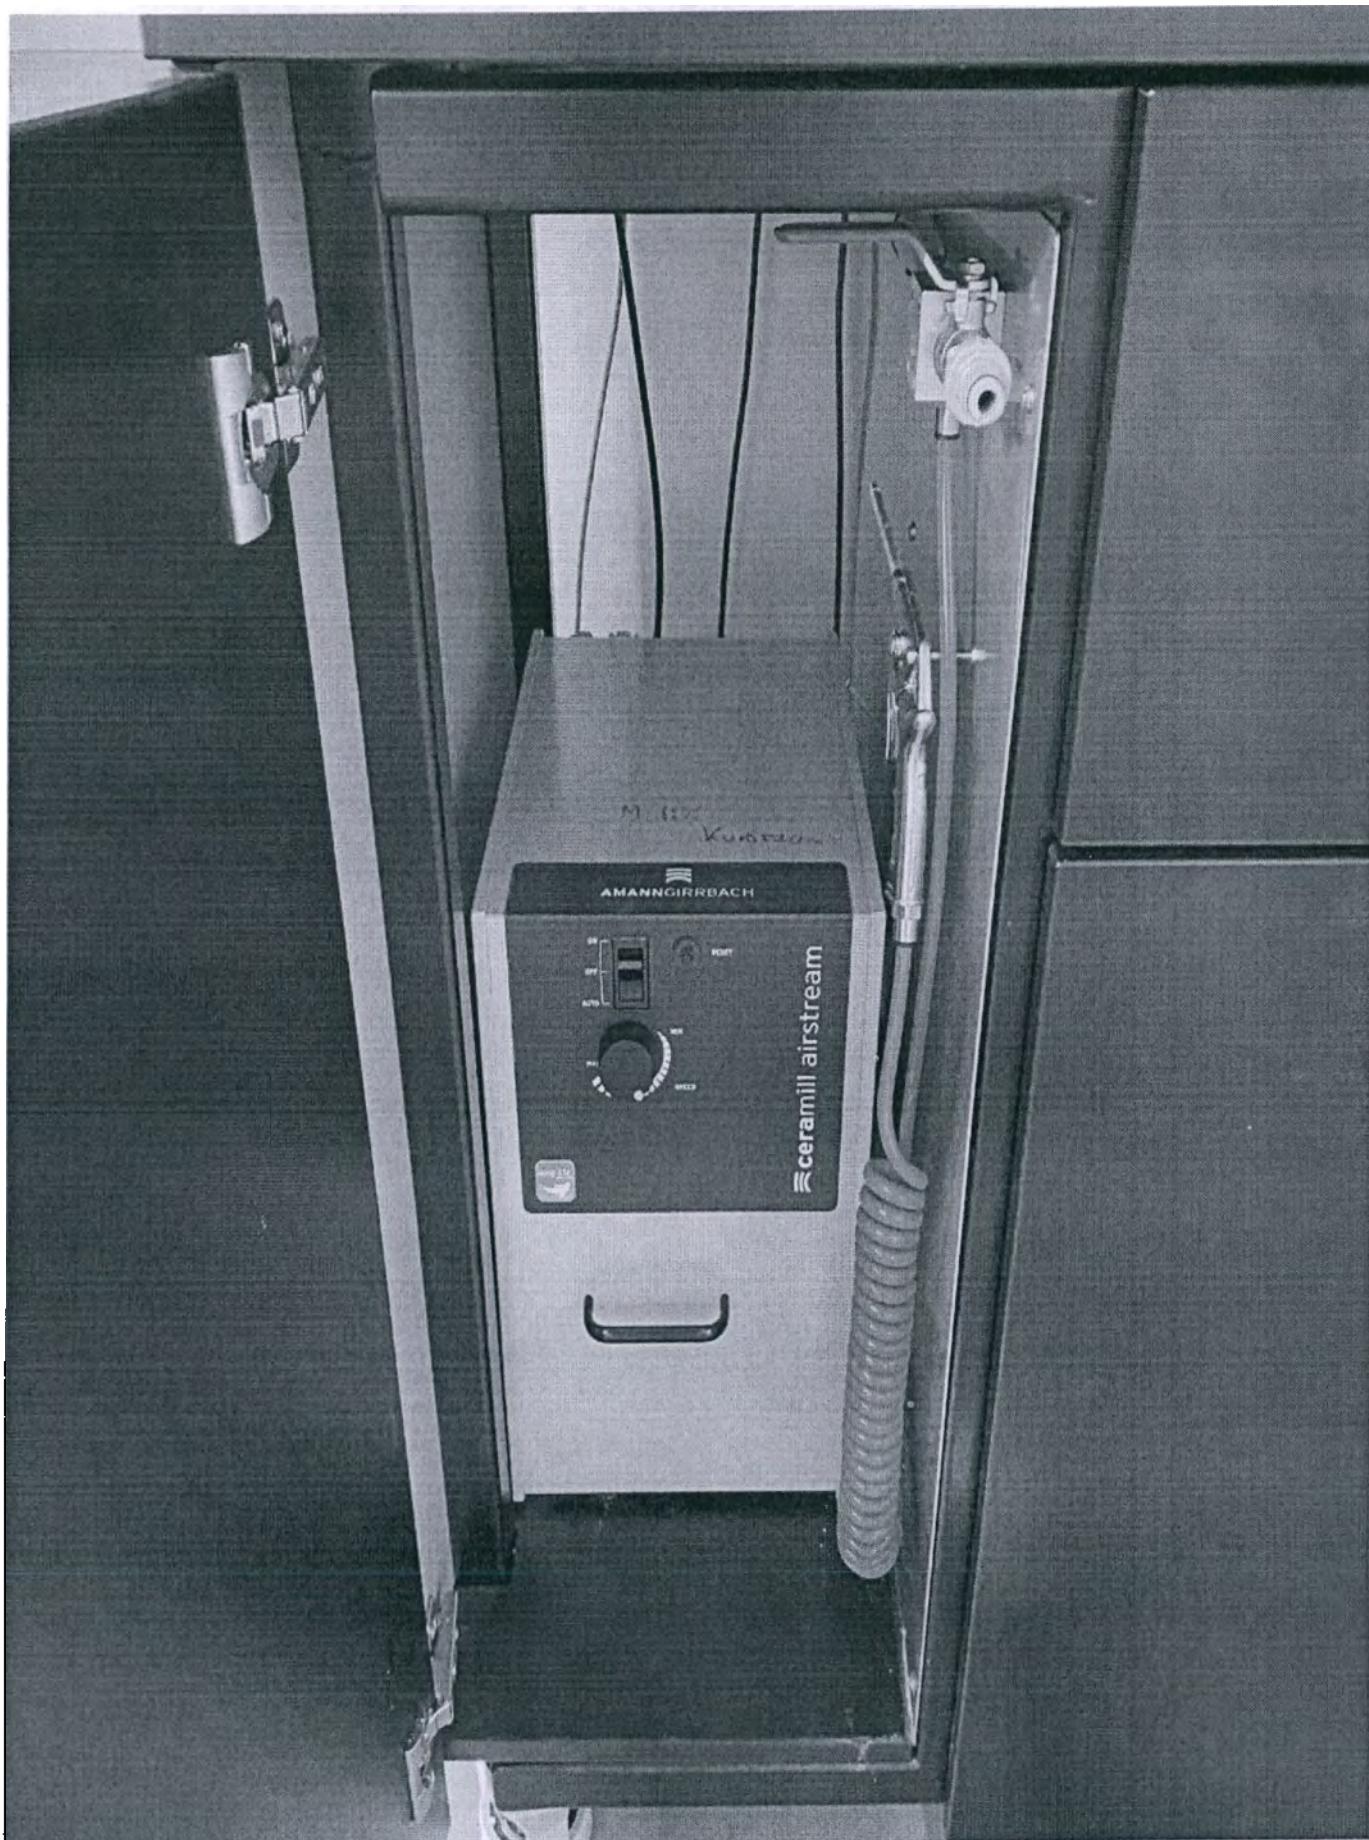

Вытяжка Ceramill Airstream. Вид спереди



Вытяжка Ceramil Airstream. Вид сзади

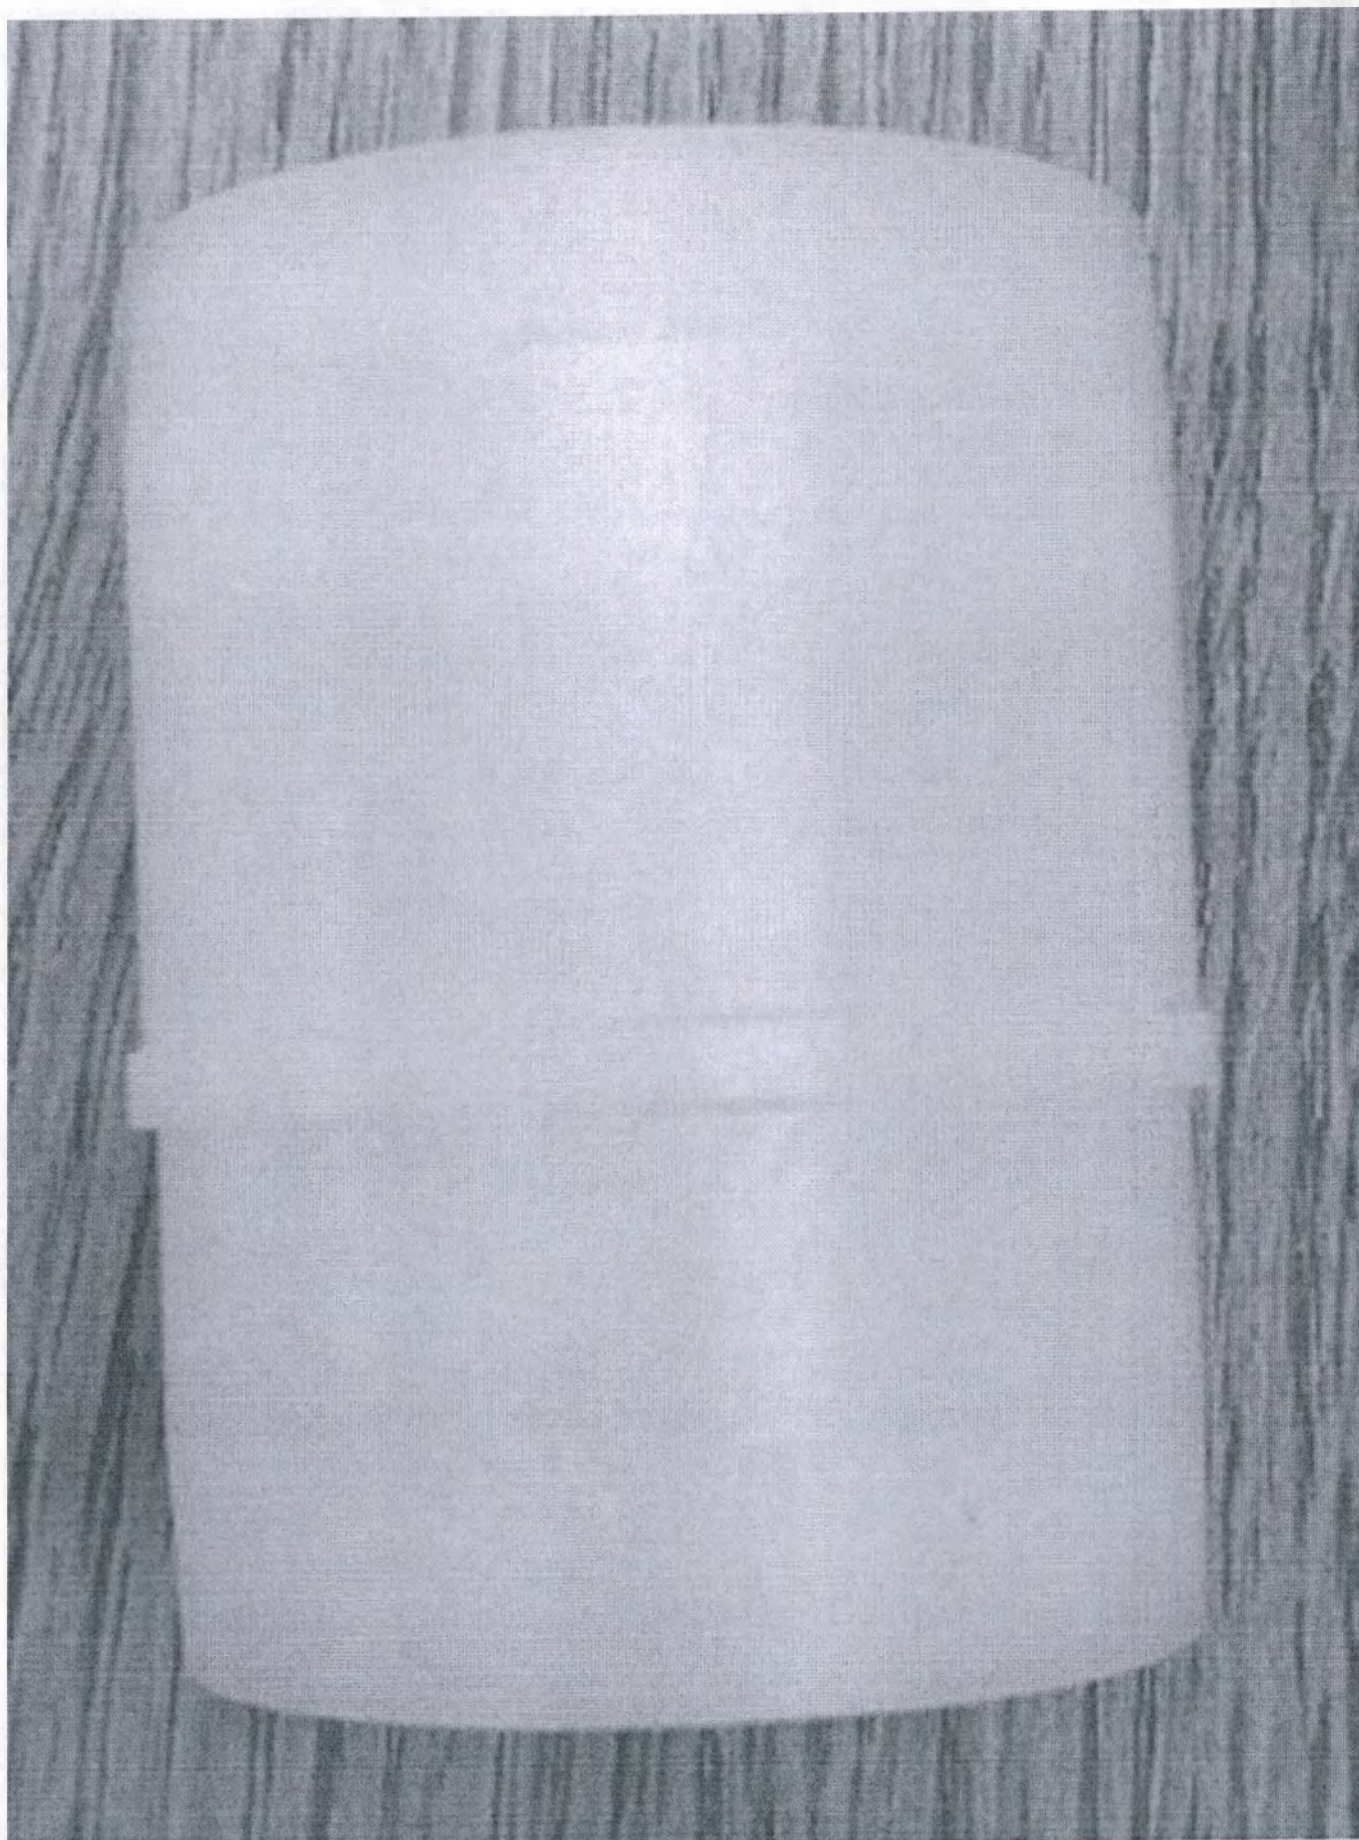


Переходник




Фильтрующие мешки

Микрофильм

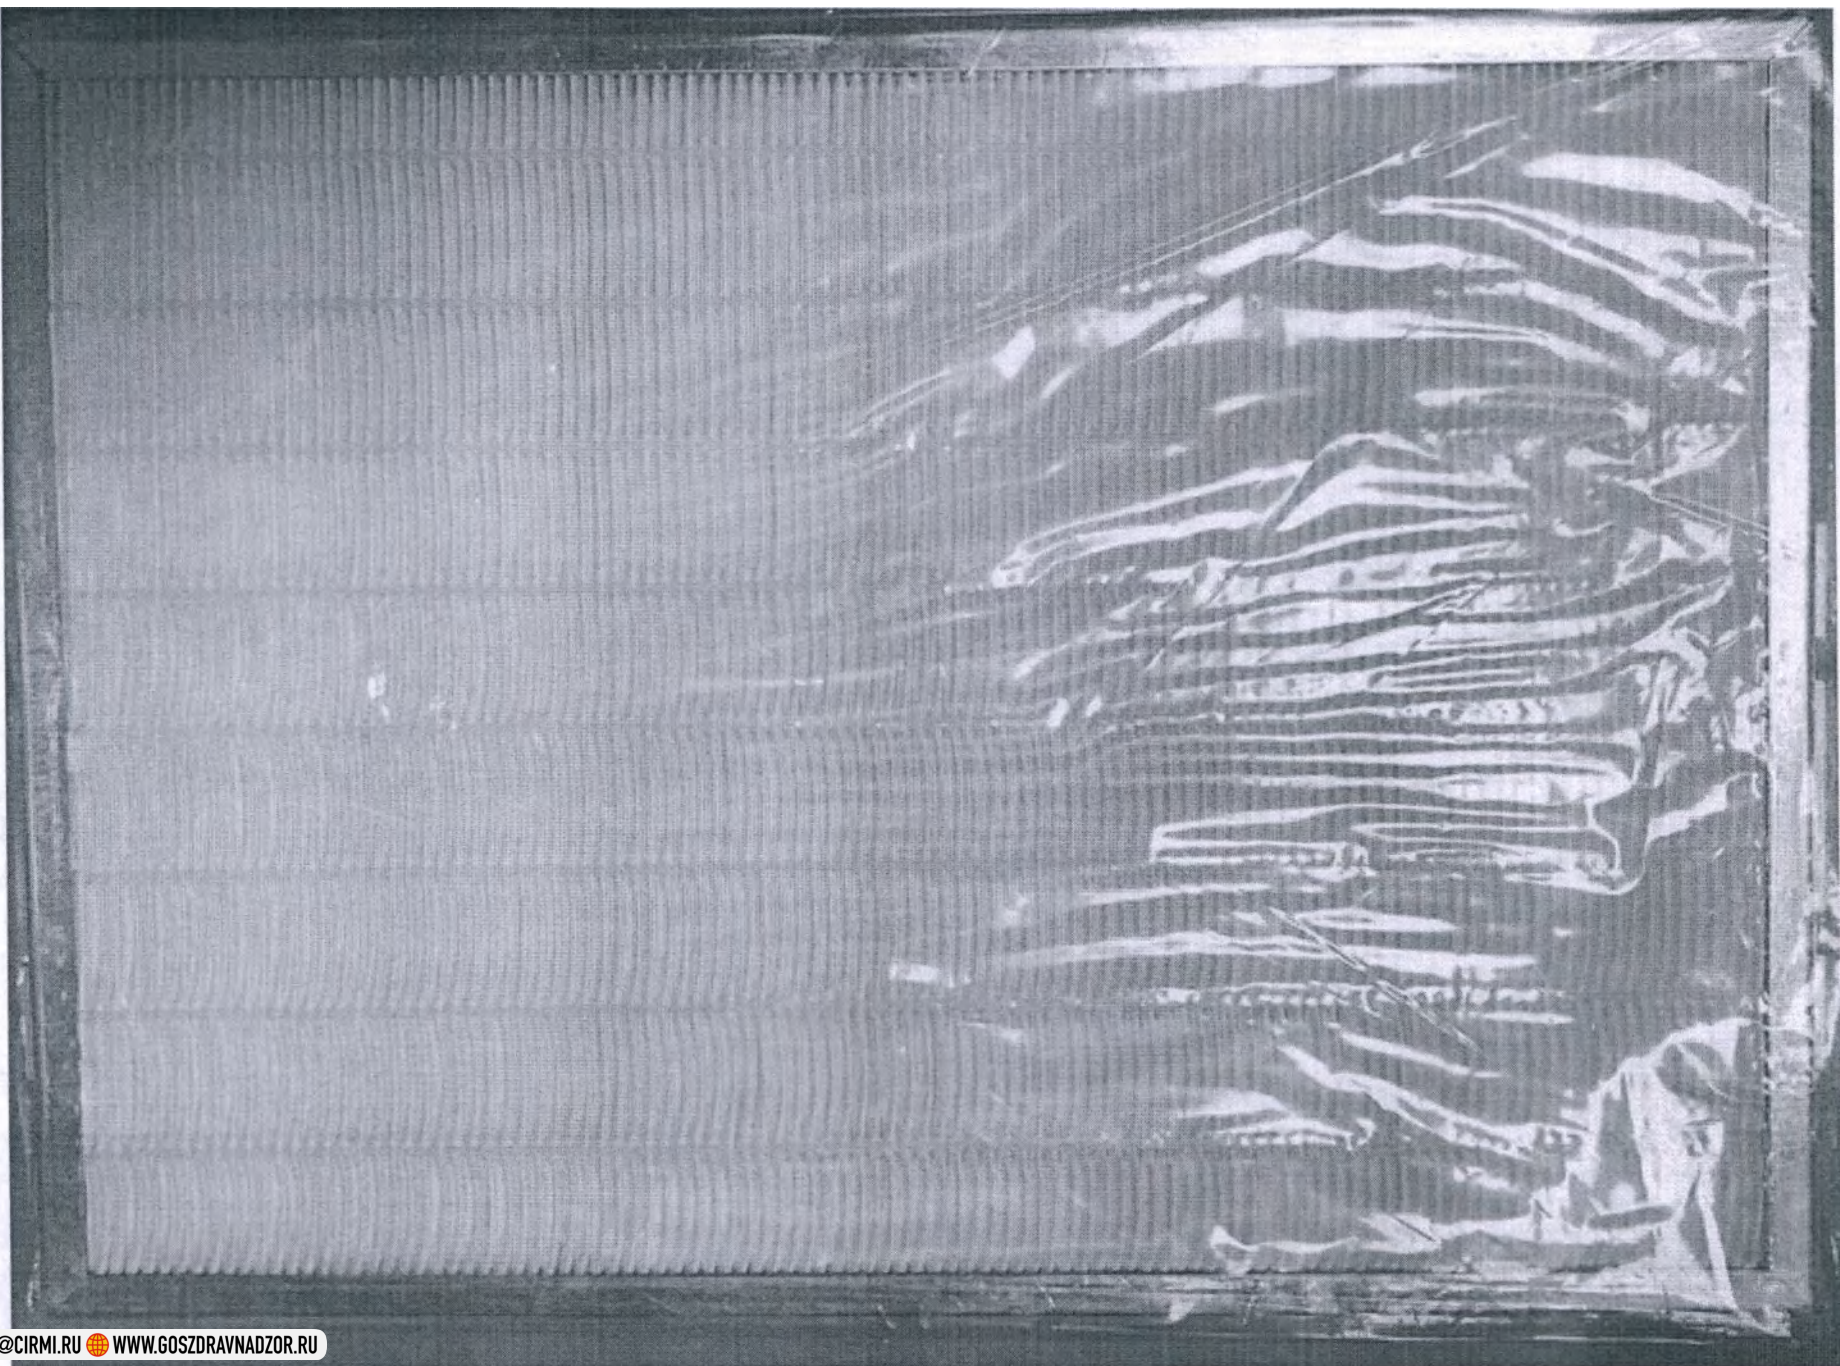





Шланг отвода воздуха

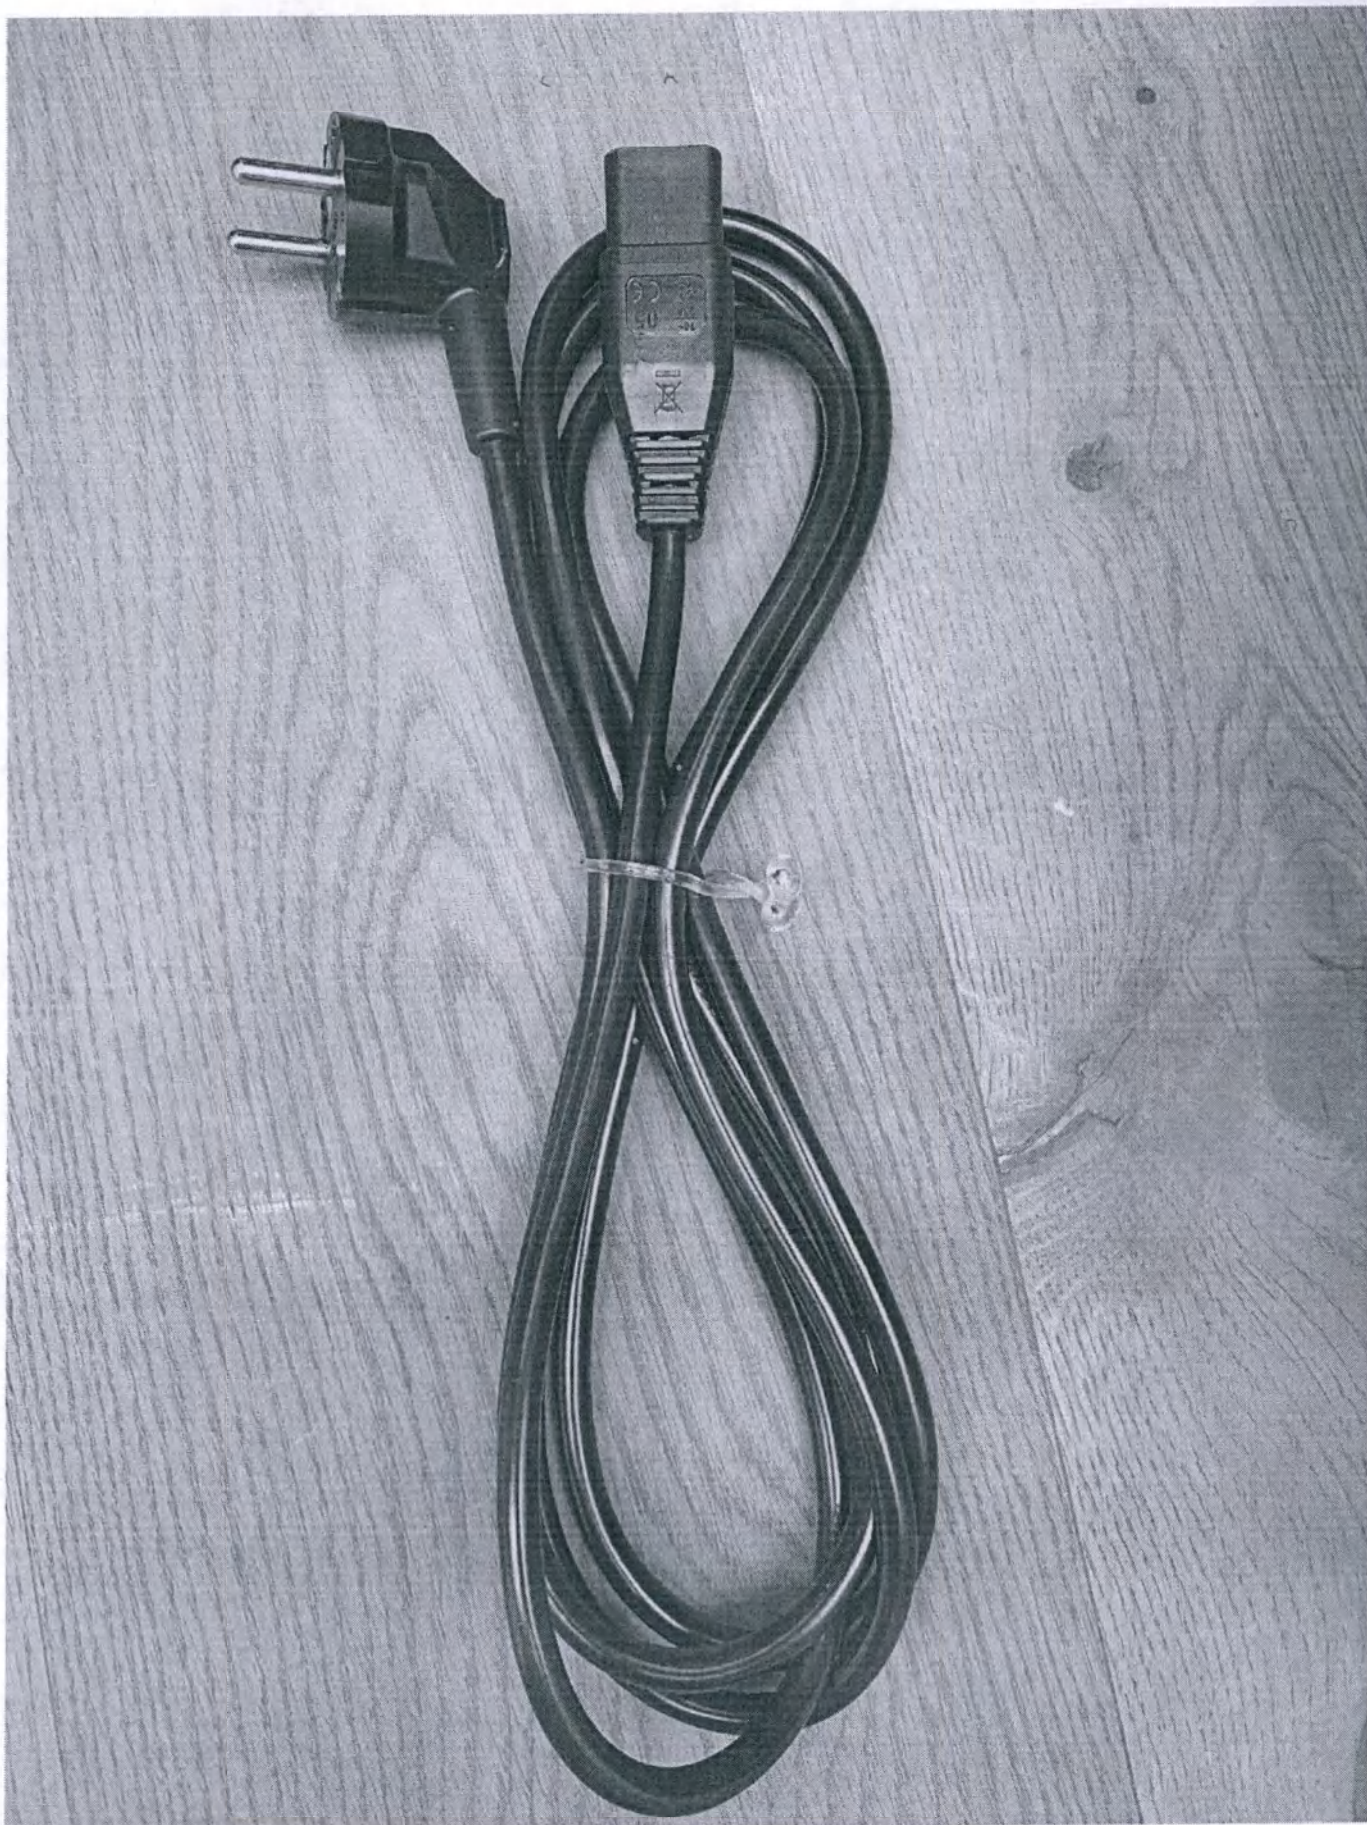

Кабель питания

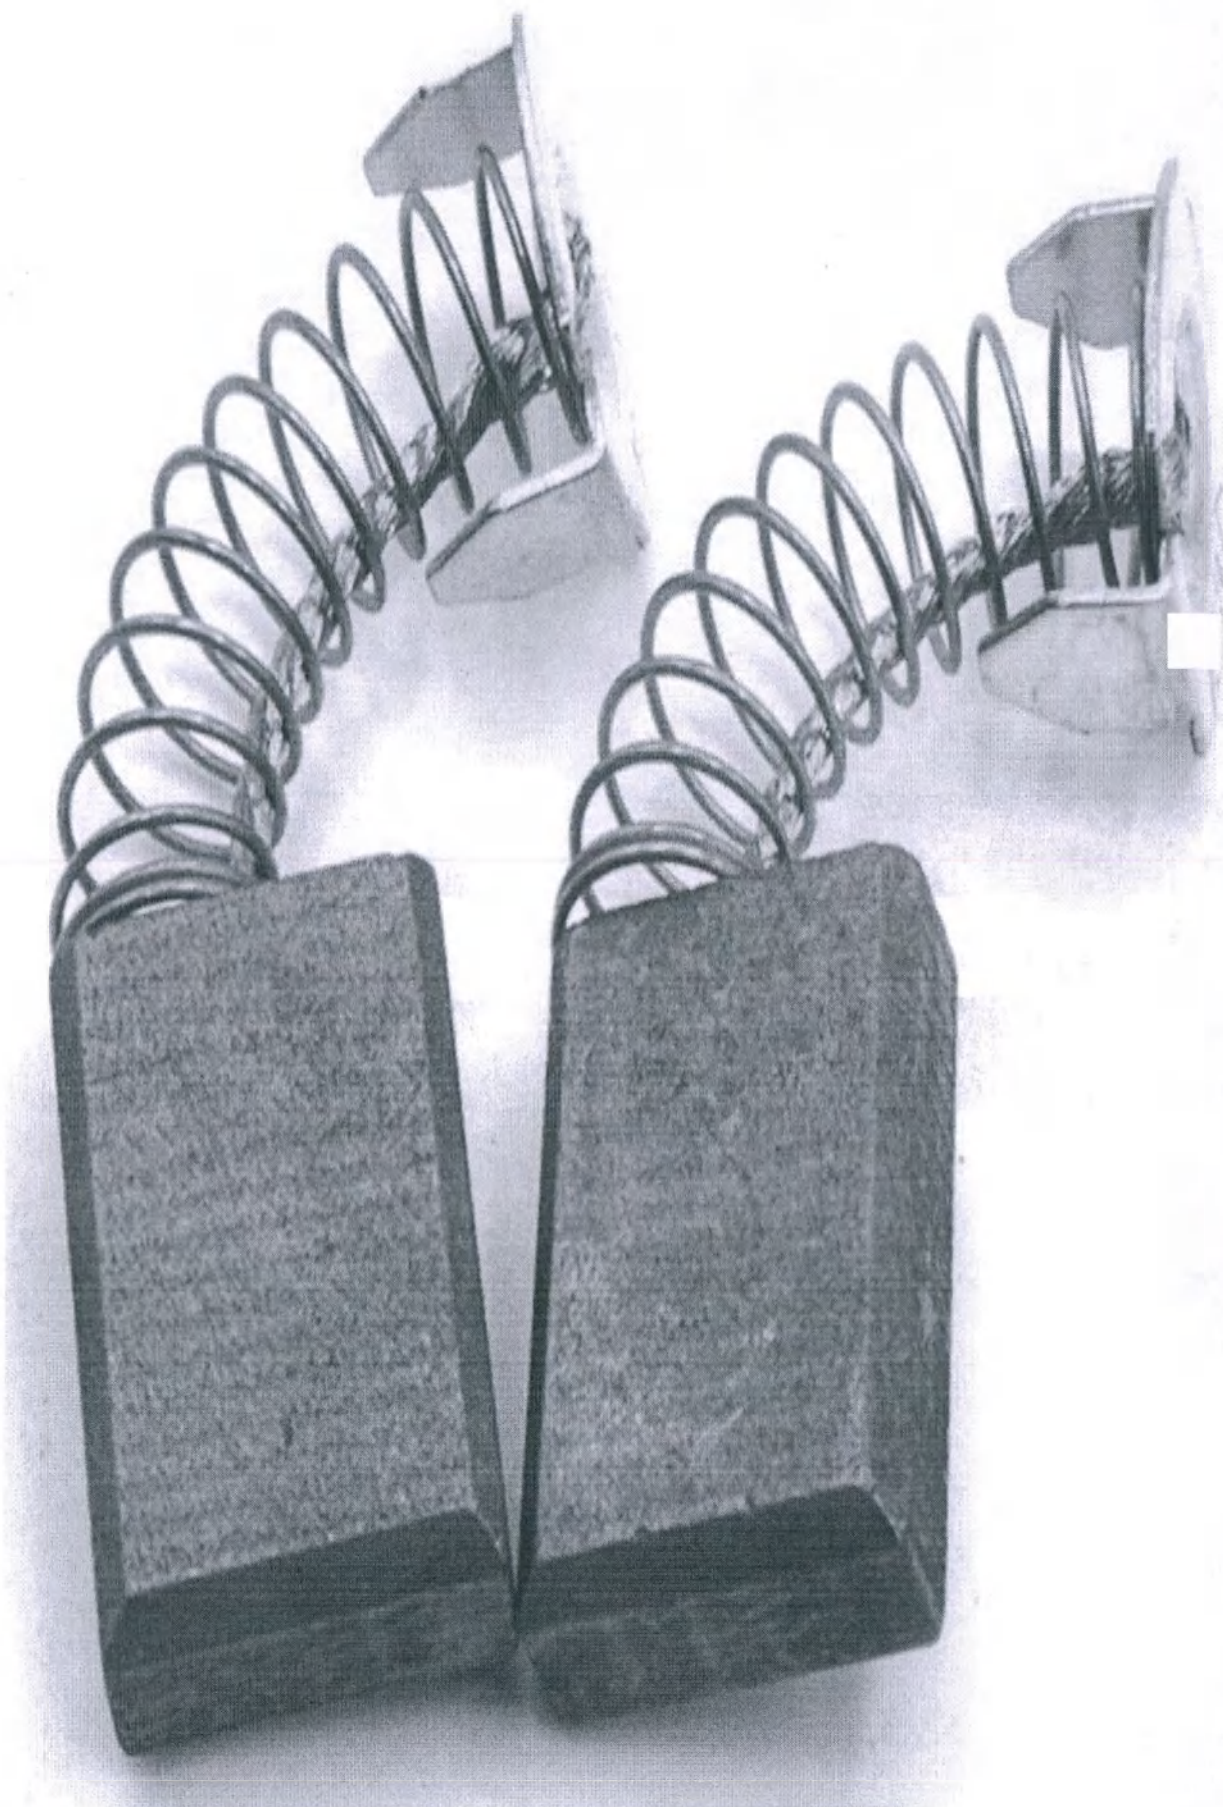

Сменные угольные щетки

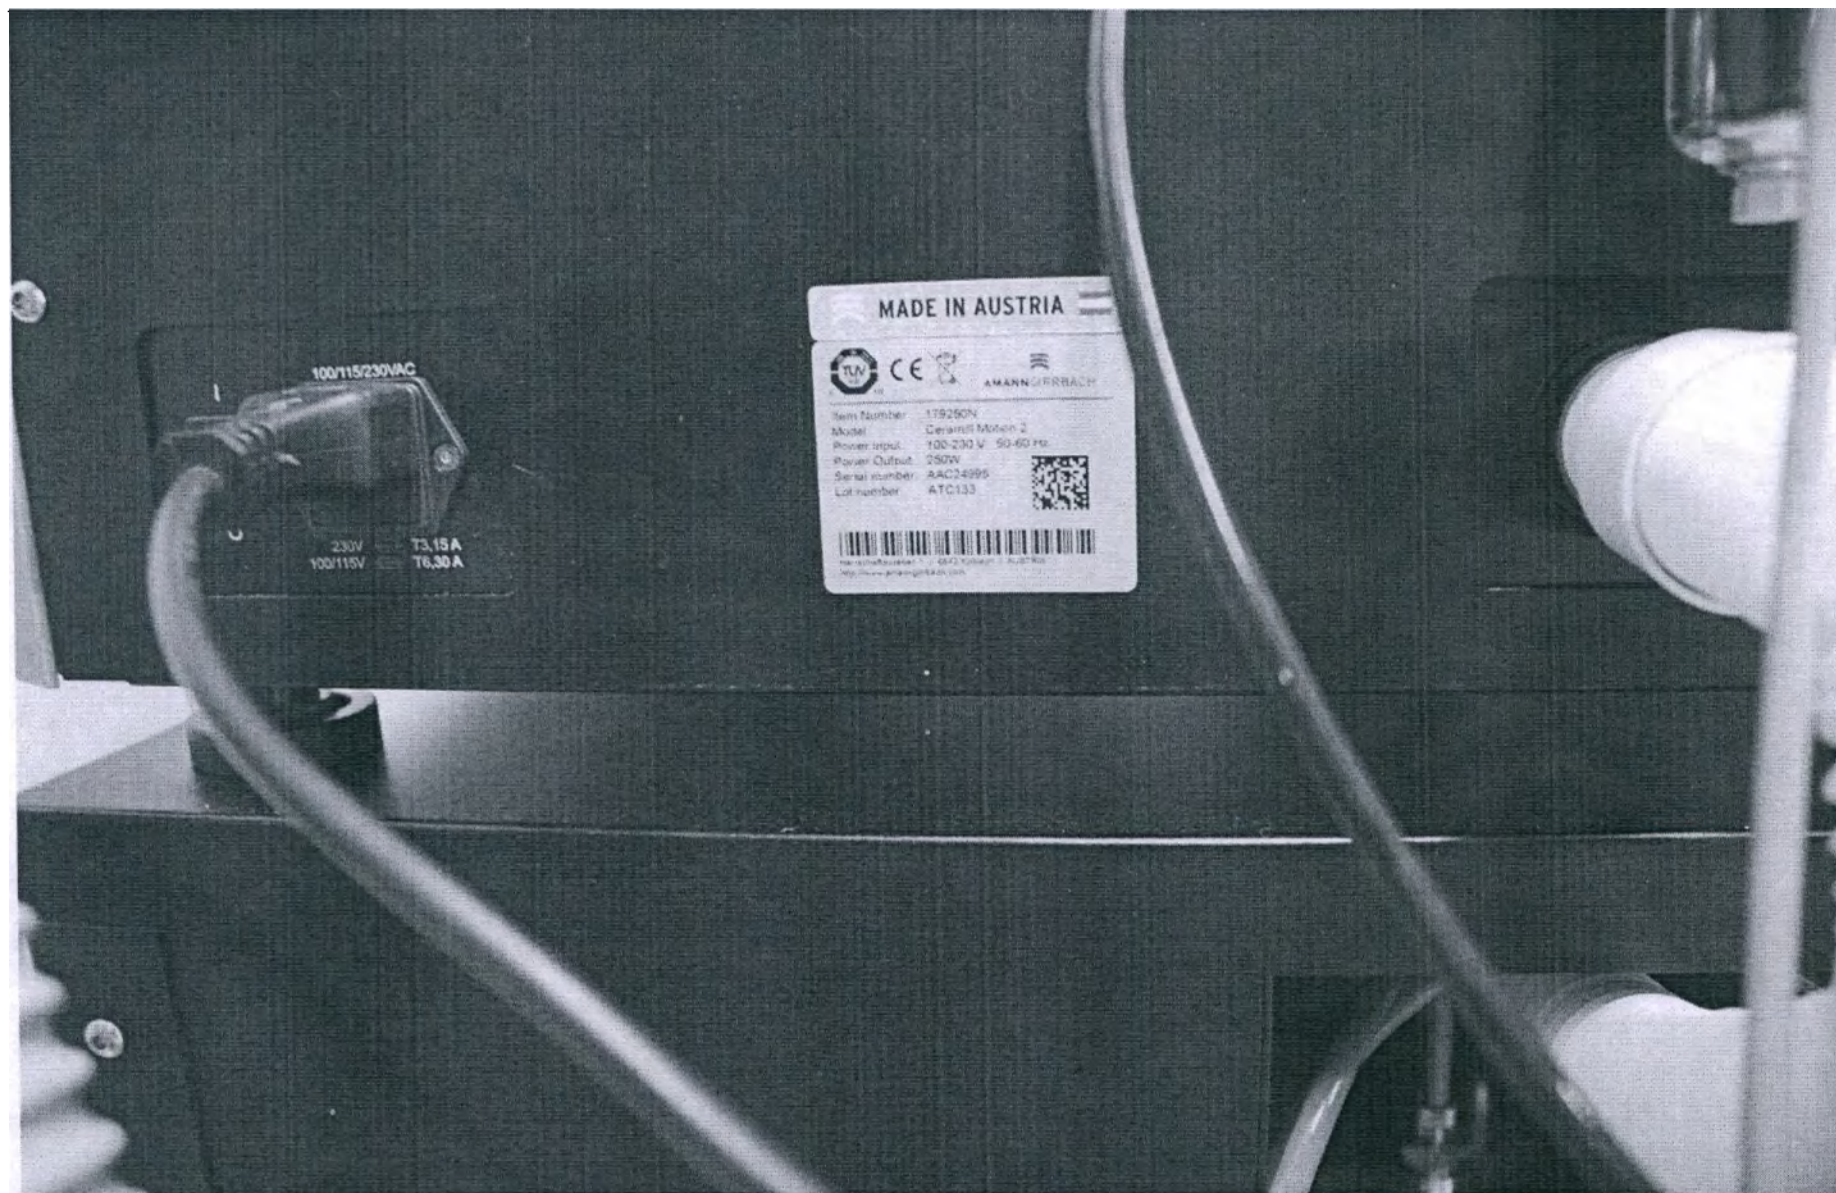

Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation, с принадлежностями. Заводская табличка



Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Matik, с принадлежностями. Заводская табличка



Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости с интегрированной системой удаления стружки Ceramill Cleanstream. Заводская табличка

**Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций
Ceramill, с принадлежностями**

Вариант исполнения: Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation, с принадлежностями

Производитель: Amann Girrbach AG/ Аманн Гиррбах АГ

Адрес производителя: Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, Austria/ Австрия

Тел.: +43 5523 62333-0

E-mail: austria@amanngirrbach.com

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «КС-Проф»

Адрес уполномоченного представителя в РФ: 440004, Пензенская область, город Пенза, улица Центральная, стр. 1в, корпус 6, комната 204

Тел.: 8 (800) 250-03-48

E-mail: info@kc-prof.ru

Номер регистрационного удостоверения: _____

Класс защиты от поражения электрическим током: I IPx0

Напряжение сети: 220 - 230 В

Частота: от 50 до 60 Гц



Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation, с принадлежностями.
Русскоязычная маркировка

Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций
Ceramill, с принадлежностями

Вариант исполнения: Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Matik, с принадлежностями

Производитель: Amann Girrbach AG/ Аманн Гиррбах АГ

Адрес производителя: Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, Austria/ Австрия

Тел.: +43 5523 62333-0

E-mail: austria@amanngirrbach.com

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «КС-Проф»

Адрес уполномоченного представителя в РФ: 440004, Пензенская область, город Пенза, улица Центральная, стр. 1в, корпус 6, комната 204

Тел.: 8 (800) 250-03-48

E-mail: info@kc-prof.ru

Номер регистрационного удостоверения: _____

Класс защиты от поражения электрическим током: I IPx0

Напряжение сети: 220 - 230 В

Частота: от 50 до 60 Гц



Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Matik, с принадлежностями. Русскоязычная маркировка

**Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости с интегрированной системой
удаления стружки Ceramill Cleanstream**

Производитель: Amann Girrbach AG/ Аманн Гиррбах АГ

Адрес производителя: Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, Austria/ Австрия

Тел.: +43 5523 62333-0

E-mail: austria@amanngirrbach.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «КС-Проф»

Адрес уполномоченного представителя производителя в РФ: 440004, Пензенская область, город Пенза, улица Центральная, стр. 1в, корпус 6, комната 204


Тел.: 8 (800) 250-03-48

E-mail: info@kc-prof.ru

Класс защиты от поражения электрическим током: I IPx0

Напряжение сети: 220 - 230 В


Частота: от 50 до 60 Гц



Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости с интегрированной системой удаления стружки Ceramill Cleanstream. Русскоязычная маркировка



**Аппарат для изготовления стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Motion 2 DNA Generation, с принадлежностями.
Упаковка**

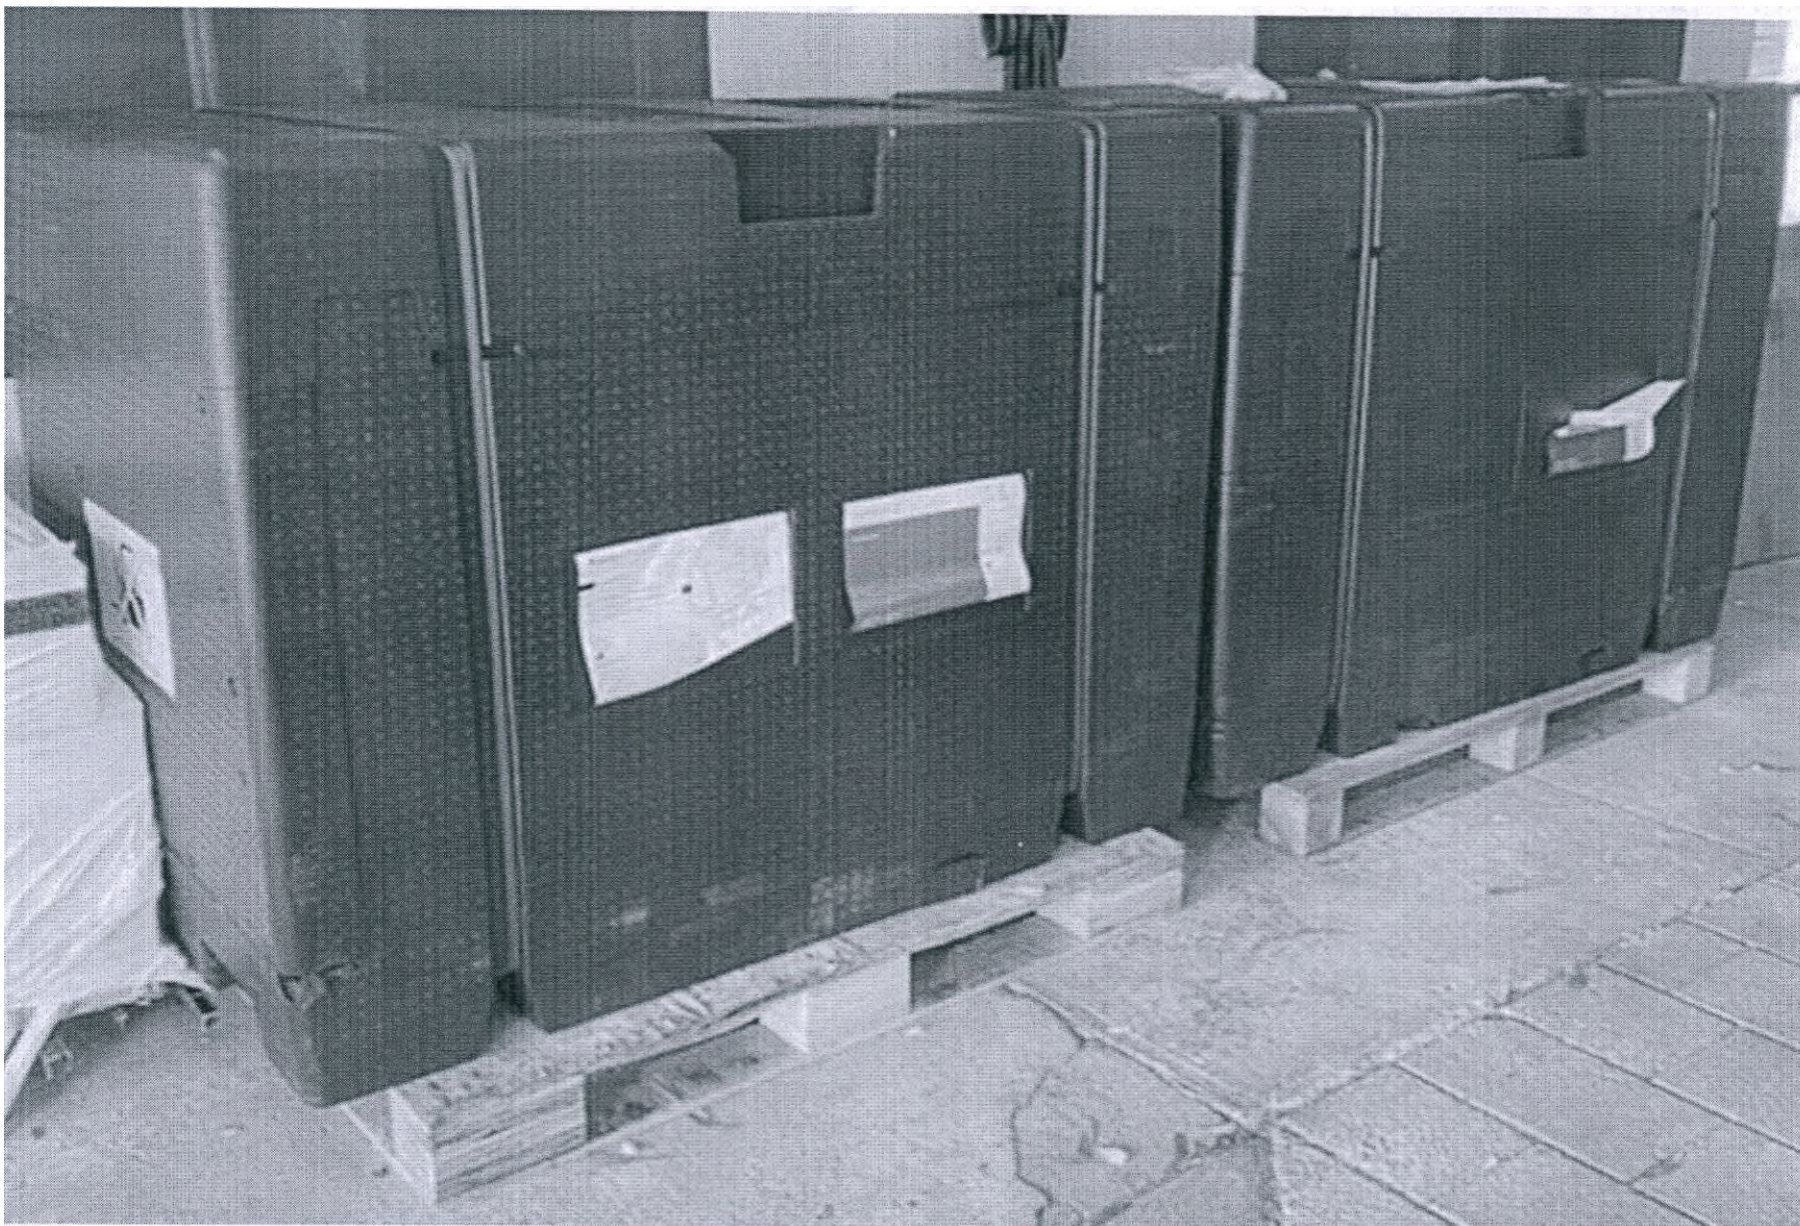

Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций Ceramill Matik, с принадлежностями. Упаковка.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

97 (девятью семь) листов
цифрами прописью

Должность генеральный директор ООО
Подпись [подпись] Артёмов И. В.
« 17 » мая 20 22 г. М. П.

