بسم اللہ الرحمن الرحیم

APOSTILLE

1. Country: Islamic Republic of Pakistan
   This public Document
2. has been signed by Zaheer Haider Awan
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC GOVT OF PAKISTAN.
4. Bears the seal/stamp of ZAHEER HAIDER AWAN (ADVOCATE HIGH COURT)
   NOTARY PUBLIC
   SIALKOT PAKISTAN

CERTIFIED

5. at SIALKOT PAKISTAN
6. the 10 December 2021
7. by ADVOCATE HIGH COURT NOTARY PUBLIC OF PAKISTAN
8. No. C.C. 6845
9. Seal/Stamp:

Notarized to Take effect in All Continents out of Pakistan Under Int. Law

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

SURGIWELL

NEAR POLY TECHNICAL

STAFF COLONY DEFENCE

ROAD SIALKOT

100 / 4951

06 - 12 - 2021

شمس علی فروش

HC-74 لائسنس نمبر

0301-6236349 موبائل

APPOSTILLE

(نمبر شناختی کارڈ نمبر

34603-9326618-1)

شمس علی

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

SURGIWELL (PVT) LTD

(СУРДЖИВЕЛЛ (ПВТ) ЛТД)

SURGIWELL
SURGICAL INSTRUMENTS
Defence Road, 51310 - Sialkot Pakistan

_____Мухаммад Аднан Юсаф

/Muhammad Adnan Yousaf/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:

ЗАЖИМЫ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование медицинского изделия:
Инструменты медицинские хирургические в вариантах исполнения: Зажимы.
(Варианты исполнения представлены в Таблице 1.)

Производитель:
SURGIWELL (PVT) LTD
СУРДЖИВЕЛЛ (ПВТ) ЛТД
Pakistan, 51310, Sialkot , Near Polytech Staff Coloney, Defence Road.
Пакистан, 51310, Сиалкот, Ниар Политех Стафф Колони, Дефенс Роуд.

Уполномоченный представитель в России:
ООО МК «Мед-Континент», 603074, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 23, пом. П1.
Телефон/факс: (831) 275-15-17
E-mail: info@med-continent.ru

Описание, назначение, функциональные характеристики:
Инструменты медицинские хирургические многоразового применения 1 класса риска.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией – 296720.

Хирургический инструмент общего назначения для прямого пережимания кровеносного сосуда в целях приостановки или предупреждения кровотечения. Обычно представляет собой ножничные щипцы с самофиксатором и ручками с кольцами под пальцы; губы зажима могут иметь различную конфигурацию (например, изогнутую по дуге или под углом, полукруглую и т. п.), в зависимости от области применения. Выпускаются модели различных типоразмеров. Изготавливаются обычно из высокосортной нержавеющей стали.

Технические характеристики:
Материал изготовления, сталь марки: 1.4021- X 20 Cr 13.

Инструменты медицинские хирургические в вариантах исполнения: Зажимы соответствуют требованиям ГОСТ 19126, ГОСТ ISO 13402, ГОСТ 21238, ГОСТ Р 53519.

Виды климатического исполнения – УХЛ4.2 и О4.2 по ГОСТ 15150.

Таблица 1.

№ №	Артикул	Наименование	Масса не более (г)	Усилие свободного хода (Н)	Усилие при зацеплении за 1-й зуб	Усилие при зацеплении за последний зуб
1	14-0684-28R	Зажим - Диссектор	100	2 Н	-	-
2	14-0671-28R	Зажим - Диссектор	100			
3	14-0739R	Зажим	110	2 Н	6-15Н (0,6-1,5кгс)	40Н (4кгс)
4	14-0739	Зажим	90			
5	14-0740	Зажим	120			
6	14-0740R	Зажим	120			
7	32-4670R	Зажим	90	2 Н	5Н (0,5 кгс)	20Н (2 кгс)
8	14-0510	Зажим	35	1 Н	10Н (1 кгс)	20Н (2 кгс)
9	14-0511R	Зажим	50			
10	14-0615R	Зажим	35			
11	14-0515	Зажим	35			
12	14-0516R	Зажим	50			
13	14-0519R2	Зажим	25			
14	14-0519R3	Зажим	30			
15	14-0519R	Зажим	35			
16	14-0519R4	Зажим	50			

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17	14-0519R5	Зажим	60	1 Н	10Н (1 кгс)	20Н (2 кгс)
18	14-0517R2	Зажим	60			
19	14-0517R1	Зажим	70			
20	14-0512R	Зажим	70			
21	14-0552R	Зажим	70	2 Н	6-15Н (0,6-1,5кгс)	40Н (4кгс)
22	14-0557R	Зажим	175			
23	14-0554R	Зажим	100			
24	14-0542	Зажим	60	2 Н	6-15Н (0,6-1,5кгс)	40Н (4кгс)
25	14-0544R	Зажим	90			
26	14-0660	Зажим	135			
27	14-0660R	Зажим	140			
28	14-0660R1	Зажим	150			
29	14-0660R2	Зажим	195			
30	14-0681R	Зажим	125	2 Н	6-15Н (0,6-1,5кгс)	40Н (4кгс)
31	14-0682R	Зажим	120			
32	14-0581R	Зажим	60			
33	14-0582	Зажим	70			
34	14-0584	Зажим	90			
35	14-0571R	Зажим	60			
36	14-0572	Зажим	70			
37	14-0574	Зажим	110			
38	14-0520R	Зажим	45			
39	14-0510R	Зажим	45			
40	14-0519-R	Зажим	50			
41	14-0519-R2	Зажим	60			
42	14-0509R	Зажим	35	2 Н	5Н (0,5 кгс)	8Н (0,8 кгс)
43	14-0508R	Зажим	25			

Инструменты медицинские хирургические не требуют установки, монтажа, настройки и иных действий для ввода в эксплуатацию.

Инструменты медицинские хирургические поставляются нестерильными.

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

Указания и инструкции по эксплуатации, повторной обработке, стерилизации и очистке:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Новые медицинские инструменты перед первым применением должны пройти все этапы обработки (дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация) аналогично инструментам бывшим в употреблении.
Ограничения при повторной обработке:	1.Внутренние части узлов изделий требуют особого внимания во время очистки. 2.Срок службы инструментов - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 3.Если медицинский инструмент использовался при лечении пациента с диагнозом или с подозрением на болезнь Крéйтцфельдта-Я́коба, повторное использование такого инструмента запрещено, он должен быть уничтожен из-за невозможности его повторной обработки или стерилизации во избежание риска перекрестного заражения.
Ограничения при повторной обработке:	4. Во всех случаях, когда в операционных используются средства и препараты с содержанием веществ вызывающих коррозию инструмента (такие как нитрат серебра, препараты йода, соединения содержащие ртуть и др.), остатки этих веществ должны быть удалены с поверхности инструмента немедленно.
ИНСТРУКЦИИ	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Герметичность и транспортировка:	Специальных требований к герметичности и транспортировке не предусмотрено.
Очистка и дезинфекция:	Инструменты следует продезинфицировать и очистить сразу же после использования. Любое загрязнение, оставшееся до высыхания, сделает очистку намного сложнее и может привести к повреждению инструментов. При необходимости инструменты должны быть раскрыты/разведены, что позволит дезинфицирующему средству воздействовать на всю поверхность. Для дезинфекции инструментов можно использовать влажную тепловую или химическую дезинфекцию. Рекомендуется влажная тепловая дезинфекция: водяной насыщенный пар под избыточным давлением 50кПа, при температуре 110°С 20+5минут. Ни в коем случае инструменты не должны храниться в физиологическом солевом растворе, поскольку длительный контакт вызывает точечную коррозию и ржавчину. Инструмент может быть поврежден в результате падения. Маленькие деликатные зажимы могут быть деформированы. Чтобы этого избежать, следует осторожно обрабатывать и складывать инструменты после использования. Во избежание покрытия ржавчиной и образования коррозии, инструменты должны быть незамедлительно подвергнуты машинной обработке. В целях обработки необходимо сложить инструменты на подходящих лотках, перфорированных стерилизационных поддонах. Для эффективной очистки необходимо открыть инструменты, имеющие шарниры (например, ножницы, зажимы, щипцы-кусачки). Инструменты, подлежащие механической обработке, должны быть помещены в комбинированный дезинфицирующий и очищающий раствор. Следует использовать только растворы, не вызывающие коррозию, в заданных концентрациях. Инструменты никогда не должны оставаться в растворе на ночь перед очисткой, так как риск причинения серьезного повреждения увеличивается с течением времени между использованием и подготовкой. Запрещается использовать высоко-кислотные или высоко-щелочные средства для дезинфекции, в частности хлоросодержащие вещества, виркон, аналиты, каталиты и растворы, содержащие перекись водорода.
Очистка и дезинфекция:	Необходимо выбрать средства для дезинфекции высокого уровня, например, дезинфицирующее средство из глутаральдегидов. При использовании средства, следуйте рекомендациям относительно концентрации, температуры, времени воздействия и повторного использования в соответствии с инструкцией производителя. При завершении процесса дезинфекции медицинский инструмент следует тщательно промыть дистиллированной водой для полного удаления дезинфицирующего раствора. Разборка не требуется.
Предстерилизационная Ручная очистка:	Для подготовки к ручной предстерилизационной очистке инструменты должны быть помещены в комбинированный дезинфицирующий и очищающий раствор с доказанным дезинфицирующим эффектом. Необходимо строго соблюдать инструкции производителя в отношении концентрации, температуры и времени проявления индукции. Ежедневно используйте свежие дезинфицирующие и чистящие средства. При длительном использовании одного и того же раствора возрастает риск коррозии. Инструменты должны быть полностью погружены в раствор. После химической дезинфекции и очистки инструменты всегда должны хорошо промываться под проточной водой (ниже 43°С).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	Любой остаток средства необходимо удалить вручную (без металлических щеток, без чистящих средств!). Во избежание появления водяных пятен рекомендуется промывка стерильной и деминерализованной водой. После этого инструменты должны быть незамедлительно высушены горячим воздухом при температуре 85°С. Оборудование: Перчатки латексные, моющее средство, неметаллическая щетка и проточная вода. Технология выполнения работ: 1. Надеть латексные перчатки. 2. Промыть инструменты в воде (рекомендованная температура от 30°С до 40°С) 3. При помощи щетки нанести моющее средство на все поверхности, при этом все узлы, губки и фиксаторы инструментов должны быть очищены в открытых и закрытых положениях. 4. Очистить зубцы и отверстия, используя подходящую щетку и обеспечивая очистку на надлежащей глубине. 5. Промыть чистой проточной водой в течение 3 - 4 минут (рекомендованная температура от 30°С до 40°С). Проточная вода должна проходить через отверстия. Несквозные отверстия должны заполняться водой и затем осушаться.
Предстерилизационная Автоматическая /механизированная очистка:	Следует обратить внимание на следующее: - при применении дезинфицирующего моющего средства, следуйте рекомендациям производителя в соответствии с инструкцией; - должны быть открыты шарнирные инструменты, что гарантирует тщательную очистку шарнира; - не перегружайте перфорированные лотки и тщательно промывайте все инструменты. Остатки, оставшиеся после фазы очистки, должны быть полностью удалены при последующих процедурах полоскания, поскольку в противном случае может произойти образование пятен и / или обесцвечивание. Дополнительное использование подходящего нейтрализующего раствора улучшает результаты промывки. Для окончательной промывки оптимальной считается температура 70-90°С. Следует использовать стерильную и деминерализованную воду. Оборудование: Перчатки латексные, жидкое моющее средство, моечная машина / дезинфекционный аппарат Технология выполнения работ: 1. Надеть латексные перчатки. 2. Загрузить инструменты таким образом, чтобы шарниры были открыты, а отверстия канюль моечной машины могли отводить воду в корзину / подставку моечной машины / дезинфекционного аппарата. 3. Промыть инструменты под проточной водой, (рекомендованная температура от 30°С до 40°С). 4. Поместить корзину / подставку с инструментами в аппарат. * 5. Запустить стандартный цикл промывки в течение 5-6 мин при 80°С - 85°С. 6. Промыть под горячей водой в течение 3 – 4 минут. 7. При разгрузке необходимо проверить углубления, отверстия и т. д. на предмет полного видимого загрязнения и т.д. При необходимости повторите цикл или используйте ручную очистку. 8. Высушить инструменты горячим воздухом при температуре 85°С.
Техническое обслуживание:	Отдать в утилизацию затупленные или поврежденные инструменты.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Осмотр и рабочие испытания:	После каждой очистки инструменты должны быть макроскопически чистыми, то есть не иметь видимого белкового и другого загрязнения. Изношенные, корродированные или поврежденные инструменты должны быть изъяты и утилизированы. Корродированные инструменты могут вызвать контактную коррозию даже на идеальном хирургическом инструменте. Пятна на хирургических инструментах могут быть вызваны неправильной подготовкой. Причинами таких пятен являются: - Недостаточная механическая или ручная очистка; - Неподходящие средства для очистки, дезинфекции и ухода; - Несоблюдение инструкций по дозировке для очистки, дезинфекции или ухода; - Остатки чистящих и дезинфицирующих средств – недостаточная промывка; - Плохое качество воды; - Остатки в стерилизационном паре, когда качество пара не соответствует рекомендациям; - Остатки лекарств, маркировки или химических индикаторов. Процедурные ошибки, например, не проведение очистки новых инструментов перед стерилизацией. 1.Осмотрите инструменты визуально на предмет повреждений и износа; на кромках не должно быть сколов. 2.В случае навесных инструментов проверьте плавное перемещение шарнира без чрезмерного зазора. Закрытие (шарнира, при наличии) механизмов должно быть проверено на предмет работоспособности. 3.Проверяйте инструменты с длинными тонкими деталями (особенно вращающиеся инструменты) на предмет искажения. Если инструменты составляют часть большей сборки, проверьте сборку с сопрягаемыми компонентами
Упаковка перед стерилизацией:	1. По отдельности: Может использоваться стандартный полиэтиленовый пакет/ сумка (рулоны комбинированые, пакеты комбинированые и бумажные типа ПИК-ПАК, ВОМ, "Клинипак",«СтериТ®»). 2. В наборах: Инструменты могут быть загружены в специализированные лотки для инструментов или в лотки для стерилизации общего назначения. Оберните лотки с помощью хлопчатобумажной ткани. Навесные инструменты, такие как ножницы и зажимы должны быть открыты.
Стерилизация Паровым методом:	- Давление пара в стерилизационной камере 210 кПа. - Температура стерилизации 134°С. - Время стерилизационной выдержки 5 минут.
Стерилизация горячим воздухом:	- Температура 180°С в течение 60+5 минут.
Условия хранения:	1.Инструменты прошедшие стерилизацию без упаковки должны быть использованы непосредственно после стерилизации. 2.Срок и условия сохранения стерильности инструмента прошедшего стерилизацию в упаковке устанавливает производитель стерилизационной упаковки. Медицинские инструменты не следует хранить вместе с химическими реагентами, т.к. последние могут разрушать металл при прямом контакте или выделять вызывающие коррозию пары.
Дополнительная информация:	При стерилизации нескольких изделий в одном автоклавном цикле убедитесь, что не превышена максимальная нагрузка, указанная изготовителем стерилизационной установки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Показания к применению и потенциальные потребители:

Инструменты соответствуют требованиям токсикологической и санитарно-химической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ ISO 10993-11 и ГОСТ Р 52770.

Инструменты предназначены для применения при производстве хирургических операций и других медицинских манипуляций медицинским персоналом высшего и среднего звена.

Инструменты должны использоваться только обученным и квалифицированным персоналом в соответствии с его назначением.

Инструменты поставляются нестерильными и перед применением должны быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы.

Инструменты должны быть подготовлены персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и образование и умеющим оценить возникающие риски и соответствующее воздействие.

Противопоказания:

Не применять при наличии повреждений в области стыкующих и фиксирующих элементов, а также на всех подвижных частях, при наличии трещин, переломов и других возможных повреждений.

Возможные побочные действия при применении медицинского изделия:

Не выявлены.

Упаковка и комплектность поставки:

Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет. Допускается использование полиэтиленового пакета с логотипом предприятия-изготовителя.

Групповая упаковка (потребительская тара) – картонная коробка.

Количество инструментов, упакованных в потребительскую тару, зависит от размера инструмента и является кратным 5.

Инструкция по эксплуатации вкладывается в транспортную тару – 1шт.

В качестве транспортной тары используется коробка, изготовленная из прочного картона. Вес коробки с изделиями должен быть не более 20 кг.

Транспортировка и хранение:

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 для группы 5 (ОЖ 4).

Инструменты медицинские хирургические транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от -50°С до +50°С.

После транспортирования в условиях отрицательных температур перед распаковкой инструменты должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях.

Условия хранения по ГОСТ 15150 для группы 1 (Л): Инструменты медицинские хирургические хранятся в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха – 80% при t- 25°С.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

В процессе эксплуатации инструменты должны выдерживать воздействие температуры в пределах от +10°С до +45°С и влажности не более 80% при 25°С, соответствующее климатическому исполнению УХЛ или О категории размещения 4.2.

Ремонт и техническое обслуживание:

Инструменты медицинские хирургические не подлежат ремонту и техническому обслуживанию. В случае выявления неисправностей, следов коррозии и пр. инструменты в гарантийный период подлежат замене, в постгарантийный – утилизации.

Правила утилизации:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Утилизация инструментов и элементов их упаковки в медицинских организациях Российской Федерации осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21:

- для неиспользованных инструментов по классу опасности А;
- для использованных инструментов по классу опасности Б.

Гарантии производителя:

Гарантийный срок эксплуатации для инструментов – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения инструментов - 5 лет без переконсервации.

Сведения о рекламациях и нежелательных событиях:

Рекламации предъявляются представителю производителя на территории Российской Федерации в установленном порядке с приложением этикетки.

Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения медицинских изделий, должны информировать представителя производителя медицинских изделий на территории Российской Федерации о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), а также предоставлять доступ к медицинским изделиям, с которыми могут быть связаны указанные события.

Представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО МК «Мед-Континент», 603074, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 23, офис П1.
Телефон/факс: (831) 275-15-17
E-mail: info@med-continent.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

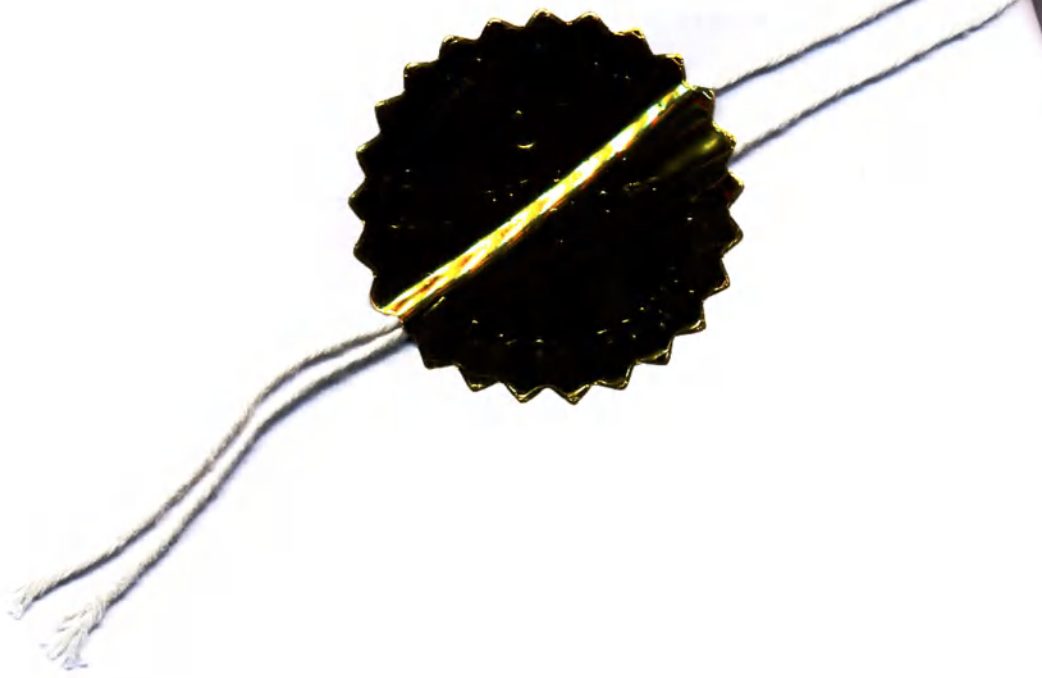

ATTESTED

Notarized to Take effect in All Continents out of Pakistan Under International Law

NOTARY PUBLIC
Zaheer Haider Awan
Advocate High Court
District Court Sialkot-Pakistan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод штампов, печатей и апостиля в инструкции по эксплуатации на инструменты медицинские хирургические в вариантах исполнения: зажимы

Марка: AK112200
100 рупий

АПОСТИЛЬ

1. Страна:	Исламская Республика Пакистан Настоящий официальный документ
2. Был подписан:	Захиром Хайдером Аваном
3. Выступающем в качестве:	НОТАРИУСА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАКИСТАНА
4. Скреплен печатью/штампом:	ЗАХИРА ХАЙДЕРА АВАНА (АДВОКАТ ВЕРХОВНОГО СУДА) НОТАРИУС СИАЛКОТ, ПАКИСТАН

УДОСТОВЕРЕНО

5. в г. СИАЛКОТ, ПАКИСТАН

6. 10 декабря 2021 года

7. АДВОКАТОМ ВЕРХОВНОГО СУДА, НОТАРИУСОМ ПАКИСТАНА

8. № С.С. 6845

9. Печать/штамп:
/подпись/

Печать: Удостоверено и действительно на территории всех стран за пределами Пакистана, в соответствии с нормами международного права.

Штамп: Удостоверено
/подпись/

Печать: Окружной суд г. Сиалкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Печать: Сиалкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Компания Сурдживелл, Сиалкот, Дефенс Роуд,
Ниар Поли Техникал Стафф Колони

4951
06-12-2021

Штамп: Шама Али
Должностное лицо с правом печати
Лицензия № HC-74
Округ суд г. Сиалкот
0301-6286849

Штамп: Шама Али
Должностное лицо с правом печати
Лицензия № HC-74
Округ суд г. Сиалкот
0301-6286849

Апостиль /подпись/

Шафик ур Рехман, сын Мухаммада Рафика
Идентификационный номер 34603-9326618-1

/подпись/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Штамп: СУРДЖИВЕЛЛ
Хирургические инструменты
Пакистан, 51310, Сиалкот, Дефенс Роуд
/подпись/

Печать: Удостоверено и действительно на территории всех стран за пределами Пакистана, в соответствии с нормами международного права.

Штамп: Удостоверено
/подпись/

Печать: Окружной суд г. Сиалкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Печать: Сиалкот, Пакистан,
Нотариус,
Захир Хайдер Аван,
Адвокат Верховного суда

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной,
Переводчиком Радонцевым Максимом Юрьевичем

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Российская Федерация

Город Нижний Новгород

Двадцать четвёртого декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Кузнецова Юлия Валерьевна, нотариус города областного значения Нижнего Новгорода, свидетельствую подлинность подписи переводчика РАДОНЦЕВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № **52/310-н/52-2021-4-839**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 639 руб. 00 коп.

Ю.В.Кузнецова

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено подписью и печатью
1 (Один) листа(ов)
Ю.В. Кузнецова

Компьютерная система "Экспресс"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU