

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «НИИИ»

И.М. Смирнов


«10» июня 2022 г.



ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с
наполнителем или без наполнителя в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-
07516304-2021**

Макет маркировки этикетки медицинского изделия

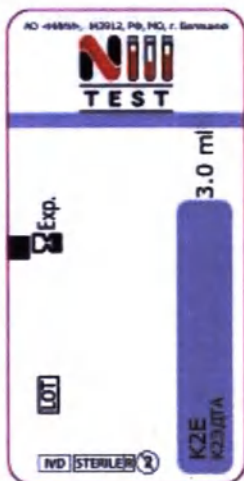

Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем K2ЭДТА, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021.



Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем K2ЭДТА с разделительным гелем, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем K3ЭДТА, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x75 мм; 2,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

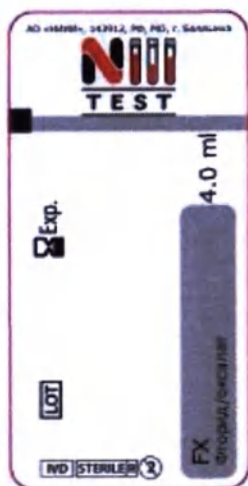


Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид натрия и Na₂ЭДТА, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

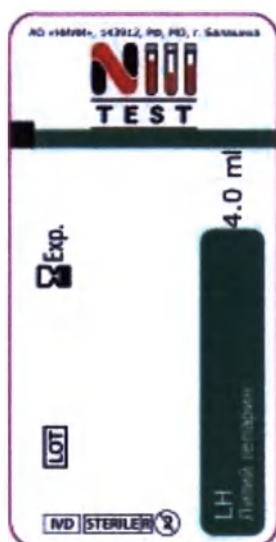

Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

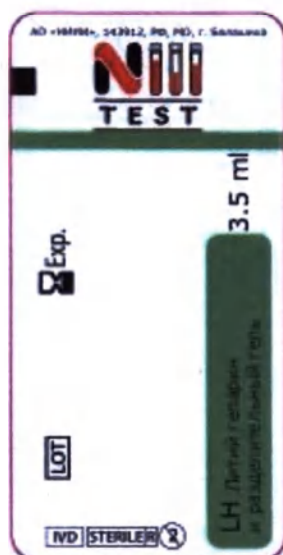


Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 13x75 мм; 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 13x75 мм; 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

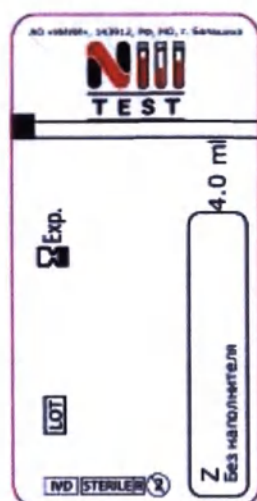

Макет маркировки: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» без наполнителя, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

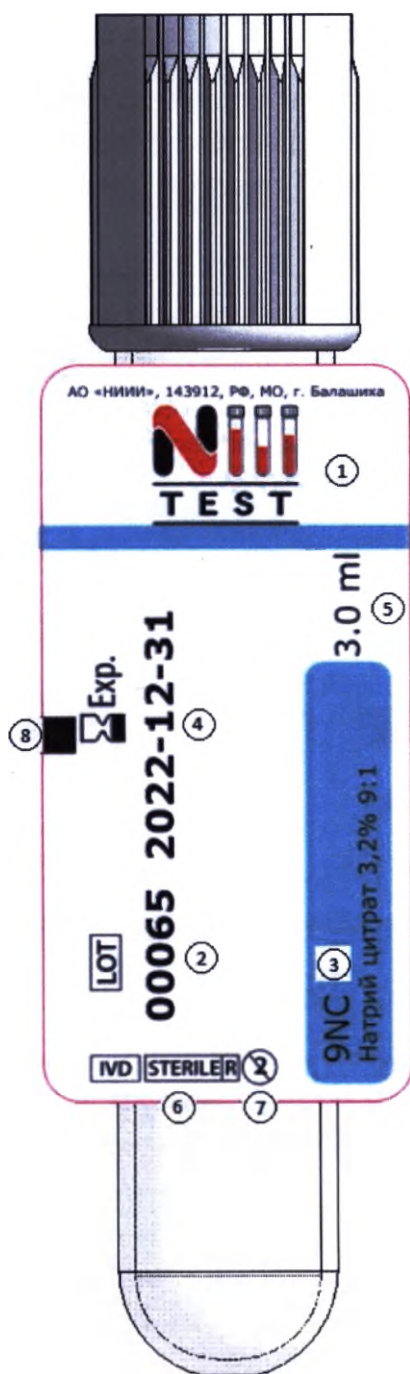

Пример маркировки этикетки медицинского изделия.

Макет потребительской упаковки медицинского изделия:

Макет представлен на примере варианта исполнения: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"	
143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6		
Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с активатором свертывания (кремнезем) 13x75 мм, 4,0 мл, R1213075040 по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021		
РУ № _____		Кол: 100 шт.
 16.09.2021	 16.09.2022	
 LOT A00048		 STERILE  IVD
		 +25
		
		
Только для профессионального применения		

Макет транспортной упаковки медицинского изделия:

Макет представлен на примере варианта исполнения: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"	
143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6		
Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с активатором свертывания (кремнезем) 13x75 мм, 4,0 мл, R1213075040 по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021		
РУ № _____		Кол: XX шт.
 XX.XX.XXXX	 XX.XX.XXXX	
 LOT XXXXXX		 STERILE  IVD
		 +25
		
		

Прошито и скреплено печатью

листов



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"**

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор


АО «НИИИ»

И.М. Смирнов


«28» июня 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем
или без наполнителя в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021**

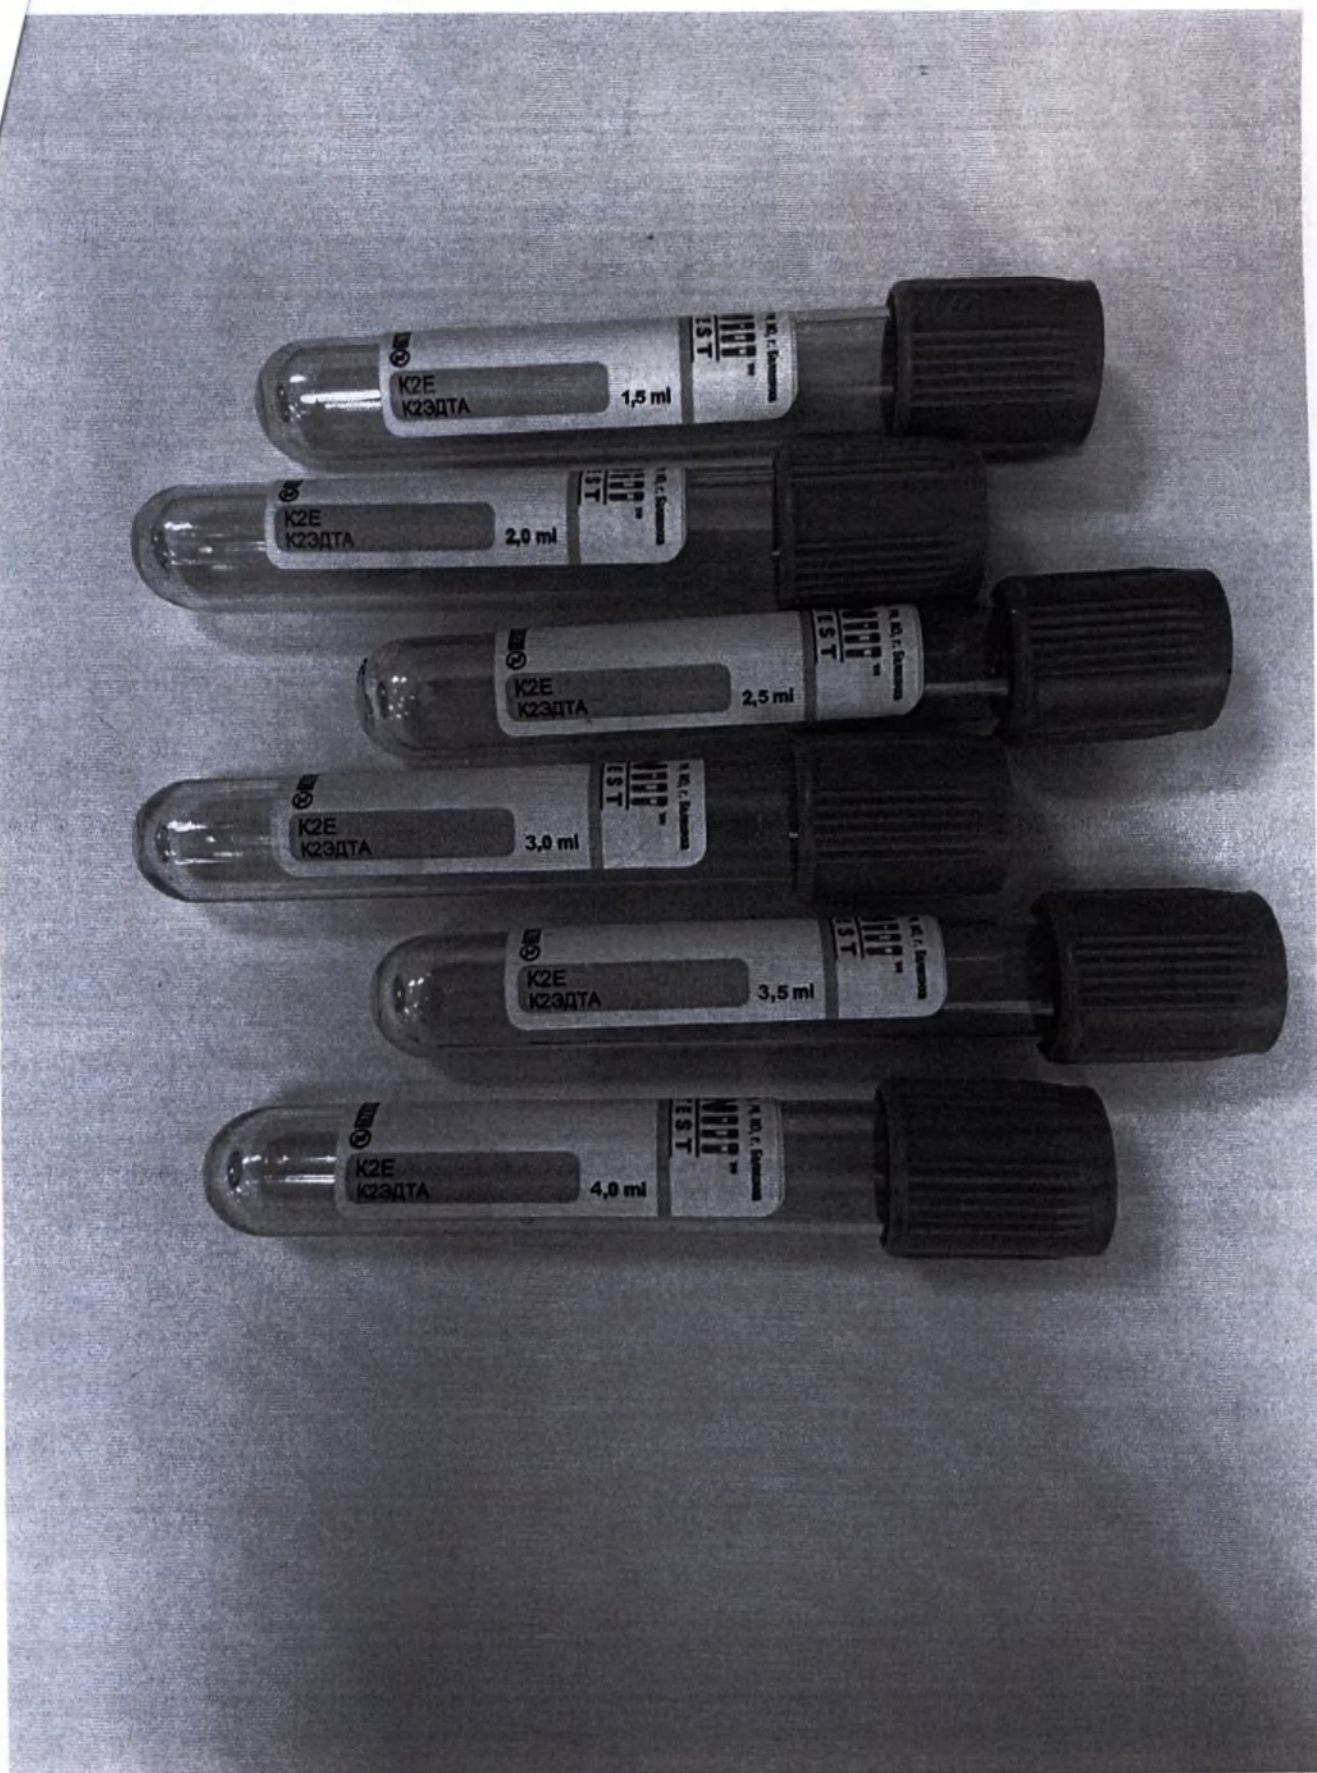


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем K_2EDTA , 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420)

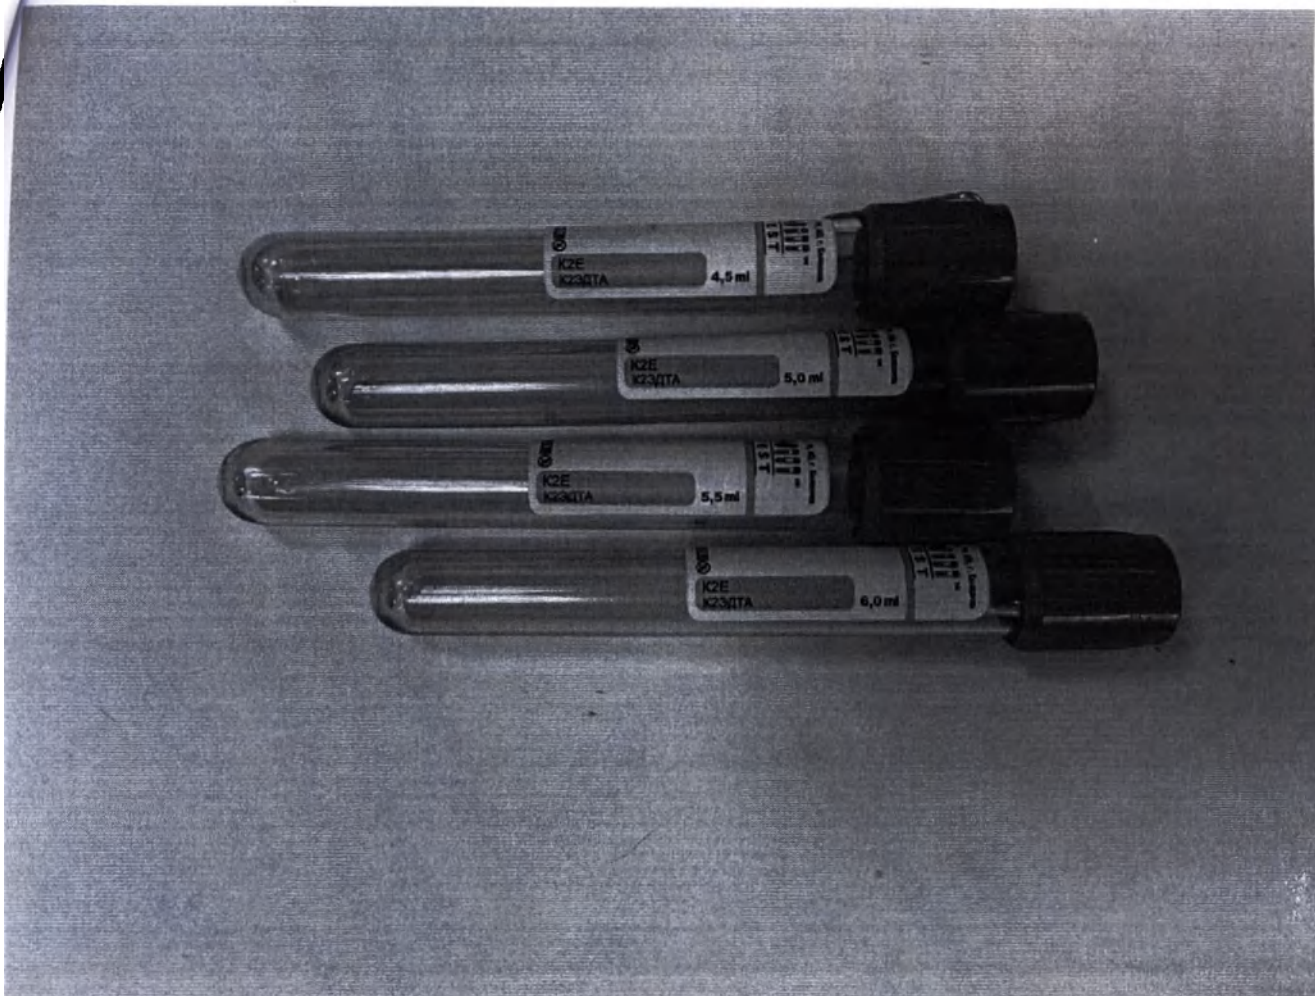

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем К2ЭДТА 13х100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420)

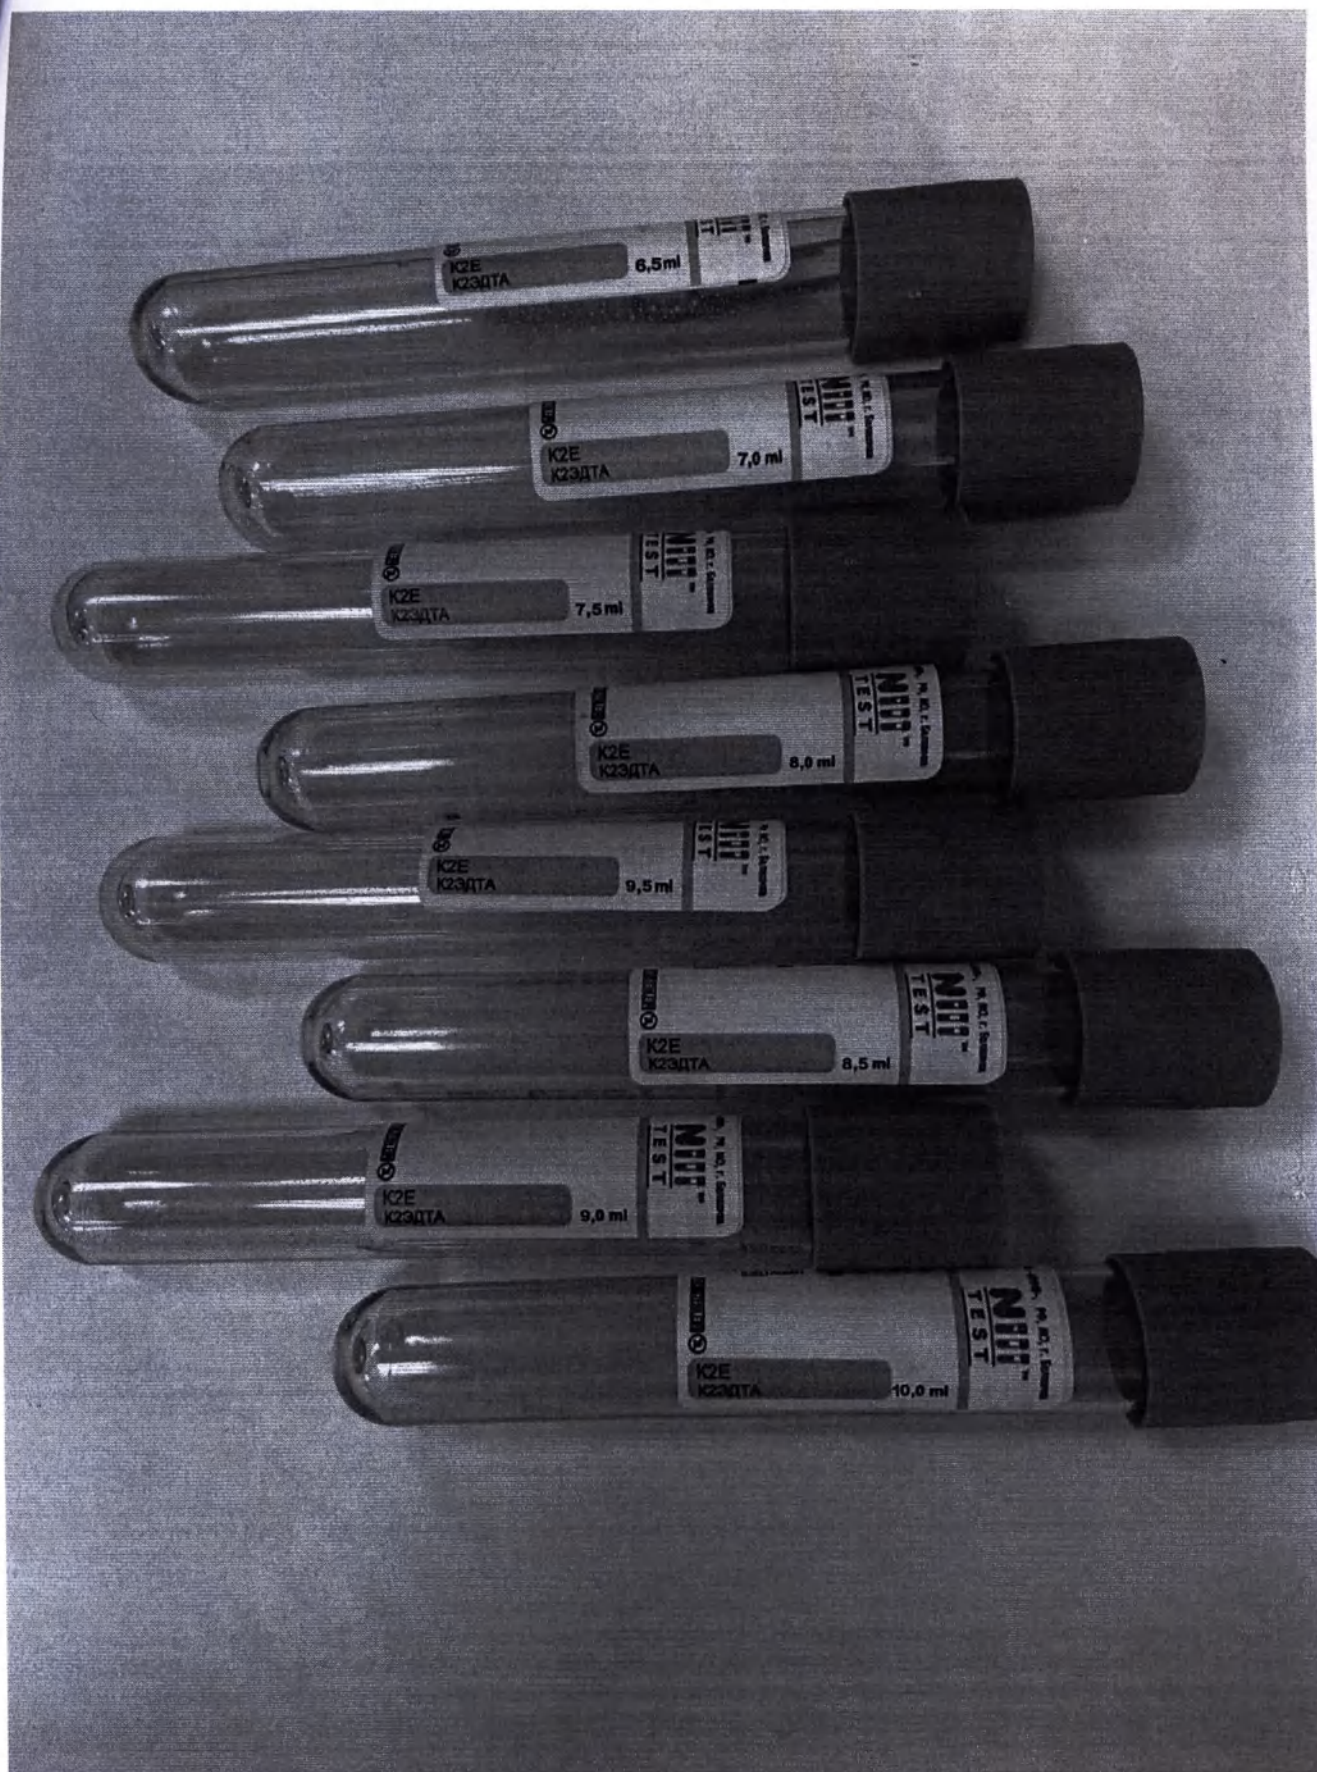


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NП TEST» с наполнителем K2ЭДТА 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420)

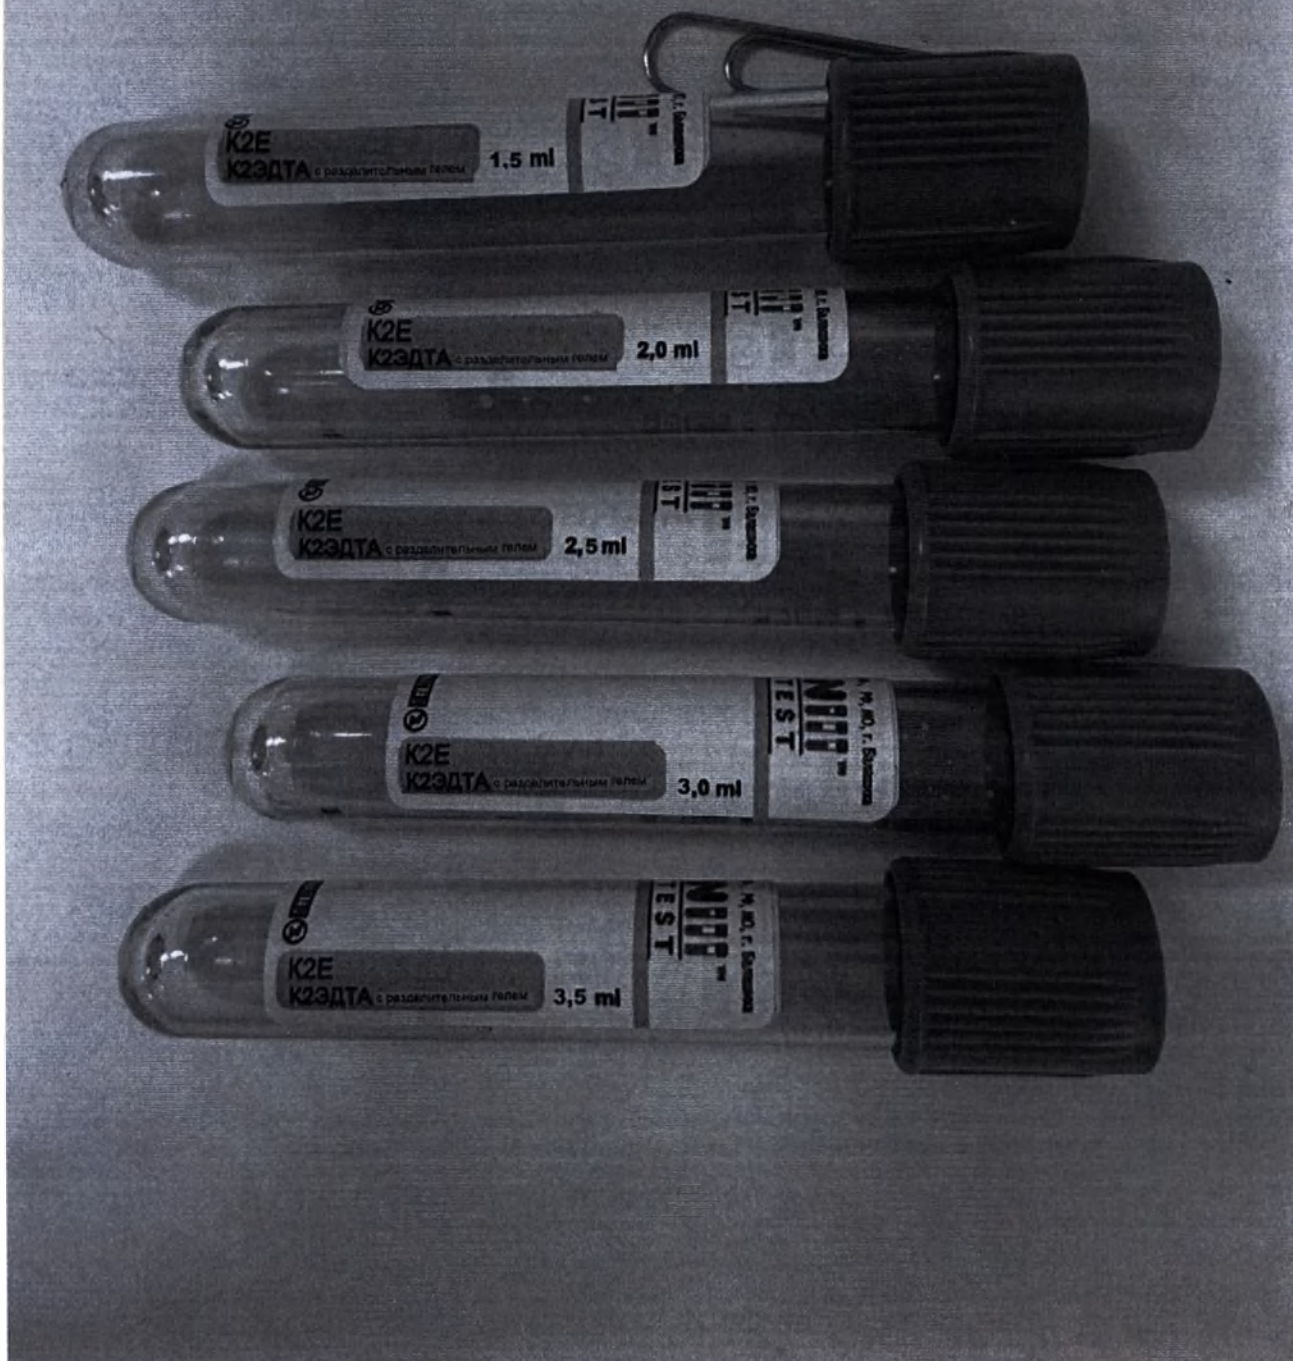


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем K2ЭДТА с разделительным гелем, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021(код вида 293630)



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем К2ЭДТА с разделительным гелем, 16x100 мм; 5,5 мл, 6,0 мл, 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021; (код вида 293630)

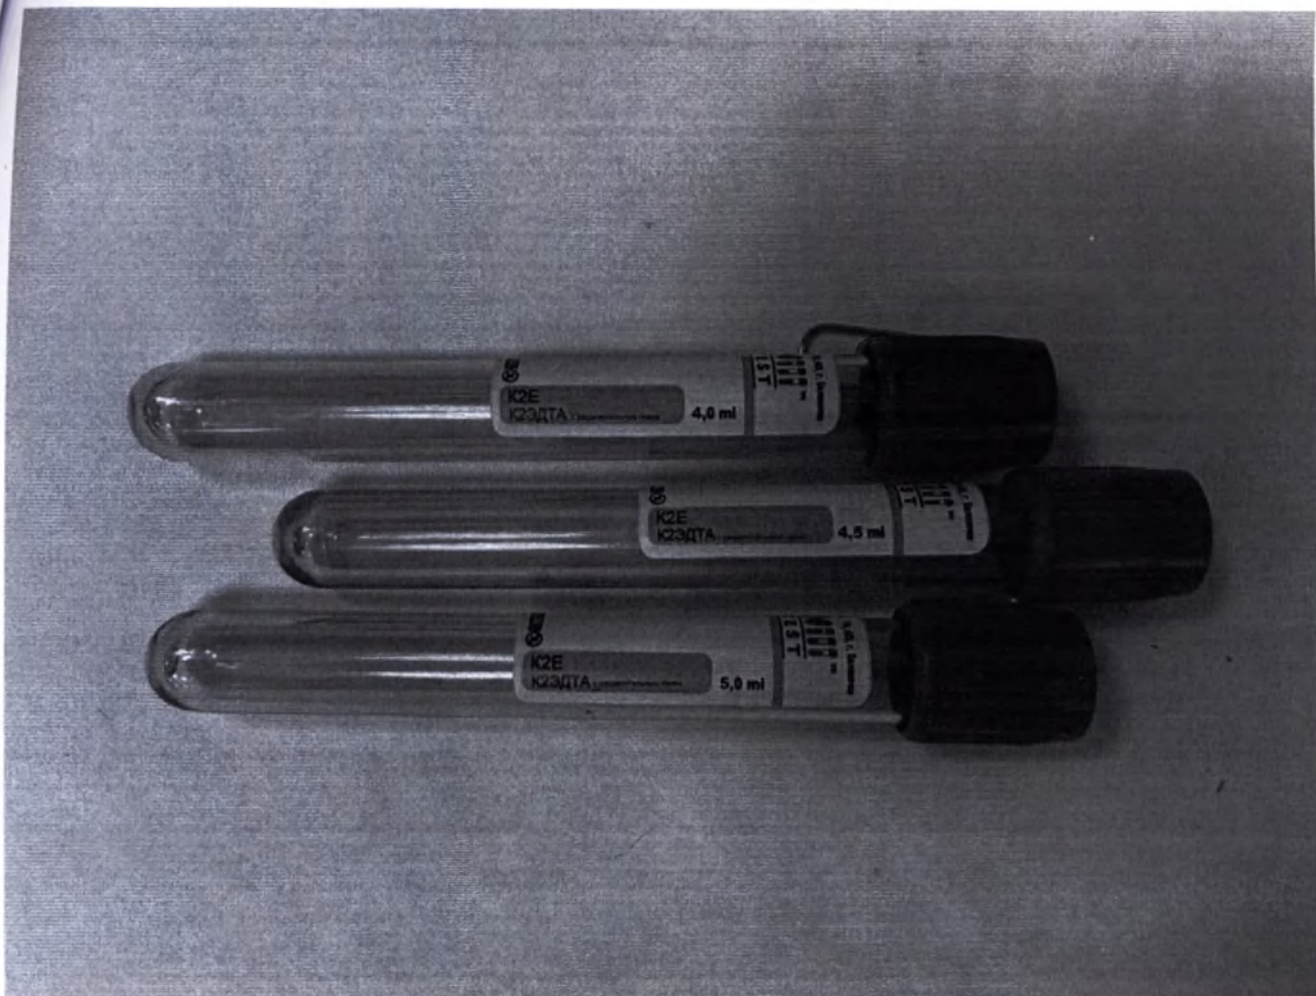


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем К2ЭДТА с разделительным гелем, 13х100 мм; 4,0 мл, 4,5 мл, 5,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021(код вида 293630)

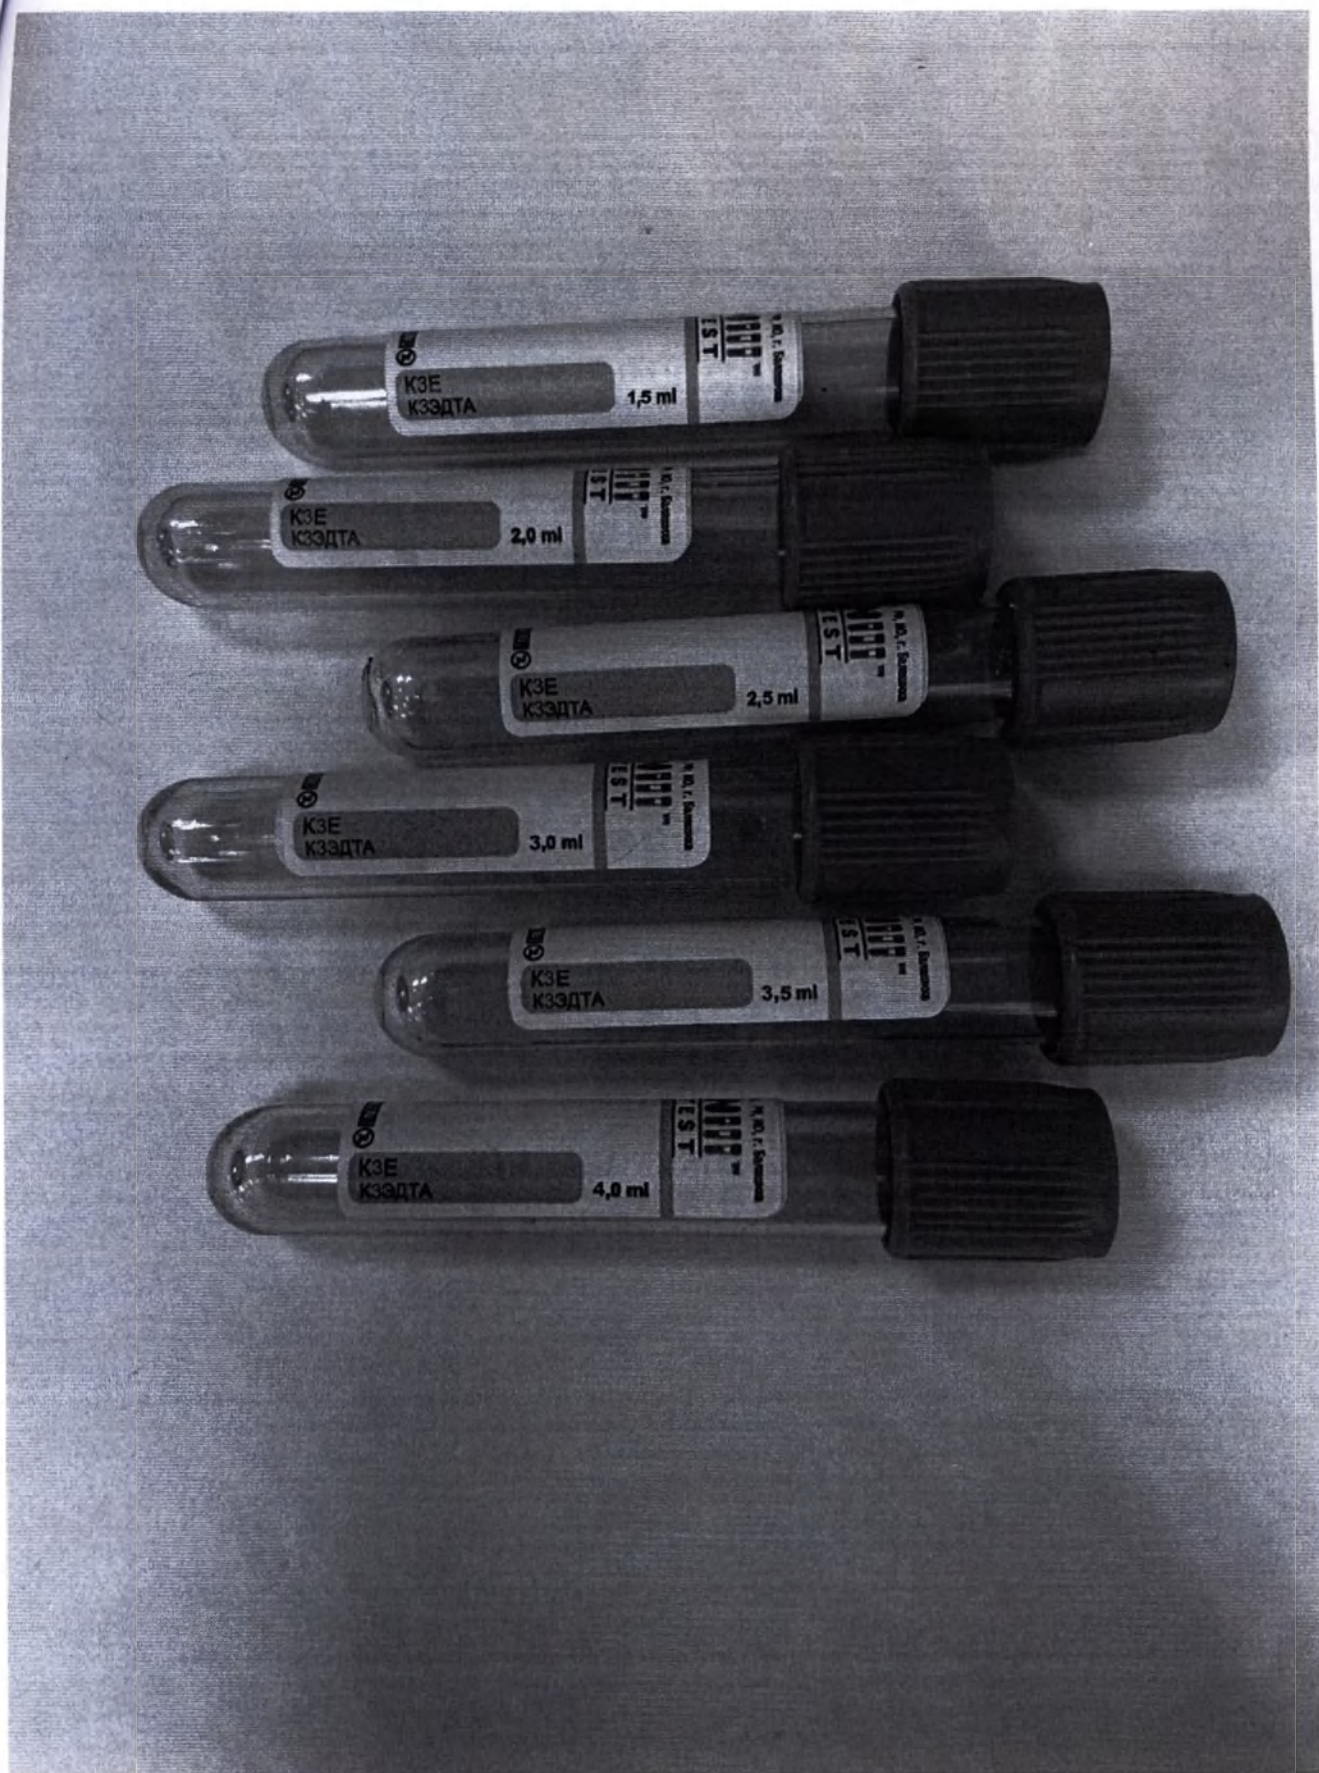

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем КЗЭДТА, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



1. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем КЗЭДТА, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

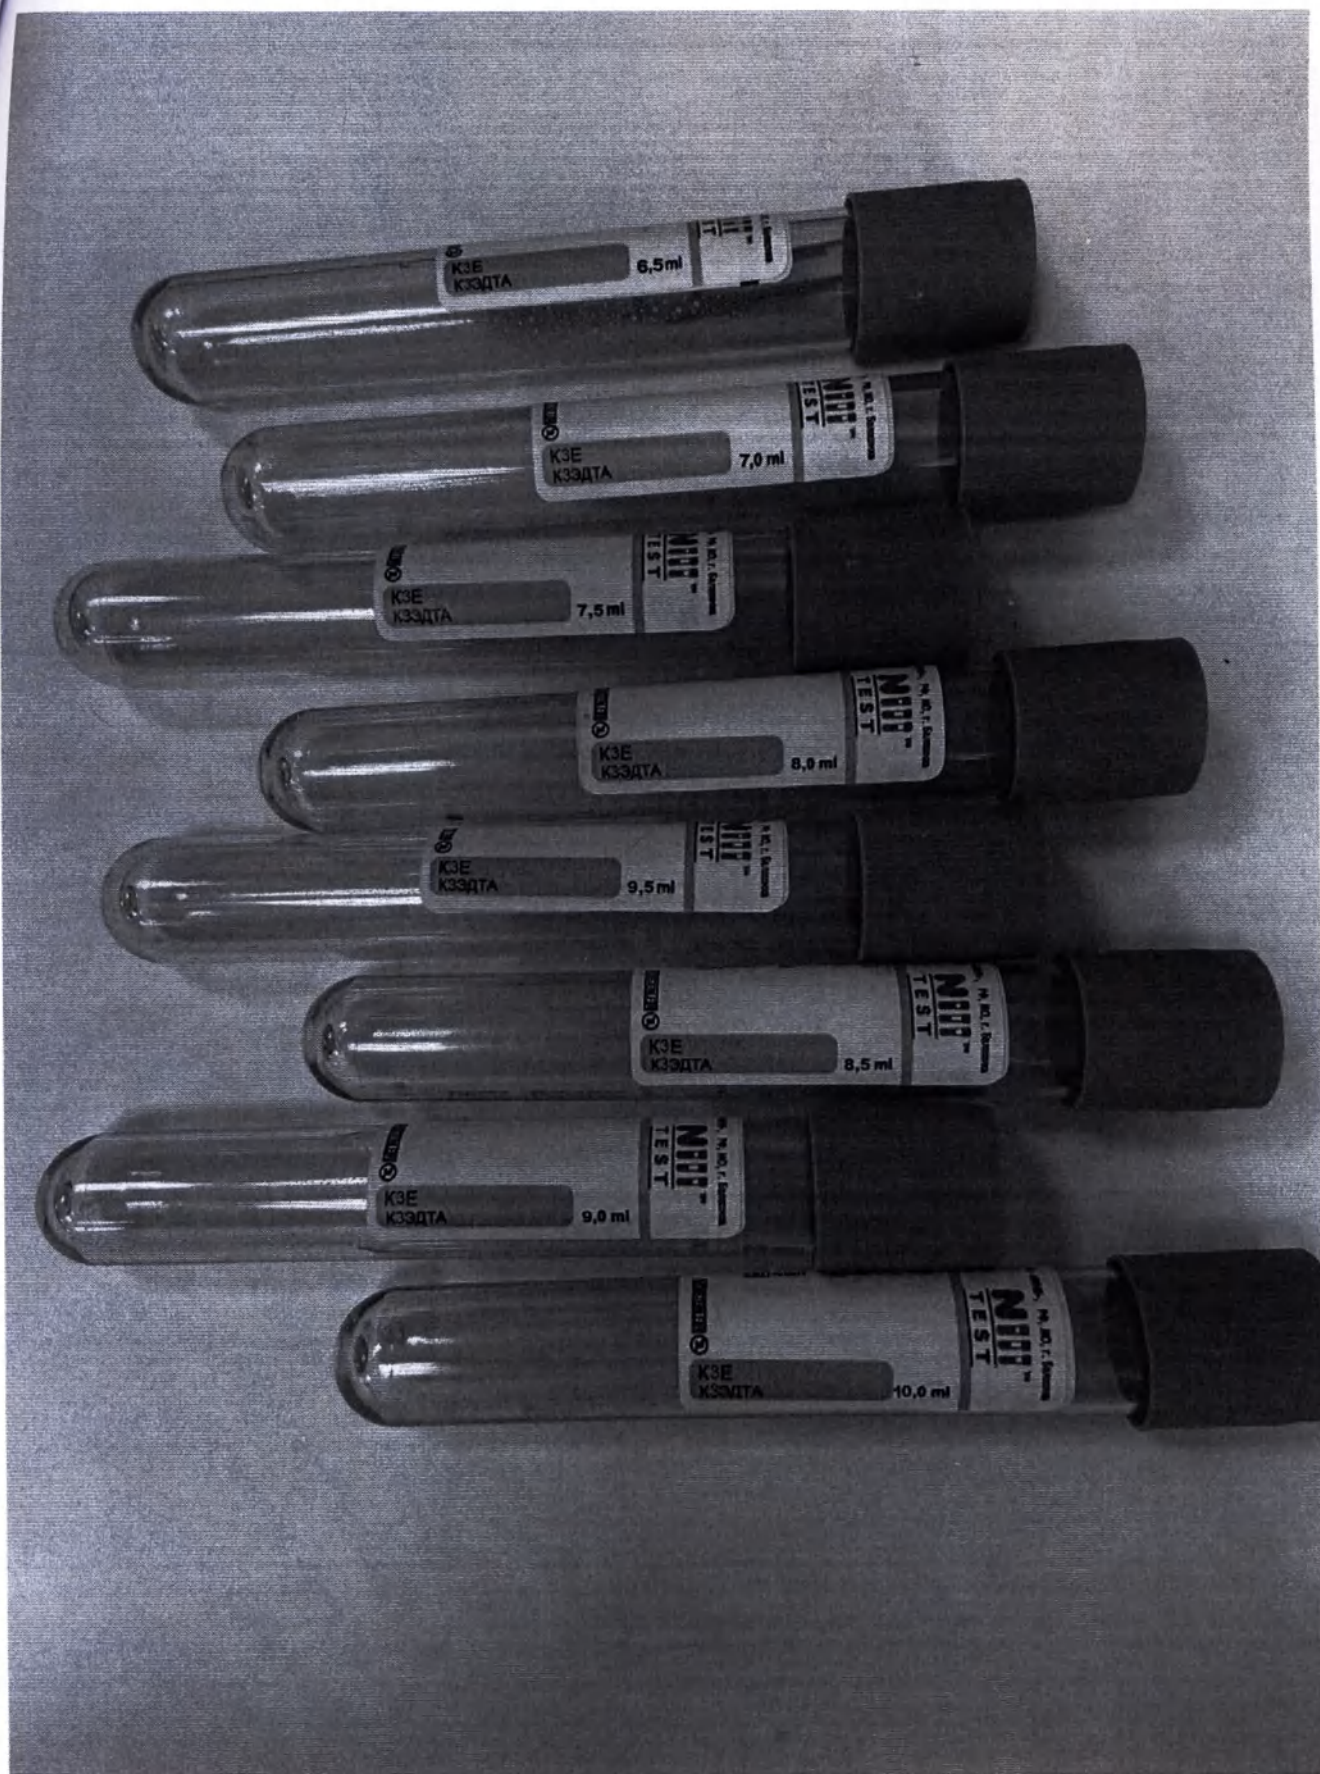


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем КЗЭДТА, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

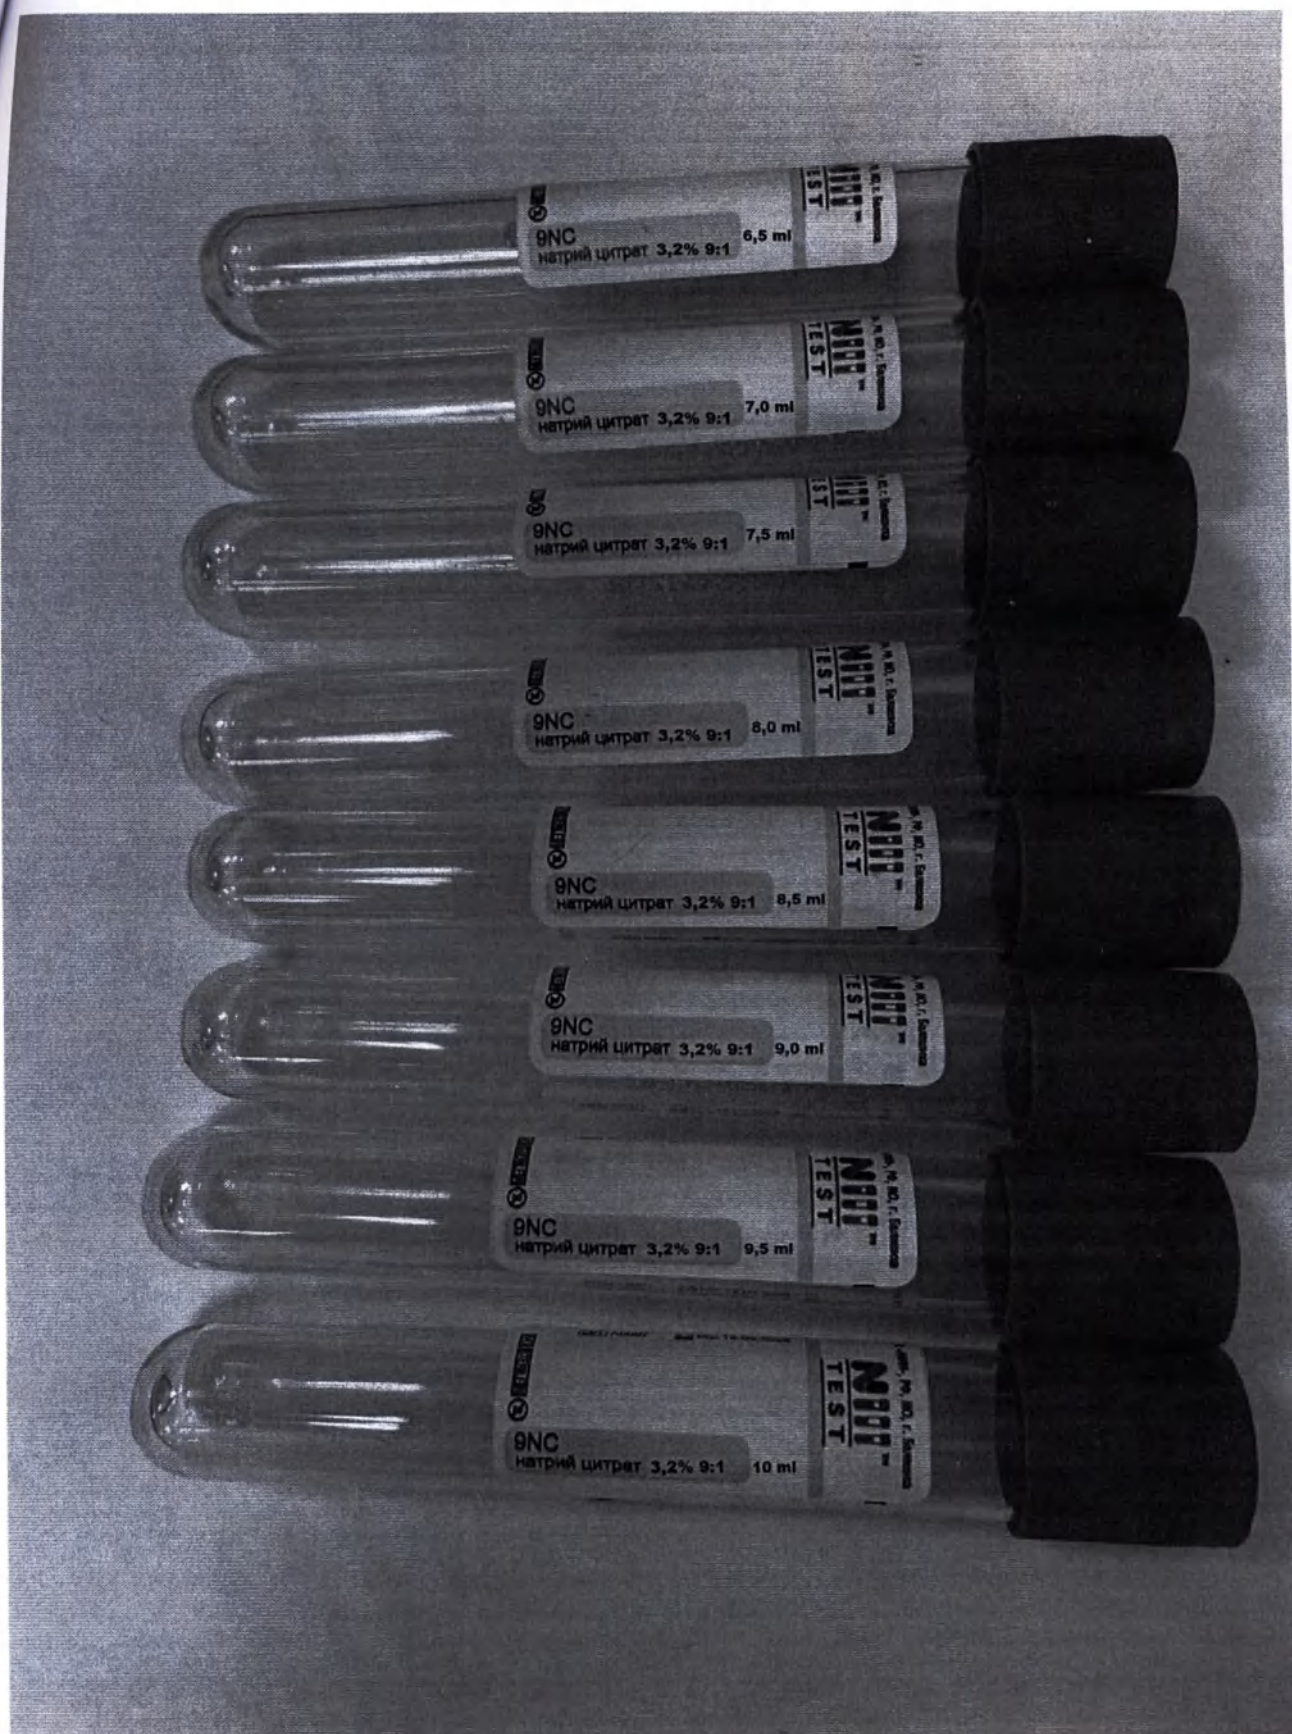

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

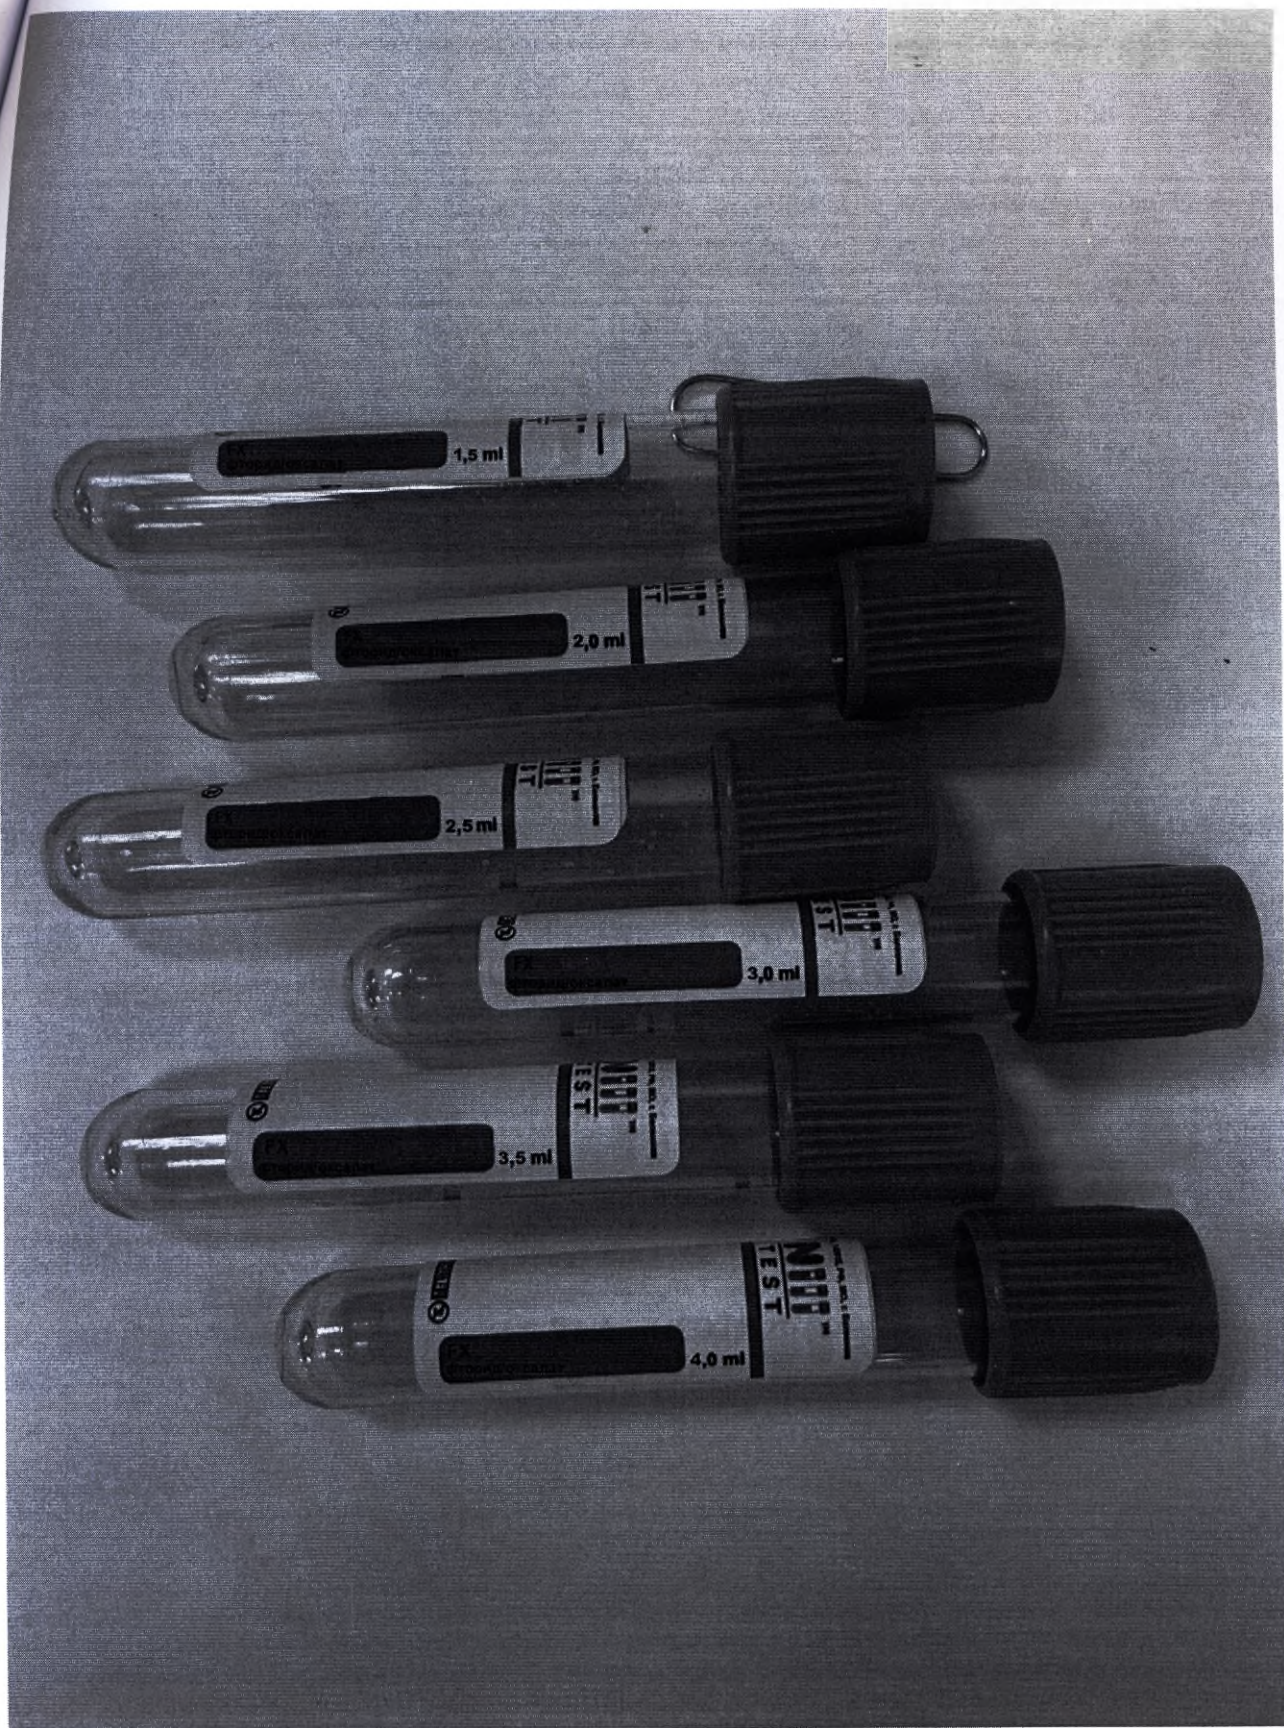

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293400);

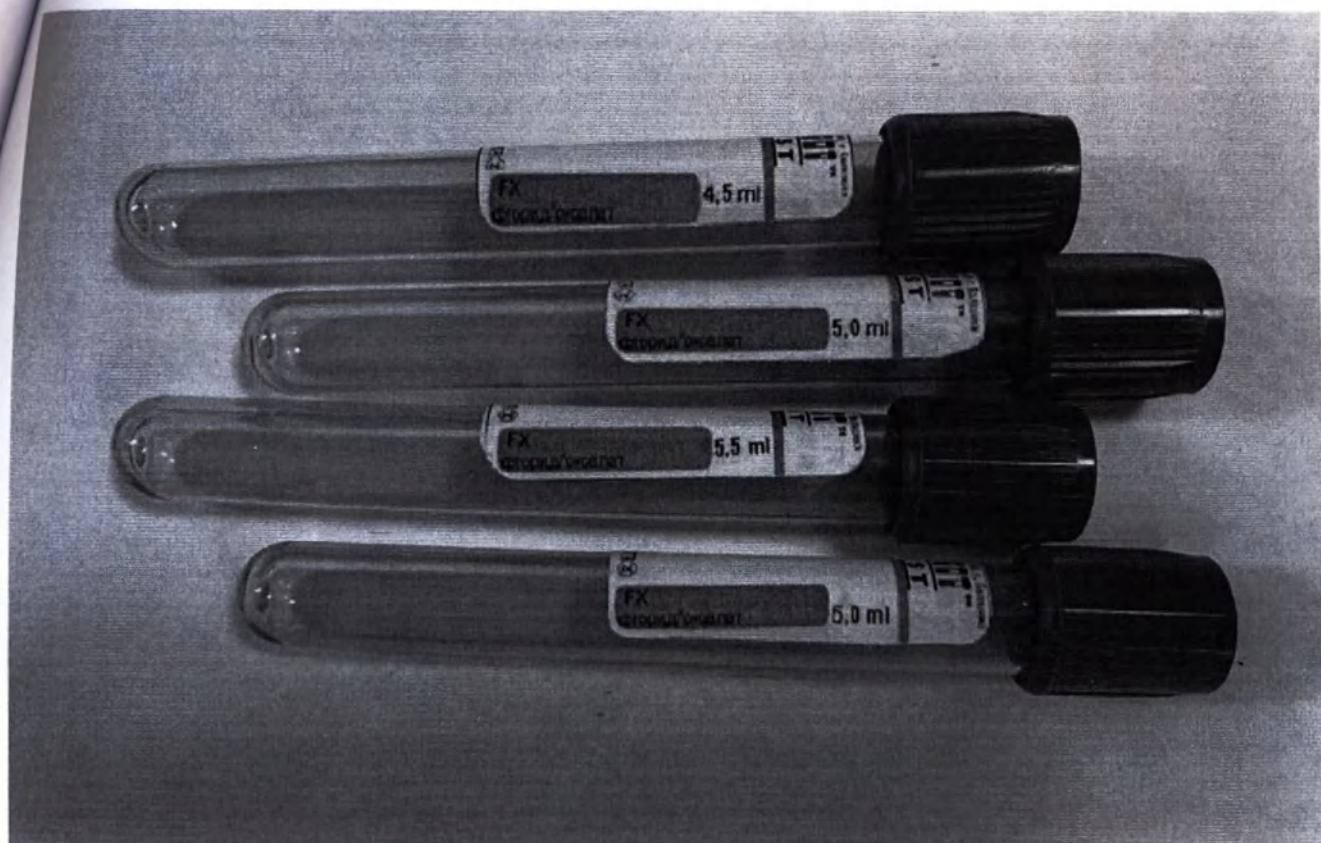


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293400);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293400);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем фторид натрия и $\text{Na}_2\text{ЭДТА}$, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293400);

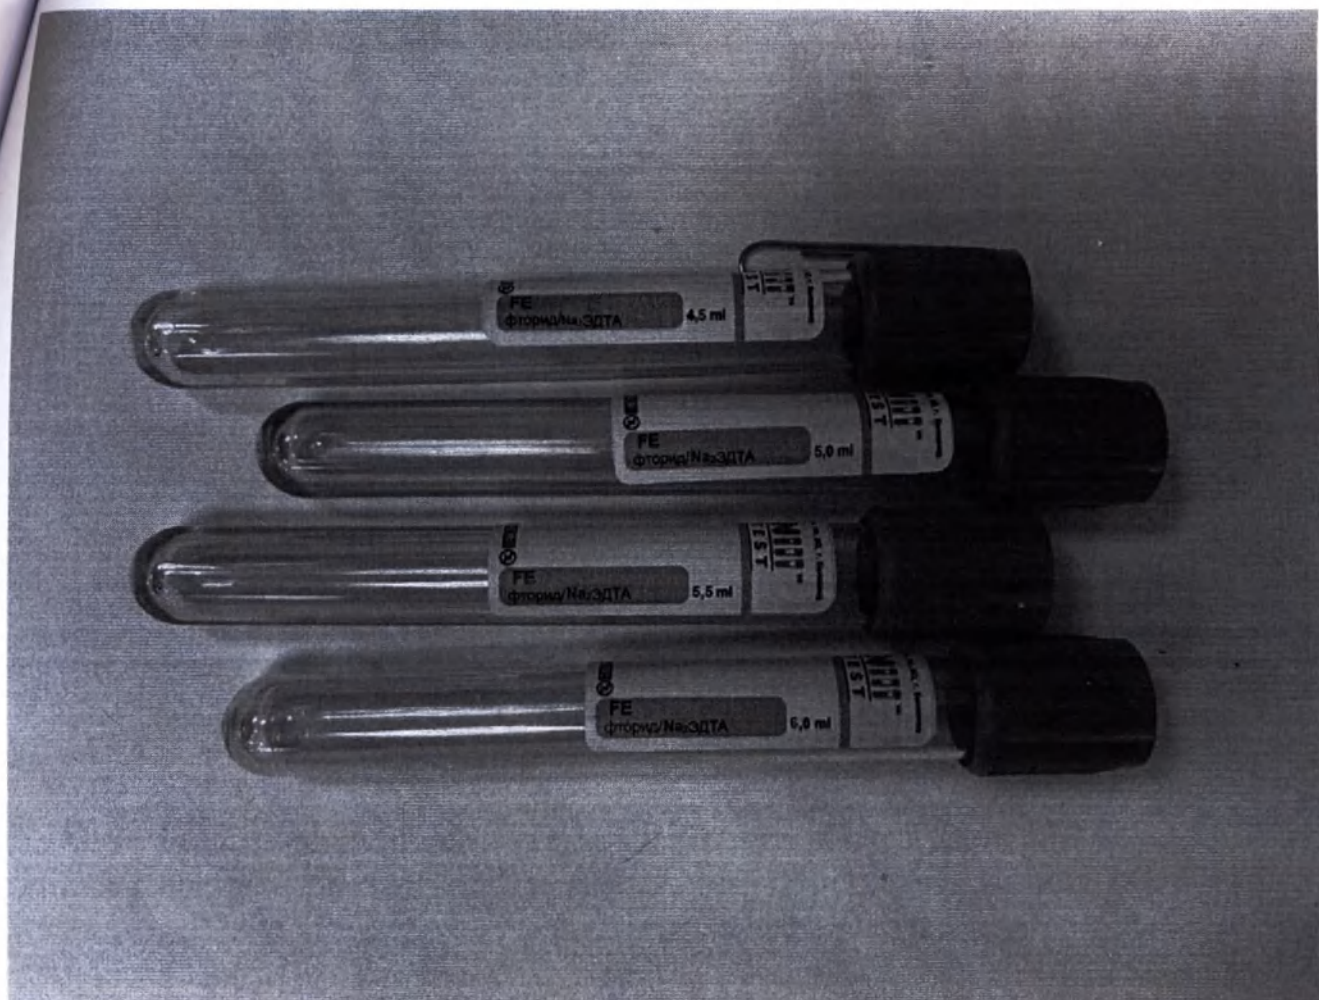


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид натрия и $\text{Na}_2\text{ЭДТА}$, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293400);

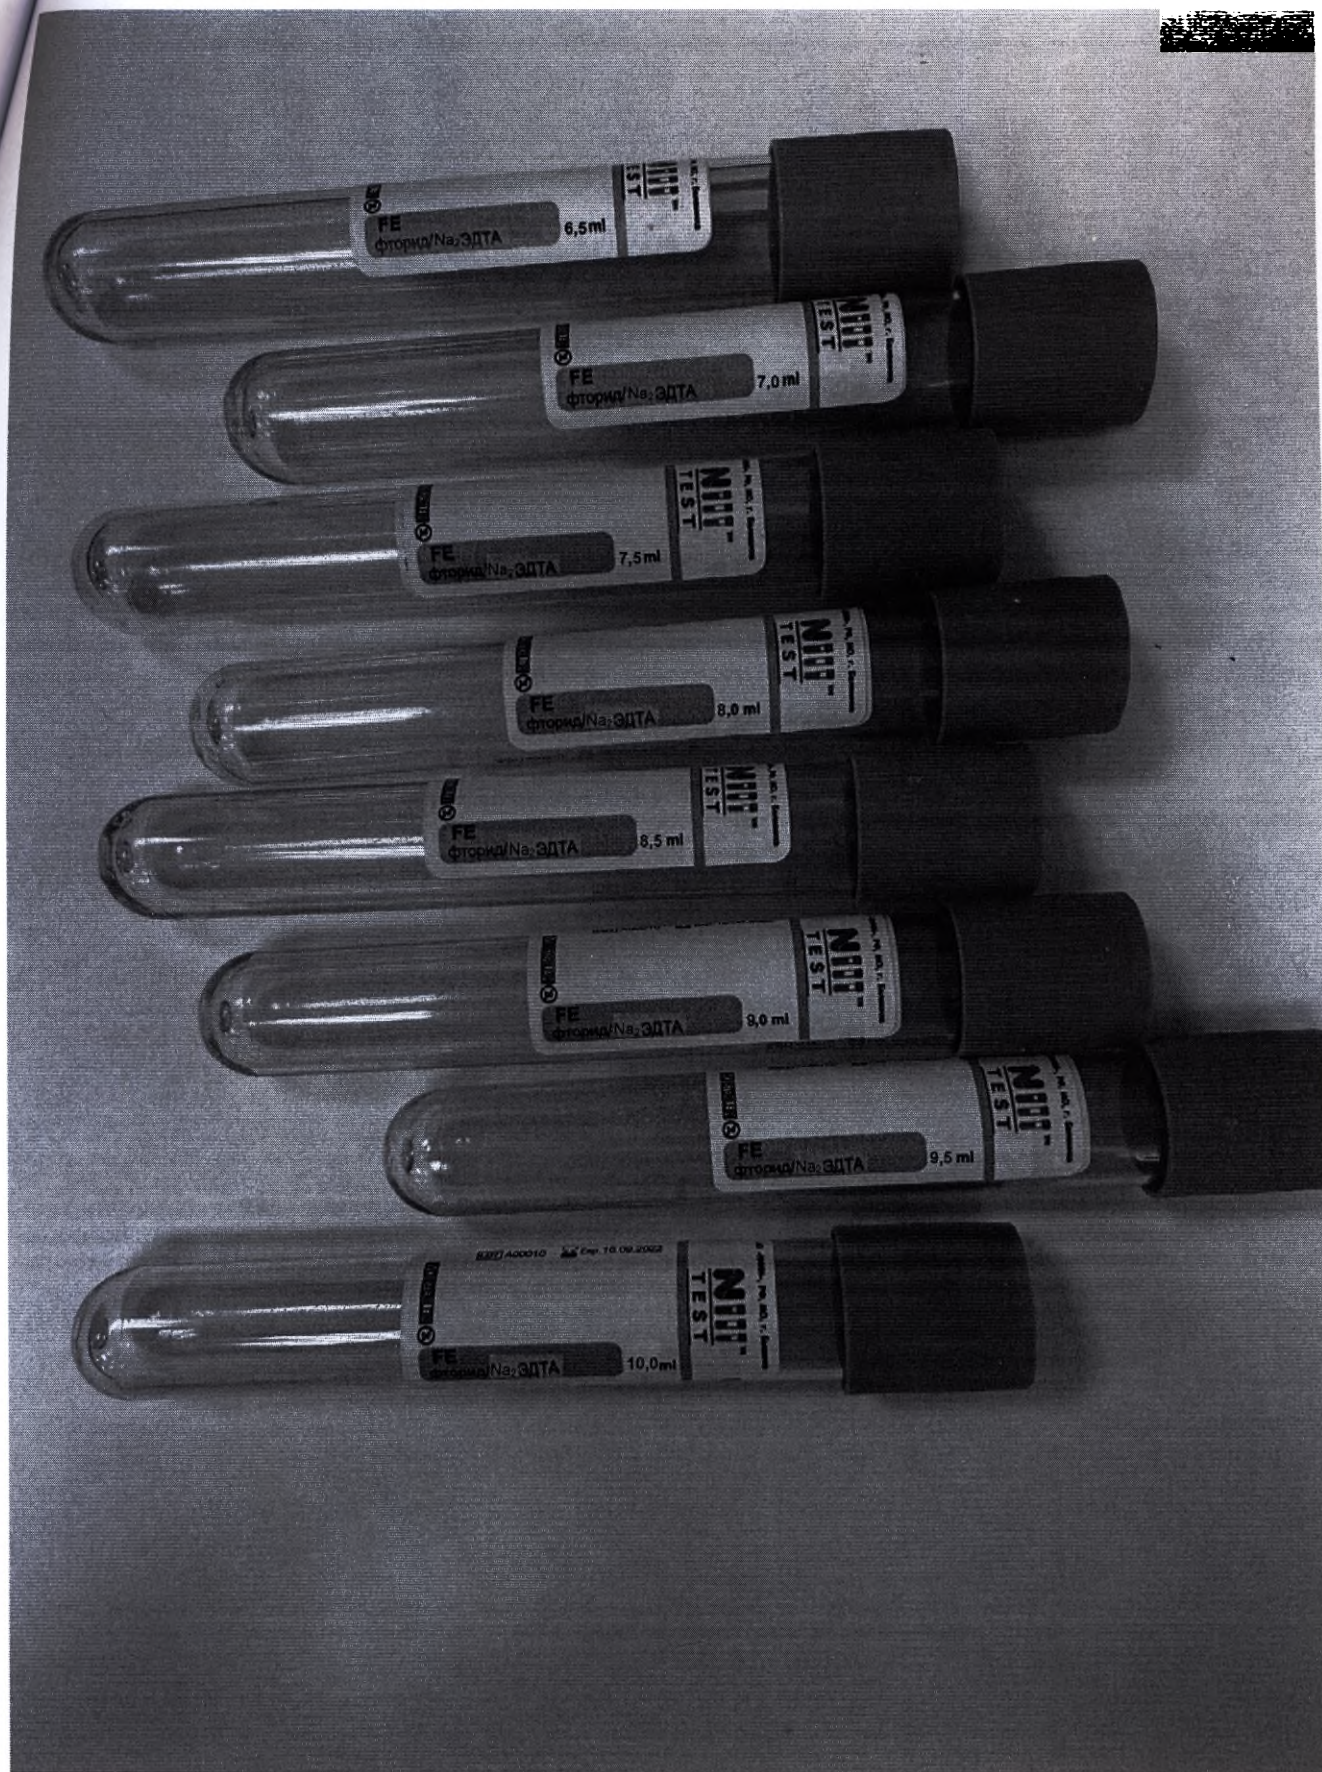

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид натрия и $\text{Na}_2\text{ЭДТА}$, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293400);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

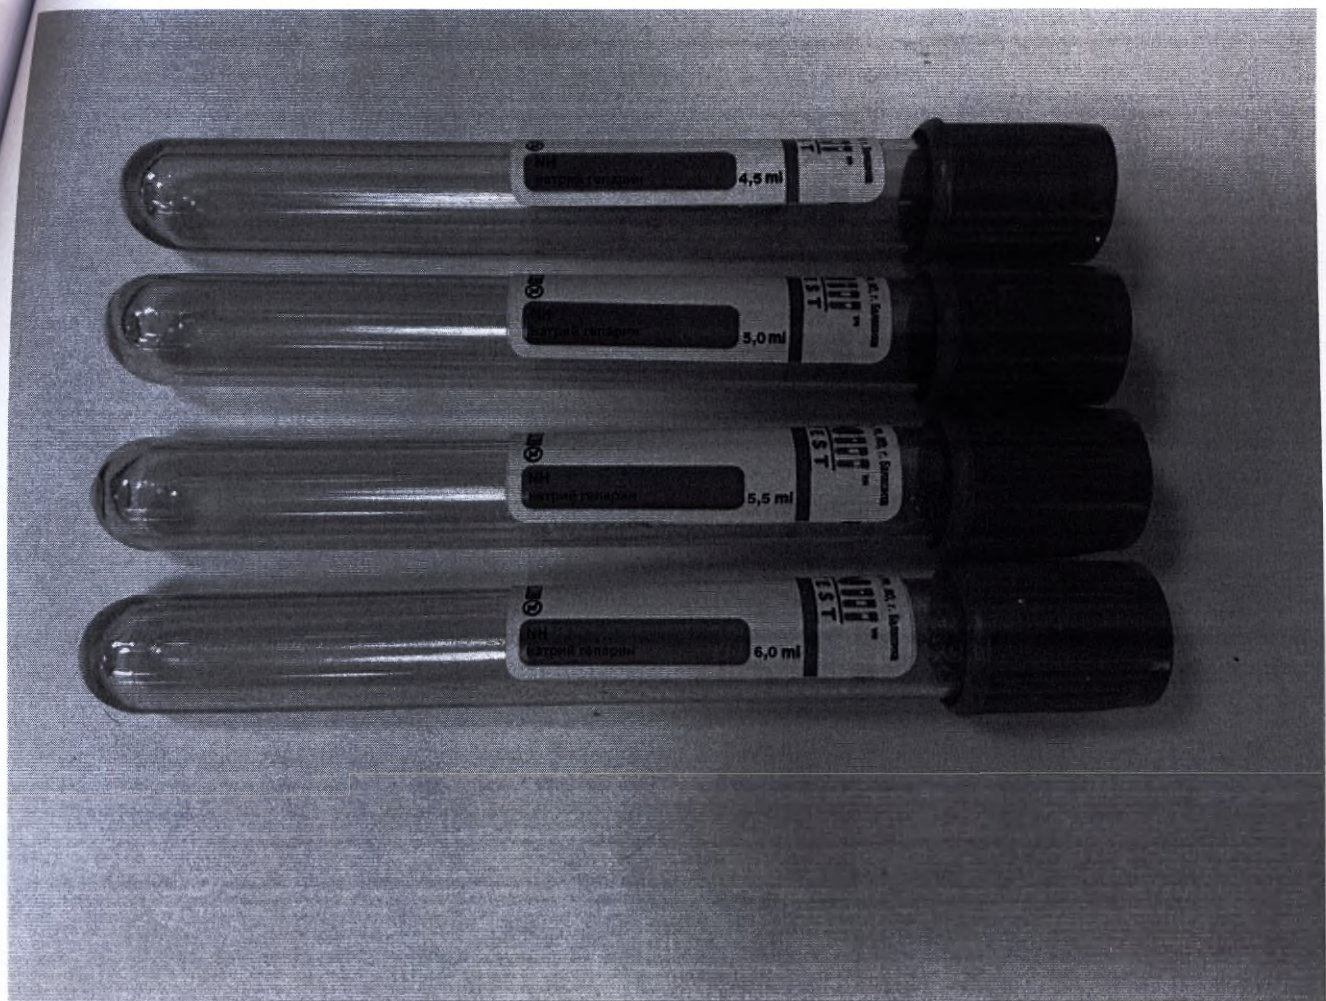


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NPII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

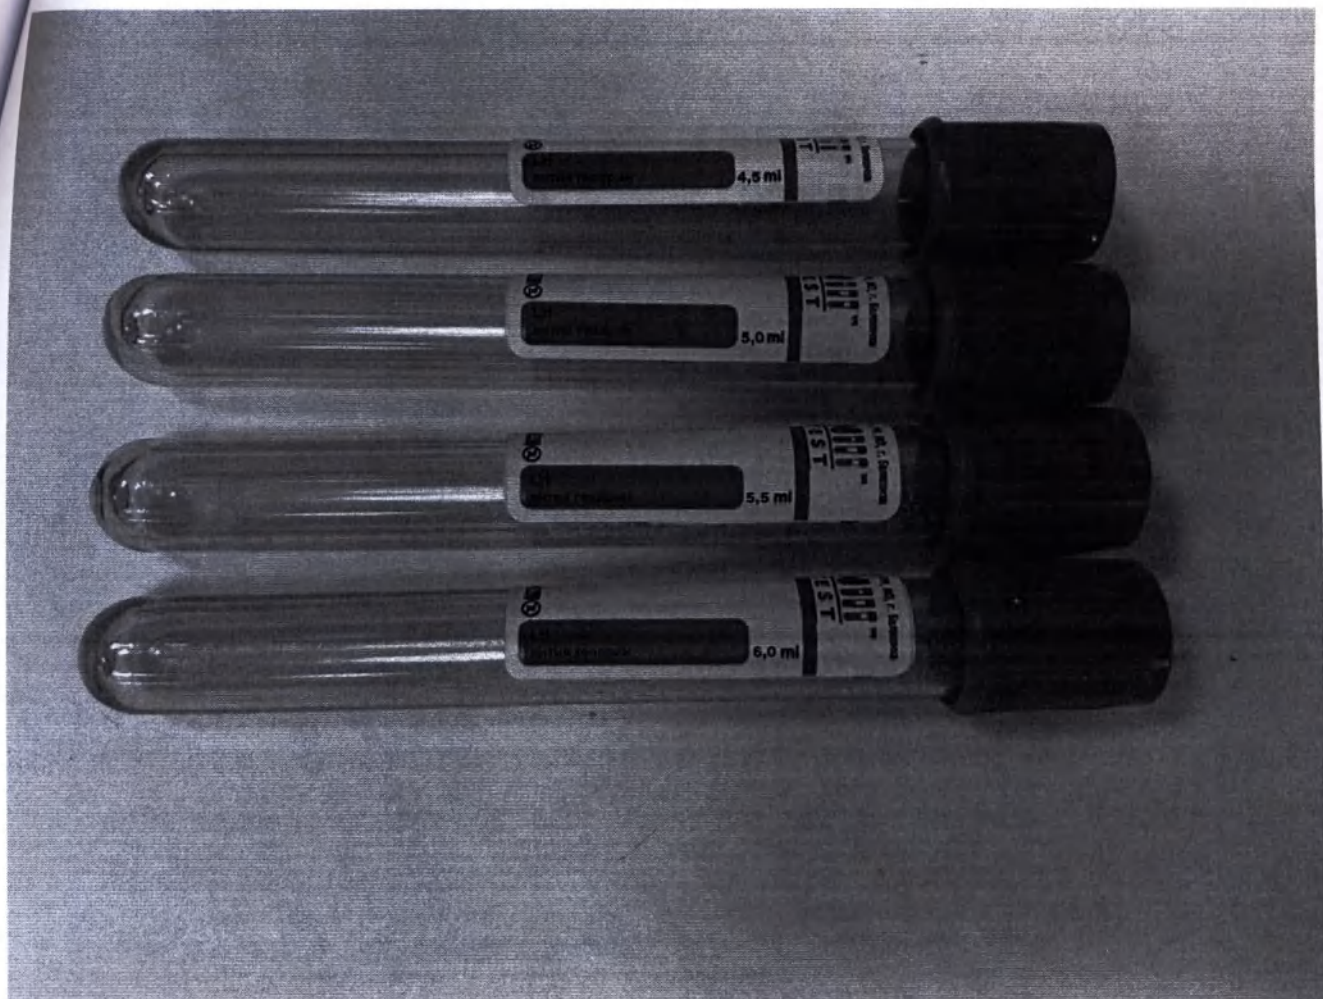


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NPII TEST» с наполнителем литий гепарин, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

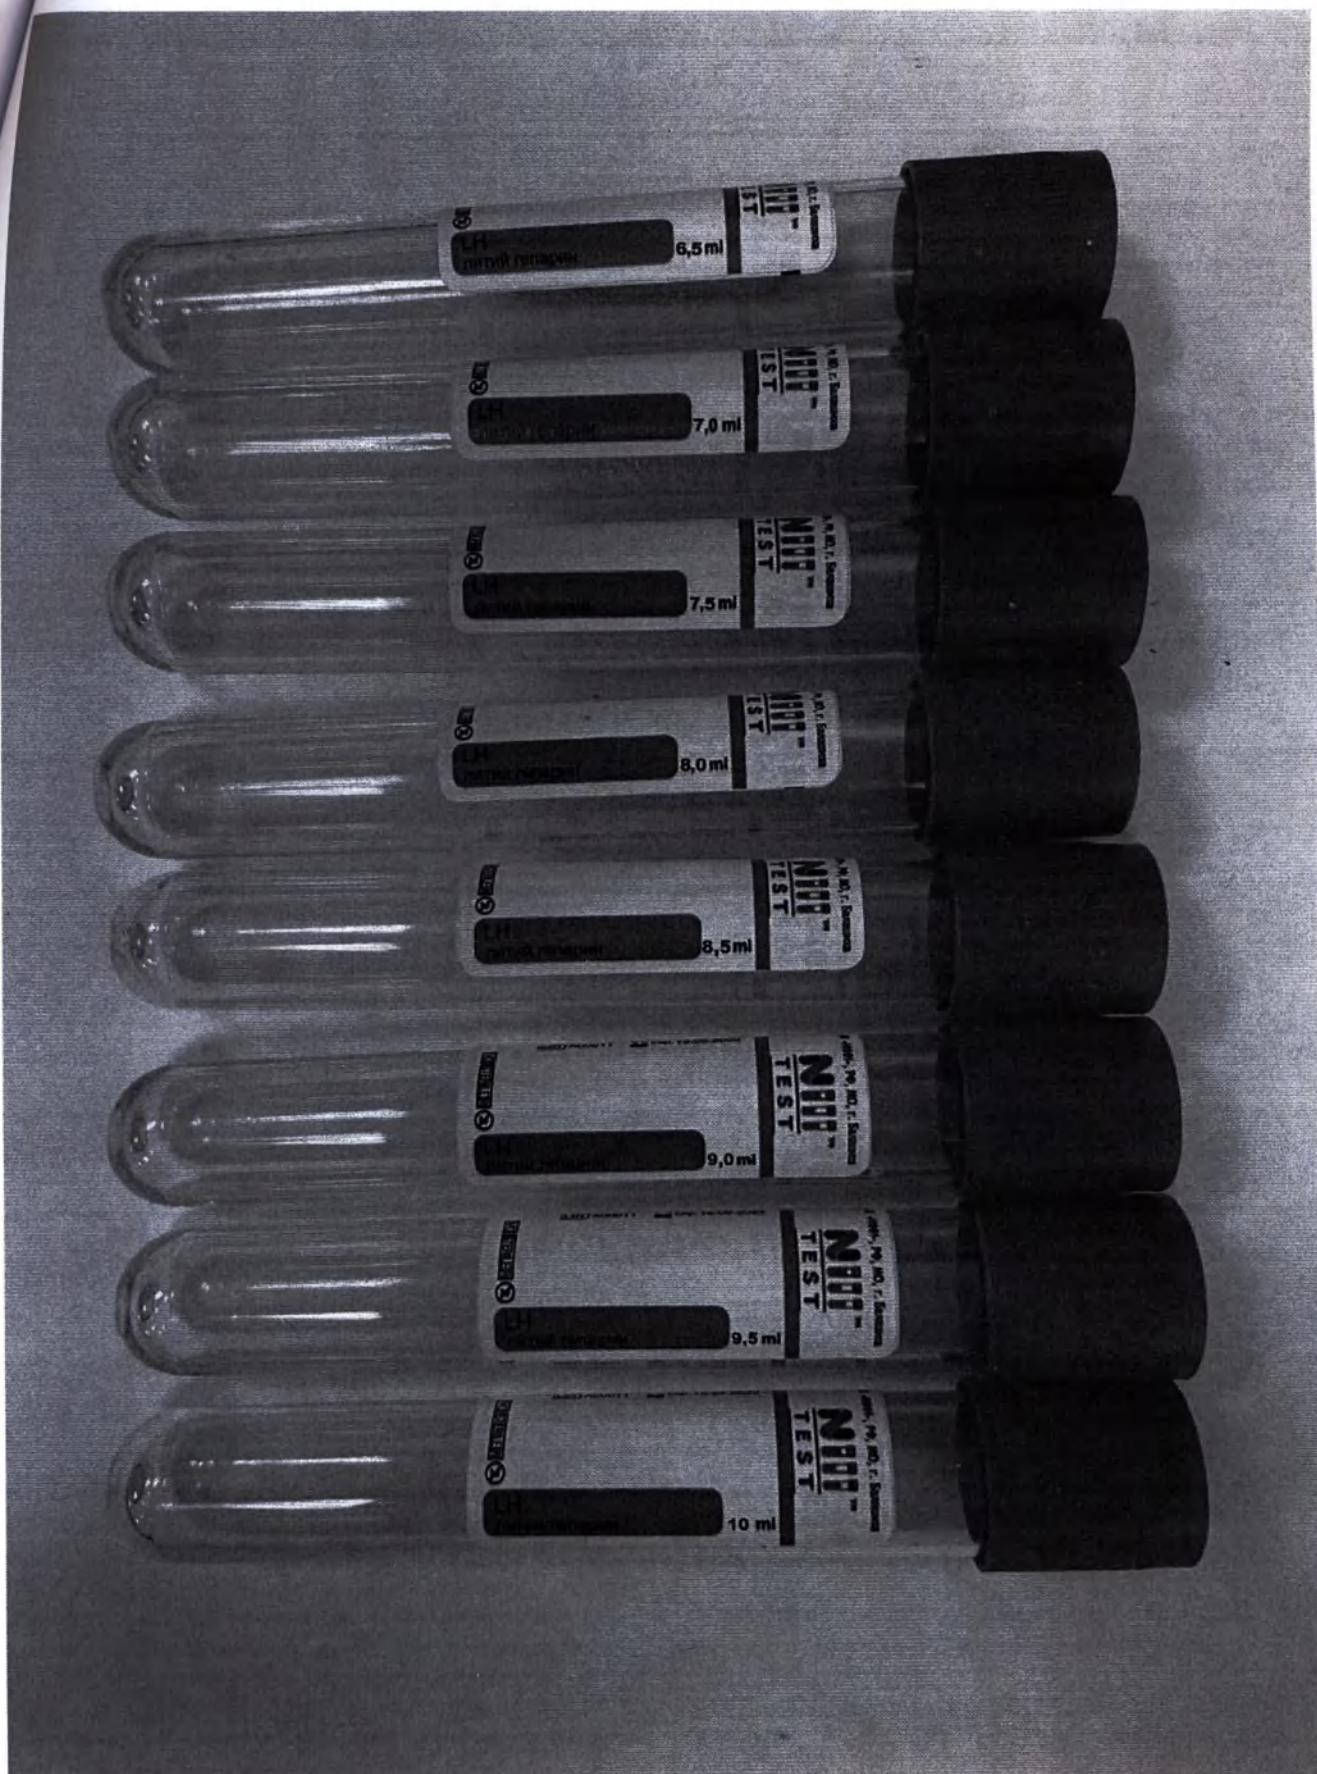


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин, 16х100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293630);

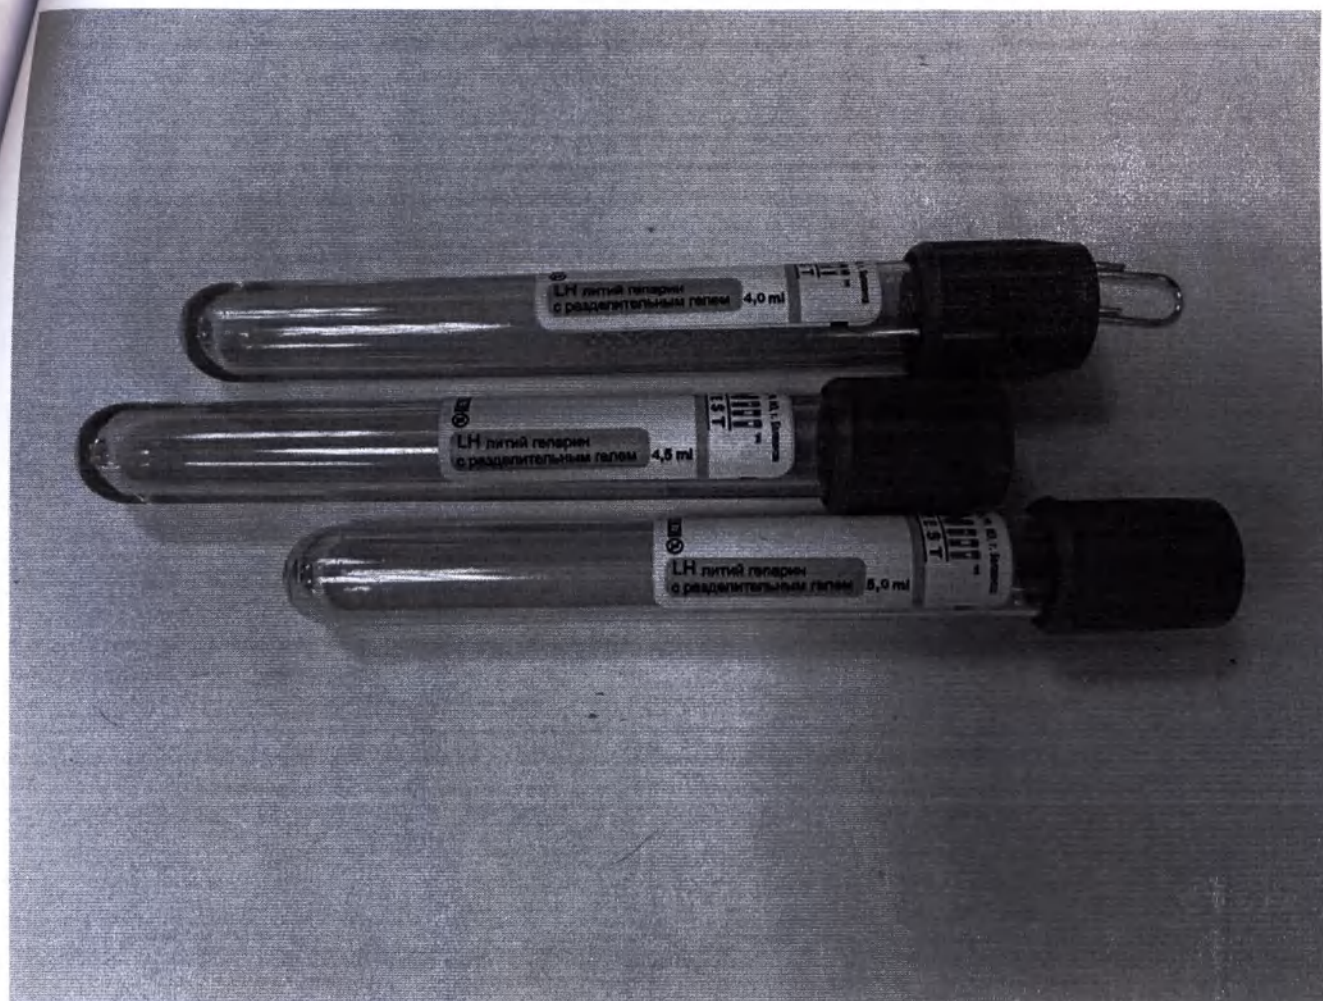


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 13x100 мм; 4,0 мл, 4,5 мл, 5,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293630);

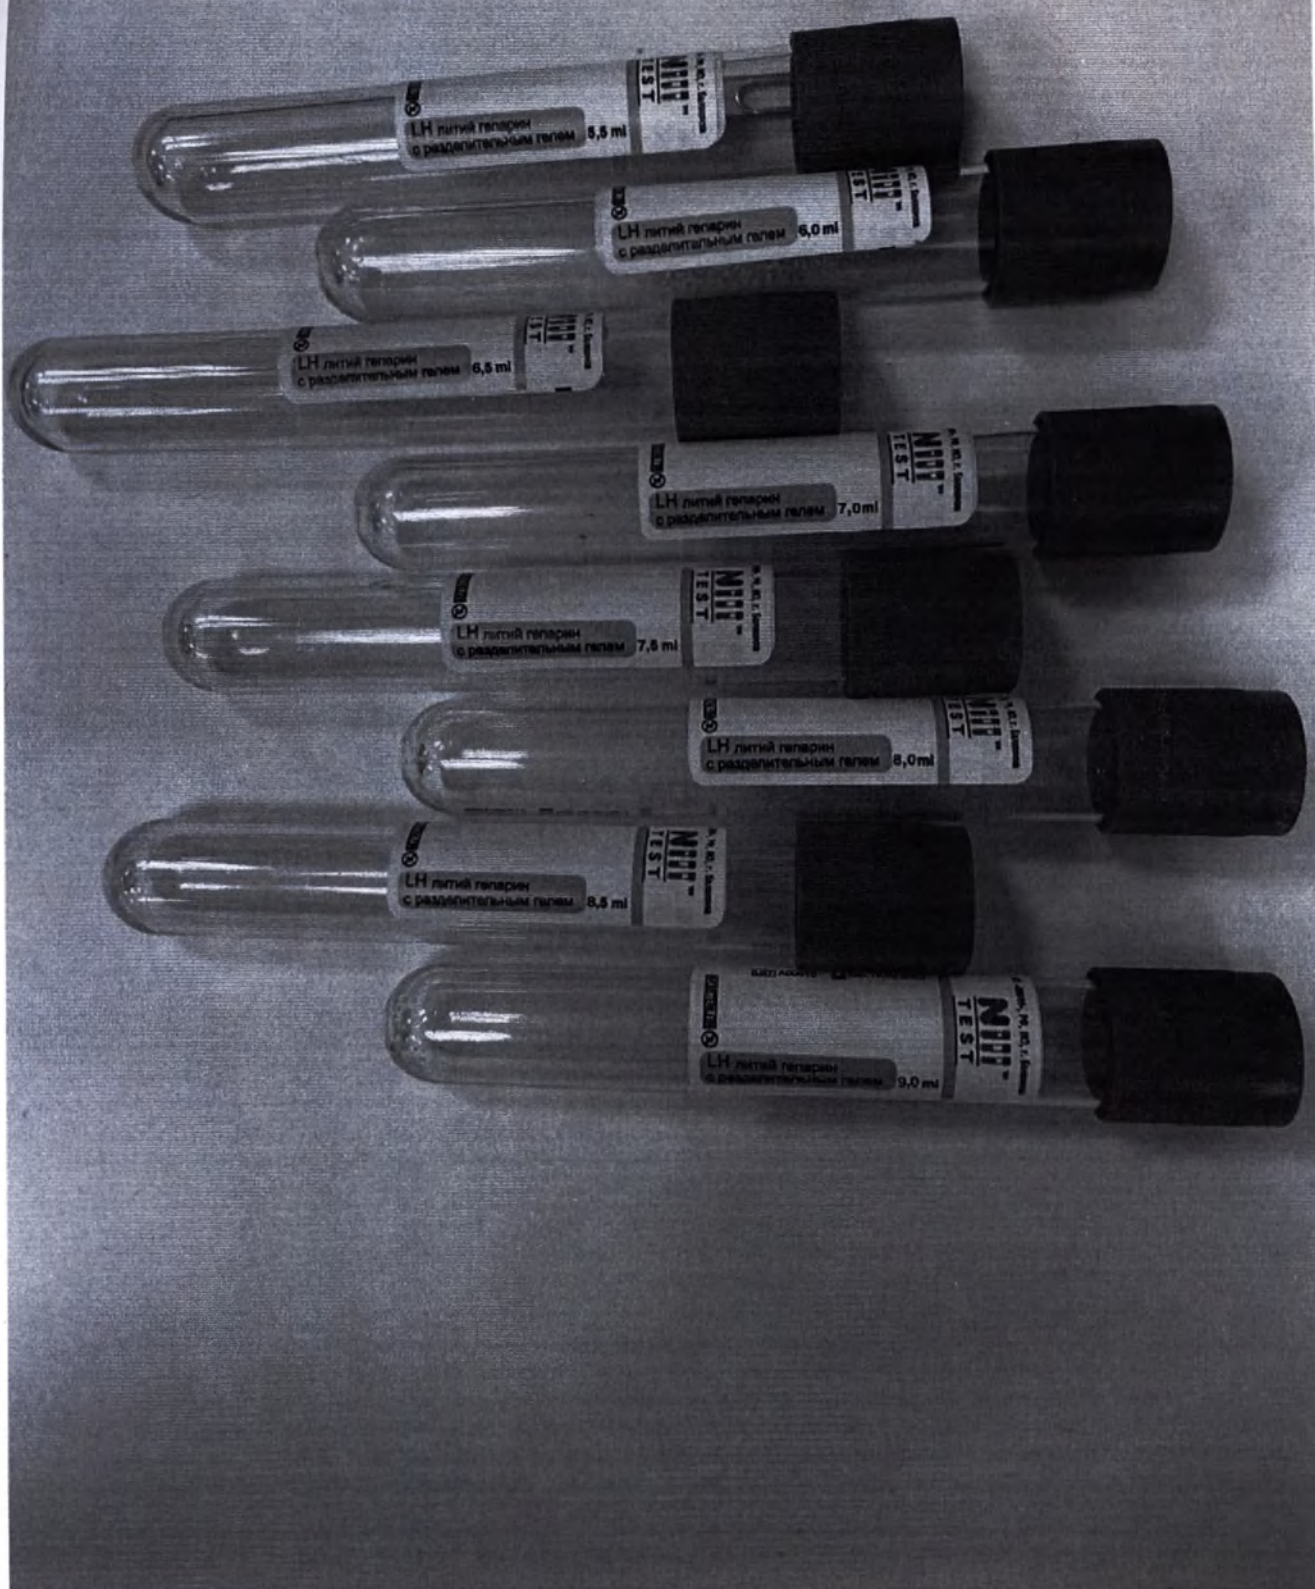

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 16x100 мм; 5,5 мл, 6,0 мл, 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293630);

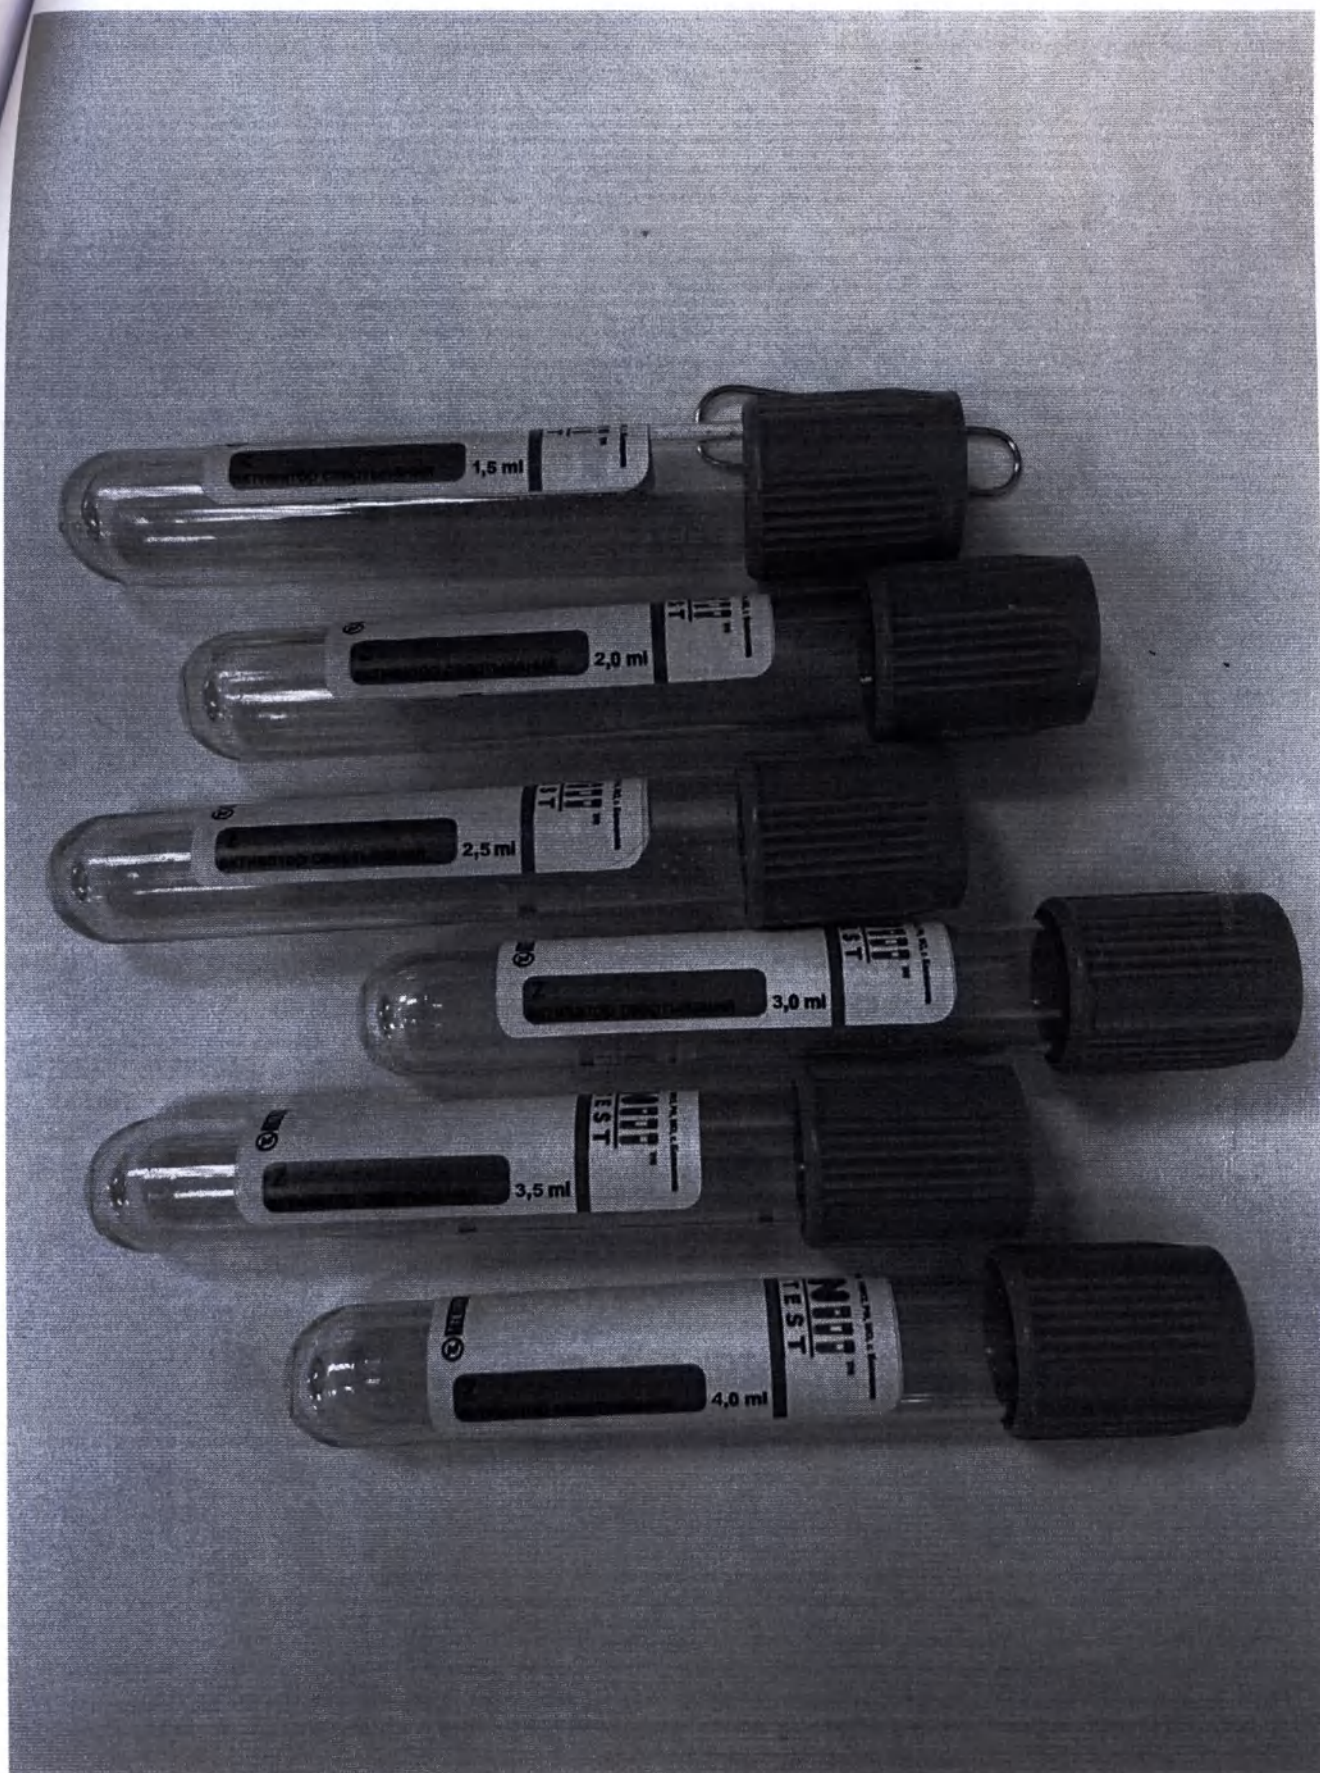

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIP TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 13х75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293570);

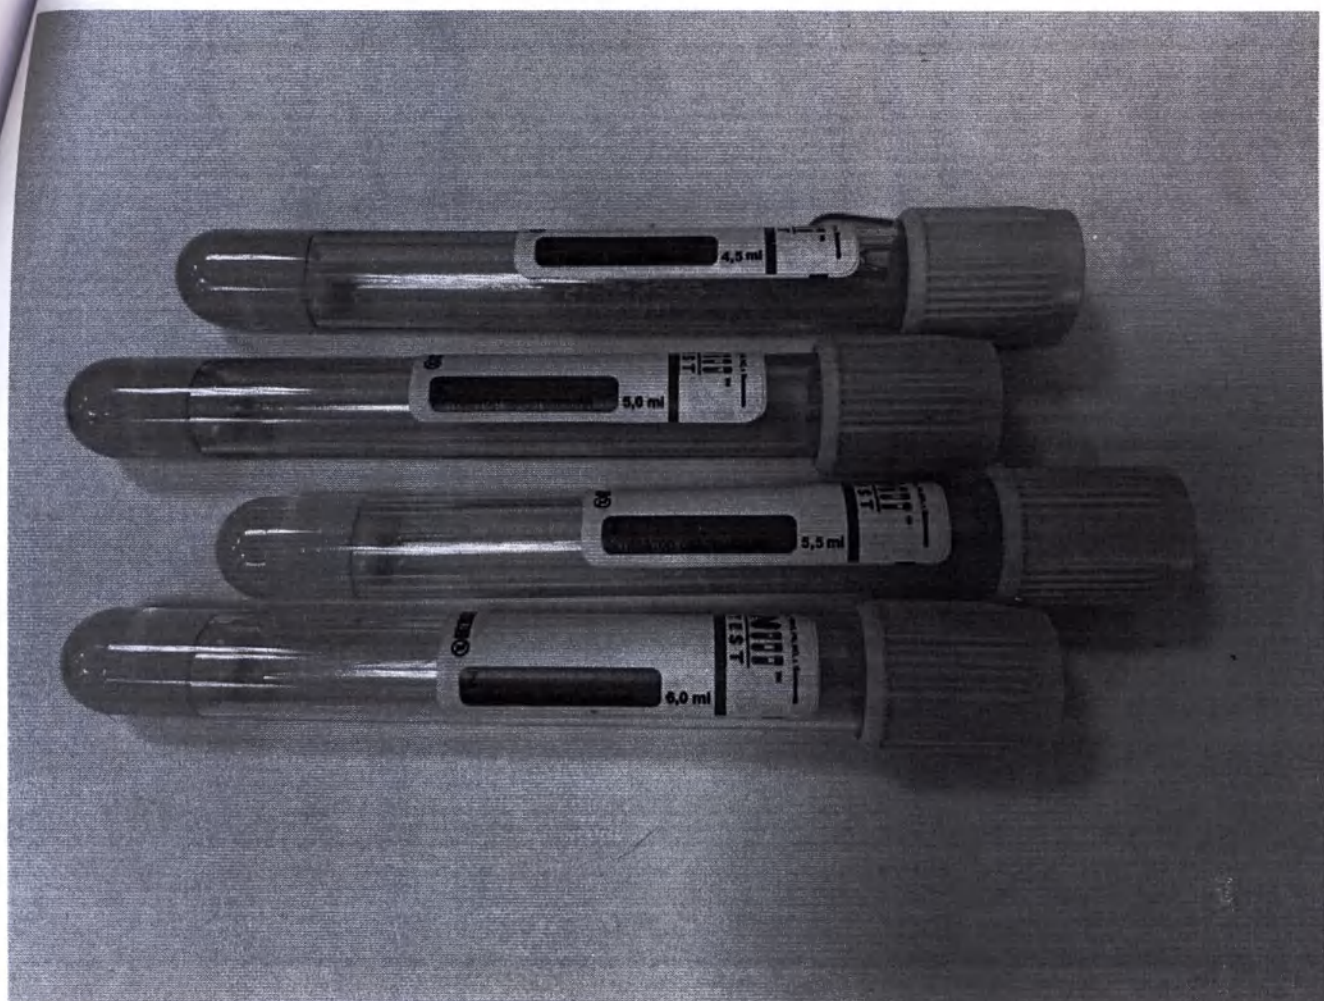


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293570);



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NPII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293570);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293640);

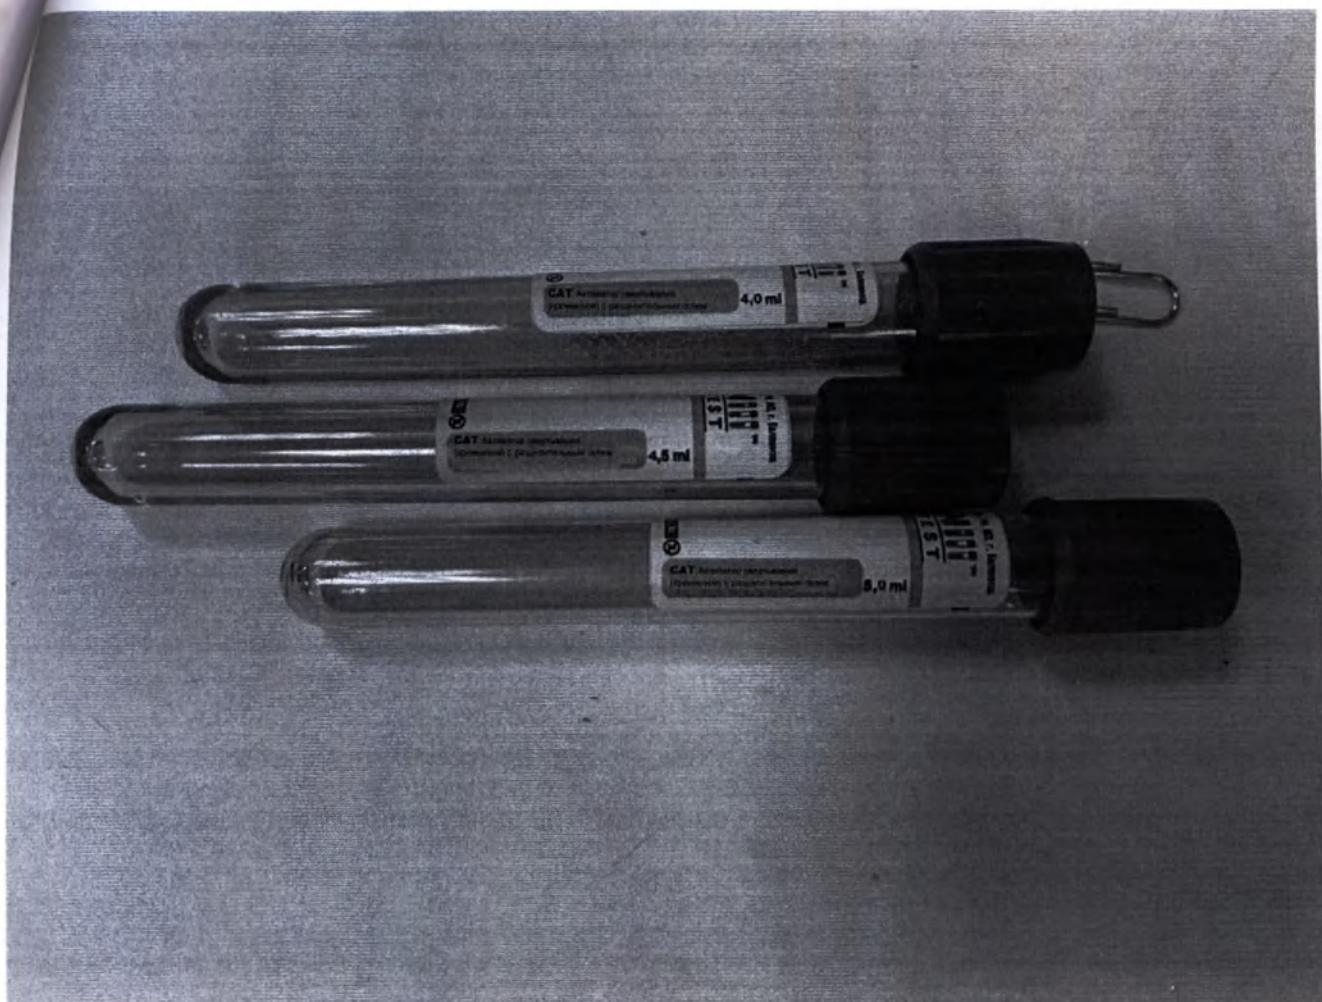


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIH TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 13x100 мм; 4,0 мл, 4,5 мл, 5,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293640);




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 16x100 мм; 5,5 мл, 6,0 мл, 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293640);

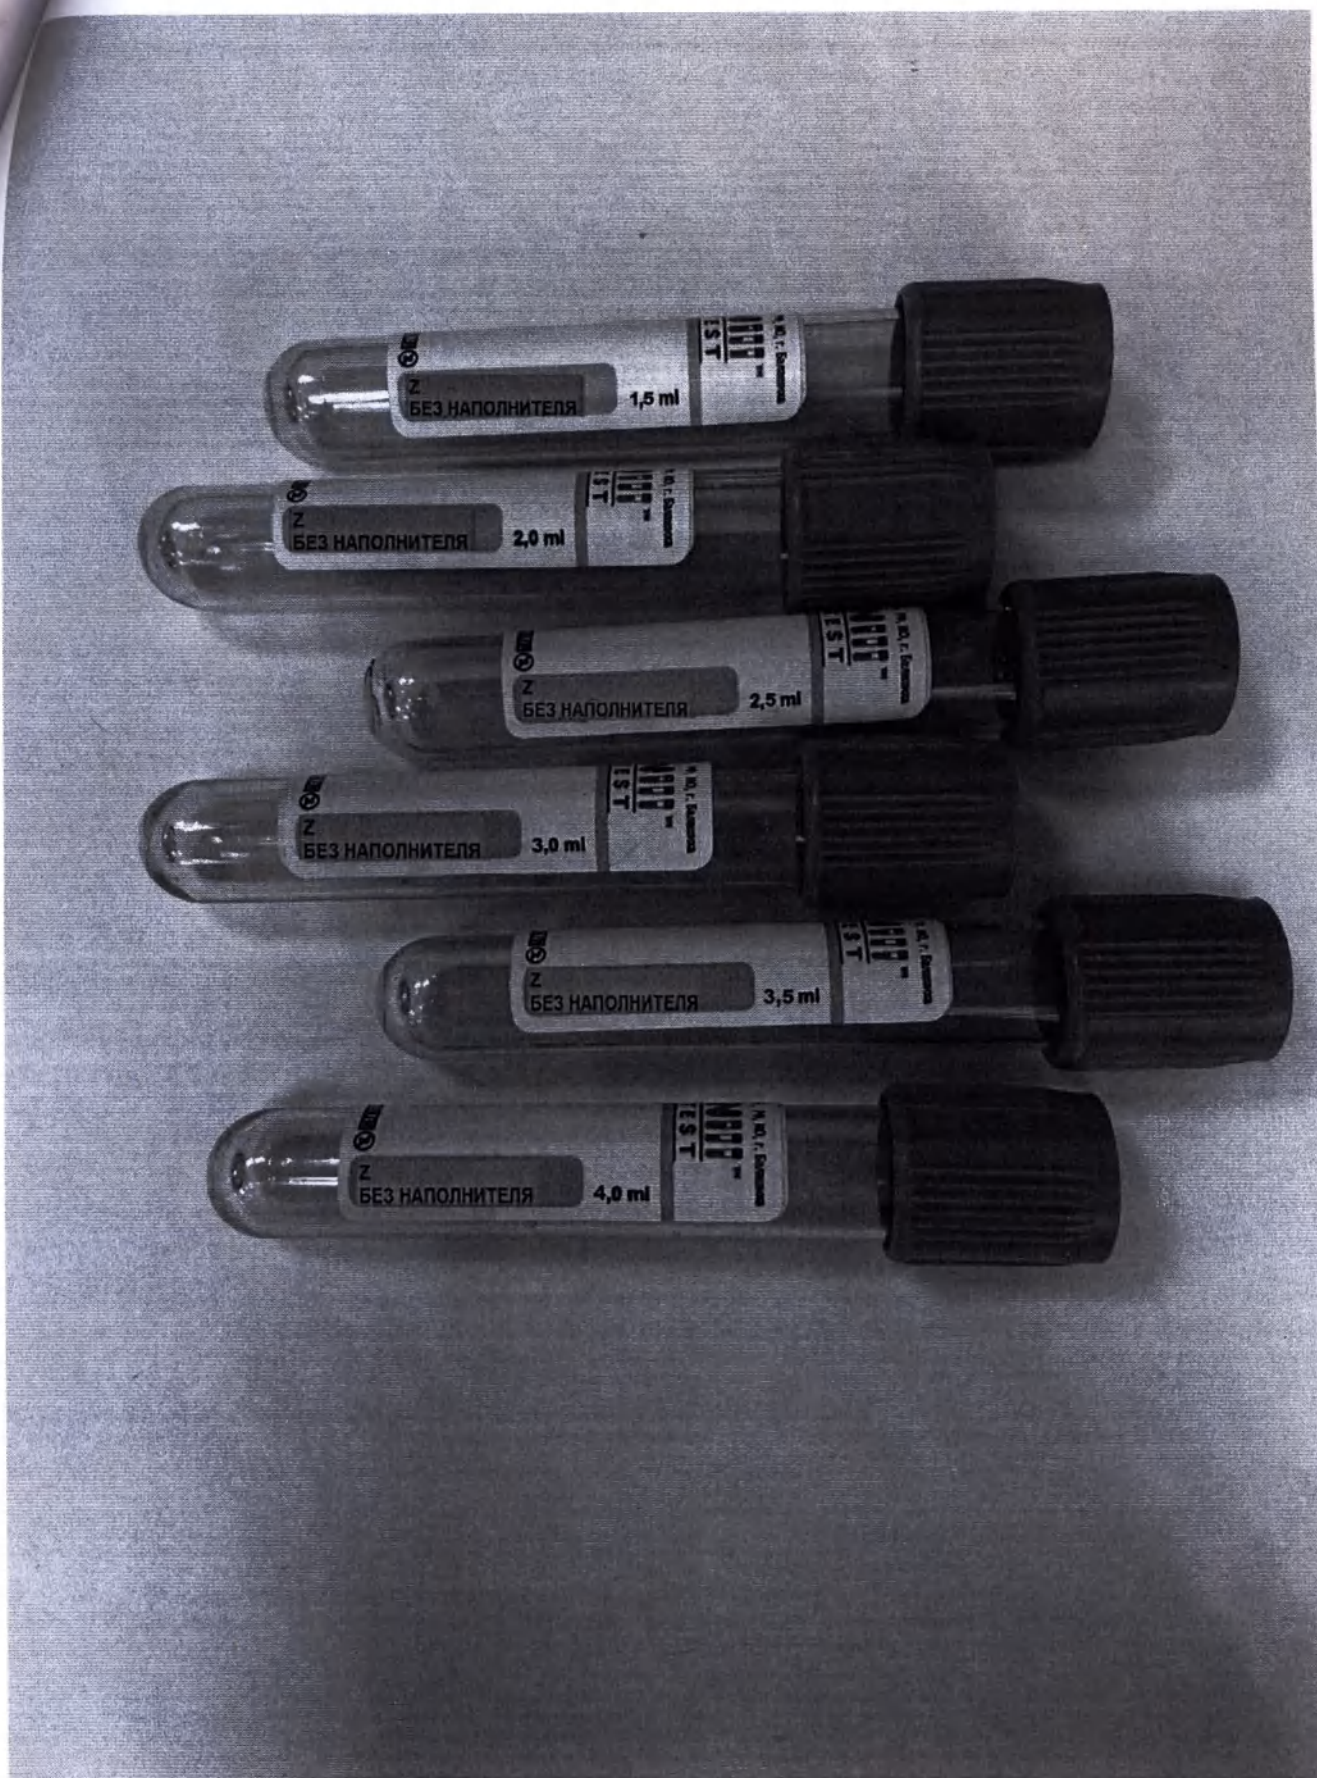


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» без наполнителя, 13x75 мм; 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл, 3,5 мл, 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293370);

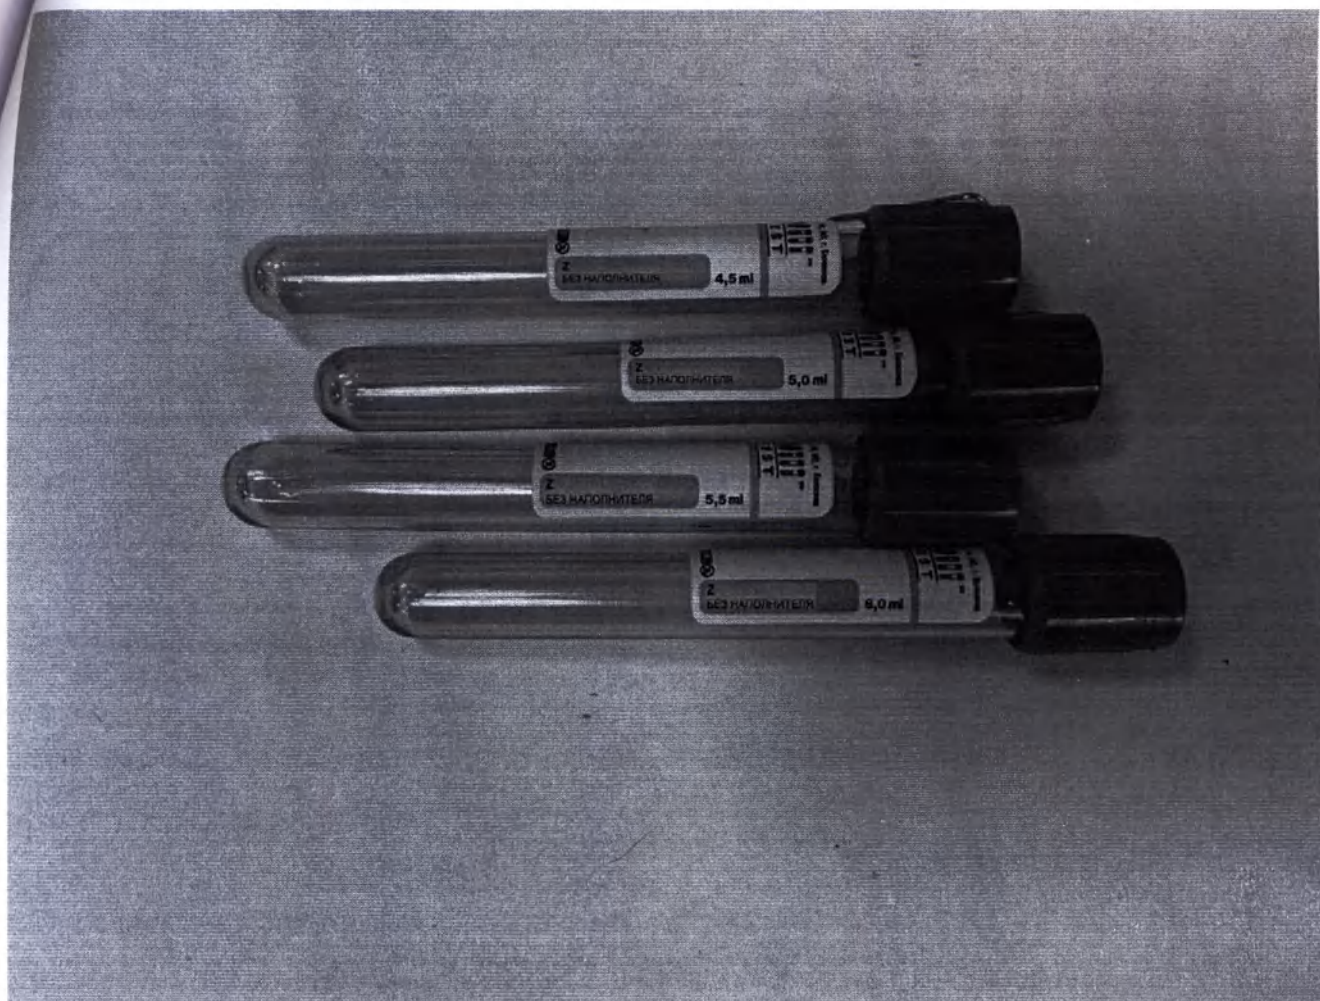

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NPII TEST» без наполнителя, 13x100 мм; 4,5 мл, 5,0 мл, 5,5 мл, 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293370);

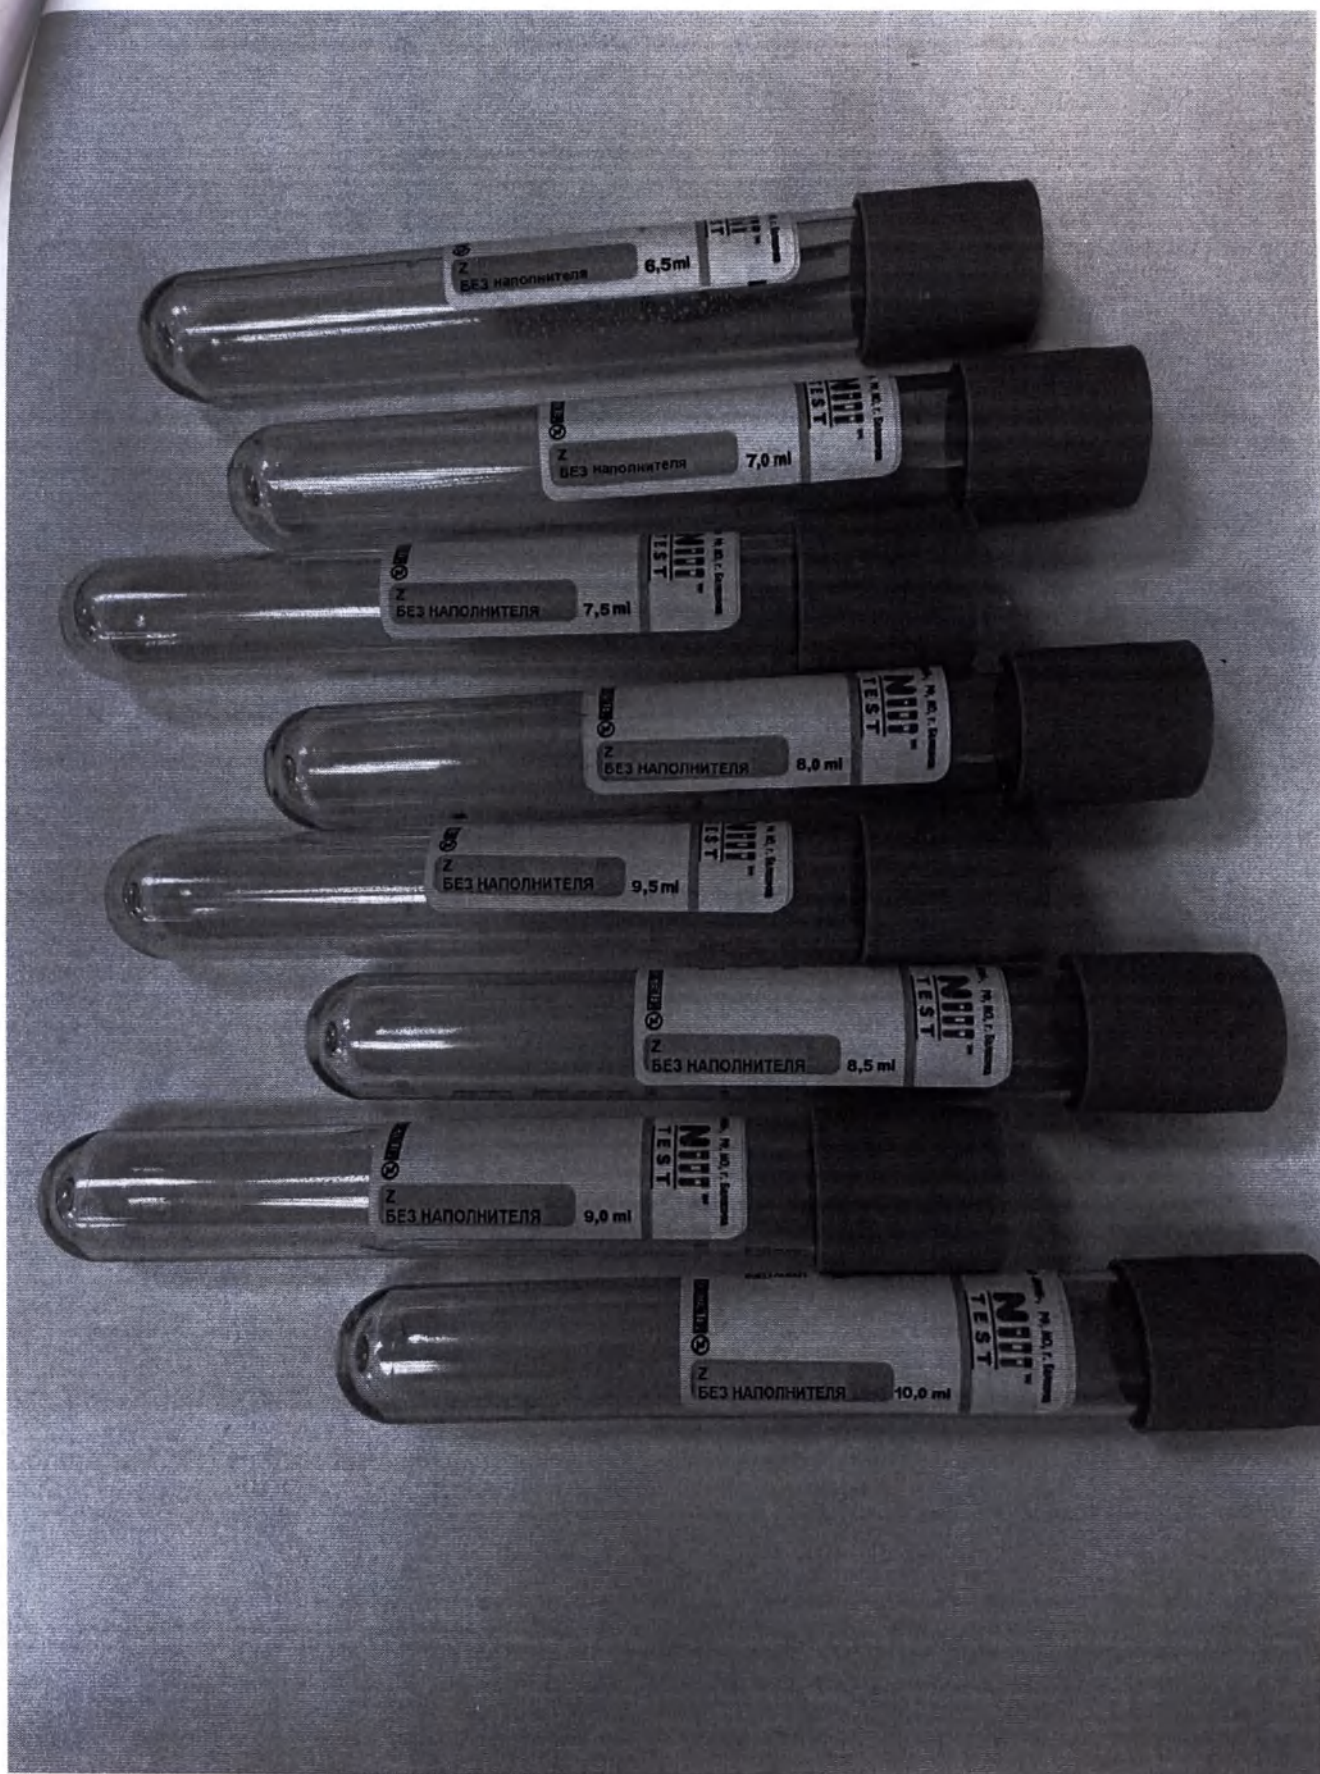

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» без наполнителя, 16x100 мм; 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл, 9,5 мл, 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293370);

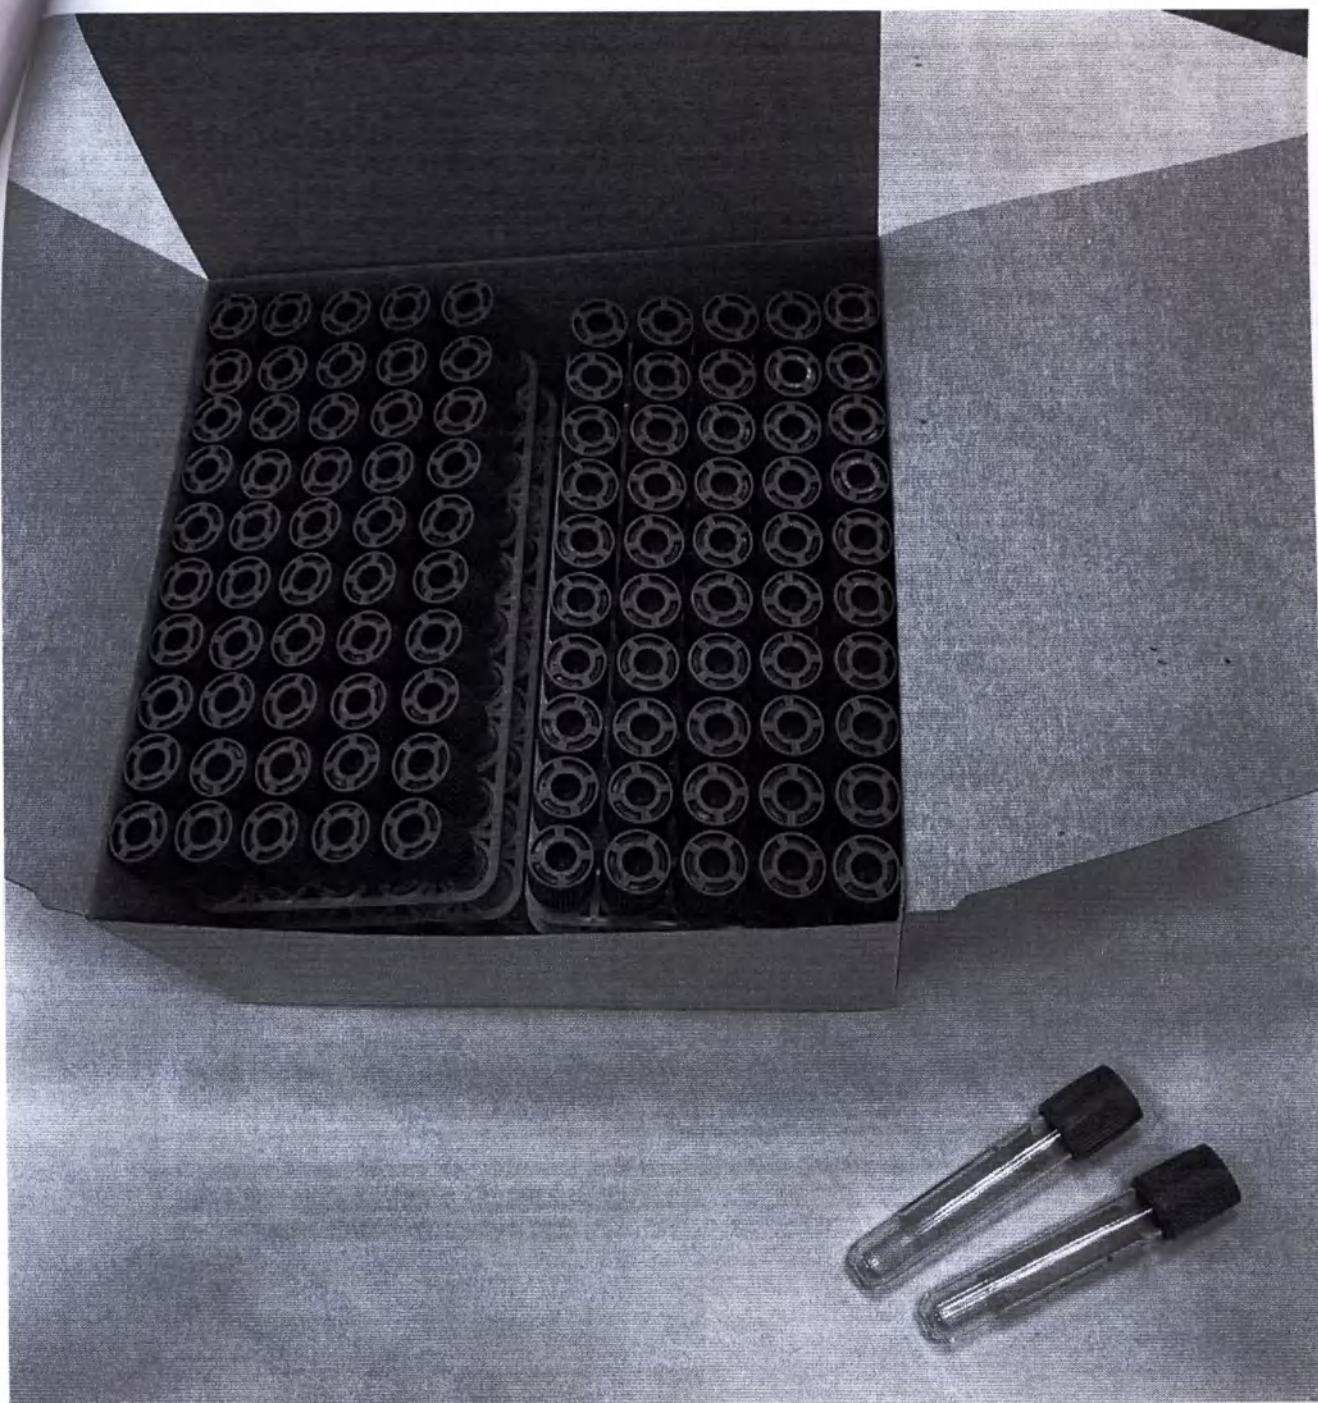

Общий вид МИ в потребительской упаковке для всех вариантов исполнения



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII
TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с
наполнителем К₂ЭДТА 13x75 мм, 4,0 мл, L0113075040
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.



A0002



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем К₂ЭДТА, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII
TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с
наполнителем К₂ЭДТА 13x100 мм, 6,0 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.



A0009



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем К₂ЭДТА 13x100 мм; 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII
TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с
наполнителем К₂ЭДТА 16x100 мм, 7,5 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0021



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем
К₂ЭДТА 16x100 мм; 7,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII
TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с
наполнителем К₂ЭДТА с разделительным гелем 13x75 мм, 2,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0020



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем
К₂ЭДТА с разделительным гелем, 13x75 мм; 2,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код
вида 293630);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NIII
TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с
наполнителем К₂ЭДТА с разделительным гелем 13x100 мм, 5,0 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0020



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем К₂ЭДТА с разделительным гелем, 13x100 мм; 4,0 мл, 4,5 мл, 5,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293630);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NIII
TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с
наполнителем К₂ЭДТА с разделительным гелем 16x100 мм, 7,5 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0016



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем К₂ЭДТА с разделительным гелем, 16x100 мм; 5,5 мл, 6,0 мл, 6,5 мл, 7,0 мл, 7,5 мл, 8,0 мл, 8,5 мл, 9,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021; (код вида 293630);



Общий вид потребительской упаковки с маркировкой на примере: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем КЭДТА, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем КЭДТА, 13x100 мм; 5,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);

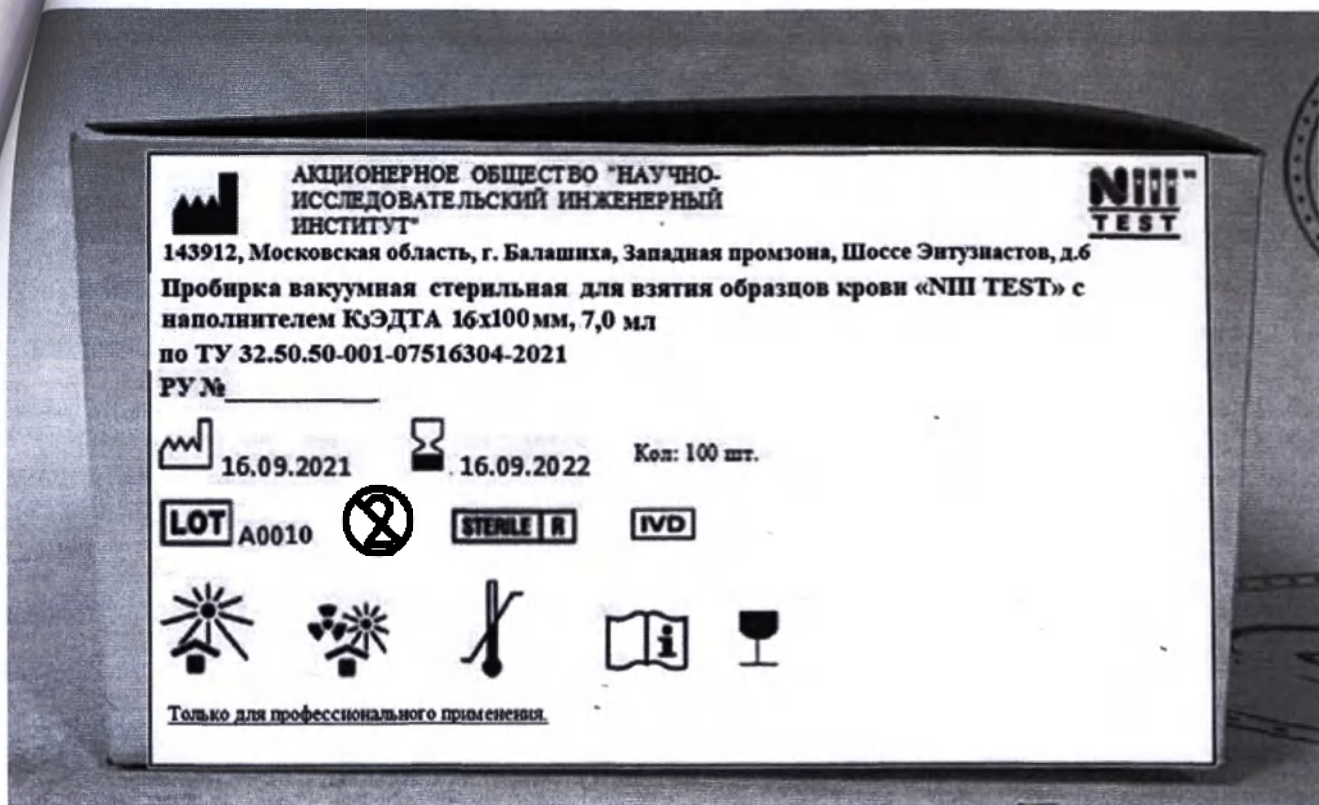


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем КЗЭДТА, 16x100 мм; 7,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



Общий вид потребительской упаковки с маркировкой на примере: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 13x75 мм; 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

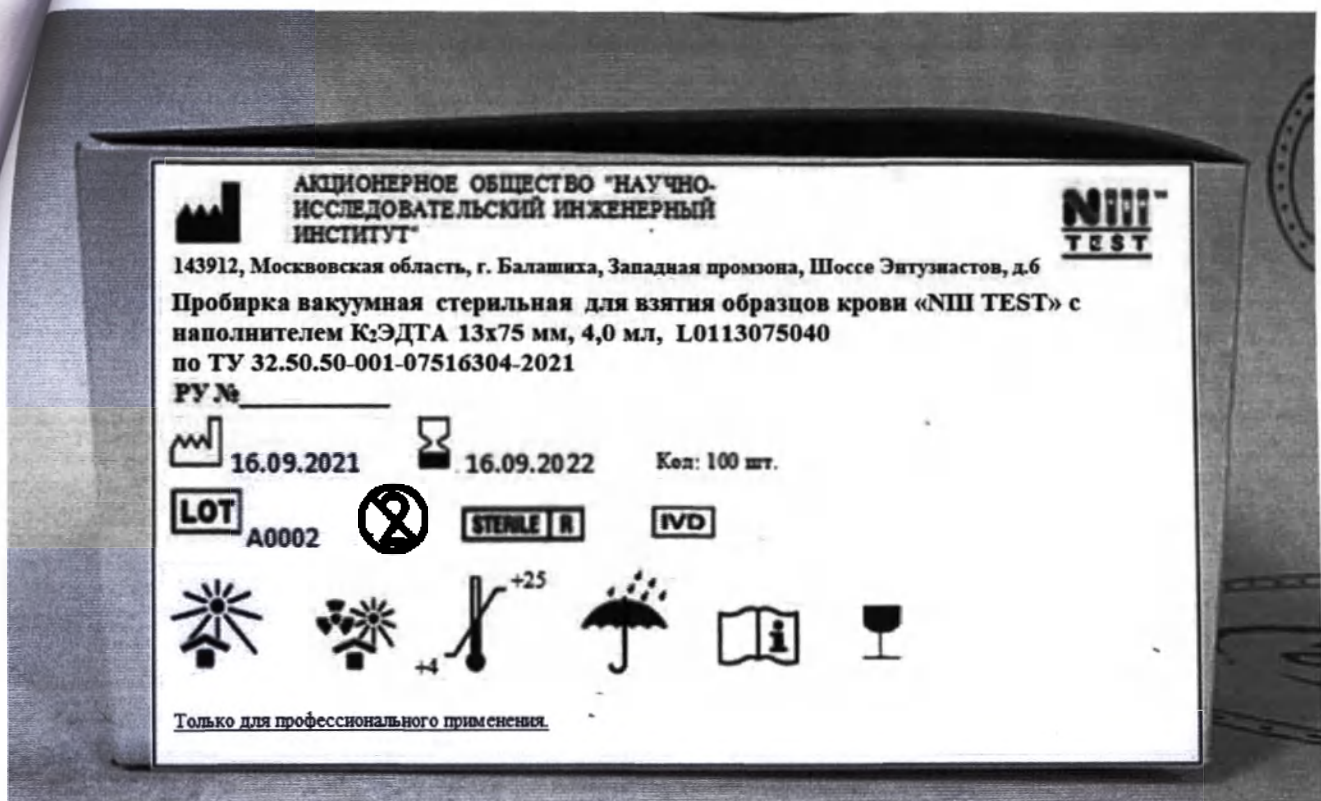

Общий вид потребительской упаковки с маркировкой на примере: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем К₂ЭДТА, 13х75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

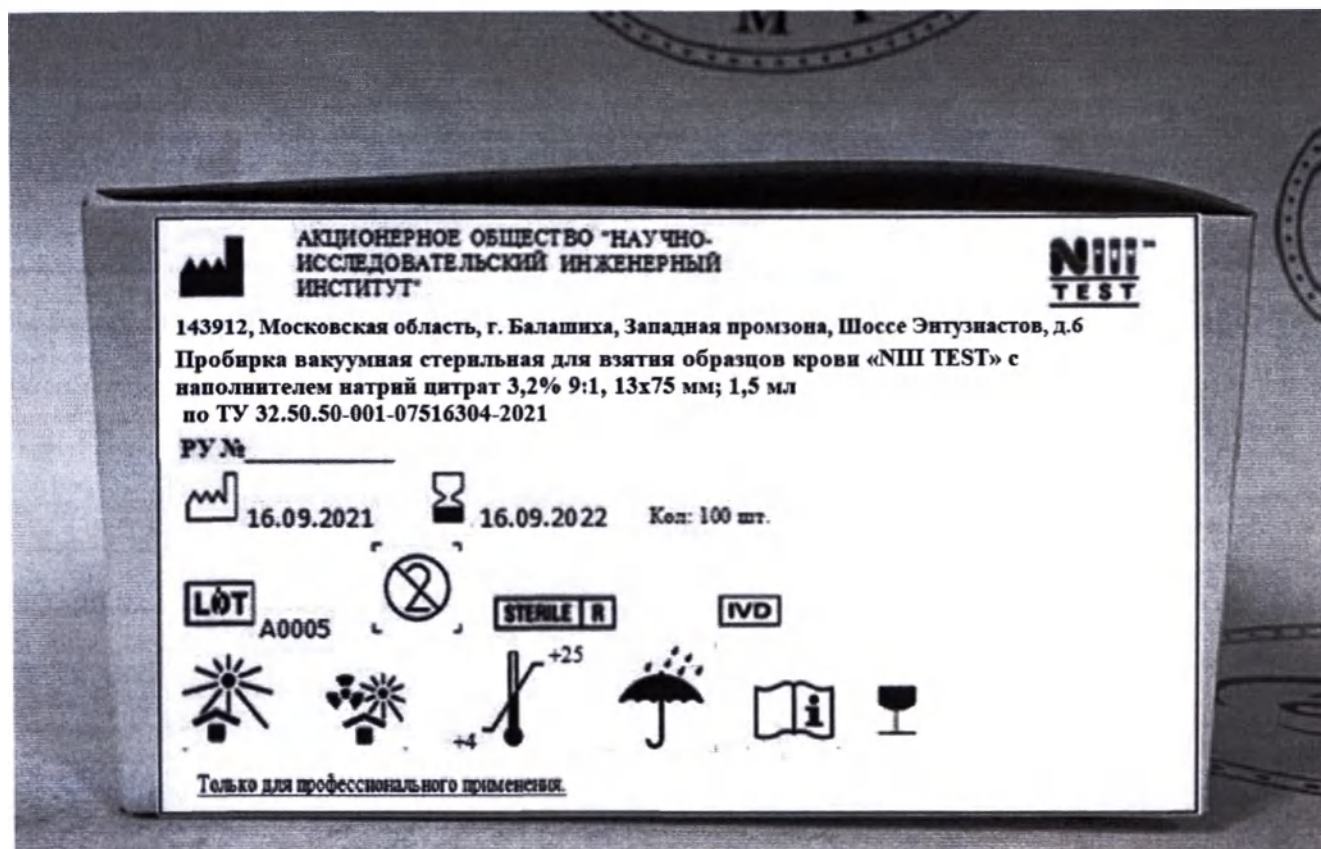

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 13х75 мм; 1,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

**NII
TEST**

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6
Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с
наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 13x100 мм; 5,5 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0006



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 13x100 мм; 5,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

**NII
TEST**

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6
Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с
наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 16x100 мм; 8,5 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0006



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,2% 9:1, 16x100 мм, 8,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021 (код вида 293420);



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с

наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x75 мм; 2,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.



A0013



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x75 мм; 2,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с

наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x100 мм; 6,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.



A0014



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 13x100 мм; 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с

наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 16x100 мм; 10,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.


LOT

A0016



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 9:1, 16x100 мм; 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с

наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x75 мм; 4,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0018



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с

наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x100 мм; 5,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.

LOT

A0019



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 13x100 мм; 5,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с

наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 16x100 мм; 10,0 мл

по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.


LOT

A0021



STERILE R

IVD



Только для профессионального применения.

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем натрий цитрат 3,8% 4:1, 16x100 мм; 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6
Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x75 мм; 2,5 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.


LOT

A0048



STERILE

IVD



Только для профессионального применения

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x75 мм; 2,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ"

NII TEST

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.6
Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x100 мм; 5,0 мл
по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

РУ № _____



16.09.2021



16.09.2022

Кол: 100 шт.


LOT

A0049




STERILE

IVD



Только для профессионального применения


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 13x100 мм; 5,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

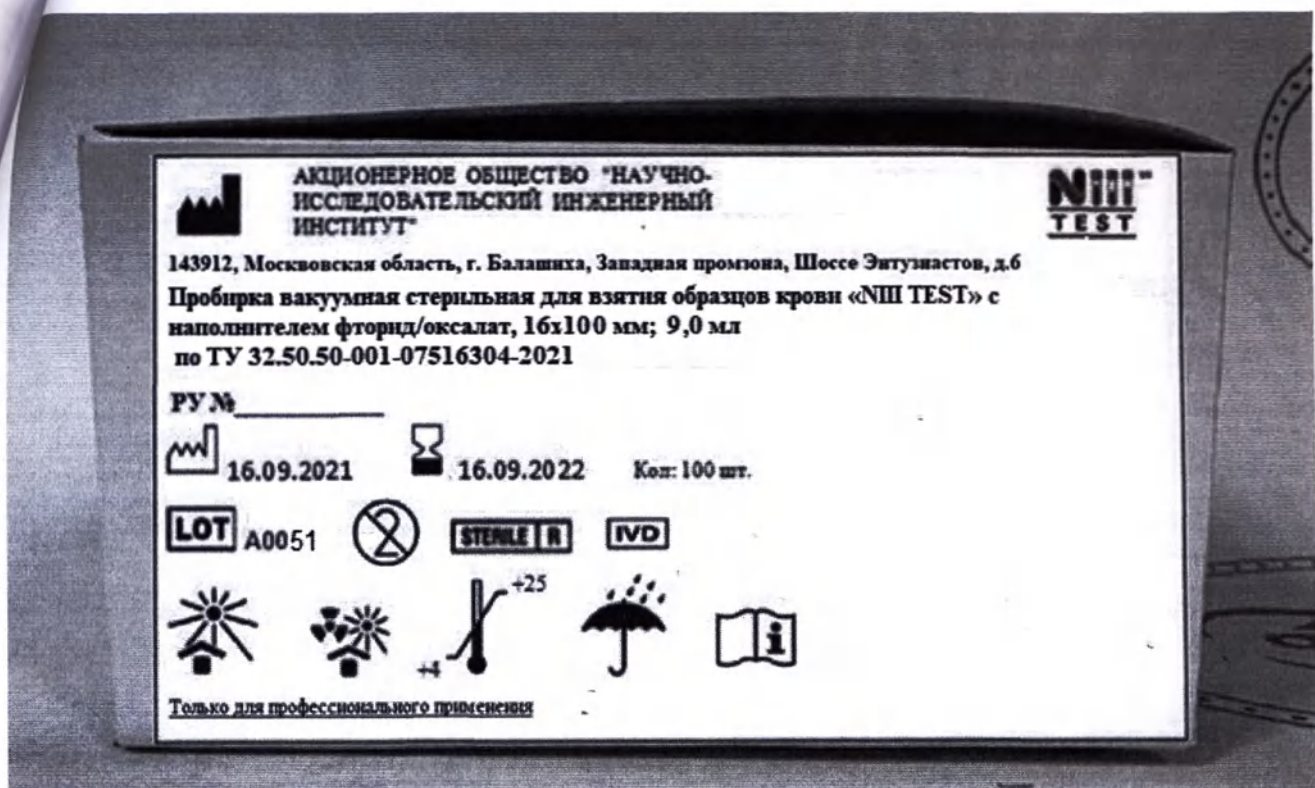

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид/оксалат, 16x100 мм; 9,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Общий вид потребительской упаковки с маркировкой на примере: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид натрия и Na₂ЭДТА, 13x75 мм; 2,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

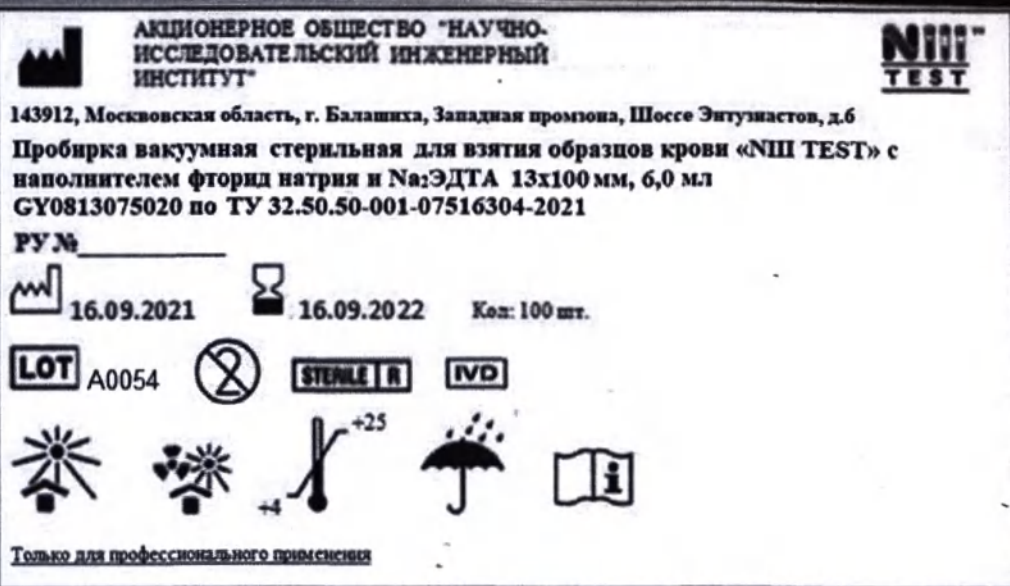


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид натрия и Na₂ЭДТА, 13x100 мм; 6,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем фторид натрия и Na₂ЭДТА, 16x100 мм; 6,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

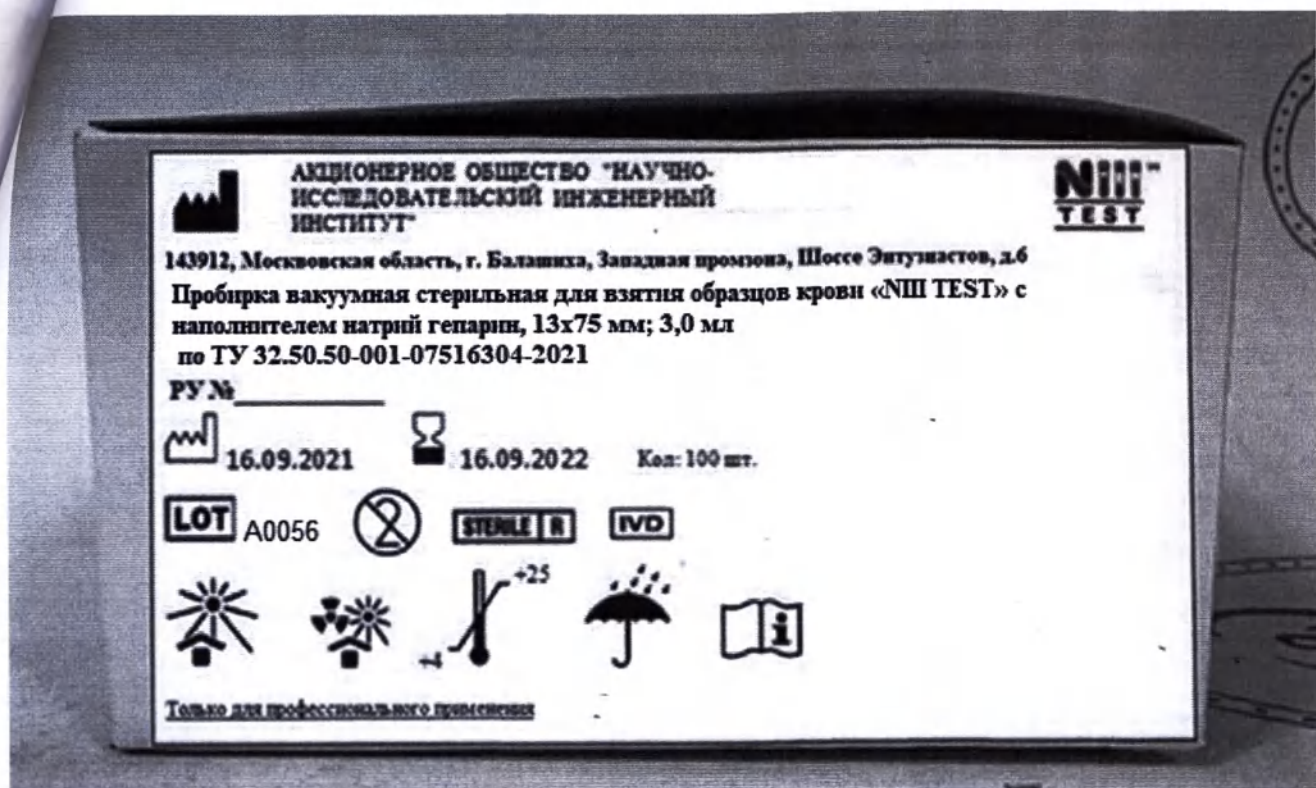


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

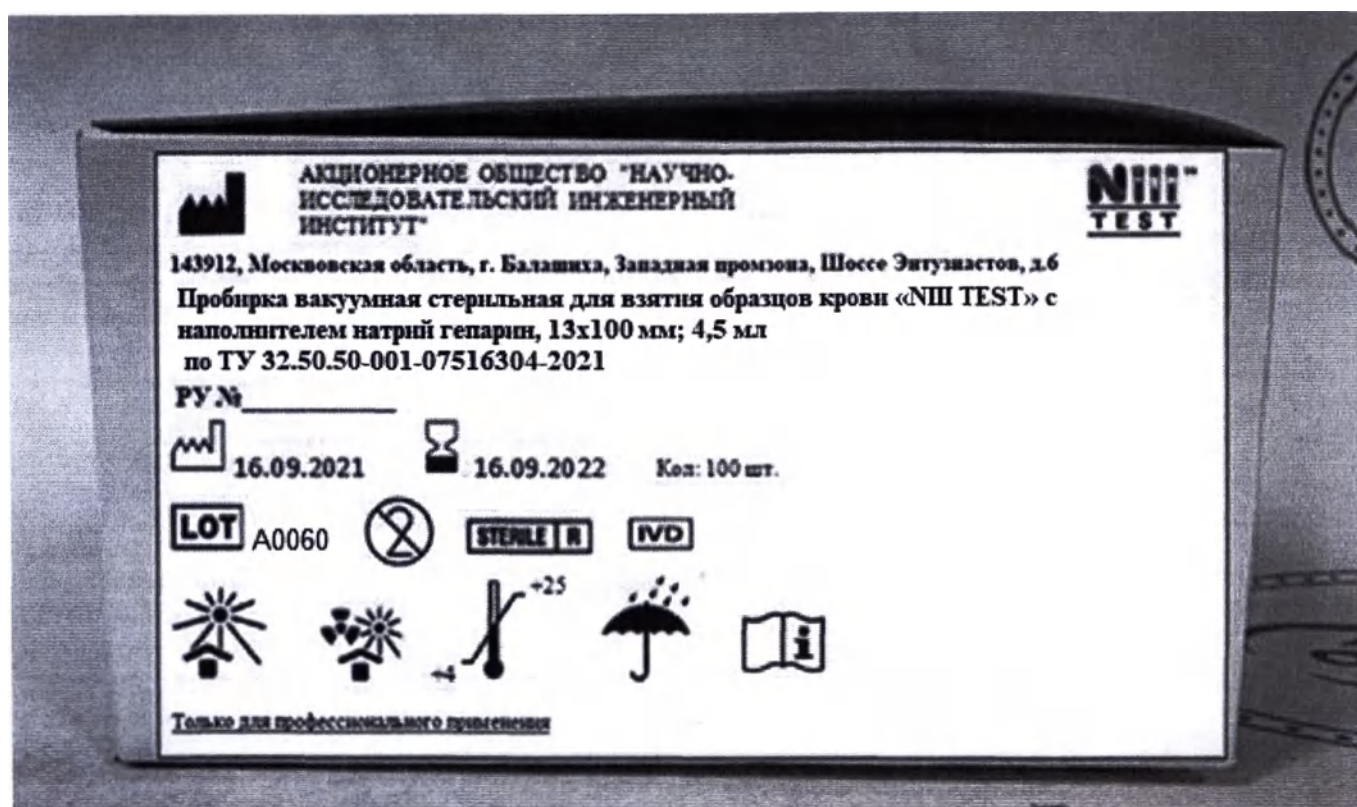

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 13x100 мм; 4,5 мл, по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

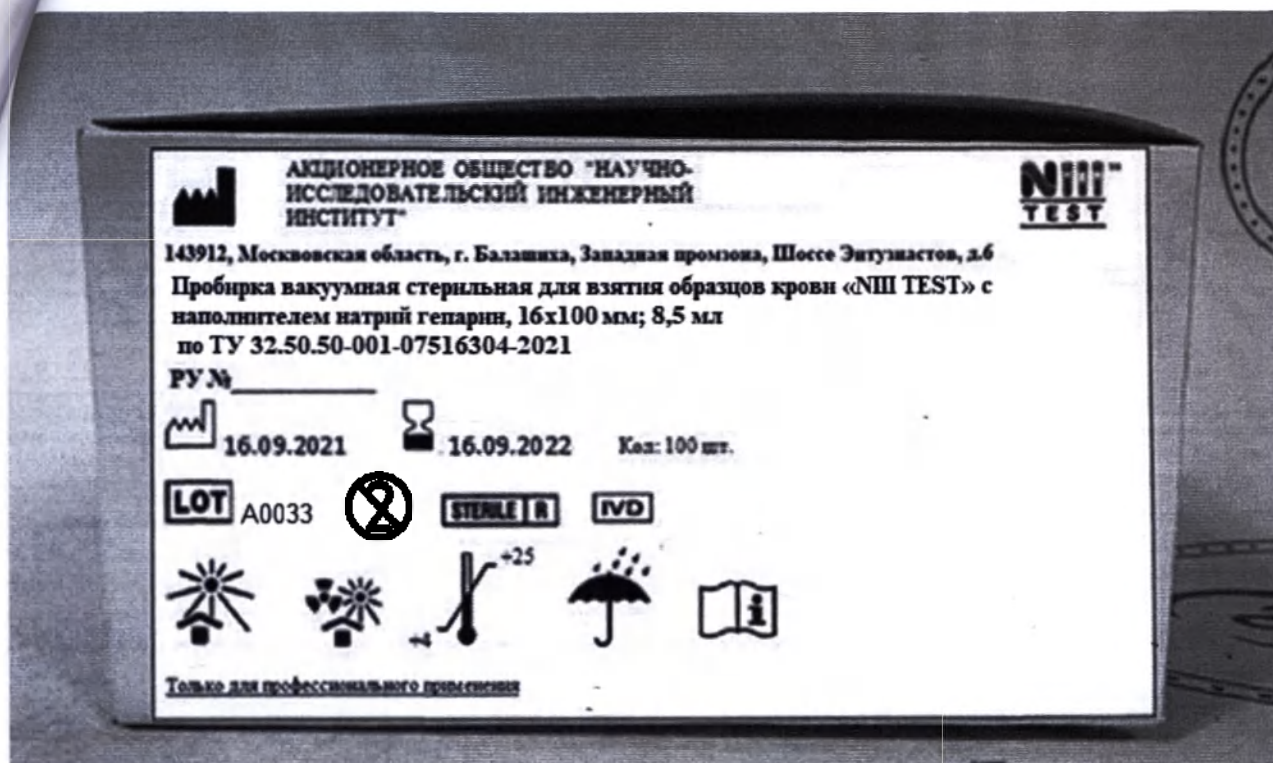

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем натрий гепарин, 16x100 мм; 8,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

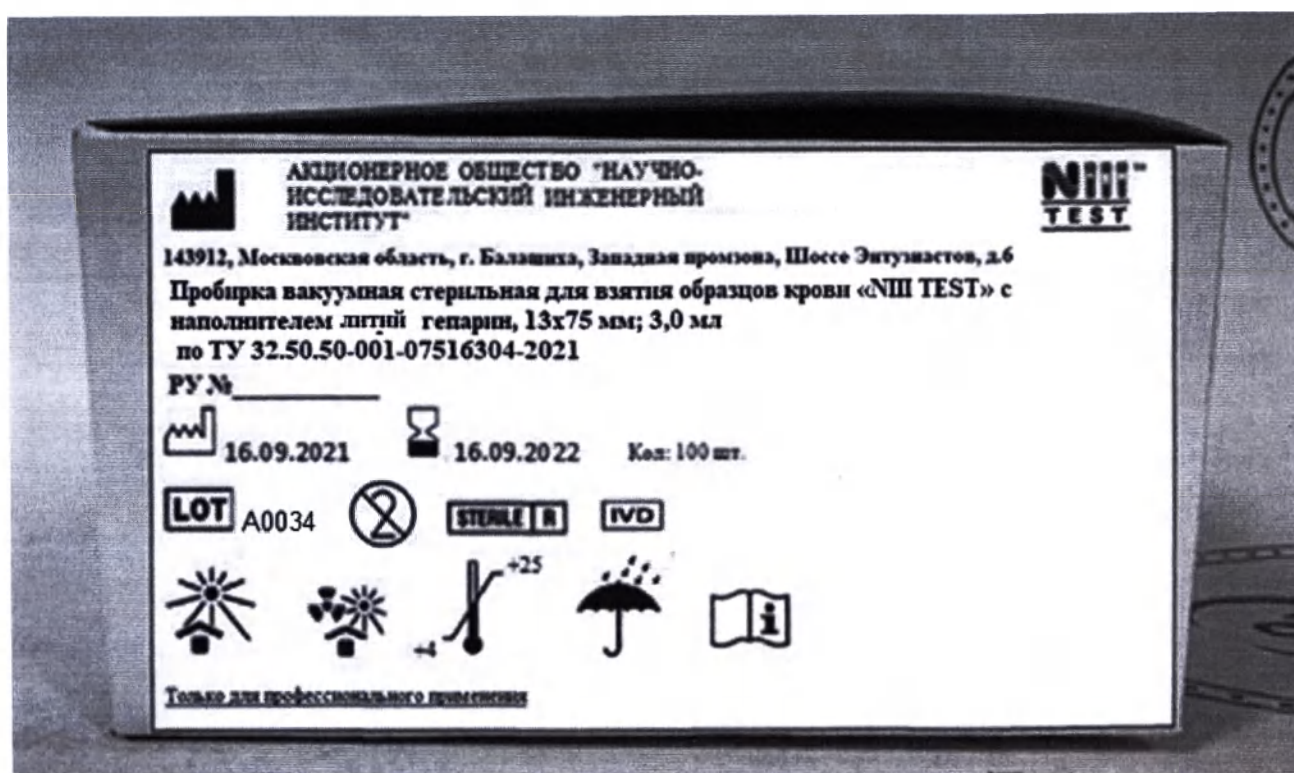

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин, 13x100 мм; 4,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин, 16x100 мм; 8,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 13x75 мм; 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

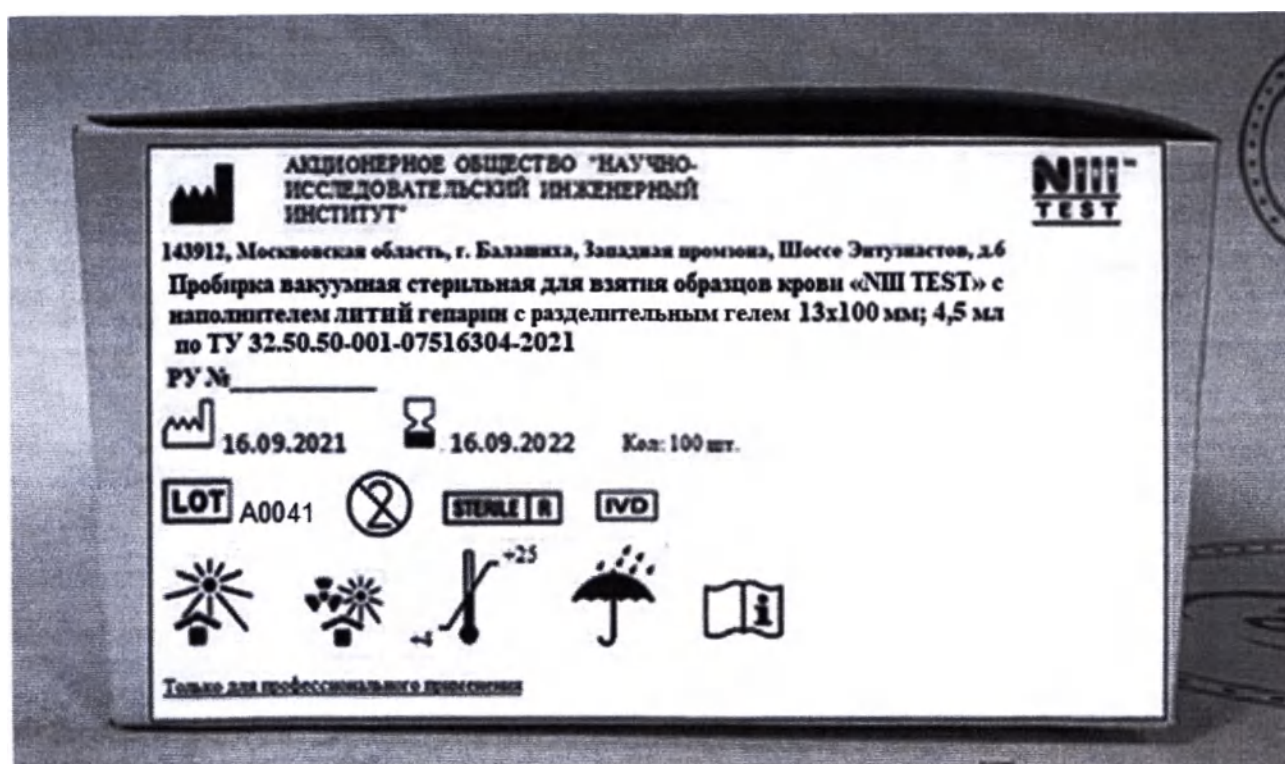


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 13x100 мм; 4,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

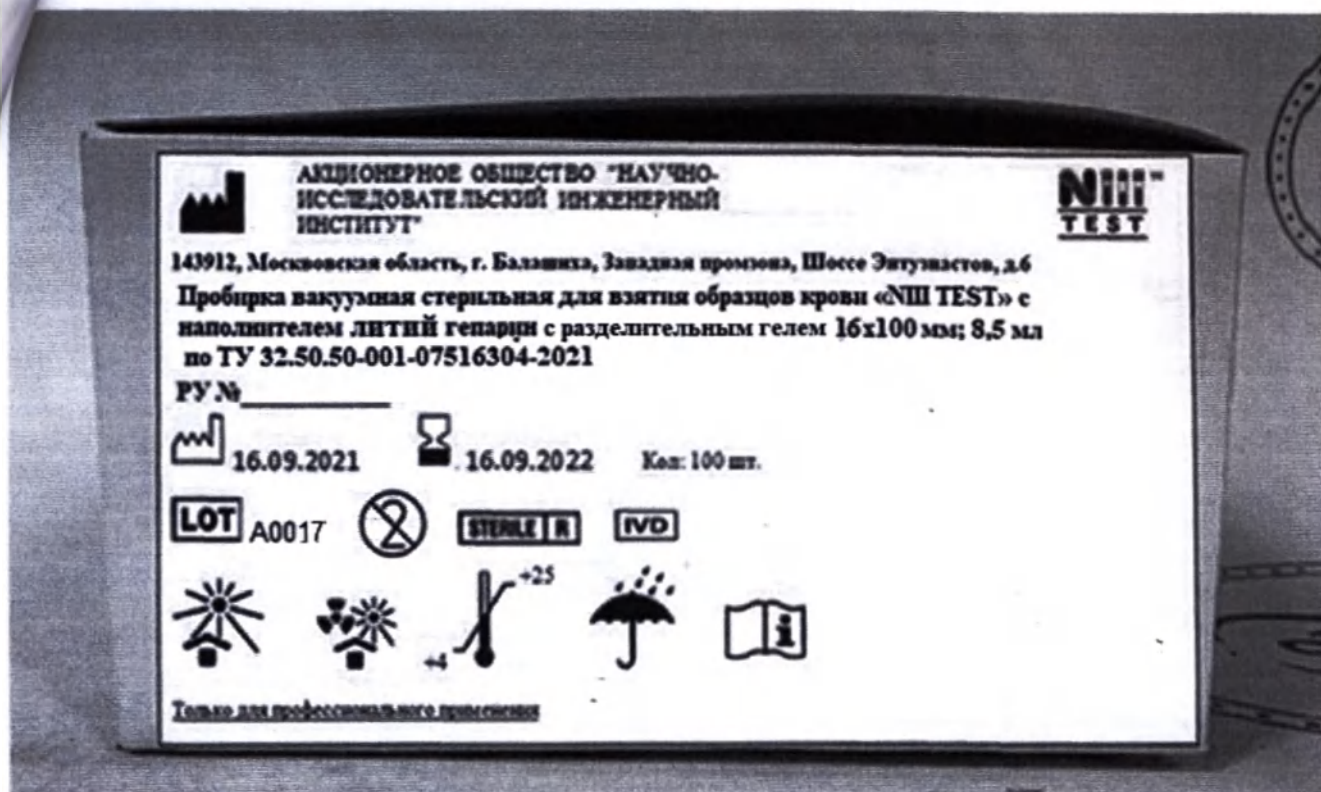


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем литий гепарин с разделительным гелем, 16x100 мм; 8,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 3,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

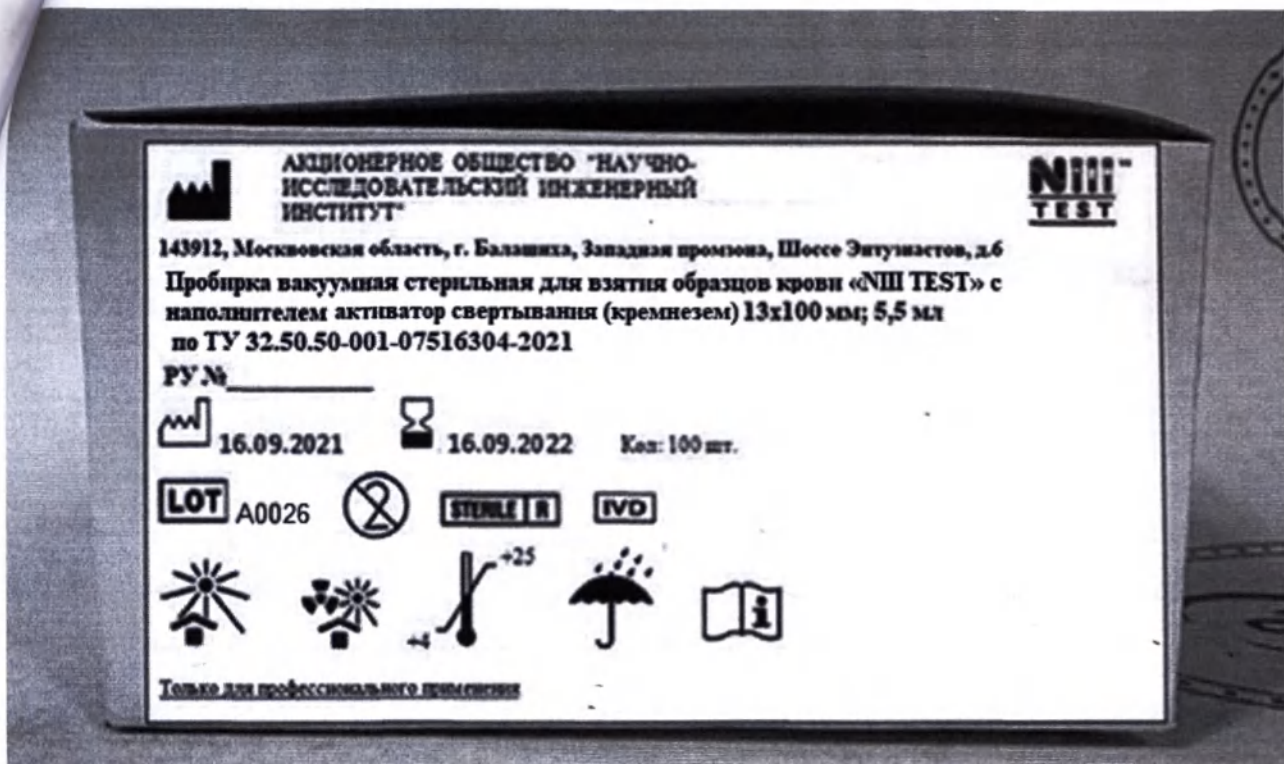

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 13x100 мм; 5,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

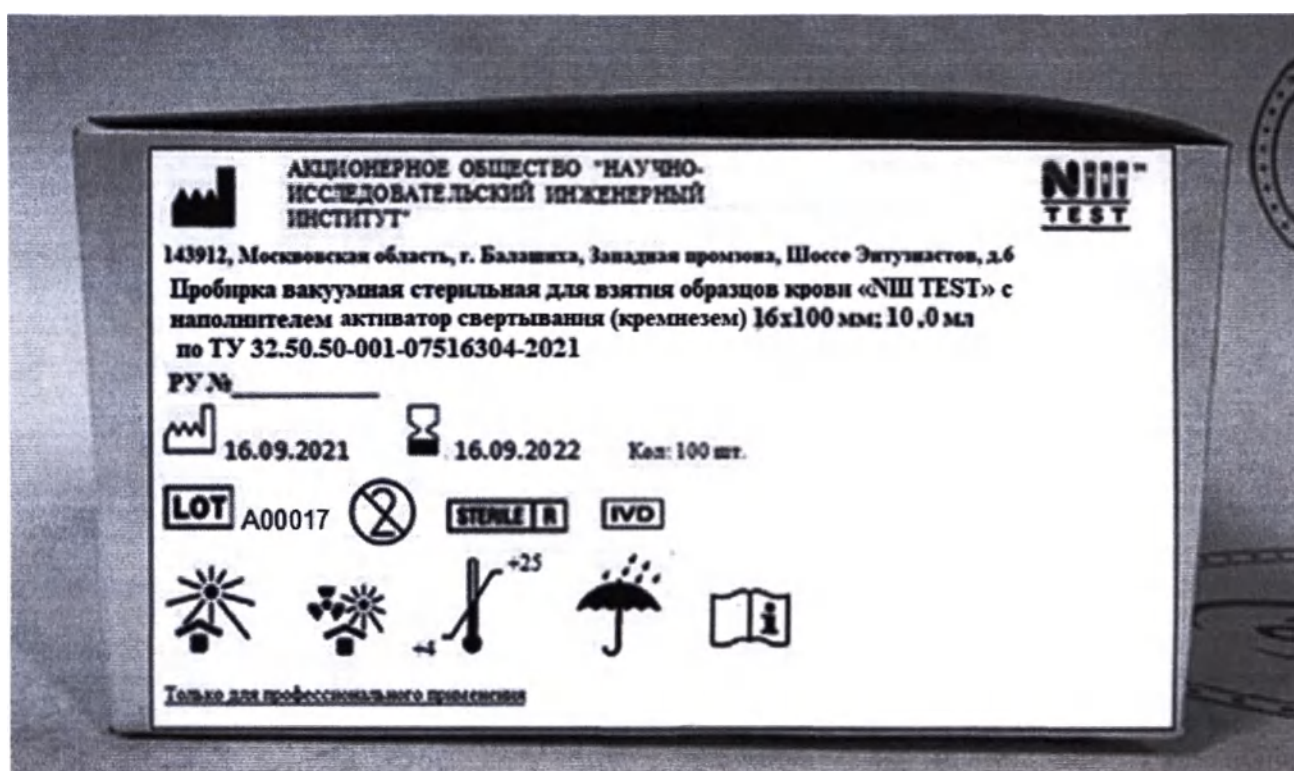


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем), 16x100 мм; 10,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

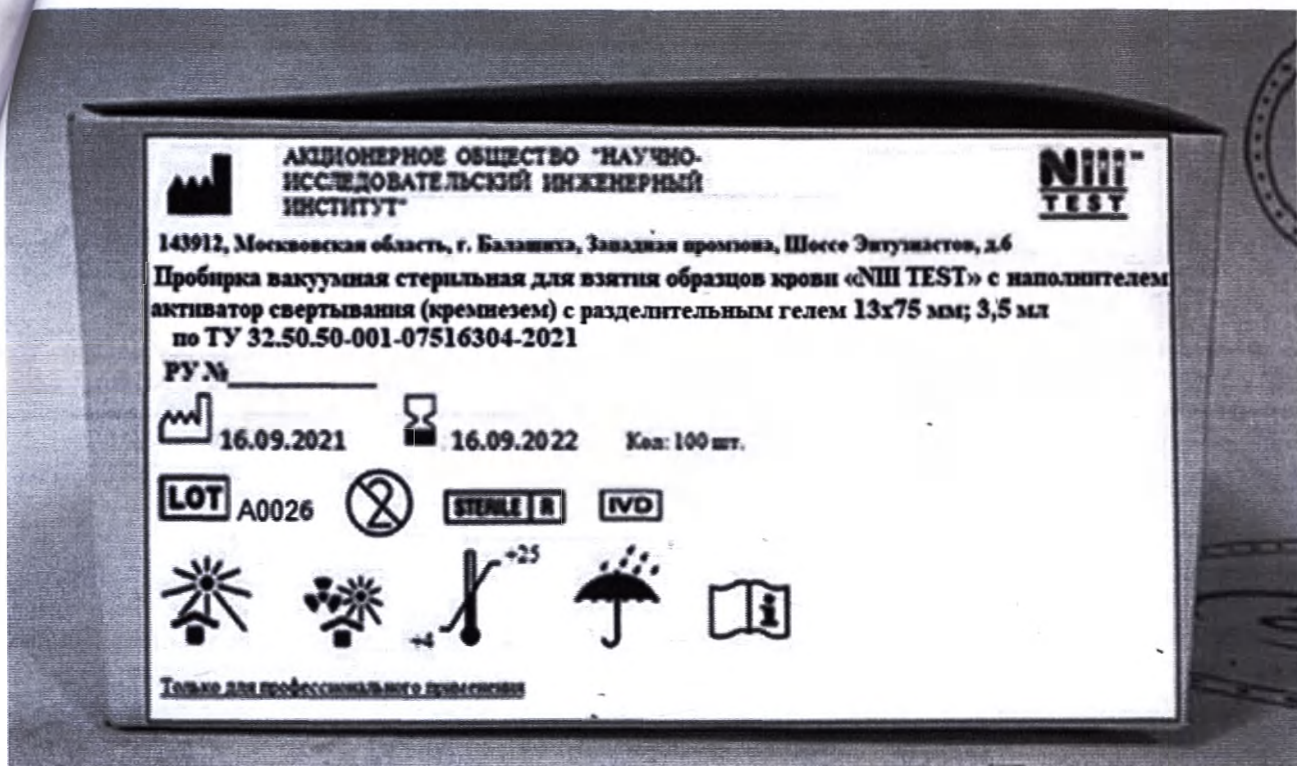

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 13x75 мм; 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021




Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 13x100 мм; 4,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

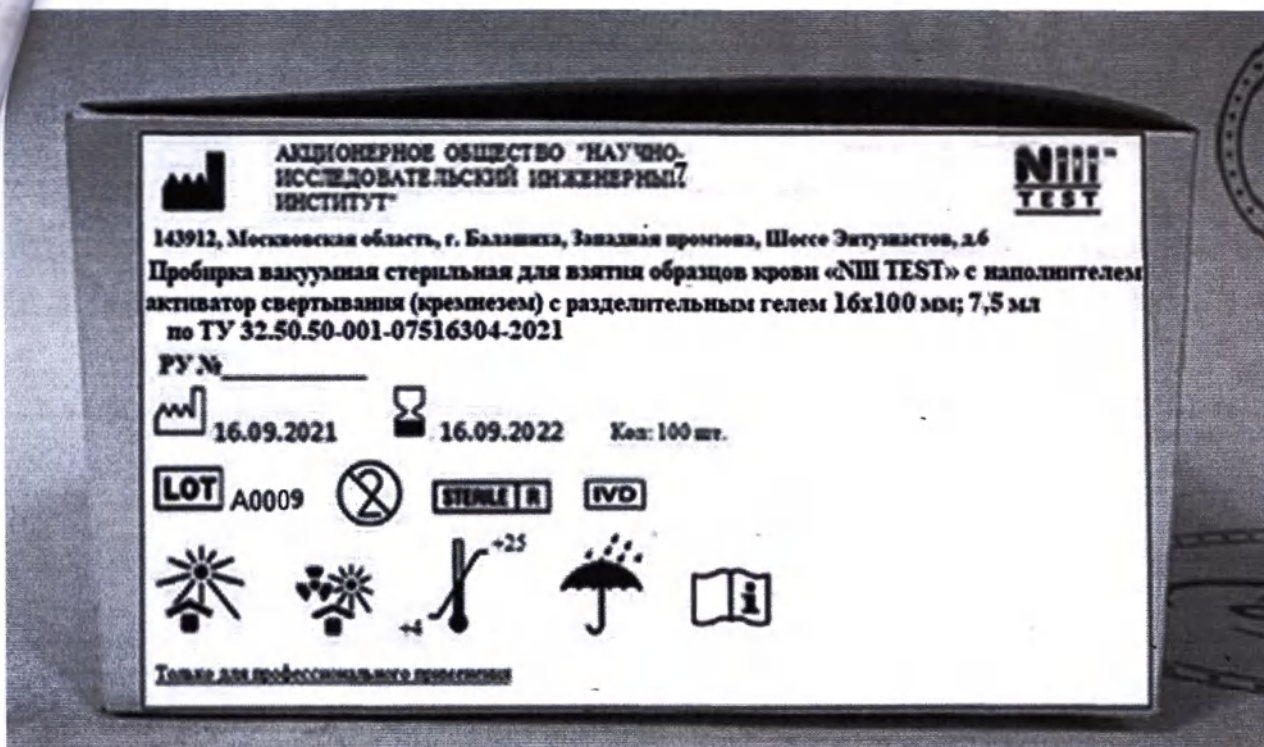


Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» с наполнителем активатор свертывания (кремнезем) с разделительным гелем, 16x100 мм; 7,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» без наполнителя, 13x75 мм; 3,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

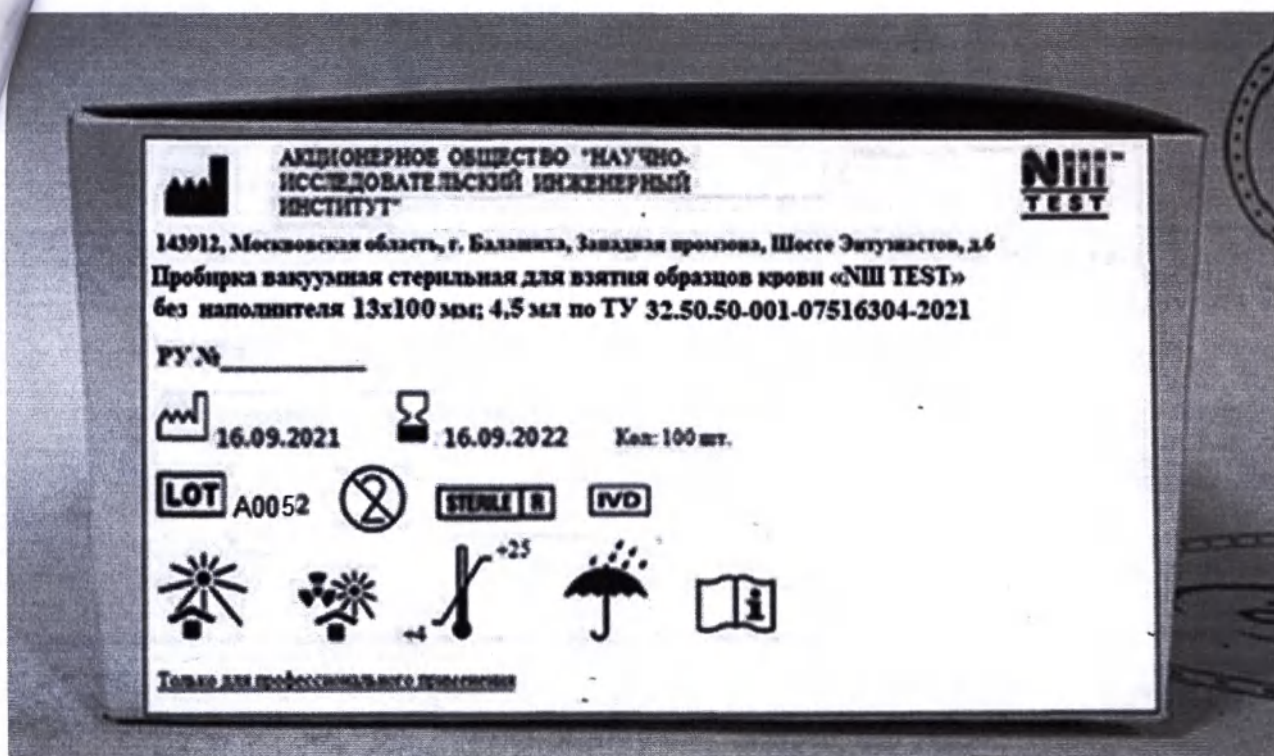

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» без наполнителя, 13x100 мм; 4,5 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

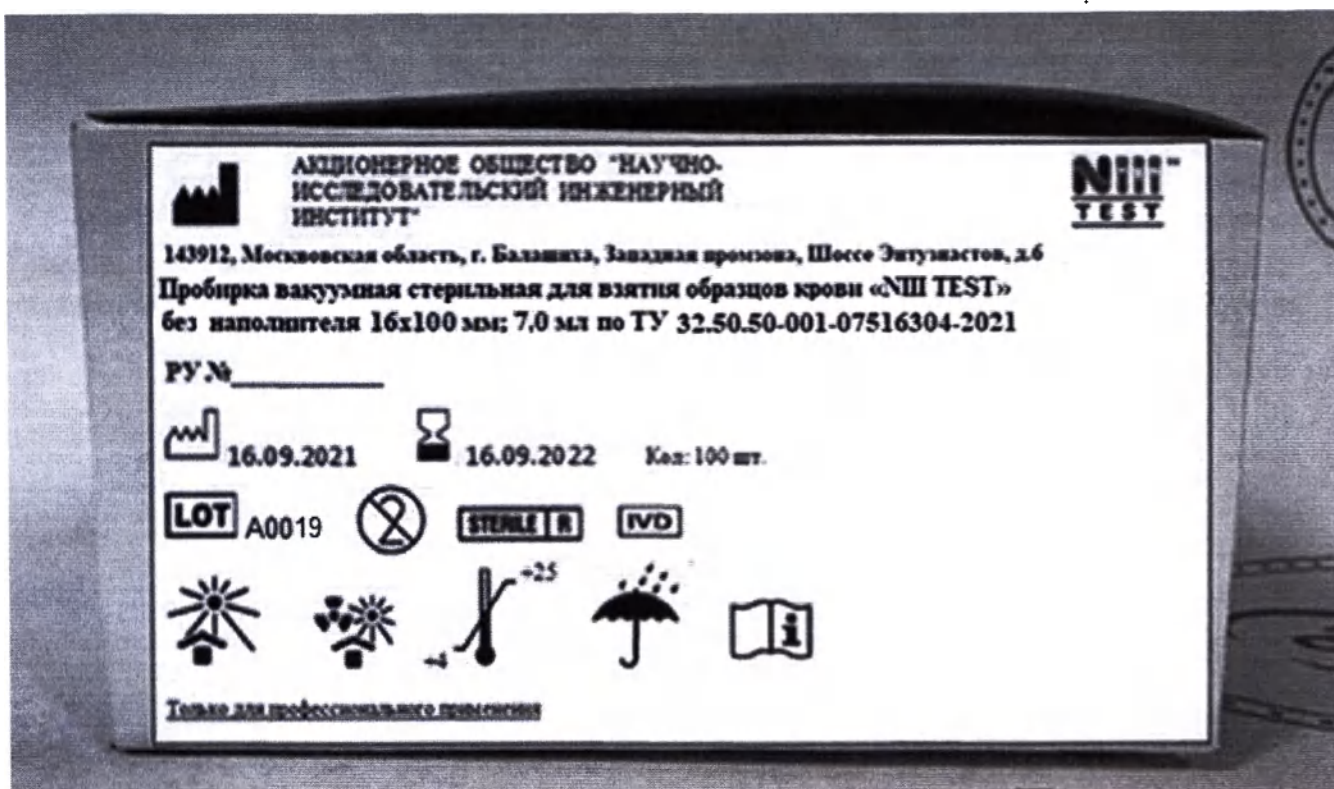

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «NIII TEST» без наполнителя, 16x100 мм; 7,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021



Транспортная упаковка с маркировкой на примере варианта исполнения: Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови «НИИ TEST» с наполнителем К2ЭДТА, 13x75 мм; 4,0 мл по ТУ 32.50.50-001-07516304-2021

ЛИСТОВ

