


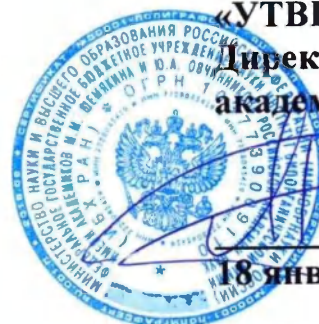

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИБХ РАН,
академик

А.Г. Габибов

18 января 2022 года

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека «SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН» по ТУ 21.20.23-053-02699487-2022, серия 053-04, дата выпуска 17.01.2022, количество наборов в серии: 5000 штук.

«Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека «SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН» по ТУ 21.20.23-053-02699487-2022, серия 053-04, дата выпуска 17.01.2022, количество наборов в серии: 5000 штук

Состав набора реагентов:

1. Иммуносорбент 2 шт.
2. Положительный контроль (К+) 1 фл. 3 мл
3. Отрицательный контроль (К-) 1 фл. 3 мл
4. Раствор для промежуточного разведения образцов (РПРО) 1 фл. 30 мл
5. Раствор для разведения образцов (РРО) 1 фл. 25 мл
6. Раствор для разведения ACE2 (PPA) 1 фл. 25 мл
7. Концентрат рекомбинантного рецептора ACE2 (ACE2(x11)) 1 фл. 2,5 мл
8. Концентрат конъюгата (Кг (x11)) 1 фл. 2,5 мл
9. Раствор для разведения конъюгата (РРК) 1 фл. 25 мл
10. ТМБ-хромоген 1 фл. 50 мл
11. Концентрат промывочного раствора 25-кратный (КПР(x25)) 1 фл. 25 мл
12. Стоп-реагент 8 шт.
13. Клейкая пленка для заклеивания иммуносорбента 8 шт.
14. Одноразовые ванночки для реагентов 64 шт.
15. Одноразовые сменные наконечники к дозаторам пипеточным (10-300 мкл) 2 шт.
16. Планшет для разведения образцов 1 шт.
17. Инструкция по применению набора реагентов.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

LOT 053-04

17.01.2022

17.01.2023



«SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН»

Комплект для автоматического анализатора или для ручной постановки анализа
192 определения

Способ применения описан в прилагаемой инструкции

ТУ 21.20.23-053-02699487-2022

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/ххххх

Для профессионального применения.



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологической химии им. академиков М.М. Шенника и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
Товарный знак «Российская академия наук» (Свидетельство № 118722) используется по лицензии

117997, г. Москва, ул. Мясницкая-Малая, д.16/10
тел. +7 (968) 431-15-05, e-mail: covid@ibch.ru

ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН Иммуносорбент

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

К+, инактивированный 3 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

К-, инактивированный 3 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

ACE2 (x11) 2,5 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

Кг (x11) 2,5 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

КПР (x25) 50 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

РПРО 30 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

РРО 25 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

PPA 25 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

РРК 25 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

ТМБ-хромоген 25 мл

LOT 053-04

17.01.2023



ИБХ РАН

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

Стоп-реагент 25 мл

LOT 053-04

17.01.2023



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИБХ РАН,
академик



А.Г. Габибов

18 января 2022 года

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека «SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН» по ТУ 21.20.23-053-02699487-2022, серия 053-04, дата выпуска 17.01.2022, количество наборов в серии: 5000 штук.

«Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека
«SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН» по ТУ 21.20.23-053-02699487-2022, серия 053-04, дата выпуска 17.01.2022, количество наборов в серии: 5000 штук

SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН

LOT 053-04

Количество наборов _____



17.01.2022

Масса нетто _____



17.01.2023


Масса брутто _____



ТУ 21.20.23-053-02699487-2022

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/xxx

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

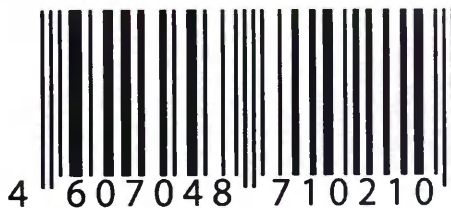

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук

117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.16/10
тел. +7 (968) 431-15-05, e-mail: covid@ibch.ru




«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИБХ РАН,
академик

А.Г. Габибов

18 января 2022 года

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения нейтрализующих
антител к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека «SARS-CoV-2 Нейтрализация
количественный ИФА ИБХ РАН» по ТУ 21.20.23-053-02699487-2022, серия 053-04, дата выпуска
17.01.2022, количество наборов в серии: 5000 штук.



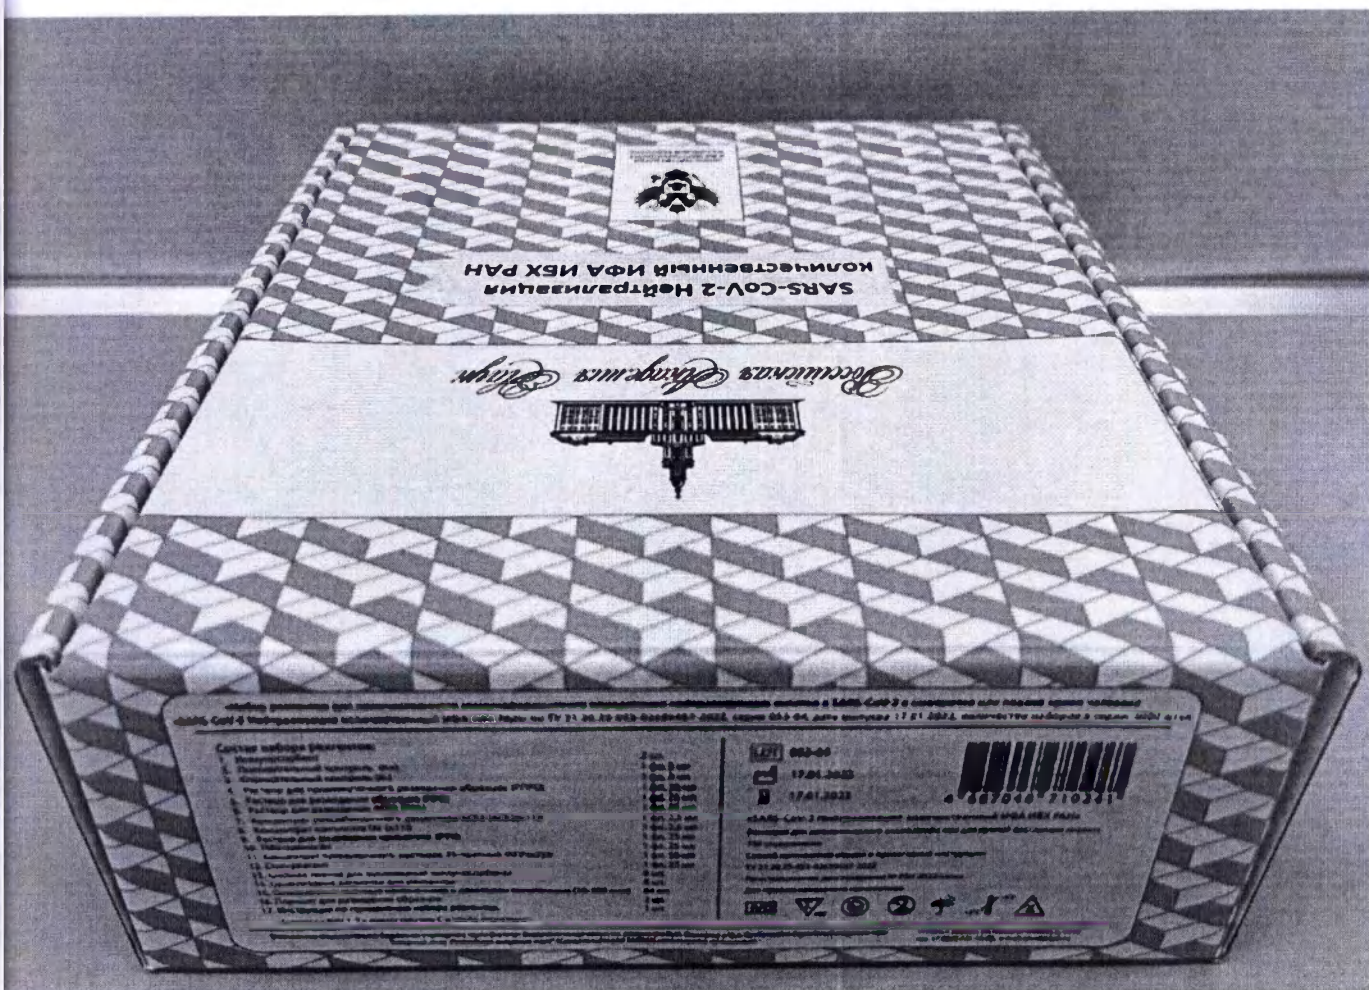

«Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека
«SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН» по ТУ 21.20.23-053-02699487-2022, серия 053-04, дата выпуска 17.01.2022, количество наборов в серии: 5000 штук

Состав набора реагентов:

1. Иммуносорбент	2 шт.
2. Положительный контроль (К+)	1 фл. 3 мл
3. Отрицательный контроль (К-)	1 фл. 3 мл
4. Раствор для промежуточного разведения образцов (РПРО)	1 фл. 30 мл
5. Раствор для разведения образцов (РРО)	1 фл. 25 мл
6. Раствор для разведения ACE2 (РРА)	1 фл. 25 мл
7. Концентрат рекомбинантного рецептора ACE2 (ACE2(x11))	1 фл. 2,5 мл
8. Концентрат конъюгата (Кг (x11))	1 фл. 2,5 мл
9. Раствор для разведения конъюгата (РРК)	1 фл. 25 мл
10. ТМБ-хромоген	1 фл. 25 мл
11. Концентрат промывочного раствора 25-кратный (КПР(x25))	1 фл. 50 мл
12. Стоп-реагент	1 фл. 25 мл
13. Клейкая пленка для заклеивания иммуносорбента	8 шт.
14. Одноразовые ванночки для реагентов	8 шт.
15. Одноразовые сменные наконечники к дозаторам пипеточным (10-300 мкл)	64 шт.
16. Планшет для разведения образцов	2 шт.
17. Инструкция по применению набора реагентов.	1 шт.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.


LOT 053-04



17.01.2022



17.01.2023



«SARS-CoV-2 Нейтрализация количественный ИФА ИБХ РАН»

Комплект для автоматического анализатора или для ручной постановки анализа
192 определений

Способ применения описан в прилагаемой инструкции

ТУ 21.20.23-053-02699487-2022


Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/ххххх


Для профессионального применения.





Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
Товарный знак «Российская академия наук» (Свидетельство № 118722) используется по лицензии


117997, г. Москва, ул. Минусино-Мавляев, д.16/10
тел. +7 (968) 431-15-05, e-mail covidibch.ru

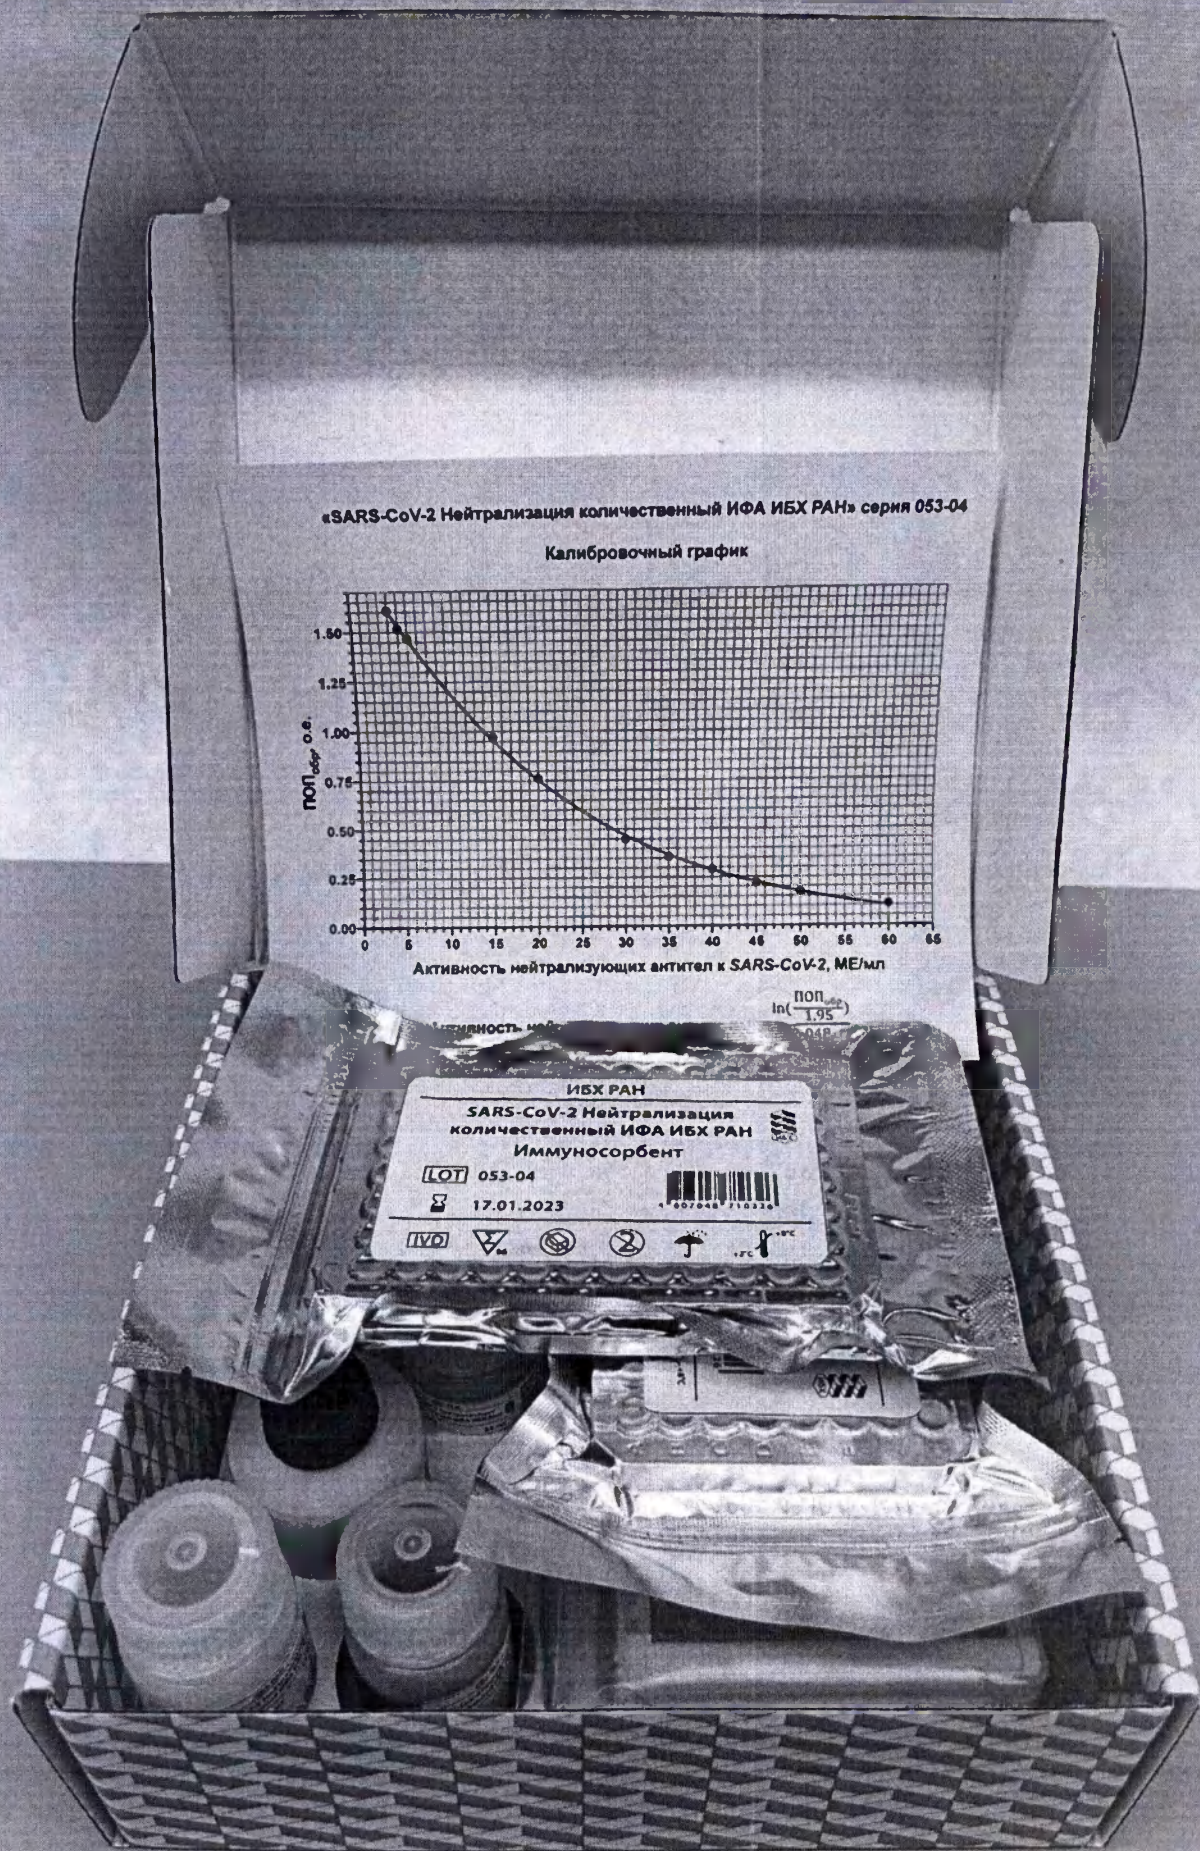


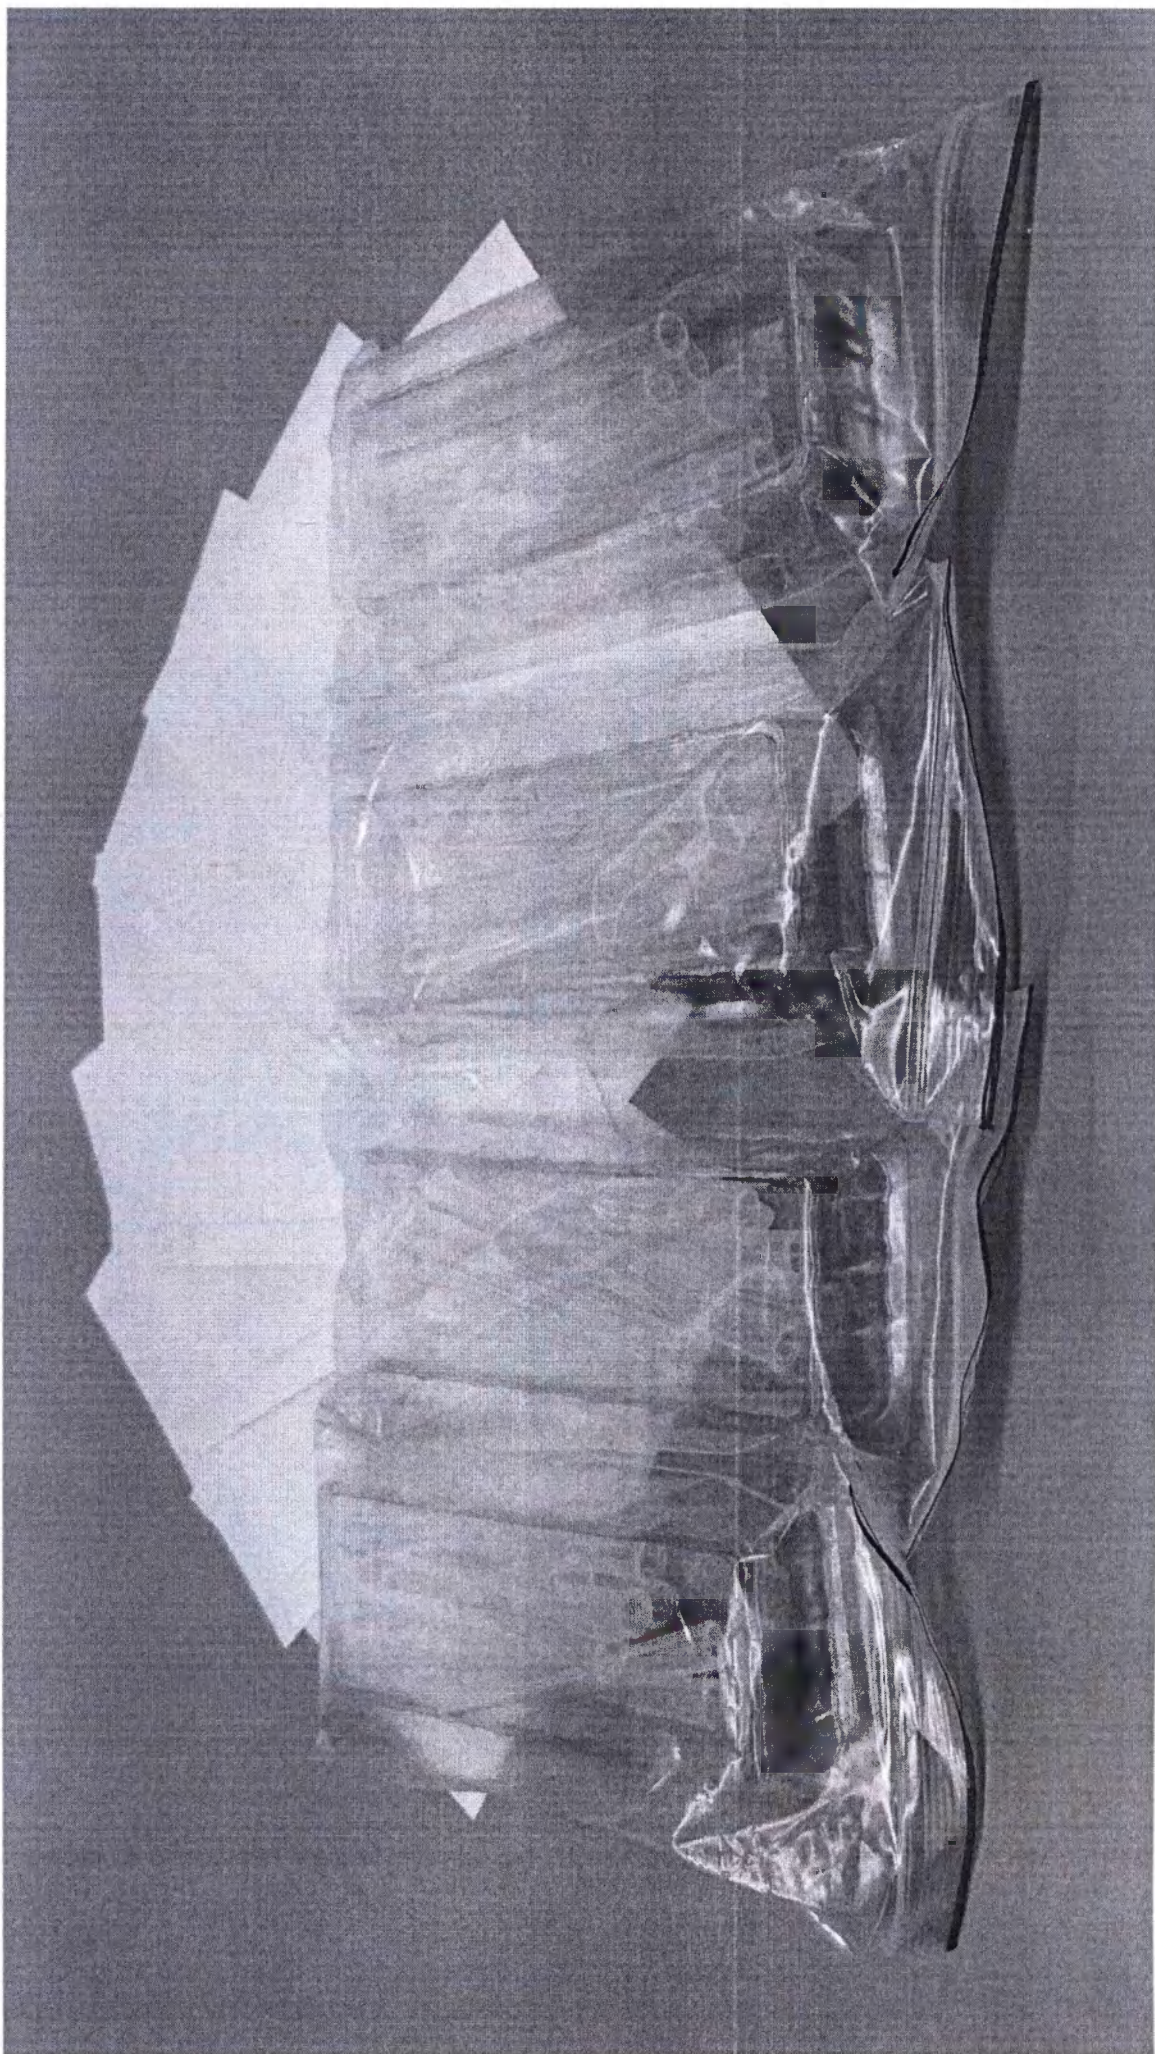


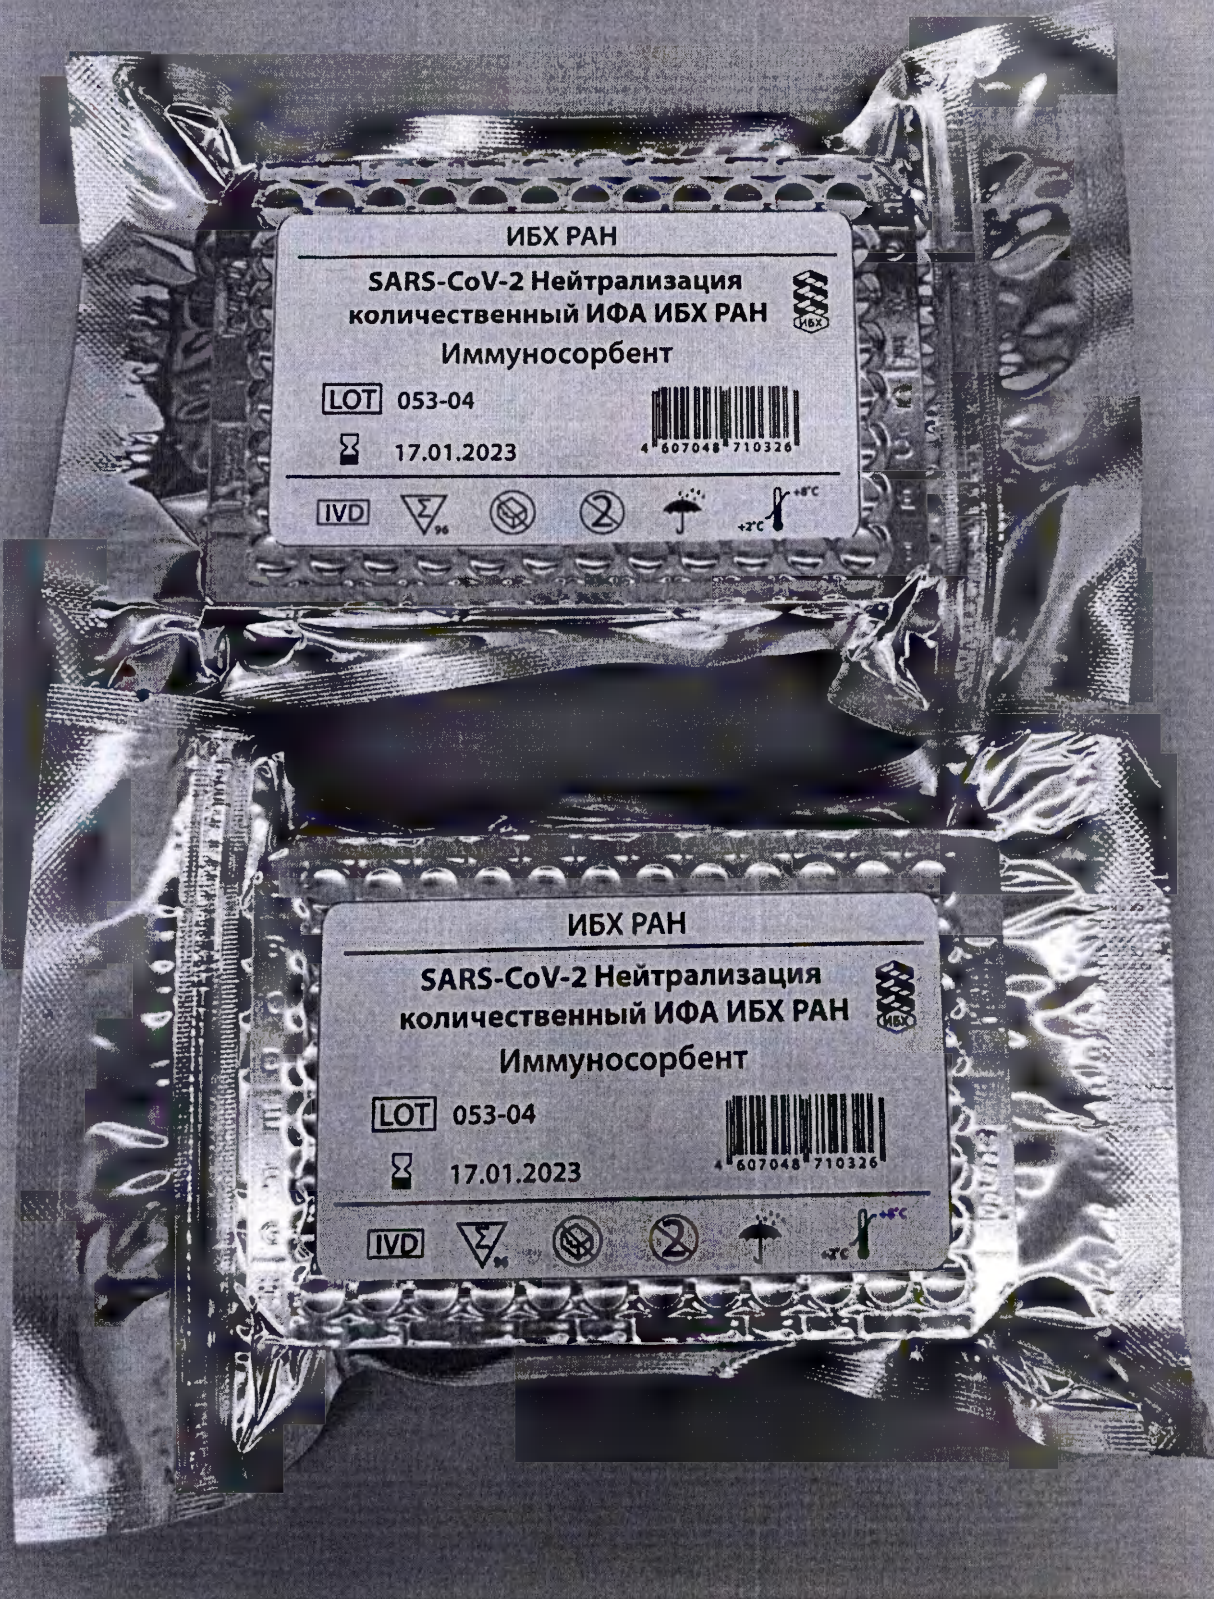


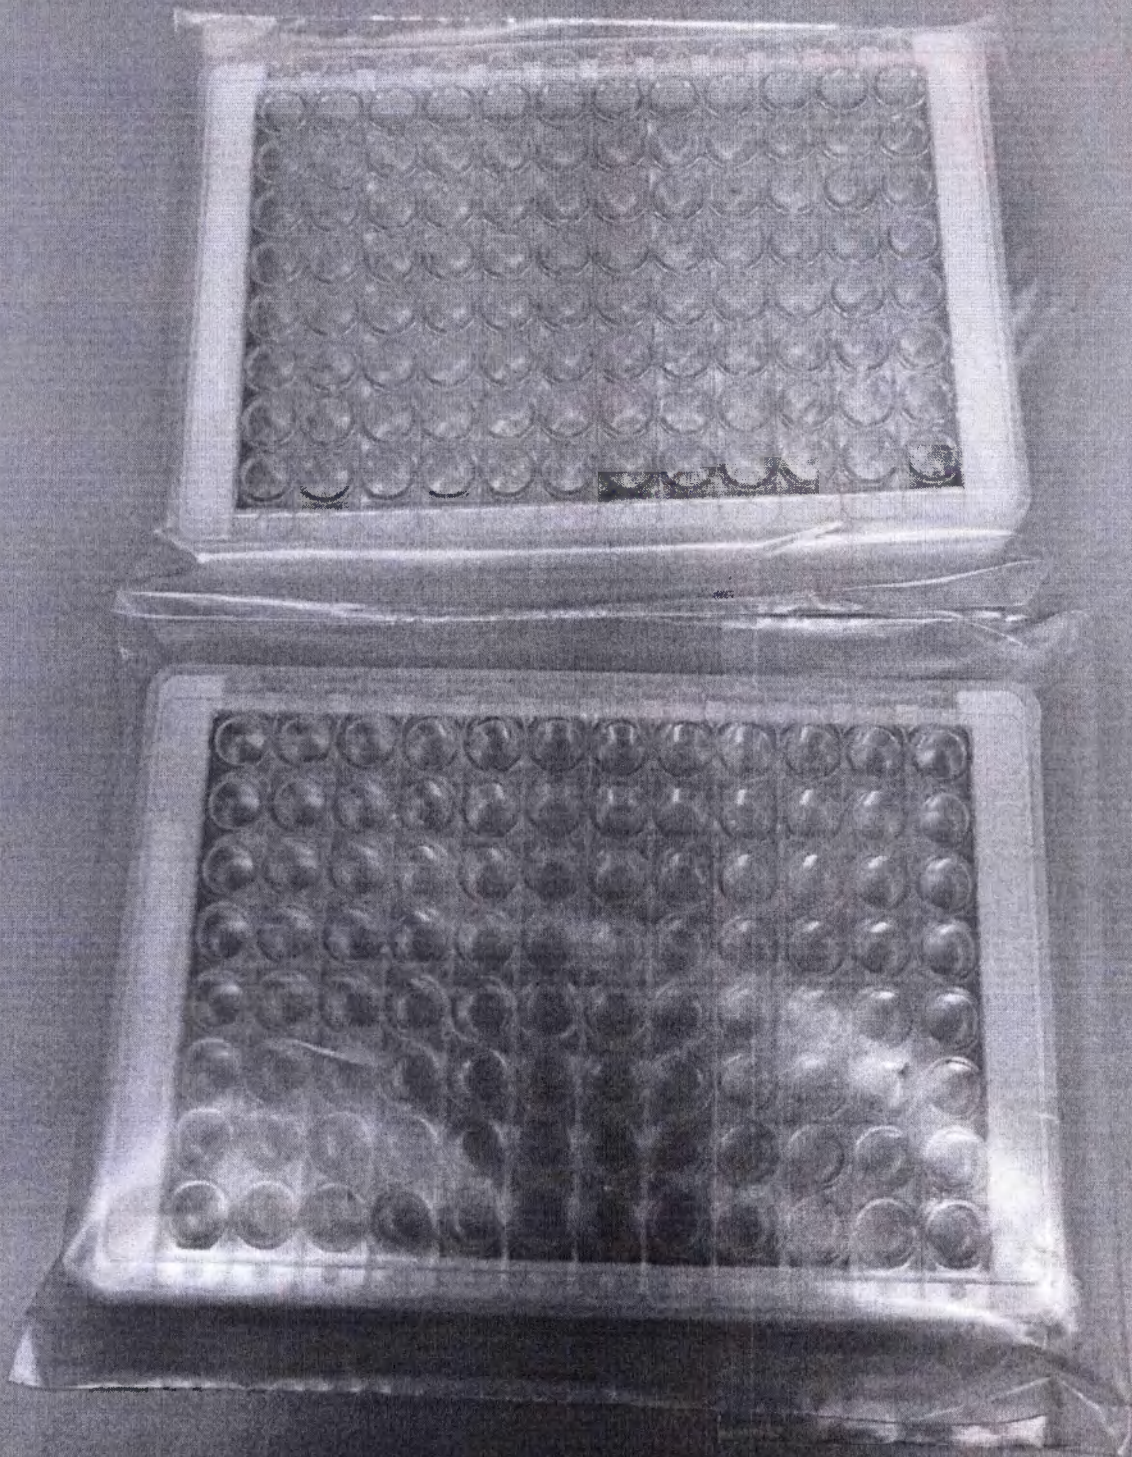


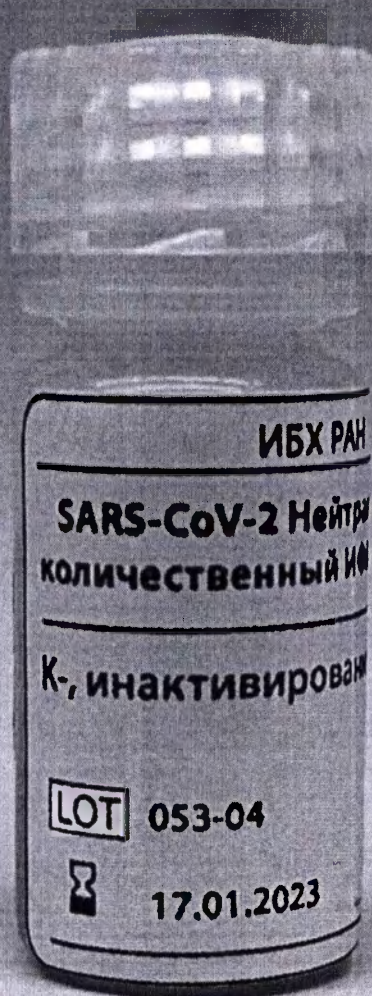


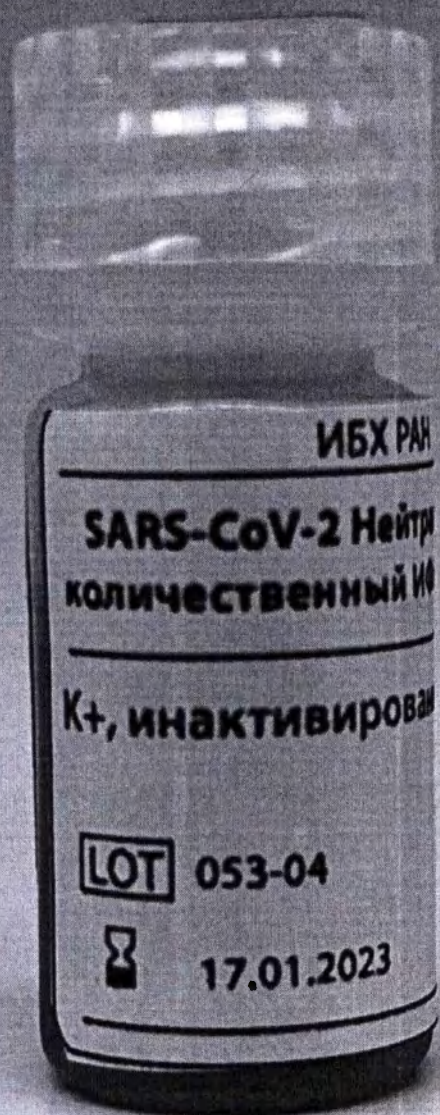


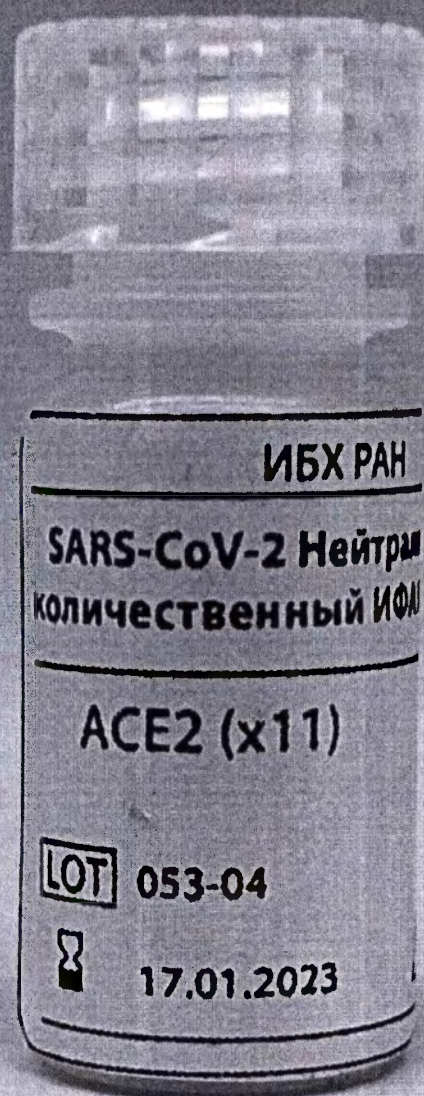


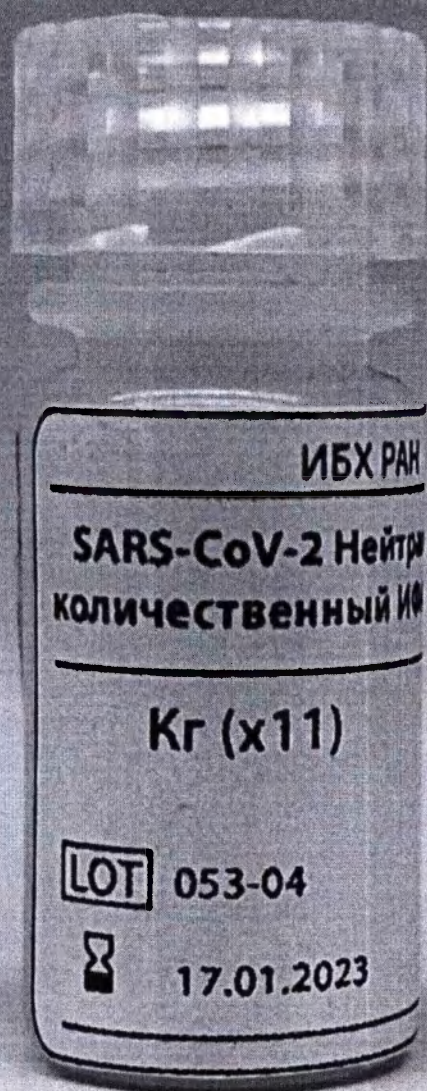


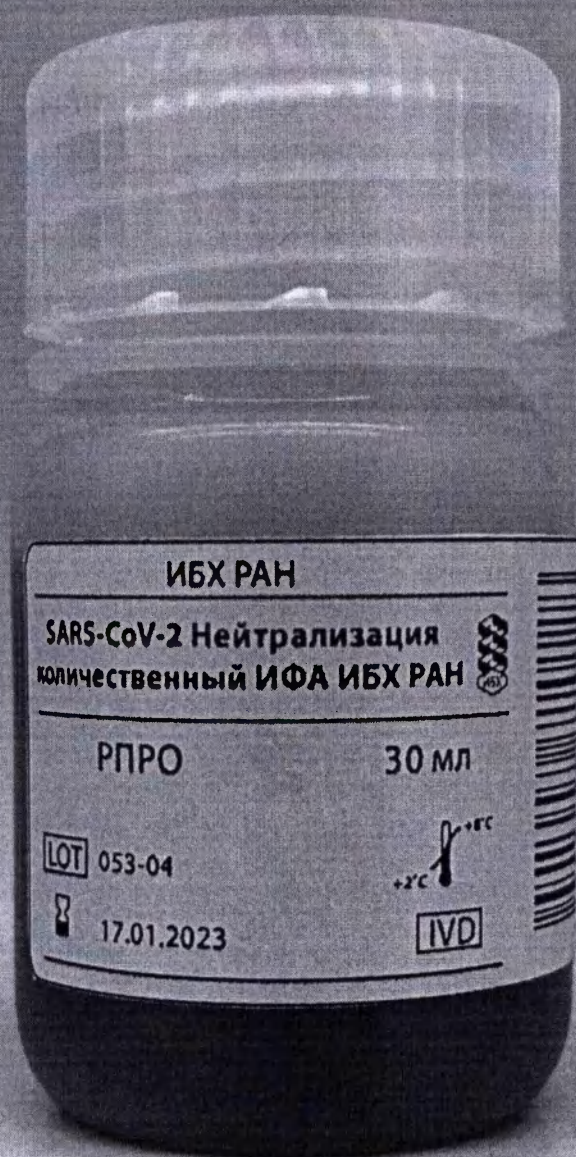


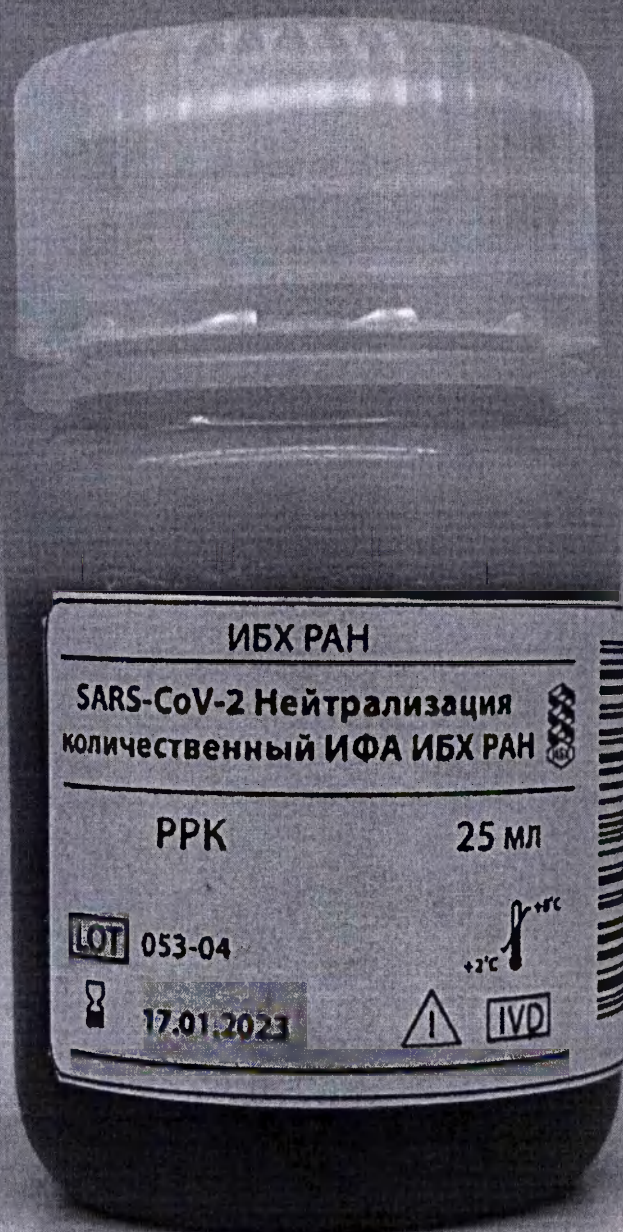


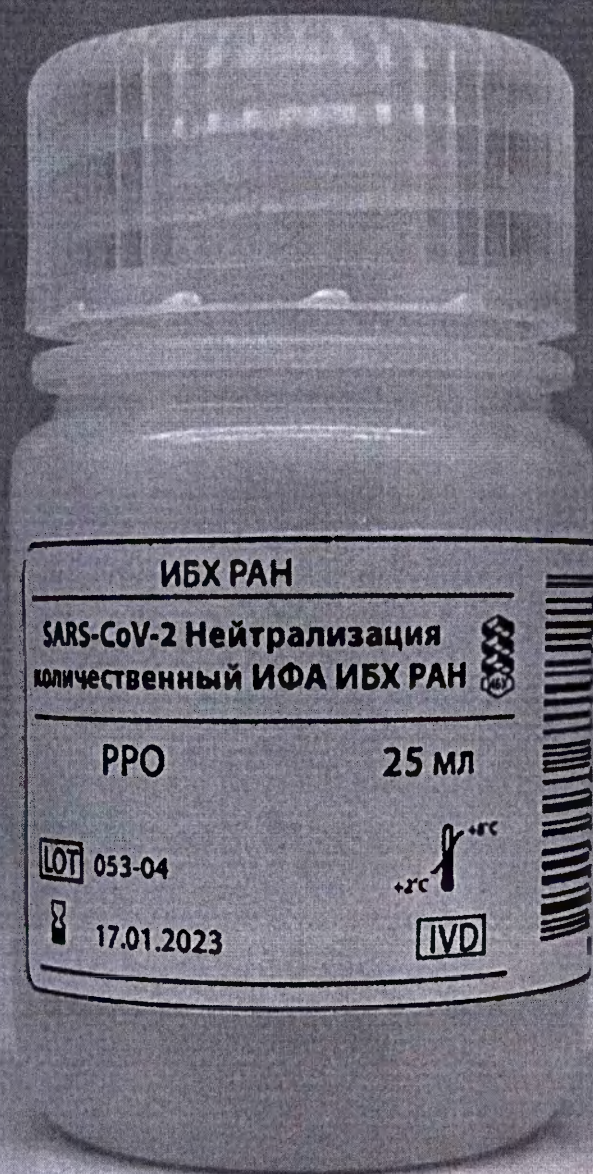

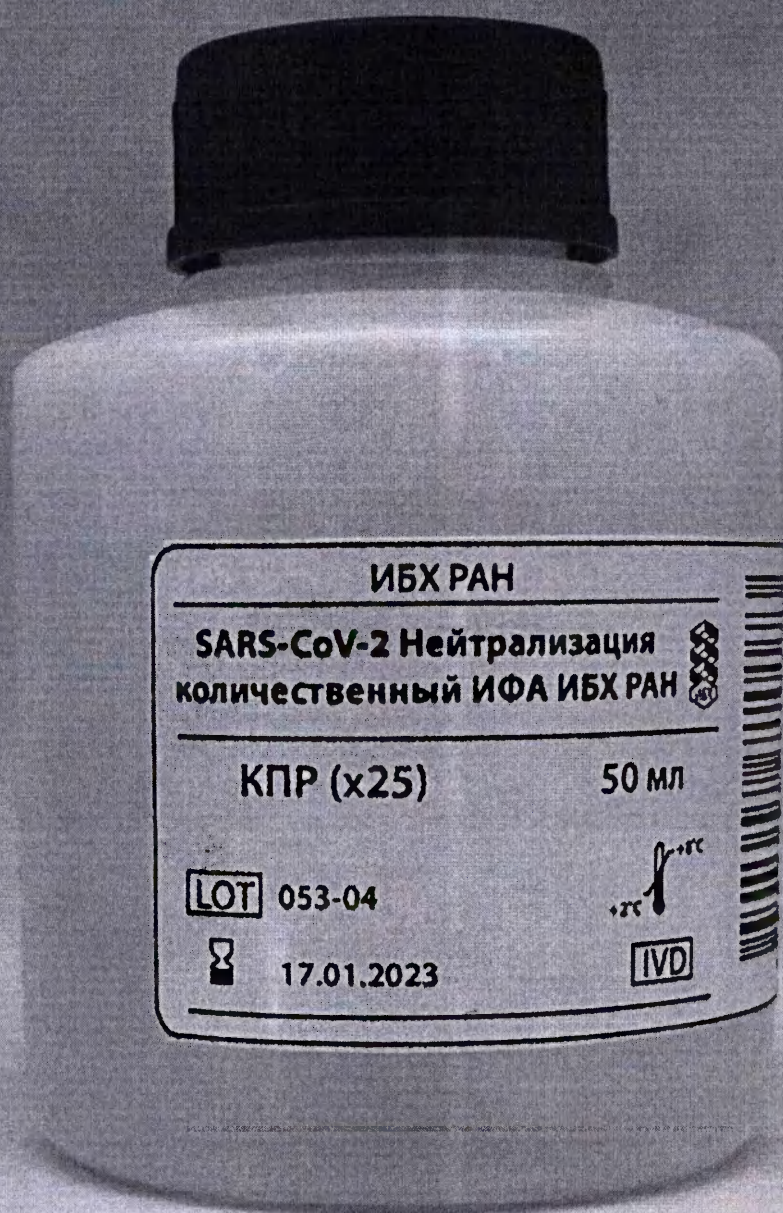

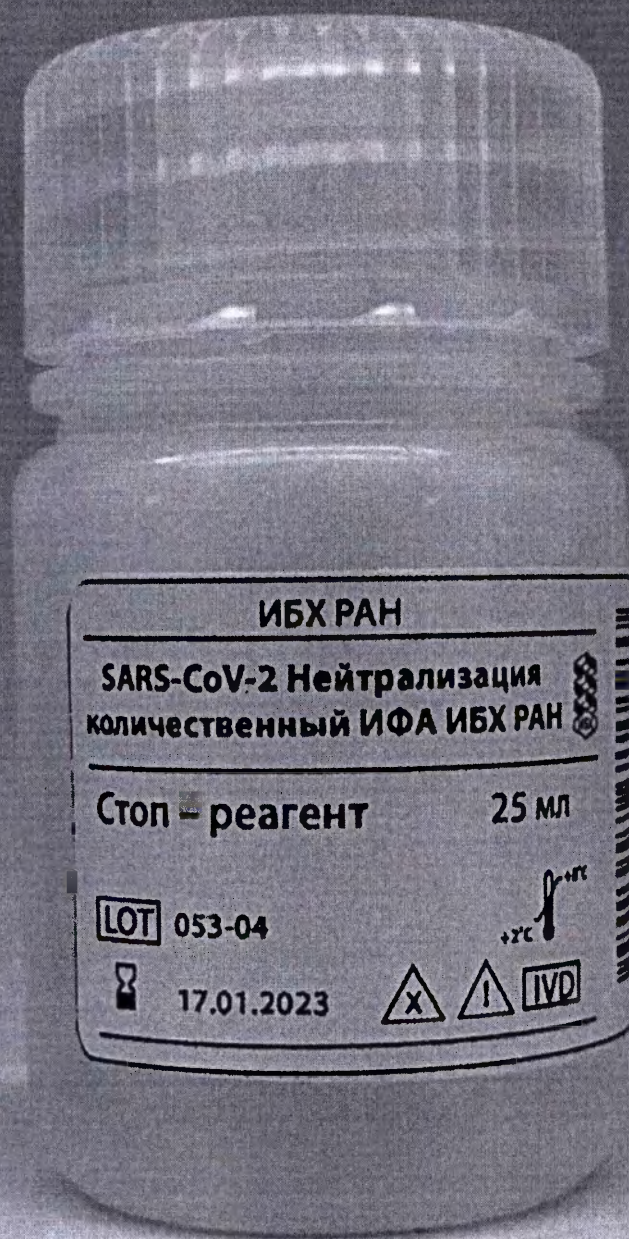

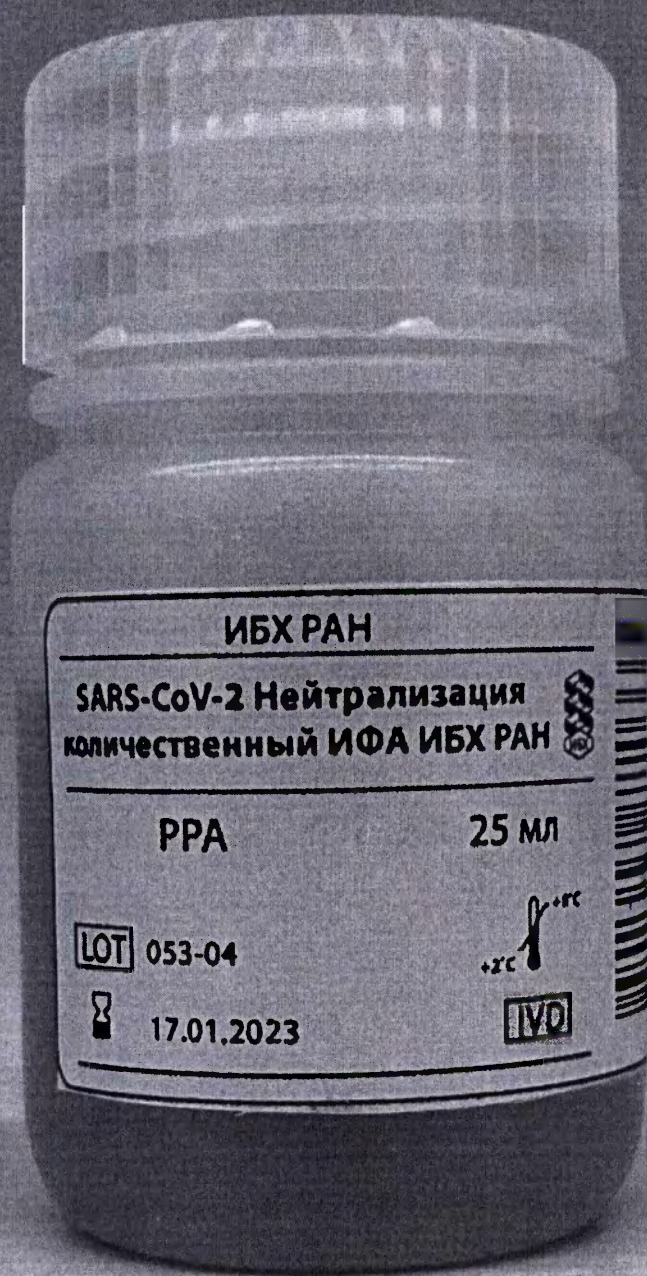

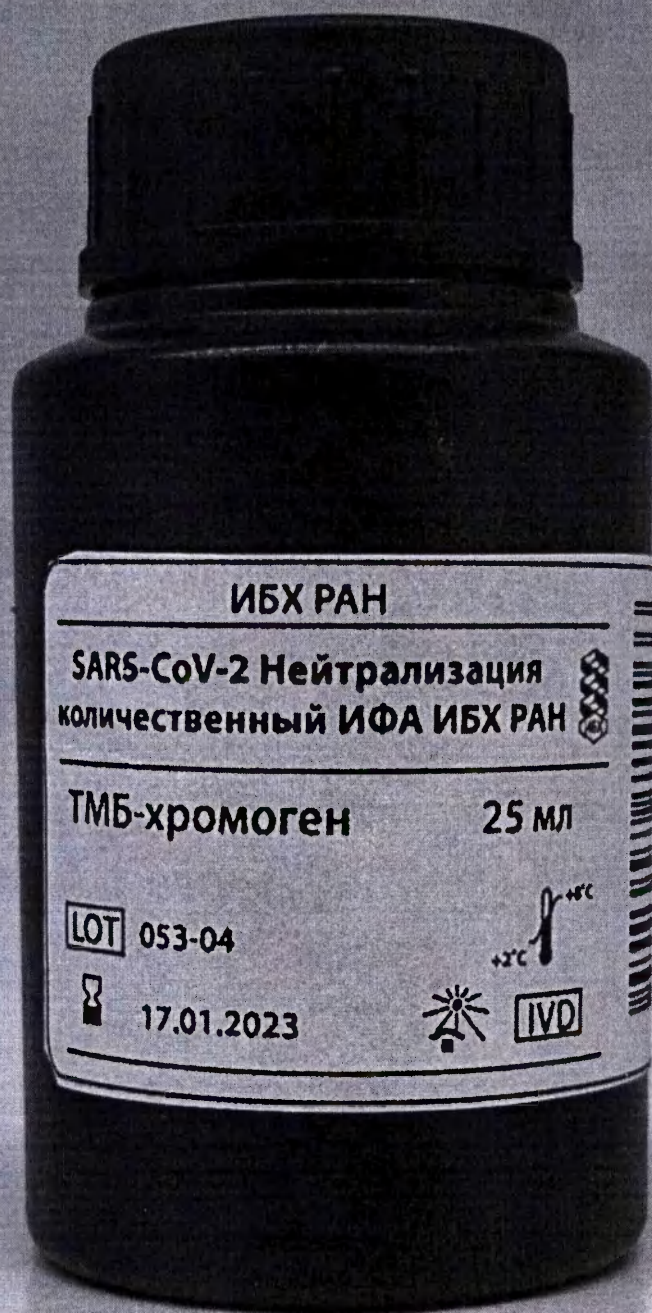

Прошито, пронумеровано 18 (Восемнадцать) листов

Директор ИБХ РАН,
академик

Габиев А.Г.

