


Проект маркировки на русском языке на медицинское изделие

«Аппарат лазерный диодный ENEKA PRO»

- производства

TERMOSALUD, S.L. «ТЕРМОСАЛЮД, С.Л.», Испания

(дополнительно наносится на аппарат уполномоченным представителем производителя)

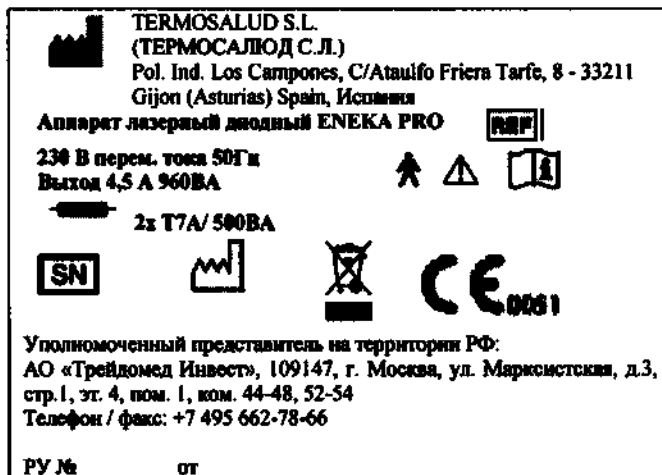

**Генеральный директор
АО «Трейдомед Инвест»
Соболева Э.Ж.
22 декабря 2021 г.**



(Подпись)

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Трейдомед Инвест»

Соболева Э.Ж.
«22» декабря 2021 г.




**Фотографические изображения
на медицинское изделие
«Аппарат лазерный диодный ENEKA PRO»**




лазерная рукоятка L 808 нм – 1 шт.



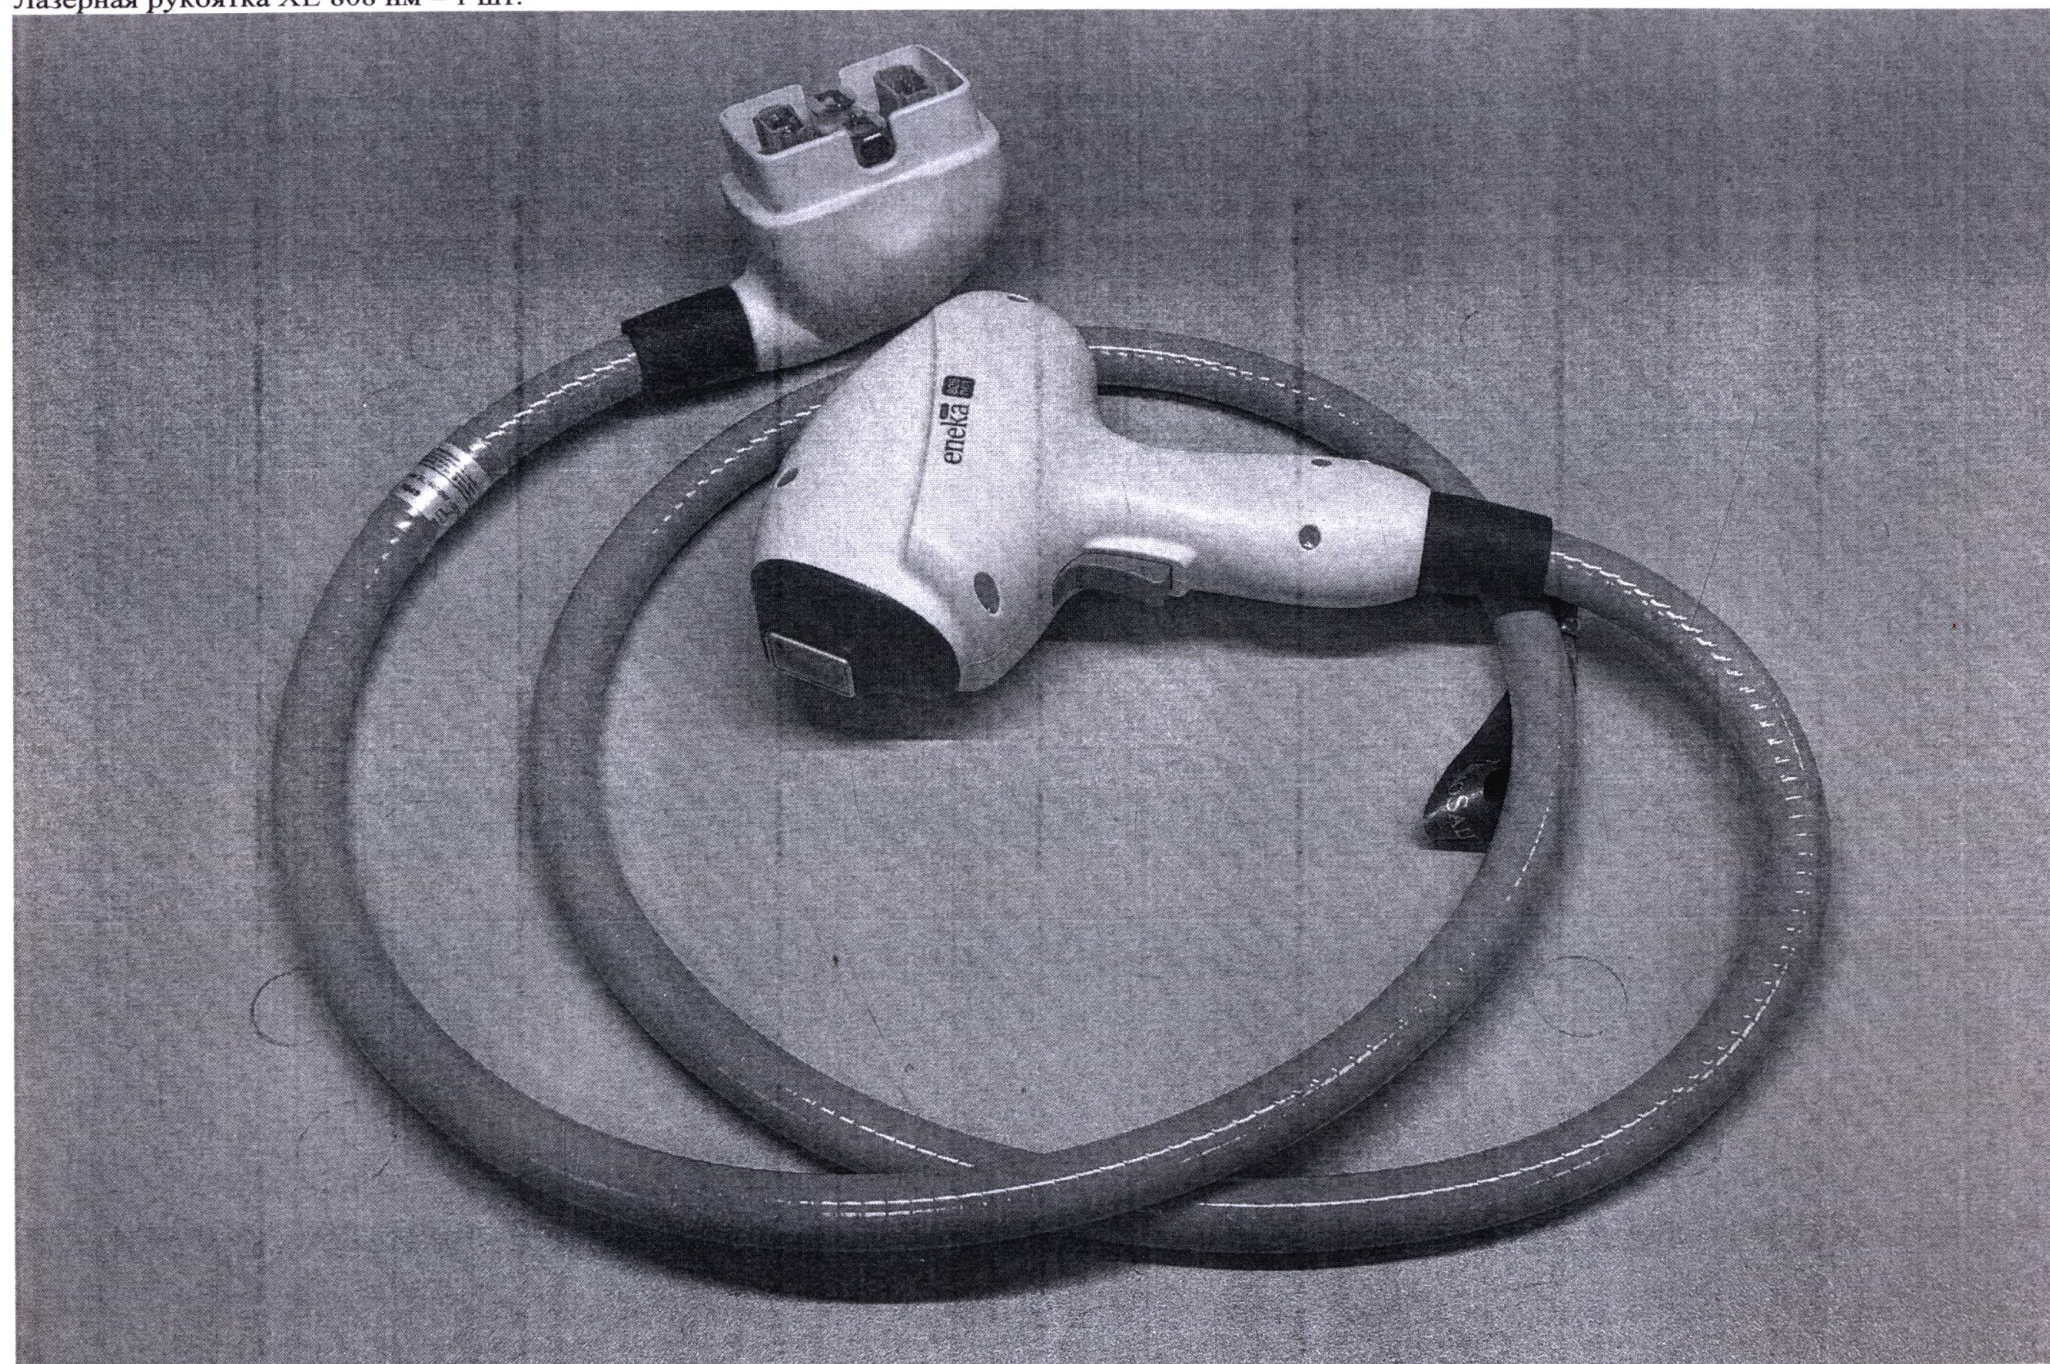





Лазерная рукоятка L 755 нм – 1 шт.

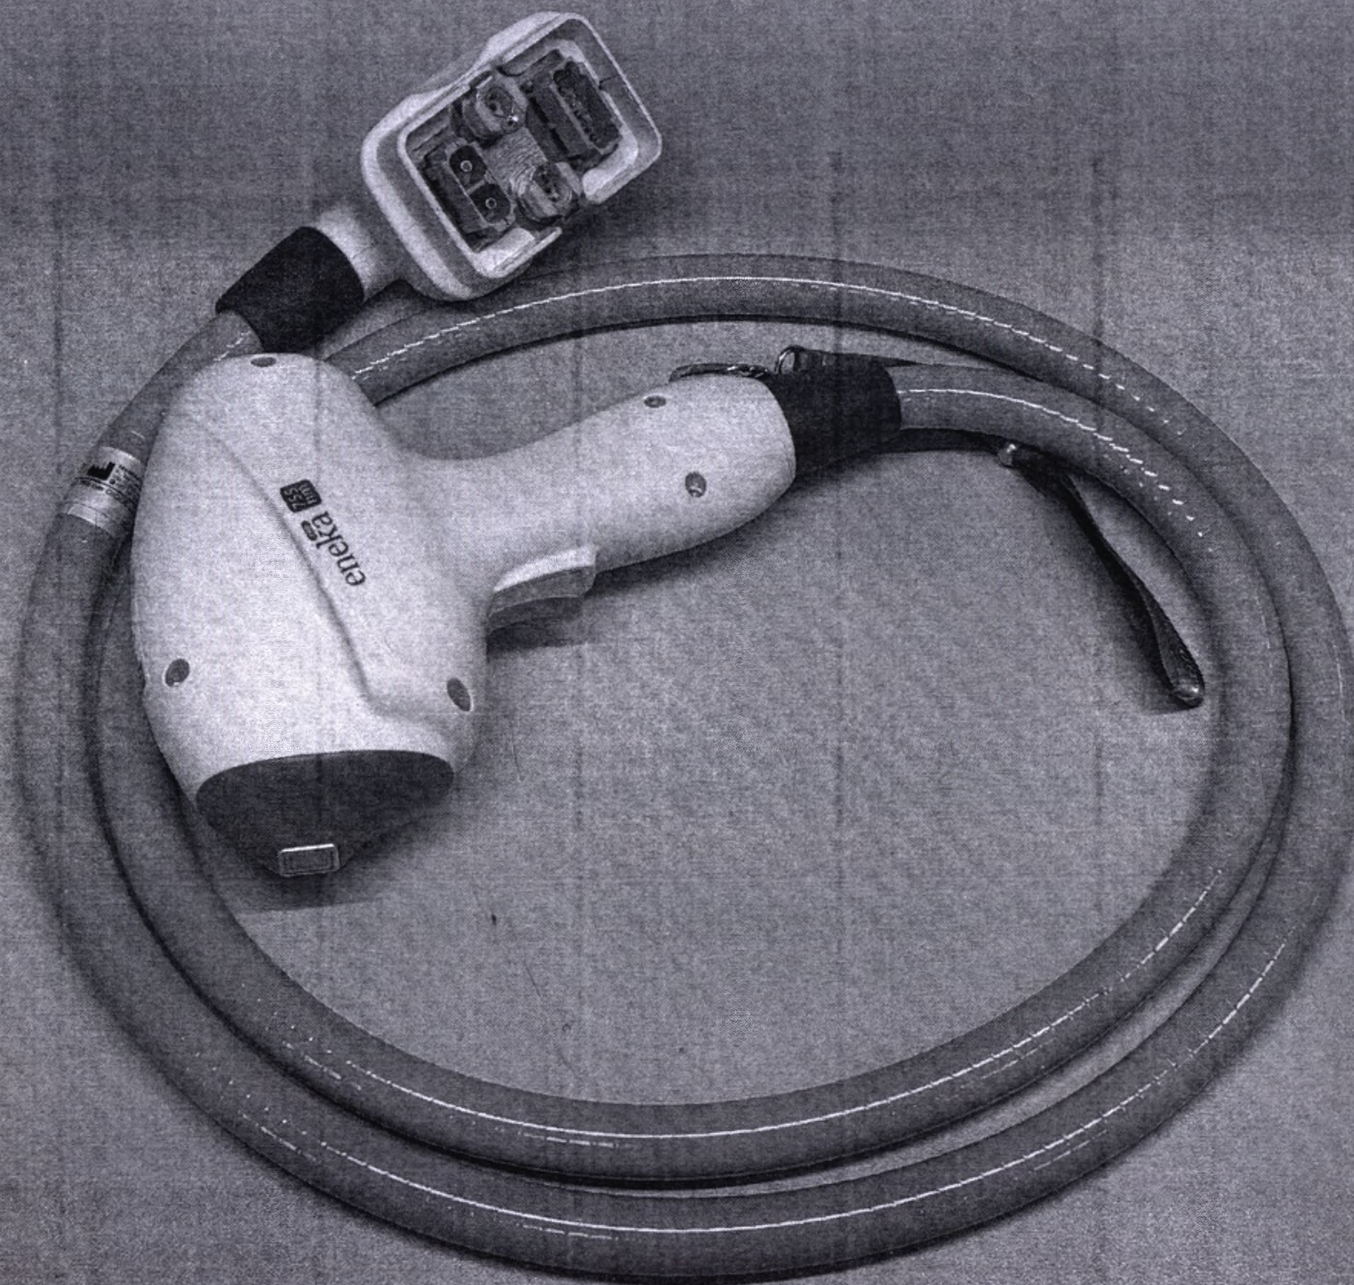

Кабель питания – 1 шт.





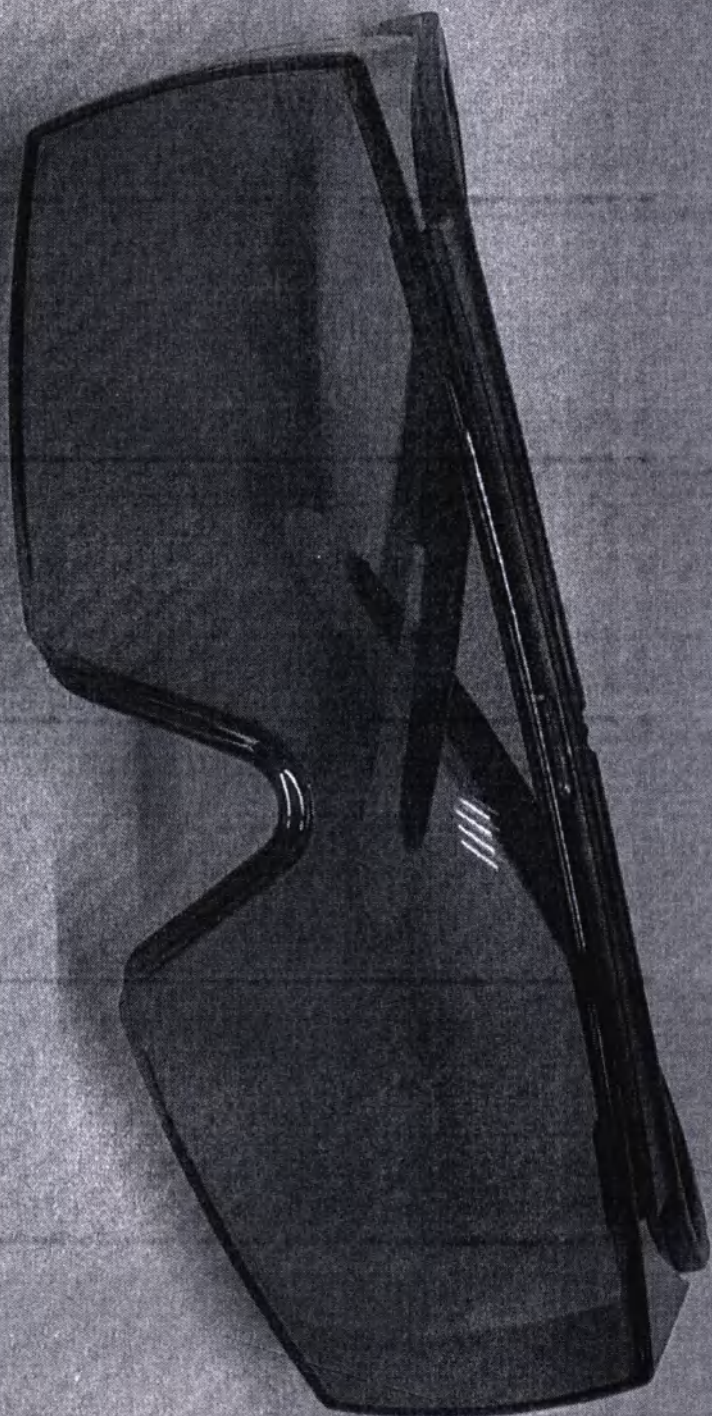

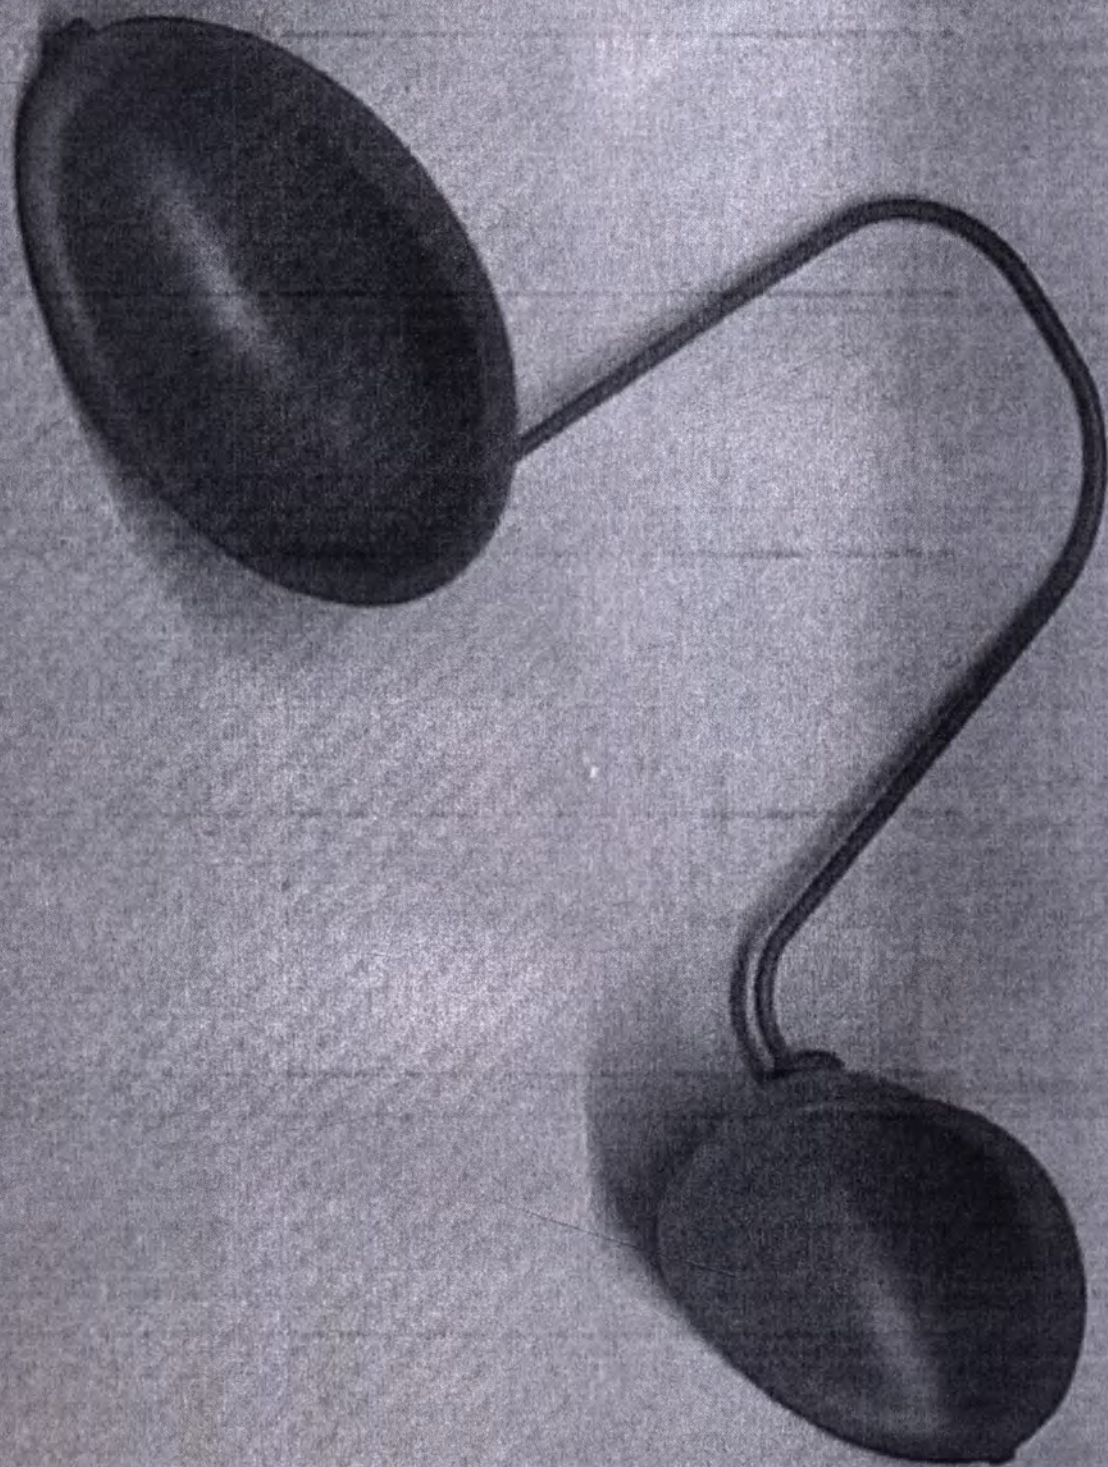

eneka^{PRO}
diode laser

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

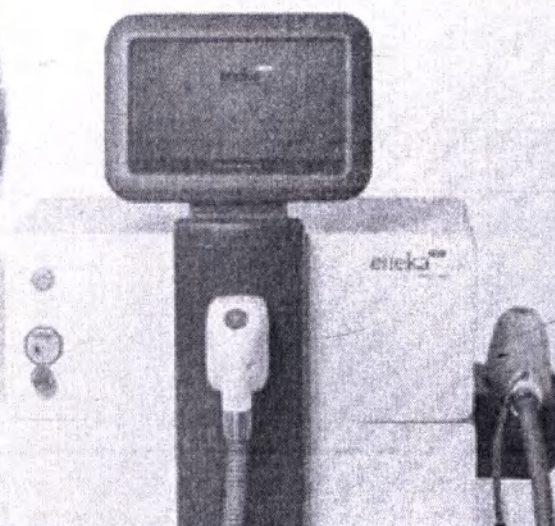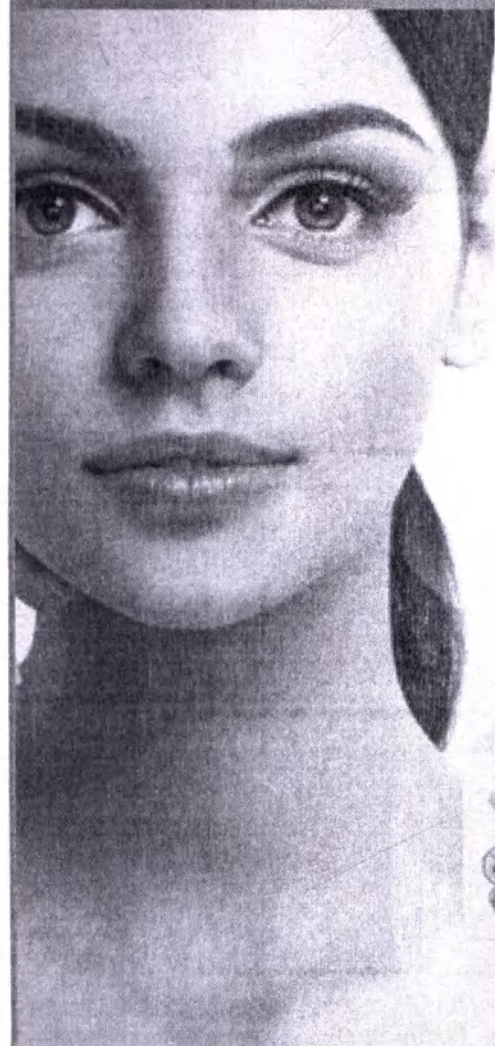


TERMO SALUD | MEDICAL
& ESTHETIC

Version
1
Model
ENEKA PRO
Name
РУССКИЙ
DATE
Февраль 2020 г.
FIELD OF APPLICATION
МЕДИЦИНА
Serial number model
M91m и M91c

termosalud.com


eneka^{PRO}
diode laser


РУКОВОДСТВО ПО ТЕРАПИИ

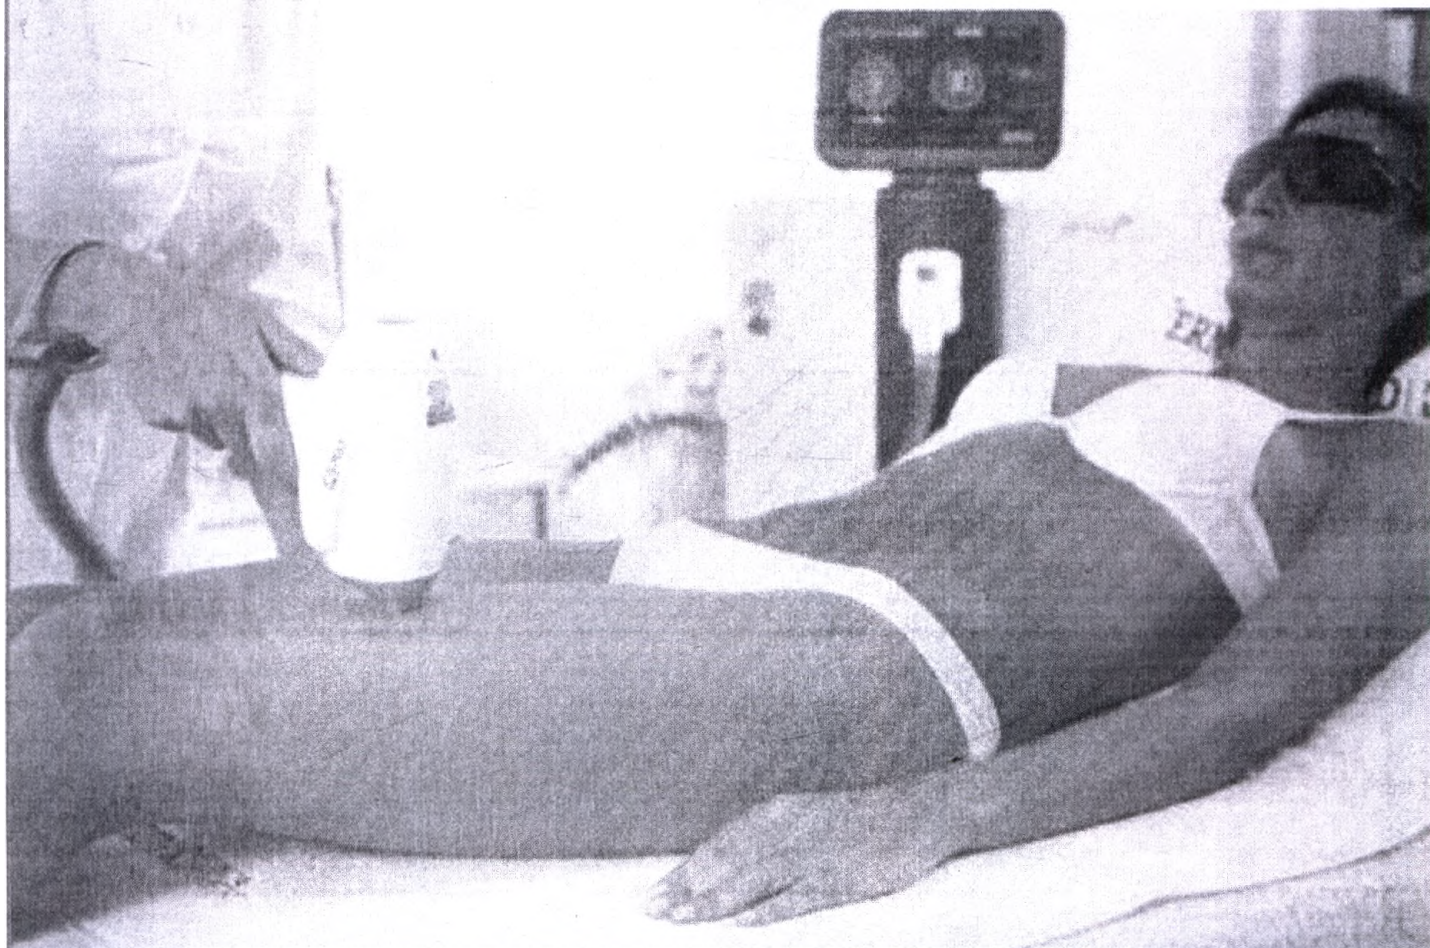


TERMO SALUD | MEDICAL
& ESTHETIC

ВЕРСИЯ
0
МОДЕЛЬ
ENEKA PRO
ЯЗЫК
РУССКИЙ
ДАТА
ФЕВРАЛЬ 2020 г.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕДИЦИНА
АРТИКУЛ
M91m

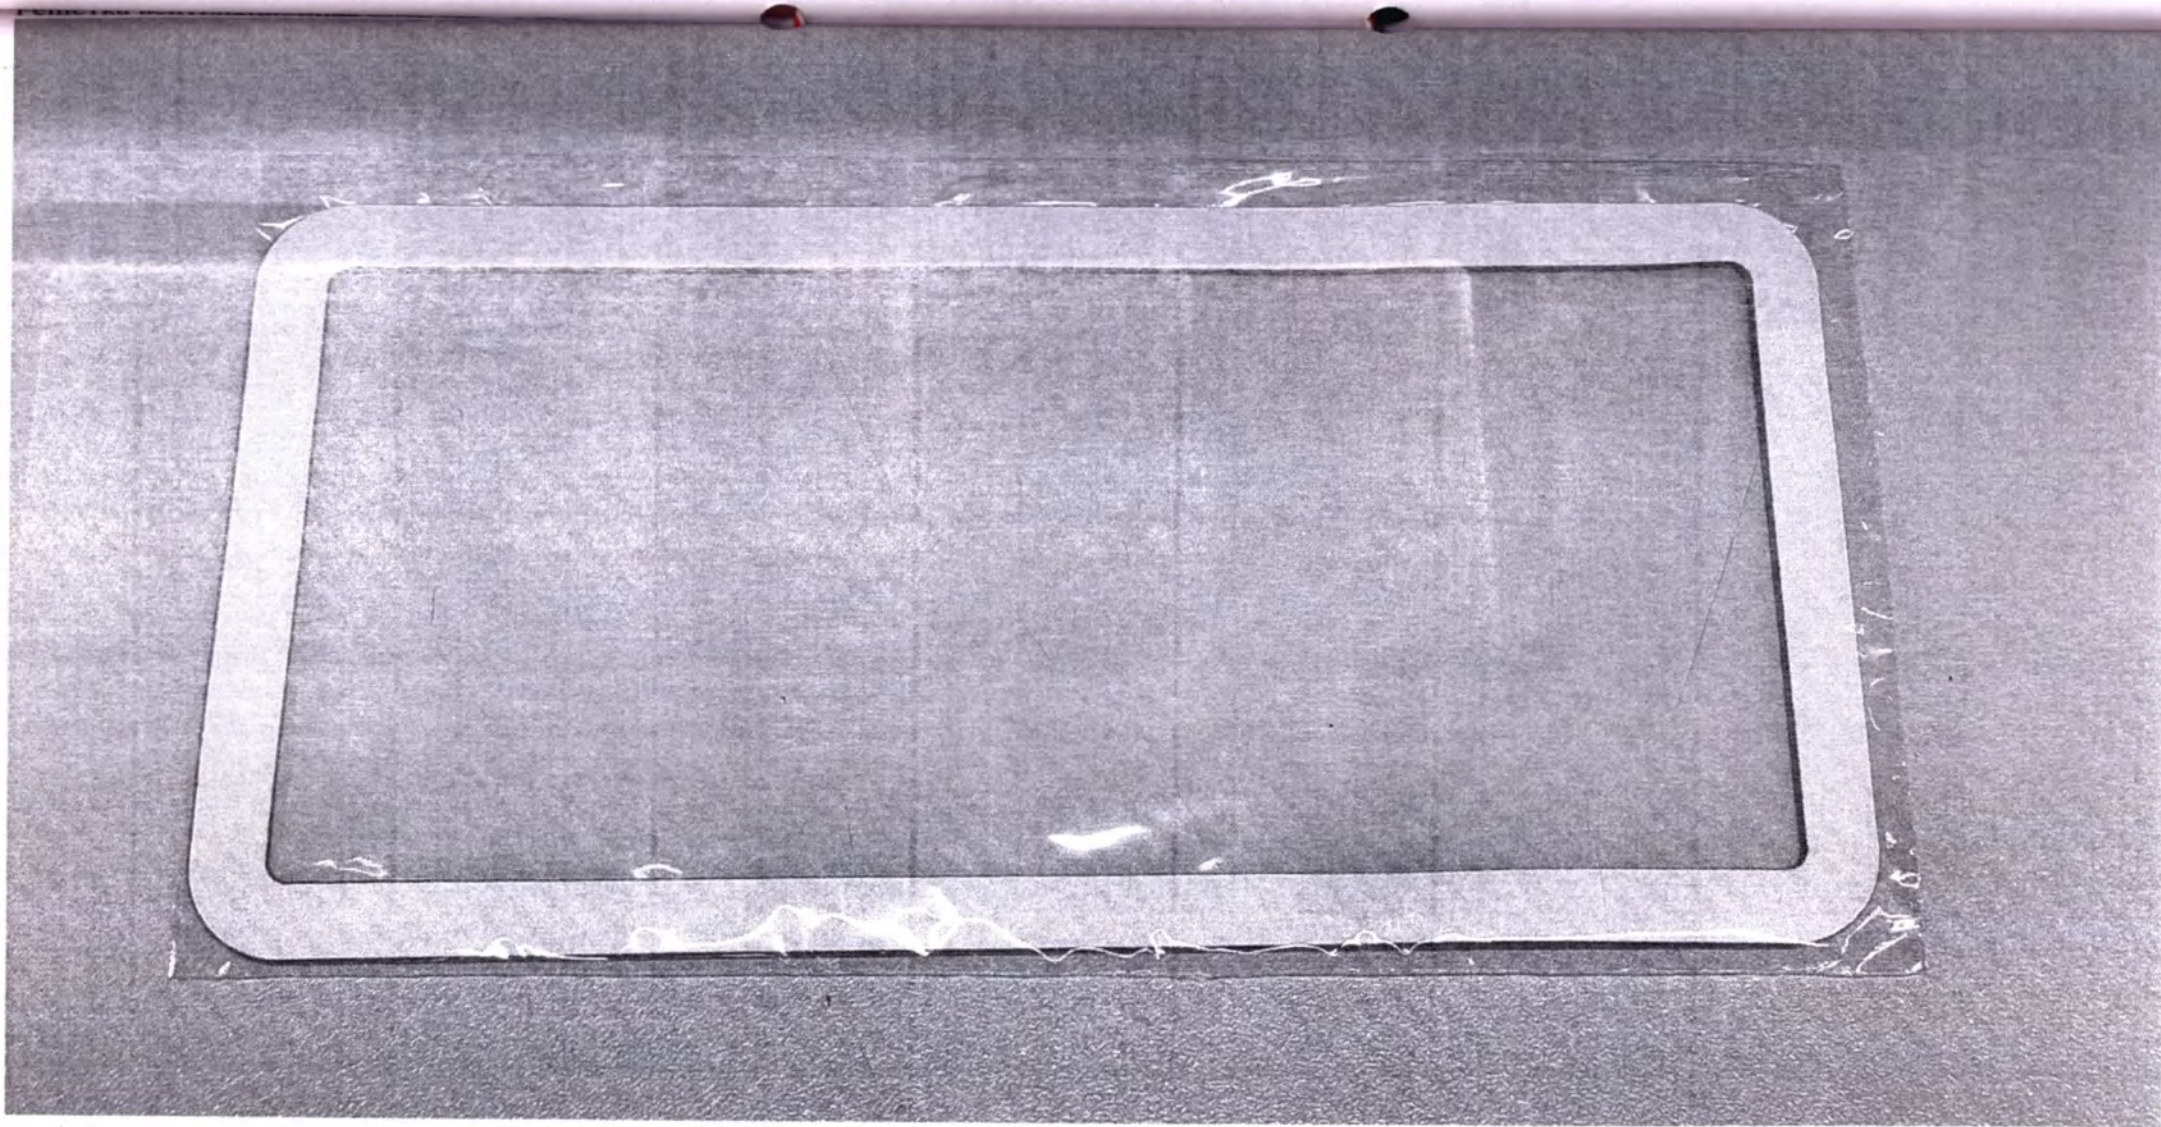

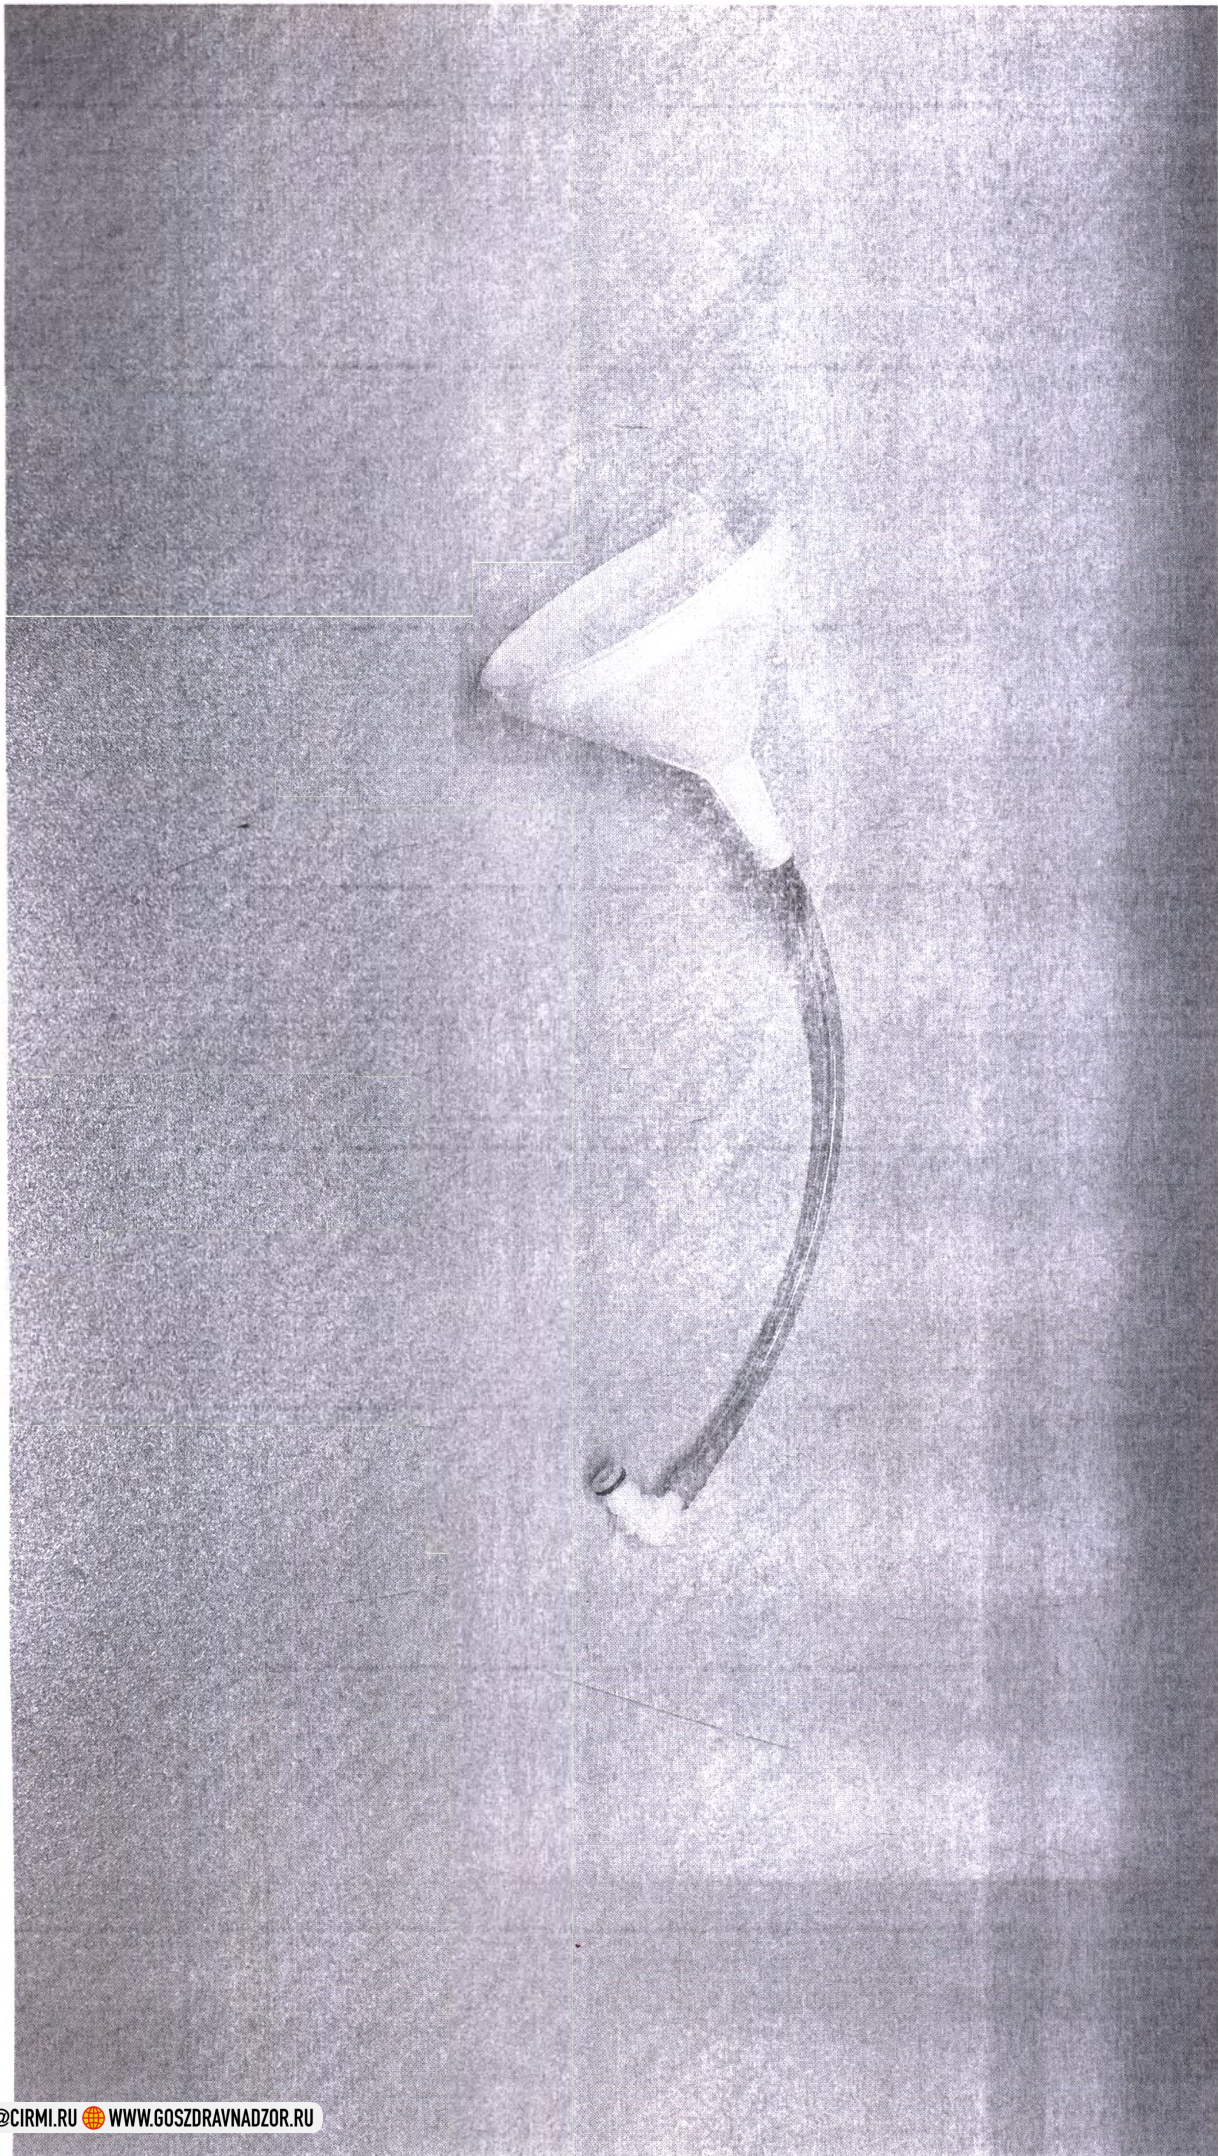

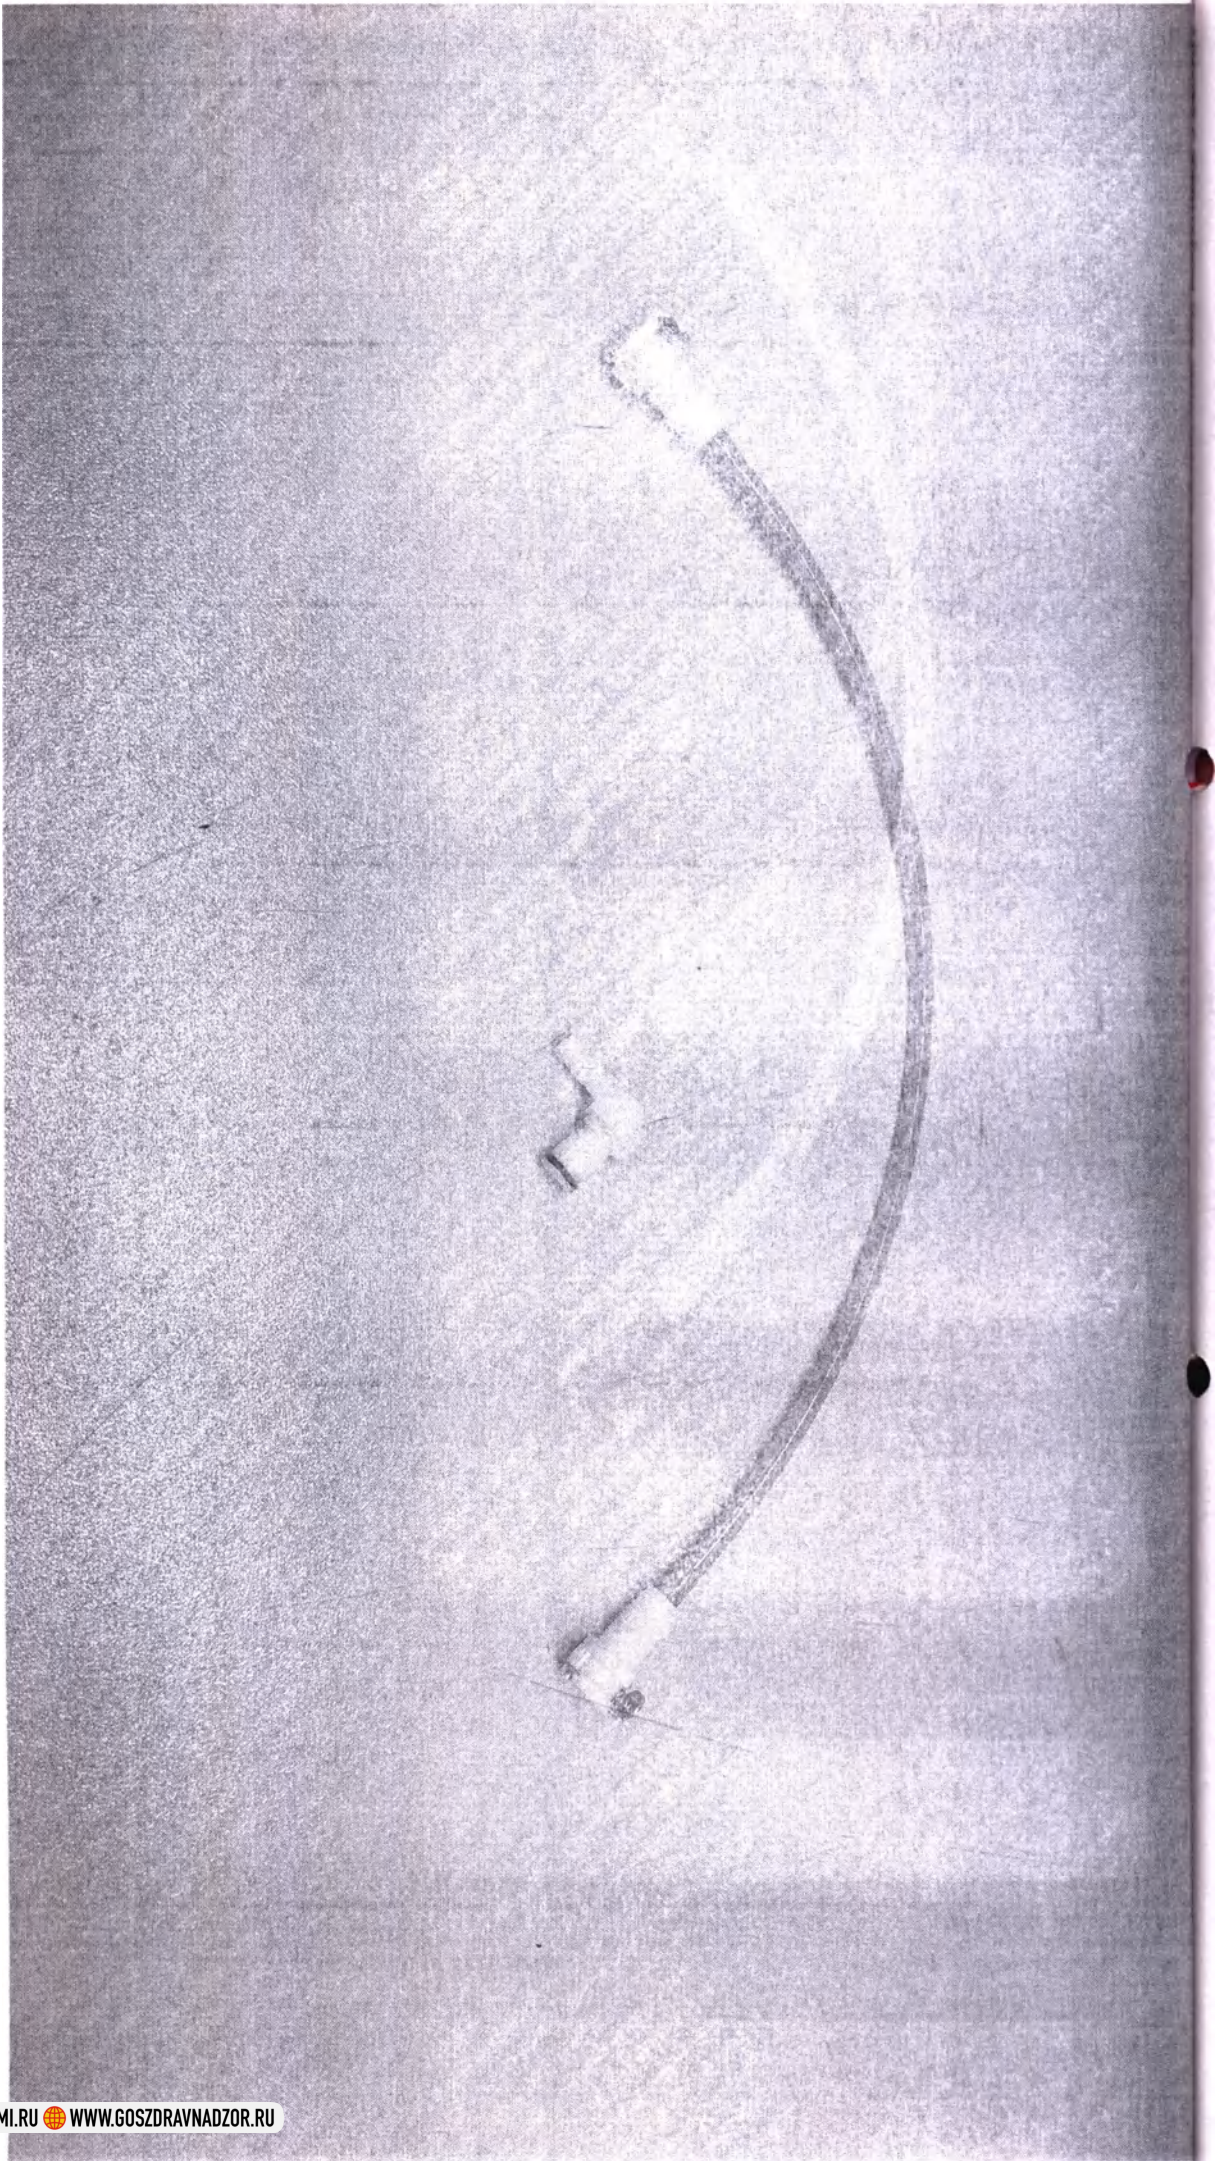

COOLANT 10%
THERMOSALIN 10%


INDICAZIONI D'USO

AVVERTENZE


PRECAUZIONI

1. 2. 3.


000 IJPMI INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

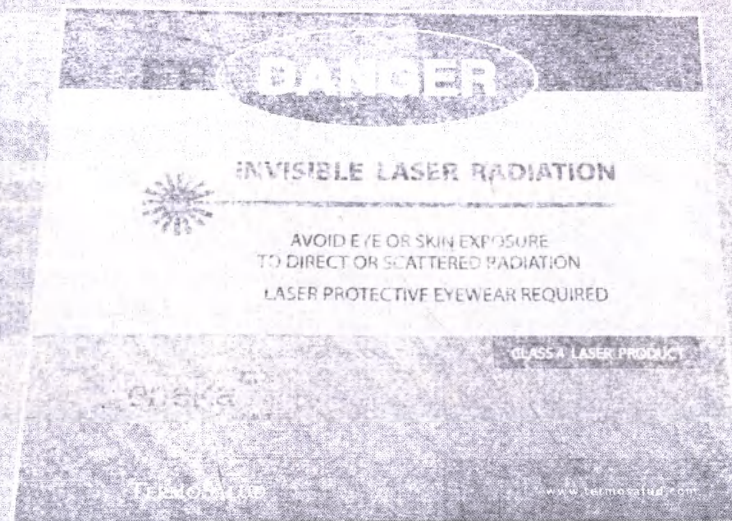


Устройство для блокировки при открытии двери – 1 шт.

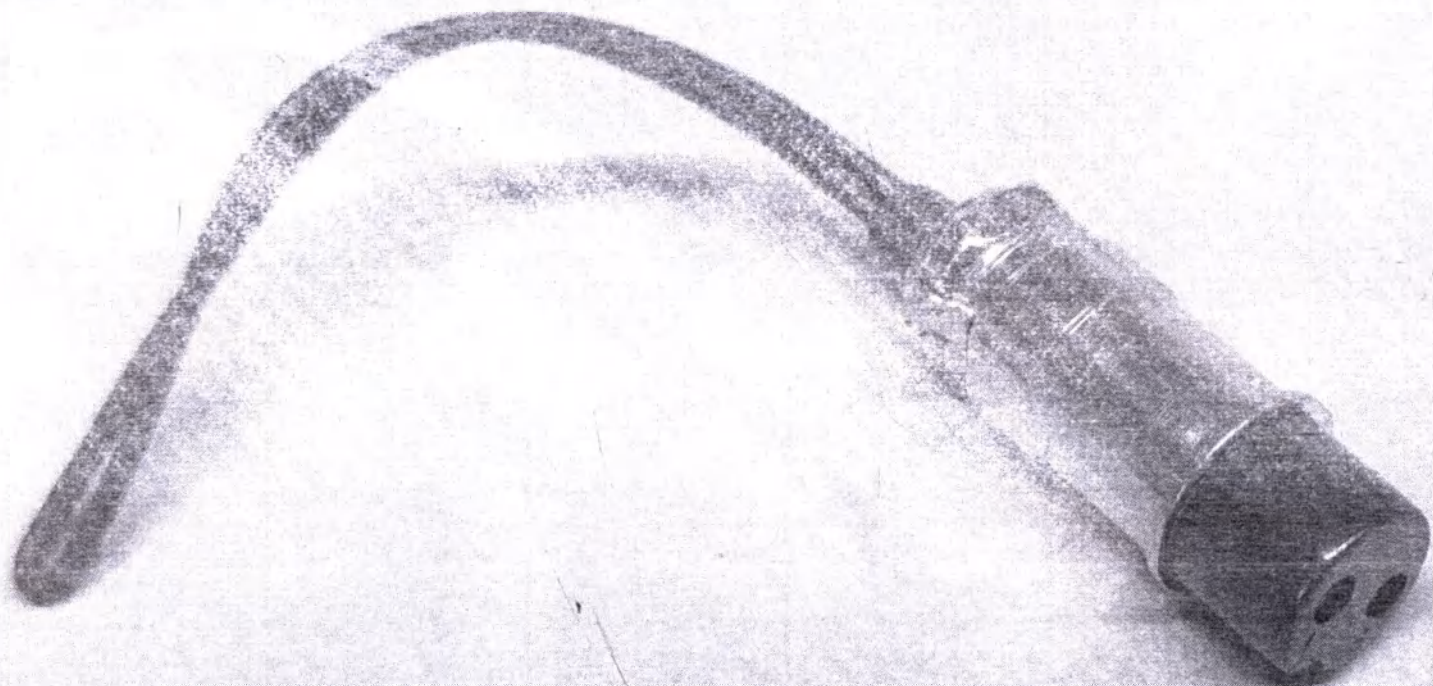


Решетка вентиляционная большая – 1 шт.

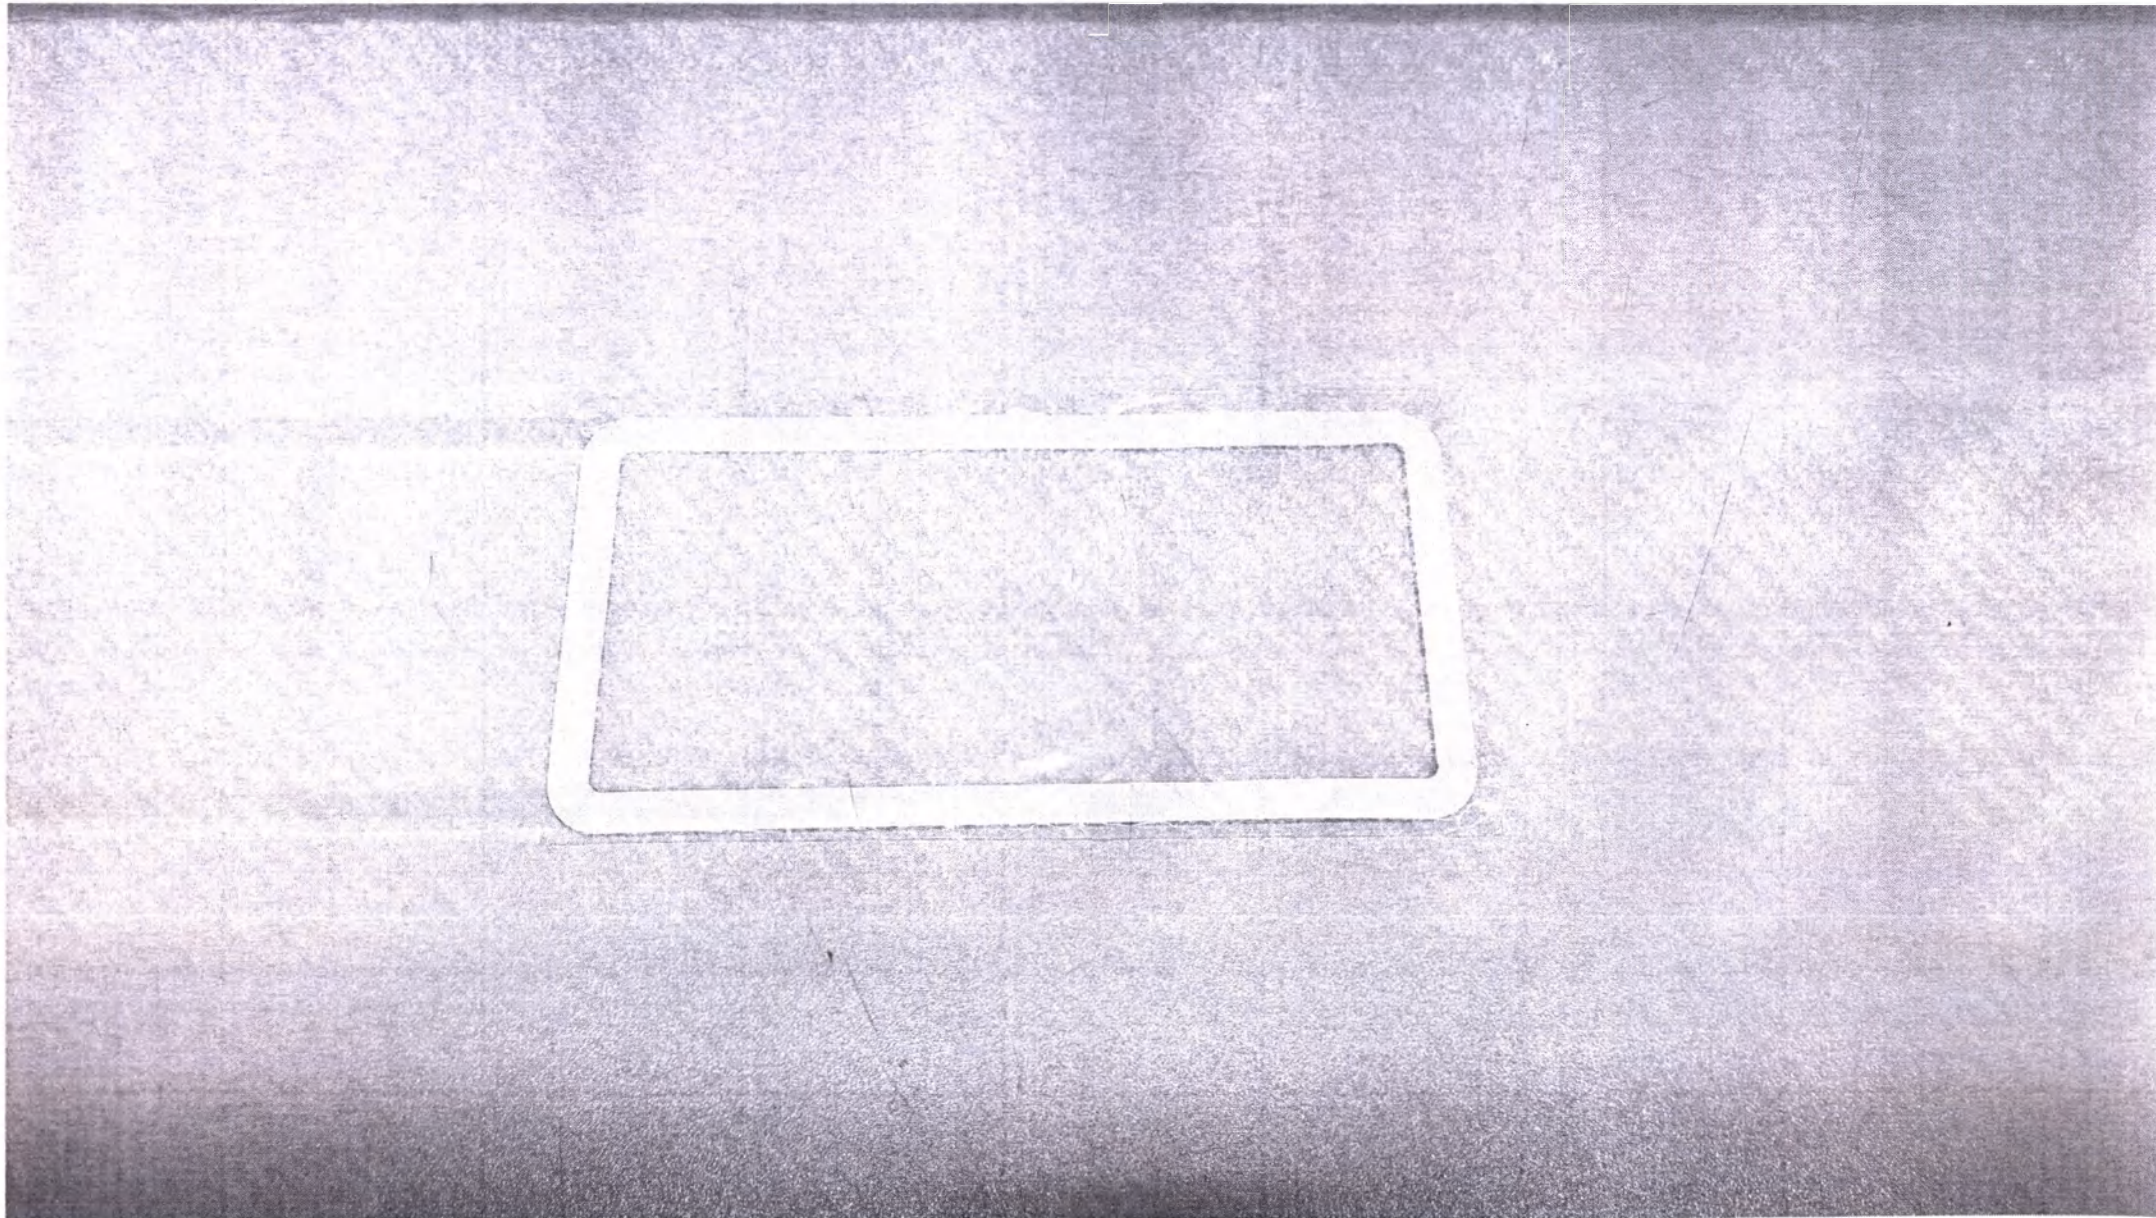

Гумбочка для хранения рукояток – 1 шт.

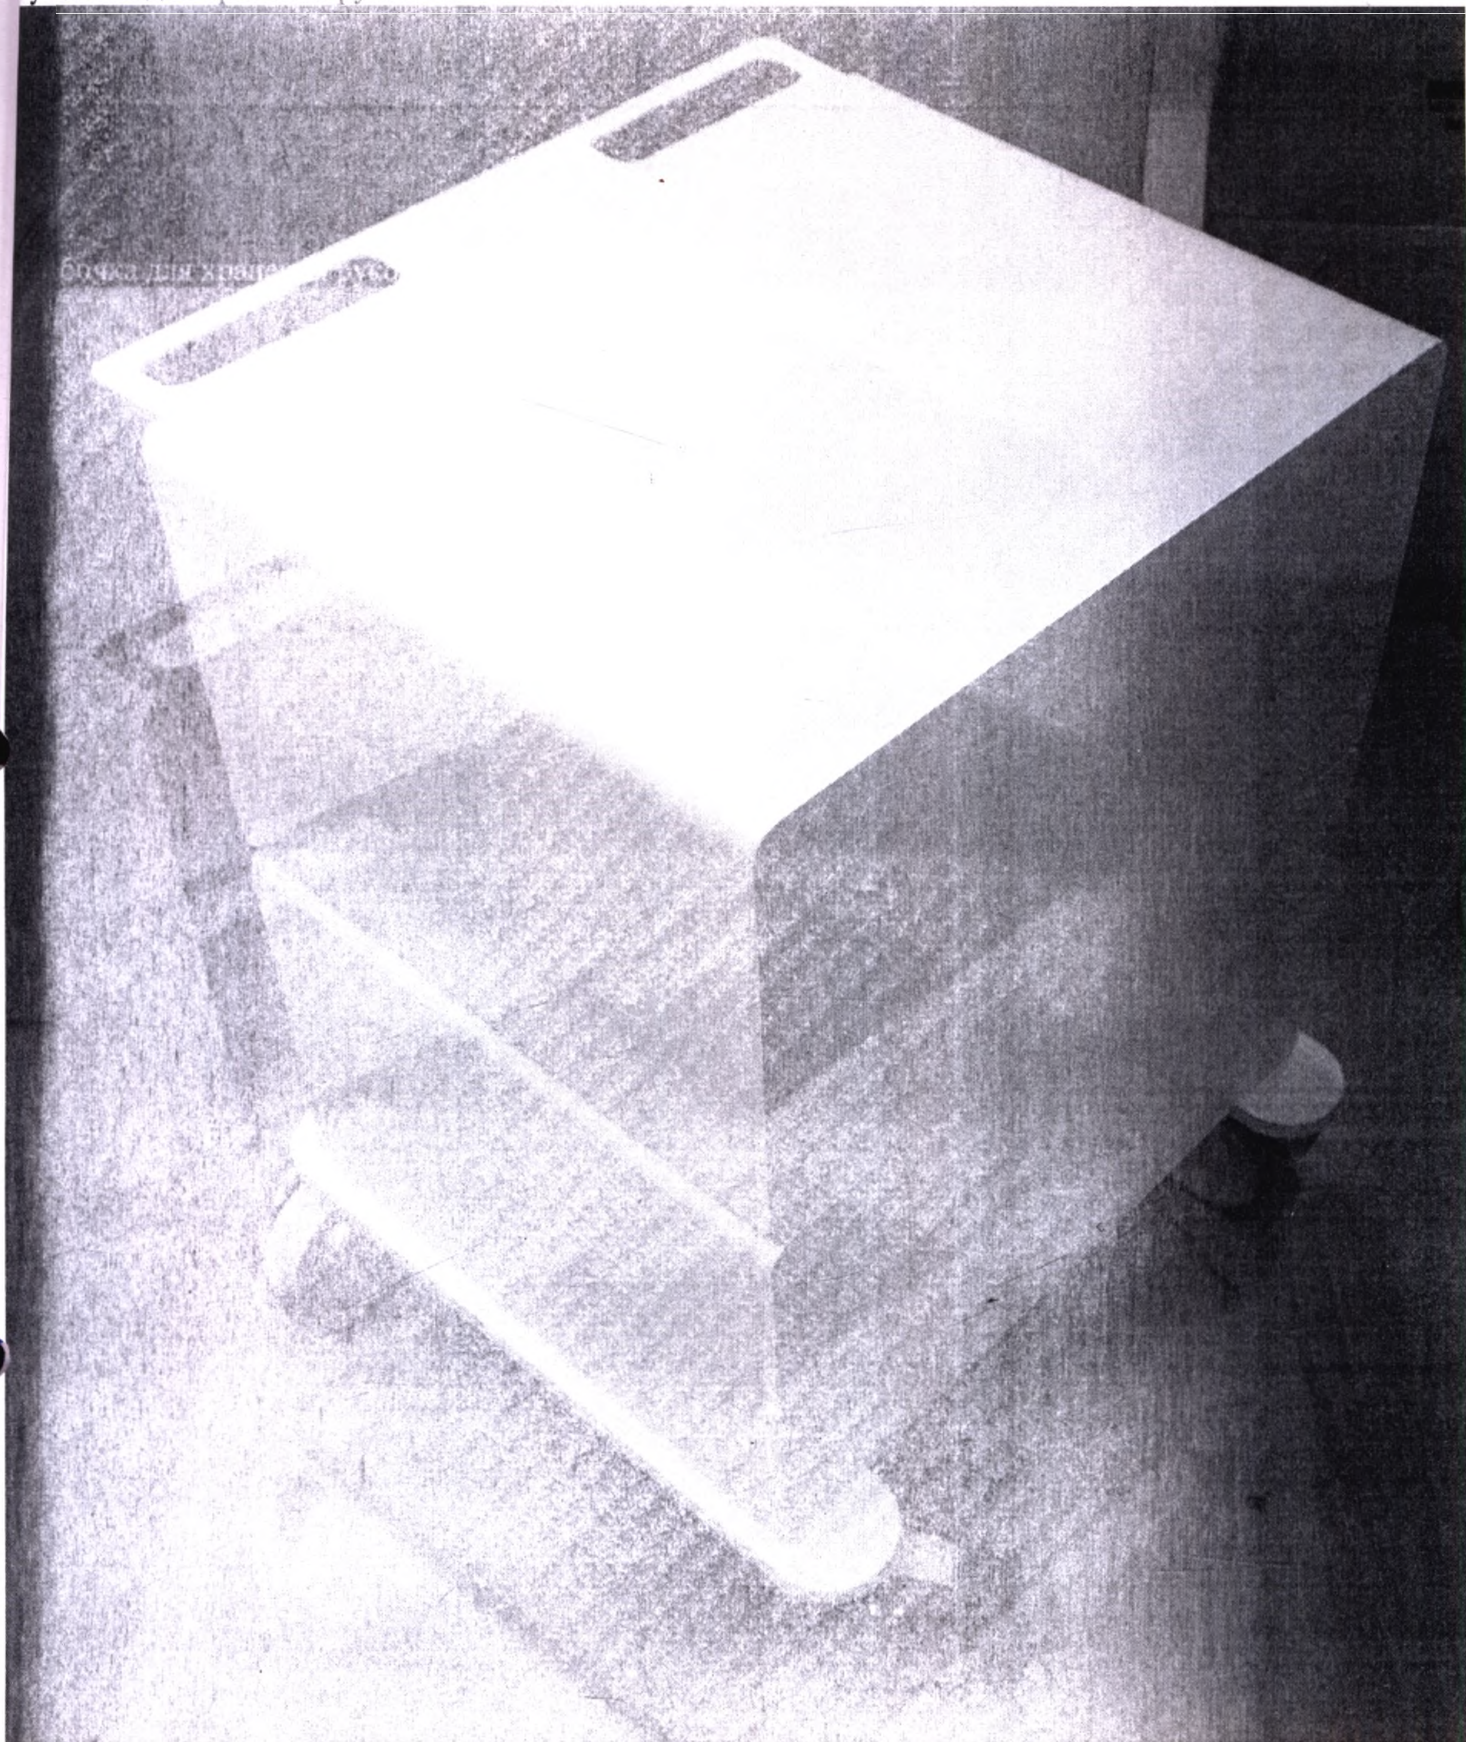

Контейнер для отходов – 1 шт.

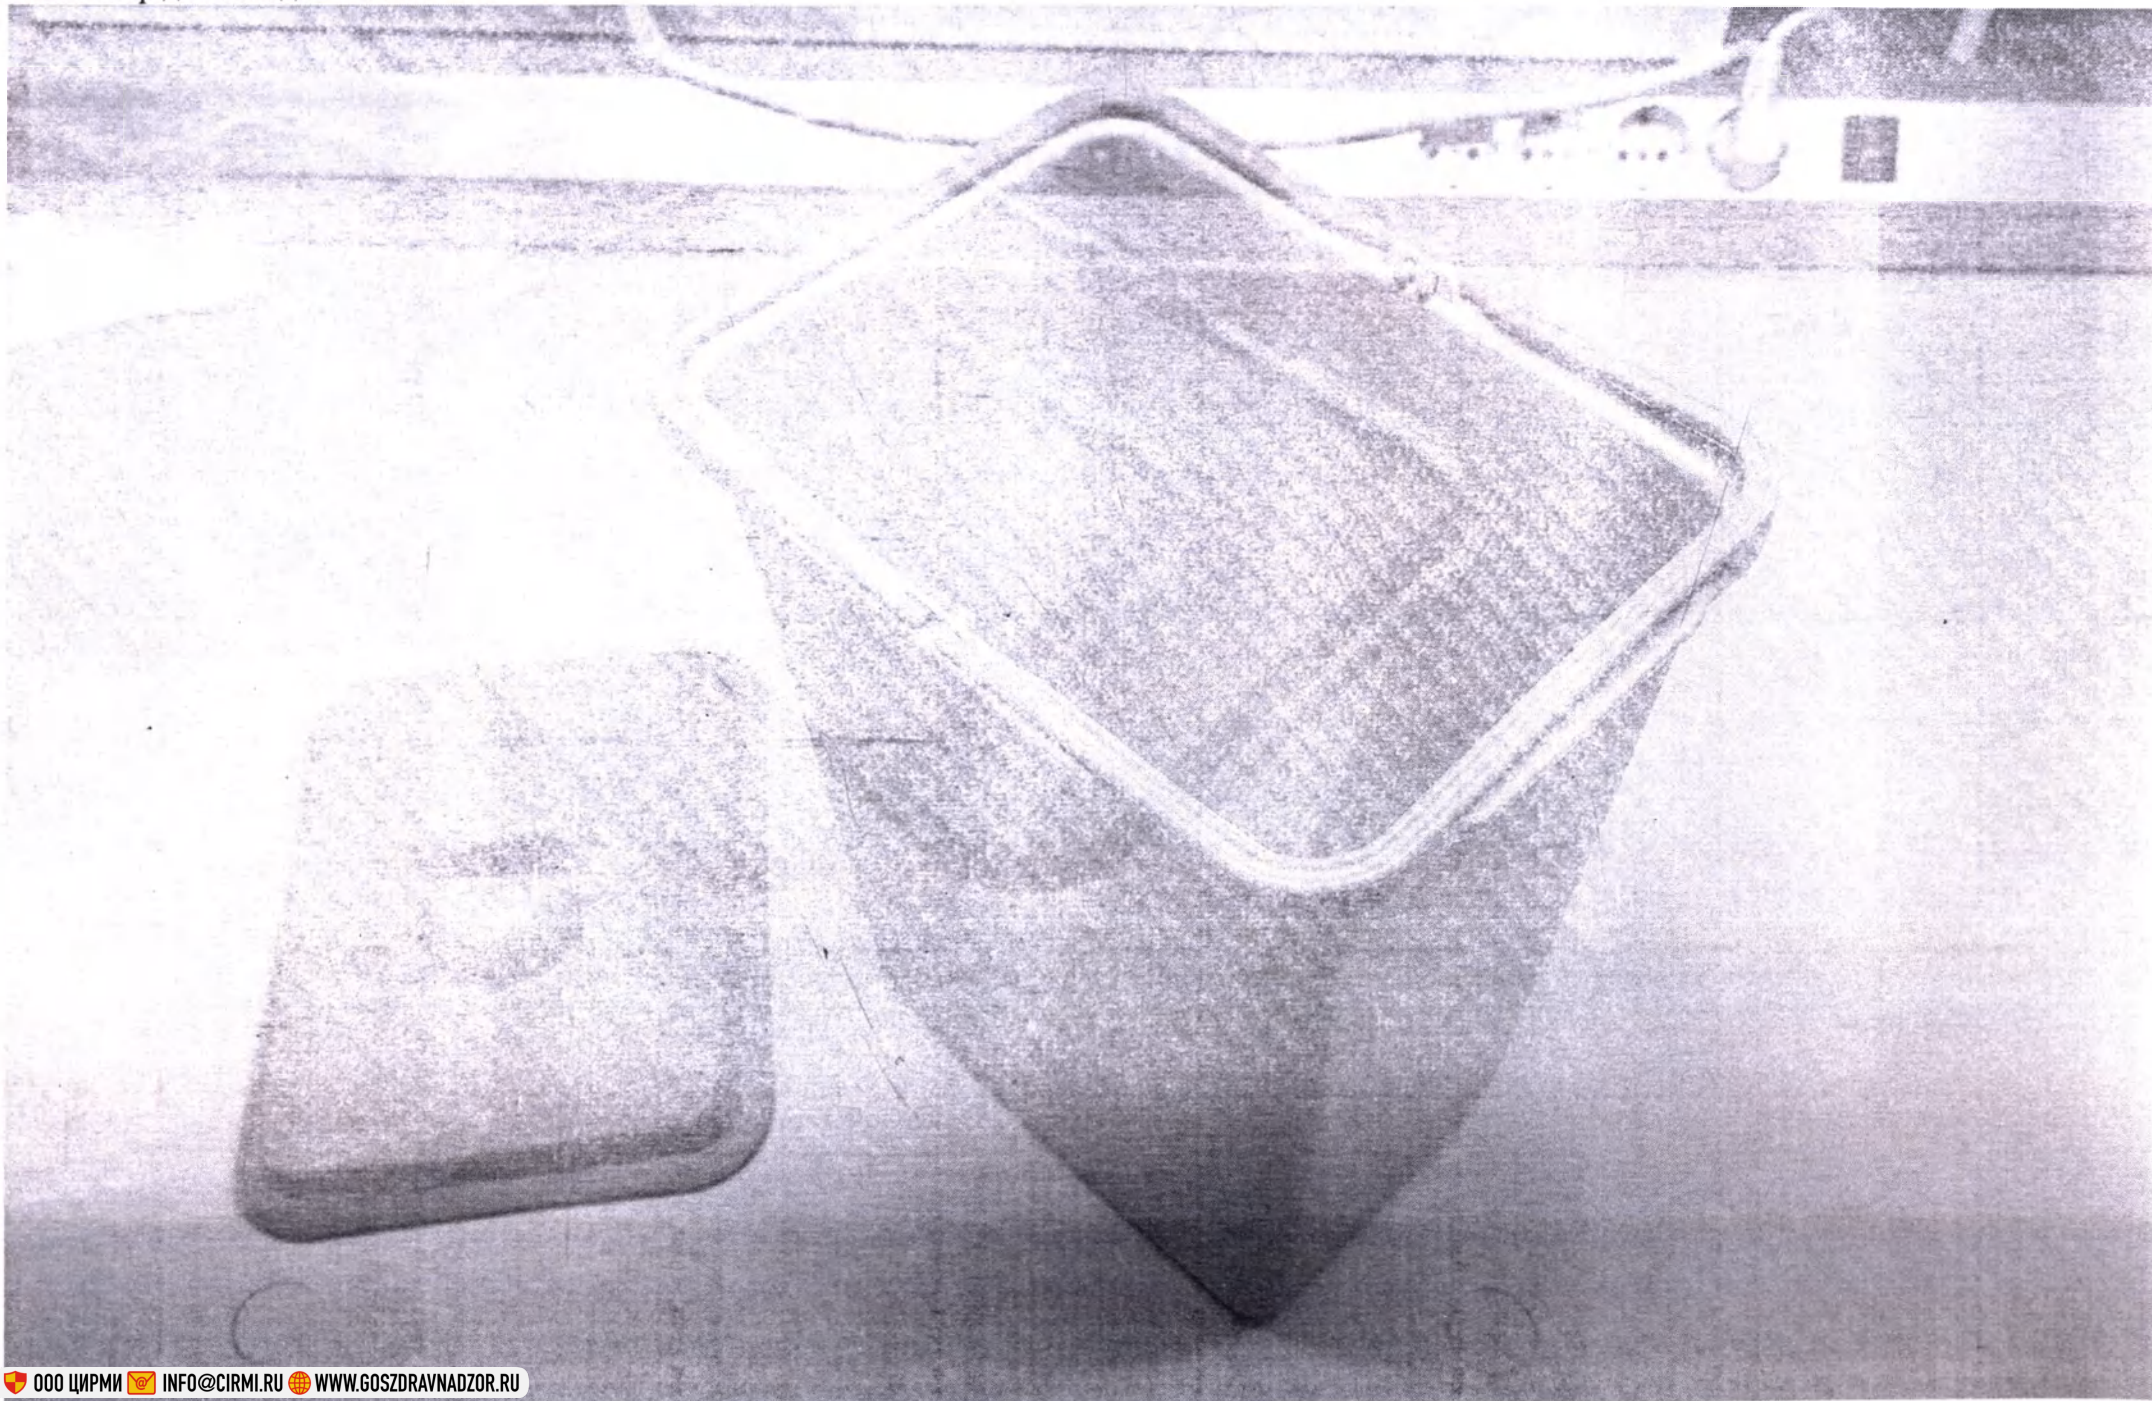

Держатель контейнера для отходов – 1 шт.





MANEATSBY
DO NOT MOVE HAND
KEEPLANT

MAINTENANCE PLANS

1870-1871

Всего прошито
22 листа

