

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

УТВЕРЖДАЮ

Супервайзер отдела регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Паламарь Е.

М.П.



Фотографические изображения медицинского изделия

*«Набор инструментов для установки имплантатов для лечения нестабильности
плечевого сустава Latarjet EXPERIENCE»
производства
Medos International SARL (Медос Интернешнл САРЛ), Швейцария*

2022г.



Фото 1. Направитель сверла для клювовидного отрезка

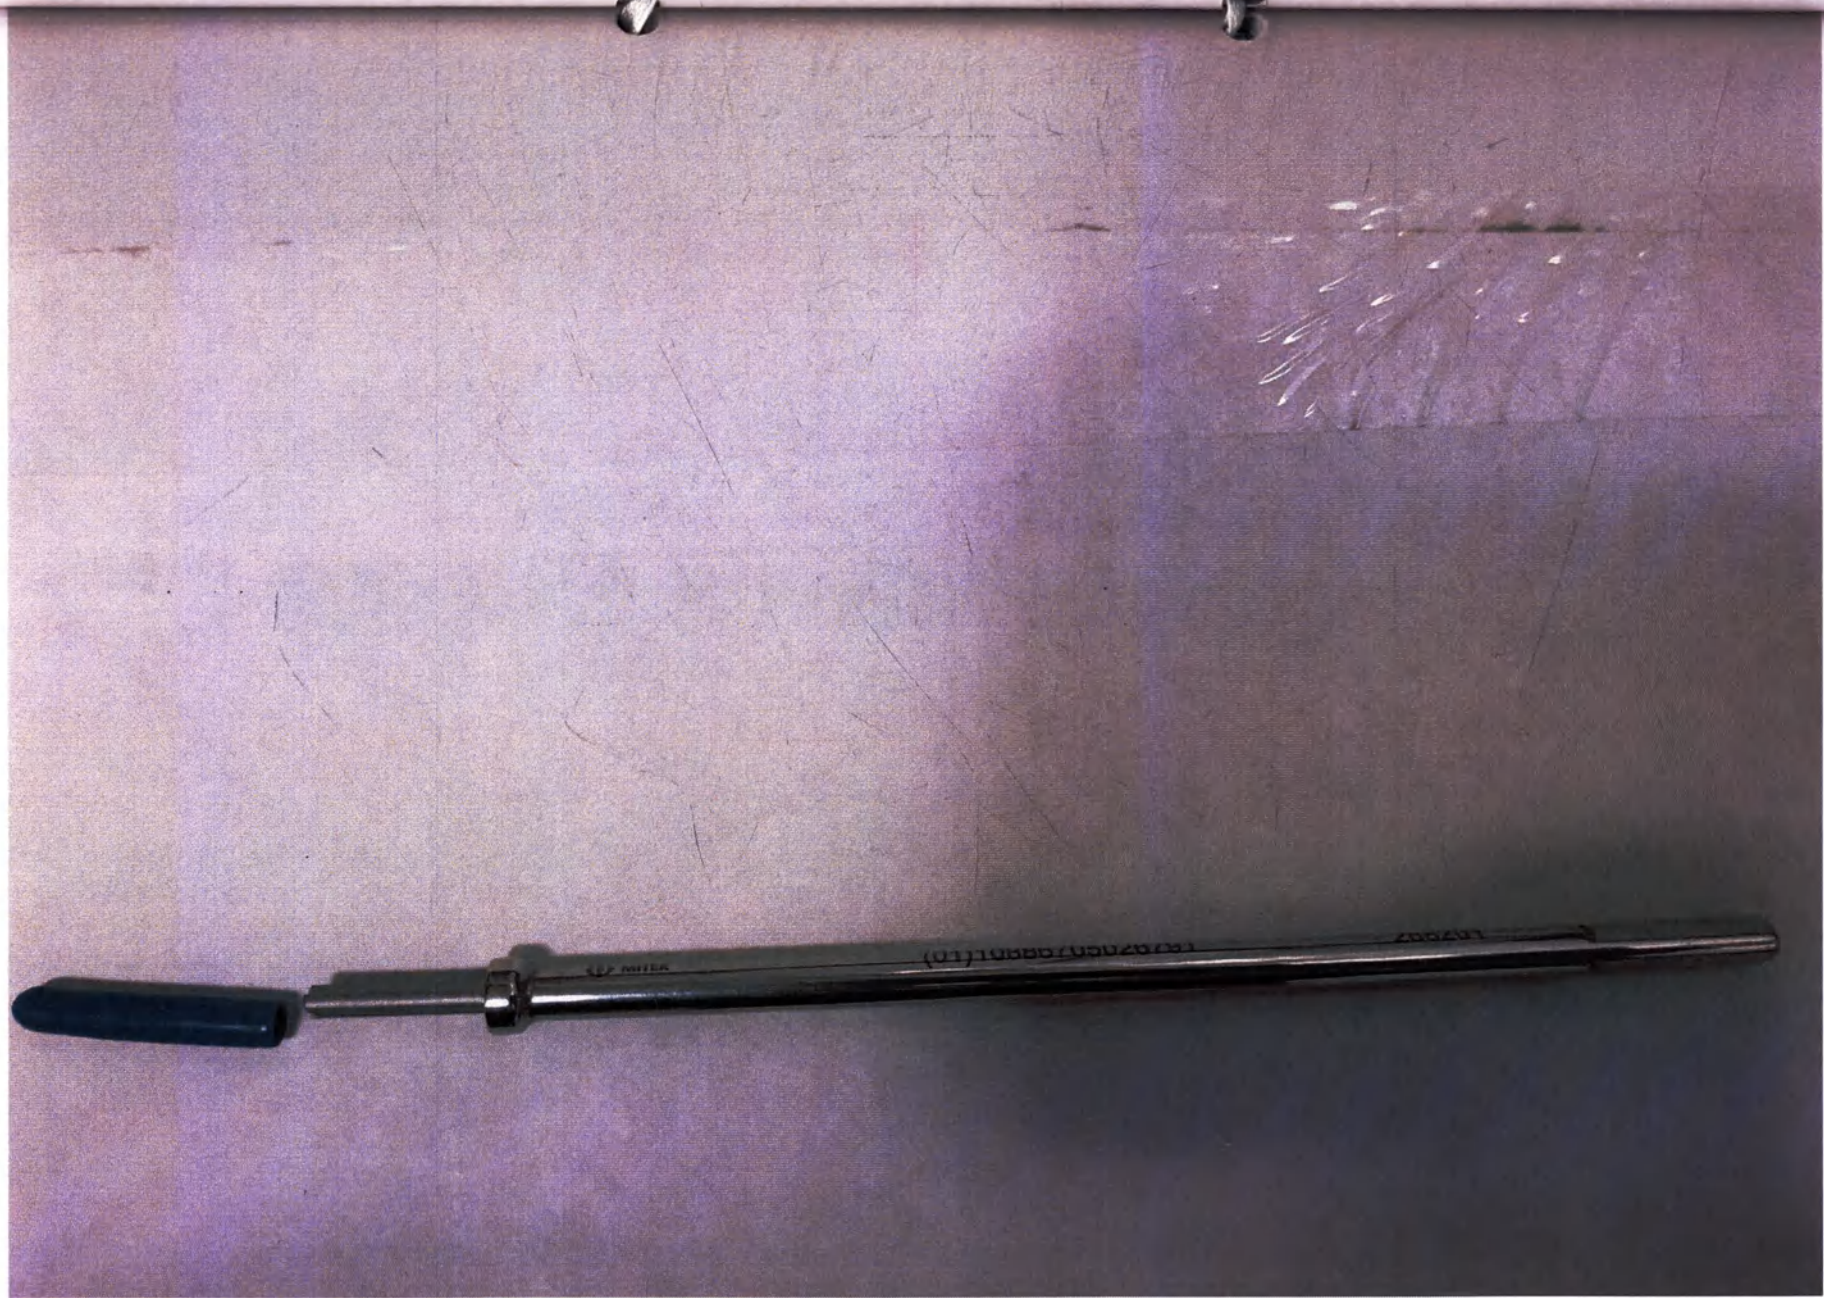


Фото 2. Сверло для клювовидного отростка.



Фото 3. Ретрактор для подлопаточной мышцы

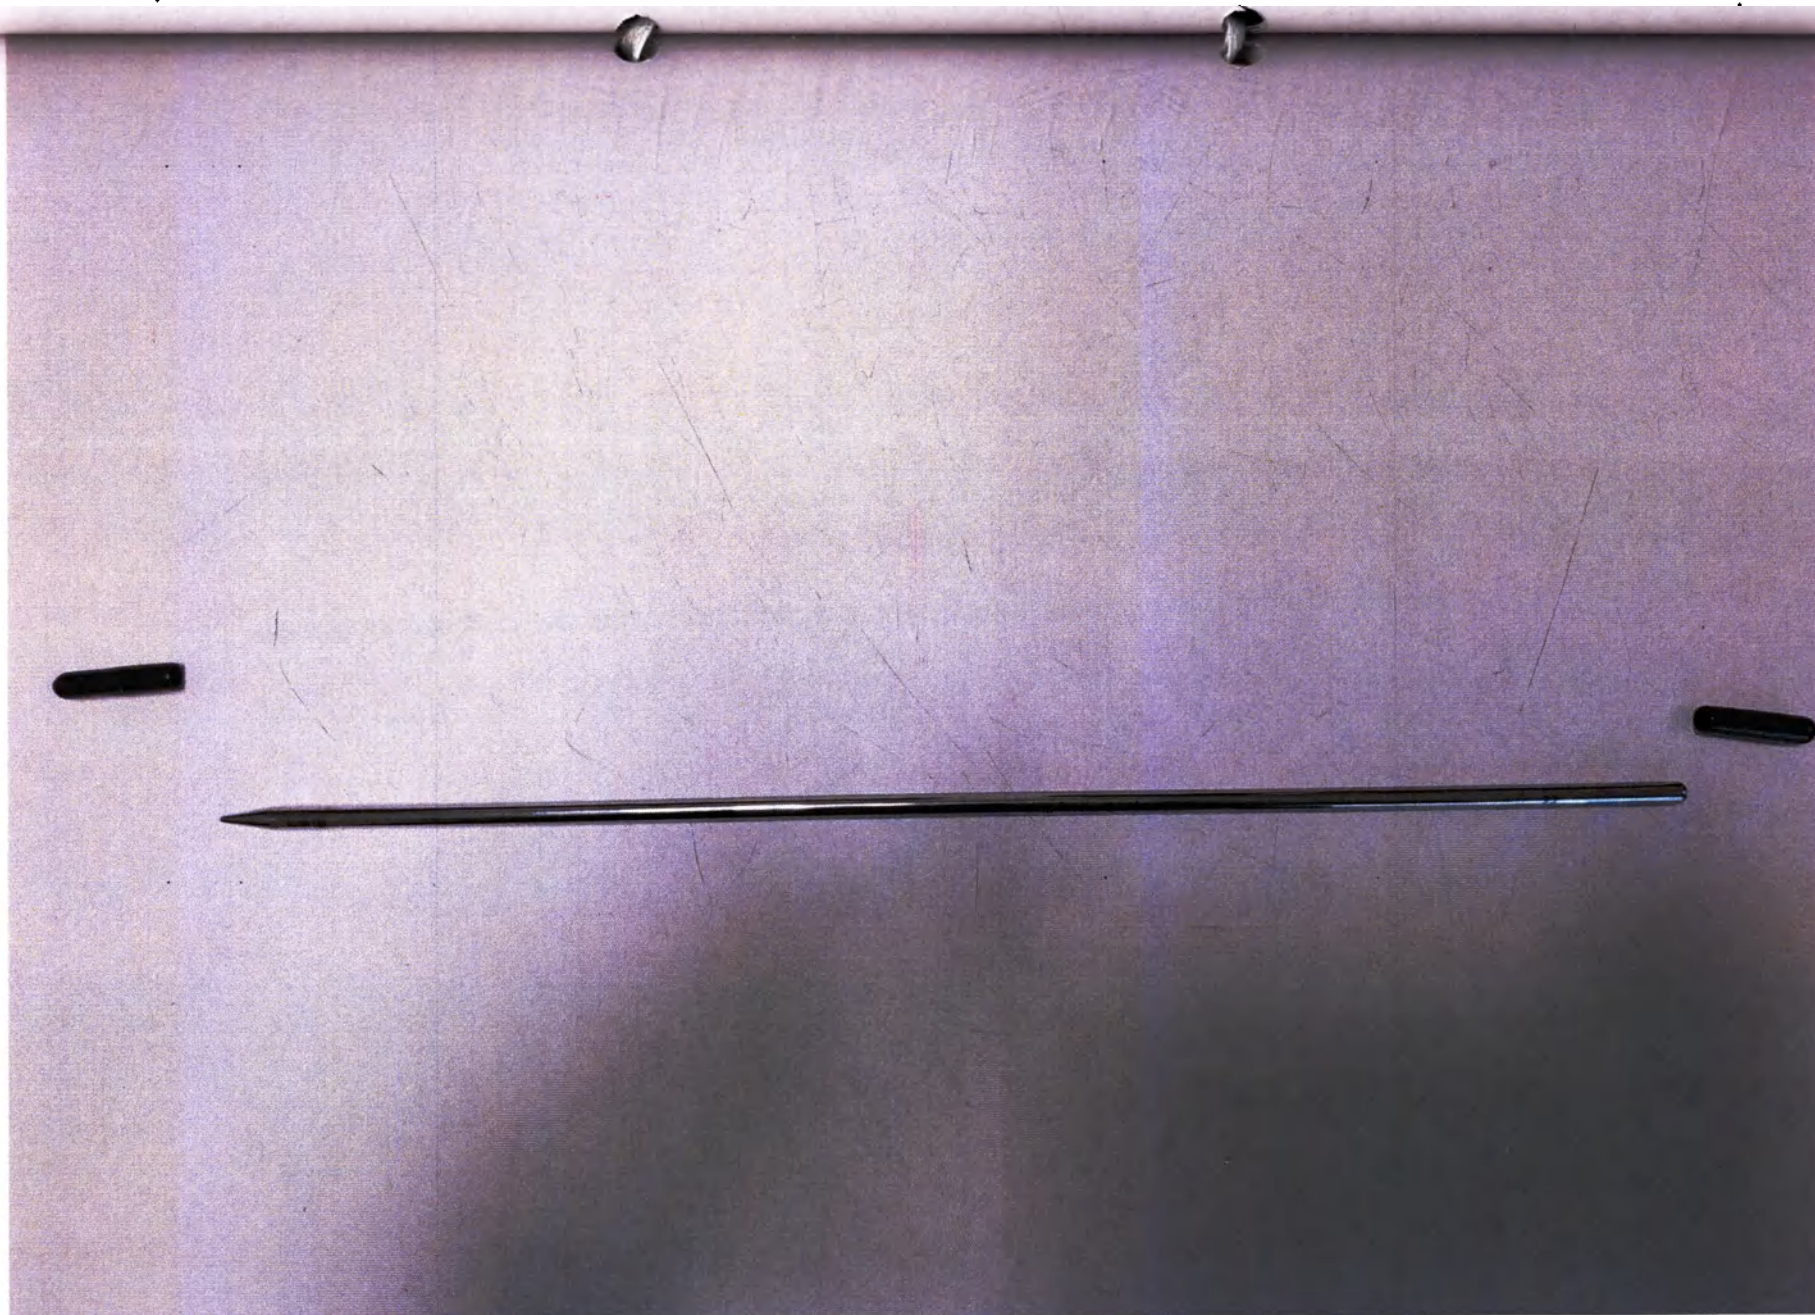


Фото 4. Переключатель Latarjet.

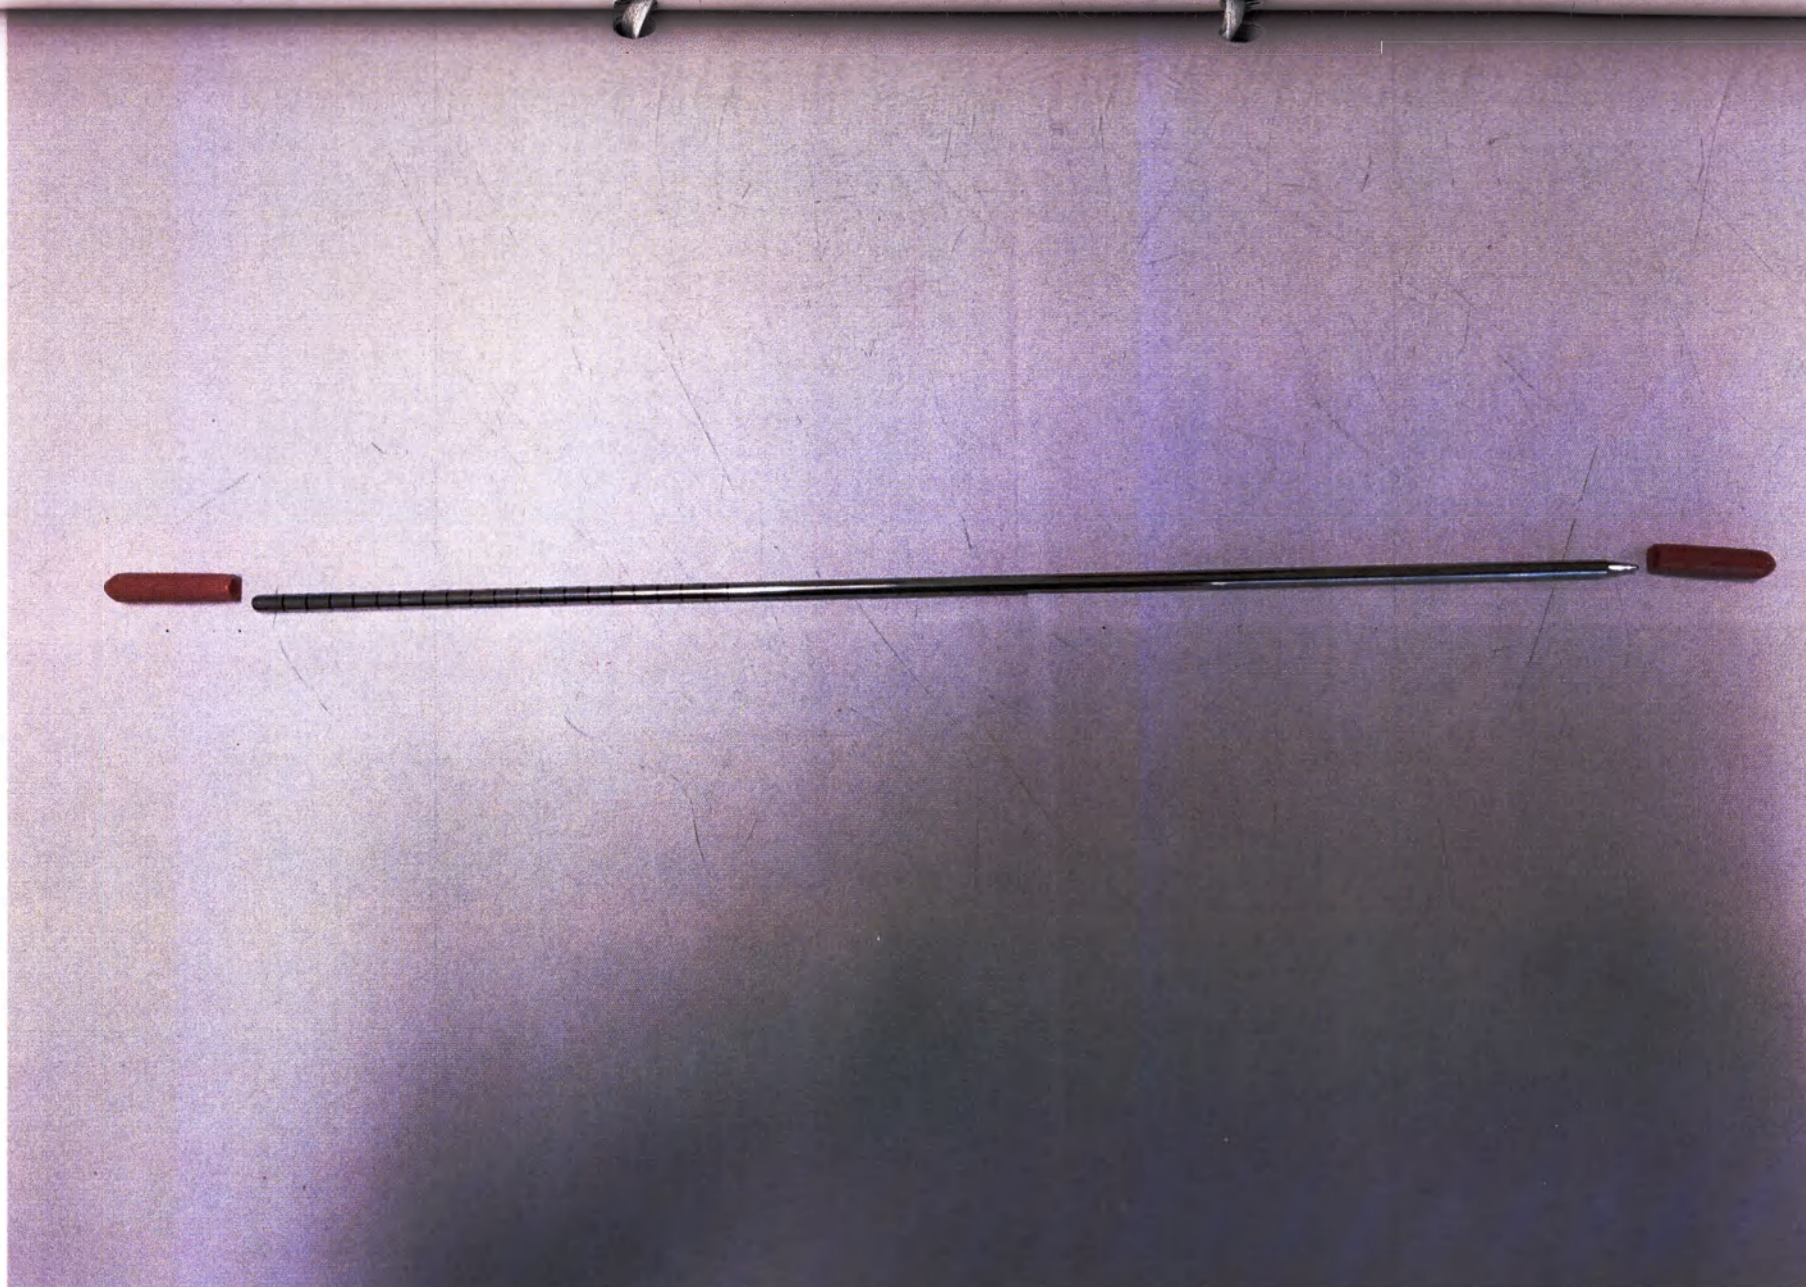


Фото 5. Переключатель малый Latarjet.



Фото 6. Остетом острый изогнутый.

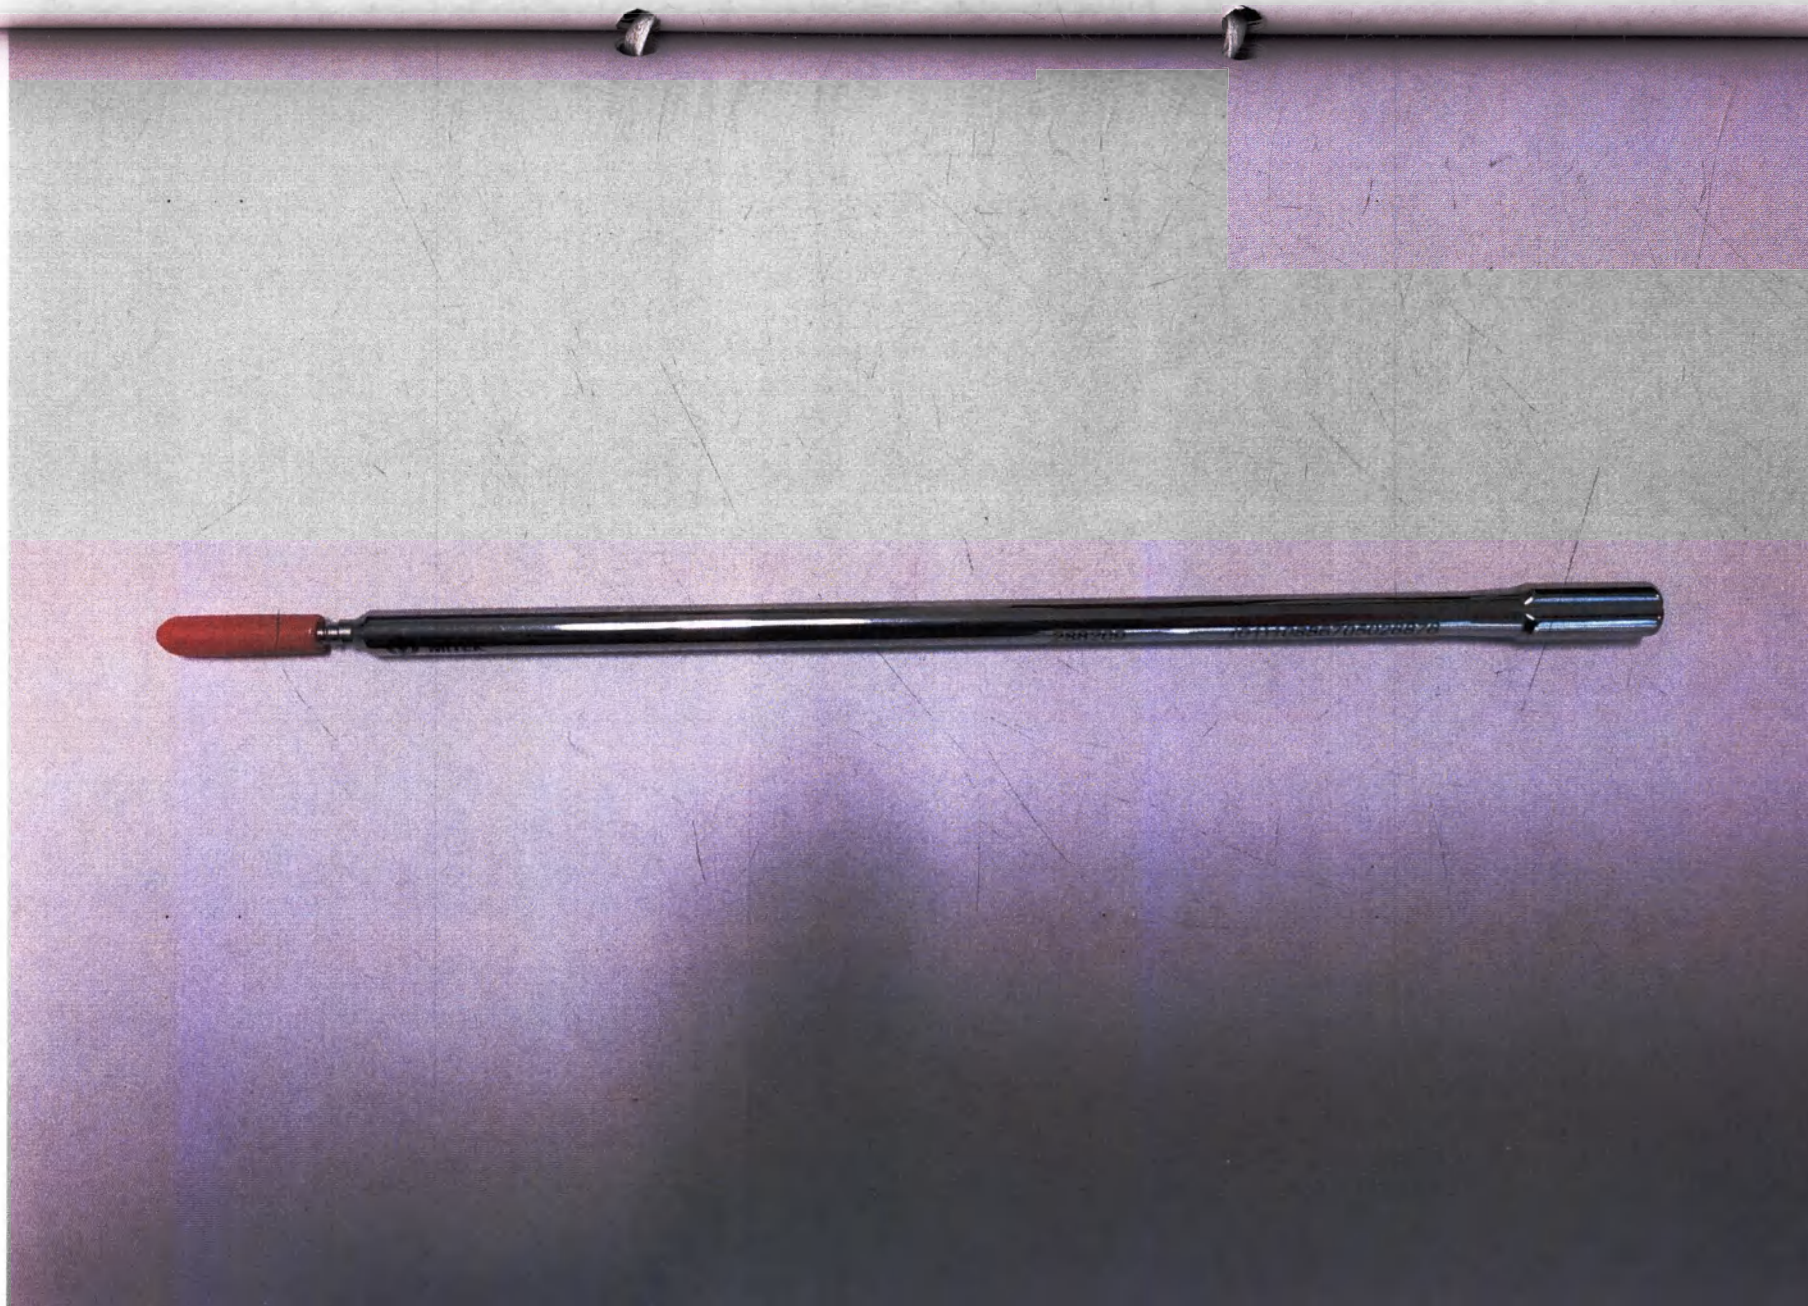


Фото 7. Стержень винтовой для клювовидного отростка 3,5 мм.

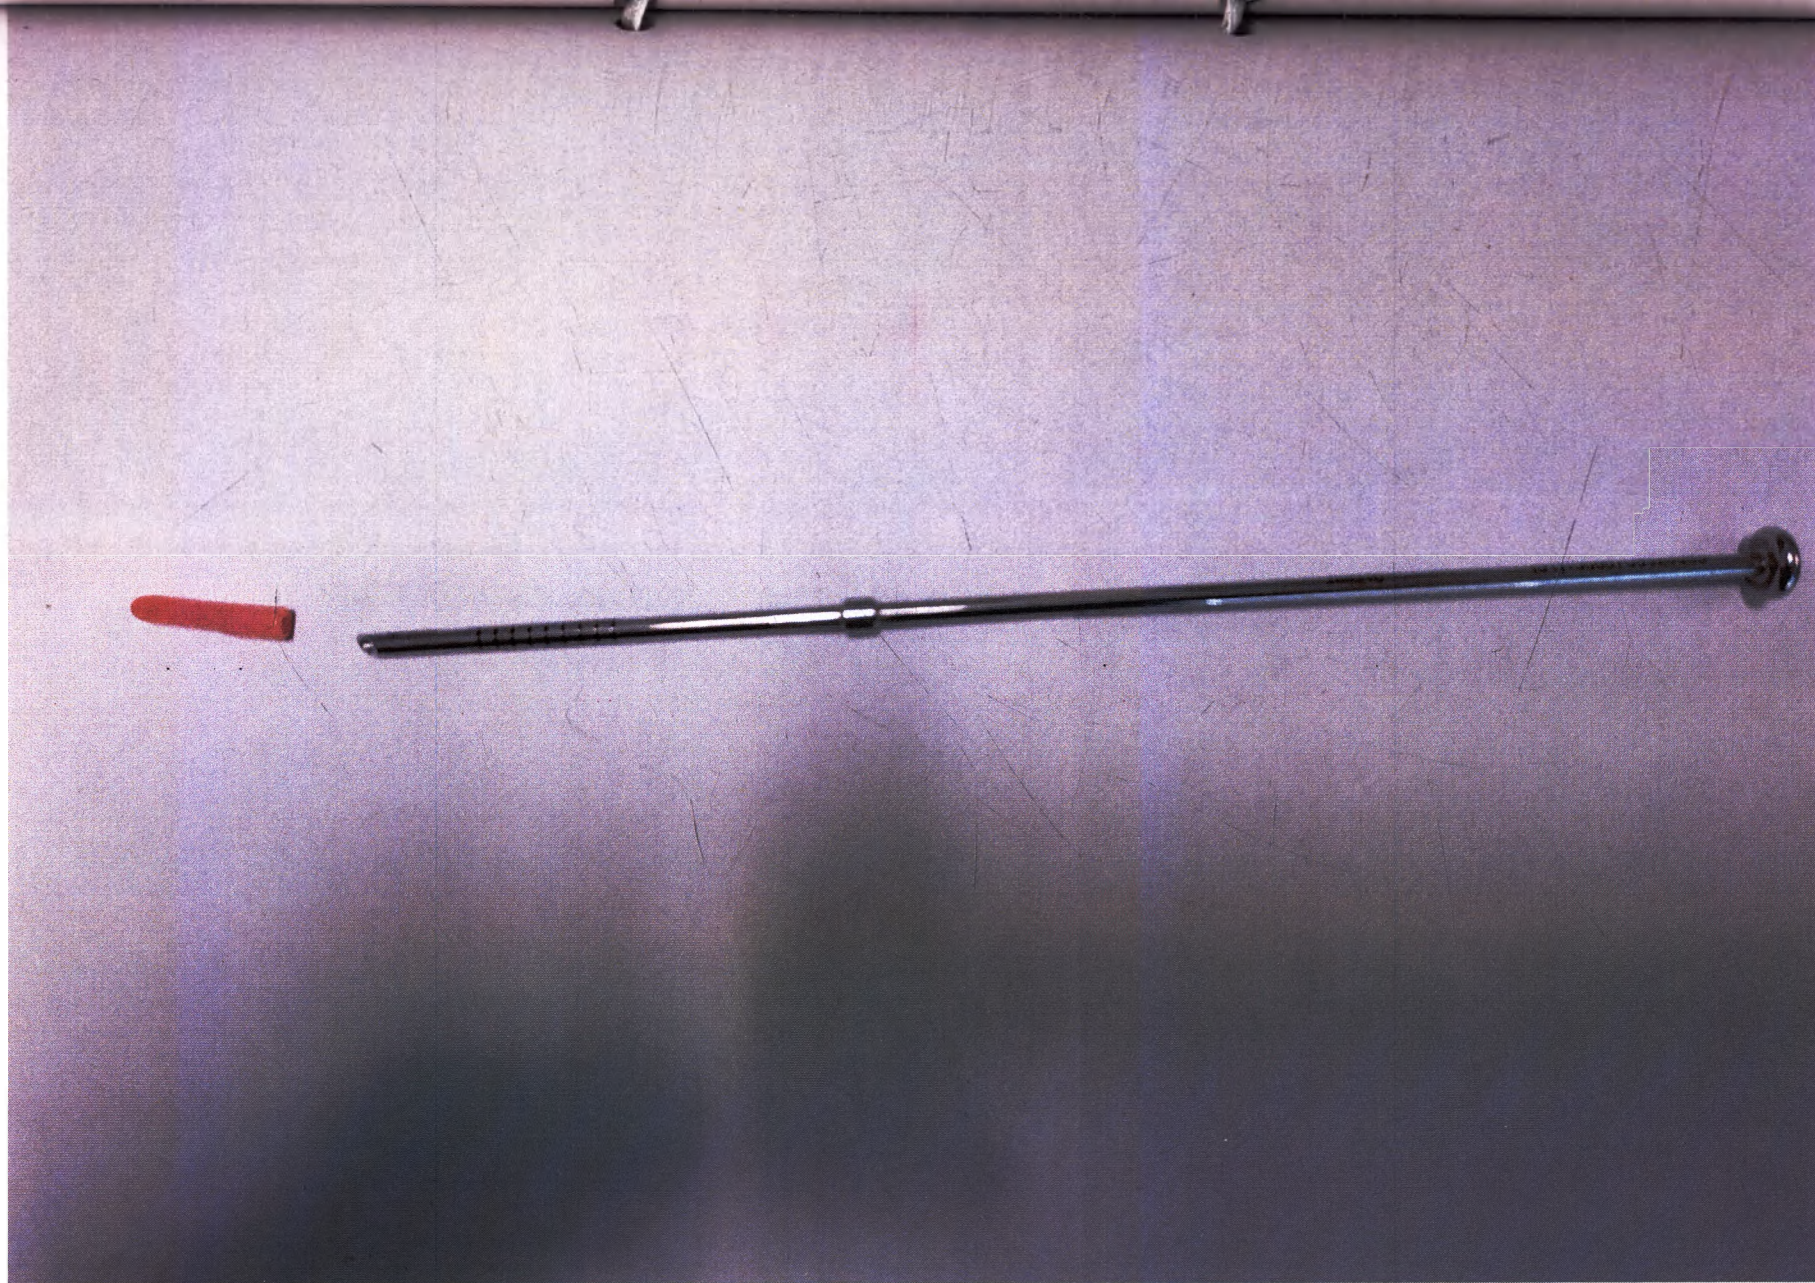


Фото 8. Зонд измерительный.

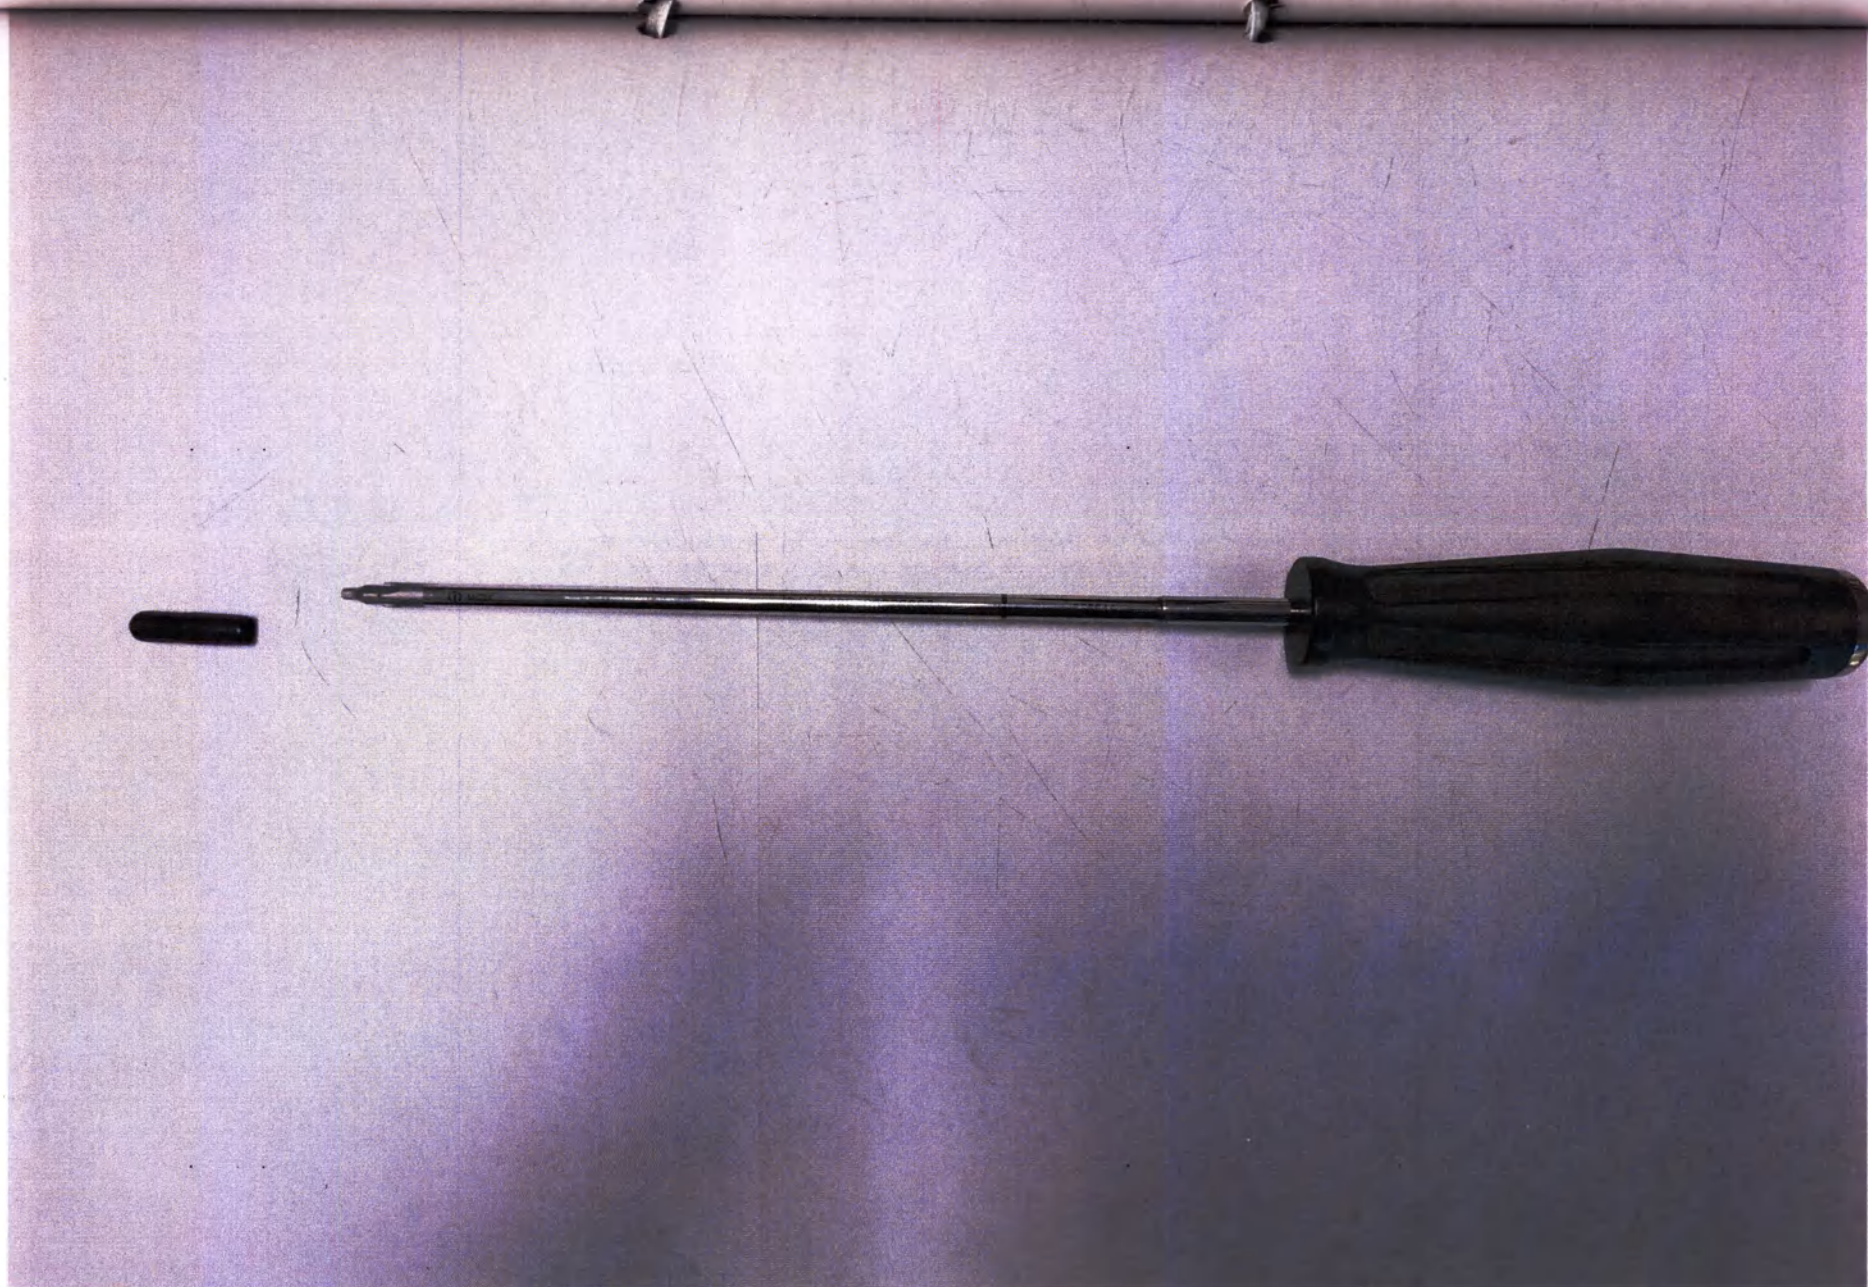


Фото 9. Отвертка комбинированная.

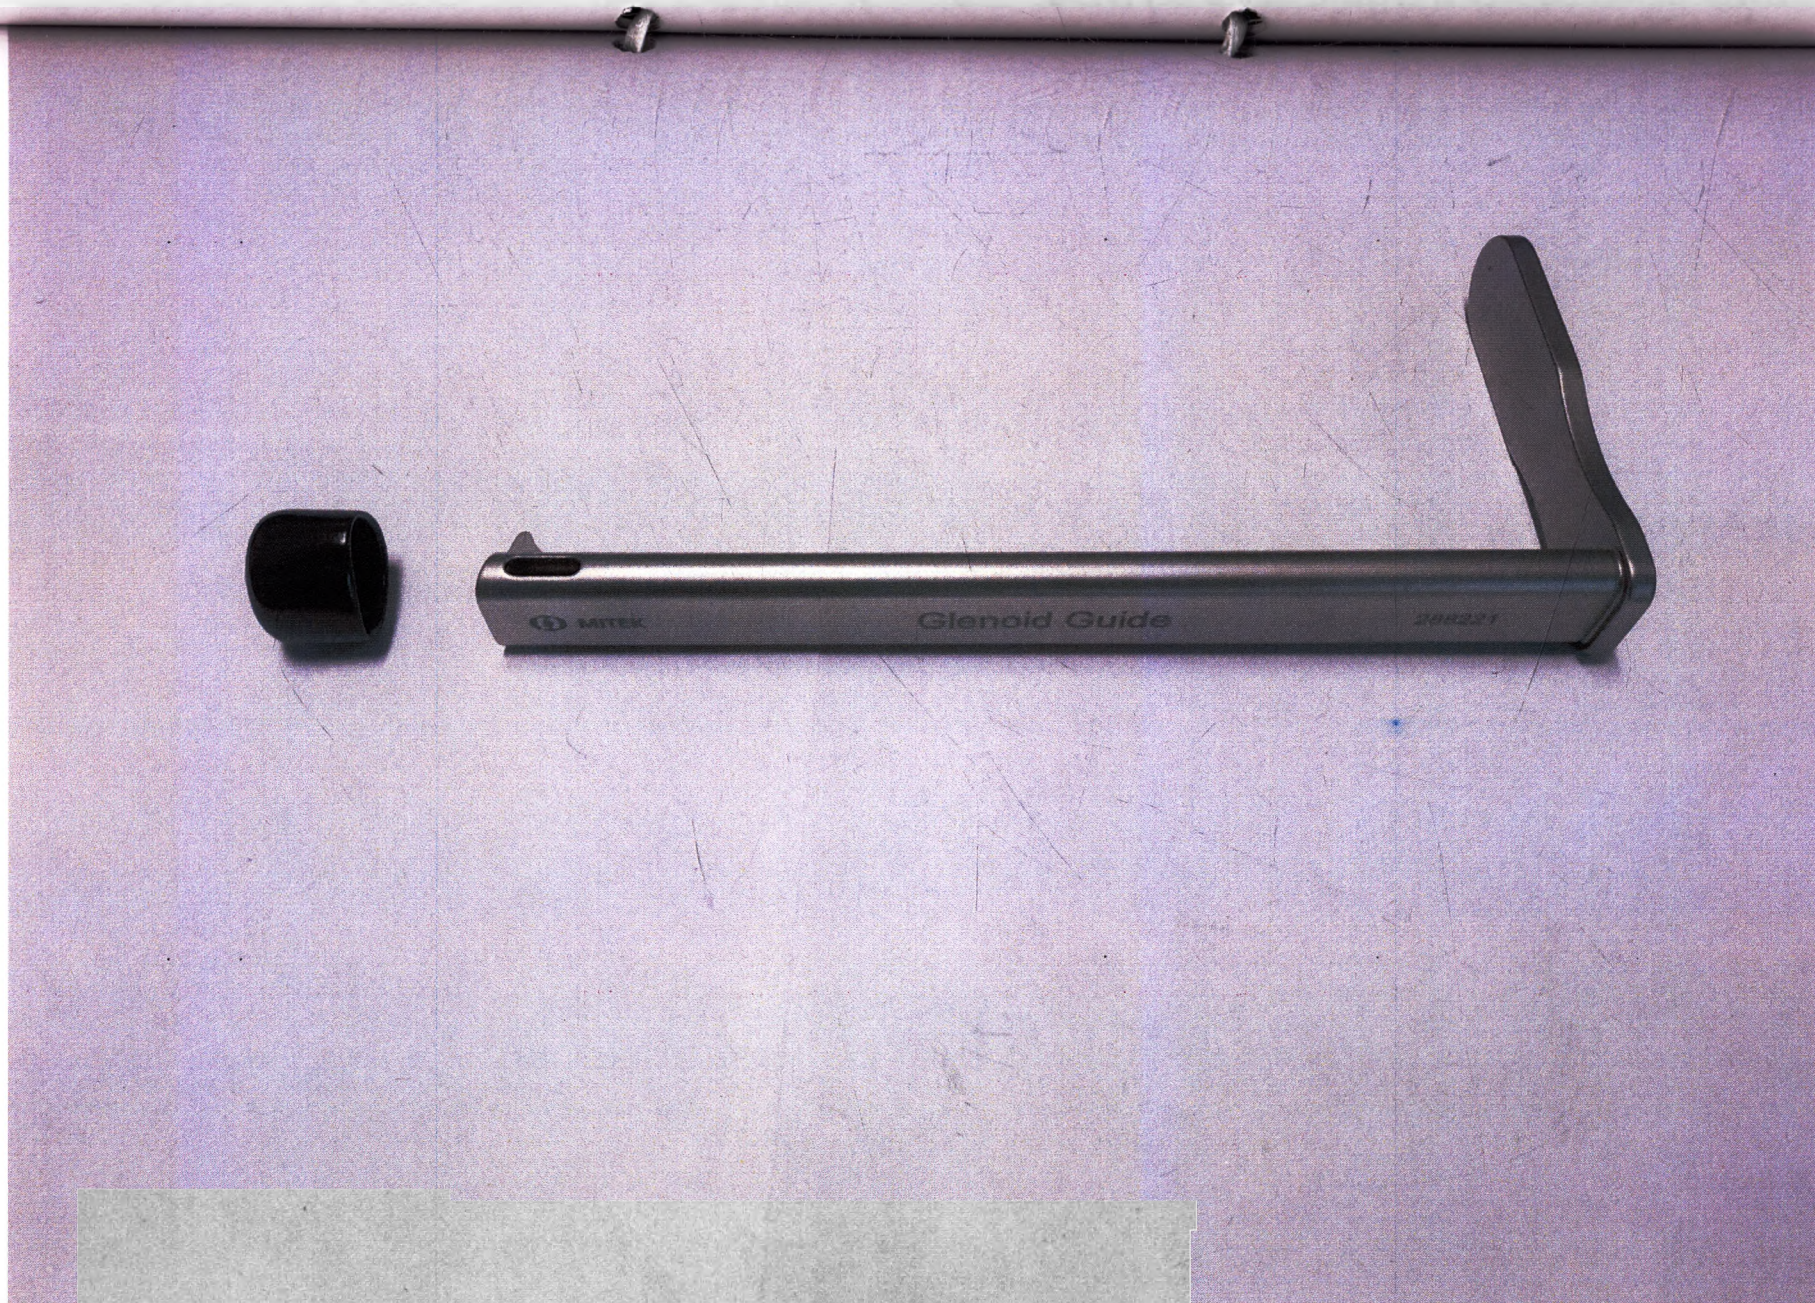


Фото 10. Направитель сверла для гленоида.

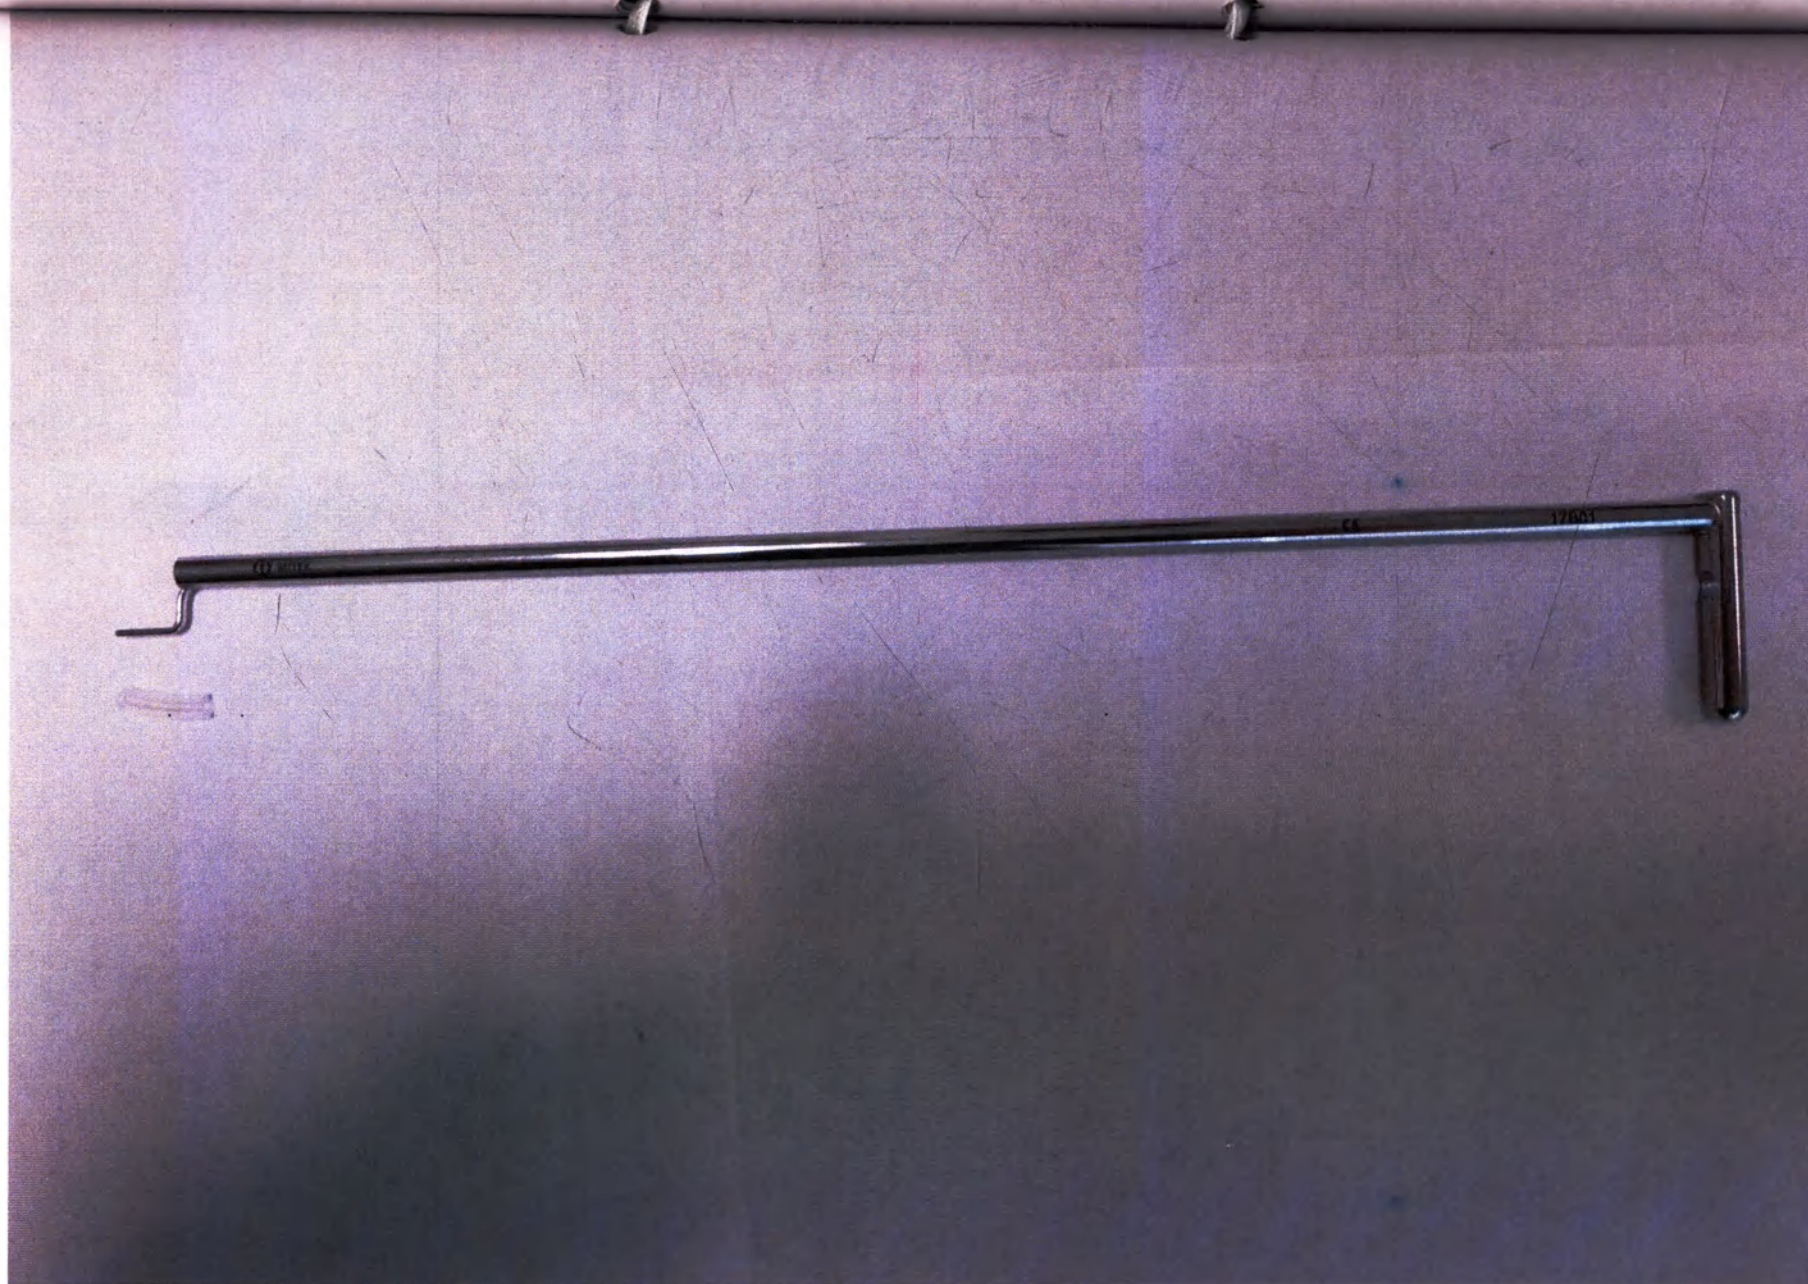


Фото 11. Штифт-направитель оффсета для клювовидного отростка.

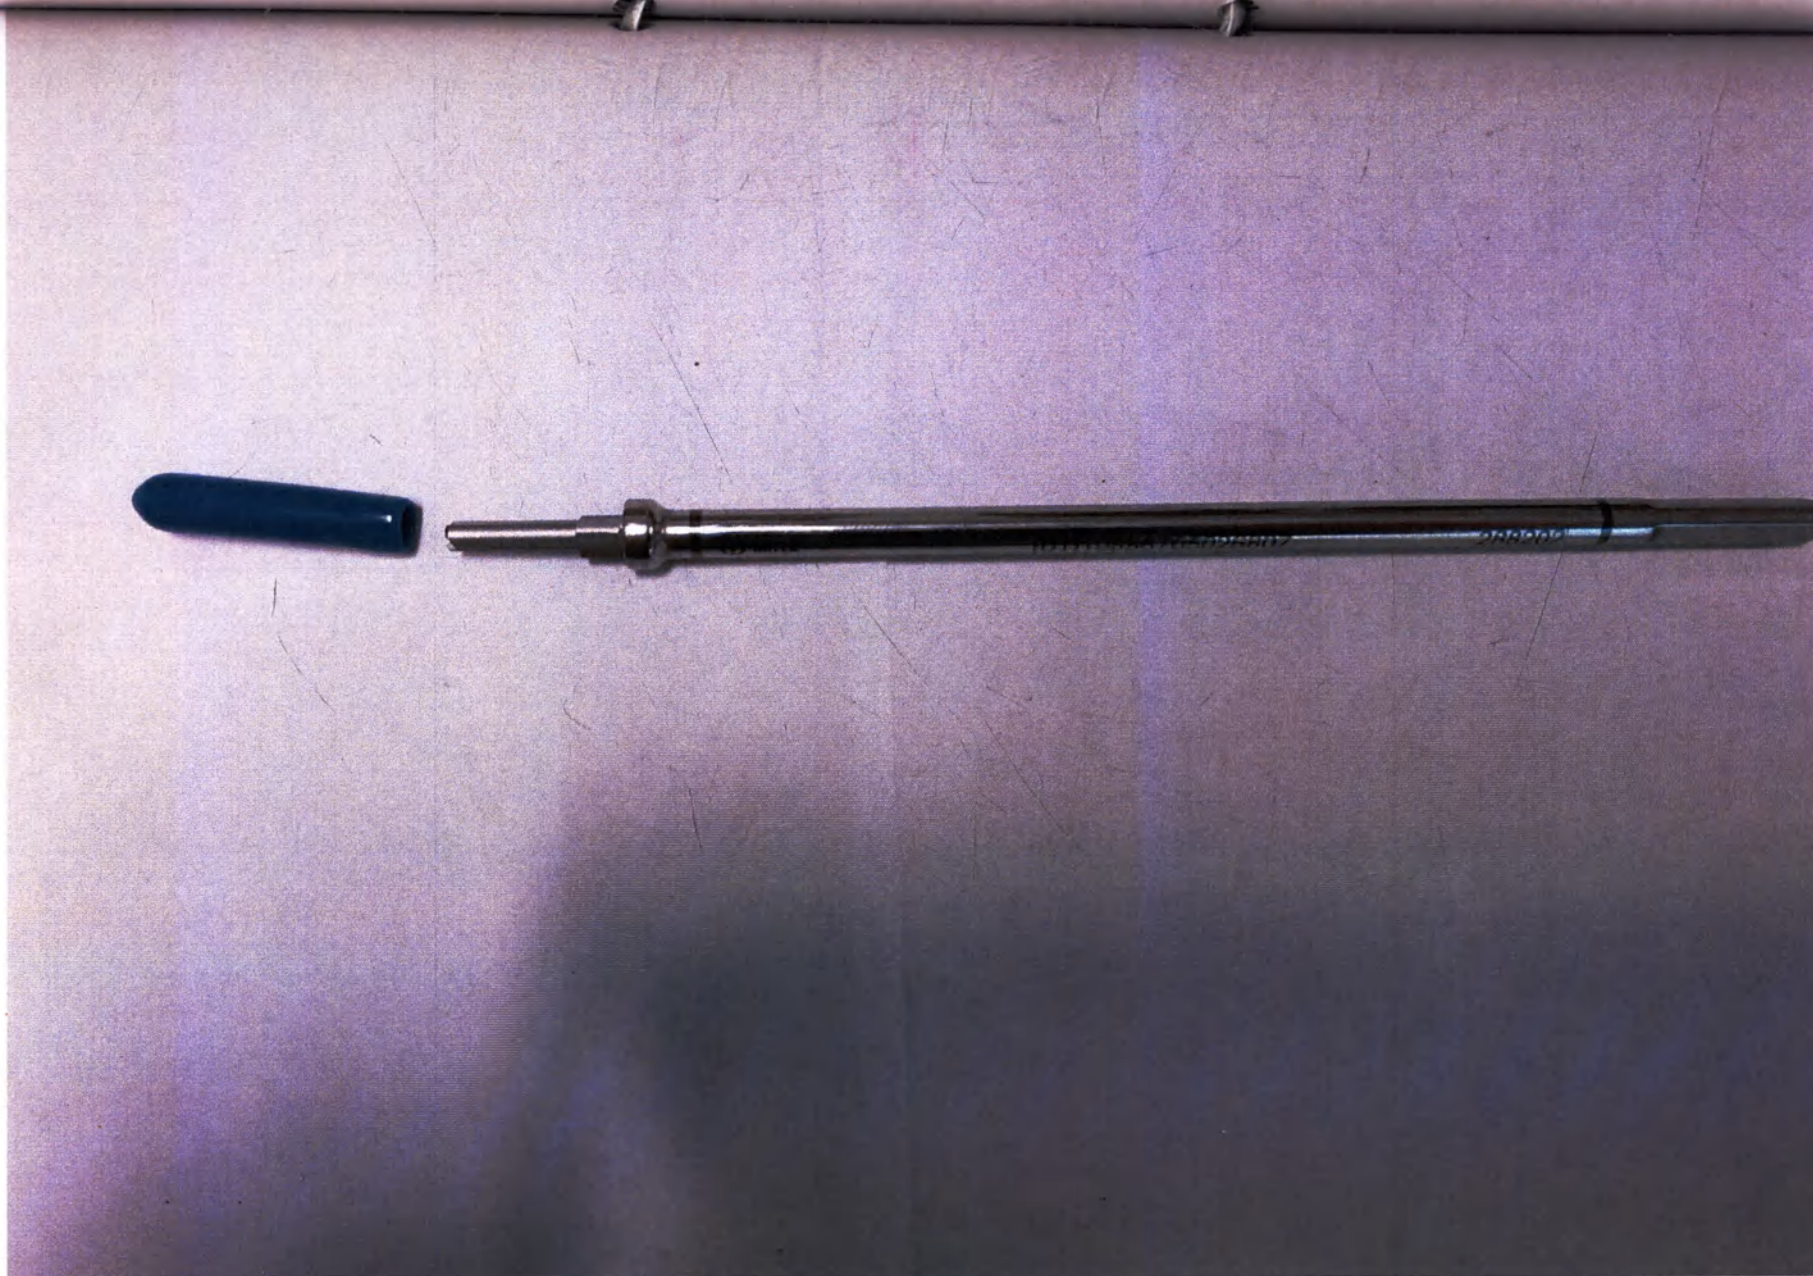


Фото 12. Сверло к гильзе для клювовидного отростка.

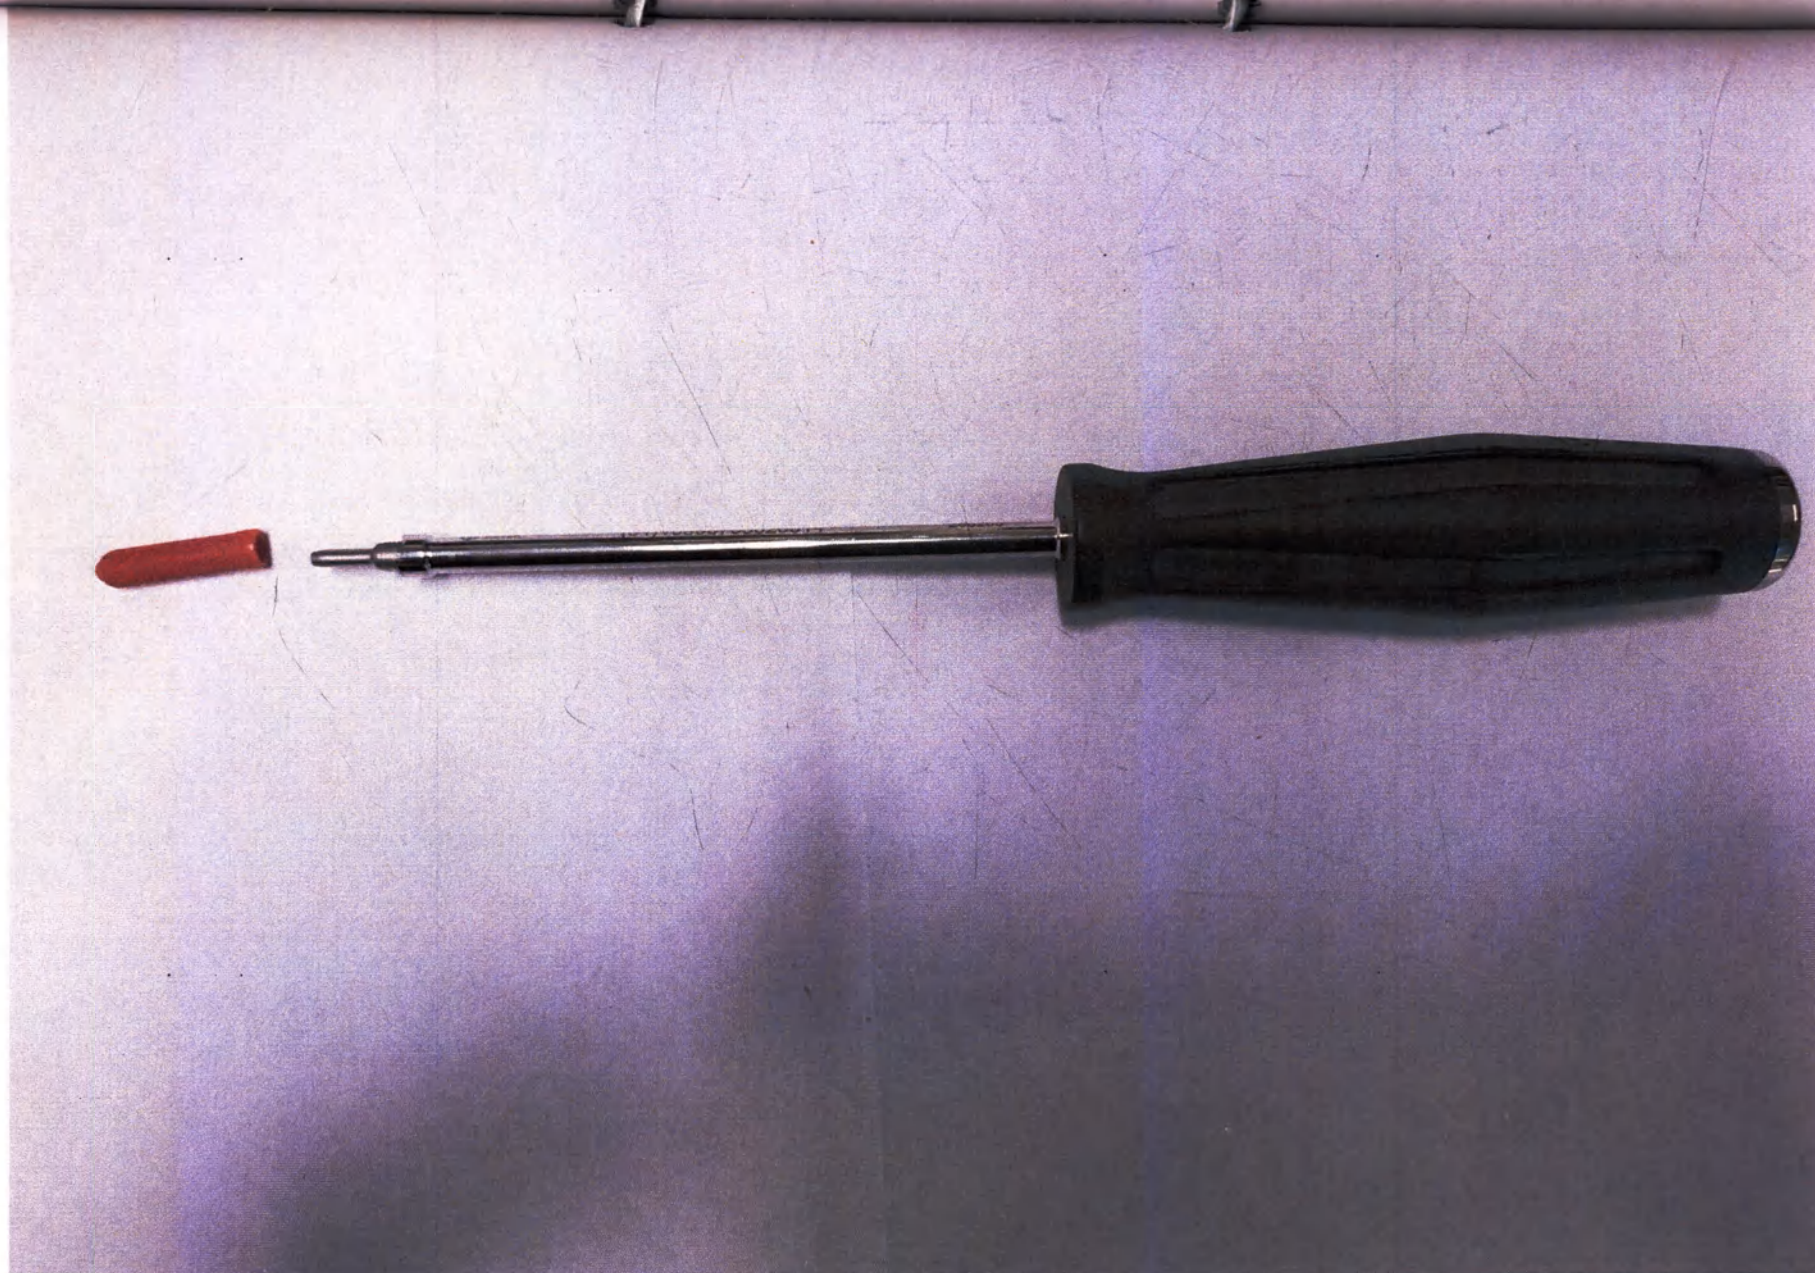


Фото 13. Метчик гильзы

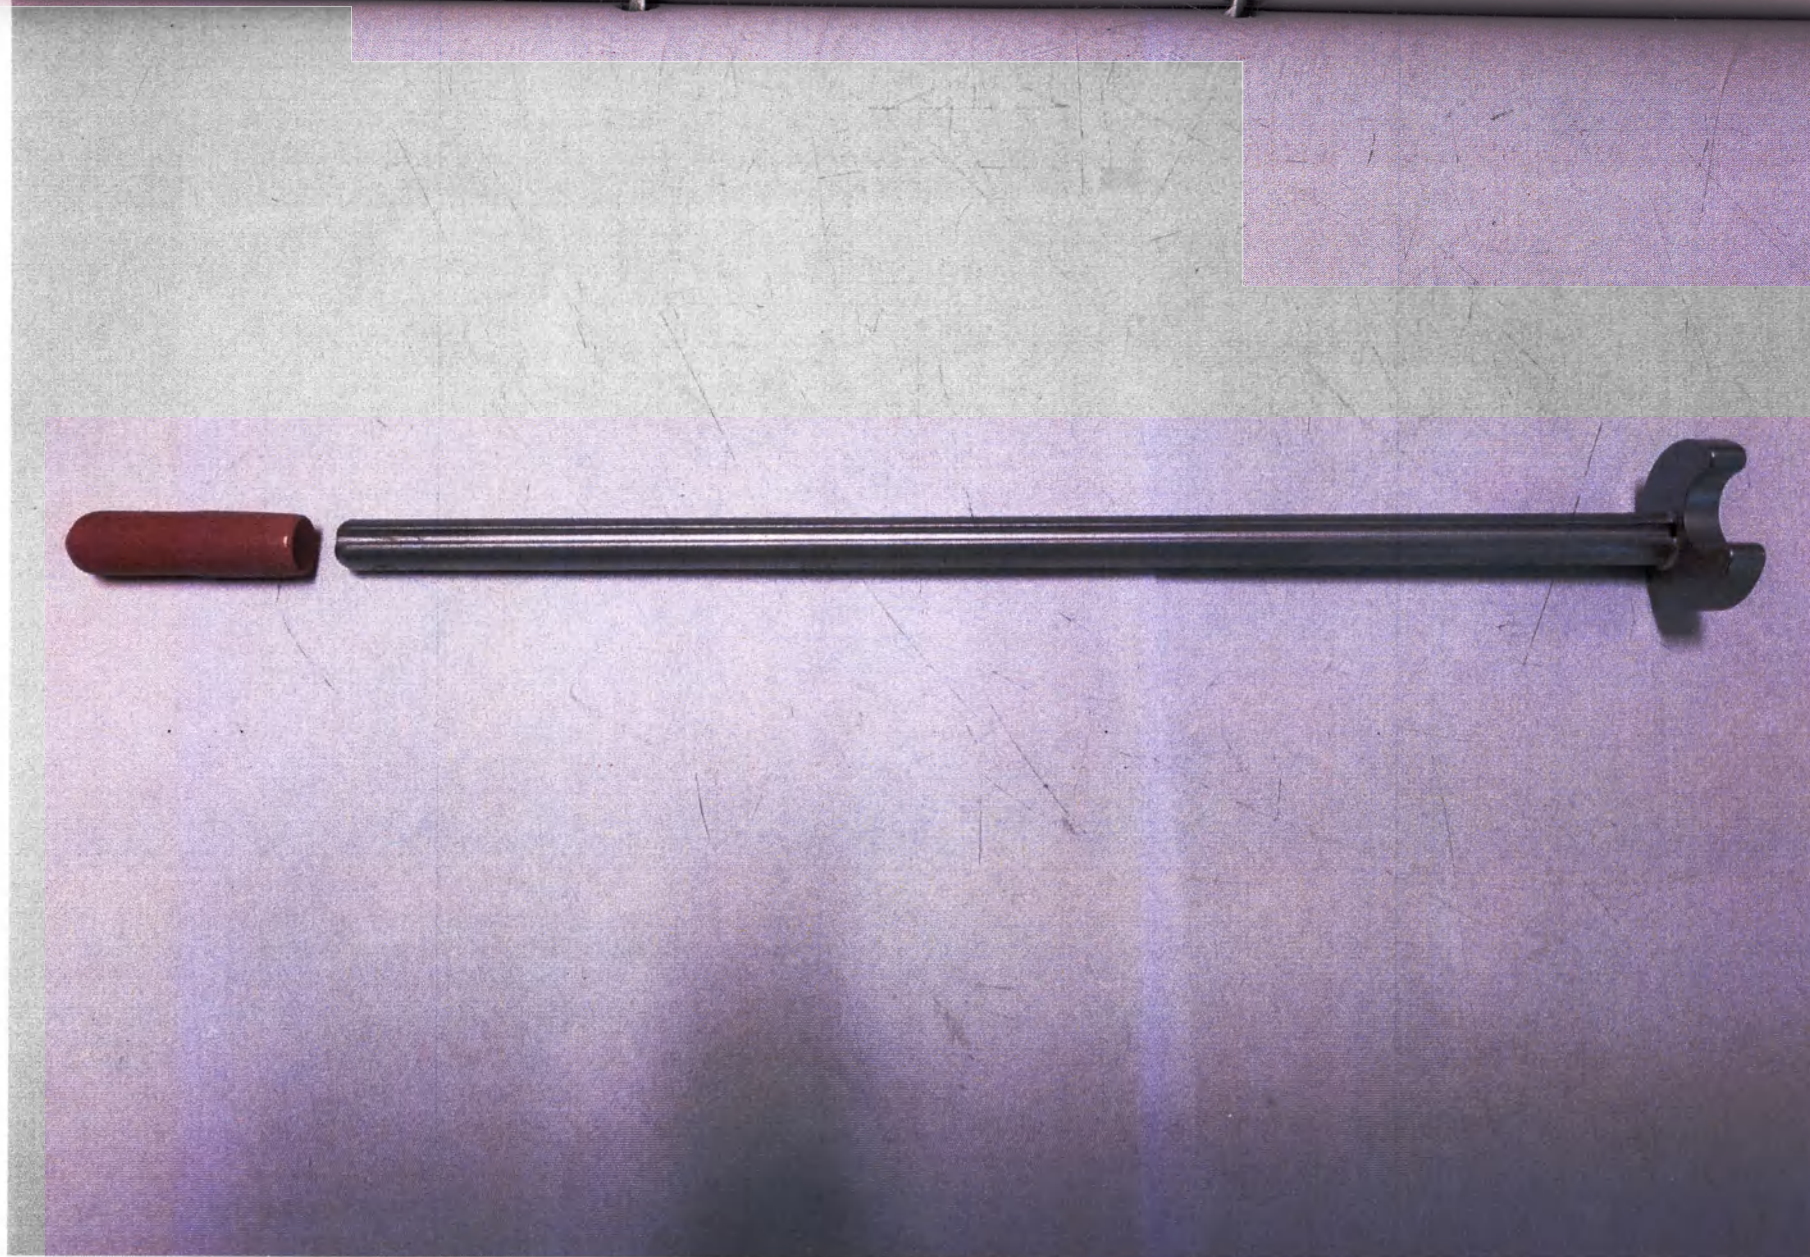


Фото 14. Штифт-направитель оффсета для гленоида.

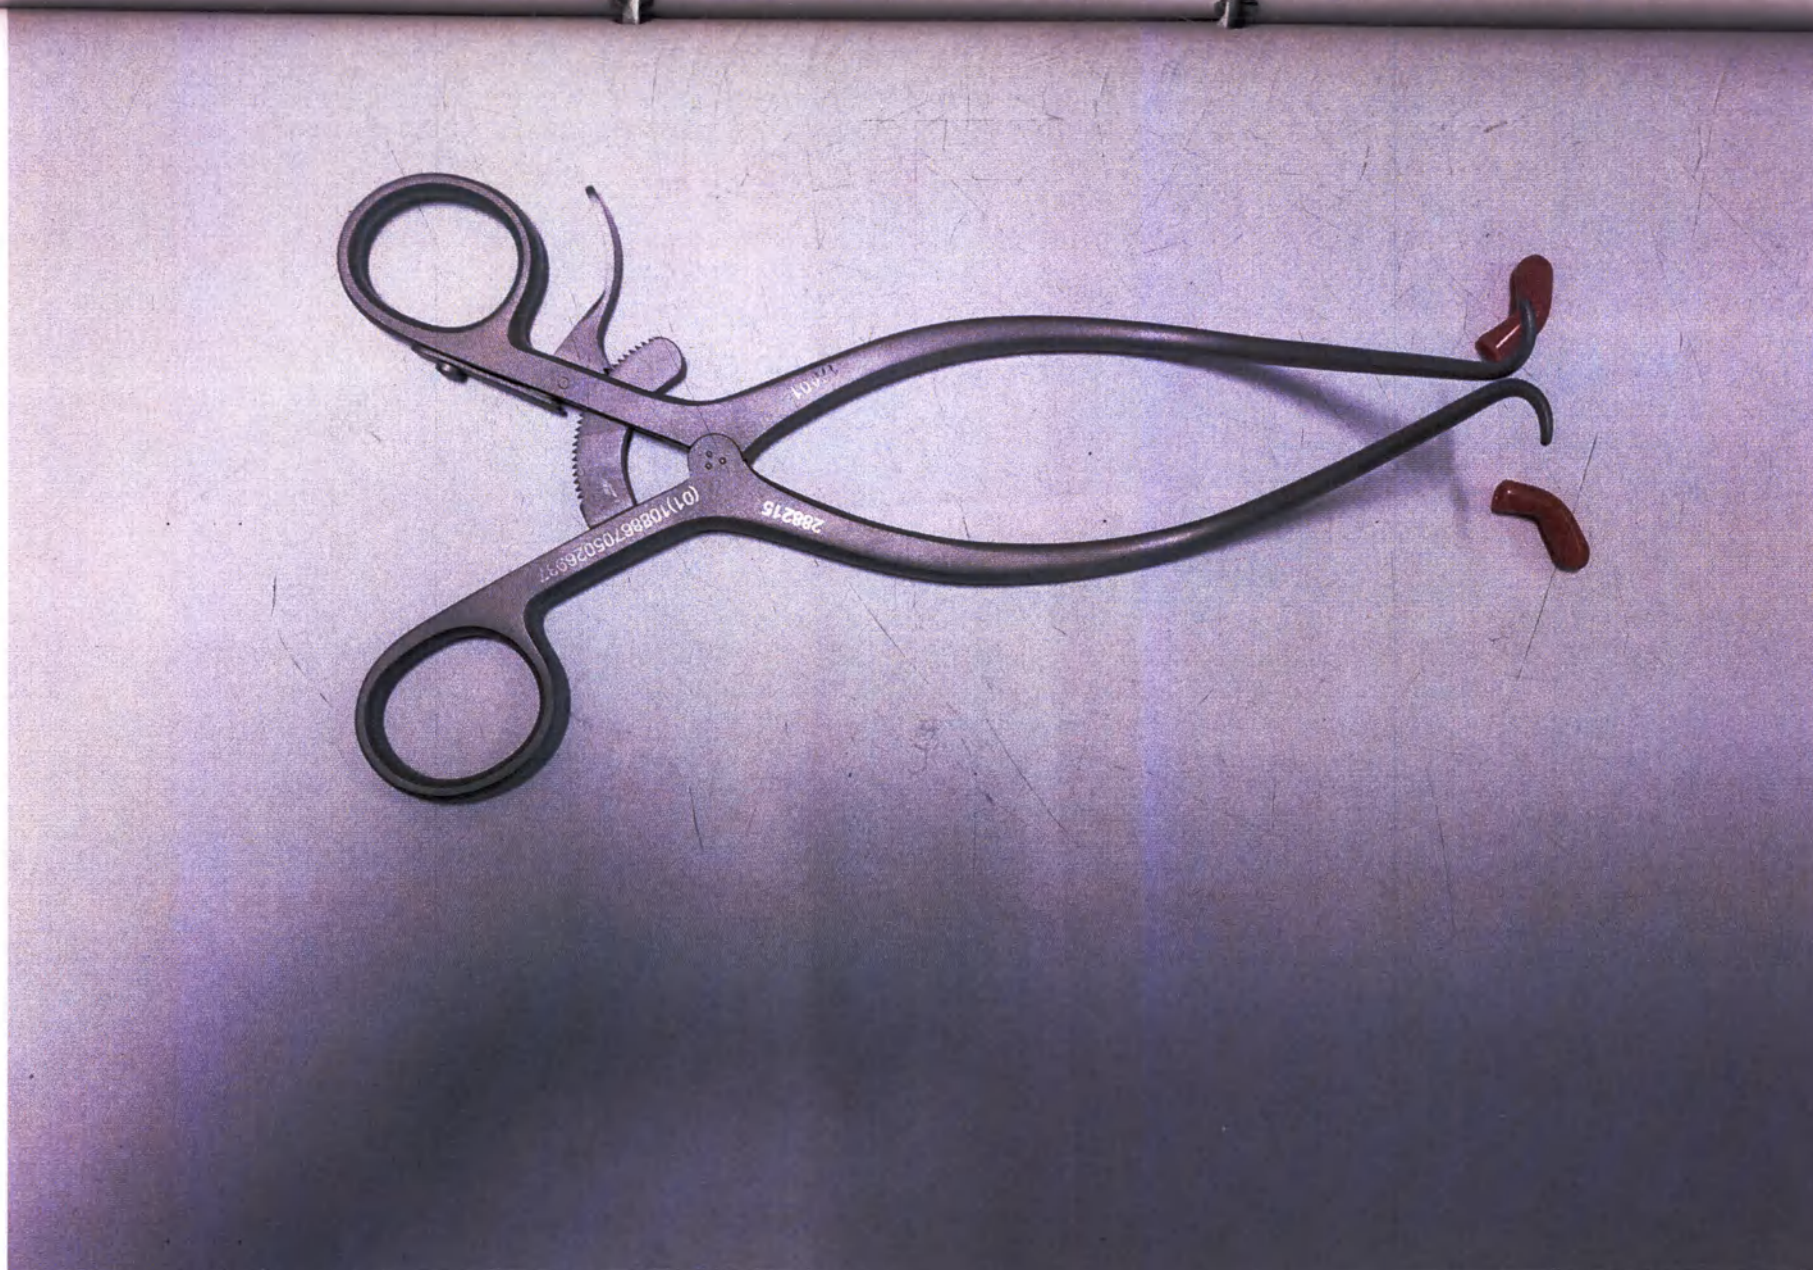


Фото 15. Расширитель подлопаточной мышцы.

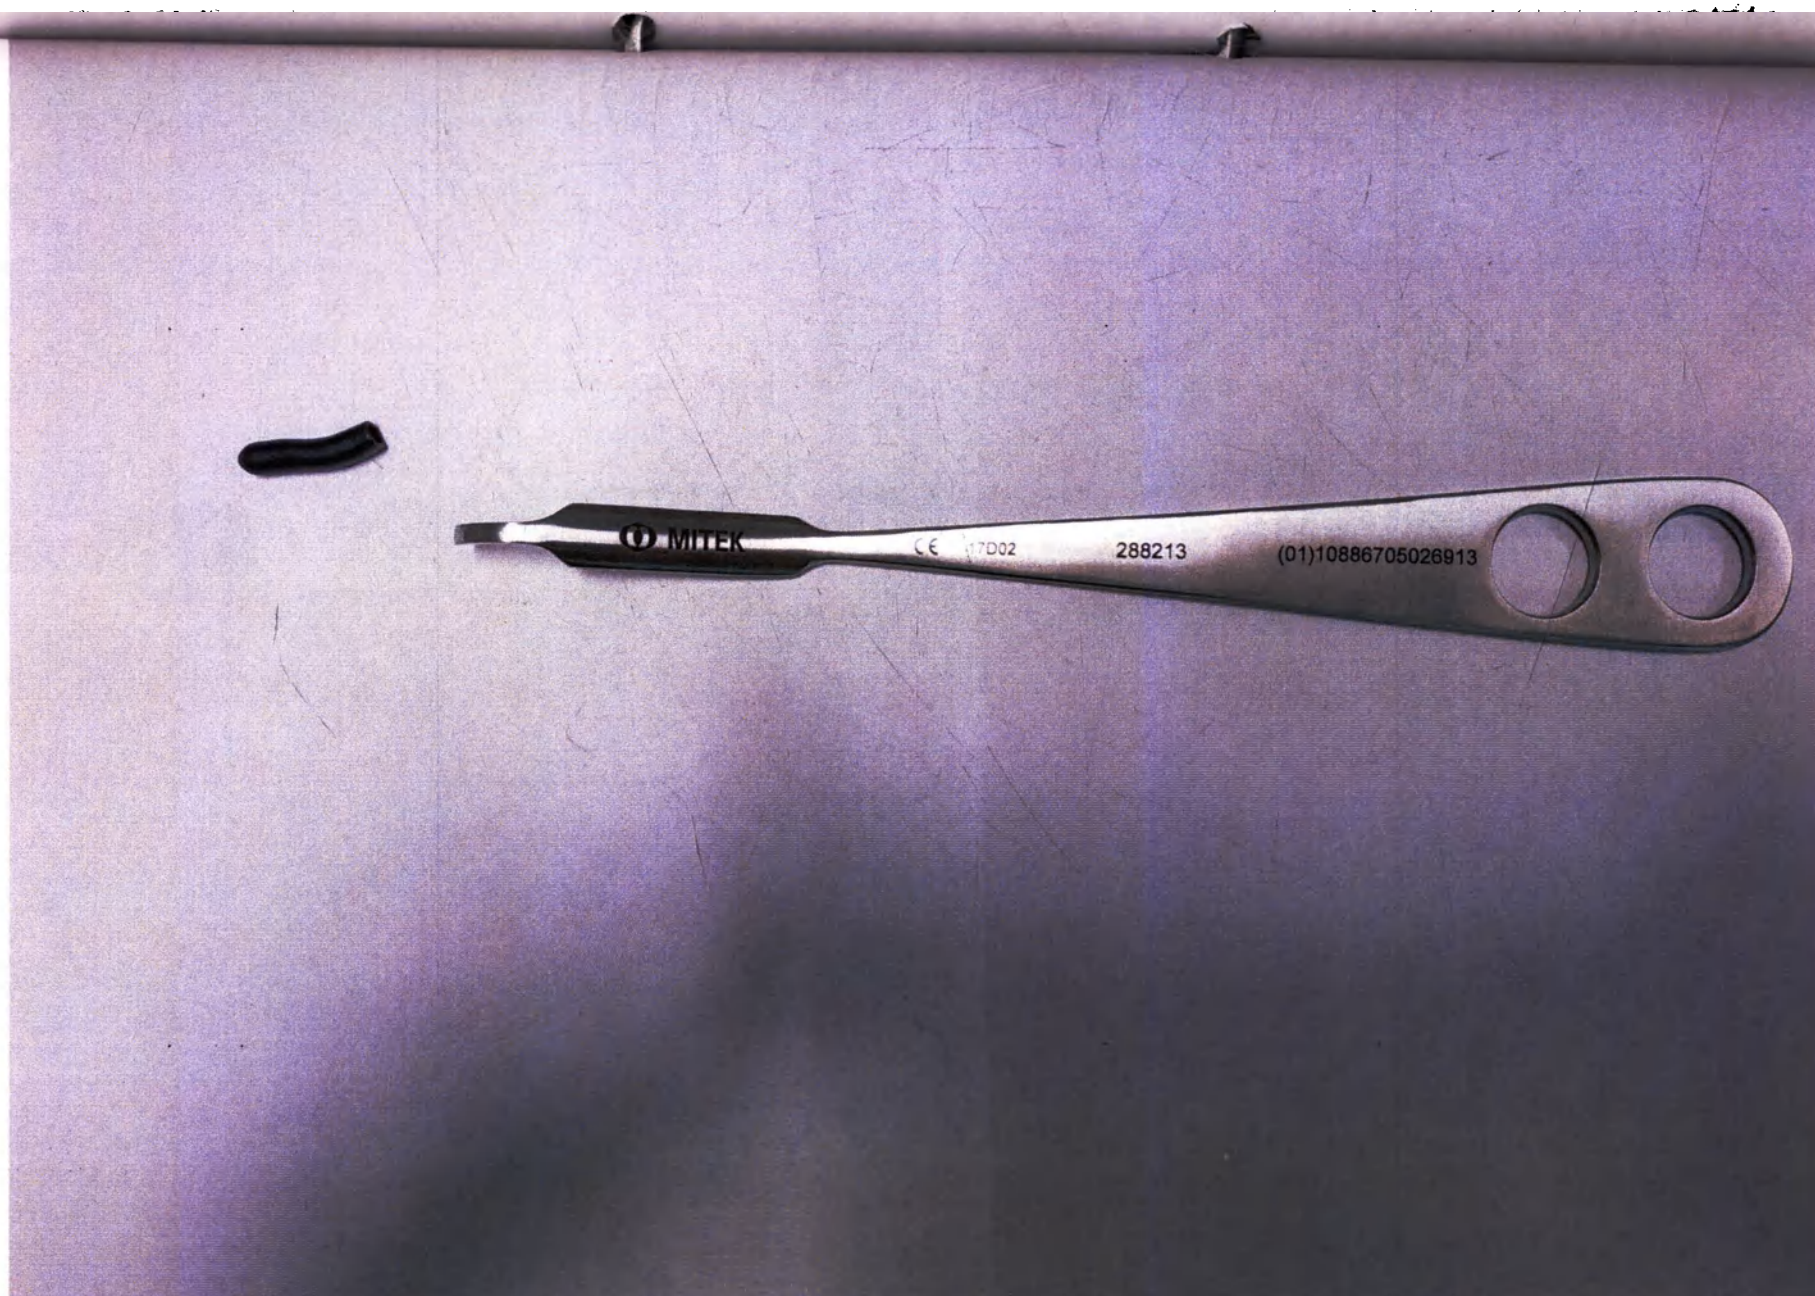


Фото 16. Ретрактор Хохмана костный Latarjet.

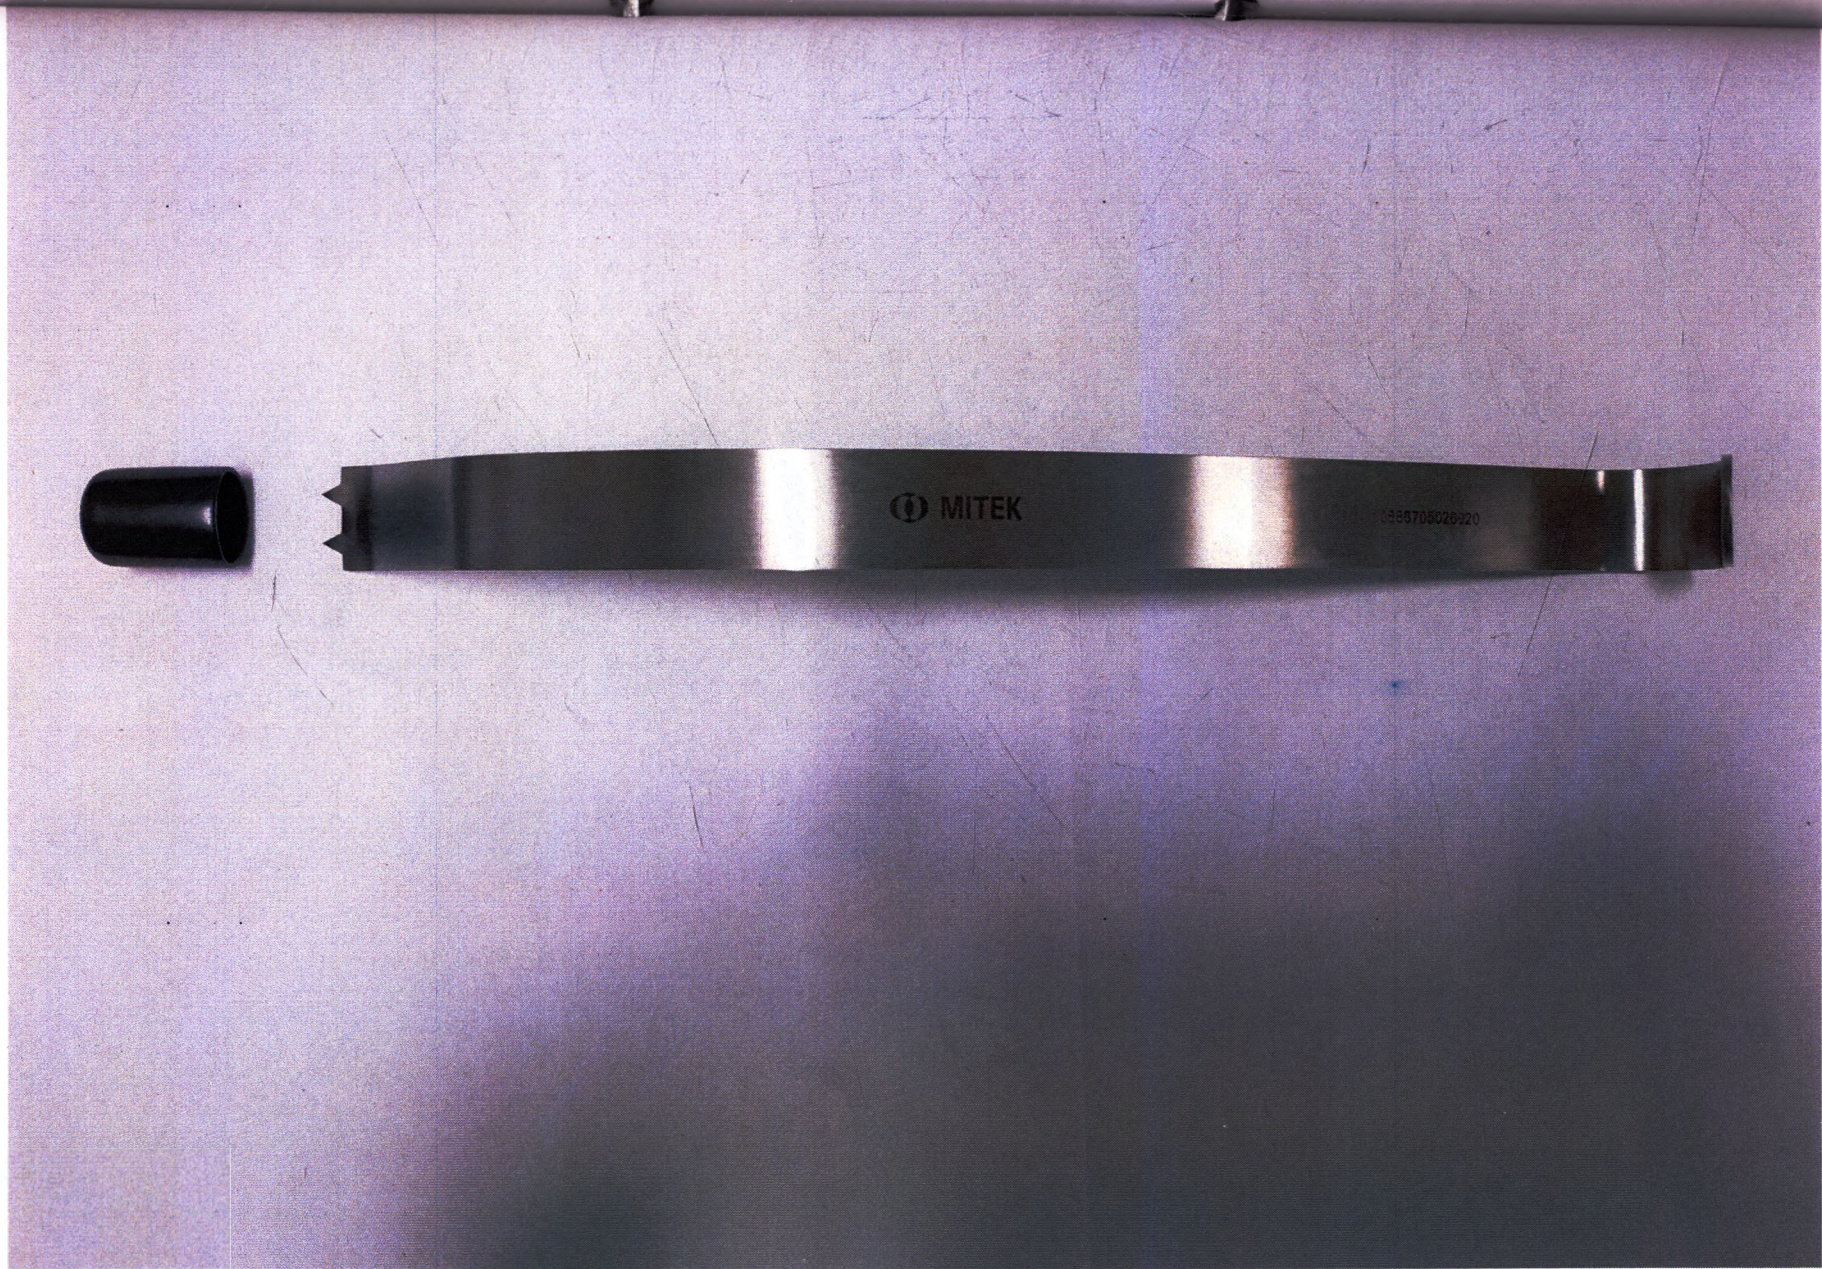


Фото 17. Расширитель для гленоида с 2 зубцами.



Фото 18. Ретрактор головки плечевой кости Latarjet.

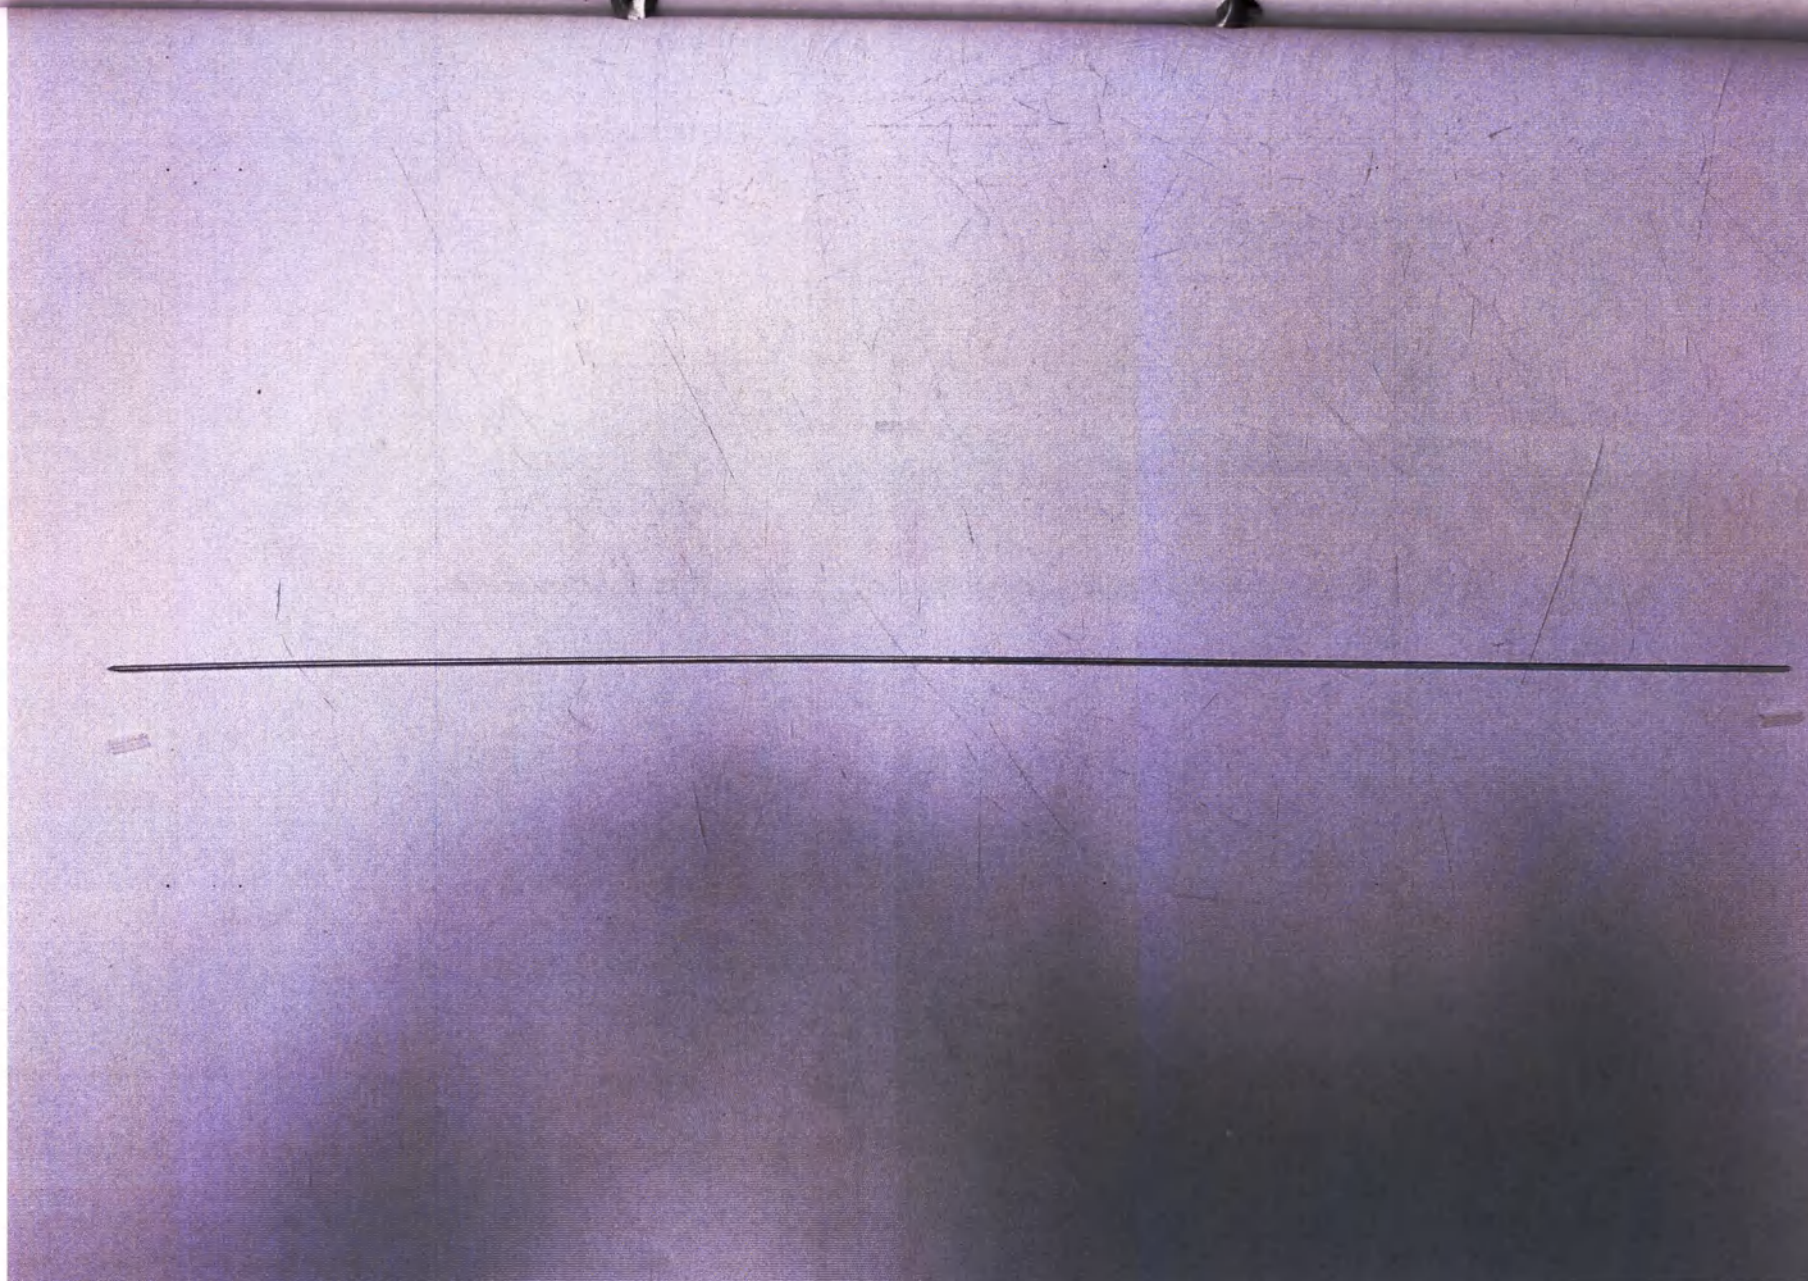


Фото 19. Проводник для гленоида K-Wire (380 мм).

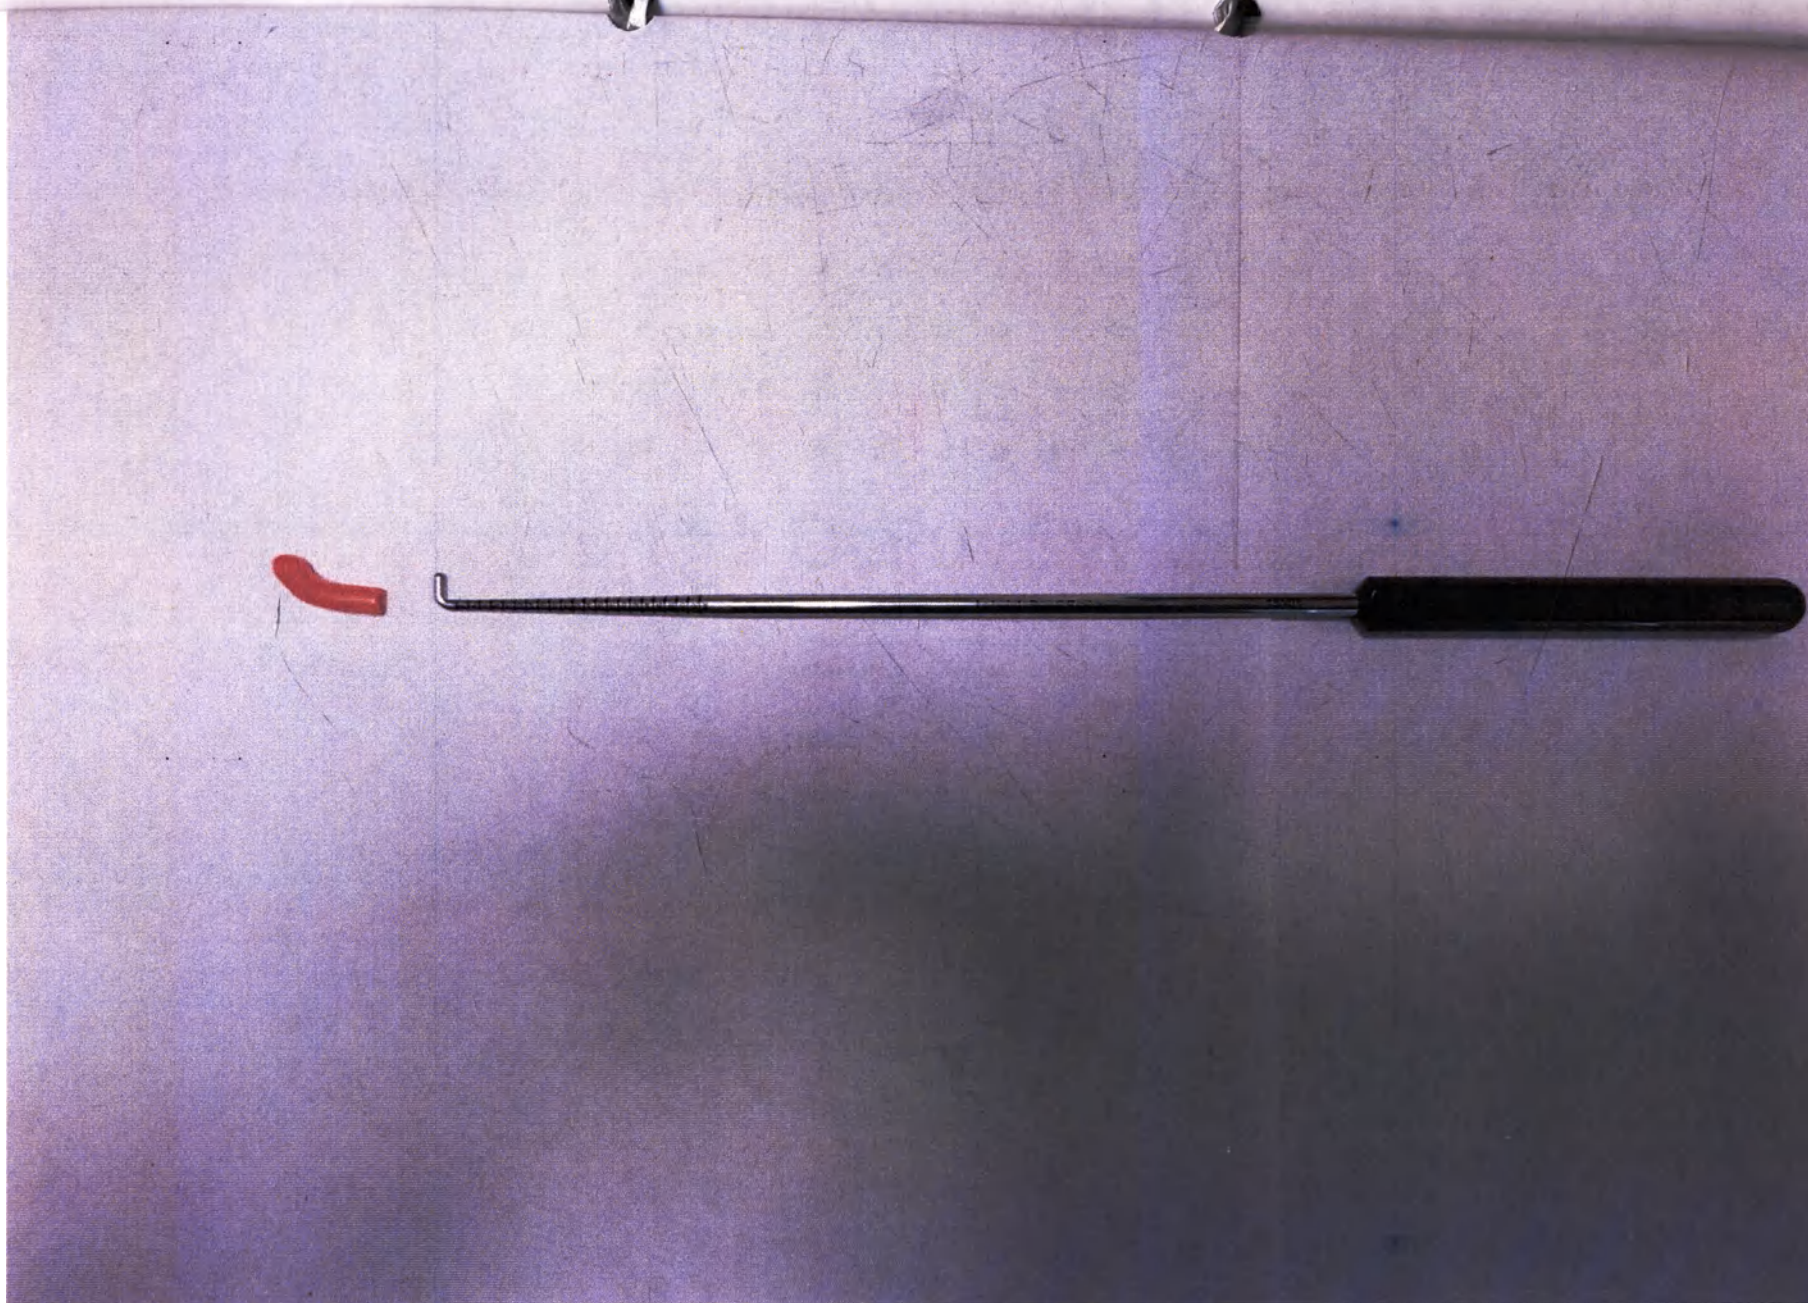


Фото 20. Зонд малый Latarjet.



Фото 21. Крышка лотка для стерилизации Latarjet.

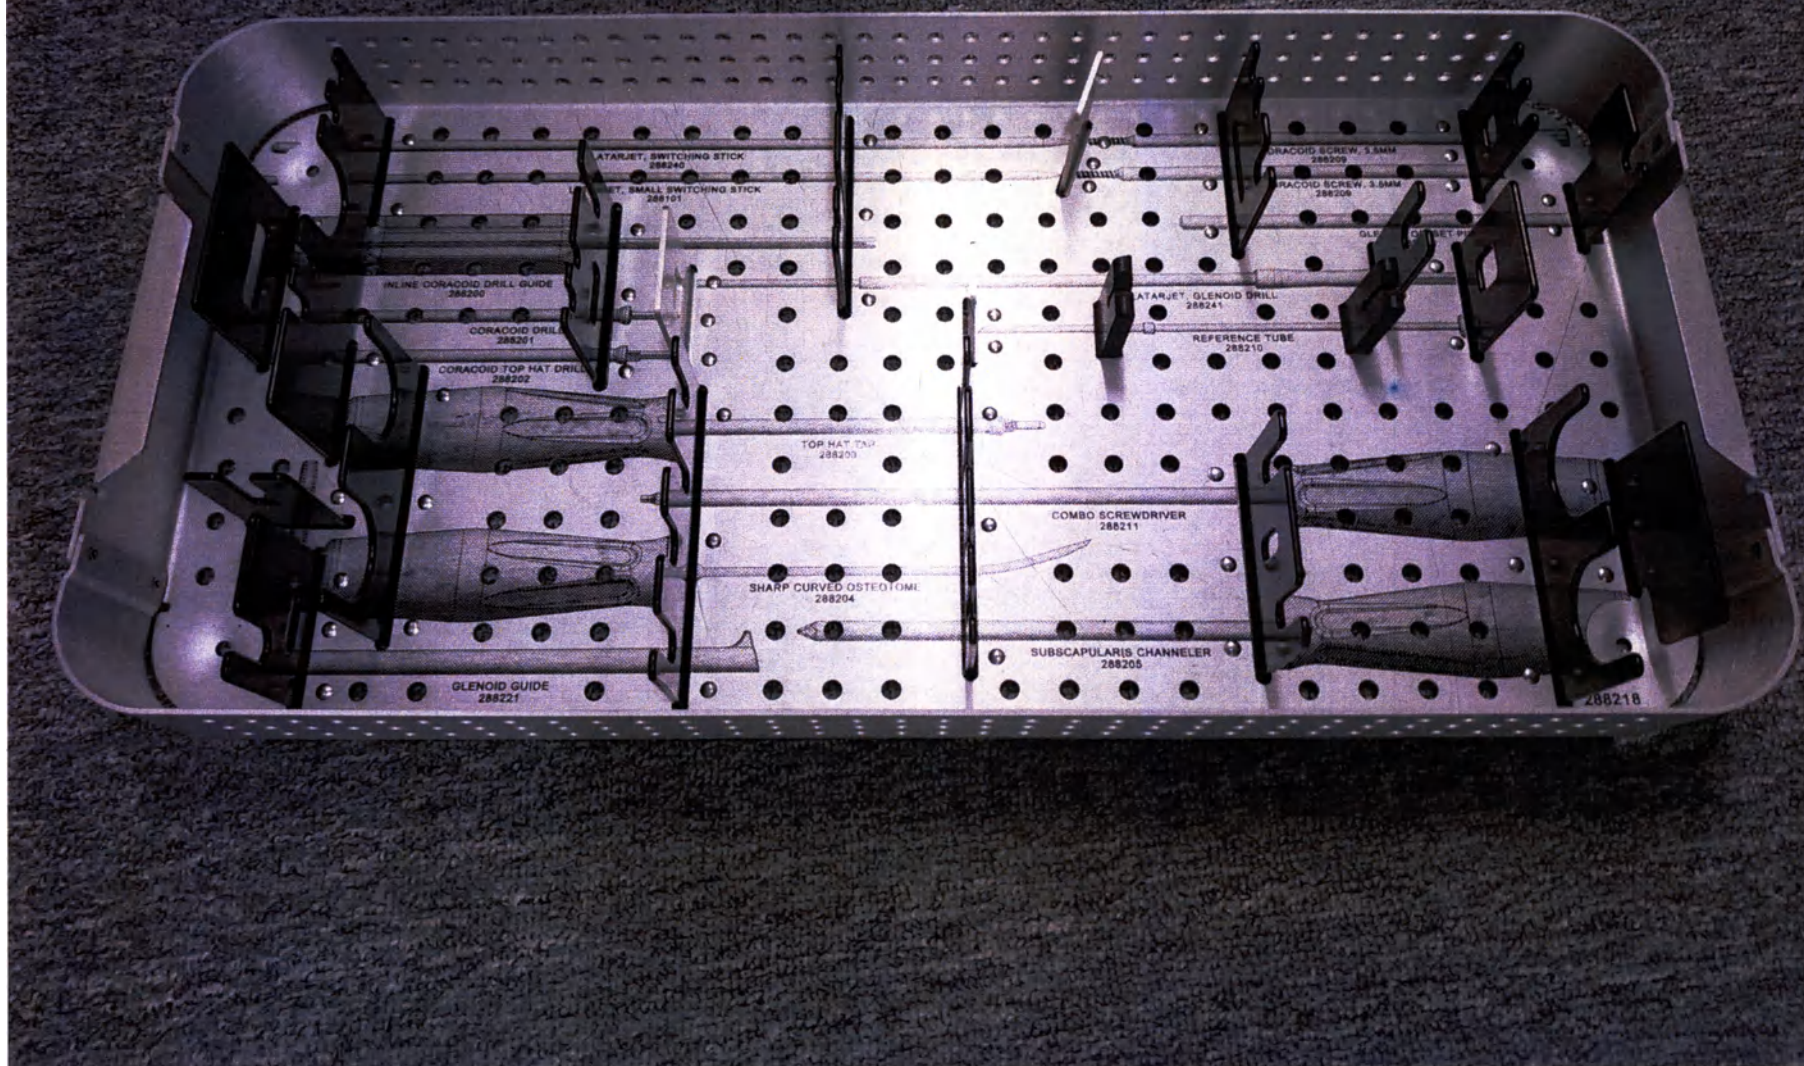


Фото 22. Вставка в лоток для стерилизации Latarjet.

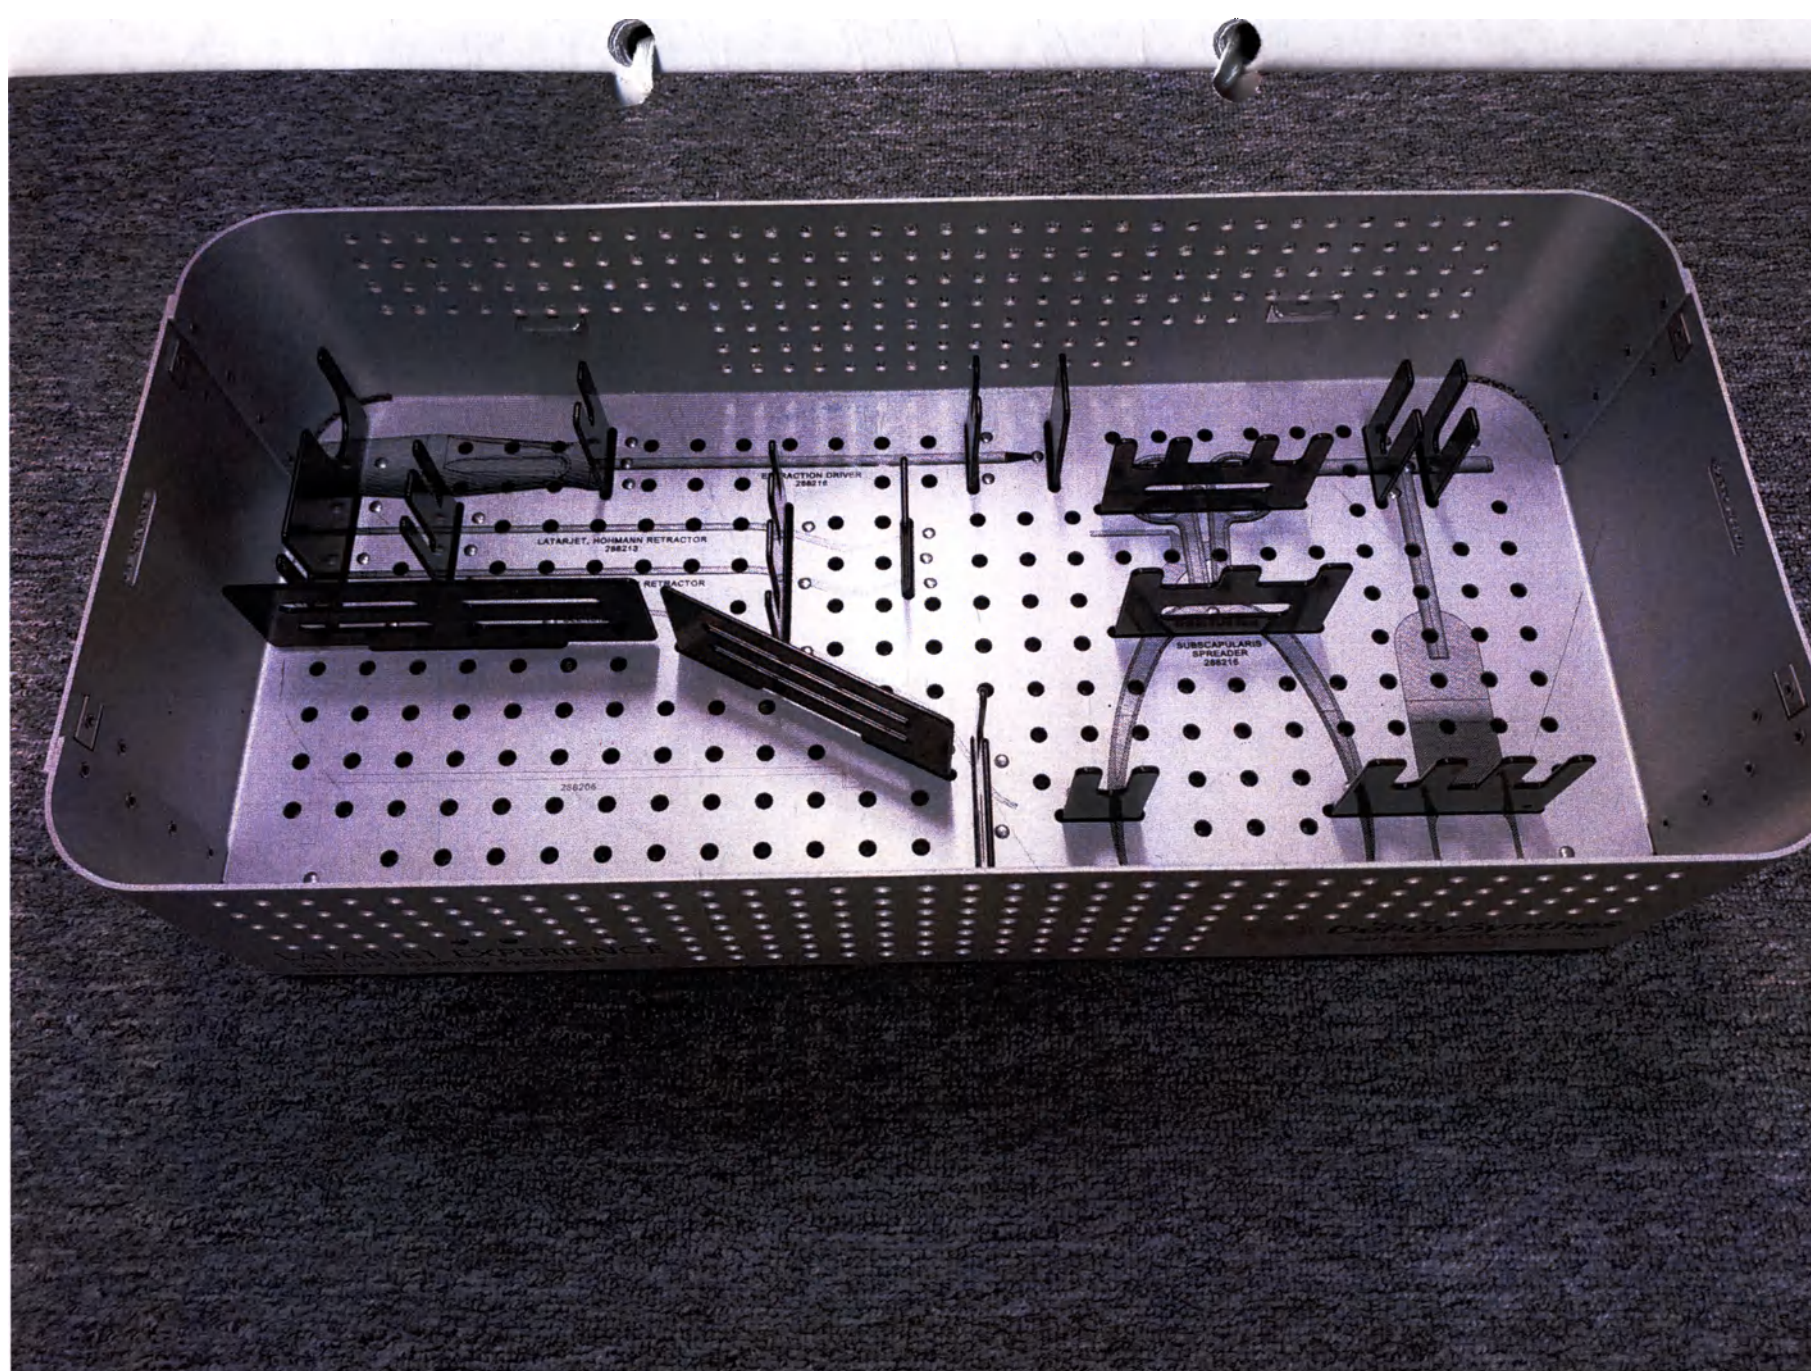


Фото 23. Лоток для стерилизации Latarjet.

СКРЕПЛЕ
ПЕЧАТЬ
24

