

УТВЕРЖДАЮ
Дмитриев Д.В.

Генеральный директор
ООО «РАЙФАРМ»



«05» мая 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Набор калибраторов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) в цервикальных мазках человека методом амплификации нуклеиновых кислот

Hologic, Inc., 10210 Genetic Center Drive San Diego, CA 92121, USA (США)

Набор калибраторов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) в цервикальных мазках человека методом амплификации нуклеиновых кислот (внешняя упаковка)

Aptima® GT HPV 16 18/45 Genotype Assay

Calibrators Kit



IVD



Rx only

PCAL1

Non-Infectious HPV nucleic acid in a buffered solution

5 x 2.8 mL

PCAL2

Non-Infectious HPV nucleic acid in a buffered solution

5 x 2.8 mL

NCAL

Buffered Solution

5 x 2.7 mL



REF 303235



(01) 15420045500136
(17) 220215
(10) 274808CH

LOT

274808CH



2022-02-15




Hologic, Inc., 10210 Genetic Center Drive, San Diego, CA 92121 USA



LBL-06582 Rev. 001

Набор калибраторов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) в цервикальных мазках человека методом амплификации нуклеиновых кислот (открытая внешняя упаковка)

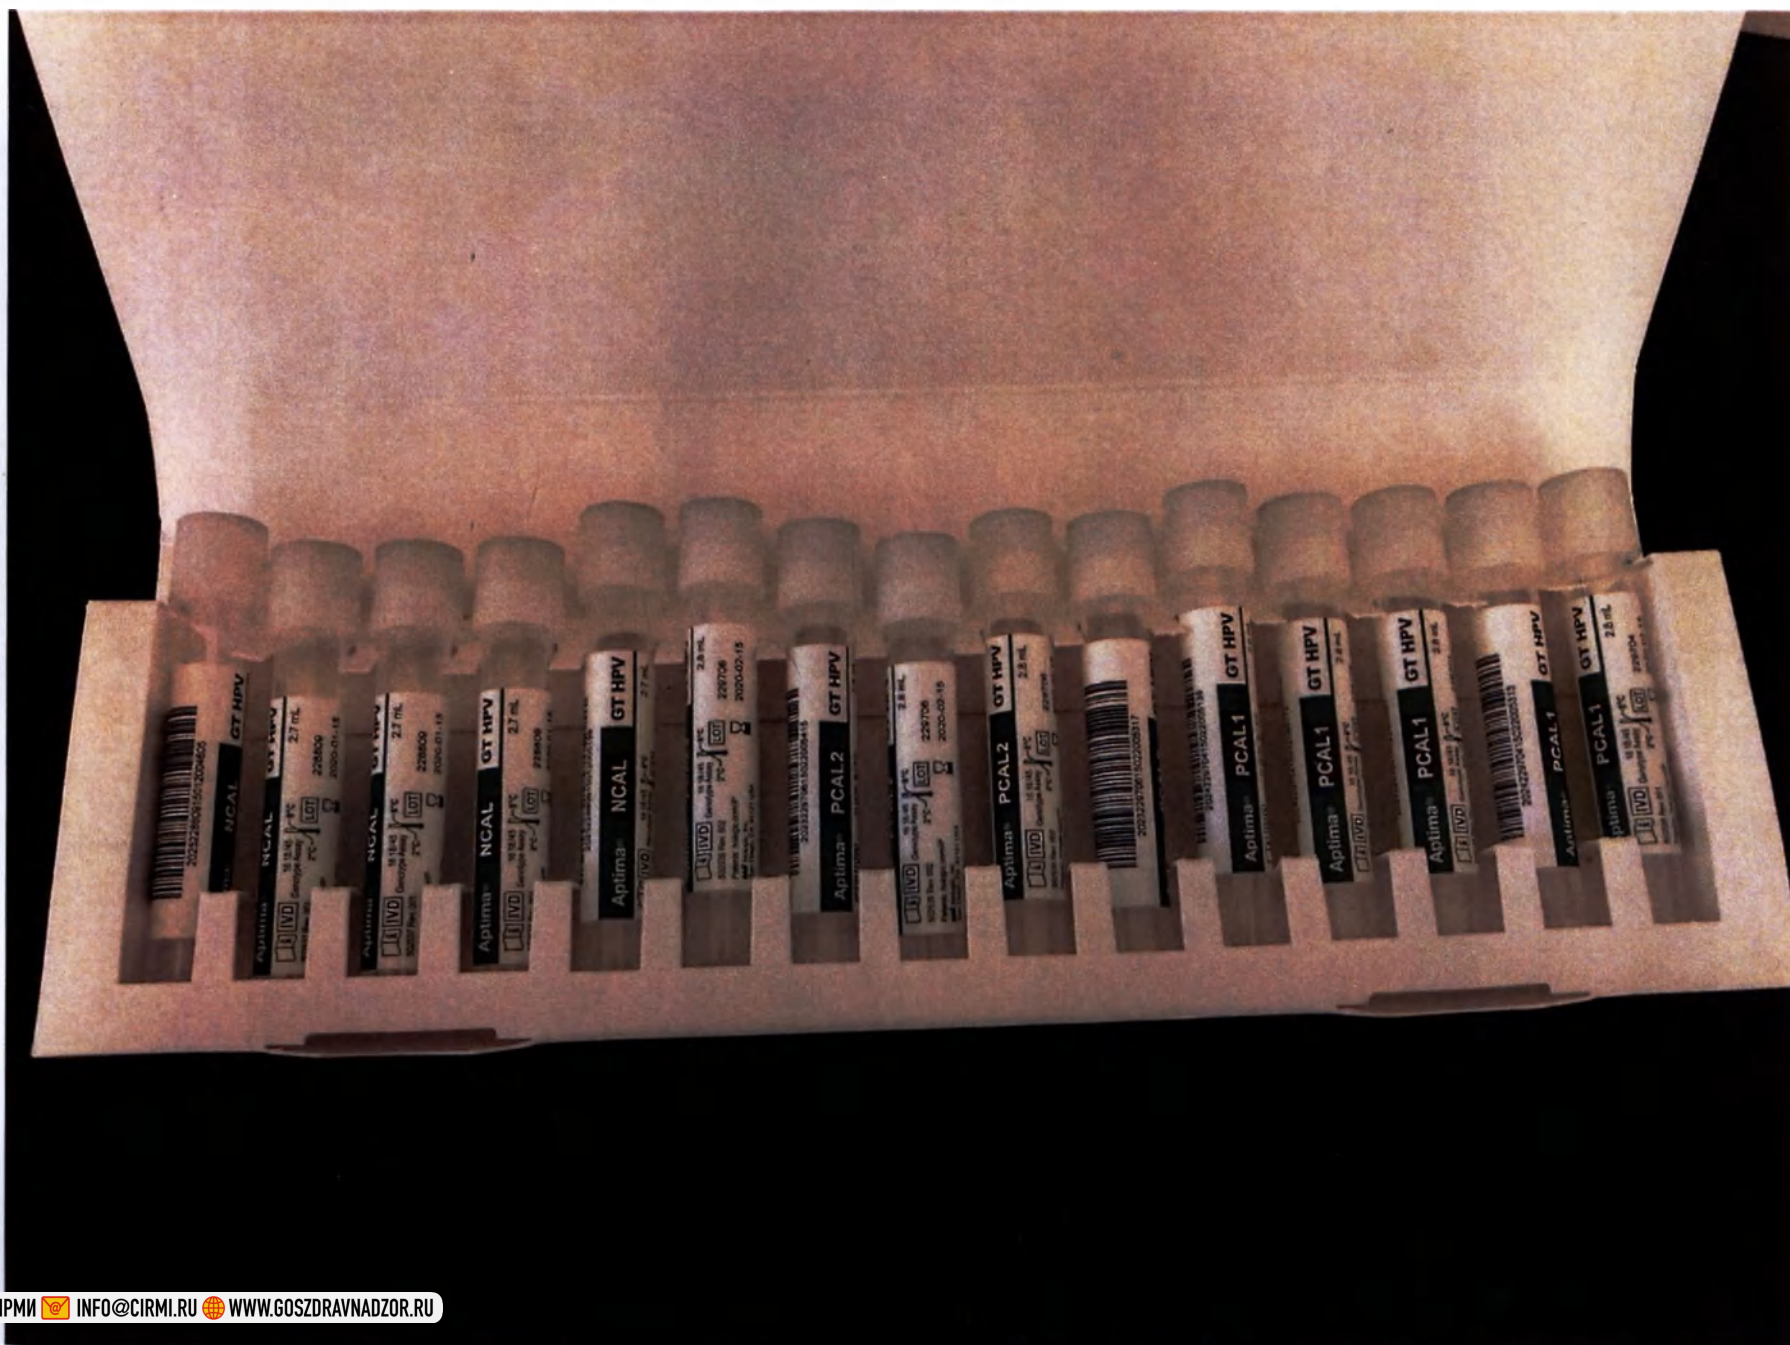

цервикальных мазках человека методом амплификации нуклеиновых кислот:


1) Положительный калибратор ВПЧ 16 18/45 №1



2) Положительный калибратор ВПЧ 16 18/45 №2



3) Отрицательный калибратор ВПЧ 16 18/45

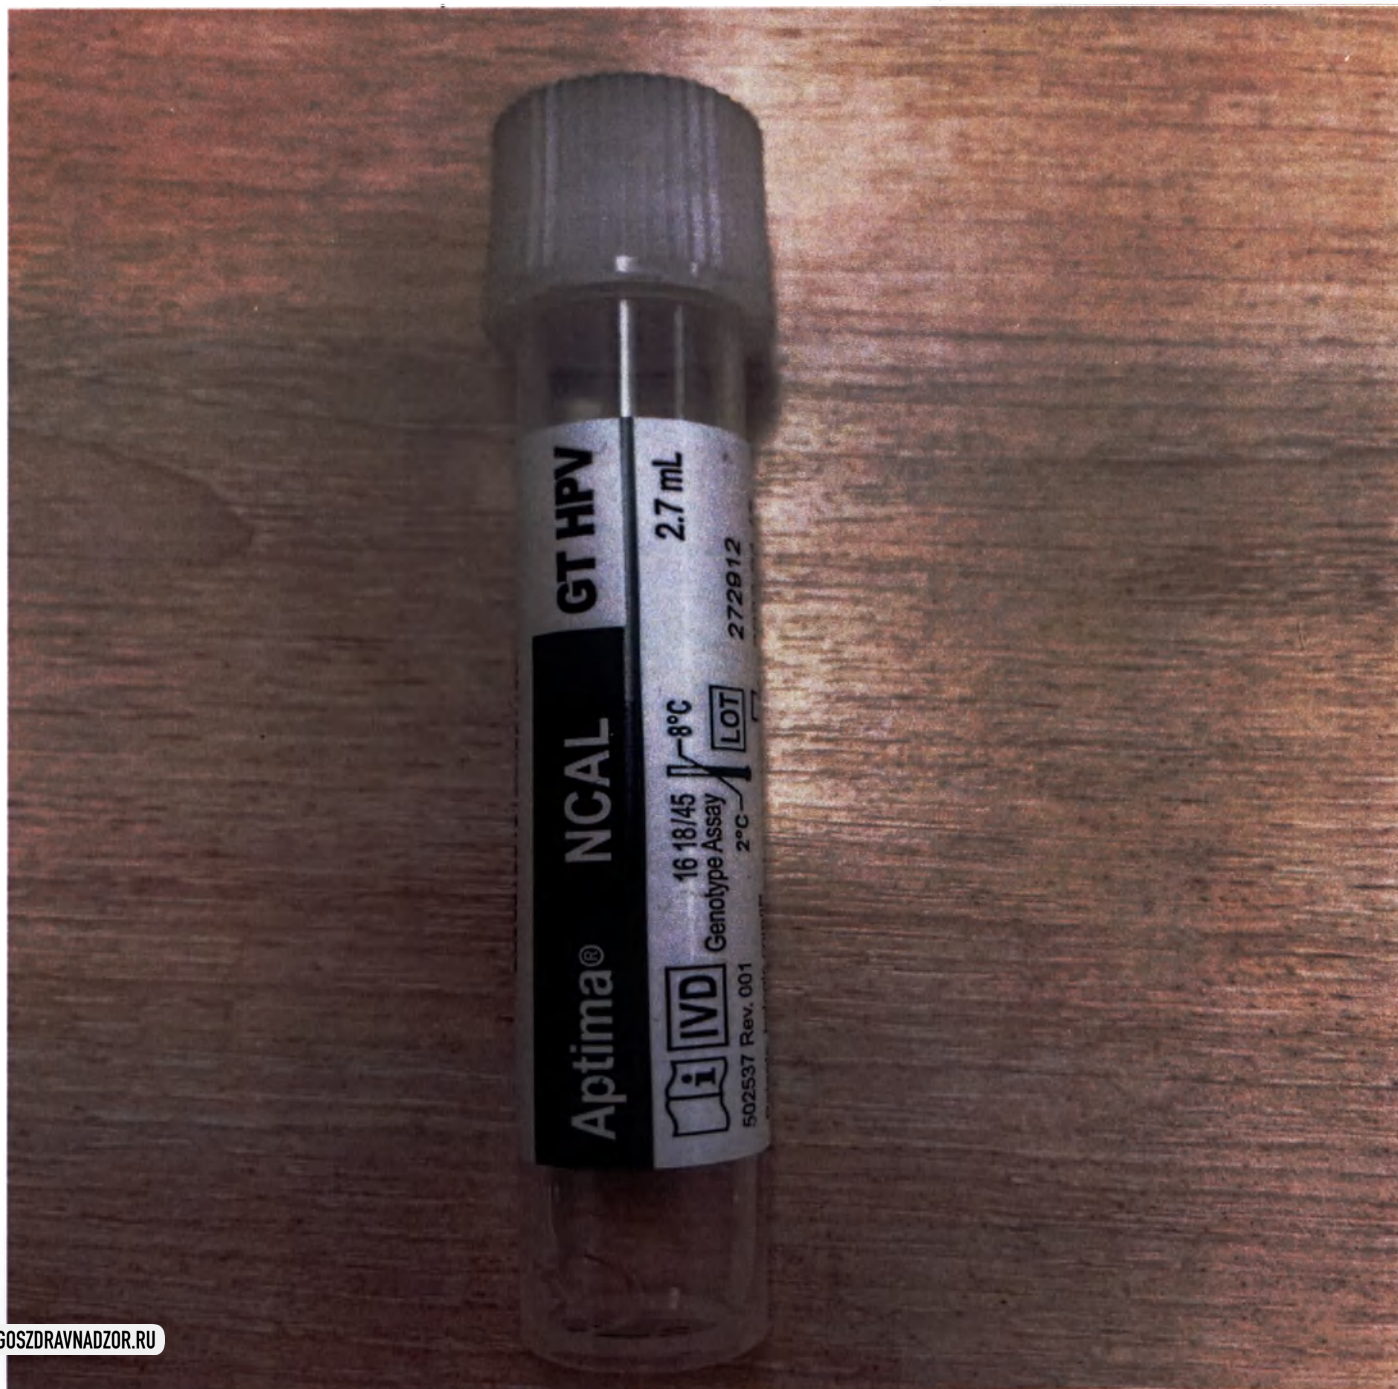

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 4 листа(ов).
Генеральный директор ООО «Райфарм»
Д.В. Дмитриев

(подпись) _____ М.П.
«05» мая 2022 года

