

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ХИЛЛ-РОМ РУС»

 Е.А. Королева

«13» мая 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская функциональная Centuris™ Pro

2022 г.

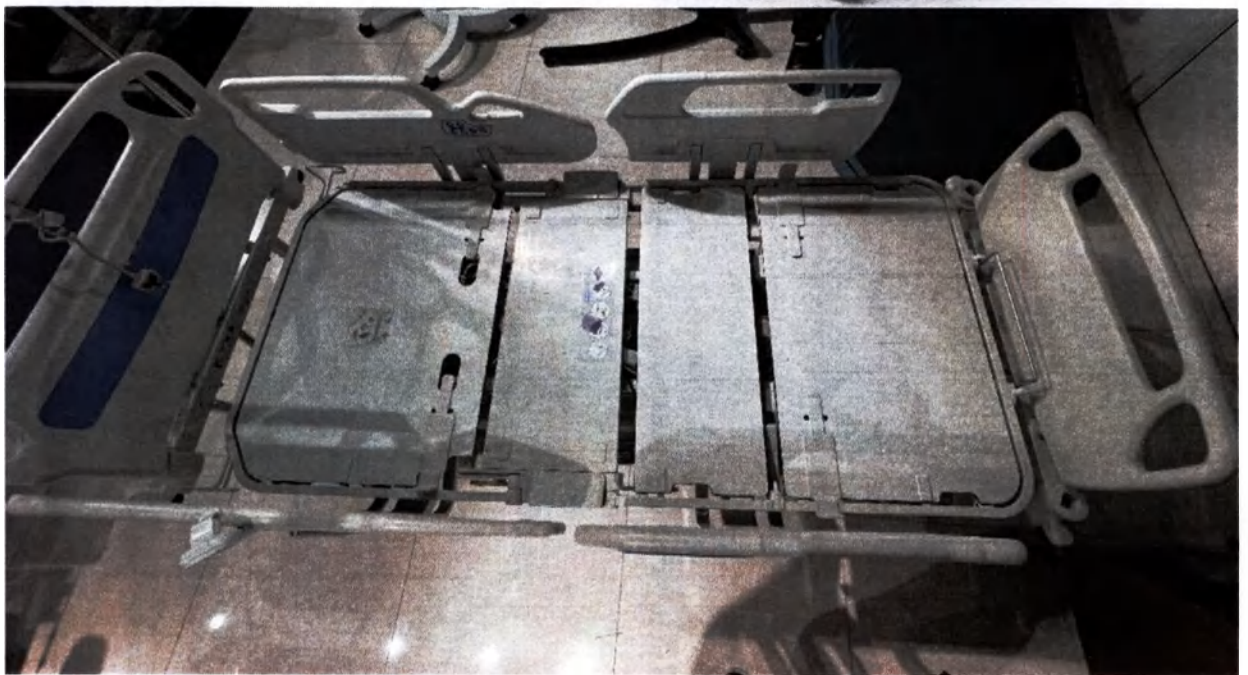


Фото 1 Ложе кровати четырех секционное – 1 шт



Фото 2 Индикатор угла наклона спинной секции – 1 шт.



Фото 3 Индикатор угла наклона положения Тренделенбург / обратный Тренделенбург – 1 шт.

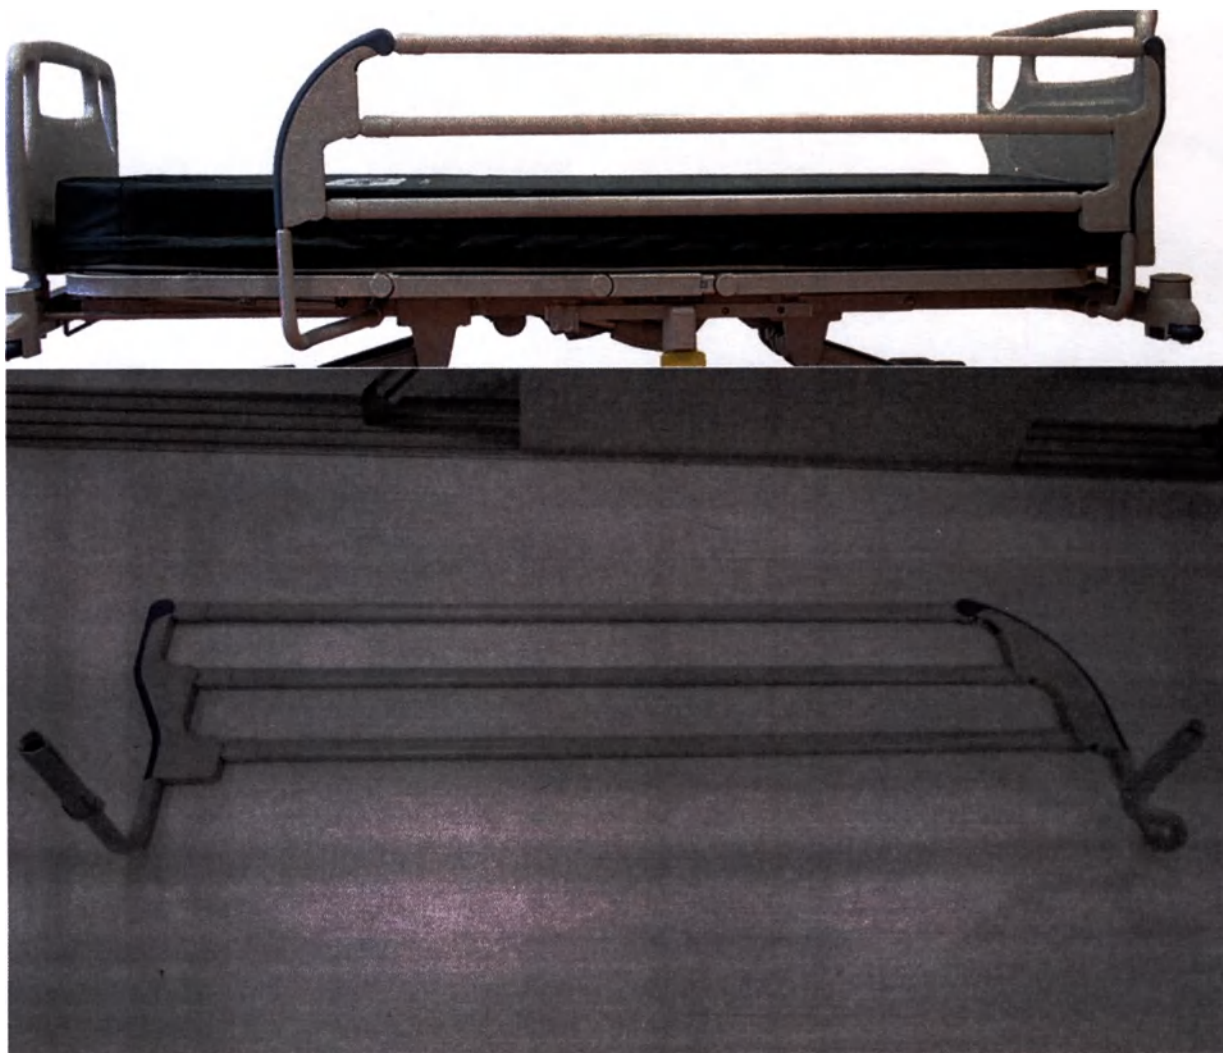


Фото 4 Боковые ограждения сплошные (при необходимости) – 2 шт



Фото 5 Сетка для боковых ограждений



Фото 6 Боковые ограждения раздельные с встроенными панелями управления (при необходимости) – 2 шт.

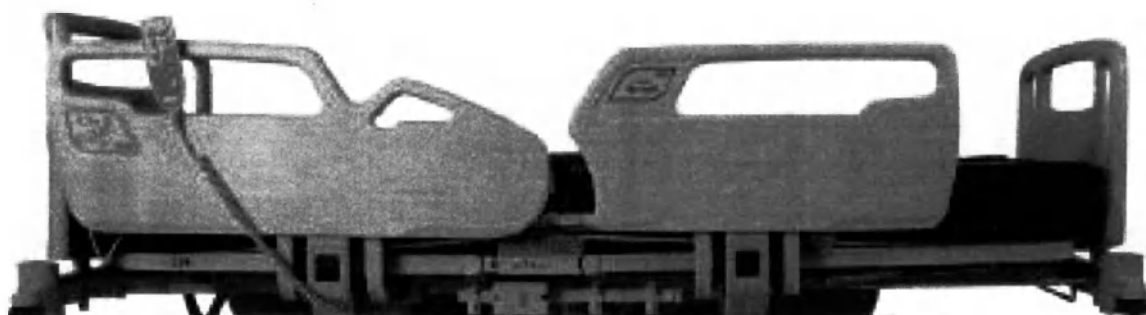


Фото 7 Боковые ограждения раздельные без панелей управления (при необходимости) – 2 шт.



Фото 8 Матрас пенополиуретановый, перераспределяющий давление (при необходимости) – 1 шт.

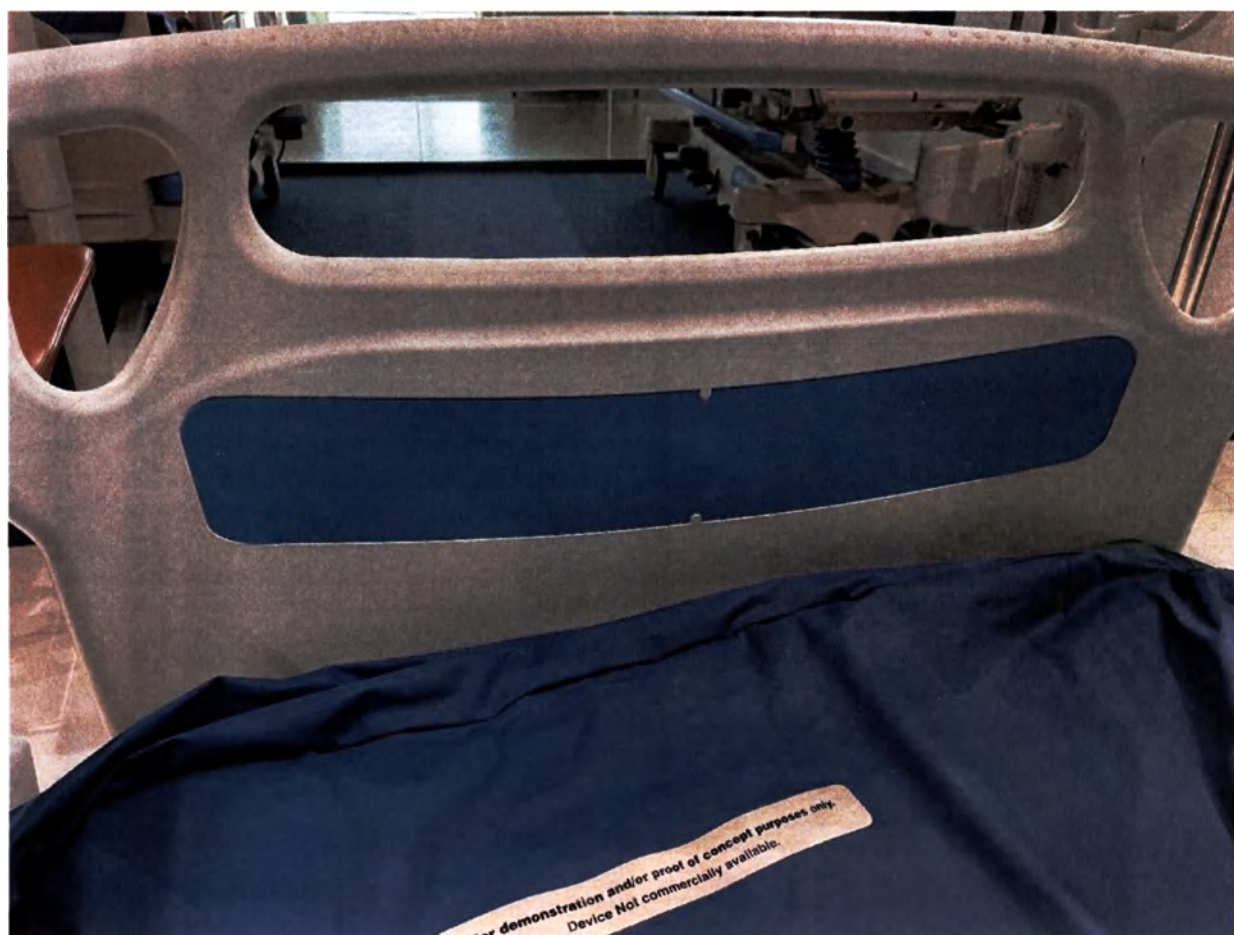


Фото 9 Спинка съемная головного конца – 1 шт.



Фото 10 Спинка съемная ножного конца – 1 шт



Фото 11 Удлинитель ложа, встроенный с держателем сменного белья – 1 шт.

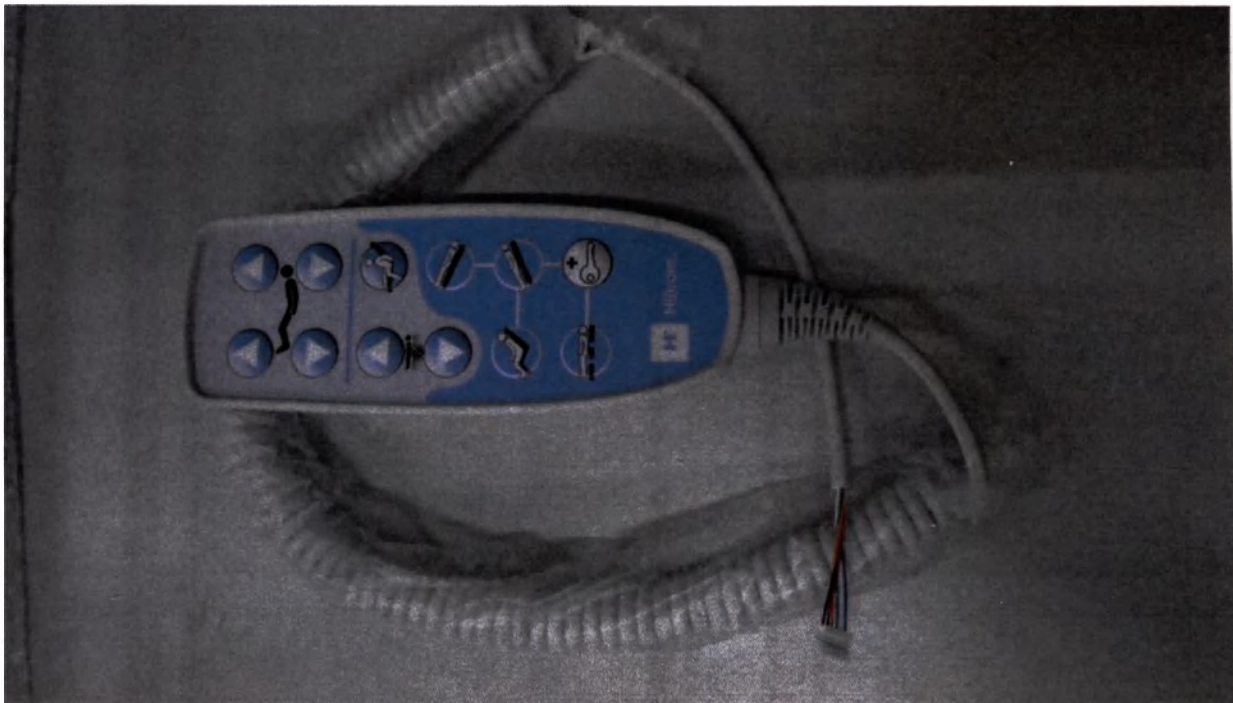


Фото 12 Пульт управления на проводе (при необходимости) – 1 шт.

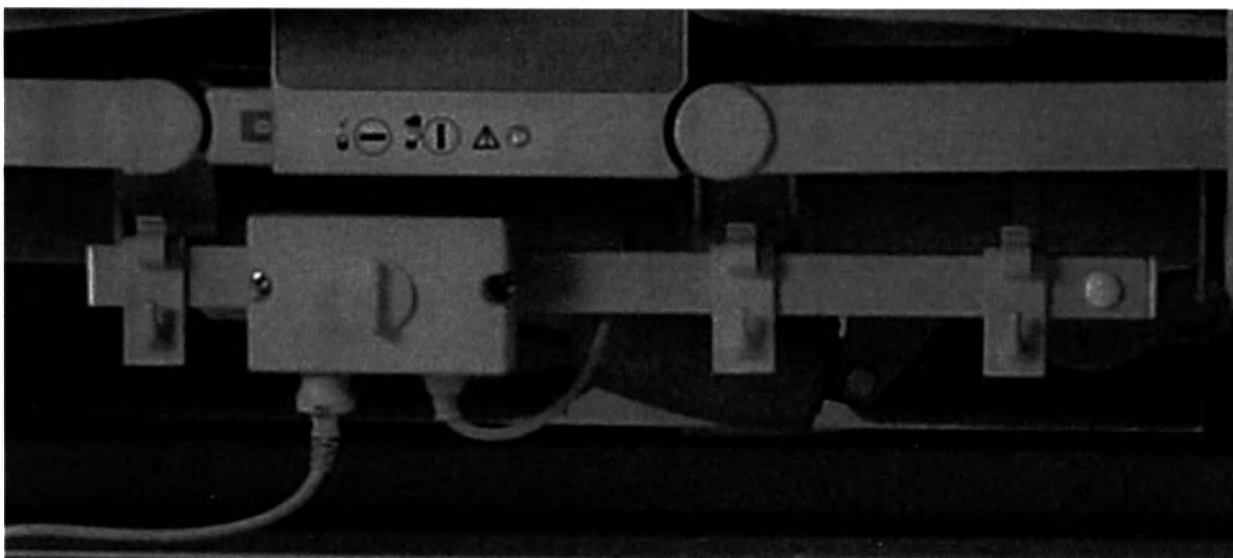


Фото 13 Держатели принадлежностей – 2 шт.



Фото 14 Колеса диаметром 150 мм – 4 шт.



Фото 15 Кабель питания – 1 шт.

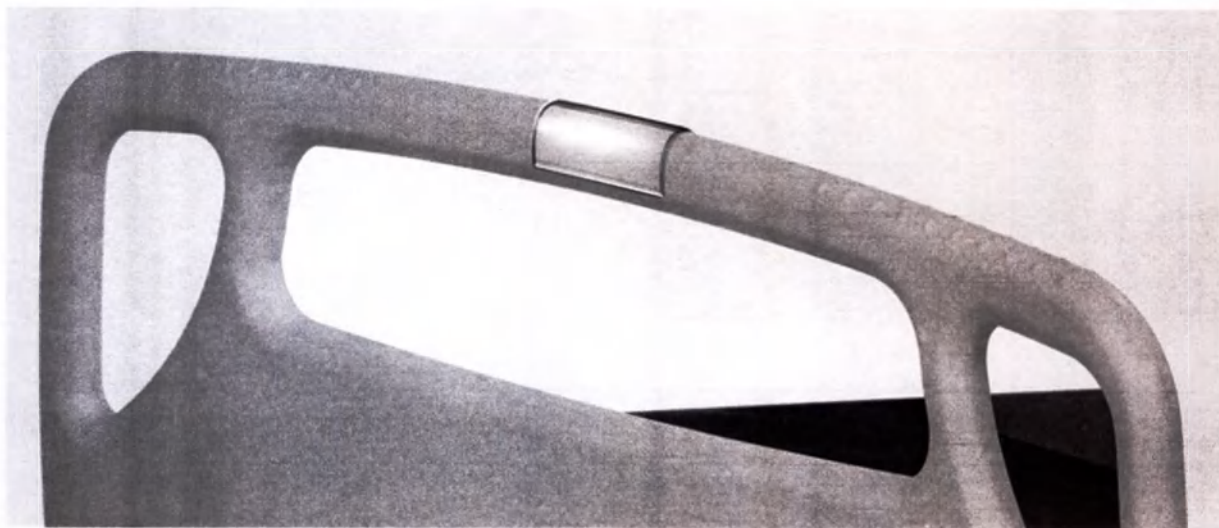


Фото 16 Табличка-держатель для имени пациента (при необходимости) – 1 шт.

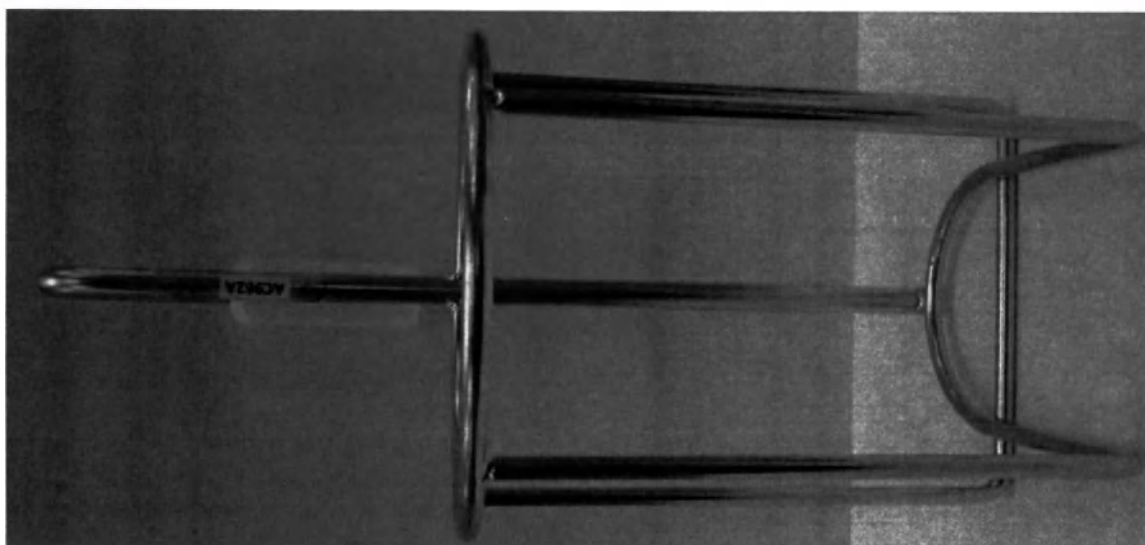


Фото 17 Вращающийся держатель для бутылей (при необходимости) – 1 шт.

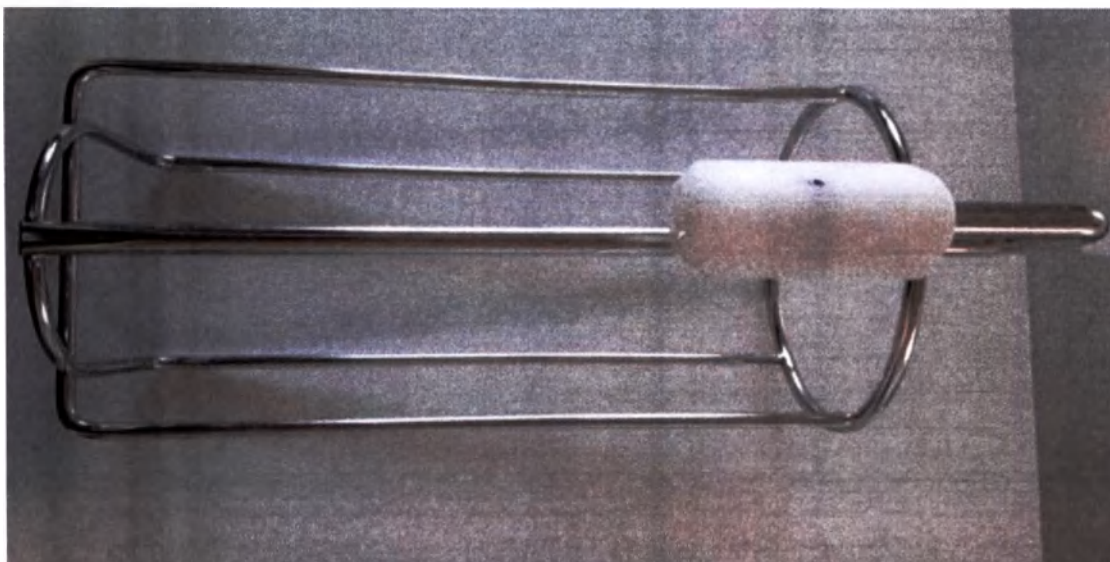


Фото 18 Держатель кислородного баллона (при необходимости) – 1 шт.



Фото 19 Стойка для внутривенных вливаний фиксированной высоты (при необходимости) – 1 шт.

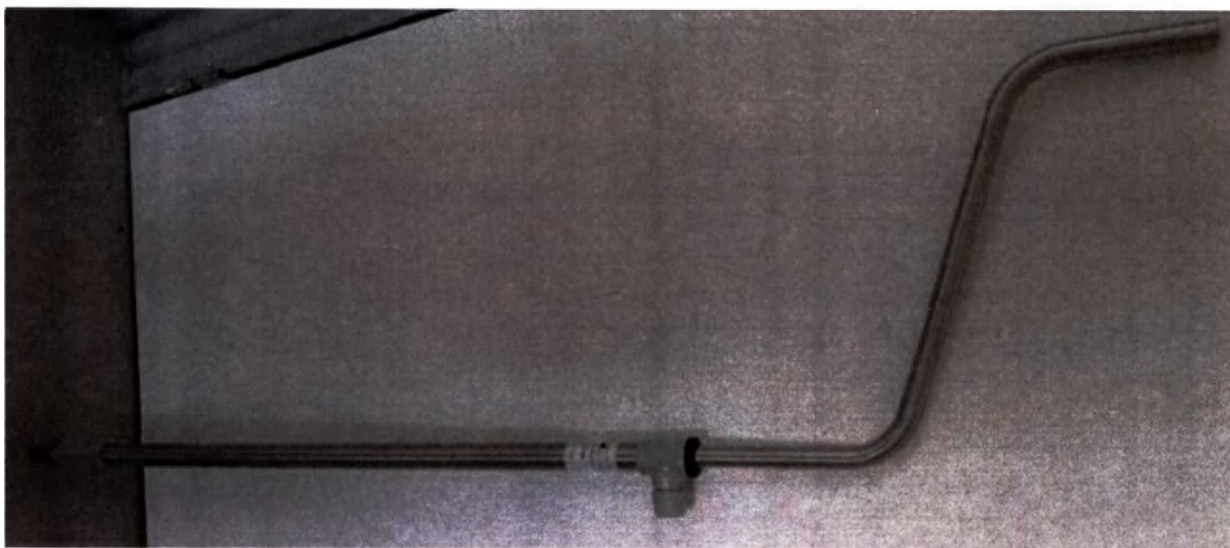


Фото 20 Стойка для внутривенных вливаний с регулируемой высотой (при необходимости) – 1 шт.



Фото 21 Г-образная стойка с рукояткой для помощи пациенту при подъеме – 1 шт.



Фото 22 Г-образная стойка с рукояткой-захватом на ремне для помощи пациенту при подъеме с регулировкой угла продольного положения – 1 шт.

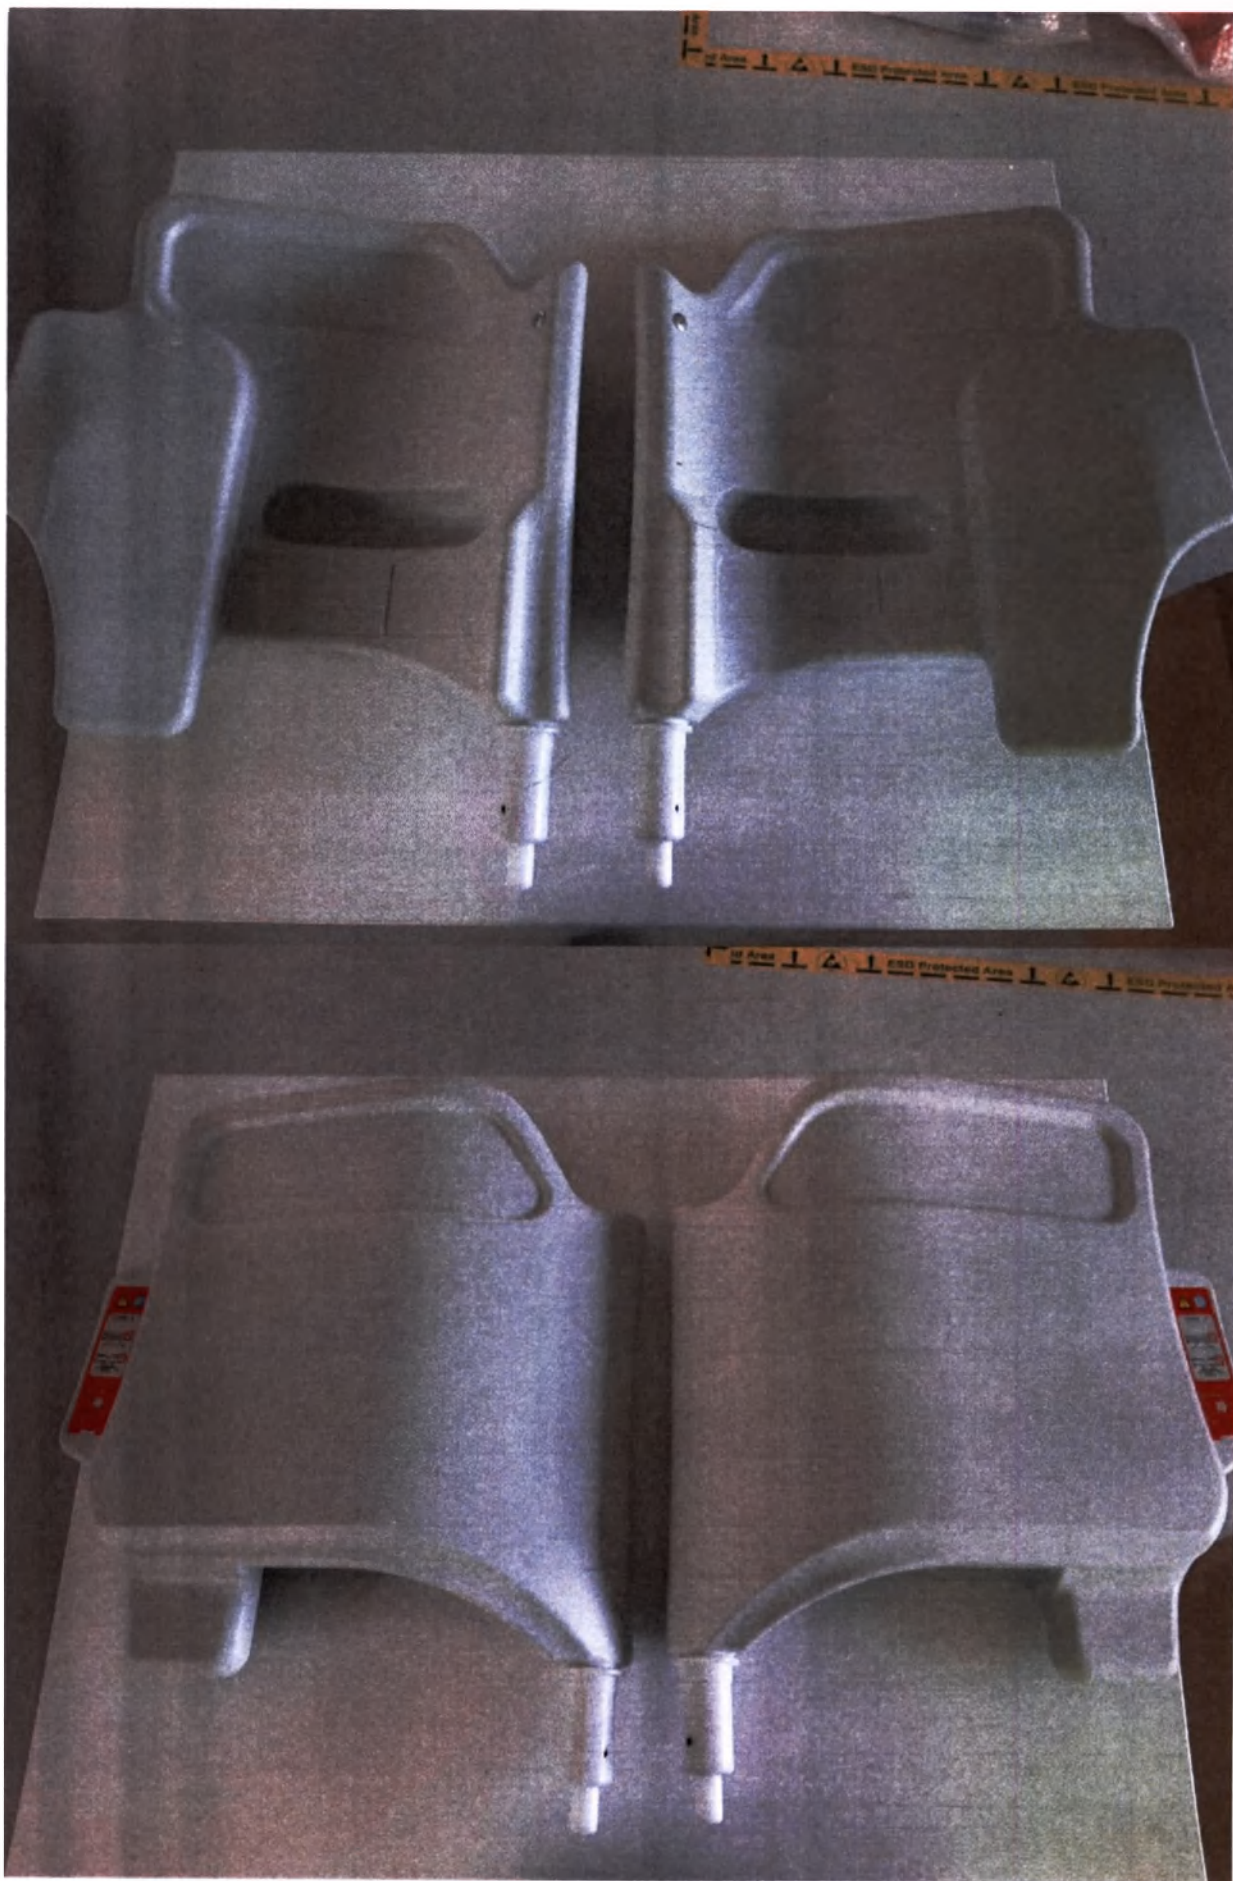


Фото 23 Ограждение бокового пространства ножной части ложа (при необходимости) – 2 шт.

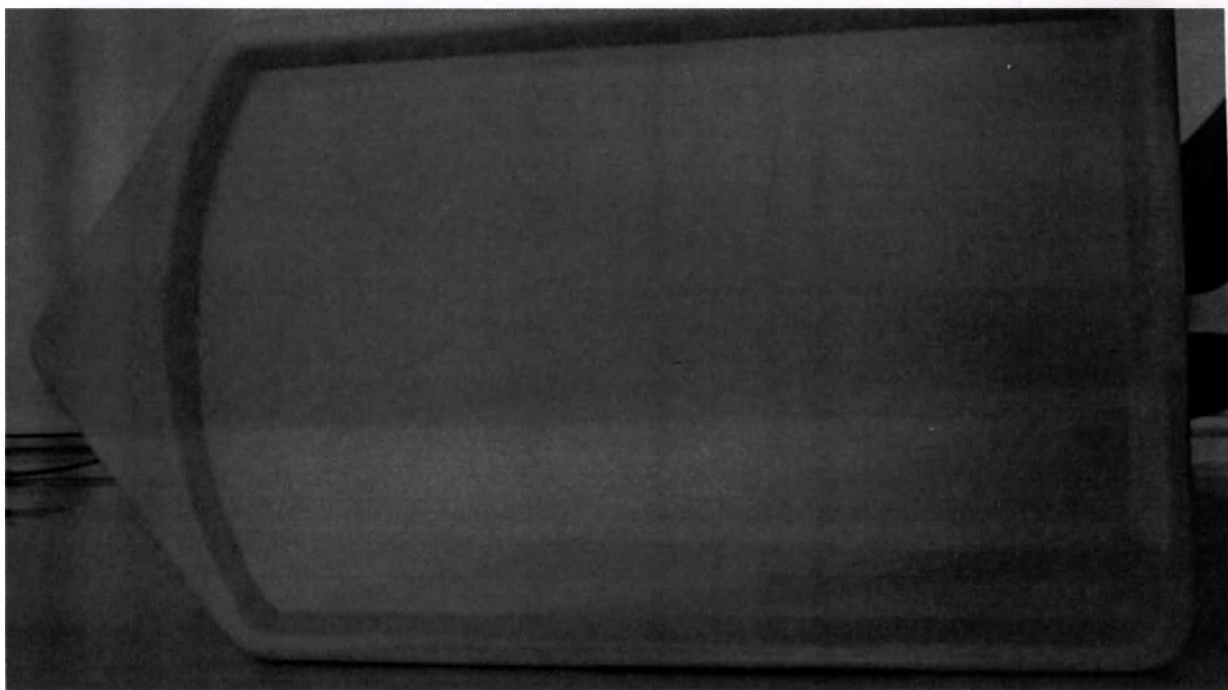


Фото 24 Лоток для процедурных принадлежностей (при необходимости) – 1 шт.

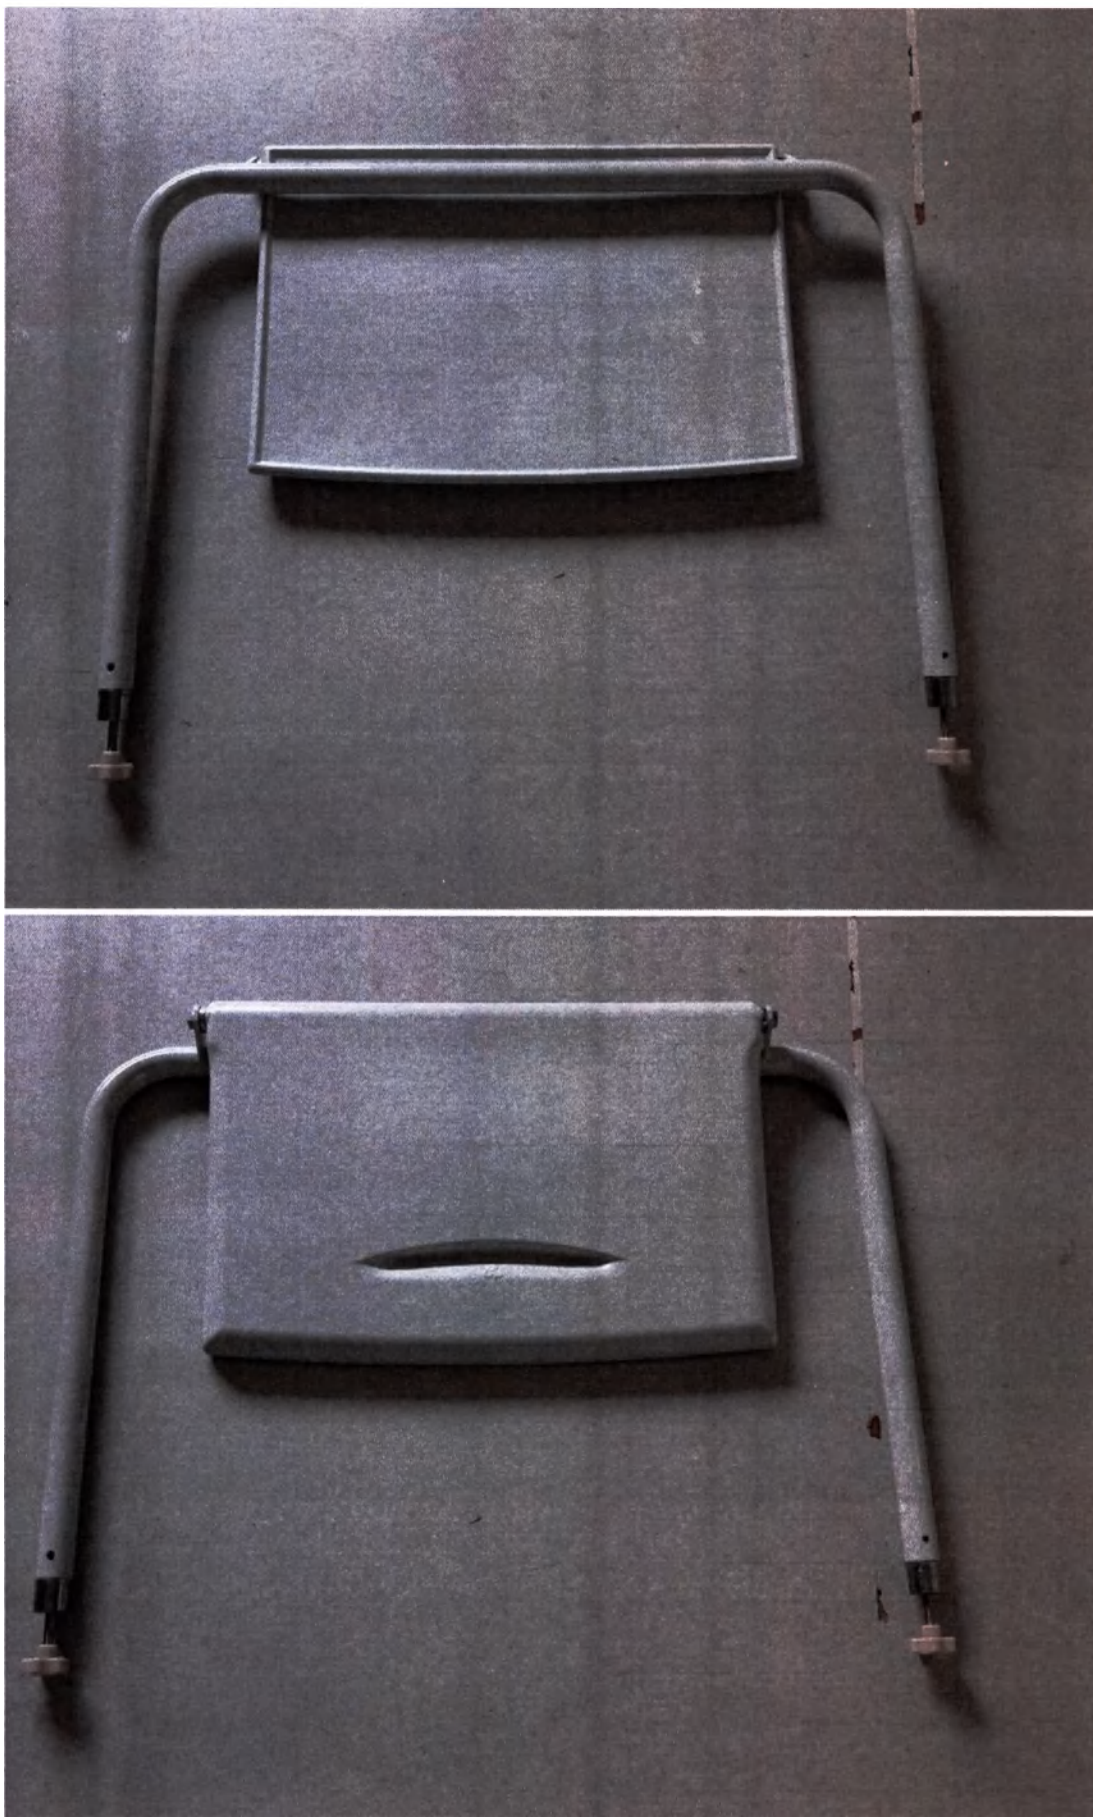


Фото 25 Подставка для монитора (по необходимости) – 1 шт



Фото 26 Дополнительная матрасная вставка для использования при удлинении ложа кровати (при необходимости)


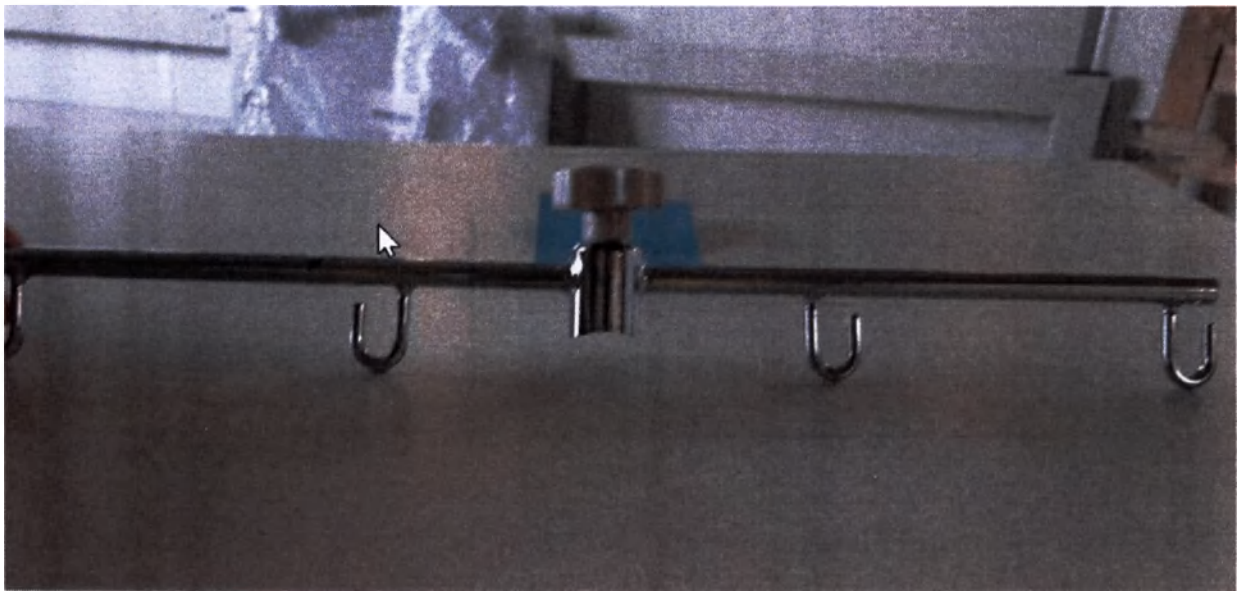


Фото 27 Хромированный крючок для внутривенного вливания (при необходимости)



Centuris™ Pro кровать
Инструкции по эксплуатации
LI900B1



195674
REV. 7

RU

Фото 28 Эксплуатационная документация

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

восьмнадцать листах

