

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медтроник»
Пясунова Е.В.



2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**«Электрокардиостимуляторы с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta,
Solara, Serena»**
производства: «Медтроник Инк» (Medtronic Inc.), США







Рисунок 1. Электрокардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель WITR04, в составе: Электрокардиостимулятор имплантируемый, Тарированный ключ, Документация по продукции



Medtronic

Bluetooth

Percepta™ CRT-P
MRI SureScan™

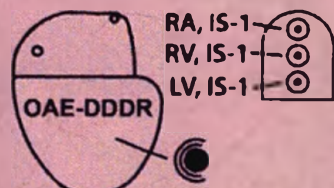

W1TR04



RNU603615S



2020-12-28
YYYY-MM-DD













2019-07-12
YYYY-MM-DD





W1TR04

DDD



FCC ID: LFSBLEIMPLANT2
IC: 3408D-BLEIMPLANT2

STERILE EO



www.medtronic.com/manuals



Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA

Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands

Manufactured in Tolochenaz, Switzerland

www.medtronic.com

CE0123

M876921A001 B - M874569A001 A

Рисунок 2. Маркировка стерильной упаковки Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan. модель W1TR04



Рисунок 3. Стерильная упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель W1TR04

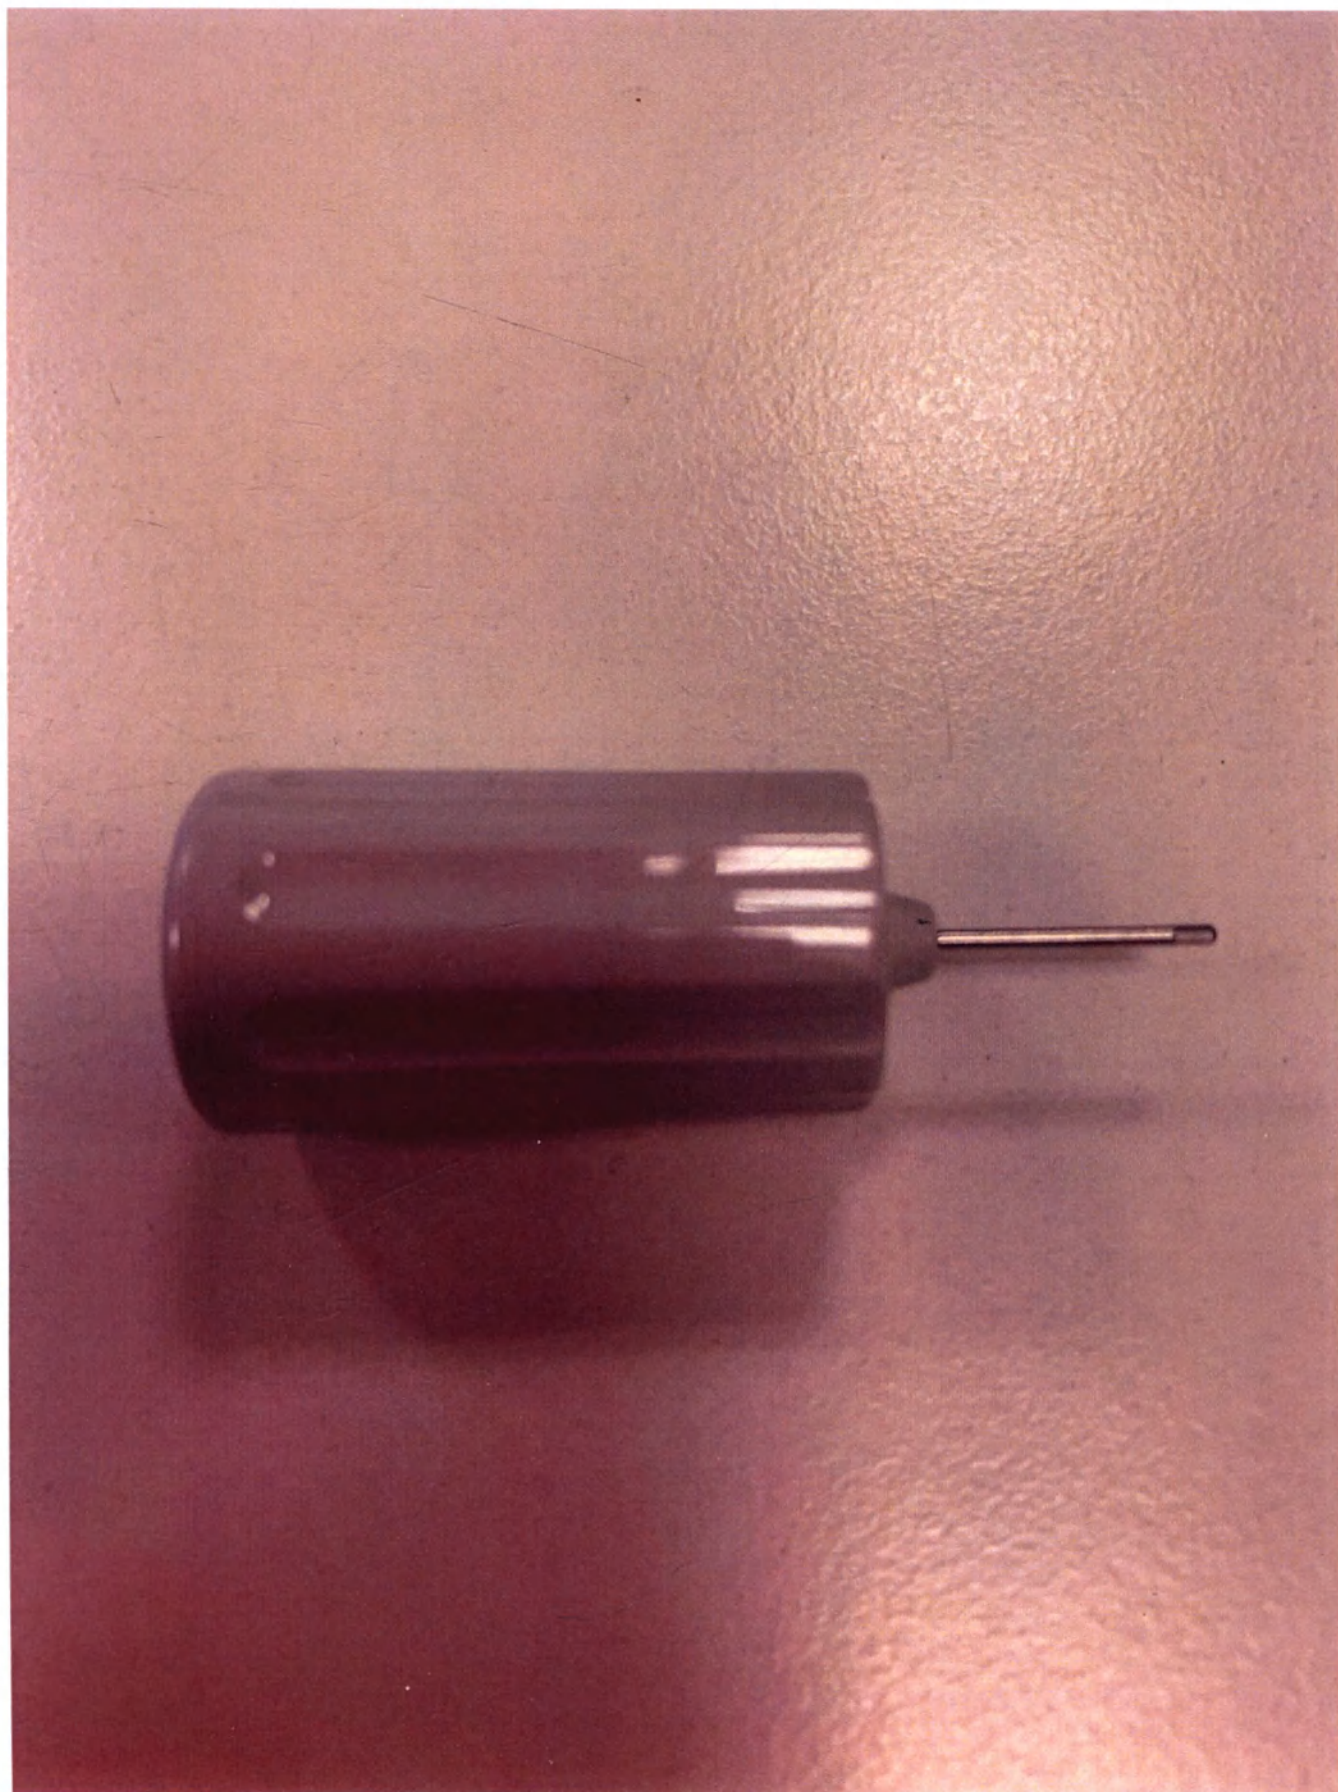


Рисунок 4. Тарированный ключ

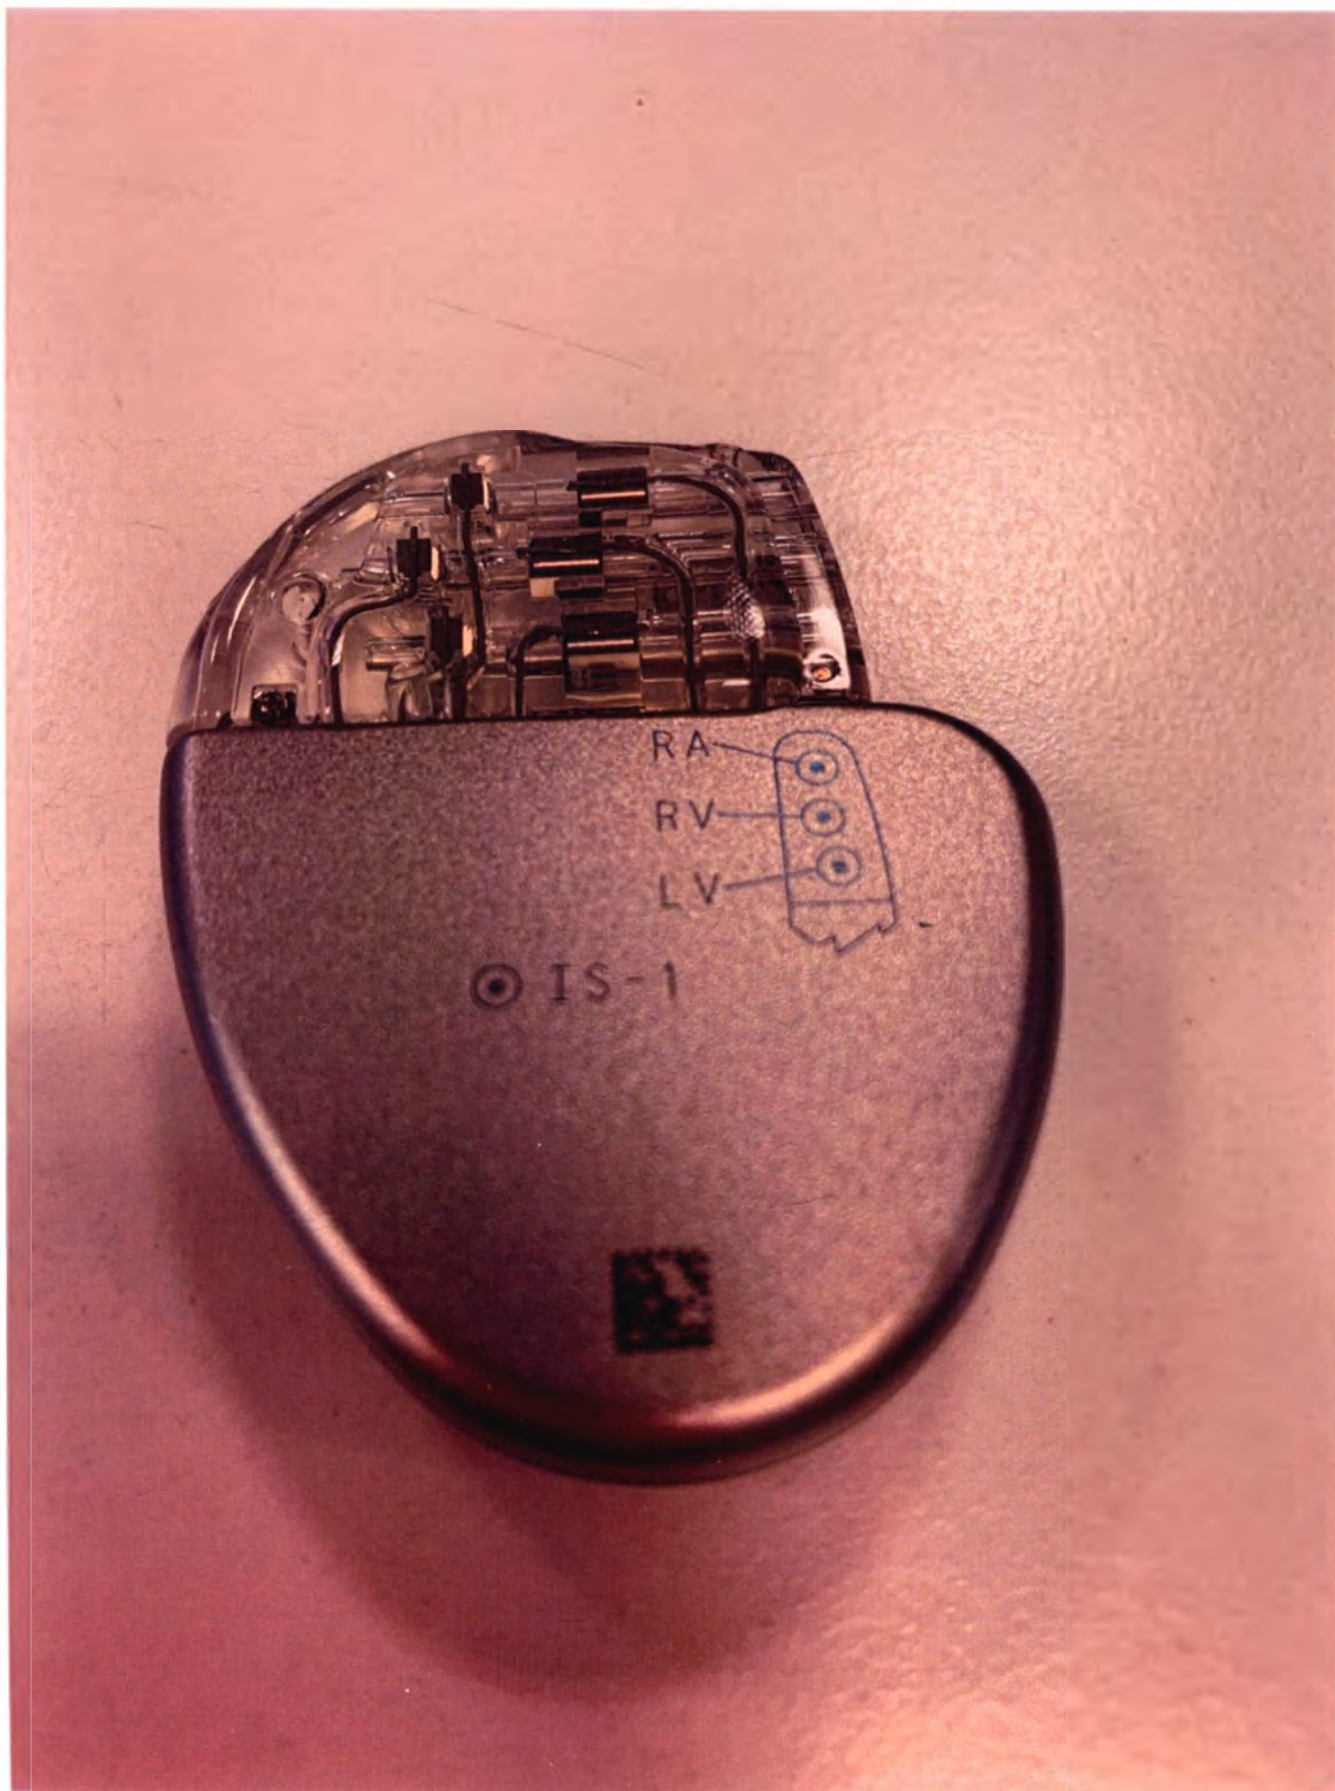


Рисунок 5. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид сзади)



Рисунок 6. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид спереди)

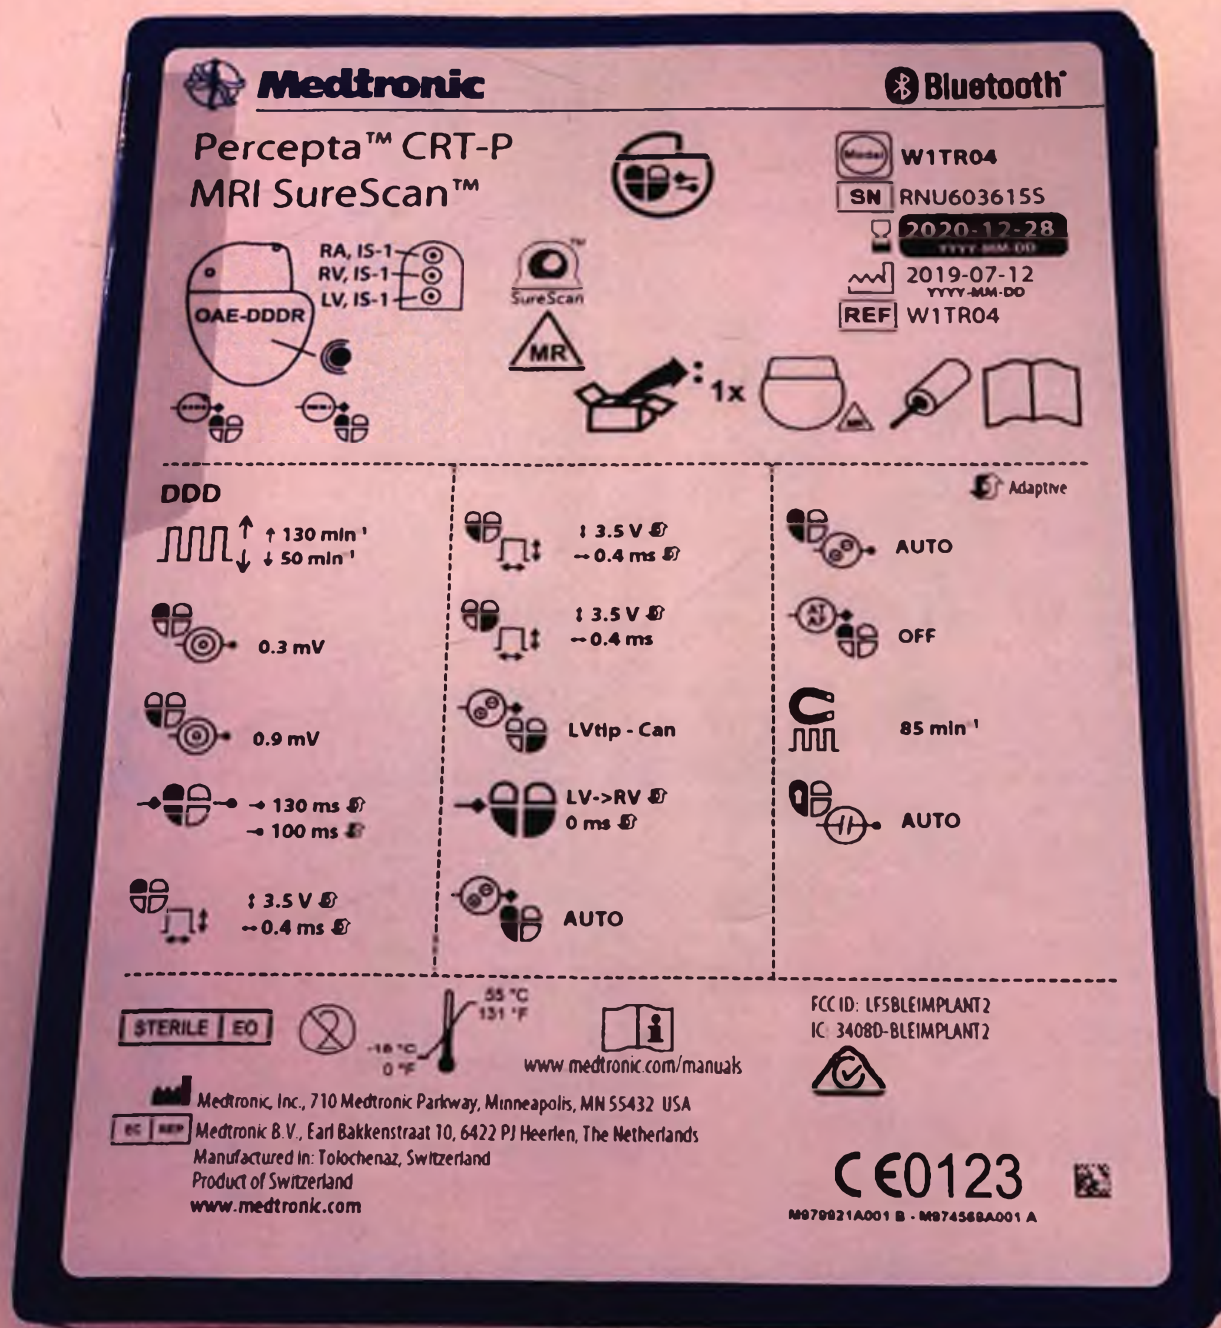


Рисунок 7. Потребительская упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель W1TR04



Рисунок 8. Электрокардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05, в составе: Электрокардиостимулятор имплантируемый, Тарированный ключ, Документация по продукции



Рисунок 9. Тарированный ключ



Рисунок 10. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид спереди)

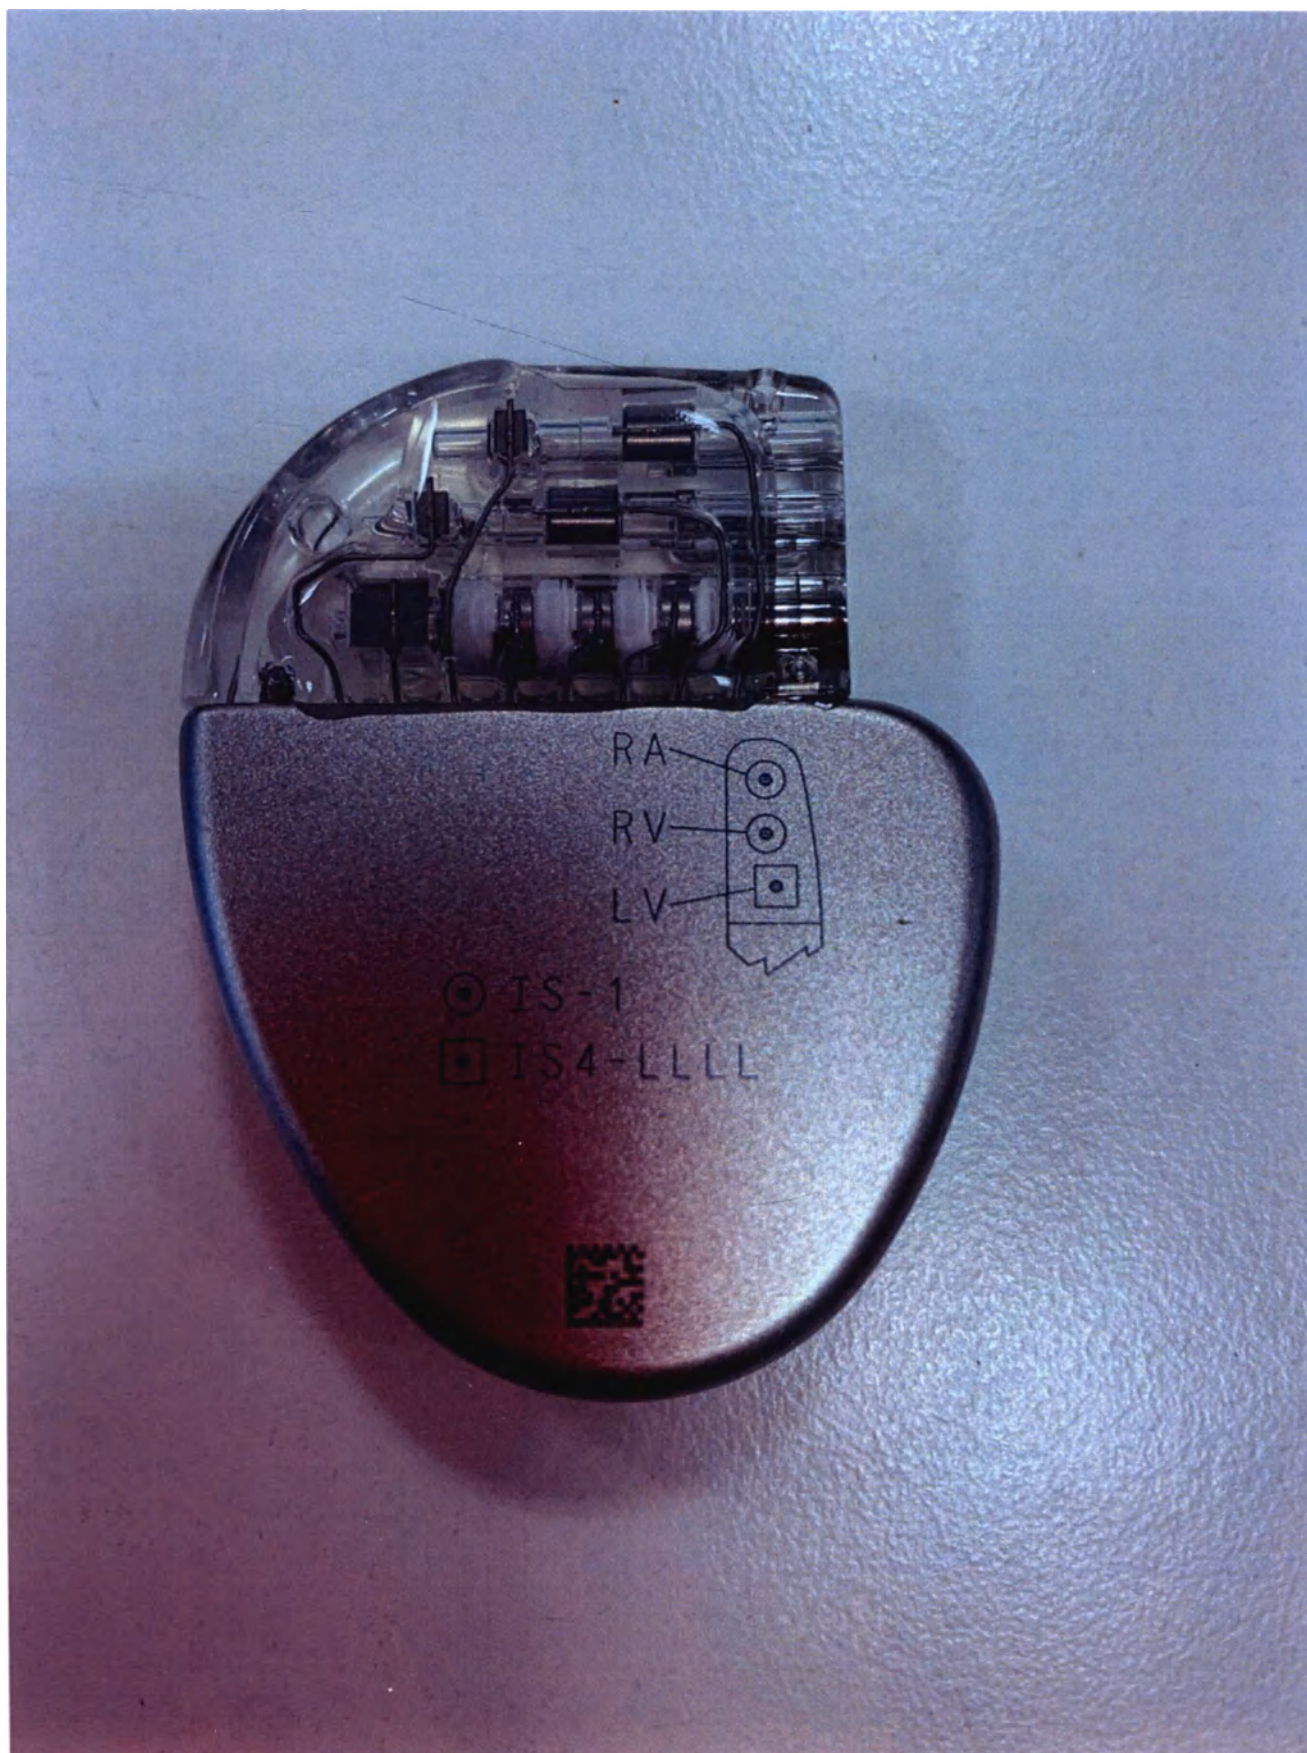


Рисунок 11. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид сзади)



Рисунок 12. Стерильная упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05

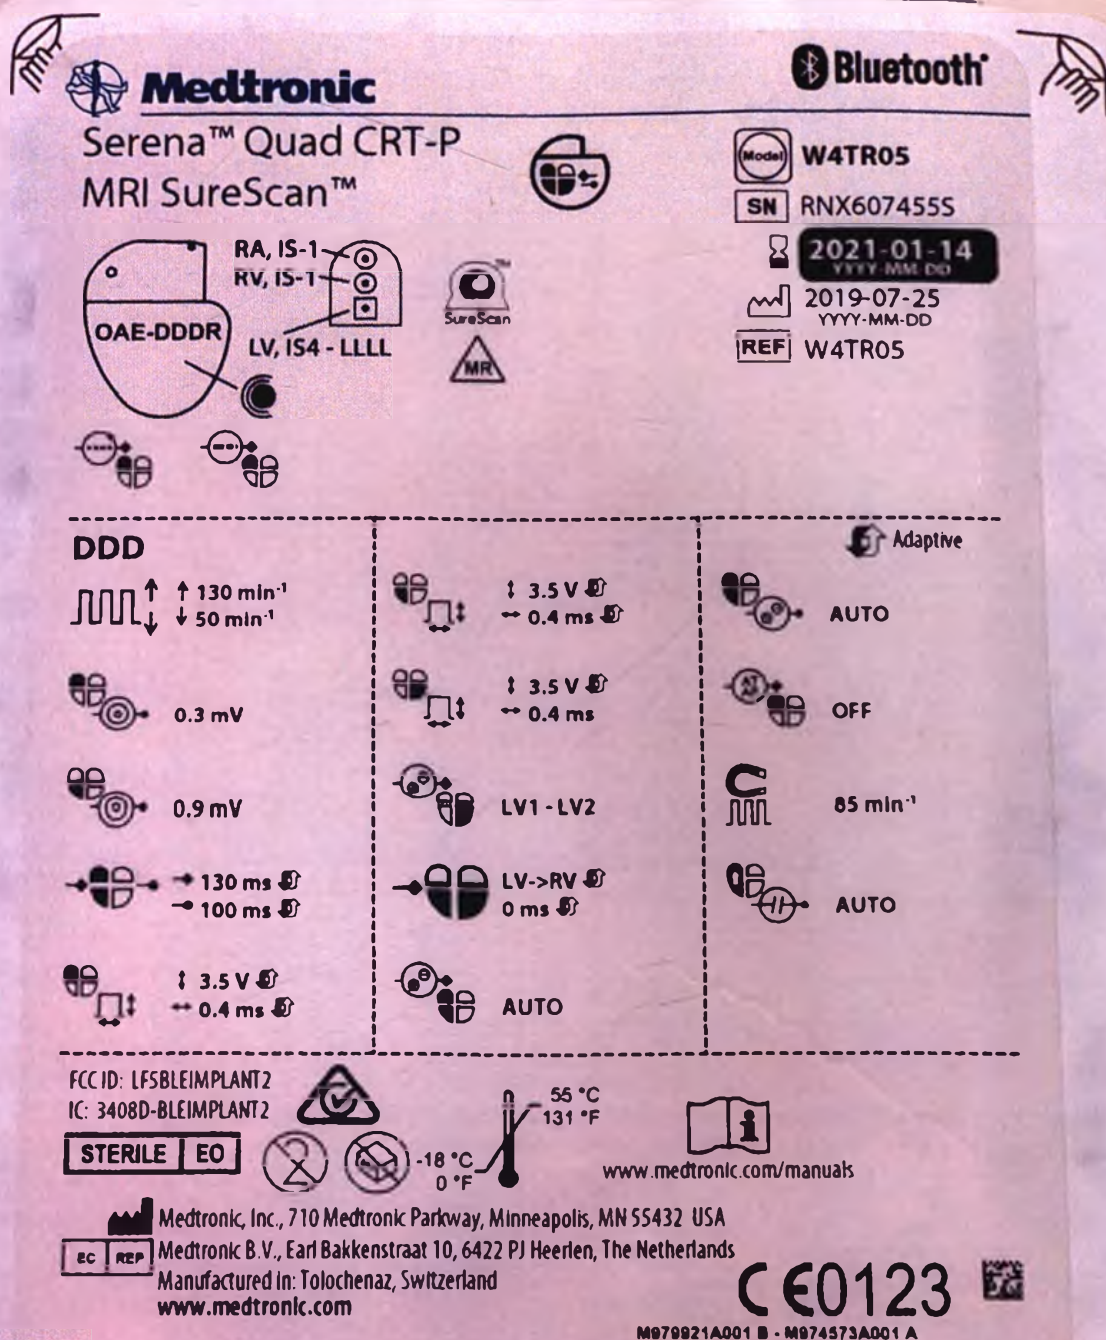


Рисунок 13. Маркировка Стерильной упаковки Электrokapдиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05

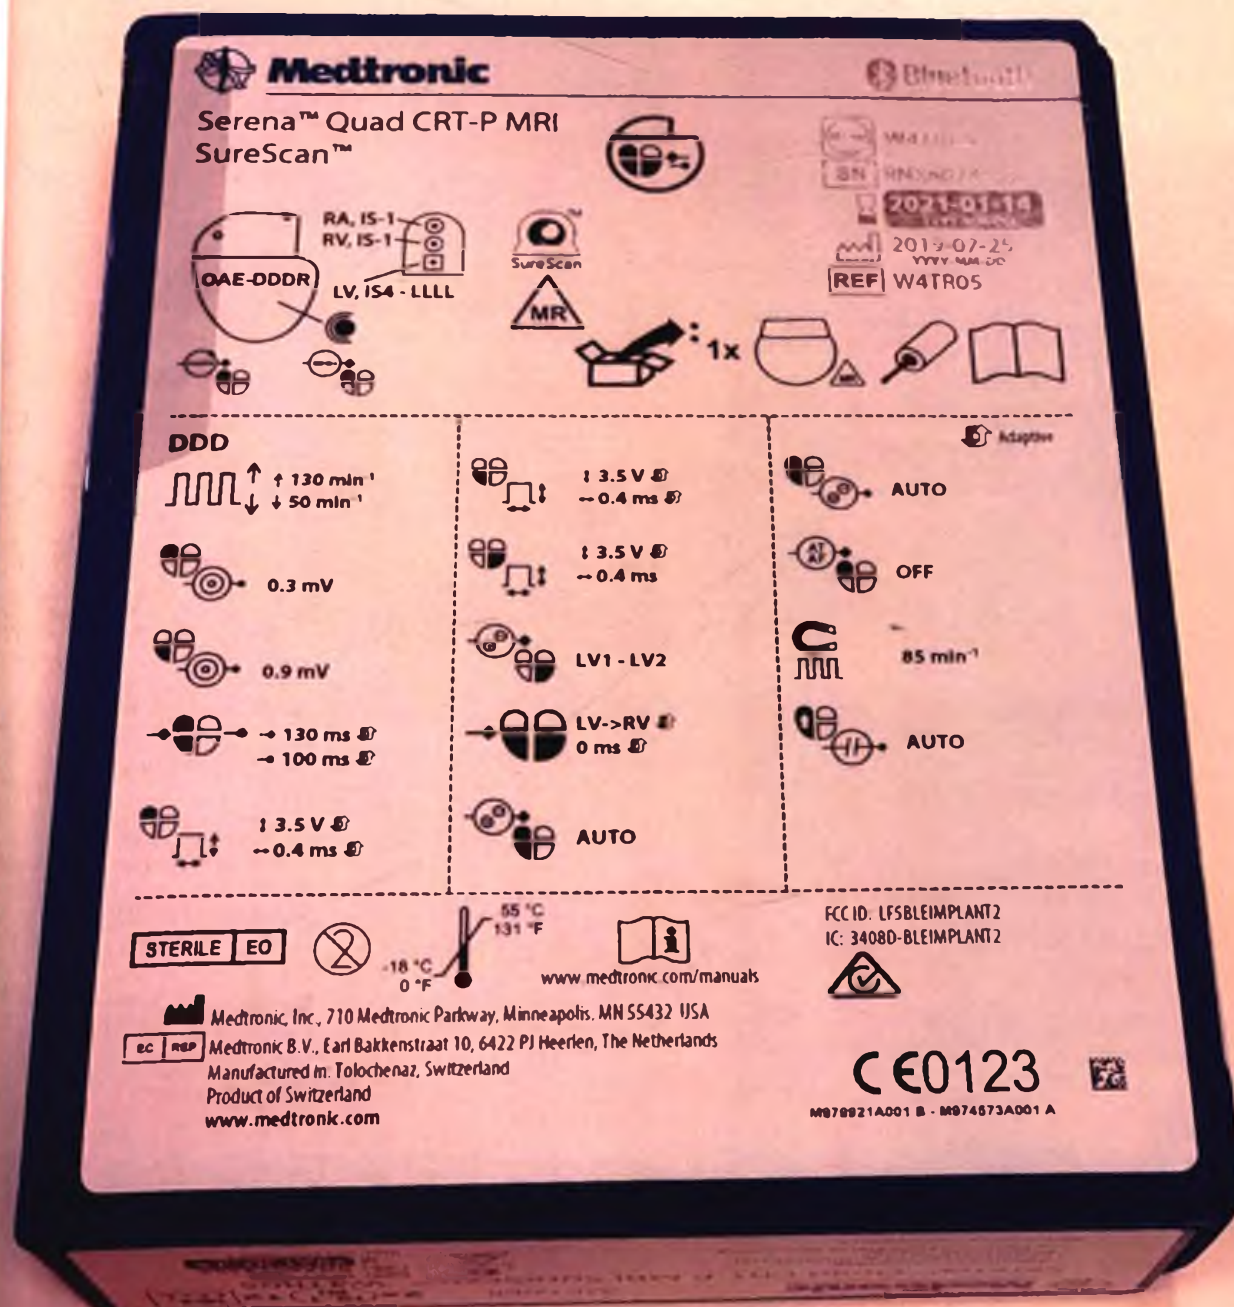


Рисунок 14. Потребительская упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05



Рисунок 15. Электрокардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06, в составе: Электрокардиостимулятор имплантируемый, Тарированный ключ, Документация по продукции



Рисунок 16. Стерильная упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06

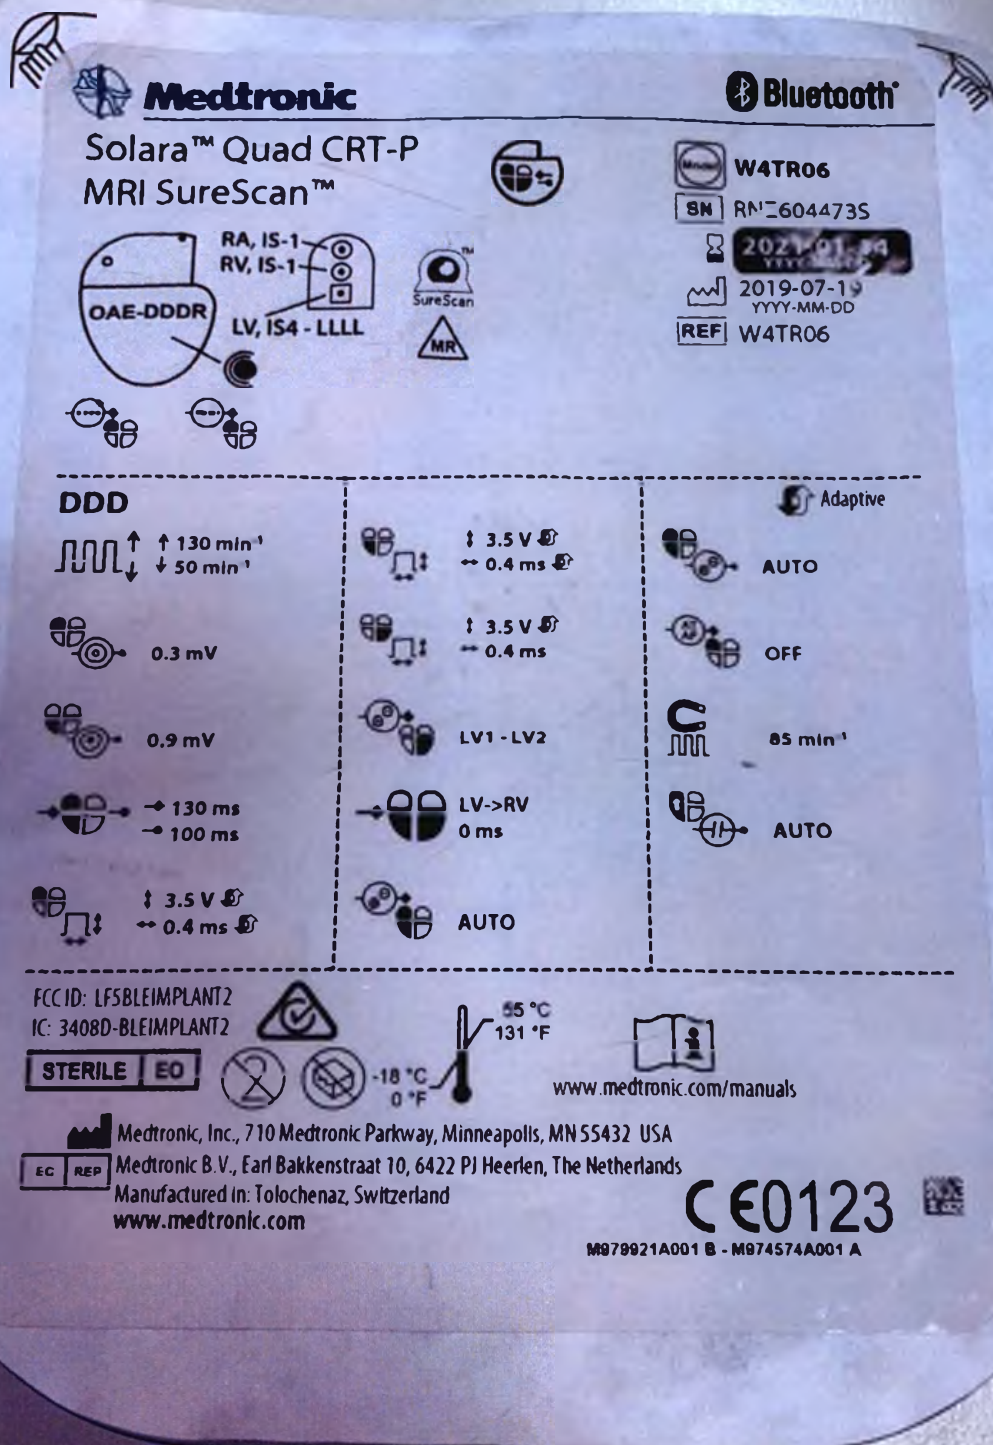


Рисунок 17. Маркировка стерильной упаковки Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06



Рисунок 18. Тарированный ключ

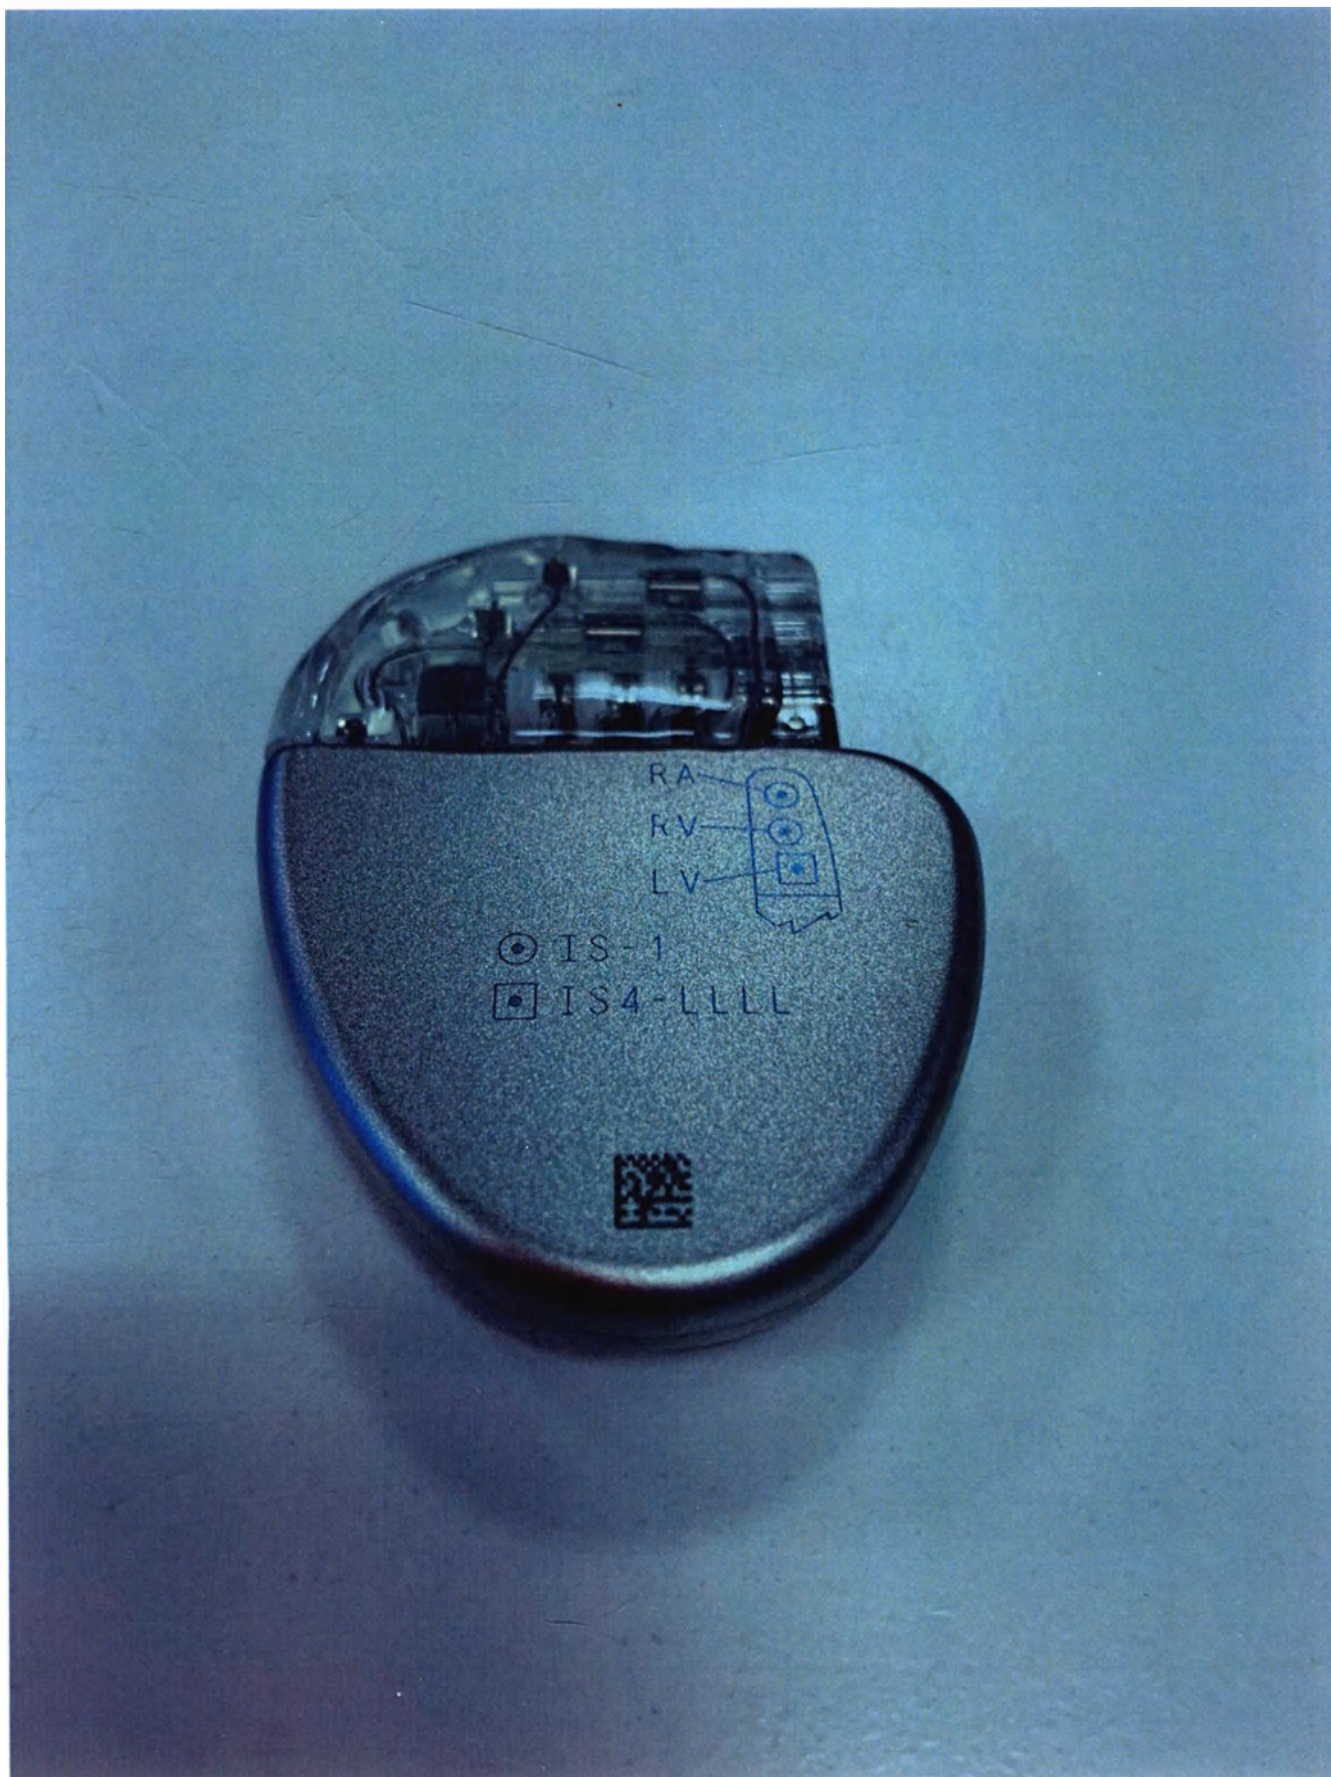


Рисунок 19. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид сзади)



Рисунок 20. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид спереди)

**Medtronic****Bluetooth**Solara™ Quad CRT-P MRI
SureScan™




W4TR06



RNZ604473S

2021-01-14
YYYY-MM-DD2019-07-19
YYYY-MM-DD

W4TR06

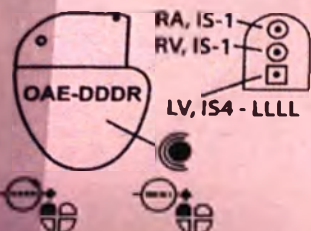**DDD**

0.3 mV



0.9 mV

→ 130 ms
→ 100 ms↑ 3.5 V ⚡
→ 0.4 ms ⚡↑ 3.5 V ⚡
→ 0.4 ms ⚡↑ 3.5 V ⚡
→ 0.4 ms ⚡

LV1 - LV2

LV → RV
0 ms

AUTO

Adaptive



AUTO



OFF



85 min⁻¹



AUTO

STERILE EO

55 °C
131 °F
-18 °C
0 °Fwww.medtronic.com/manualsFCC ID: LFSBLEIMPLANT2
IC: 3400-2115MPL/INT2

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA

Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands

Manufactured in: Tolochenaz, Switzerland

Product of Switzerland

www.medtronic.com

CE0123



M0799214001 B - 002745746-111

Рисунок 21. Потребительская упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06

Пример локального стикера

	Название медицинского изделия, модель	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в Российской Федерации:	
	Регистрационное удостоверение № _____ дата _____	
	Дата производства / серия / срок годности: см. на упаковке	См. инструкцию См. символы на упаковке

