


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение общего вида упаковки SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагент для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-22 (в открытом виде)

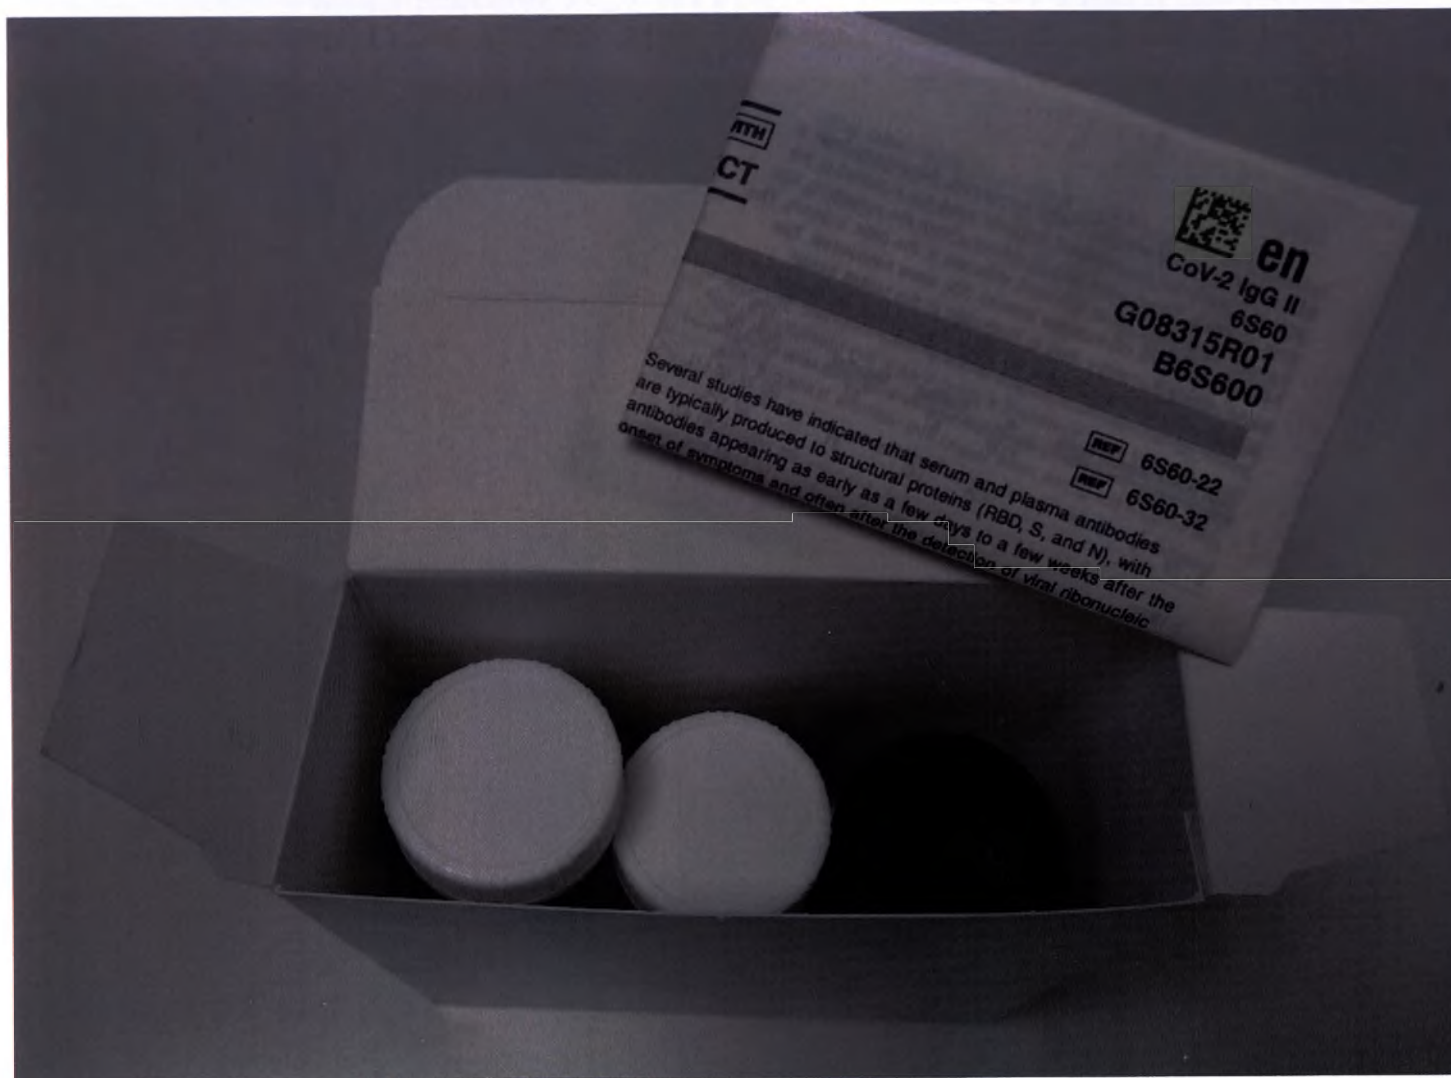


Фотографическое изображение флаконов реагентов, входящих в состав МИ SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-22




Фотографическое изображение общего вида упаковки SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-32



Фотографическое изображение общего вида упаковки SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-32 (в открытом виде)

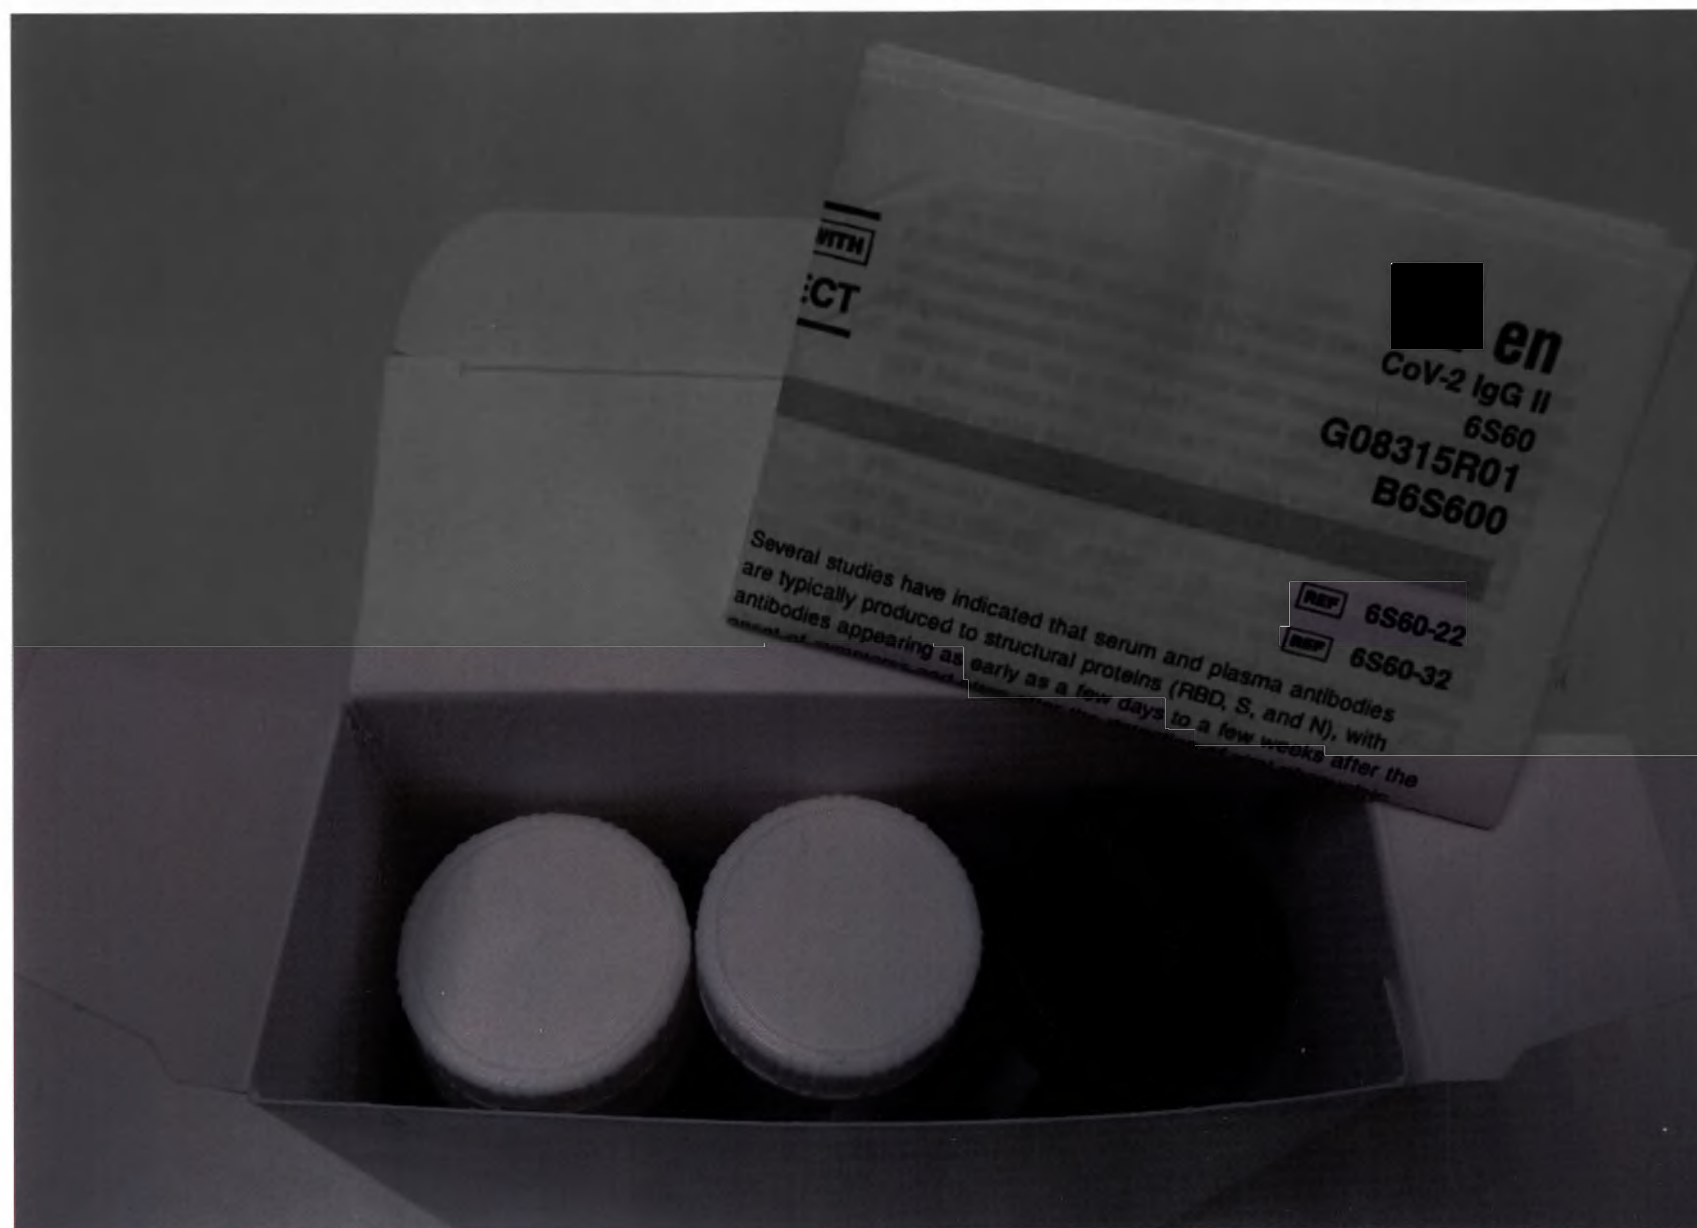

Фотографическое изображение флаконов реагентов, входящих в состав МИ SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-32

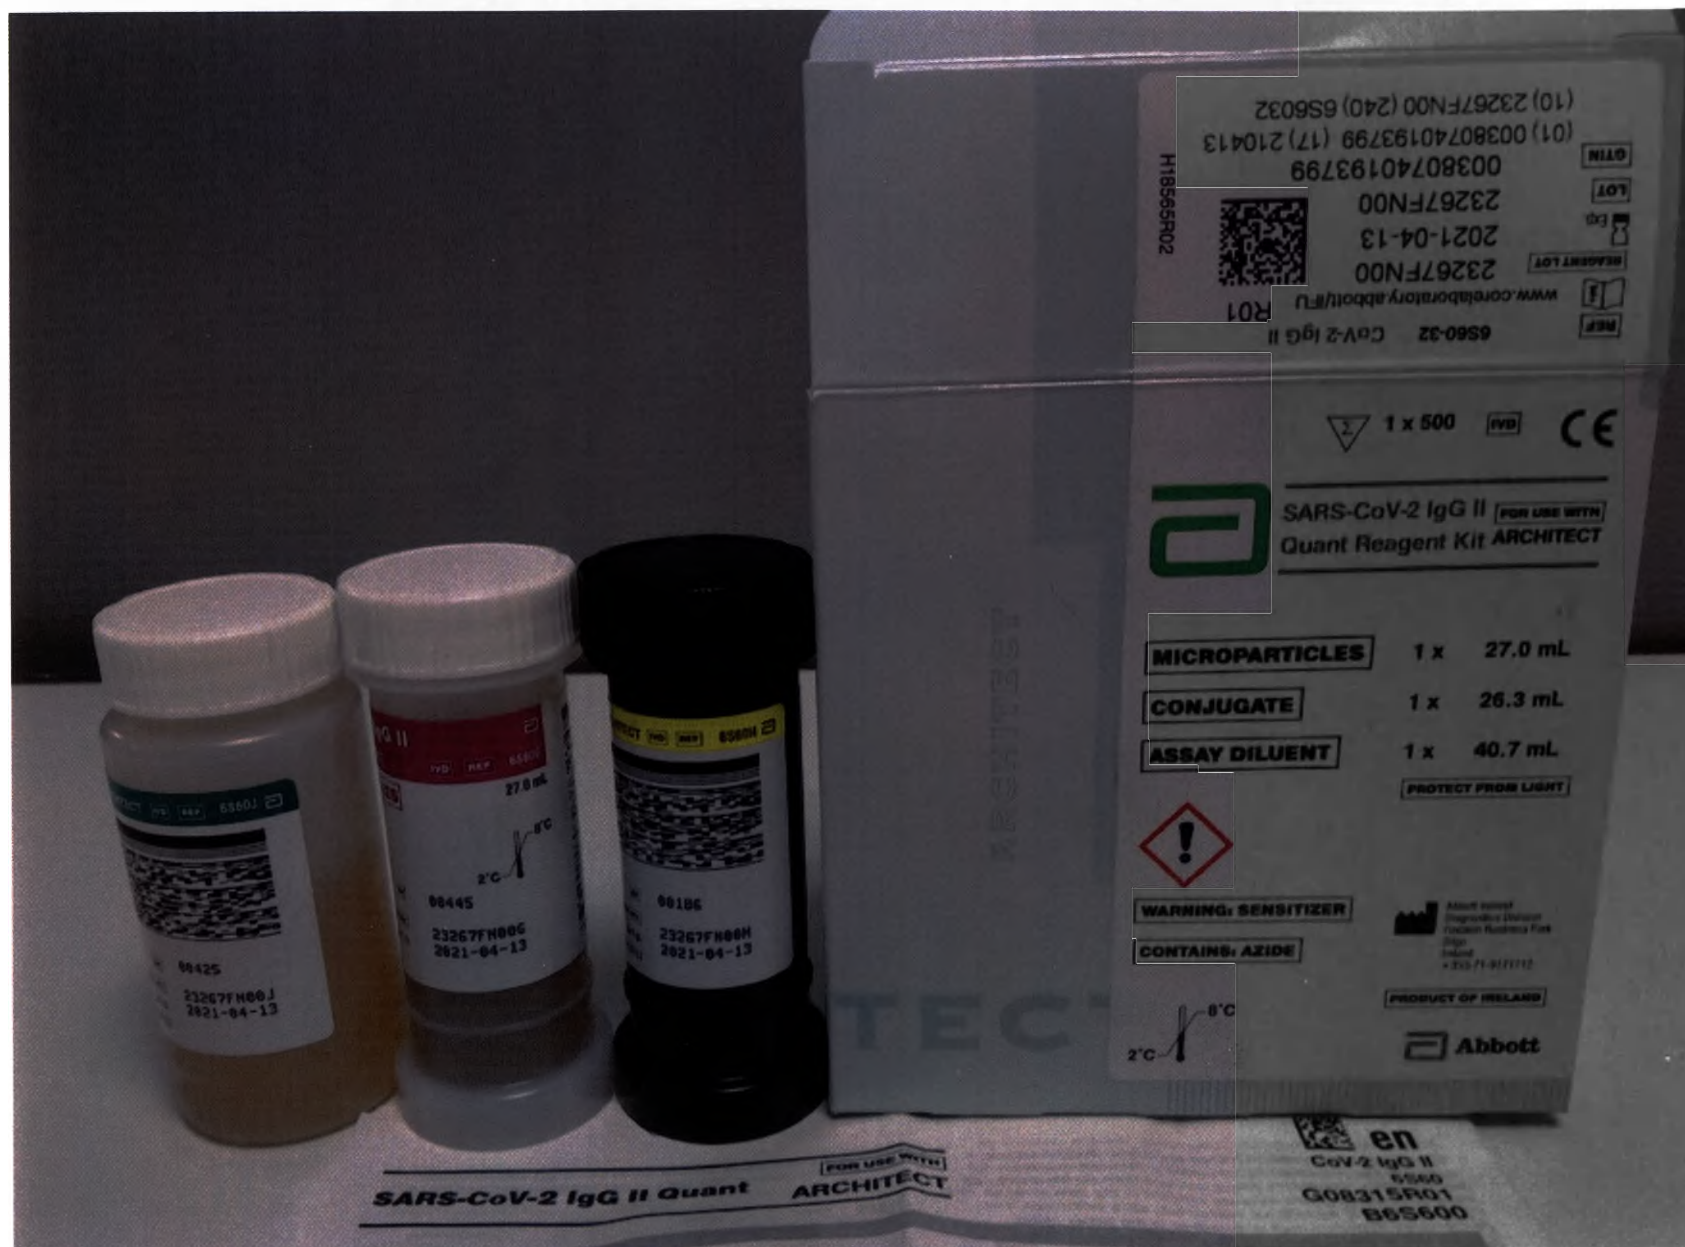

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)»

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22



6S60-22



Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)»

Набор на 100 тестов в составе: Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles) – 1 x 6,6 мл;

Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate) – 1 x 5,9 мл; Дилуент теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent) – 1 x 7,9 мл, Инструкция по применению /Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland /Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott /IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22

HT 8564F03

REF 6S60-22 CoV-2 IgG II
www.abbott-diagnostics.org/abx-ifu
REAGENT LOT
EXP
LOT

1 x 100
CE 0123

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH
Quant Reagent Kit ARCHITECT

MICROPARTICLES 1 x 6.6 mL

CONJUGATE 1 x 5.9 mL

ASSAY DILUENT 1 x 7.9 mL

PROTECT FROM LIGHT



WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finislin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

PRODUCT OF IRELAND




Abbott


CoV-2 IgG II

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22


- Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles)

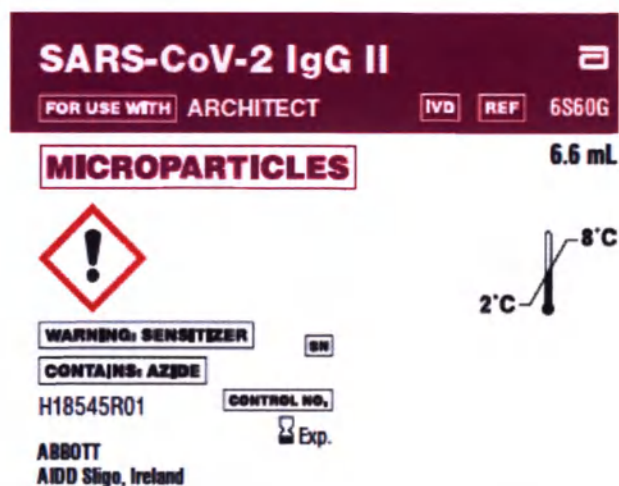

- Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate)

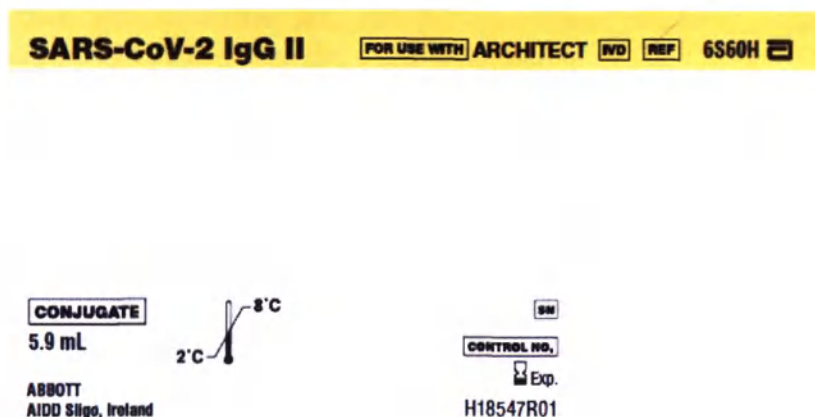

- Дилуэнт теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent)

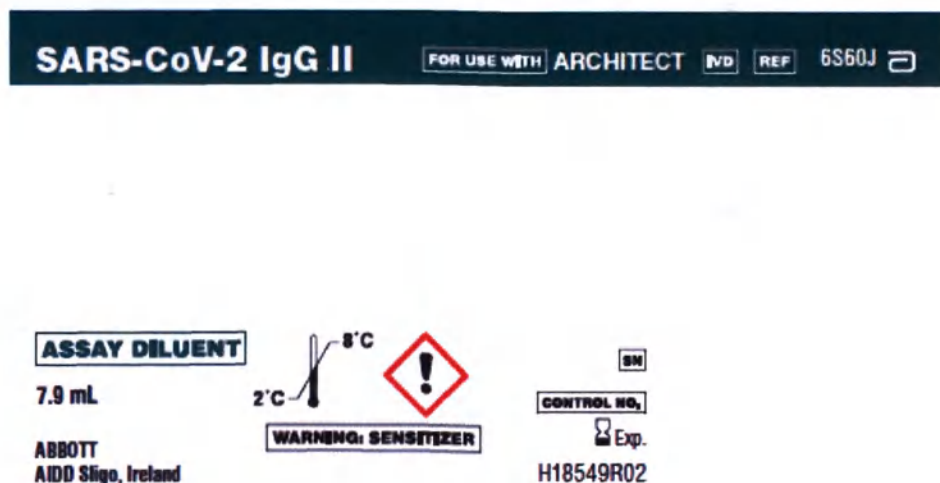

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32



6S60-32



Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)»

Набор на 500 тестов в составе: Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles) – 1 x 27 мл;

Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate) – 1 x 26,3 мл; Дилуент теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent) – 1 x 40,7 мл, Инструкция по применению /Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland /Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:


Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32

Н18565R03

REF 6S60-32 CoV-2 IgG II
www.abbott.com/abbott
REAGENT LOT
Exp
LOT

1 x 500
CE 0123

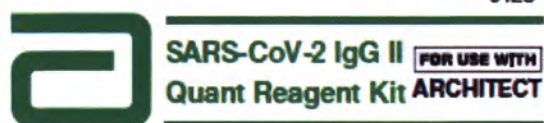

MICROPARTICLES 1 x 27.0 mL

CONJUGATE 1 x 26.3 mL

ASSAY DILUENT 1 x 40.7 mL

PROTECT FROM LIGHT





WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finiskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-711-917 1712


PRODUCT OF IRELAND




CoV-2 IgG II

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32


- Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles)

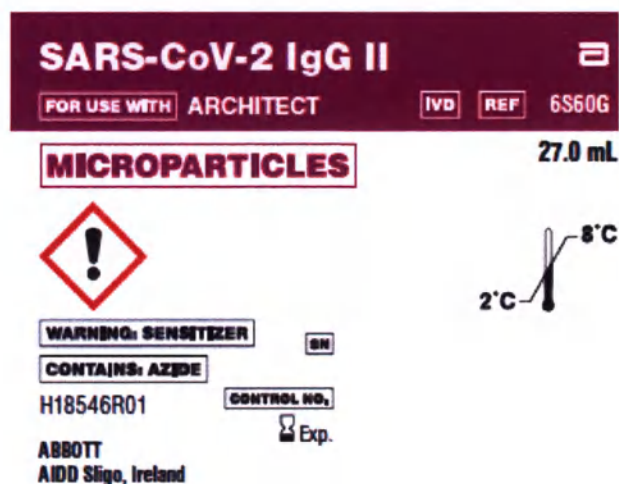

- Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate)

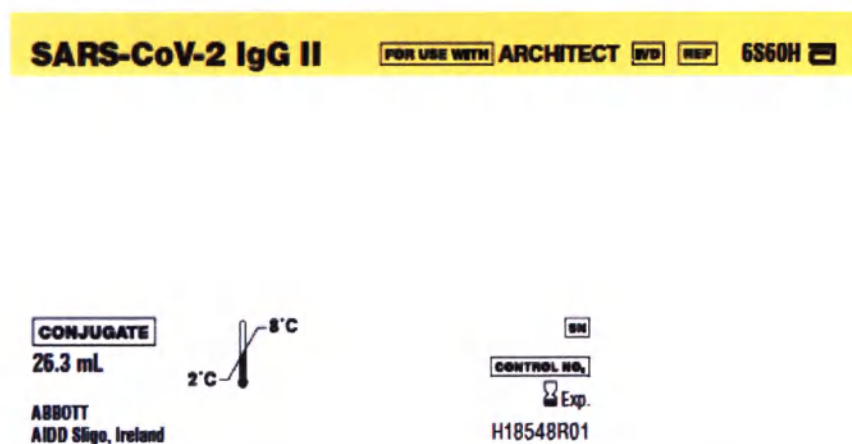

- Дилуэнт теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent)

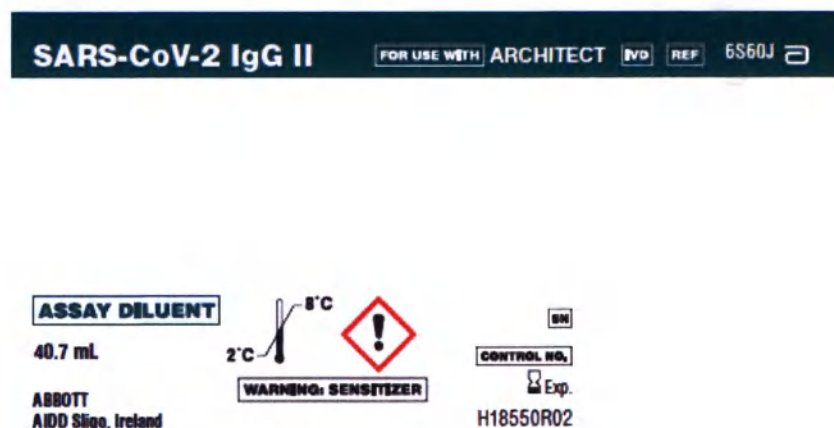

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

____ листов

Подпись _____

