



ООО «СМТраст»

**125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16
корпус 3, помещение 305, комната 1.
Тел. (499) 250-26-21
Эл. почта: smtrust@yandex.ru**

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ.

**Аппарат для гистологической проводки тканей (гистопроцессор
автоматический) Donatello Series 2 с принадлежностями.**

Макет стикера транспортной упаковки с маркировкой на русском языке:

Аппарат для гистологической проводки тканей (гистопроцессор автоматический) Donatello Series 2		DIAPATH	
№ РУ*****/*****		SN *****	
 ***** УПП В РФ: ООО «СМТраст» Юр. адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16 корпус 3, помещение 305, комната 1. Тел. (499) 250-26-21 Эл. почта: smtrust@yandex.ru Сайт: www.smtrust.ru		 Diapath S.p.A. Via Savoldini, n.71, 24057 Martinengo (BG) Италия, Tel.: (+39) 0363.986.411, Fax: (+39) 0363.948.000, Web: www.diapath.com , E-mail: info@diapath.com	
МАССА НЕТТО МАССА БРУТТО		СДЕЛАНО В ИТАЛИИ	

Генеральный директор
ООО «СМТраст»




Попова Л.Р.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов.

Генеральный директор
ООО «СМТраст»

Л.Р. Попова

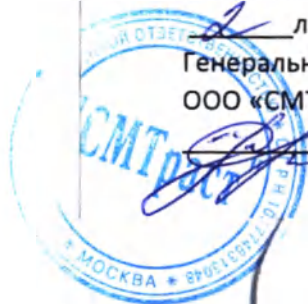



ООО «СМТраст»

125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16
корпус 3, помещение 305, комната 1.
Тел. (499) 250-26-21
Эл. почта: smtrust@yandex.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

**Аппарат для гистологической проводки тканей (гистопроцессор
автоматический) Donatello Series 2**

2022г



Рис.1. Изображение медицинского изделия в транспортной упаковке.

Рис.2.

Фотографическое
изображение общего
вида медицинского
изделия:

Гистопроектор
автоматический
Donatello Series 2





Рис.3. Фотографическое изображение общего вида Устройства автоматического набора номера (115-230В).



Рис.4. Фотографическое изображение общего вида Кабеля питания с разъемом Schuko, форм-фактор: EURO.

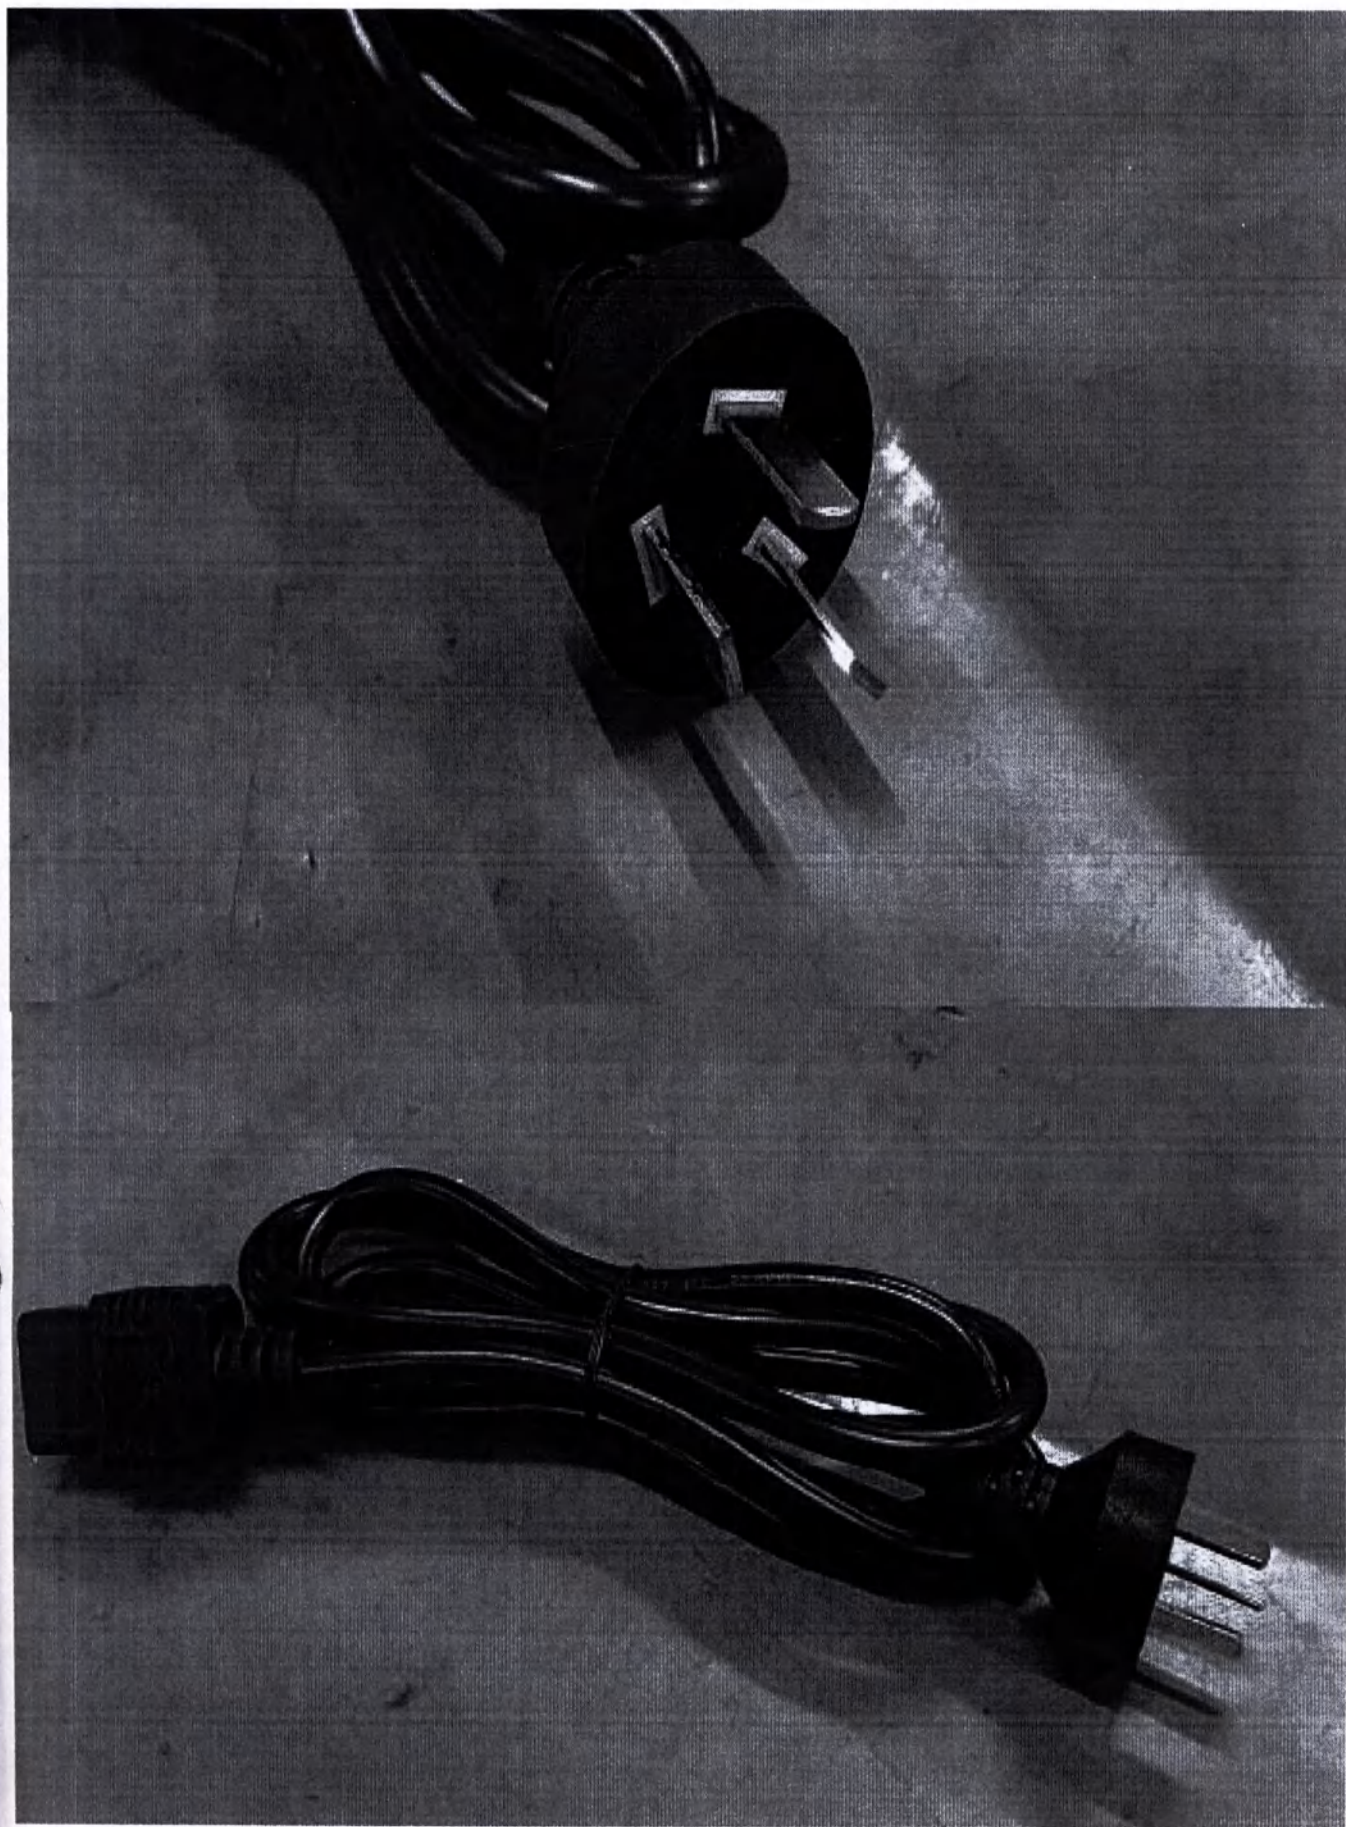


Рис.5. Фотографическое изображение общего вида Кабеля питания с разъемом Schuko, форм-фактор: CN.



Рис.6. Фотографическое изображение общего вида Кабеля питания с разъемом Schuko, форм-фактор: UL.

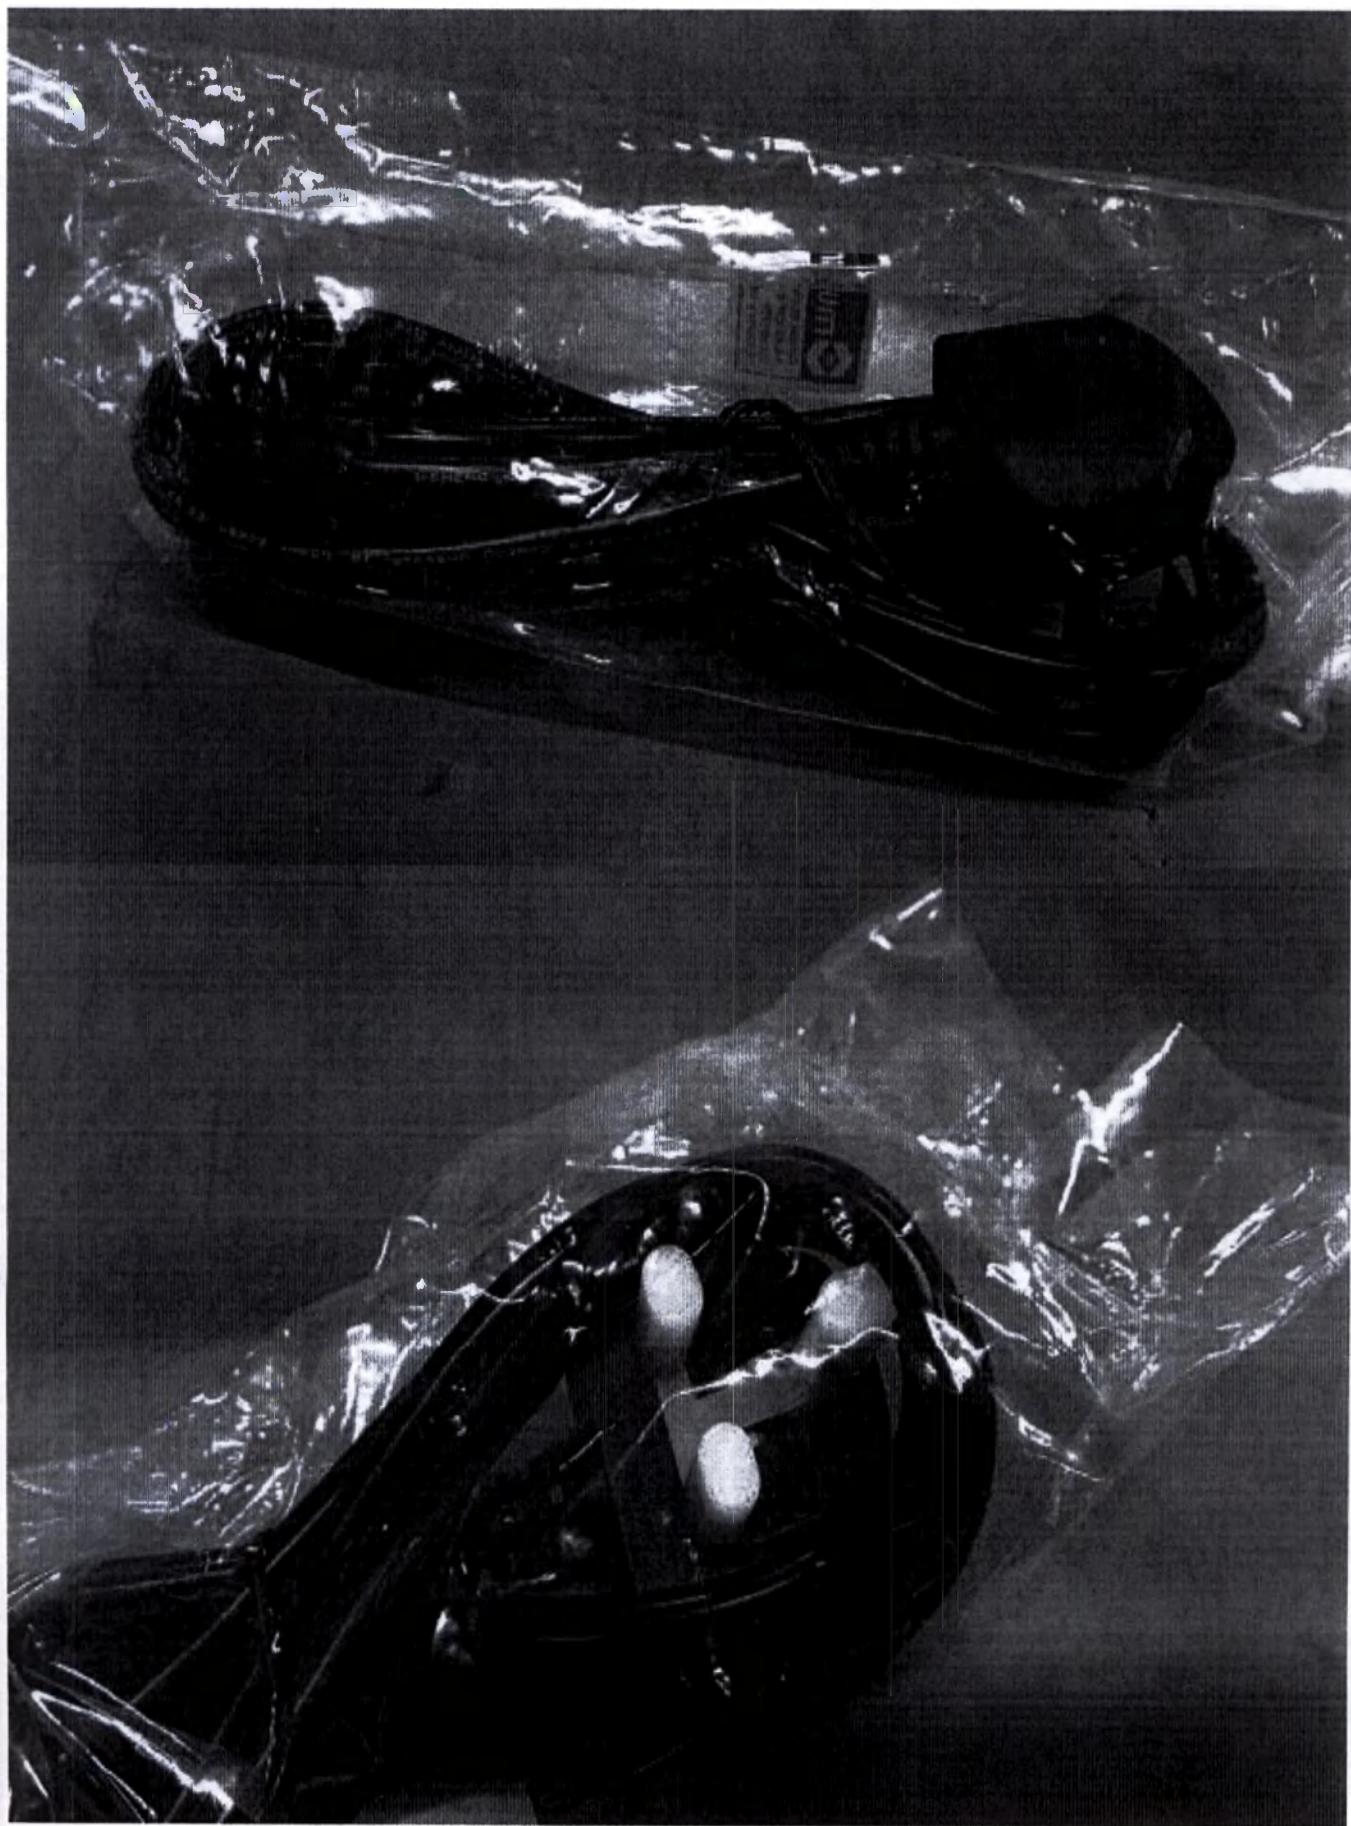


Рис.7. Фотографическое изображение общего вида Кабеля питания с разъемом Schuko, форм-фактор: UK.

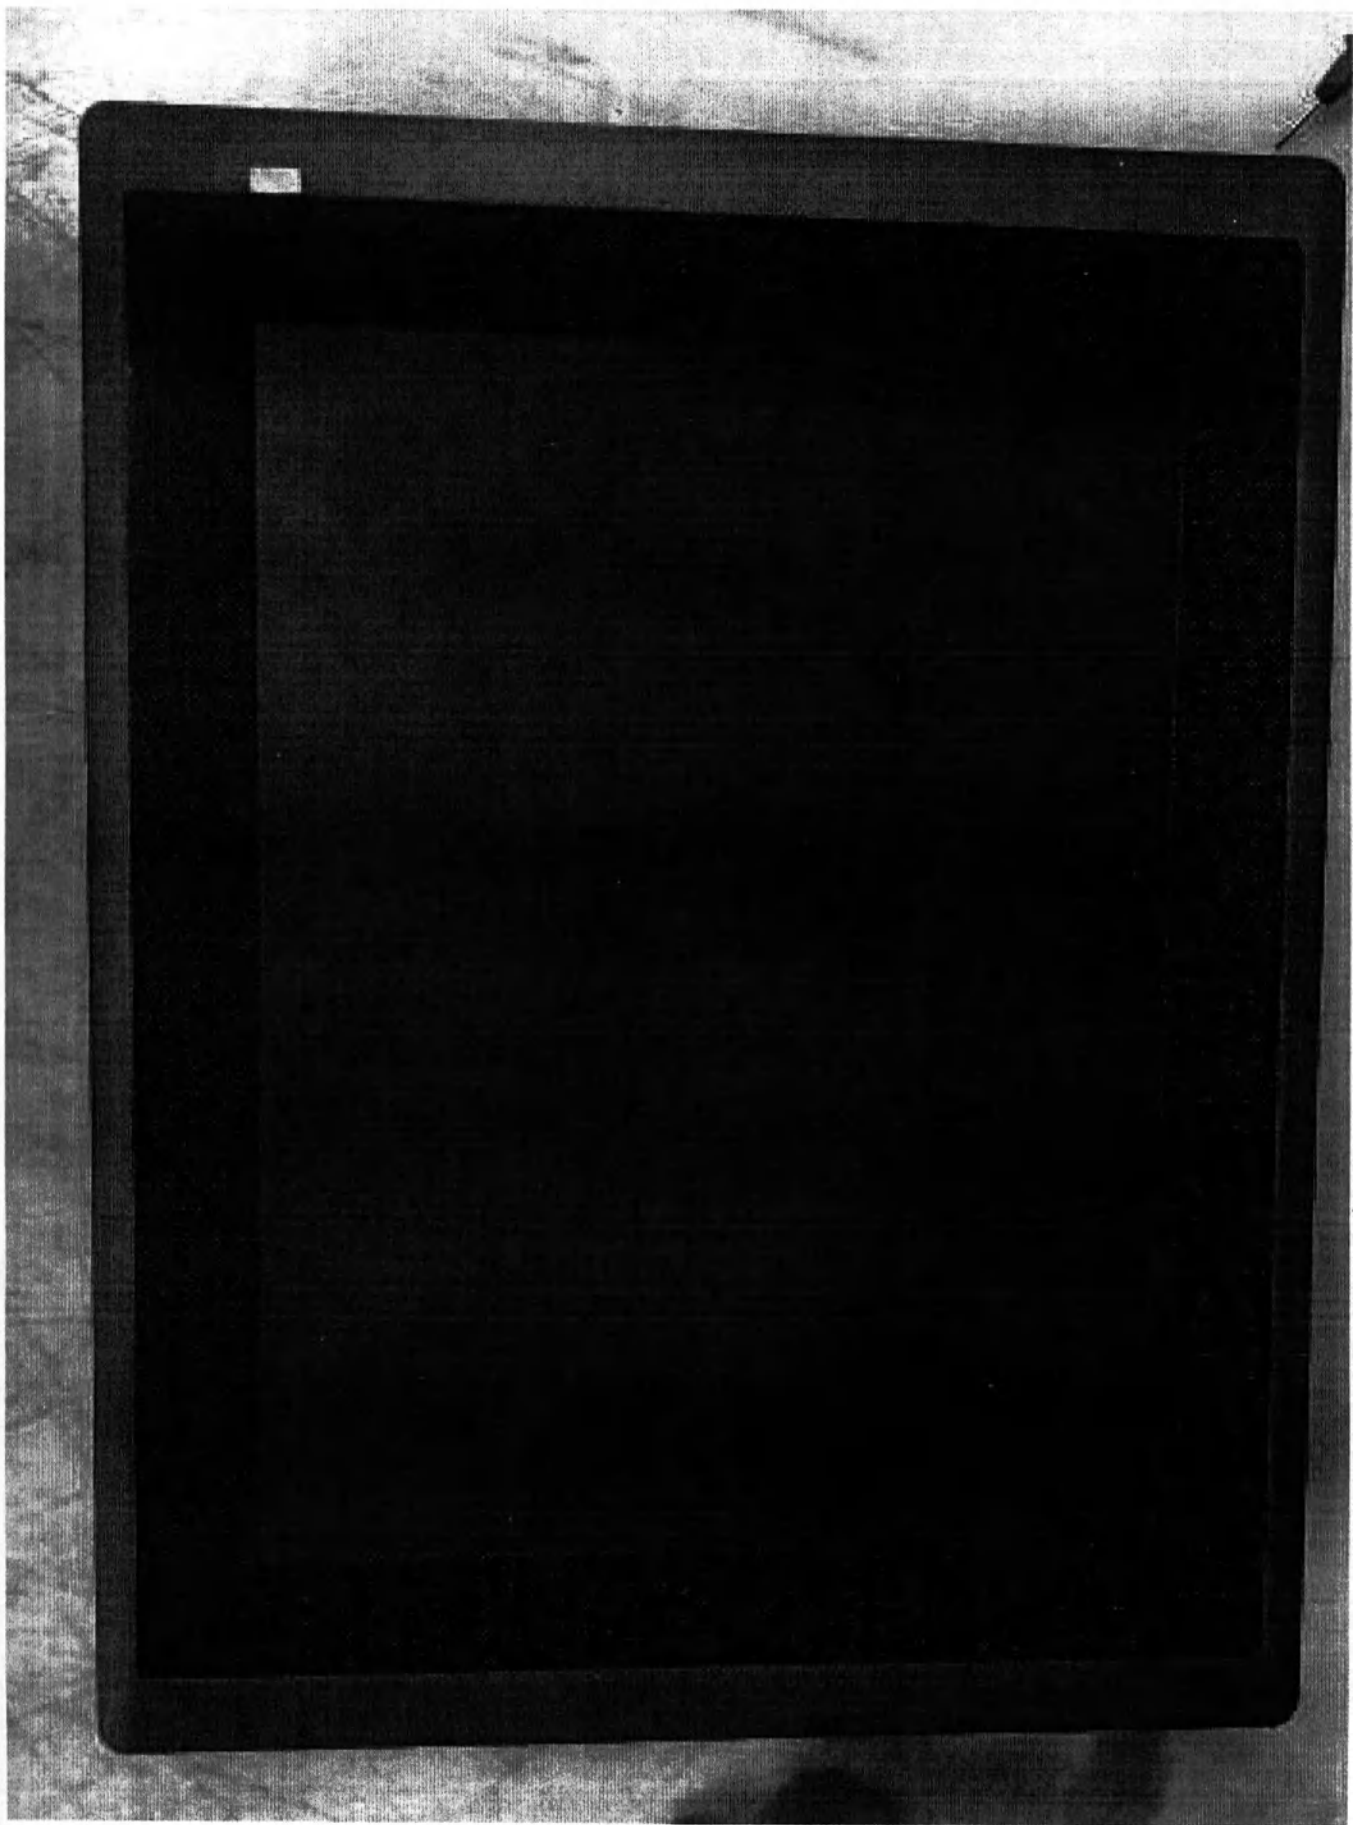


Рис.8. Фотографическое изображение общего вида Сенсорного ЖК монитора.

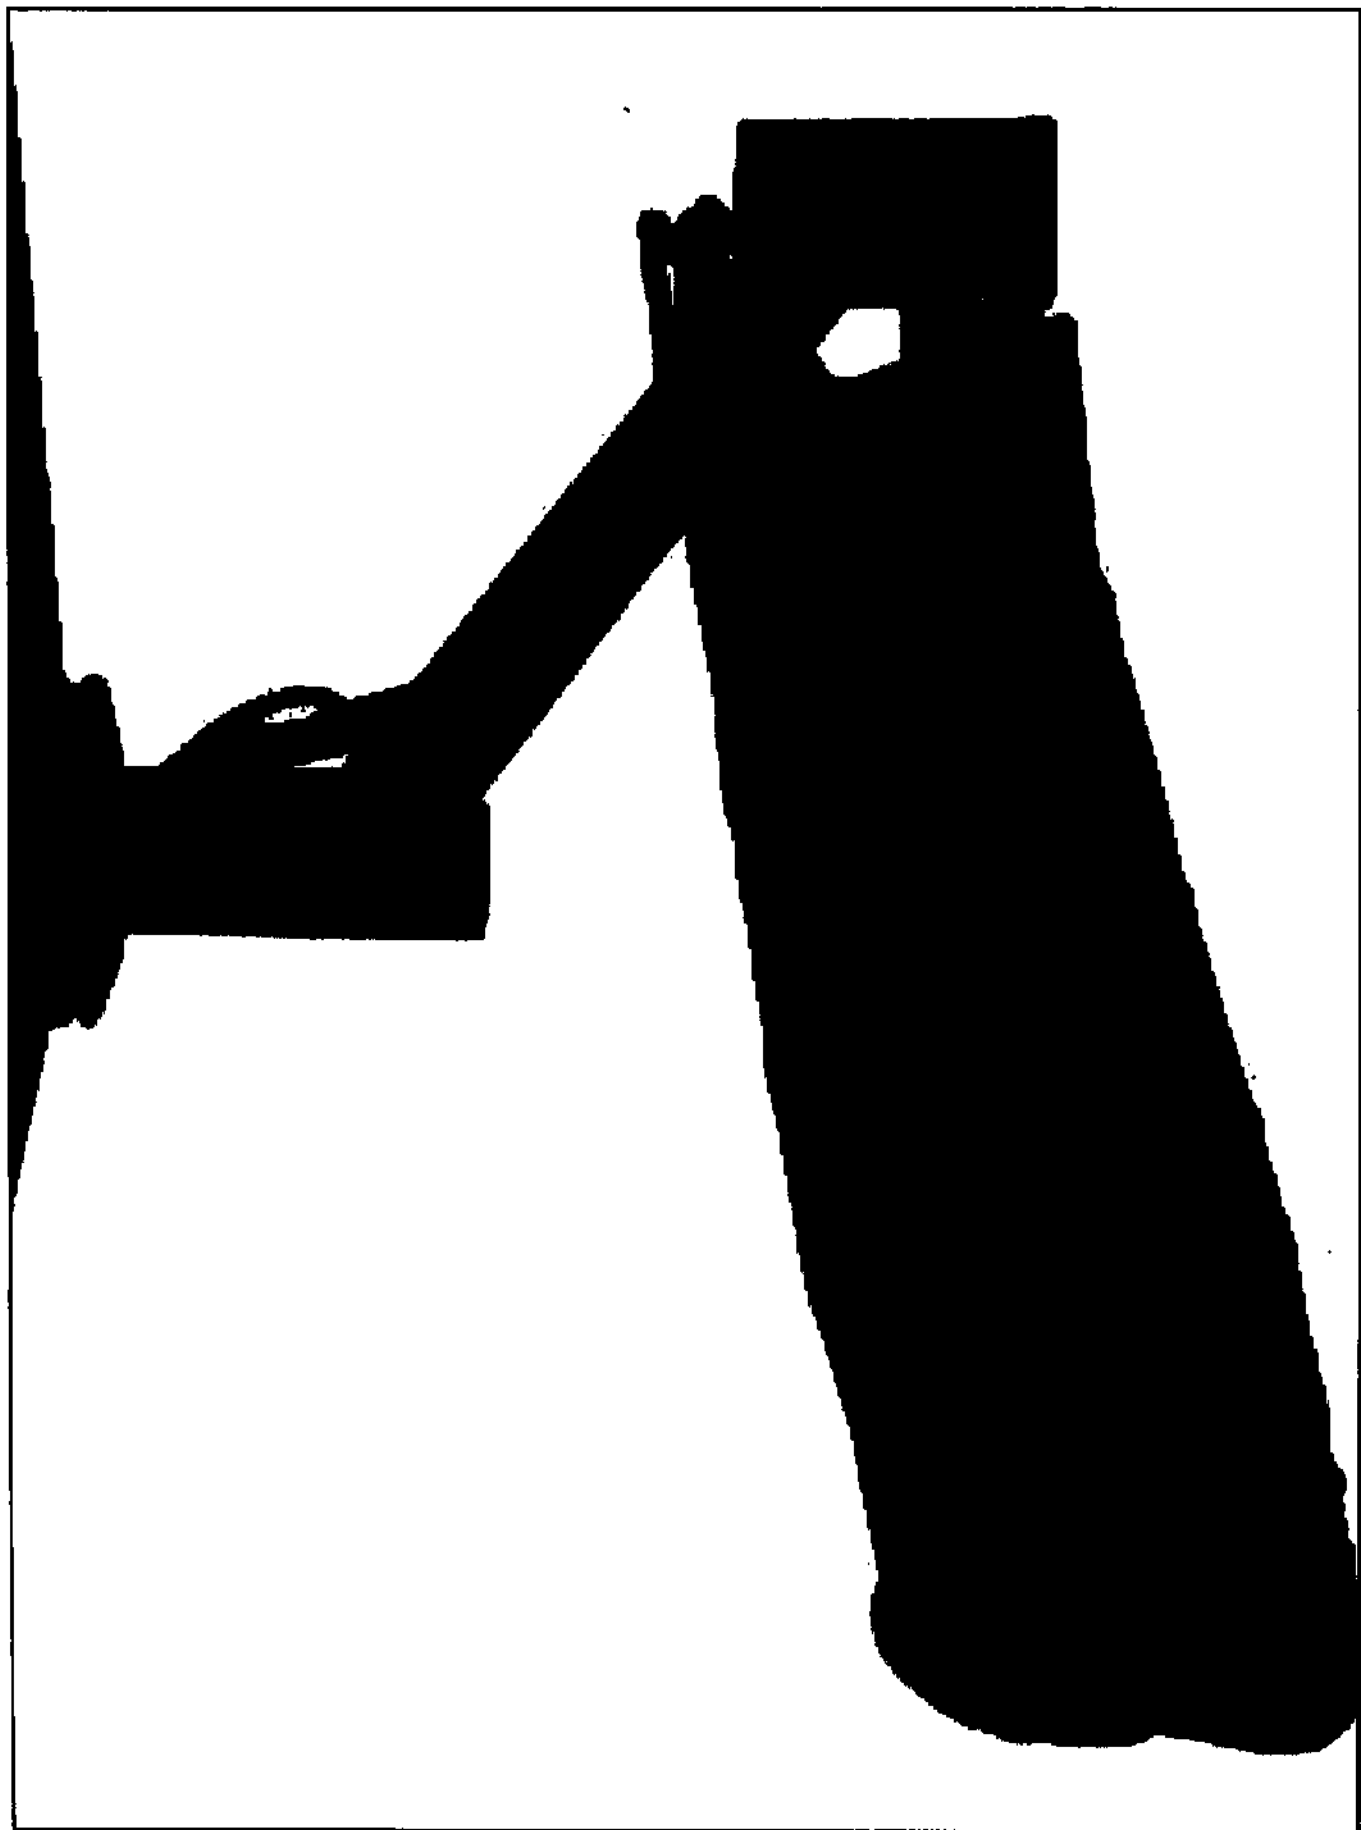


Рис.9. Фотографическое изображение кронштейна для крепления Сенсорного ЖК монитора.

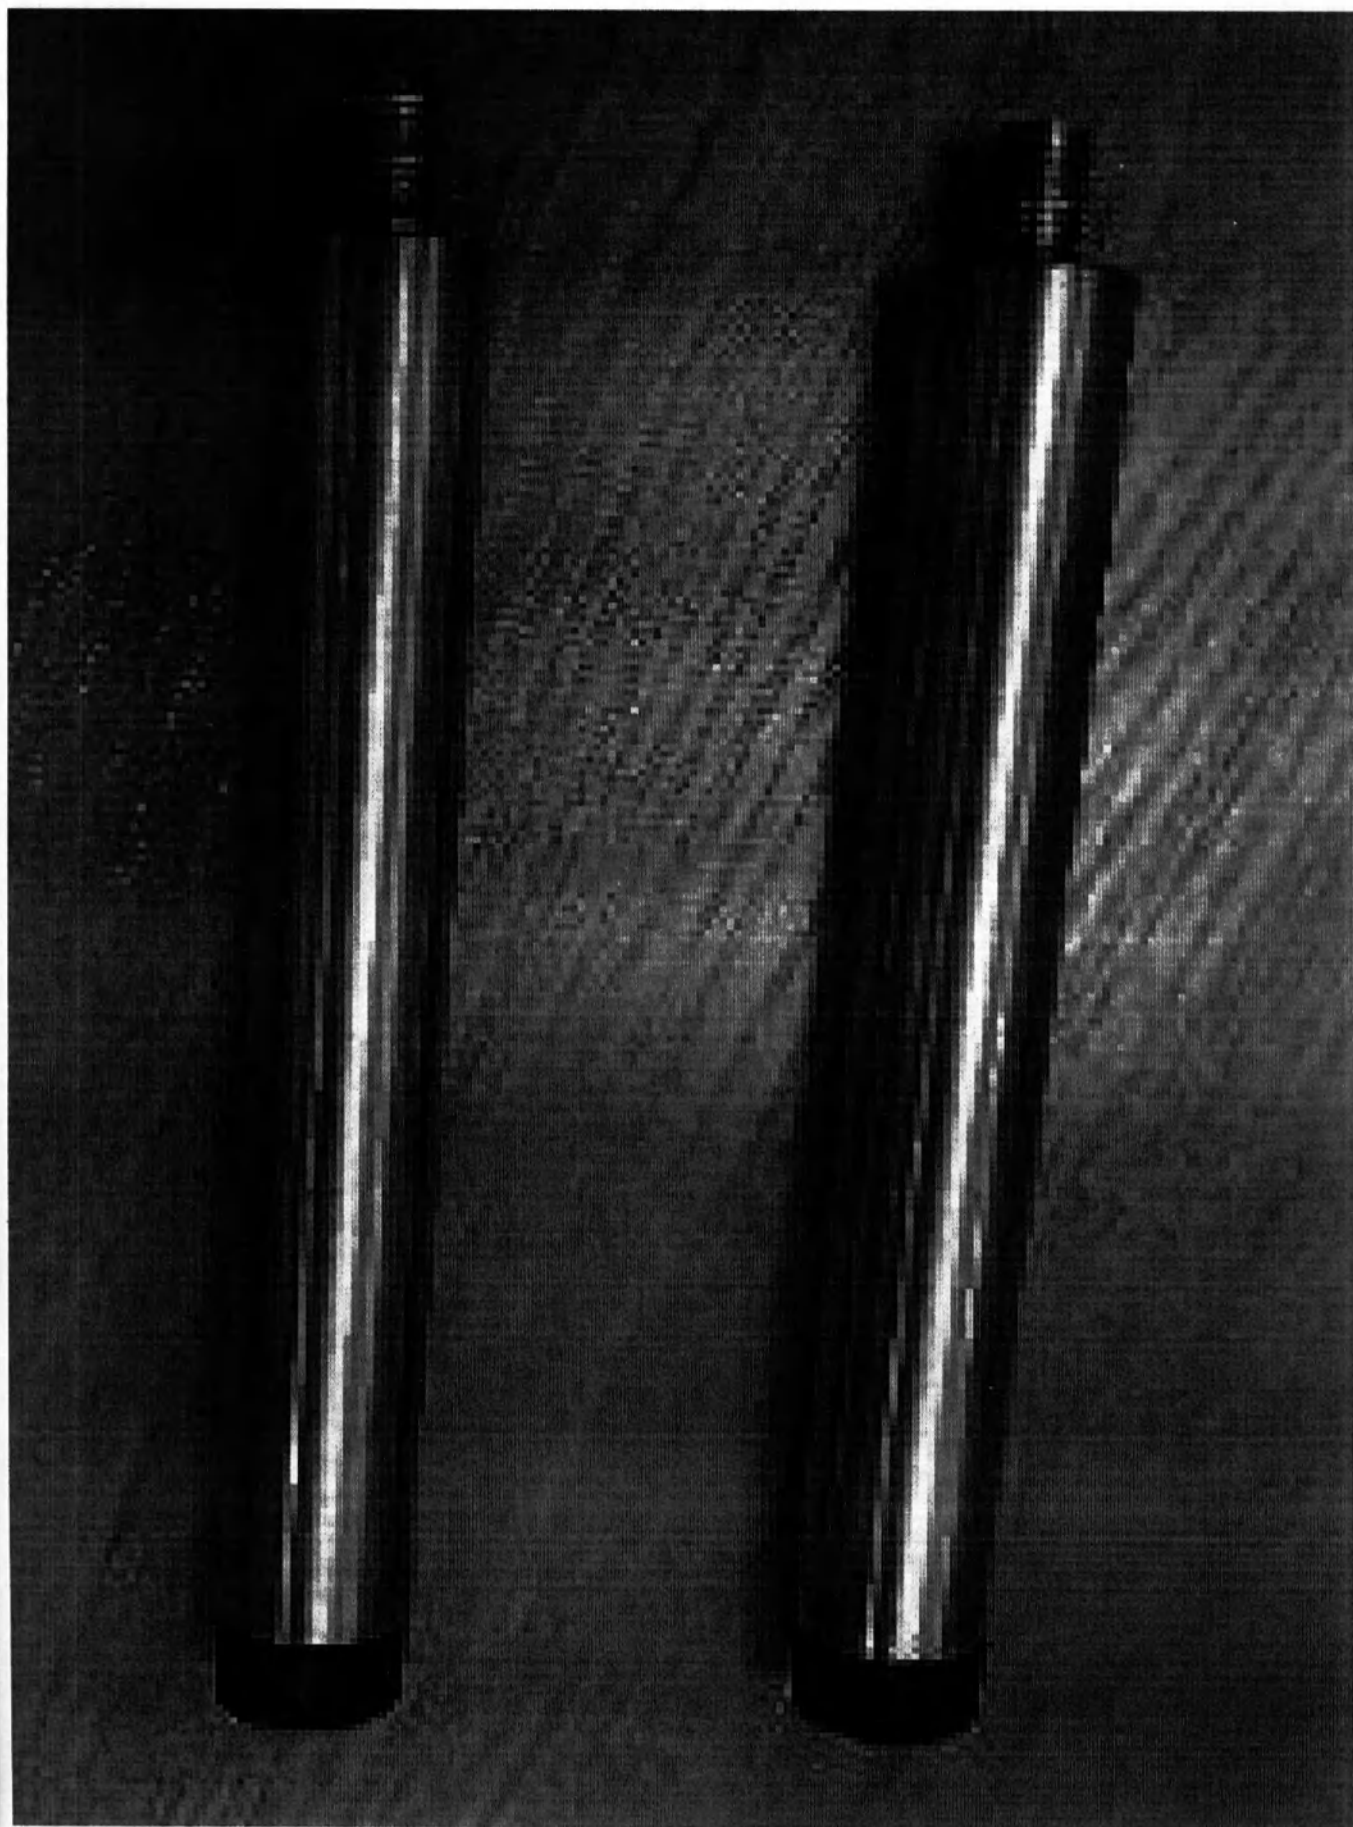


Рис.10. Фотографическое изображение Ограничителя расстояния (от инструмента до стены).

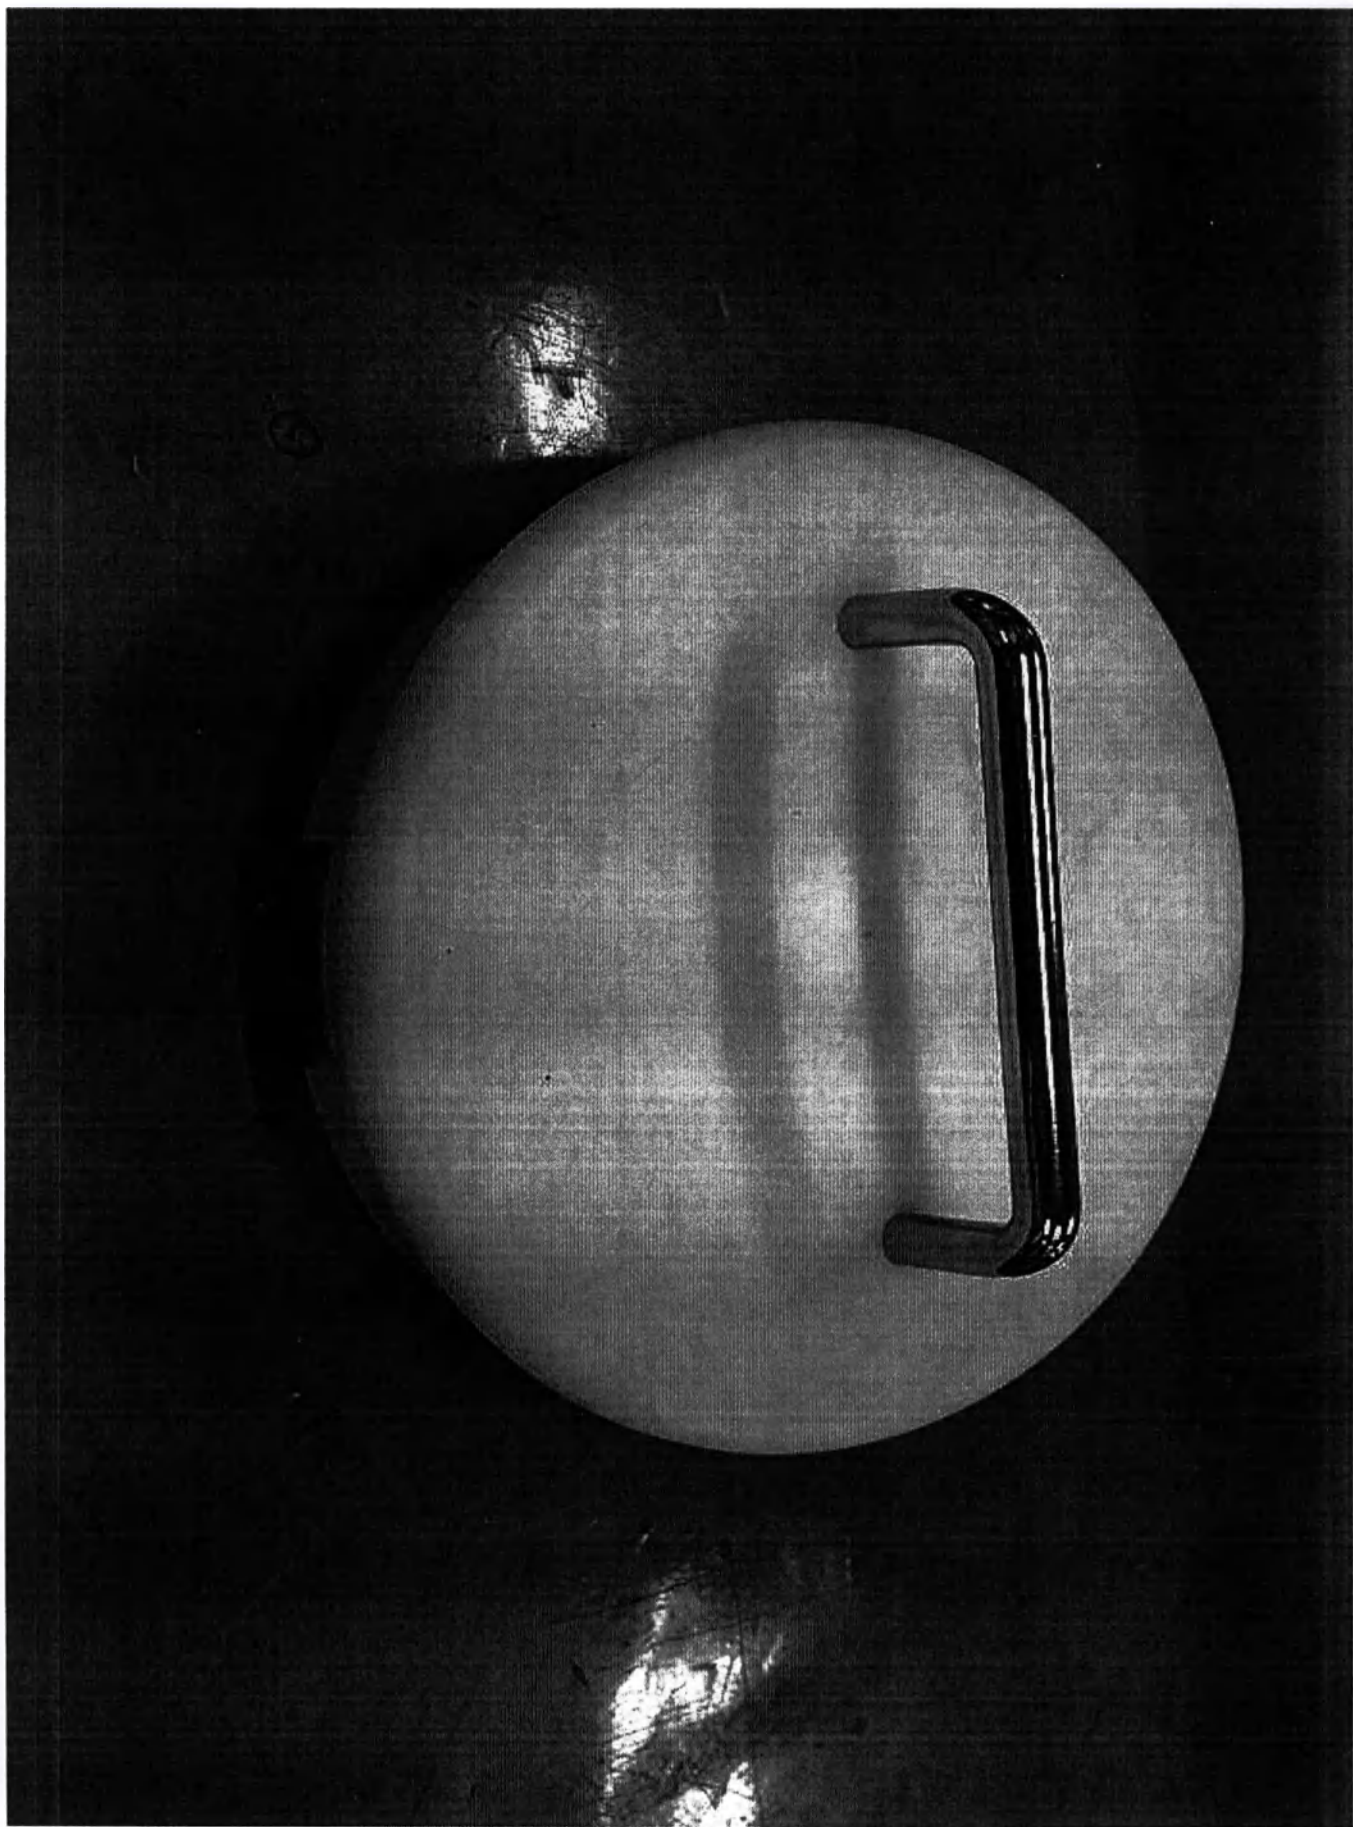


Рис.11. Фотографическое изображение общего вида Крышки к резервуару для парафина.

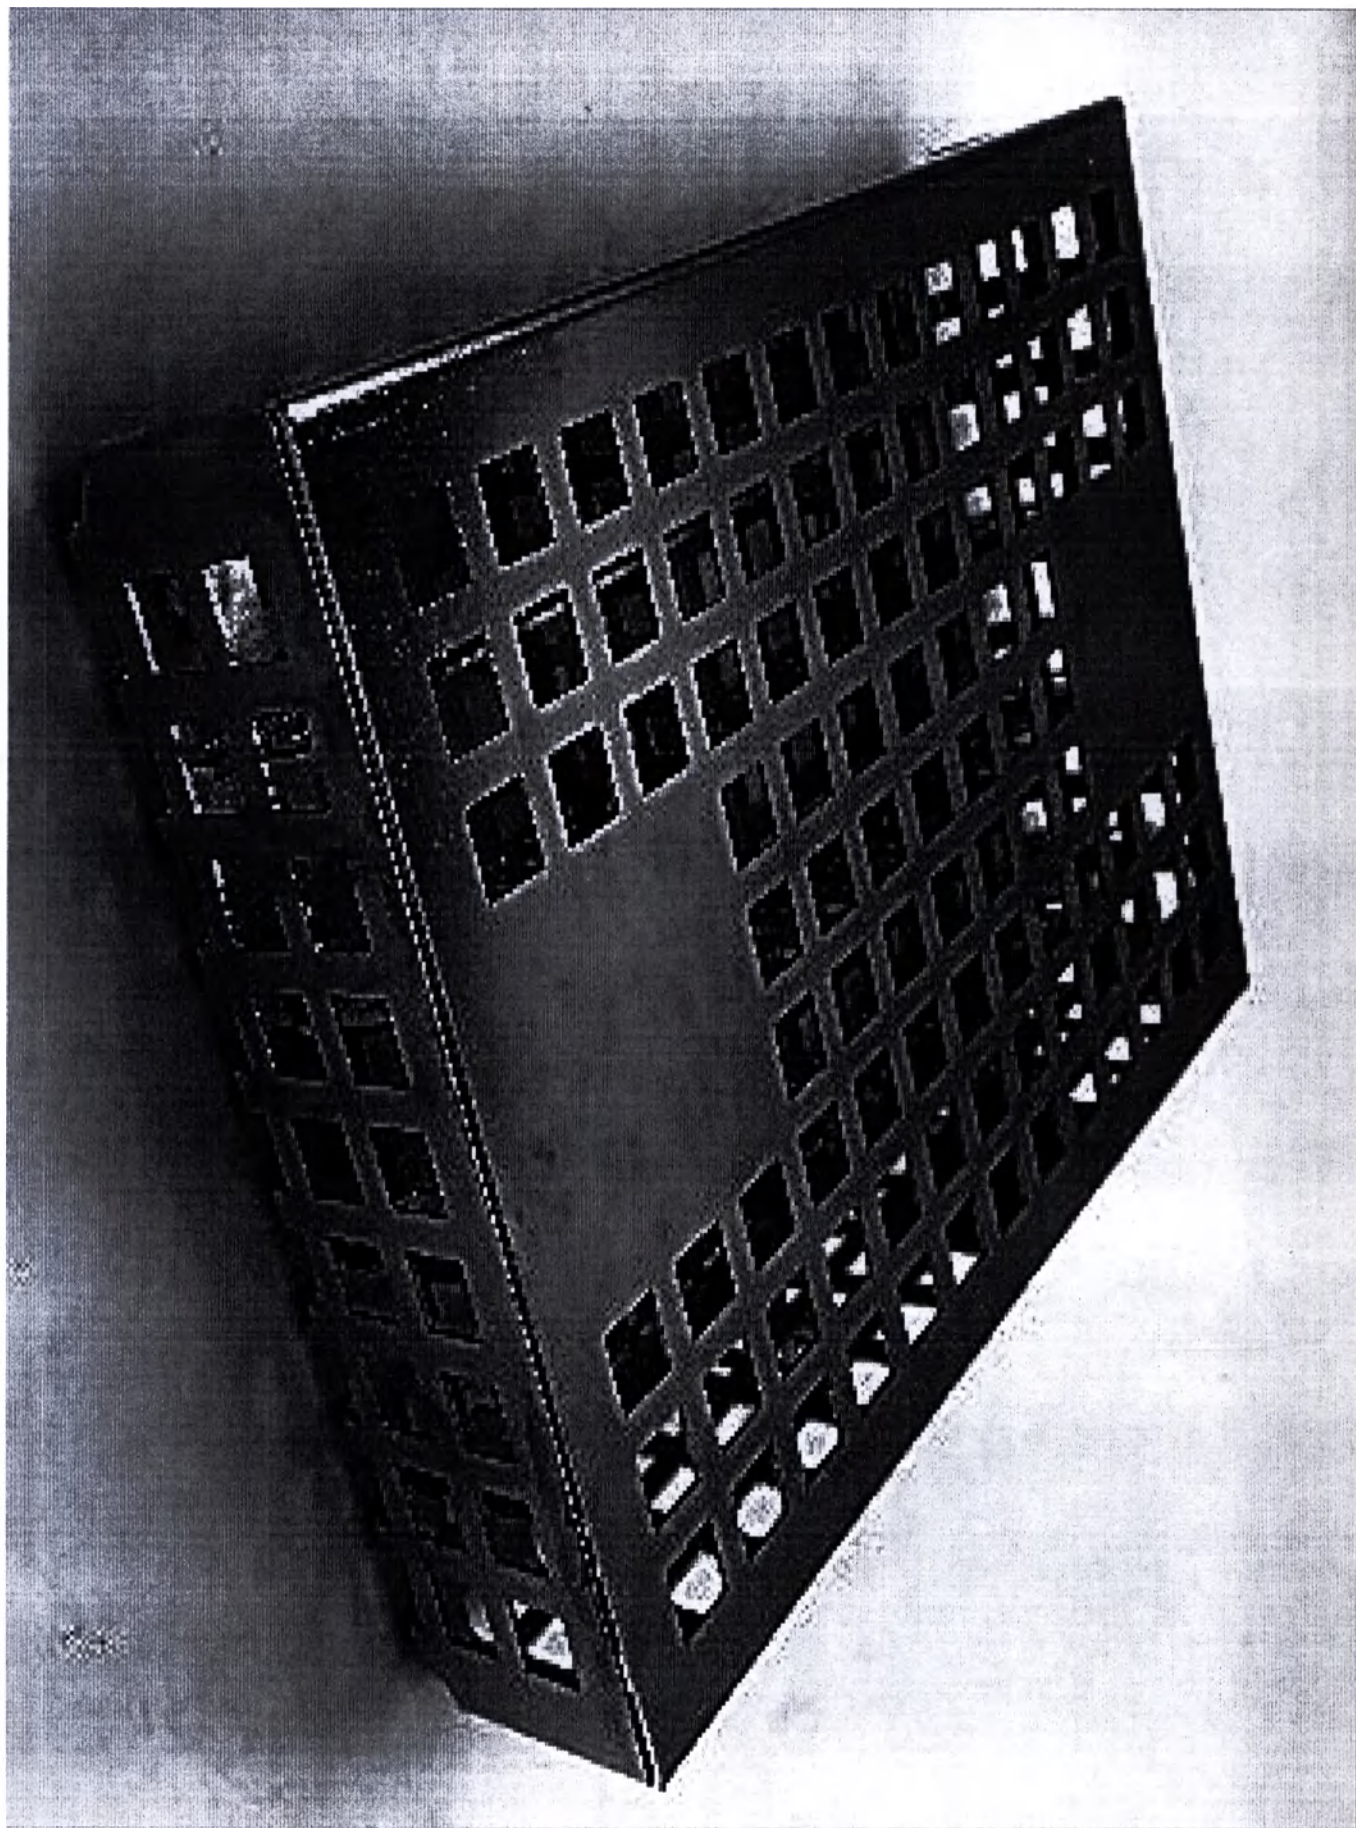


Рис.12. Фотографическое изображение общего вида Корзины на 135 кассет

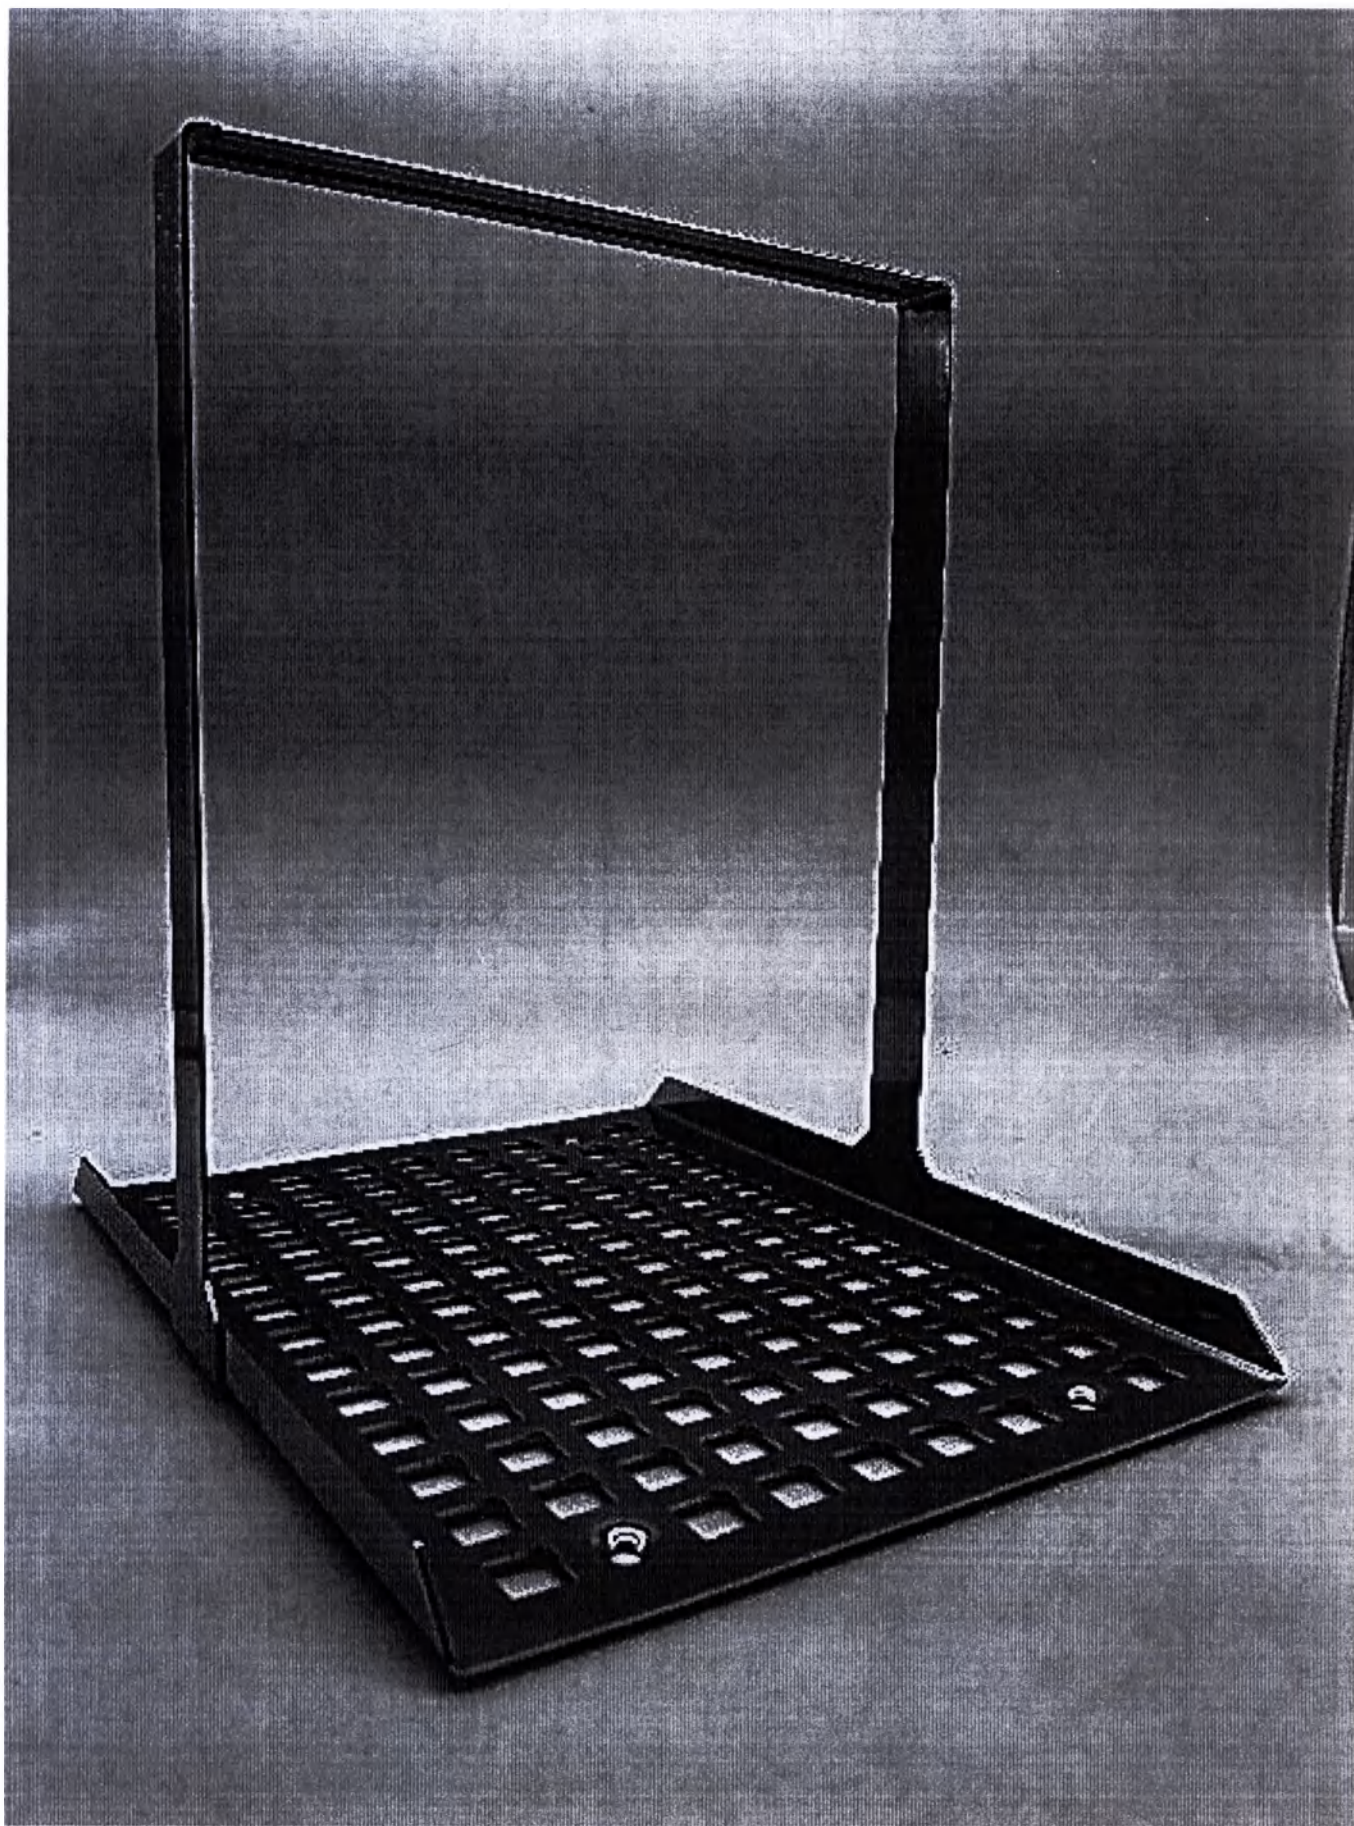


Рис.13. Фотографическое изображение общего вида Ручки для корзины на 135 кассет.

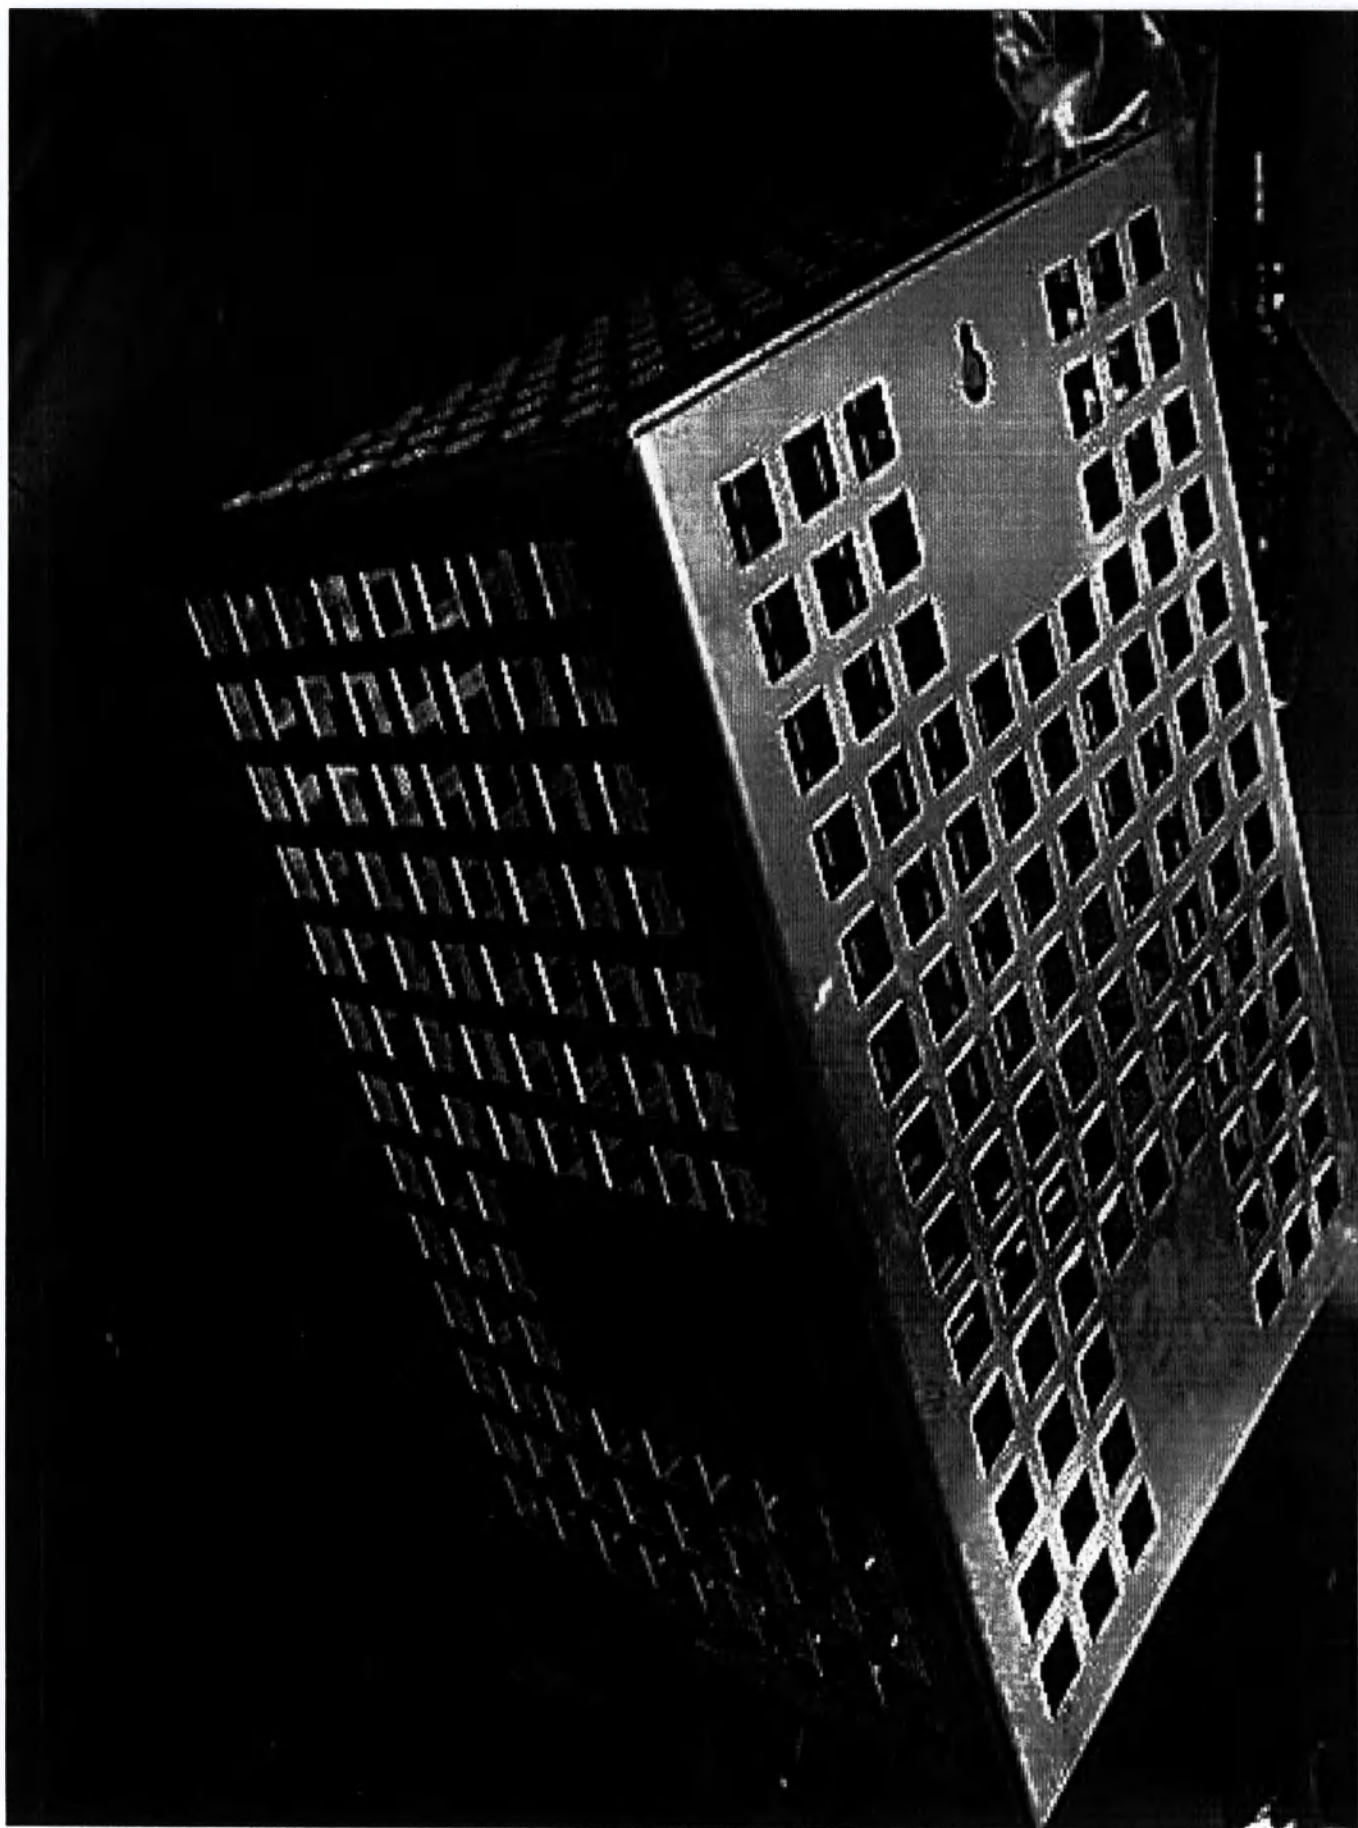


Рис.14. Фотографическое изображение общего вида Корзины для мега кассет.

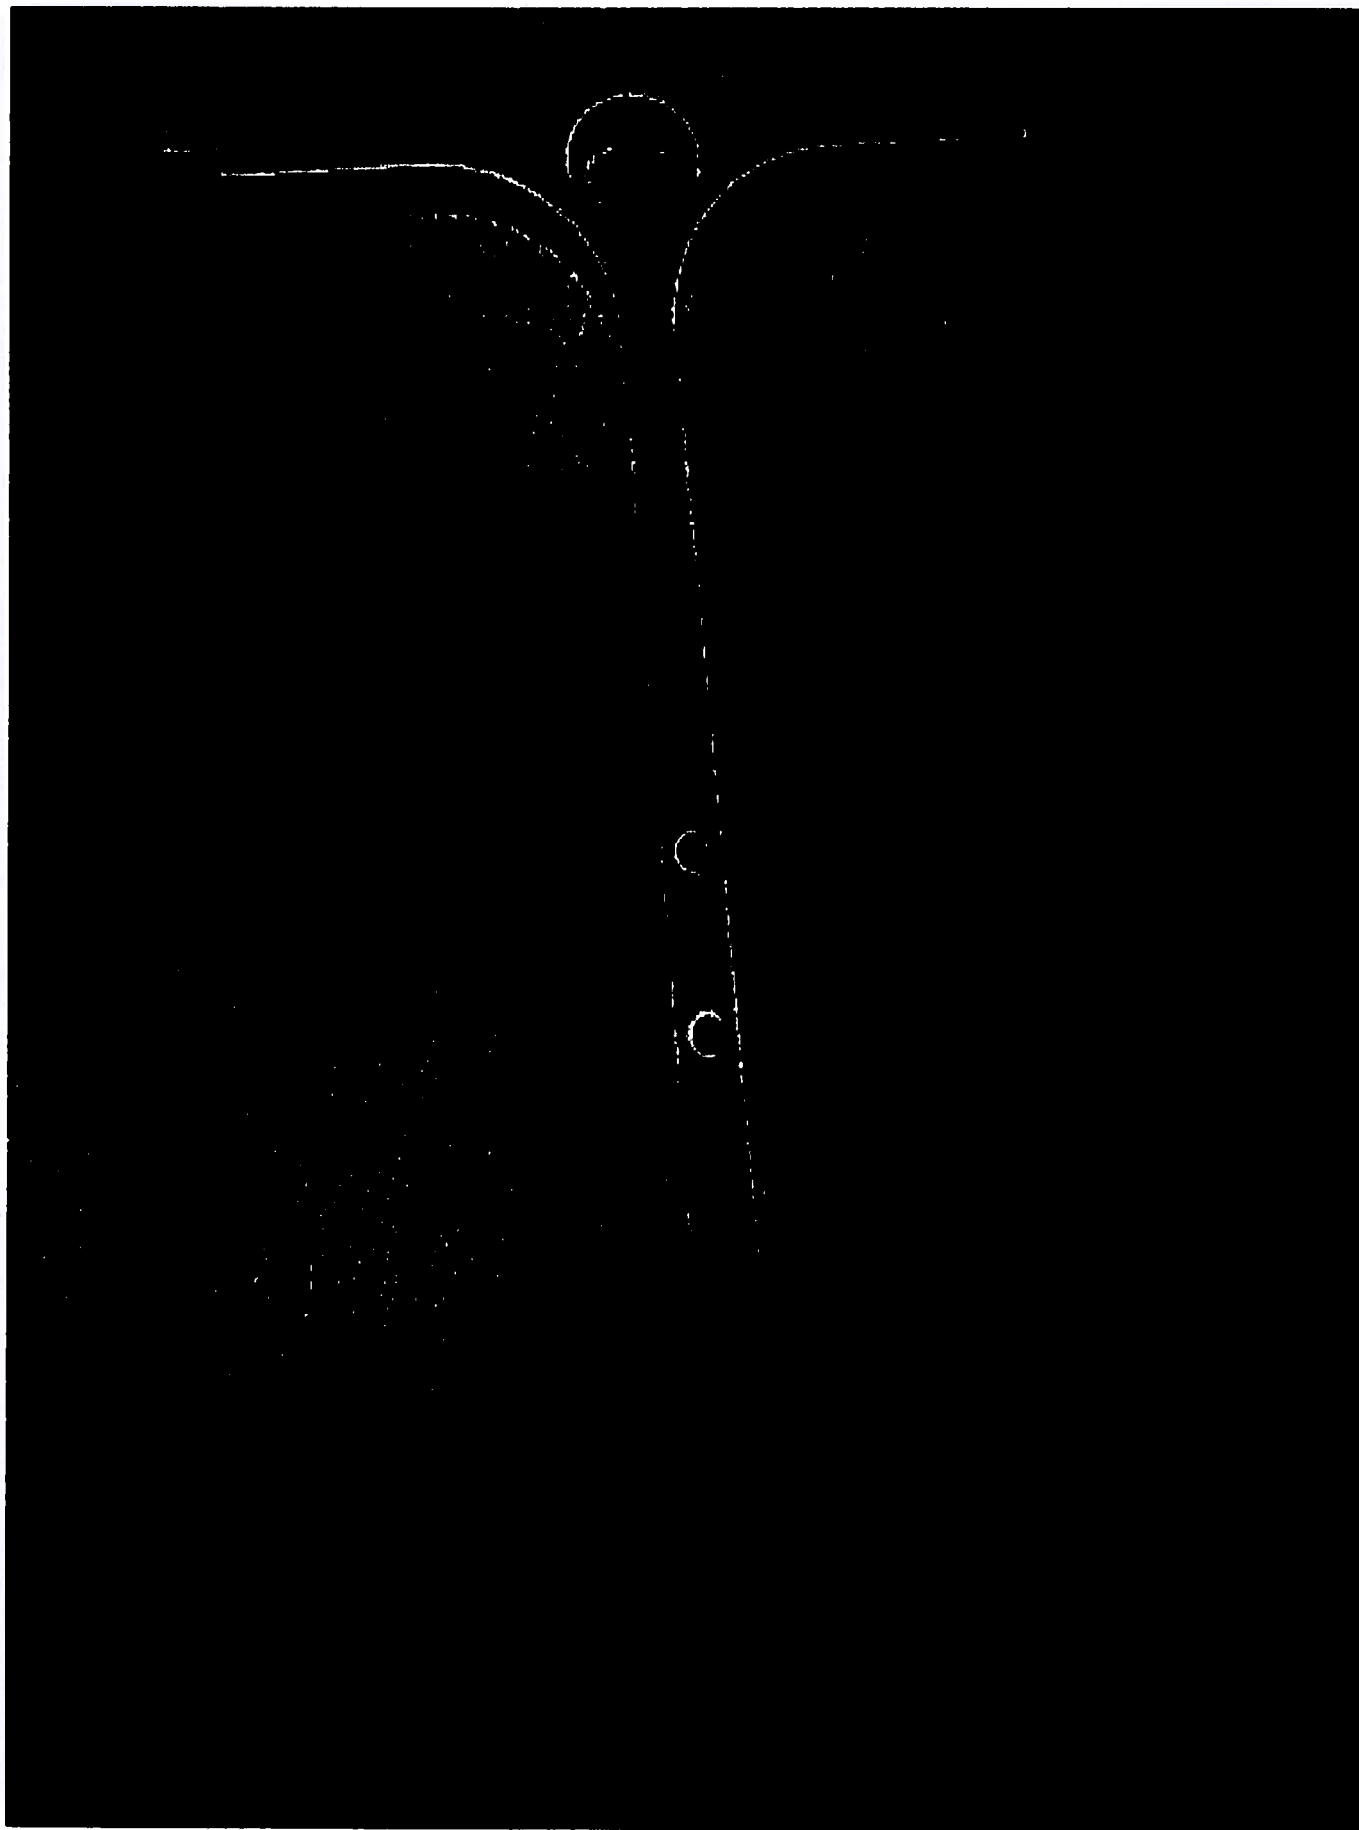


Рис.15. Фотографическое изображение общего вида Измерителя уровня парафина.



Рис.16. Фотографическое изображение общего вида Лотка для корзин.



Рис.17. Фотографическое изображение общего вида Ключа универсального для открытия крышек емкостей для реагентов.



Рис.18. Фотографическое изображение общего вида фильтра для фильтрации паров формалина и растворов.

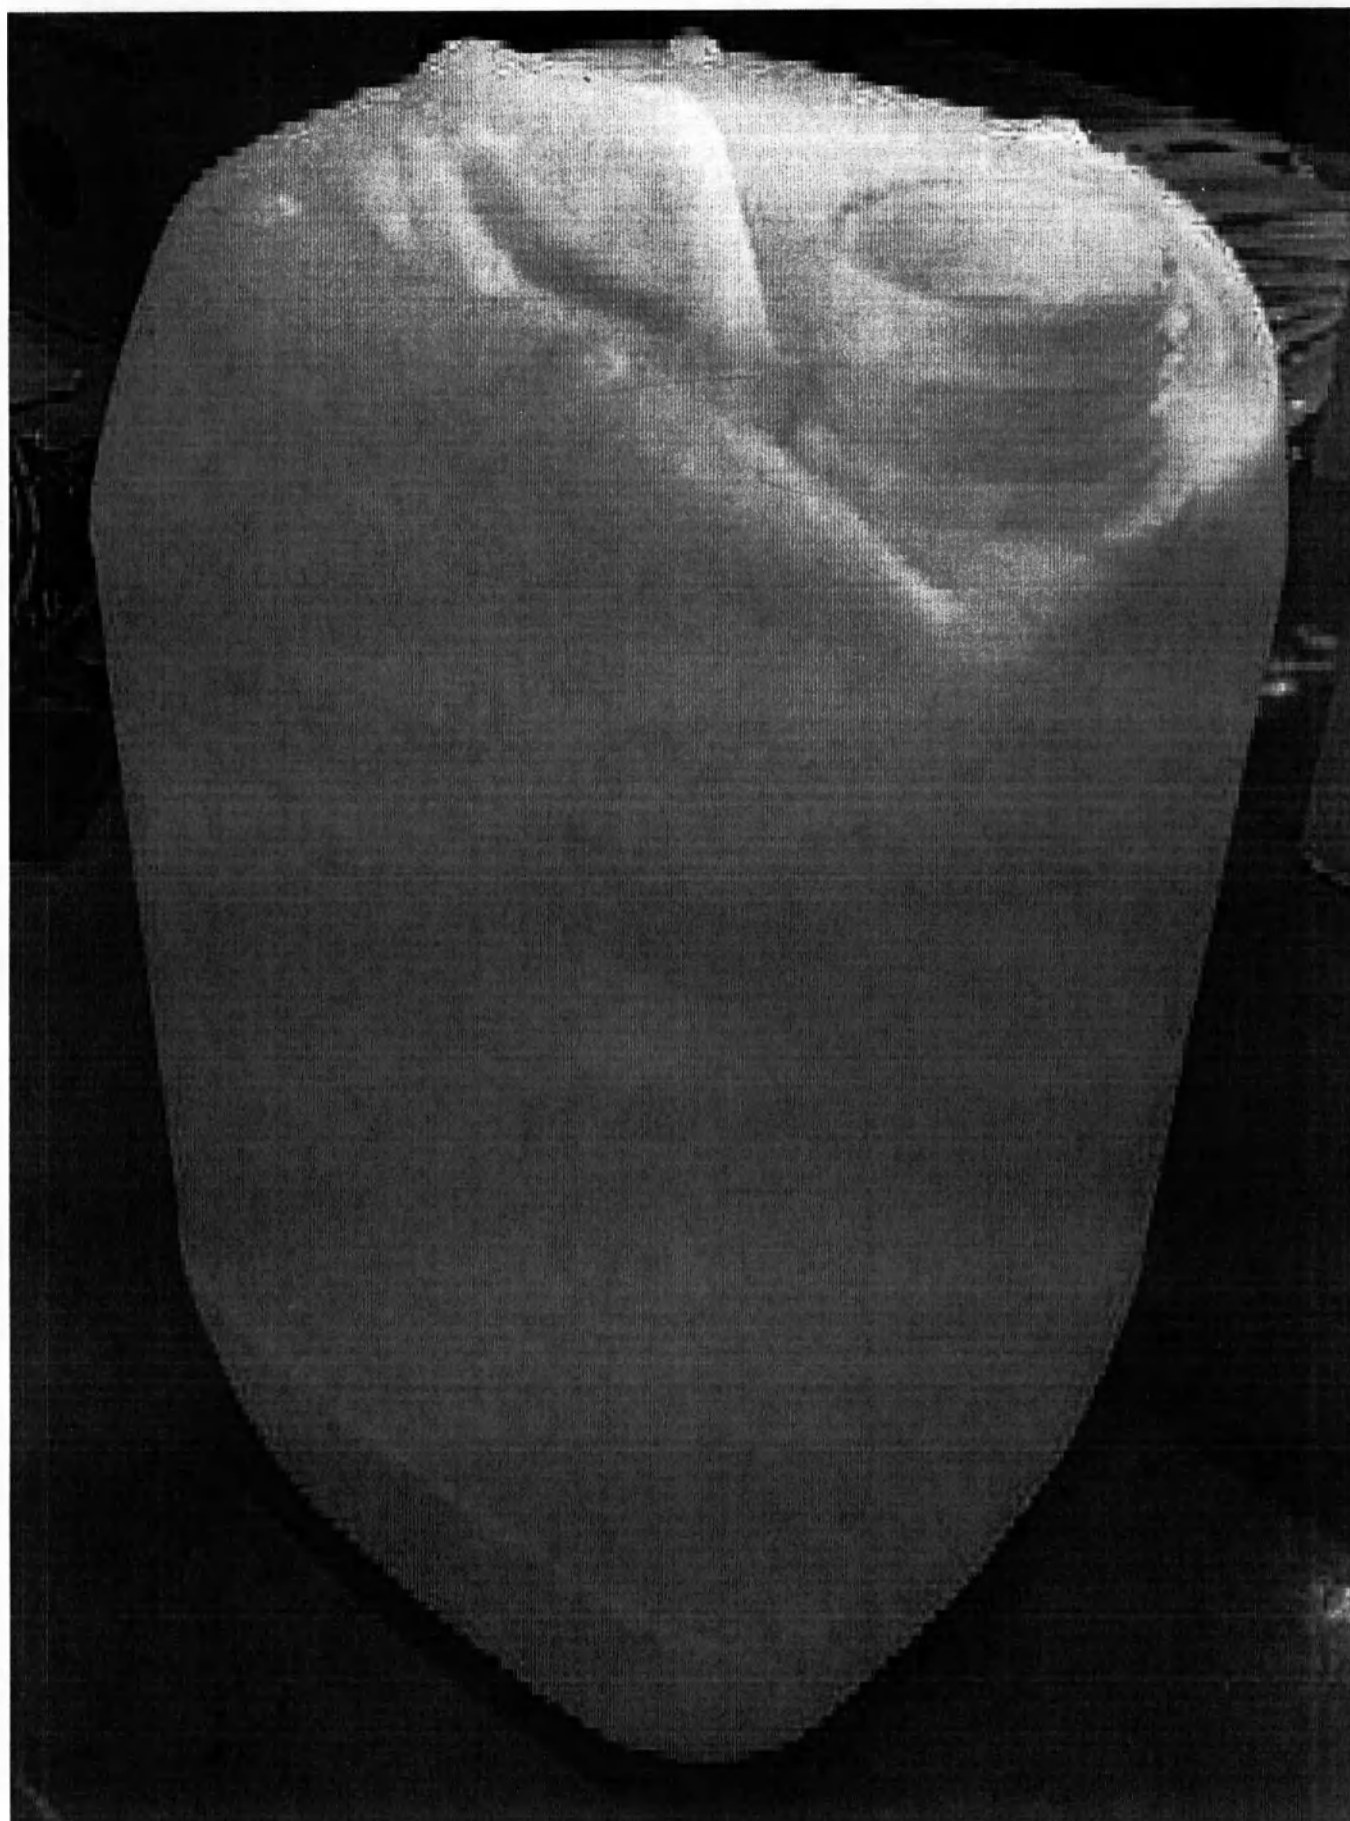


Рис.19. Фотографическое изображение общего вида Емкости для реагентов, объемом 5л.



Рис.20. Фотографическое изображение общего вида Трубки слива парафина.



Рис.21. Фотографическое изображение общего вида Трубки слива/наполнения реагентов.



Рис.22. Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинского изделия с наклеенным макетом маркировки.

Аппарат для гистологической проводки
тканей (гистопроеессор автоматический)
Donatello Series 2

DIA PATH

№ РУ

SN 28657



 10/2019

УПП В РФ: ООО «СМТраст»
Юр. адрес: 125047, г. Москва, ул.
4-я Тверская-Ямская, дом 16
корпус 3, помещение 305, комната
1.
Тел. (499) 250-26-21
Эл. почта: smtrust@yandex.ru
Сайт: www.smtrust.ru



Diapath S.p.A.
Via Savoldini, n.71,
24057 Martinengo (BG)
Италия.
Tel.: (+39) 0363.986.411,
Fax: (+39) 0363.948.000,
Web: www.diapath.com,
E-mail: info@diapath.com



МАССА НЕТТО: 305 кг
МАССА БРУТТО: 328 кг

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Рис.23. Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинского изделия с наклеенным макетом маркировки.
Увеличенное изображение макета.

1.


Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

24 листов.

Генеральный директор

ООО «СМТраст»



Л.Р. Попова

