

Фотографические изображения общего вида
Набор контролей «Alinity m HBV CTRL Kit» для количественного определения ДНК вируса
гепатита В методом ПЦР в плазме и сыворотке крови человека
на анализаторе Alinity m

В состав наборов входят следующие компоненты:

Набор пробирок с отрицательным контролем




Набор пробирок с положительным контролем с низкой концентрацией



Набор пробирок с положительным контролем с высокой концентрацией



Набор контролей «Alinity m HBV CTRL Kit» для количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в плазме и сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m с компонентами

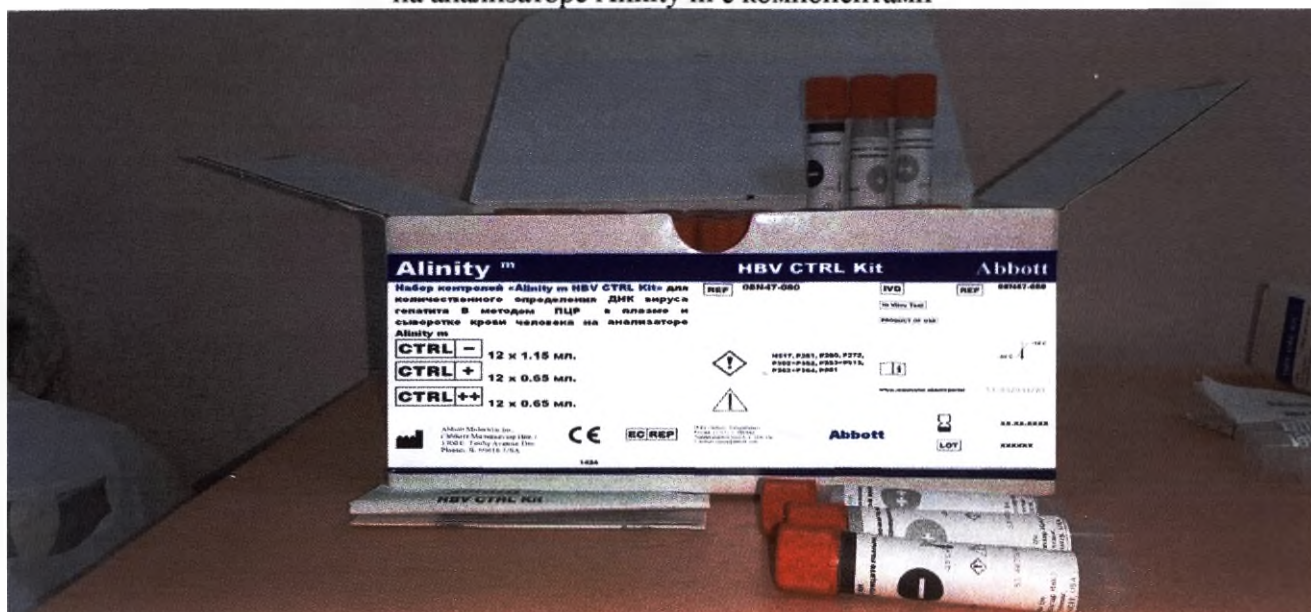

Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»

Е.Р. Коничева

Сшито и заверено печатью _____
(5) лист 24

Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбор»
Конишева Е.Р.

