

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»



24.12.2021

(Дата)

В.А. Яковлев

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

DIXION


Фотографические изображения медицинского изделия

Комплексы анестезиологические «Практис»
по ТУ 32.50.21-007-74487176-2021, варианты исполнения:
«Практис 3000», «Практис 3100»


**Основной блок аппарата ингаляционной анестезии на тележке с двумя выдвижными ящиками
(КФИП.944460.004)**




**Основной блок аппарата ингаляционной анестезии на тележке с двумя выдвижными ящиками
(КФИП.944460.004-01)**

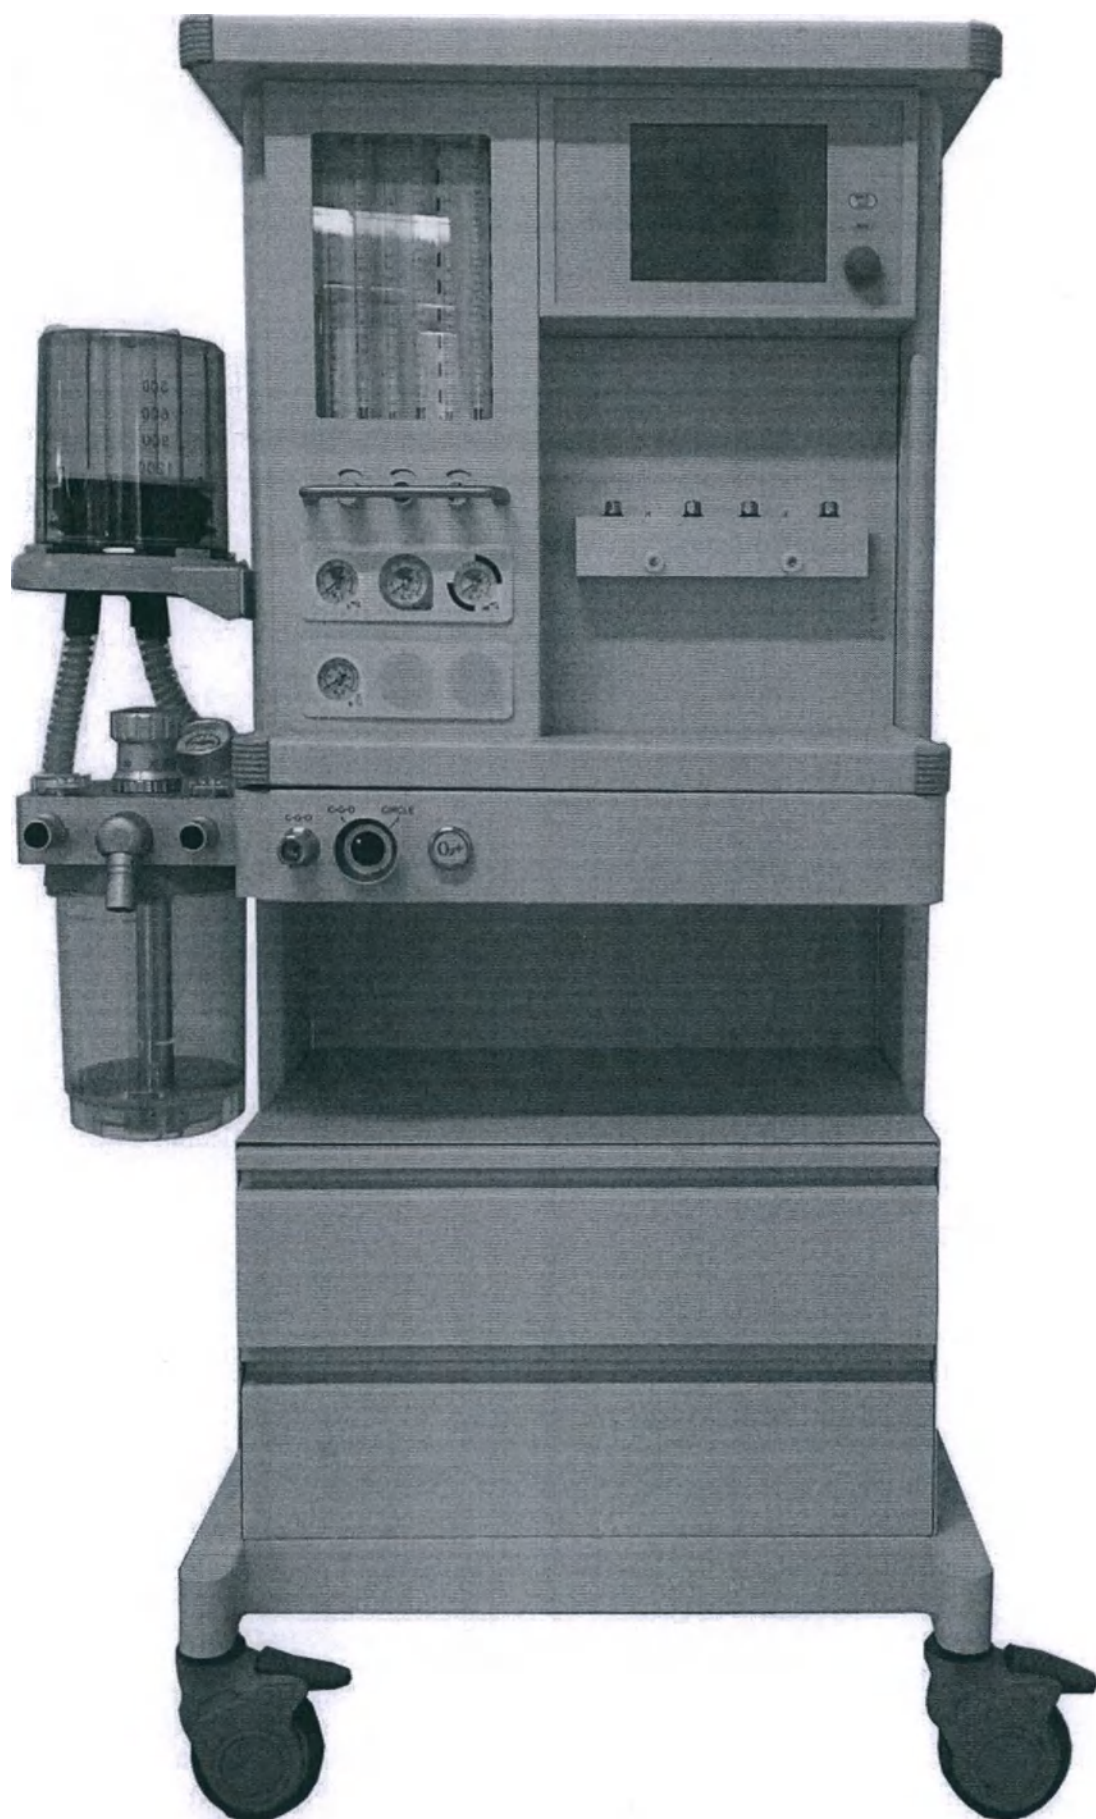


Кабель питания (КФИП.944460.004.001)

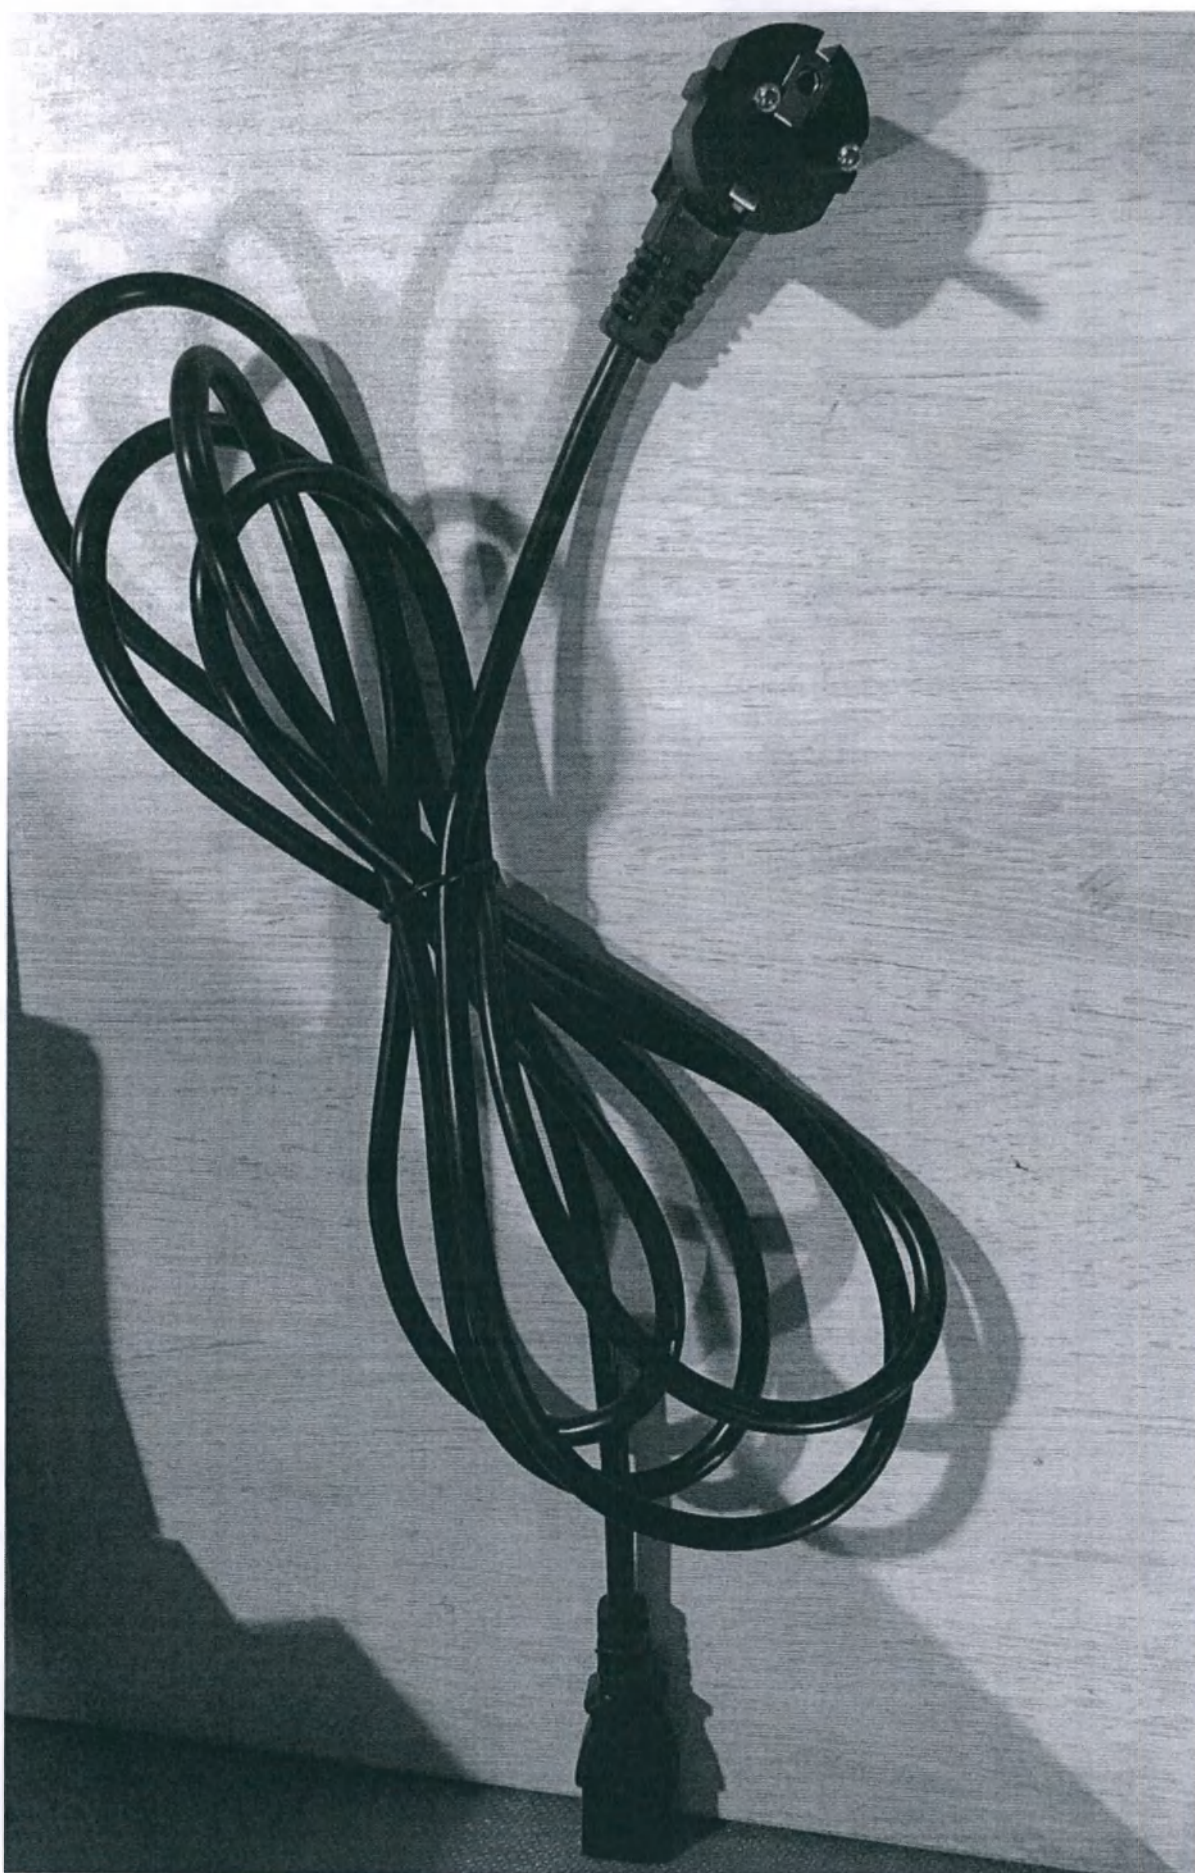

Кабель заземления (КФИП.944460.004.002)

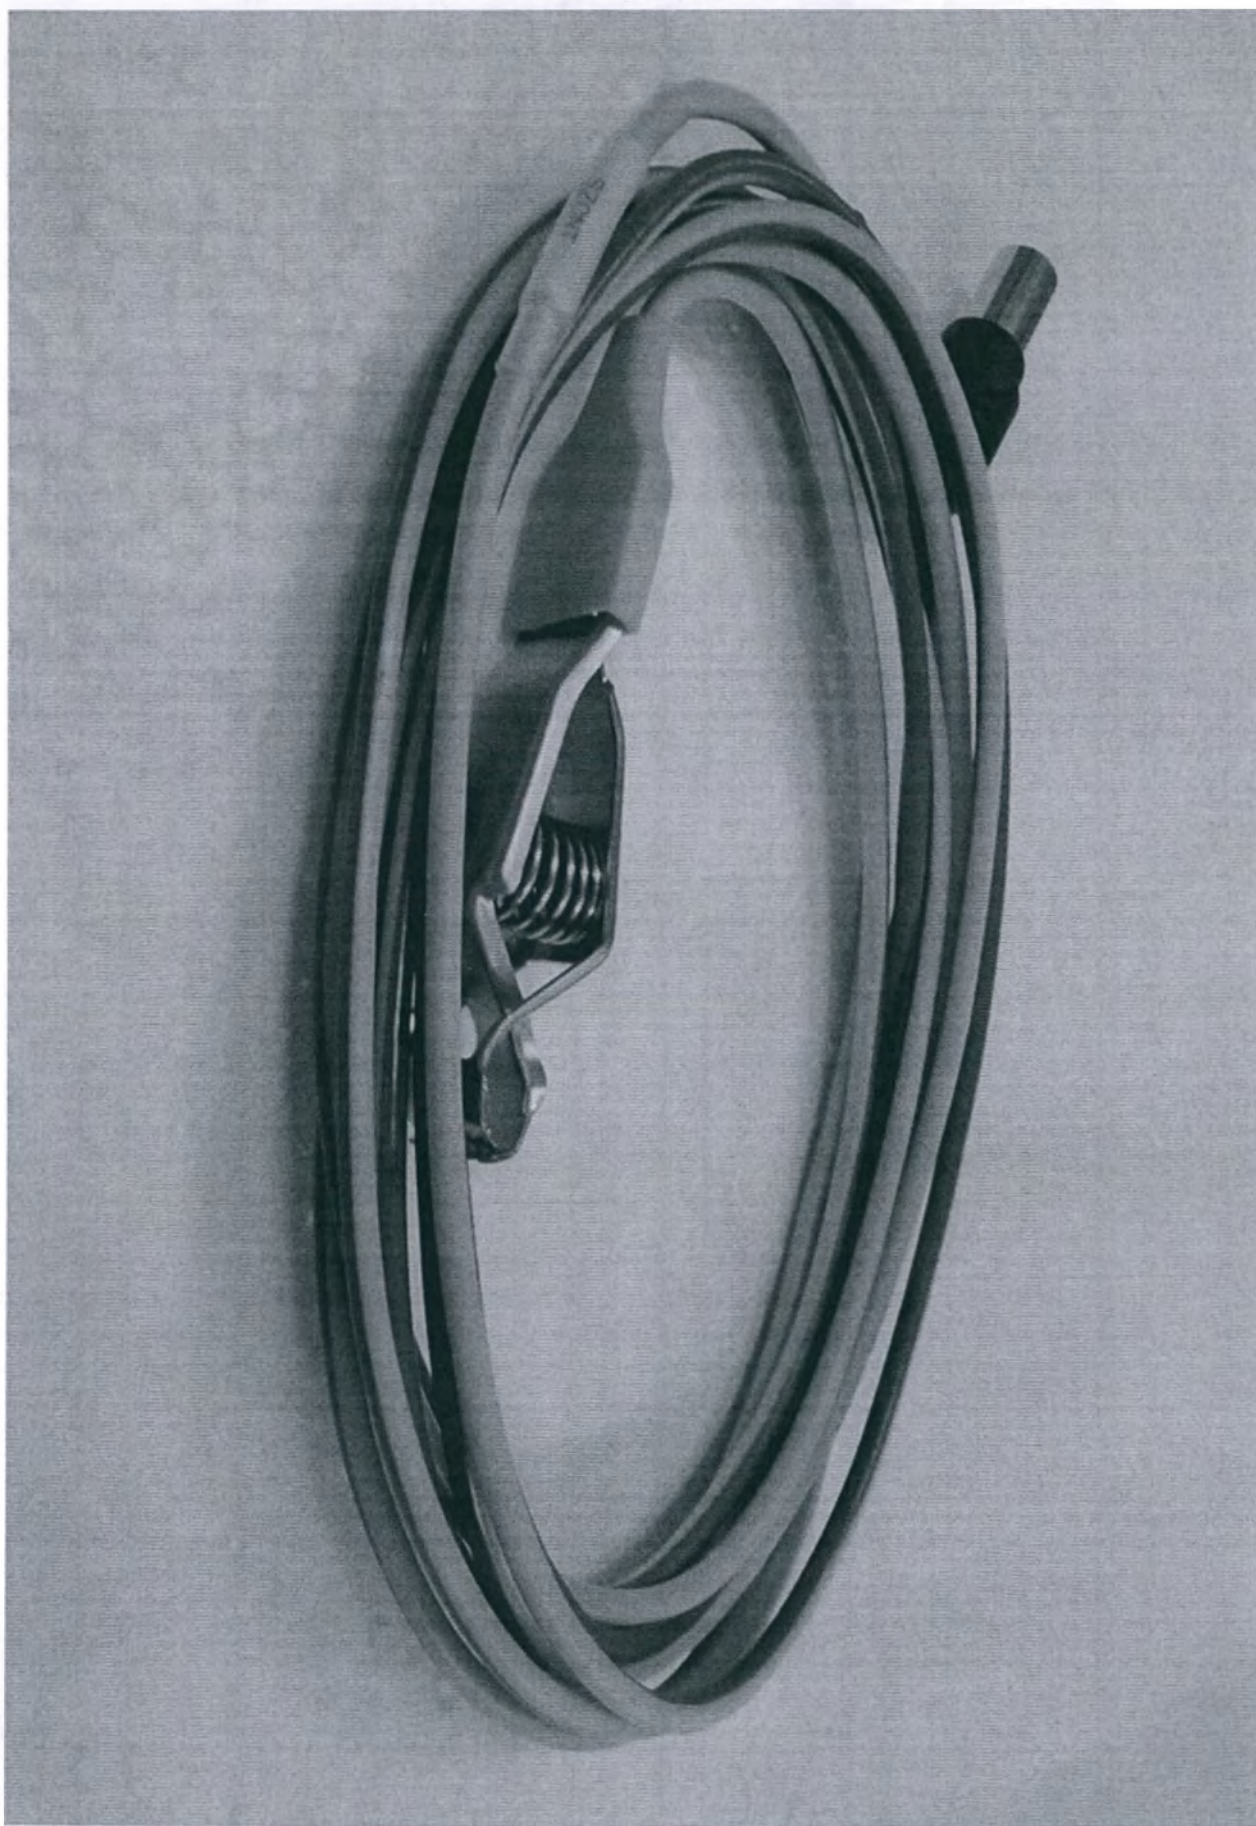

Испаритель анестетика (фторотан (галотан)), (при необходимости)

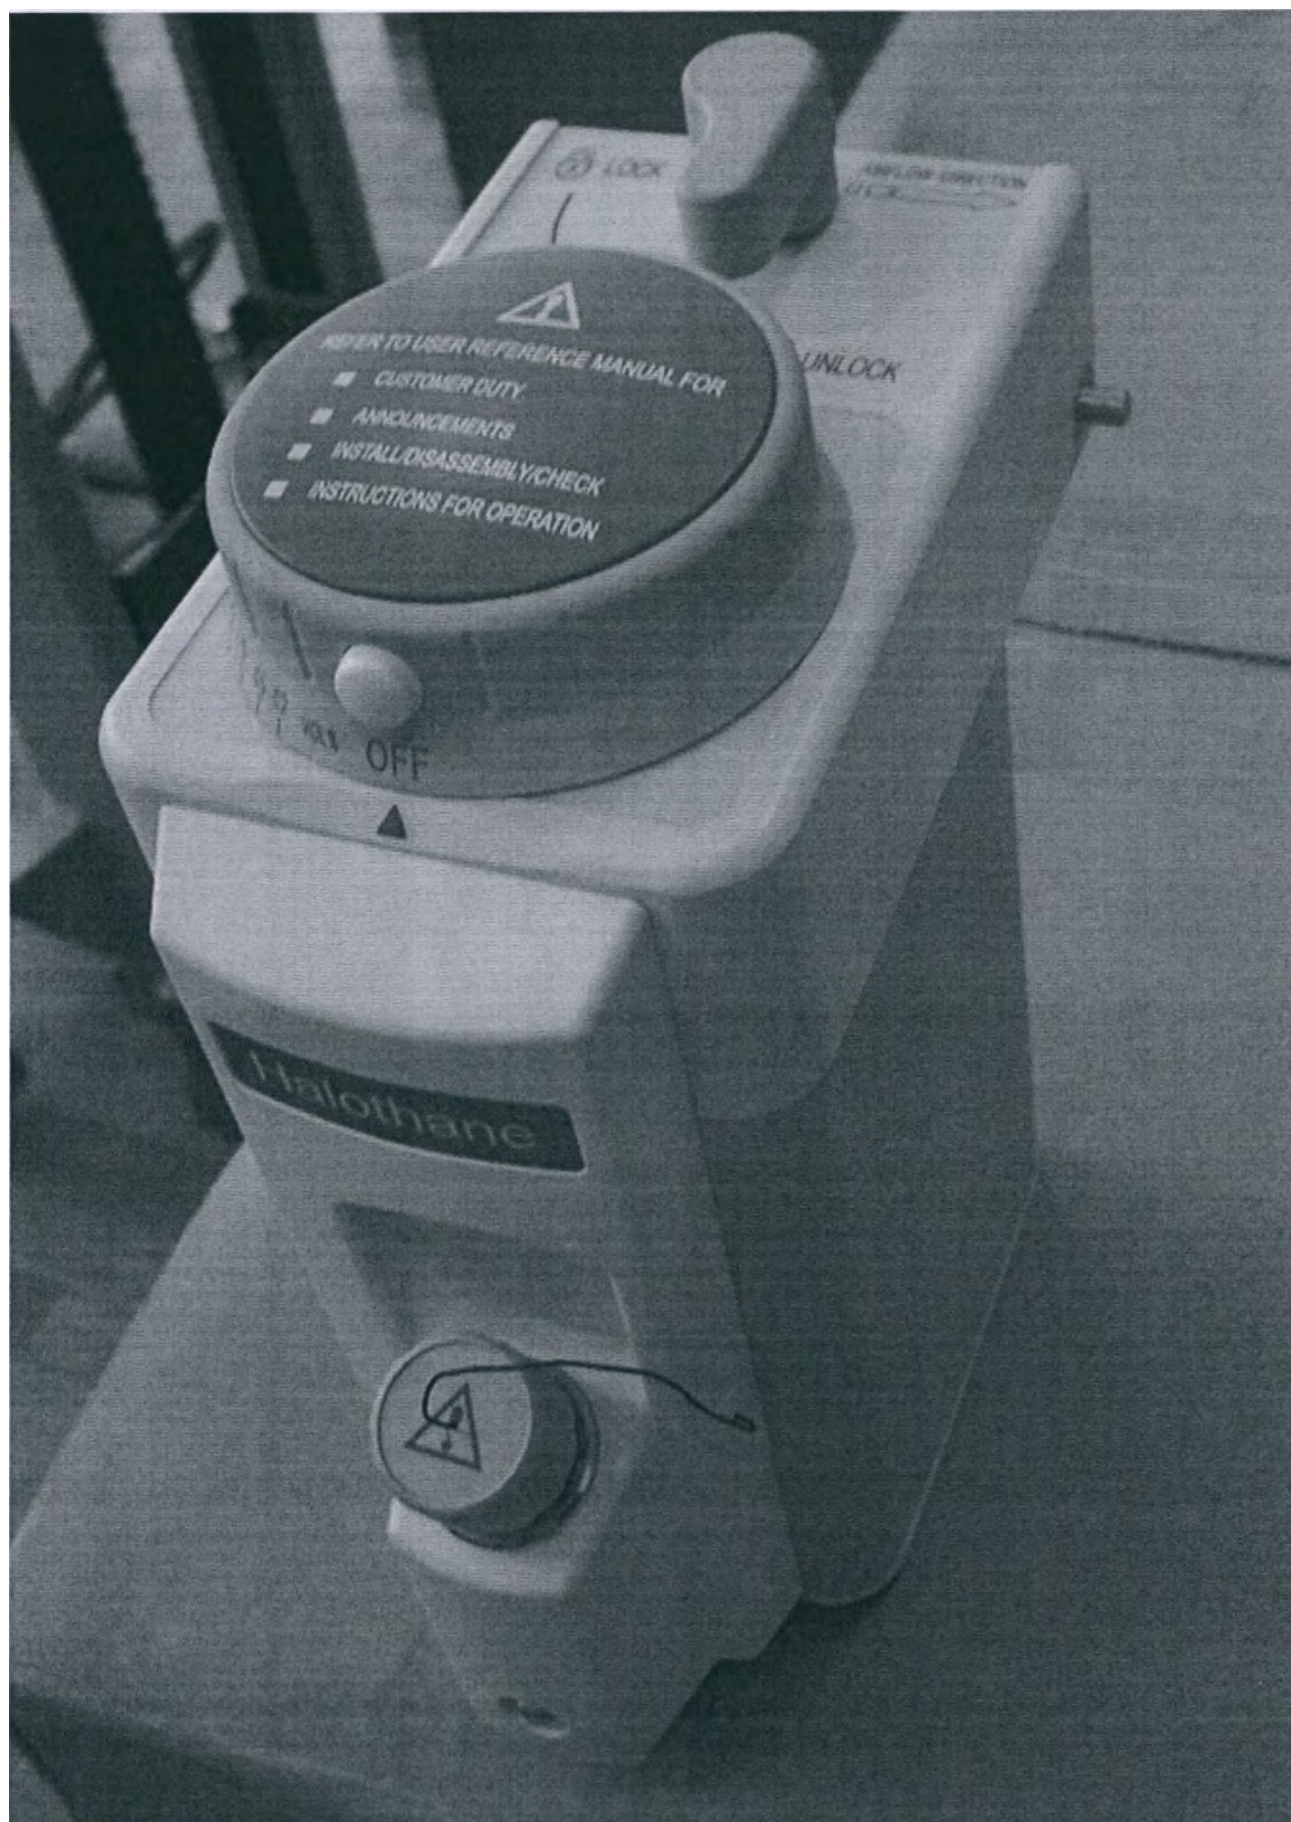

Испаритель анестетика (изофлюран), (при необходимости)



Испаритель анестетика (севофлюран), (при необходимости)




Датчик кислорода, (при необходимости)




Соединительный провод датчика кислорода, (при необходимости)




Тройник датчика кислорода

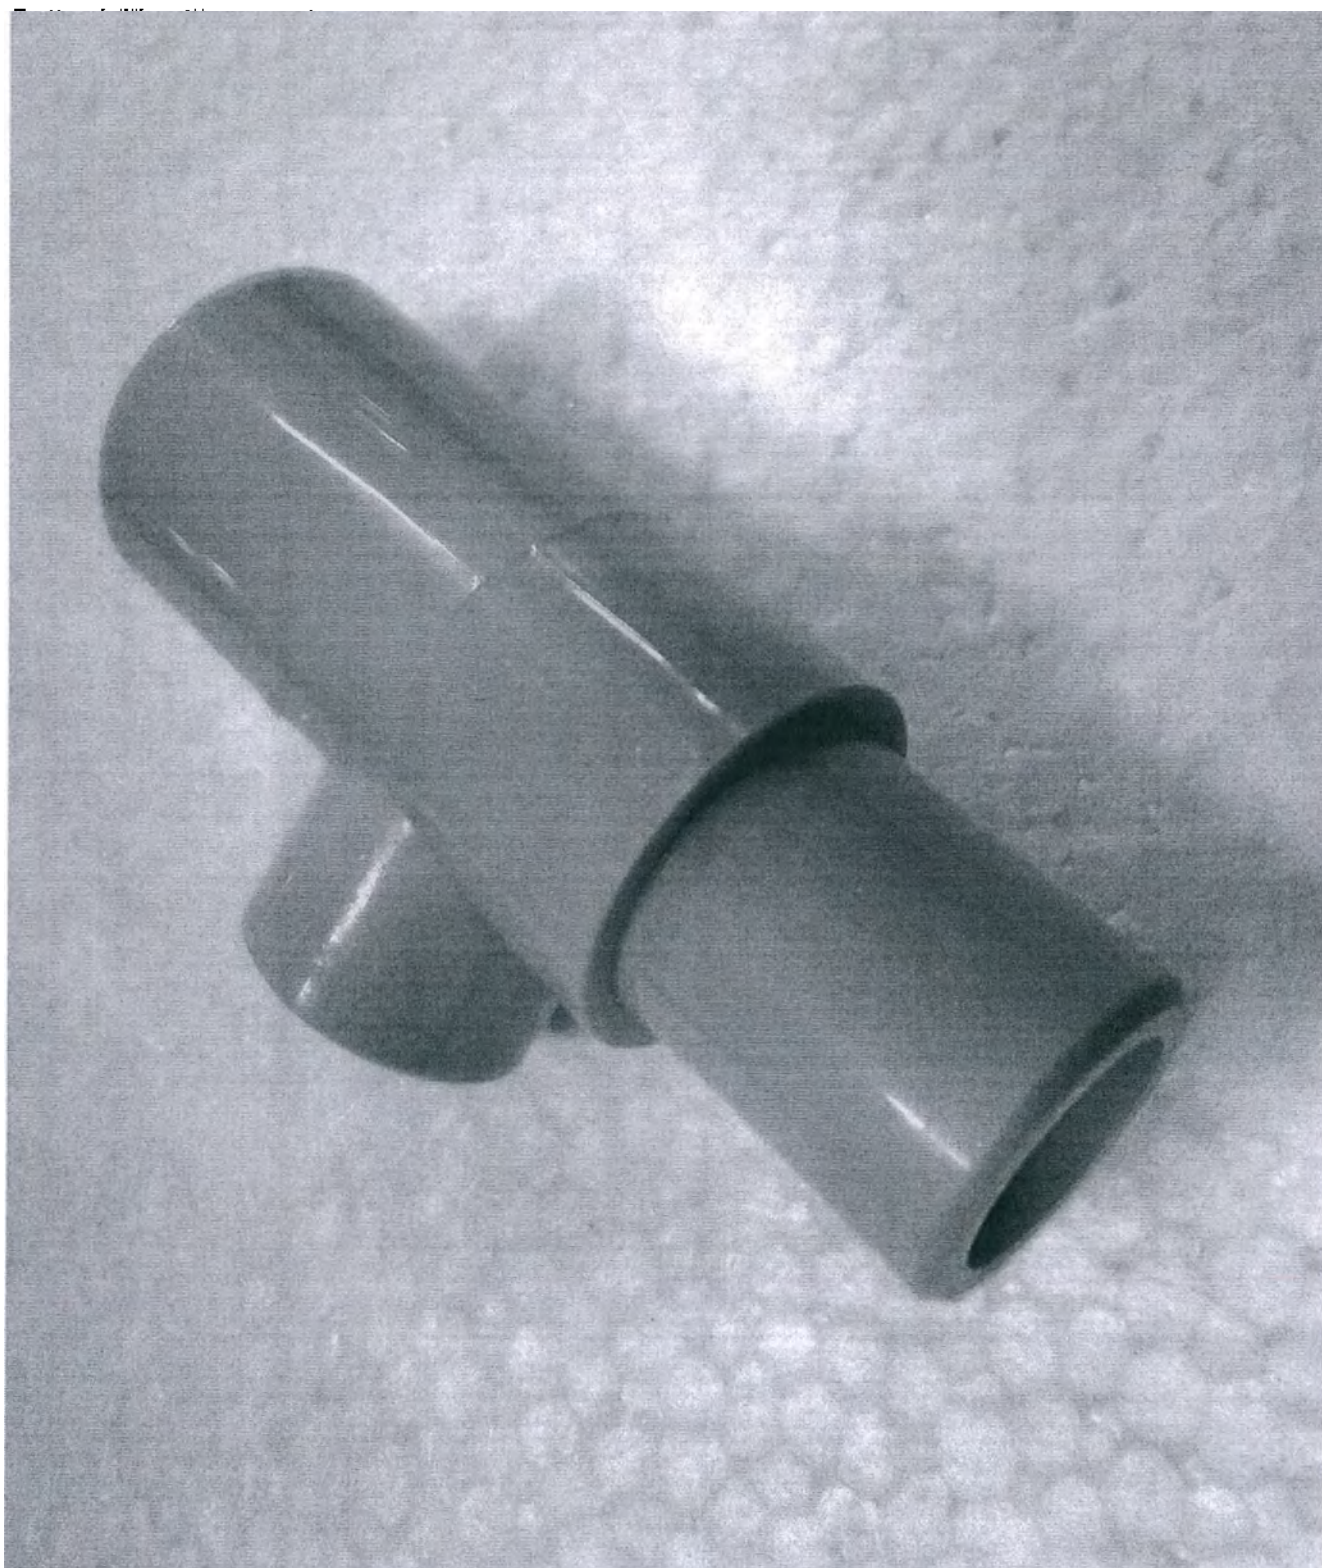


Шланг кислородный, 34I-OXY-GS/NS-5, (при необходимости)

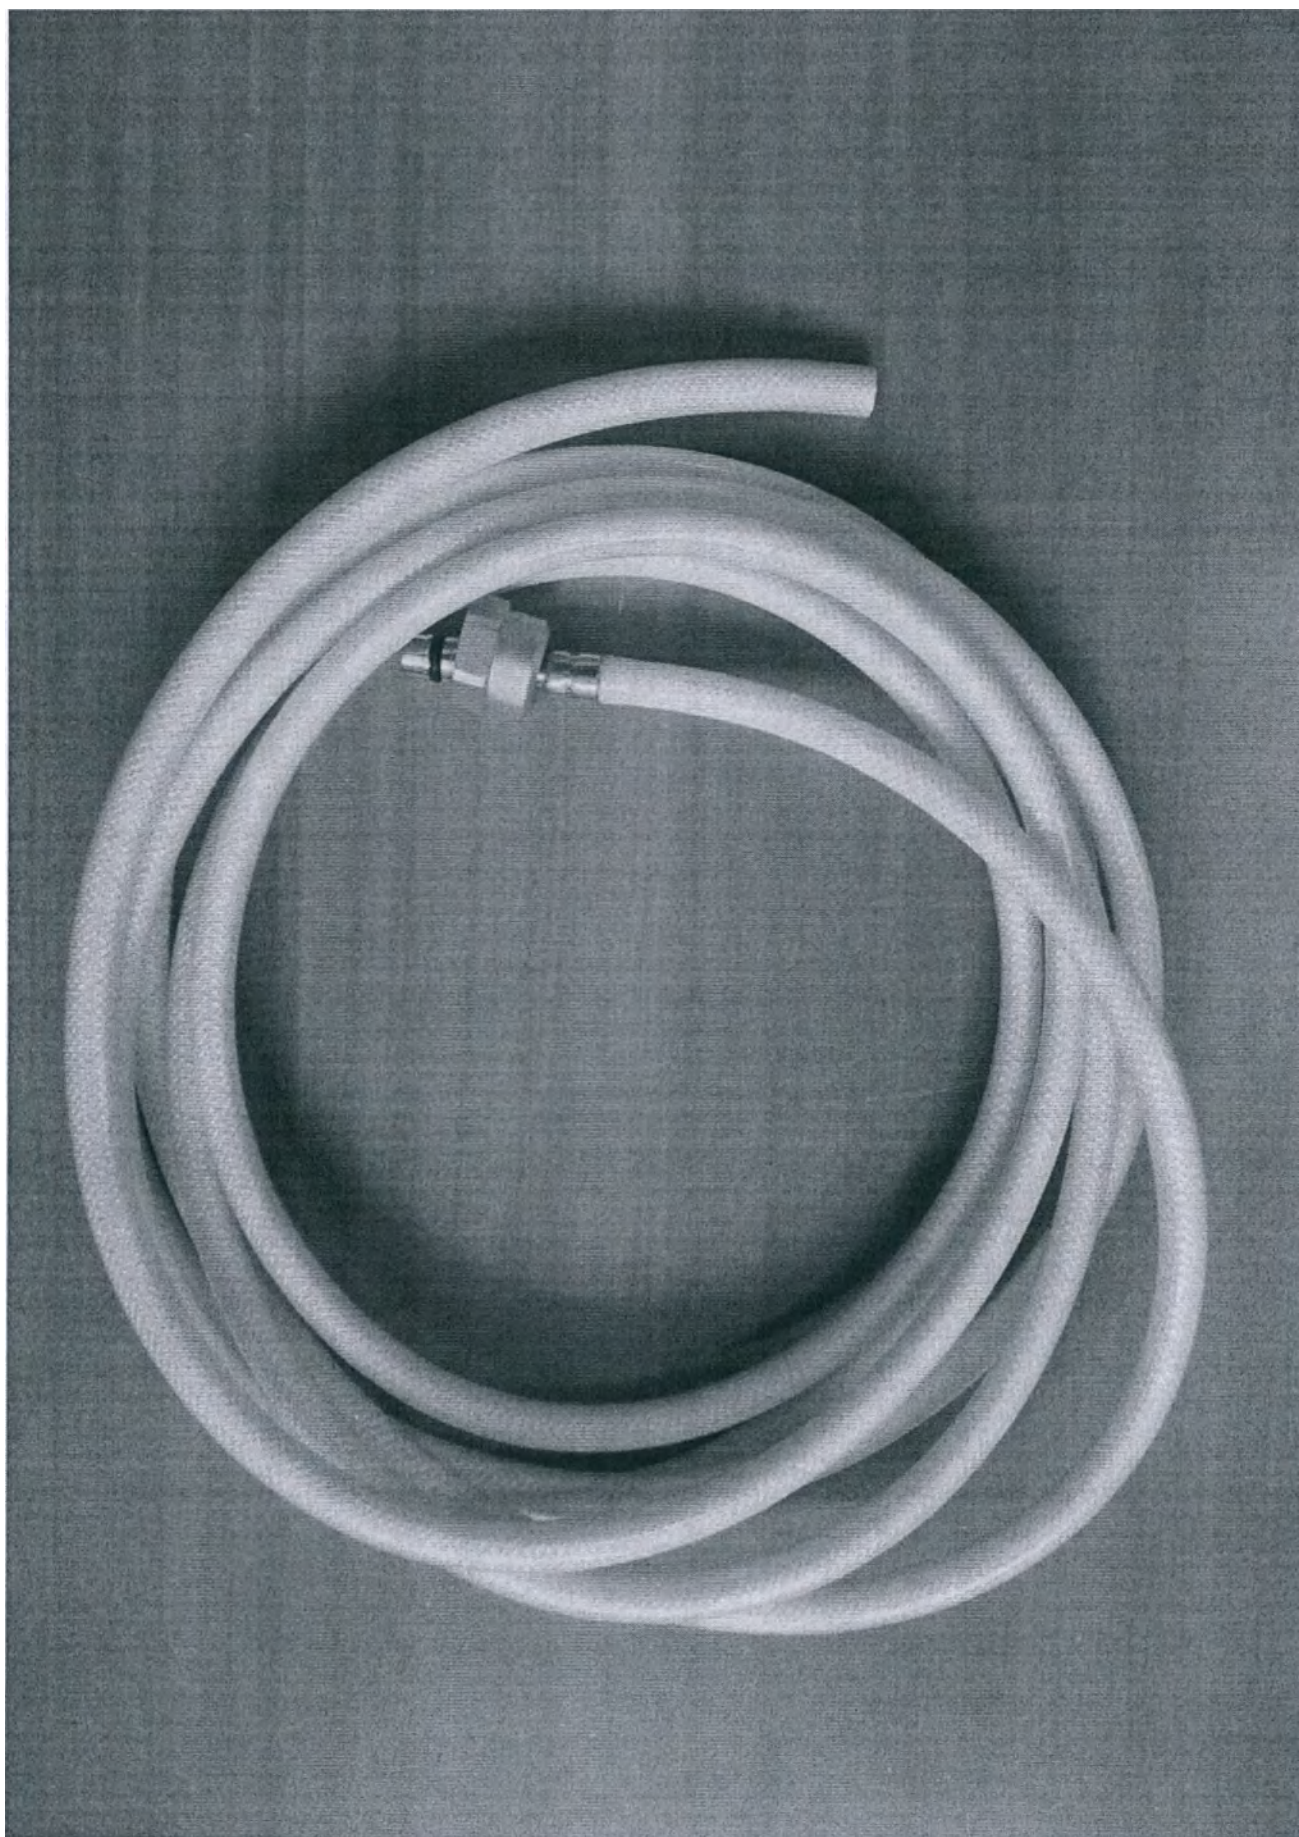

Шланг подачи закиси азота, (при необходимости)

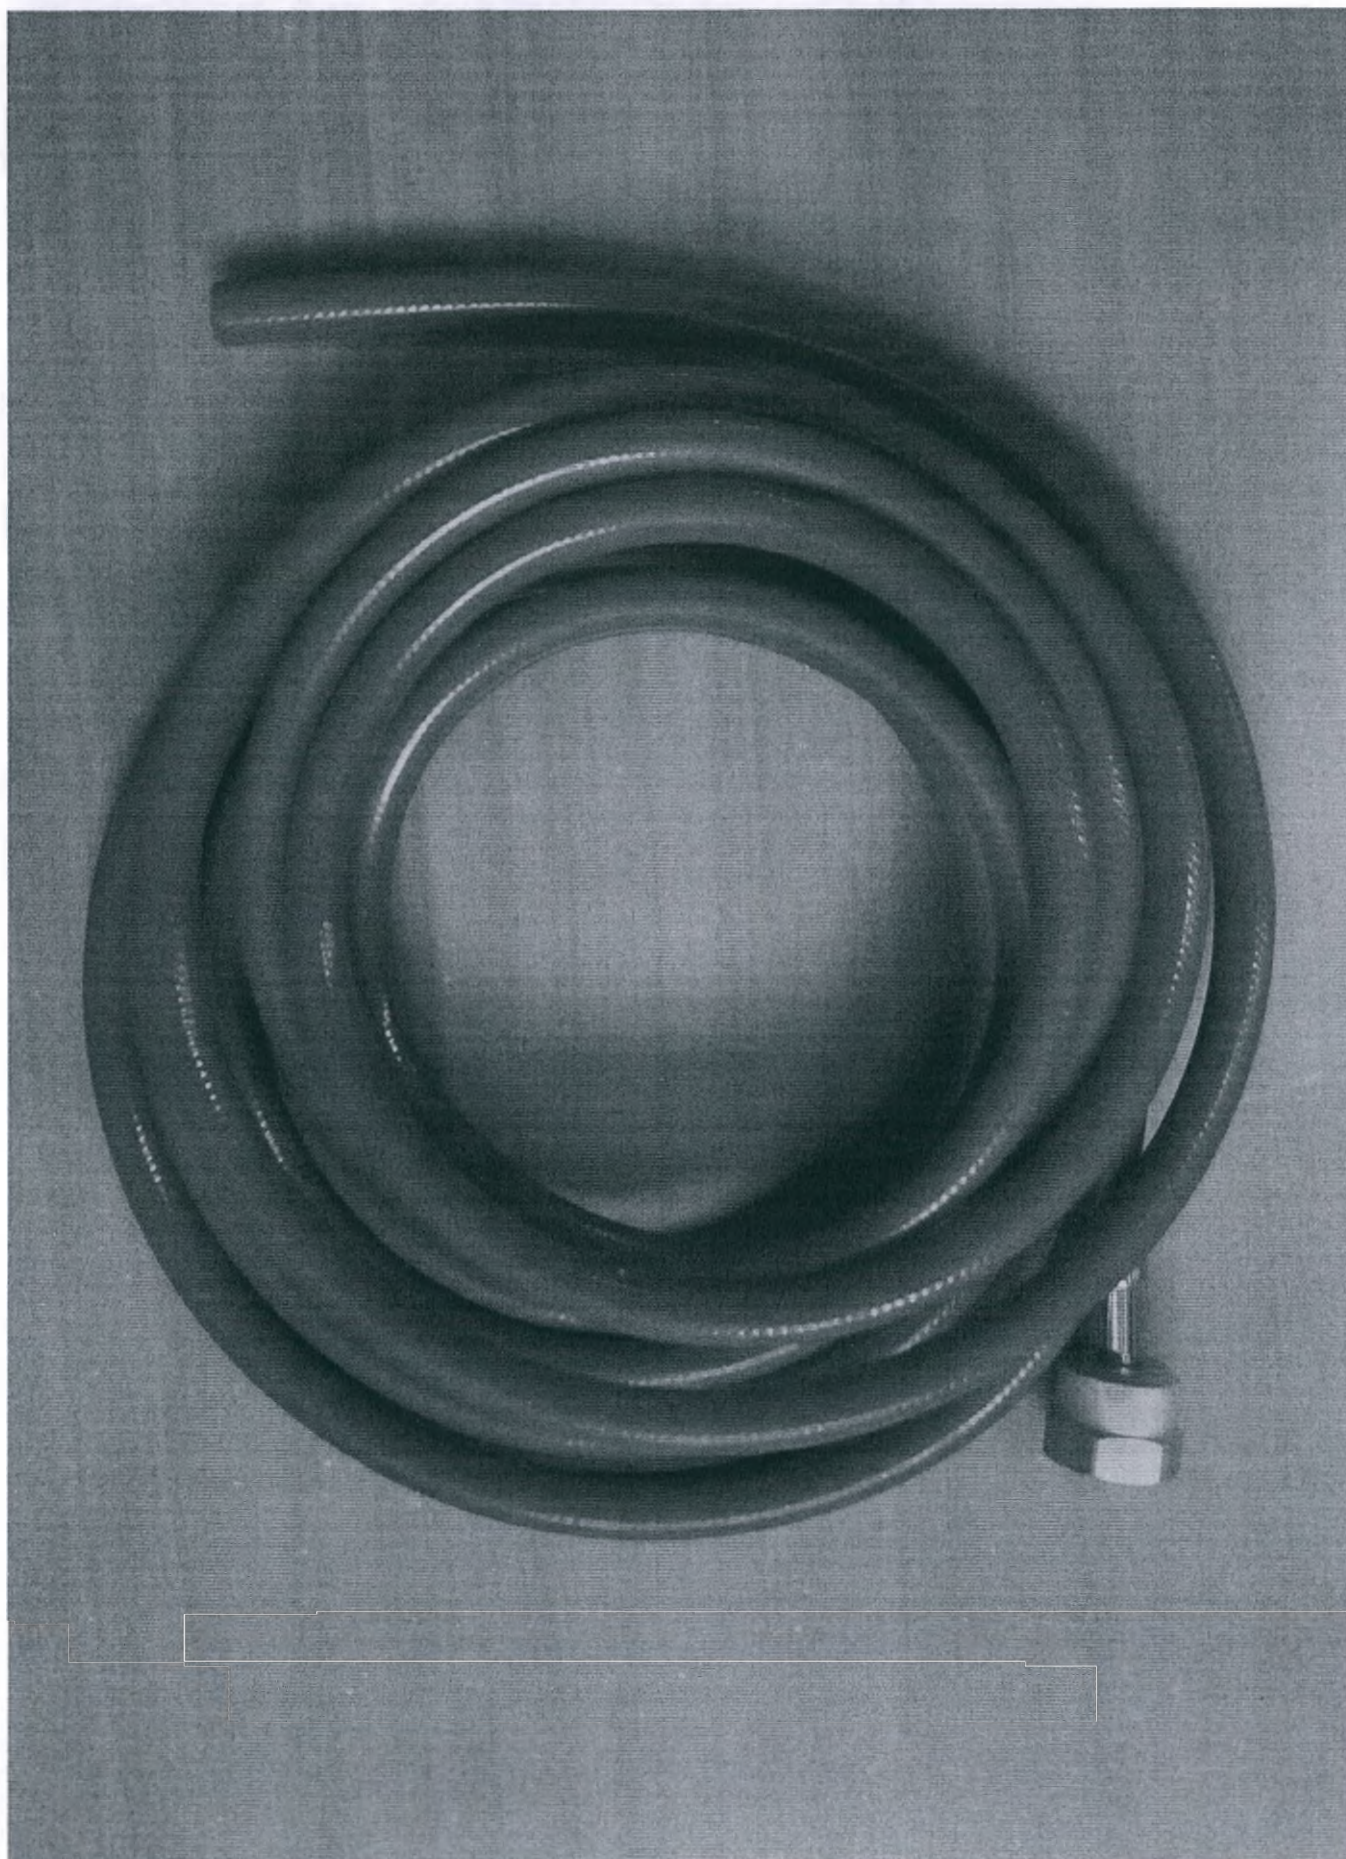


Шланг подачи сжатого воздуха (при необходимости)

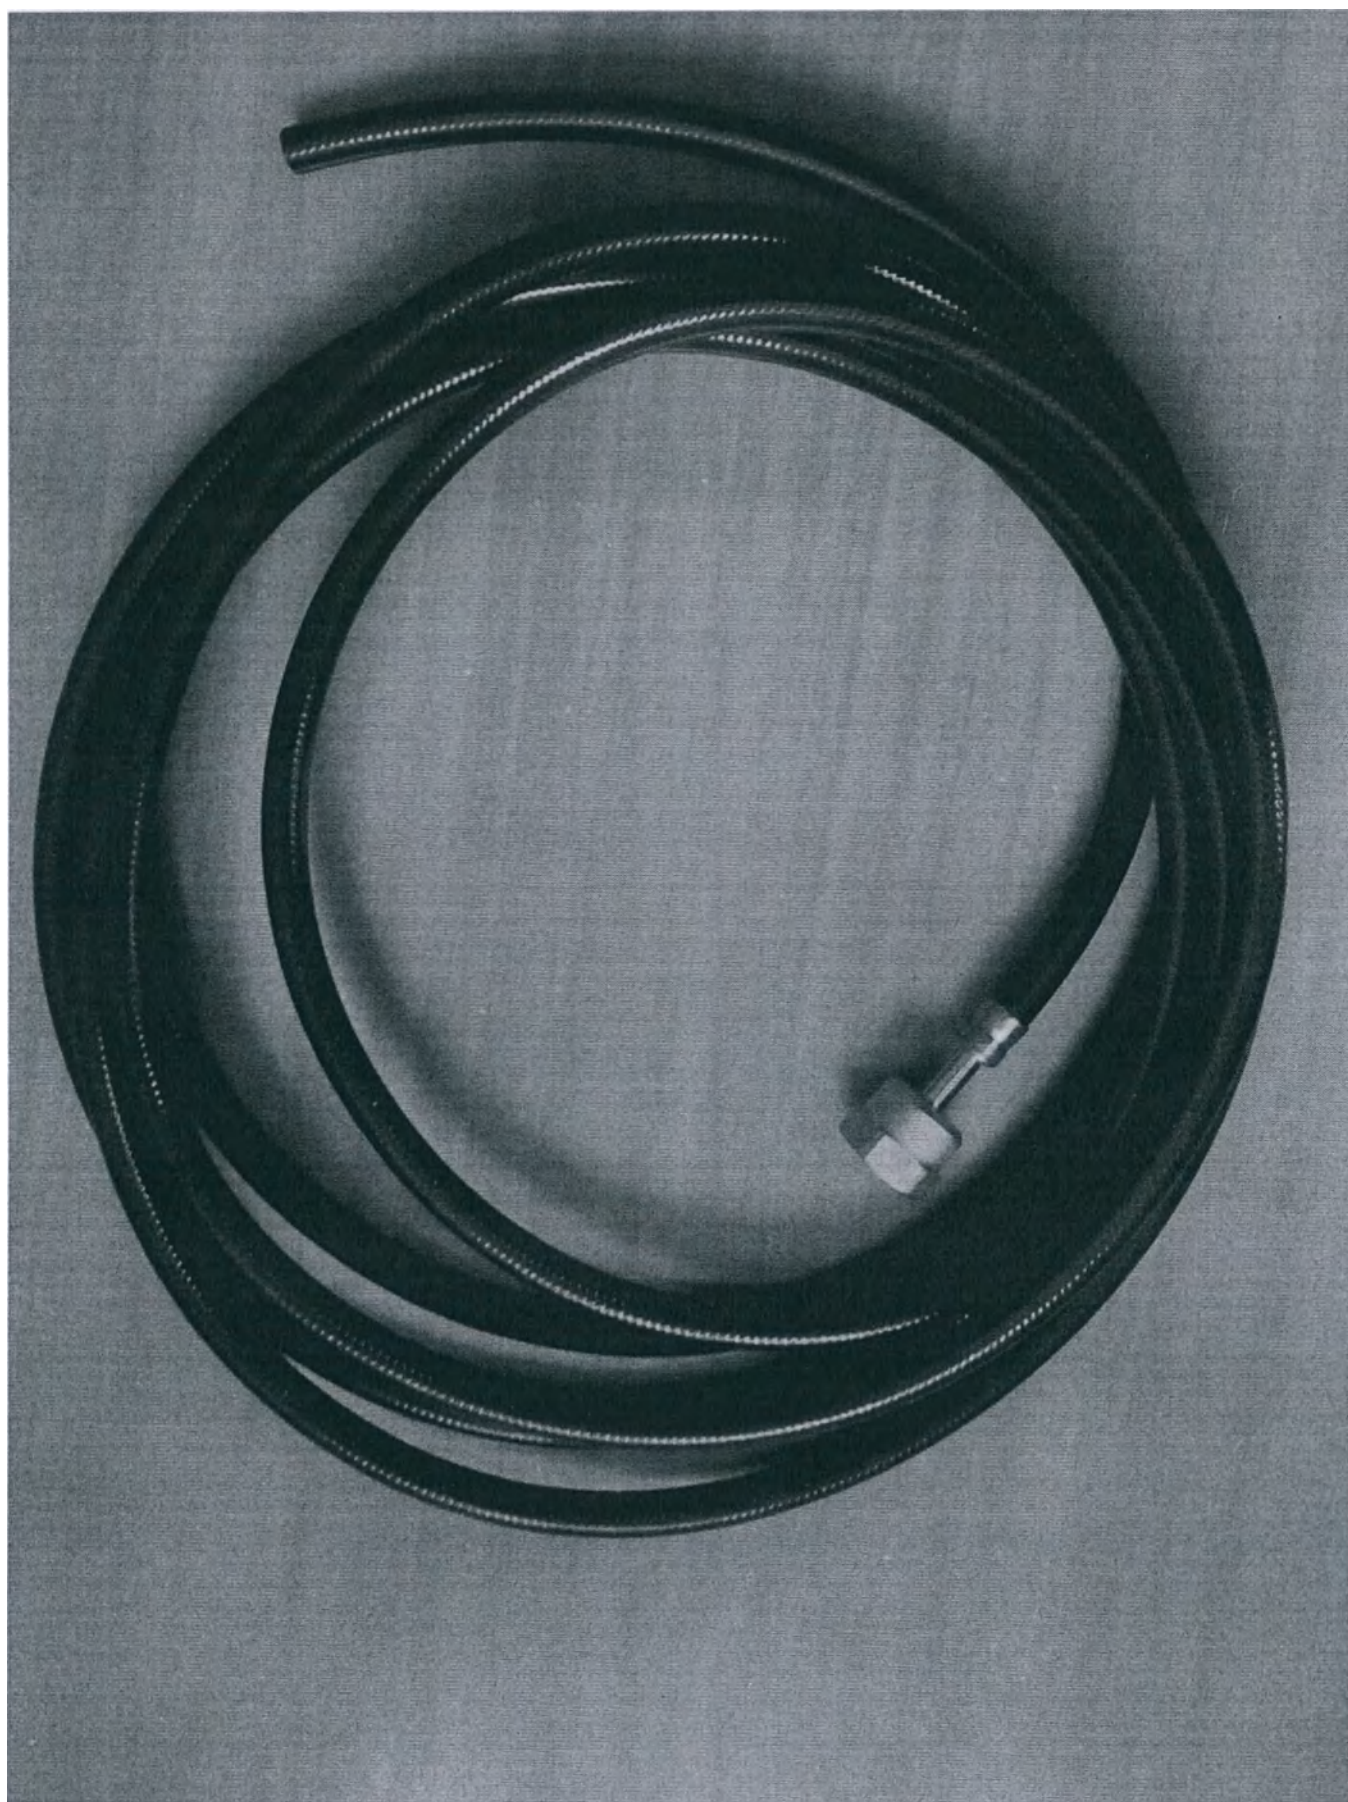

Маска лицевая




Мешок дыхательный 3 л

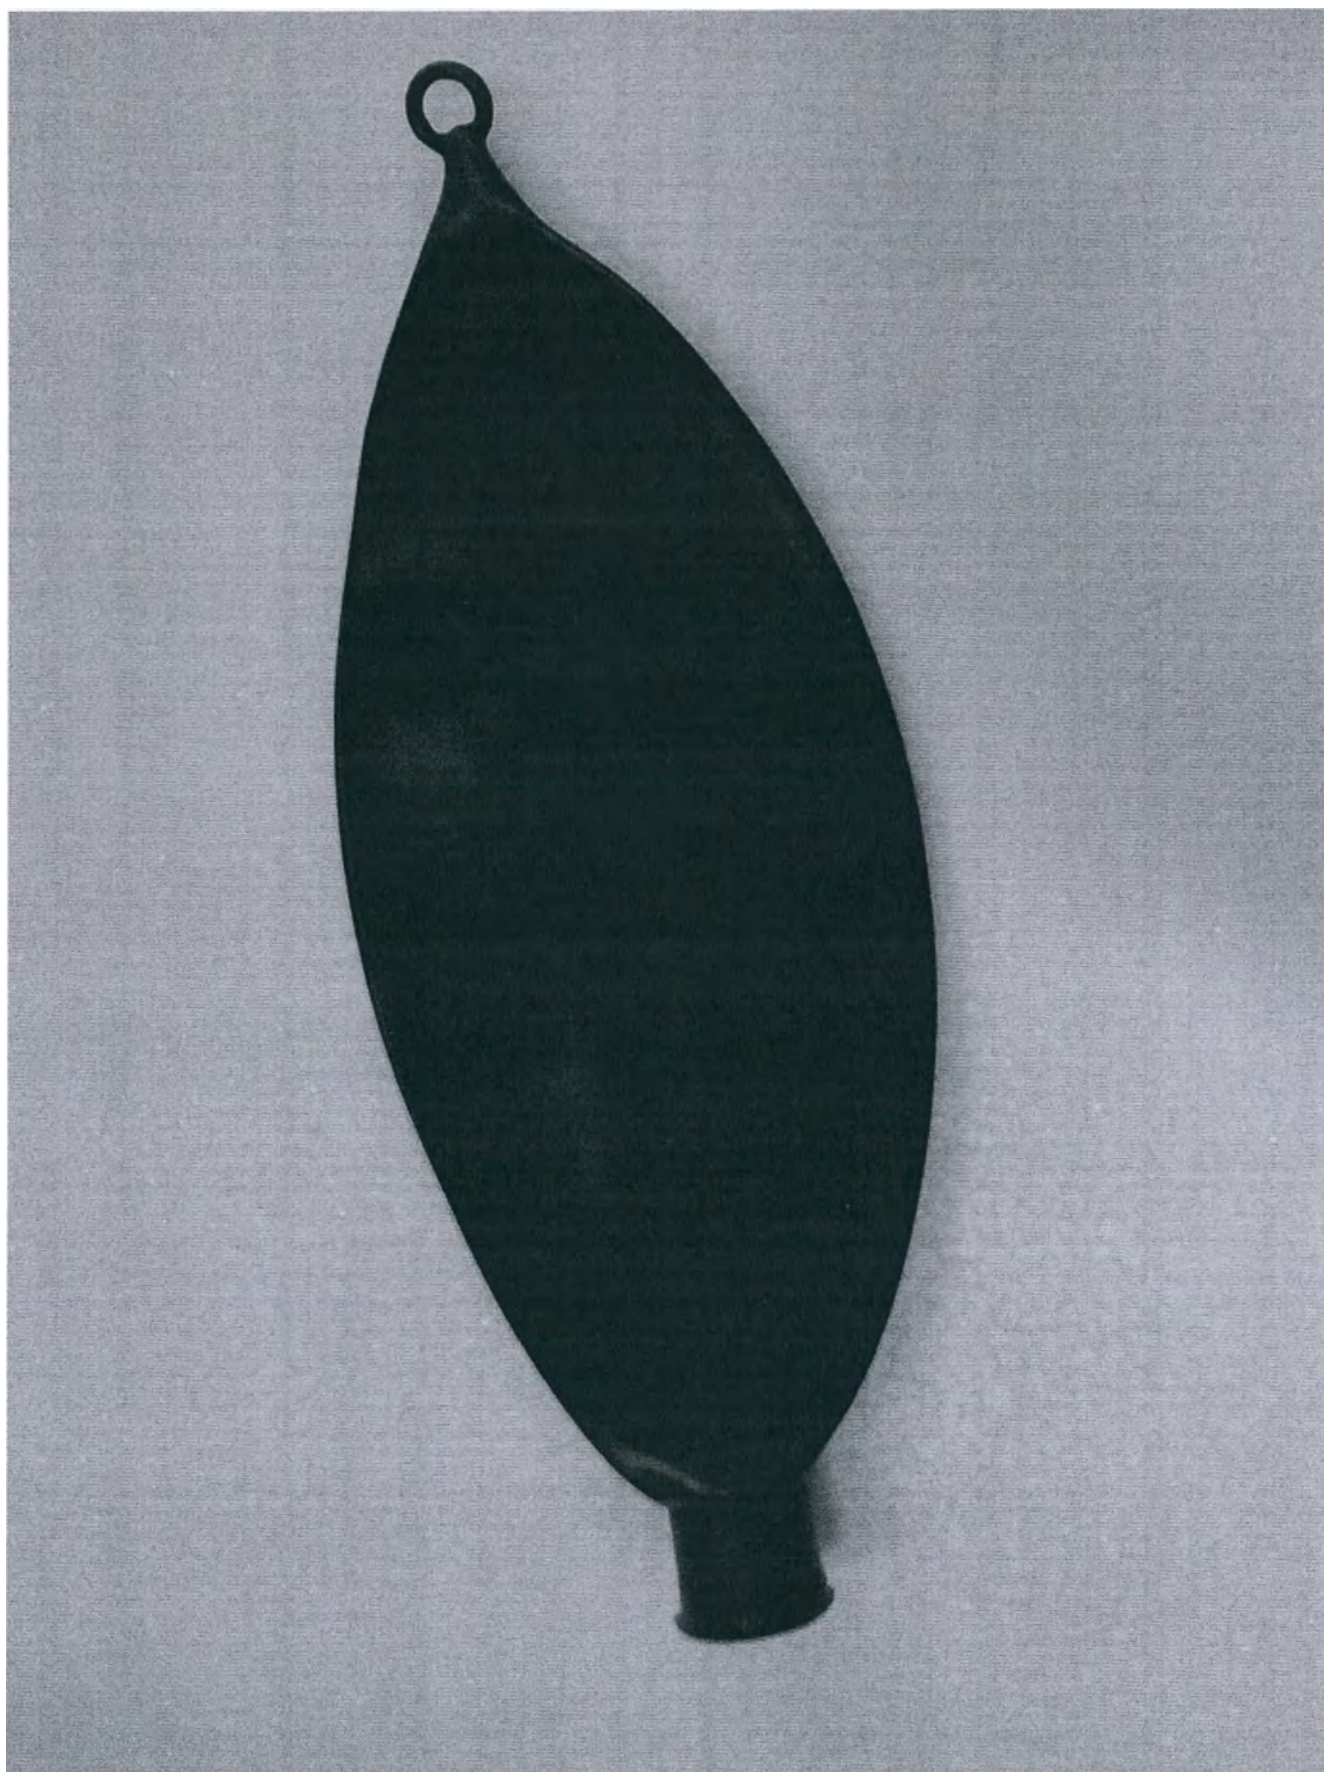

Мешок дыхательный 2л




Адаптер Y-образный

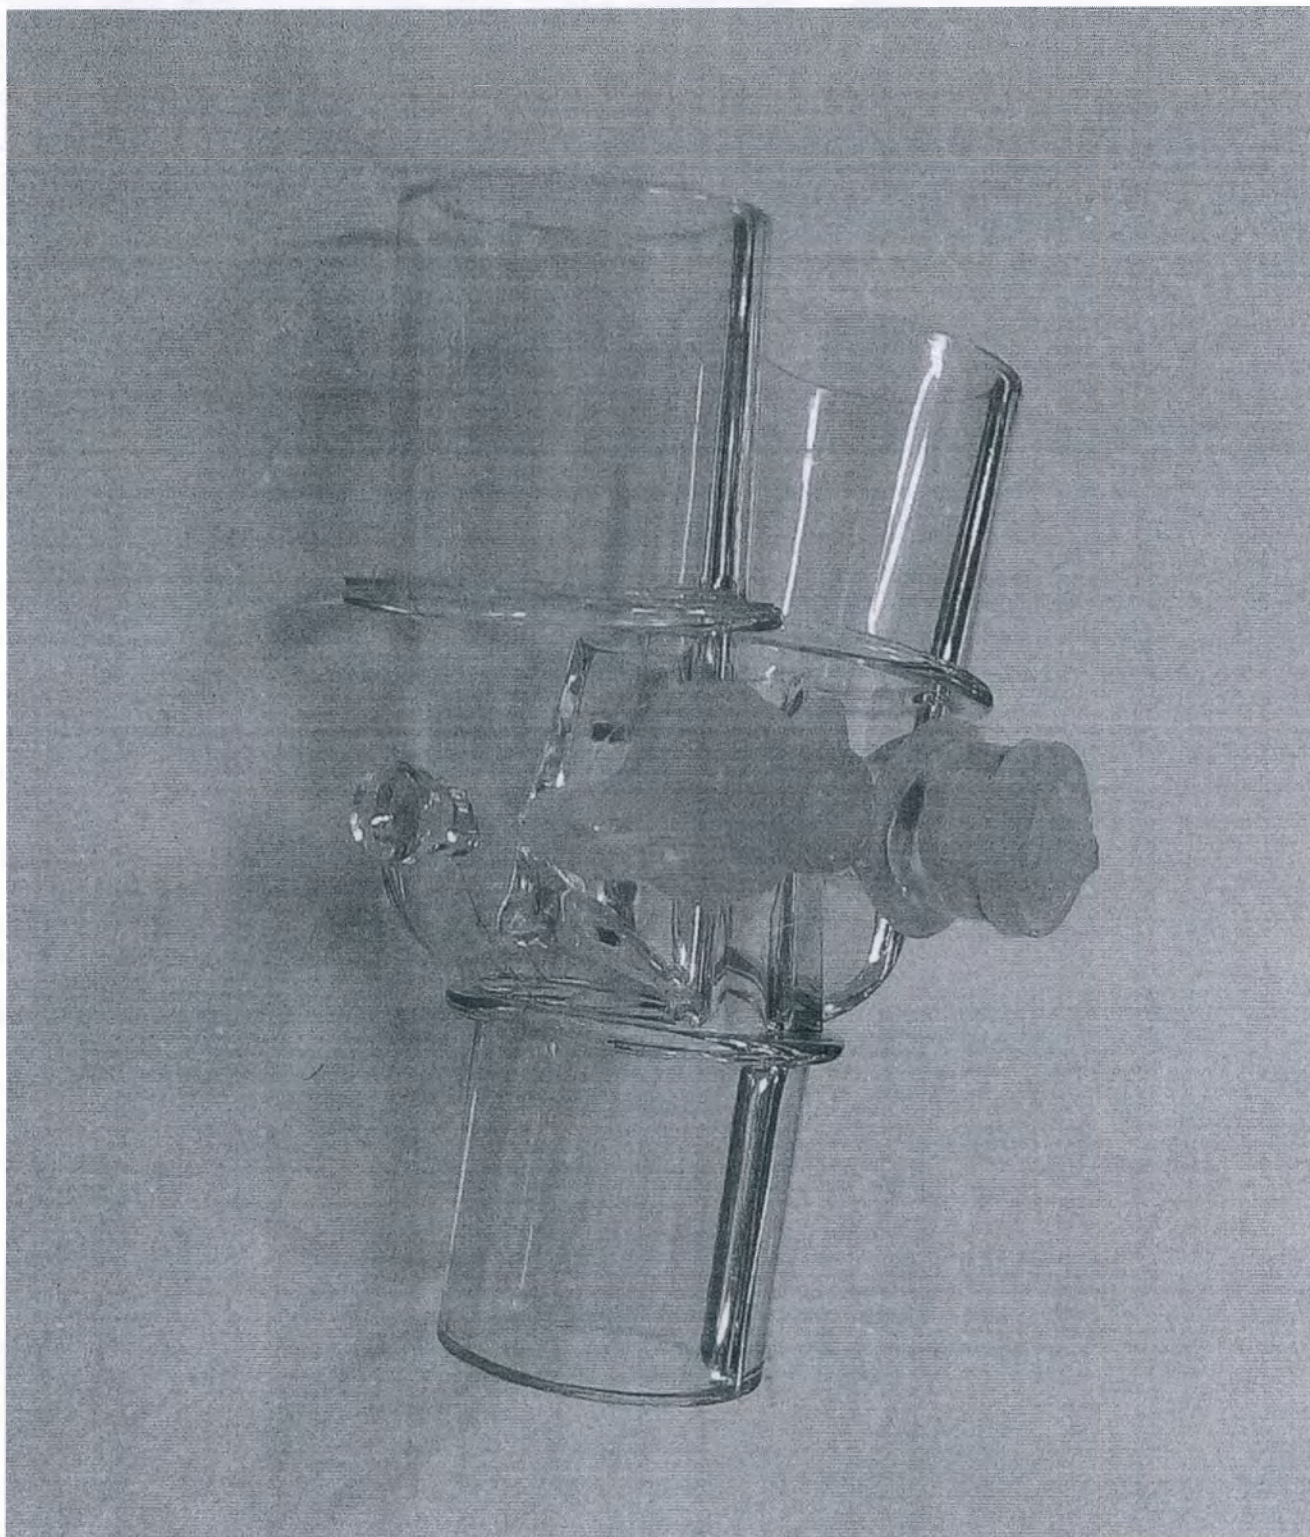


Соединитель прямой




Соединитель угловой

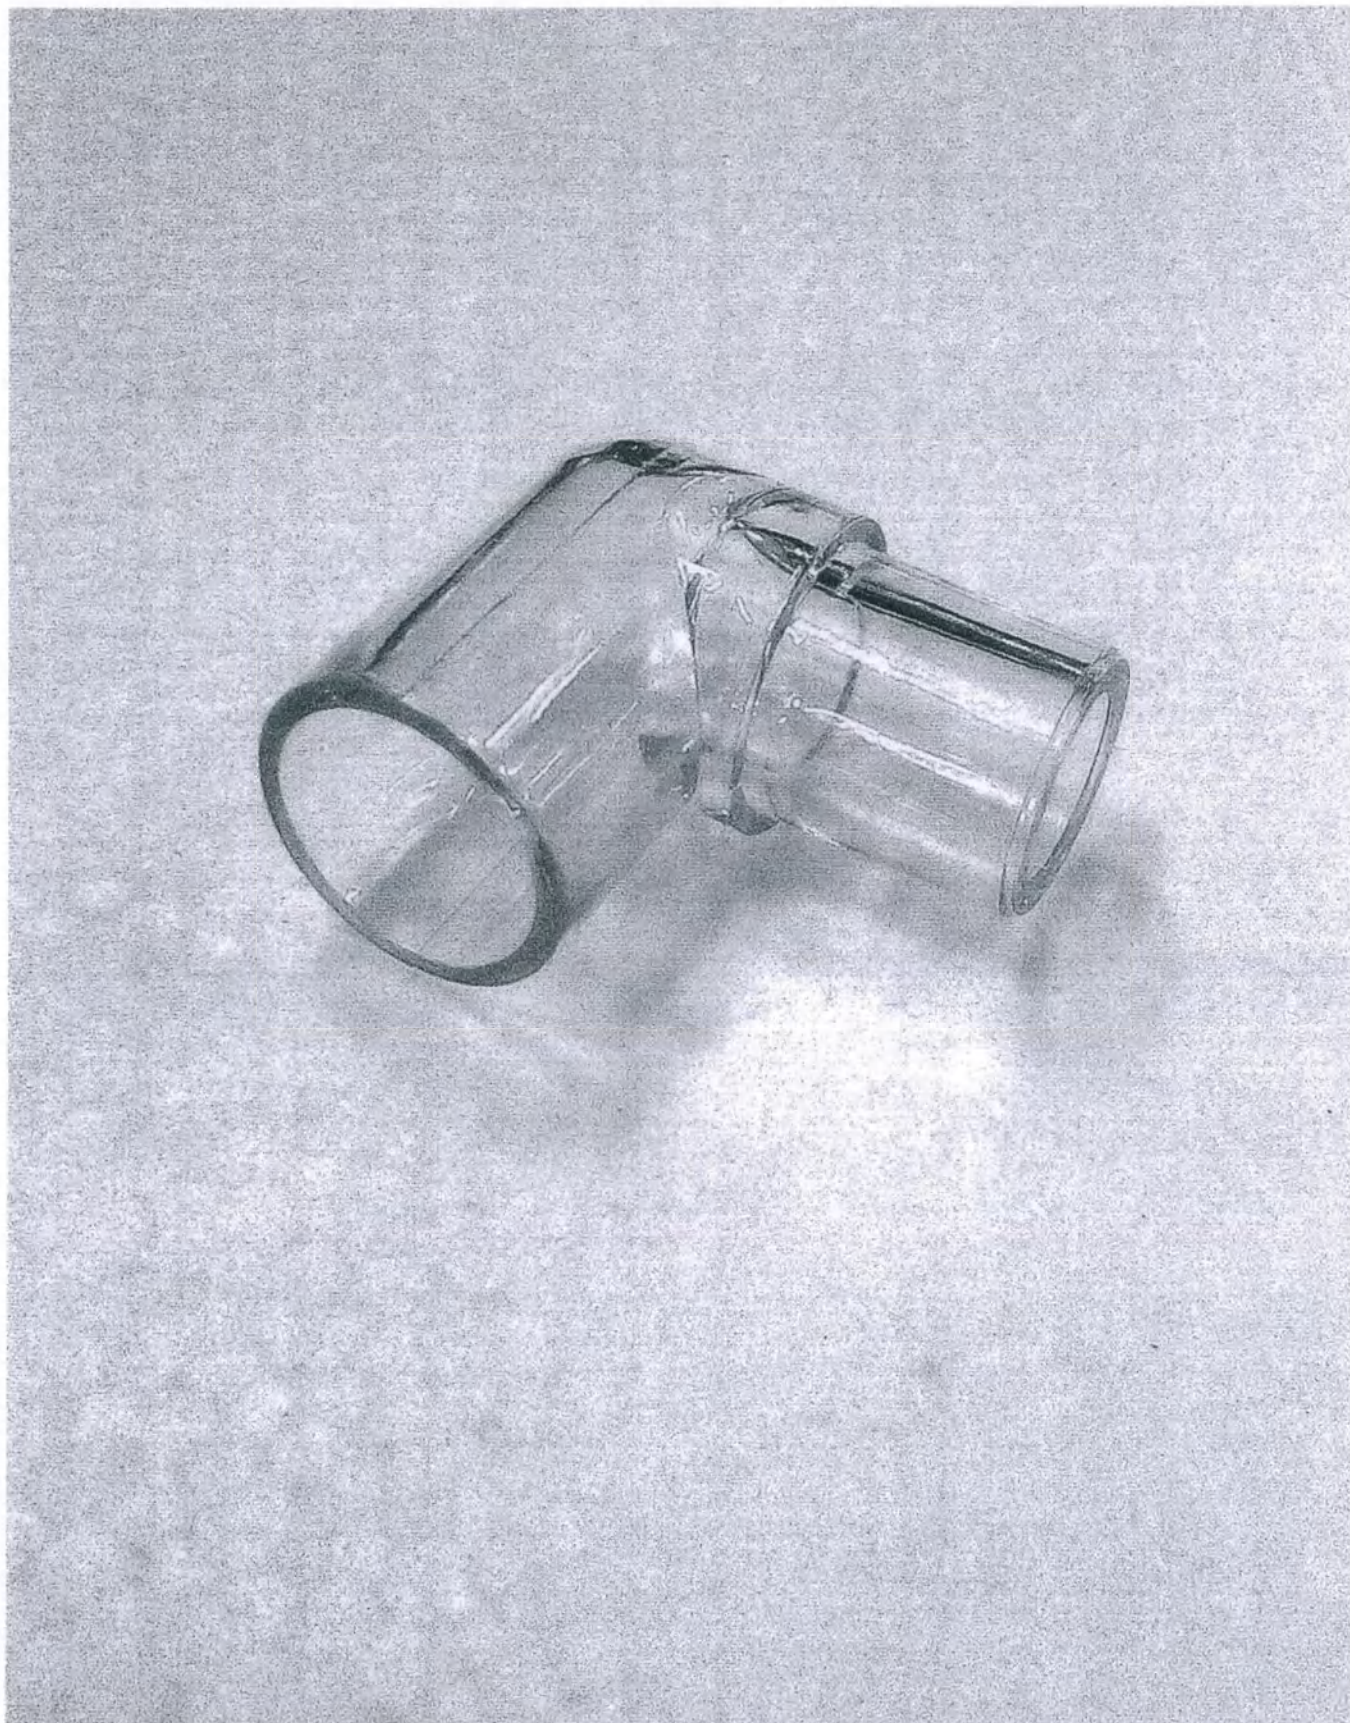


Шланг гофрированный с двумя втулками А-22-30

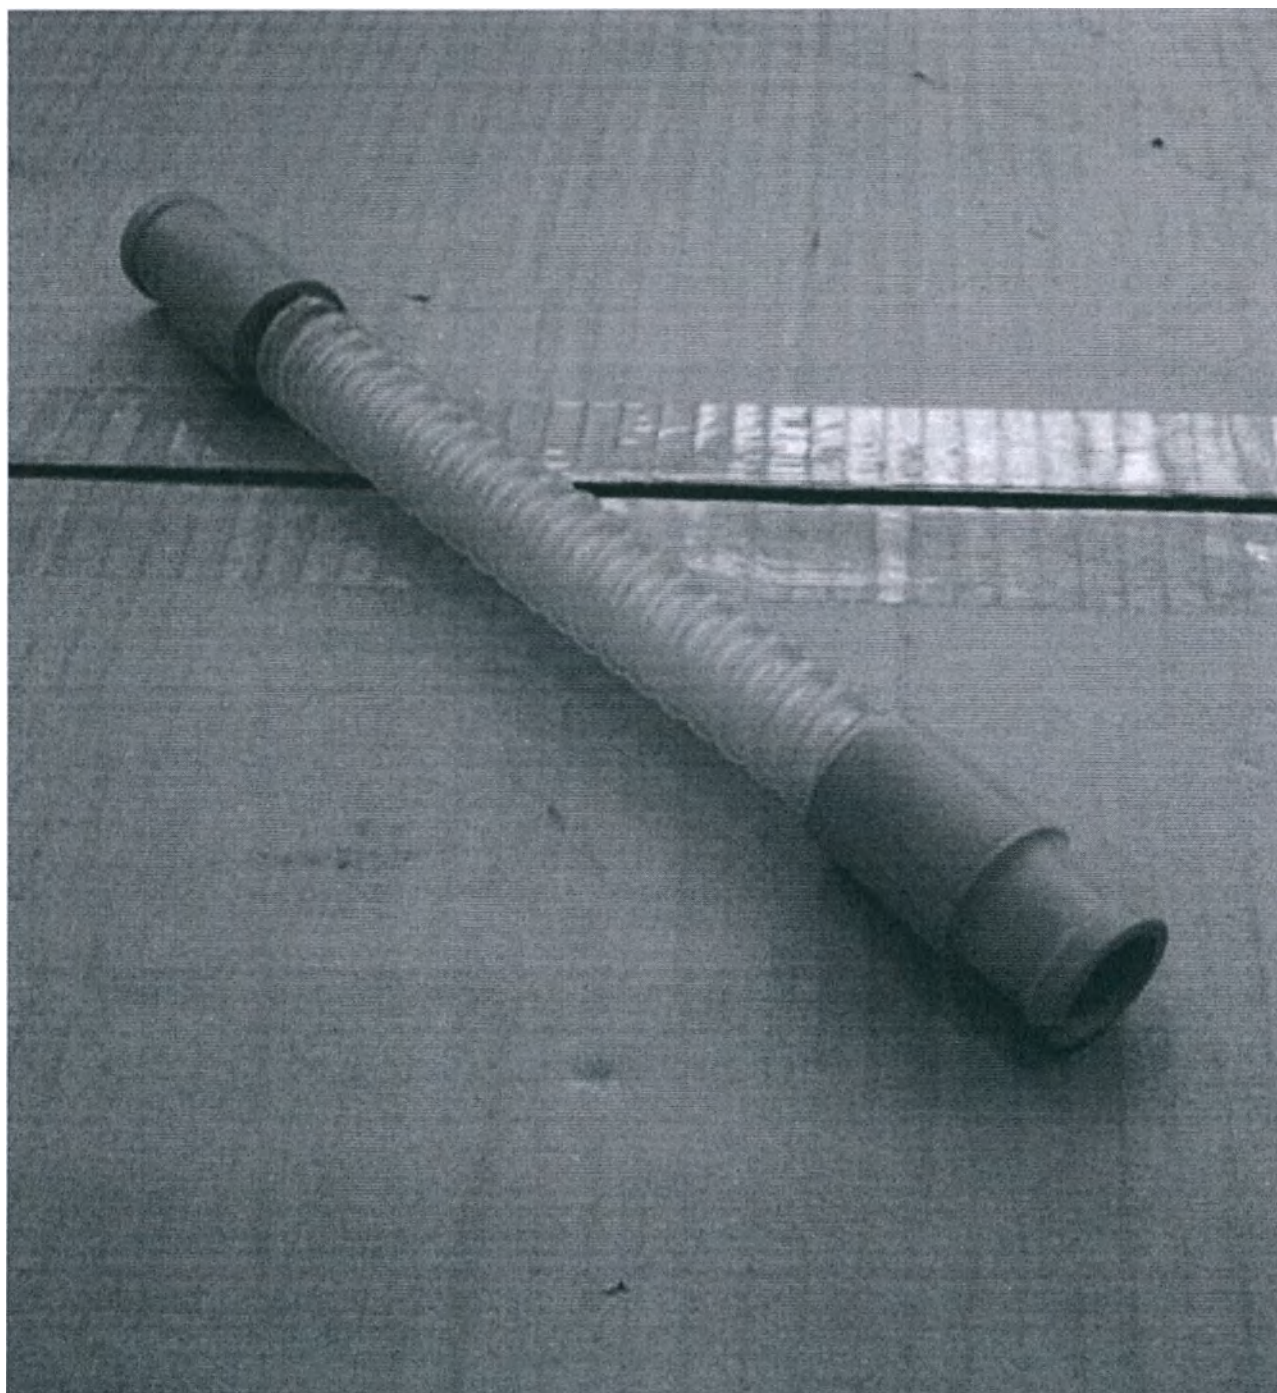


Шланг гофрированный с двумя втулками А-22-100

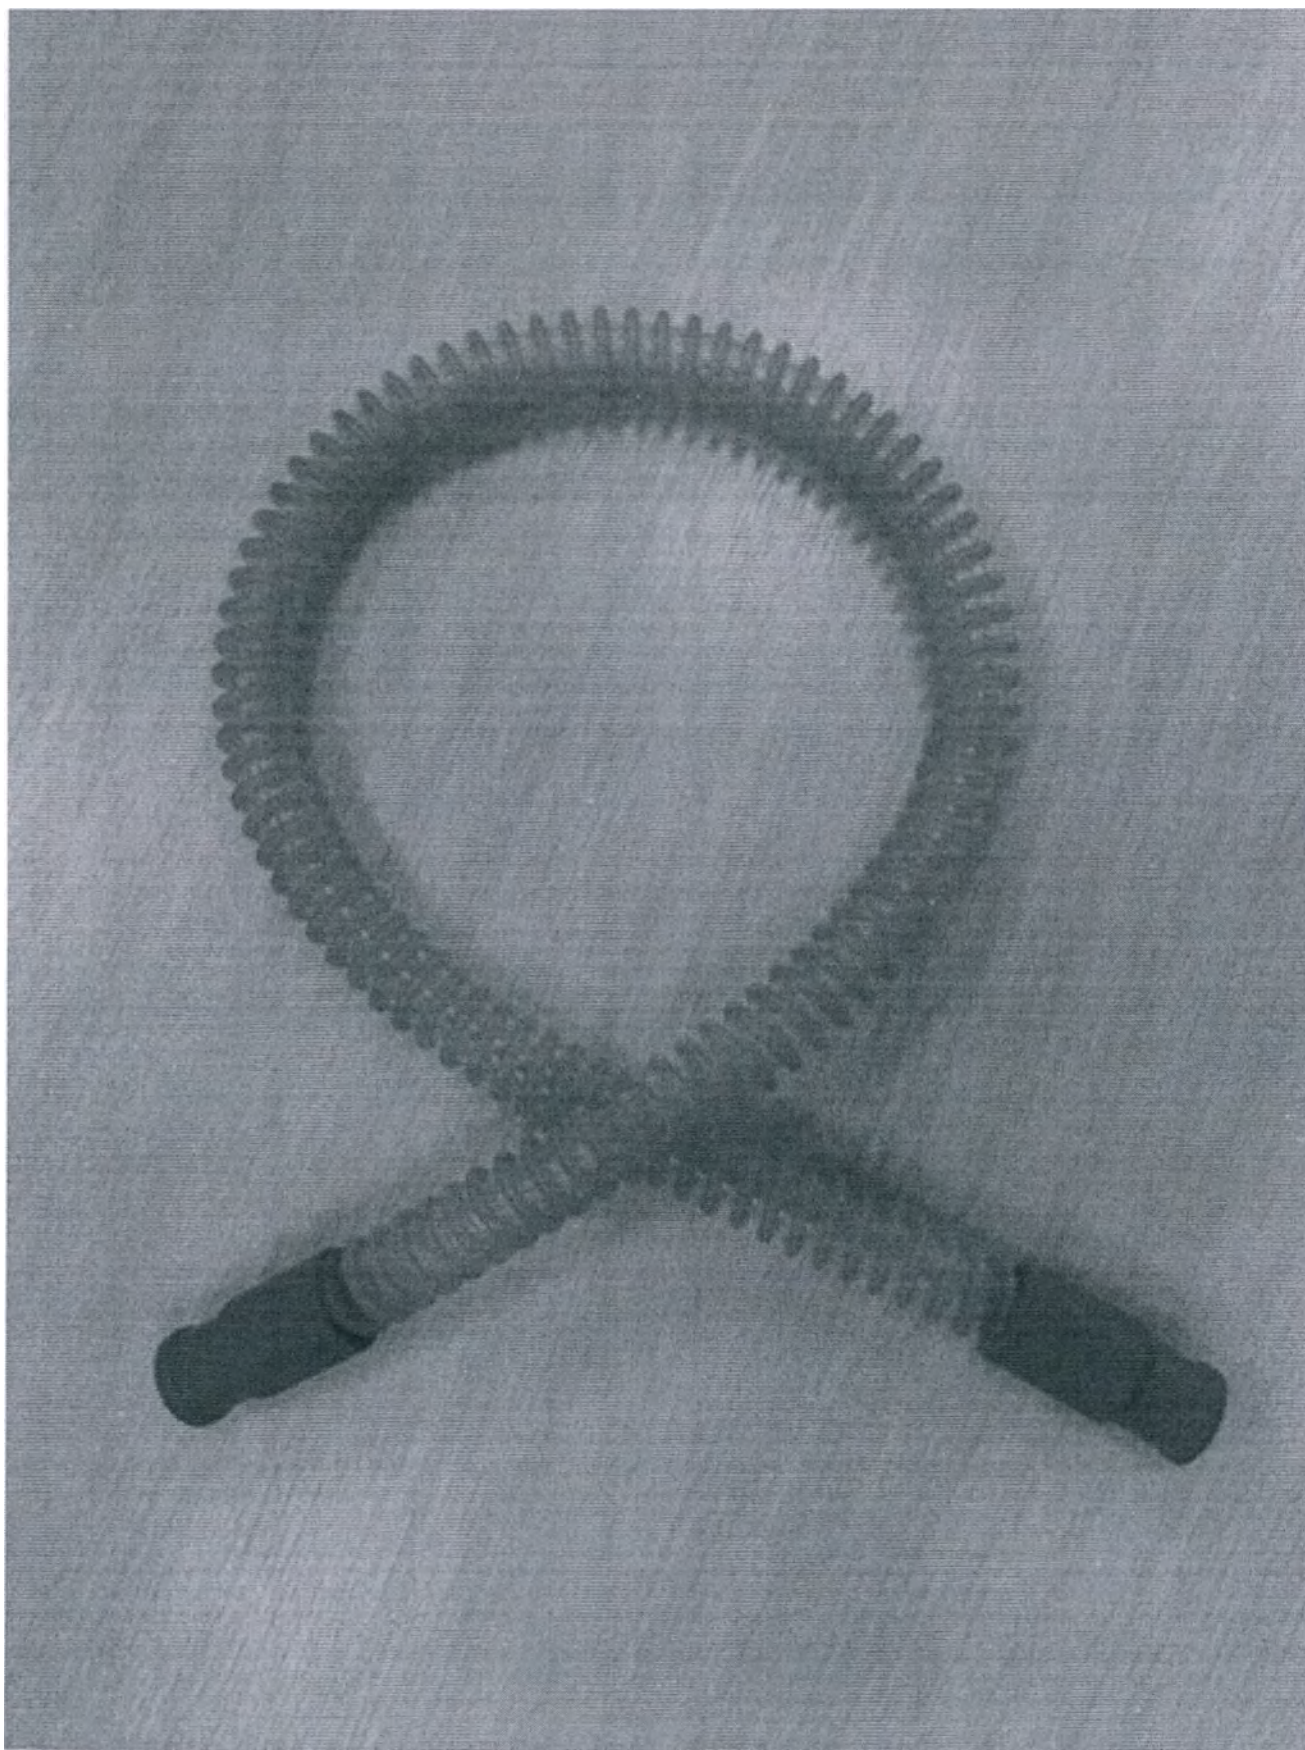

Шланг гофрированный с двумя втулками А-17-60

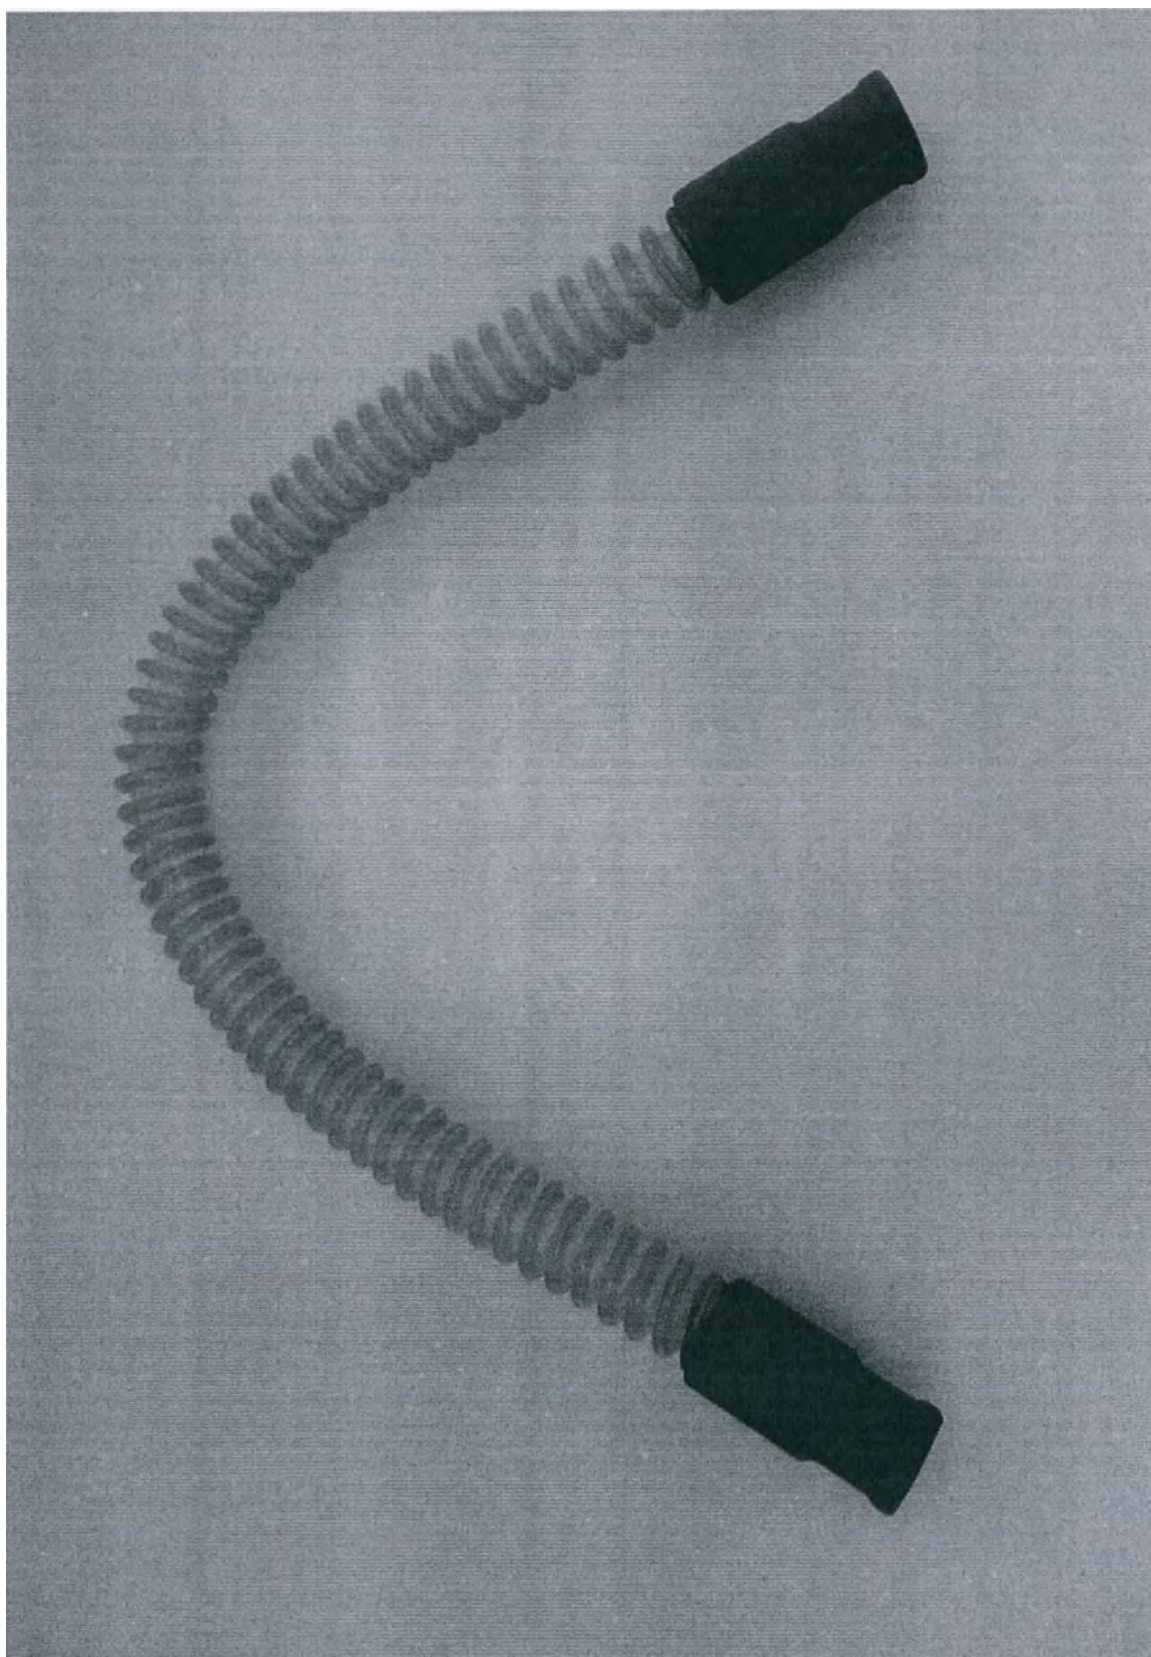

Шланг гофрированный с двумя втулками А-22-60

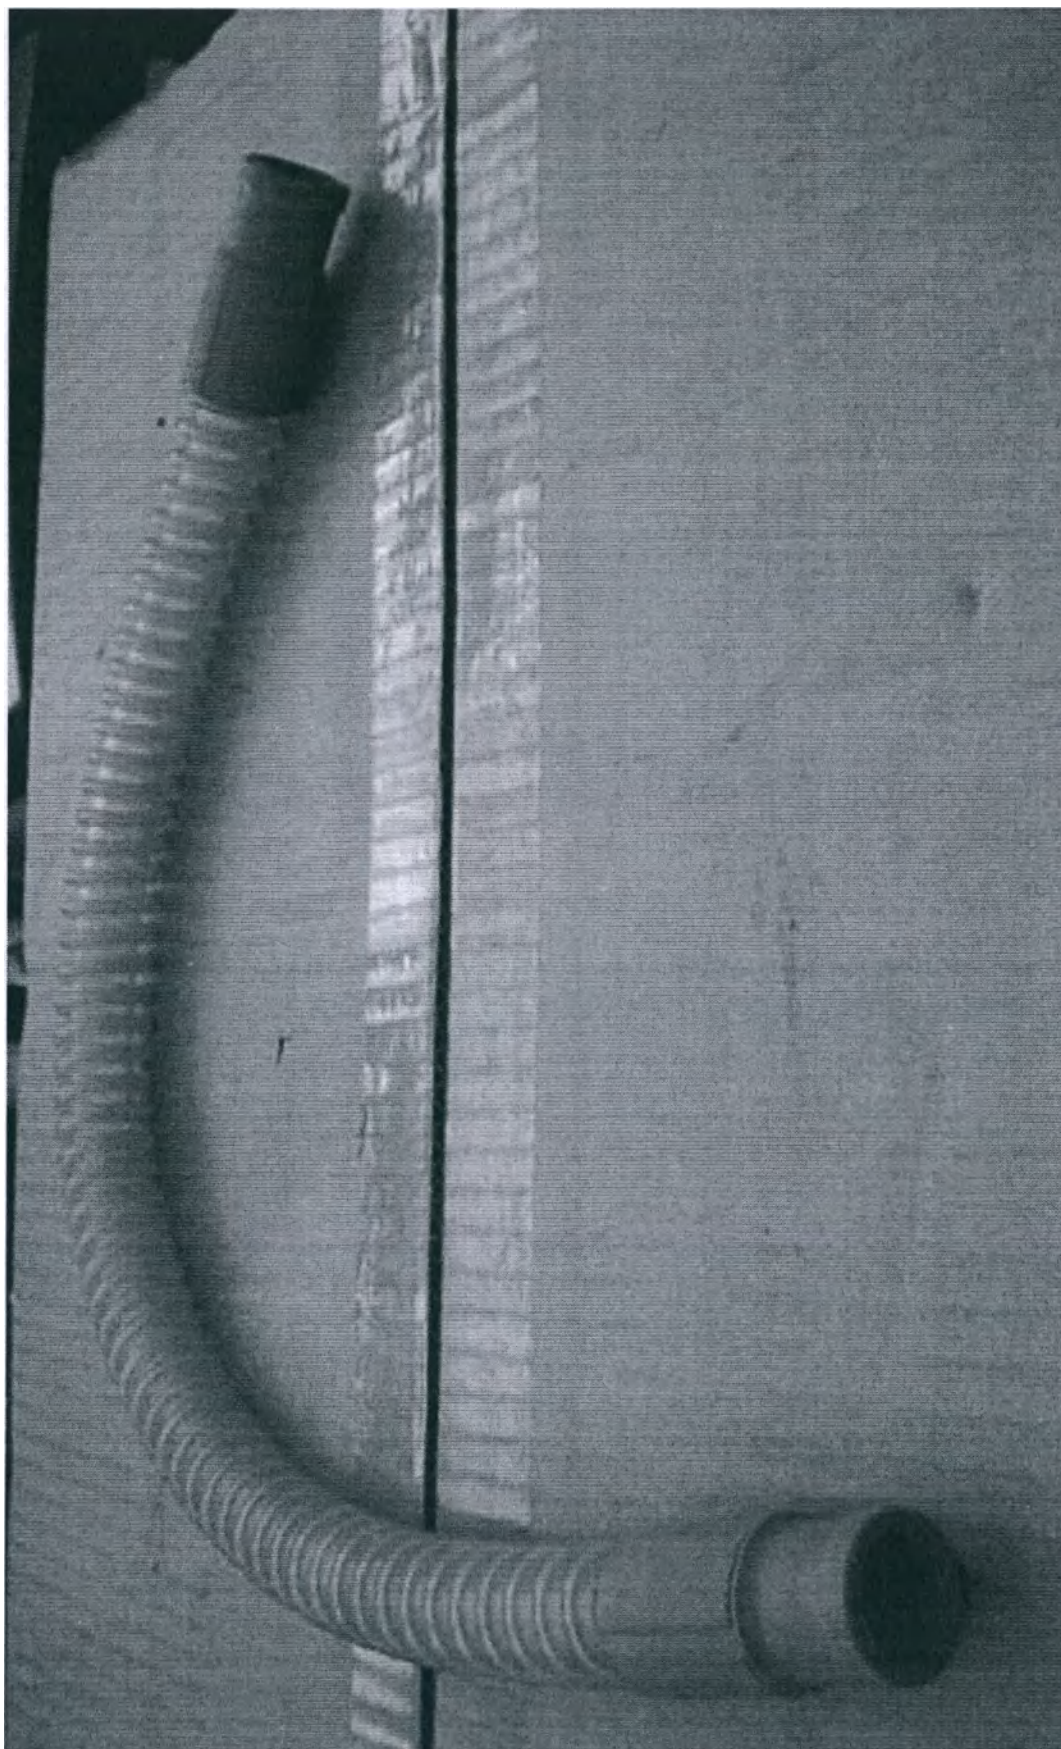


Шланг гофрированный с двумя втулками А-17-80 (при необходимости)




Блок активной эвакуации отработанных газов, (при необходимости)




Шланг блока активной эвакуации отработанных газов, (при необходимости)

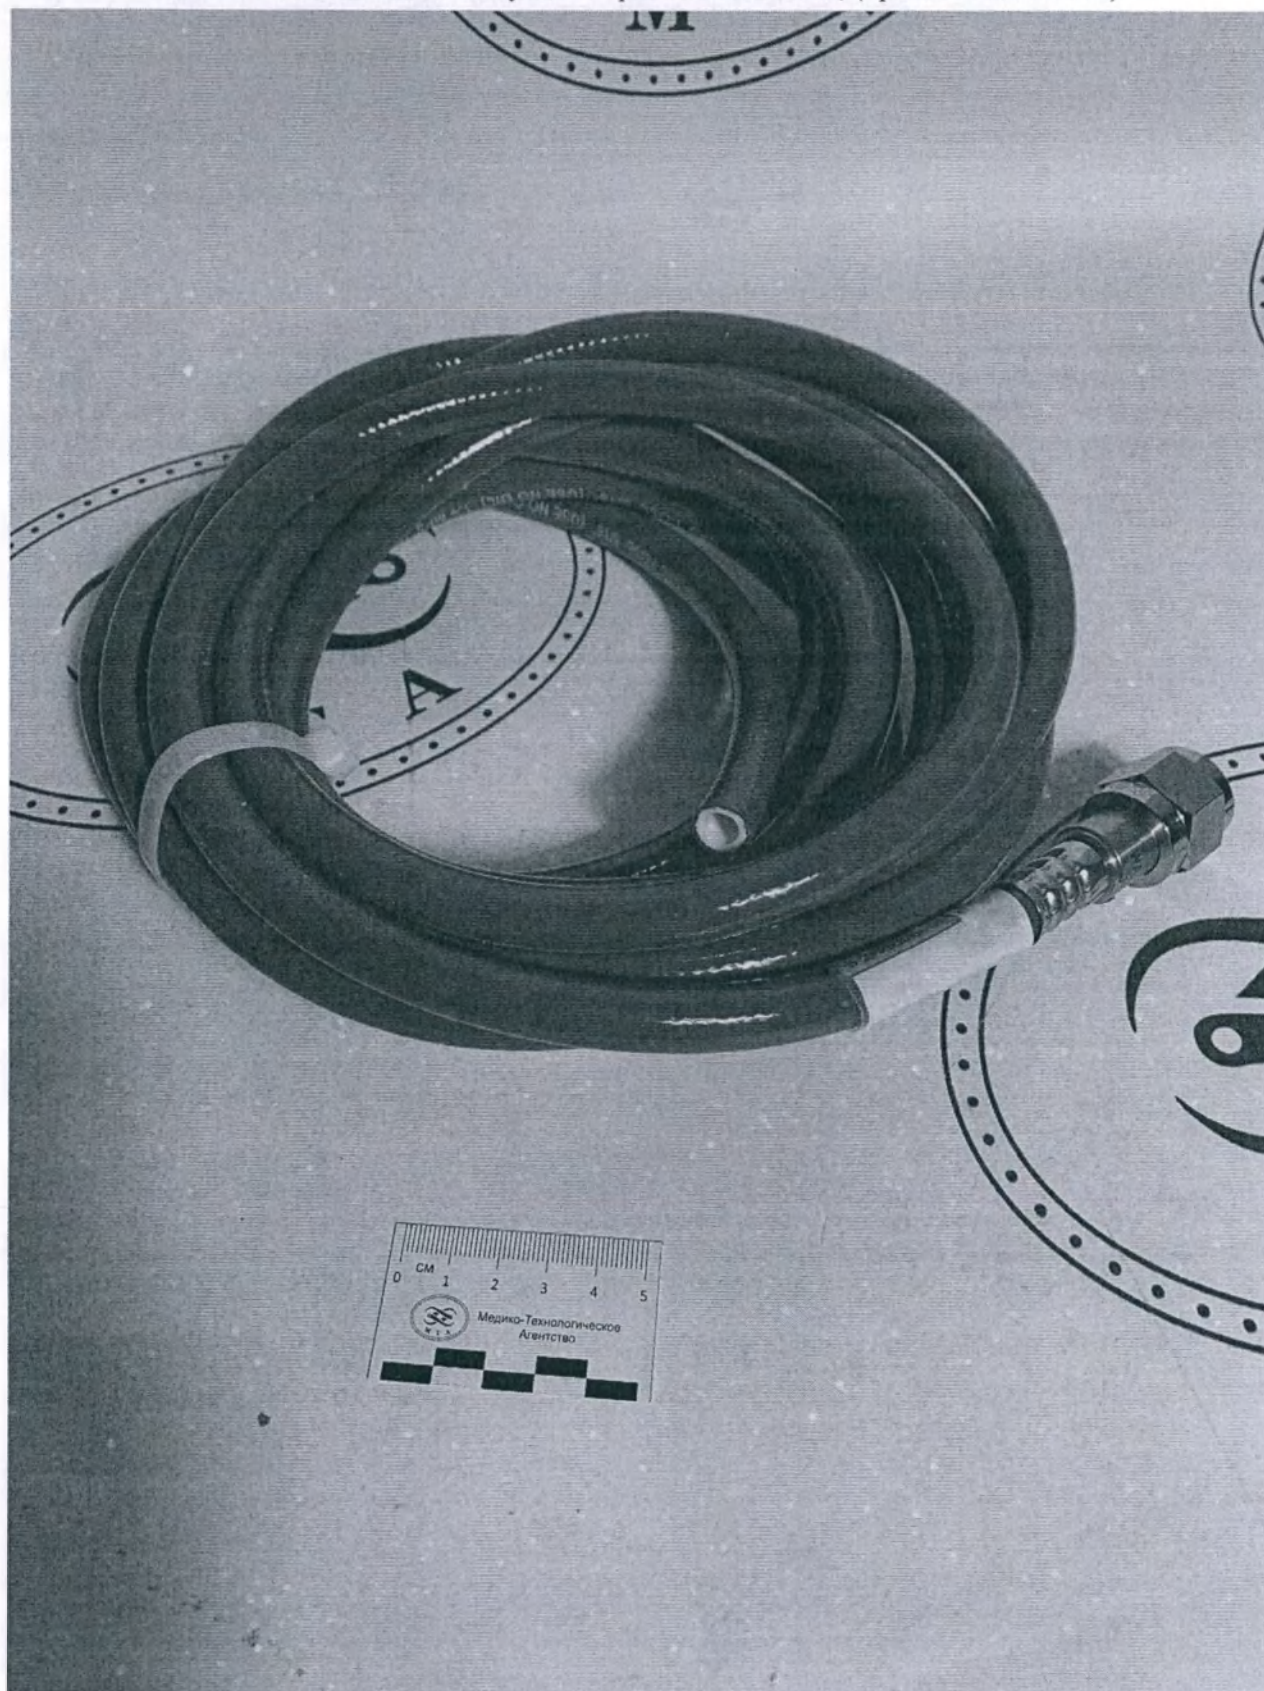


Переходник для блока активной эвакуации отработанных газов

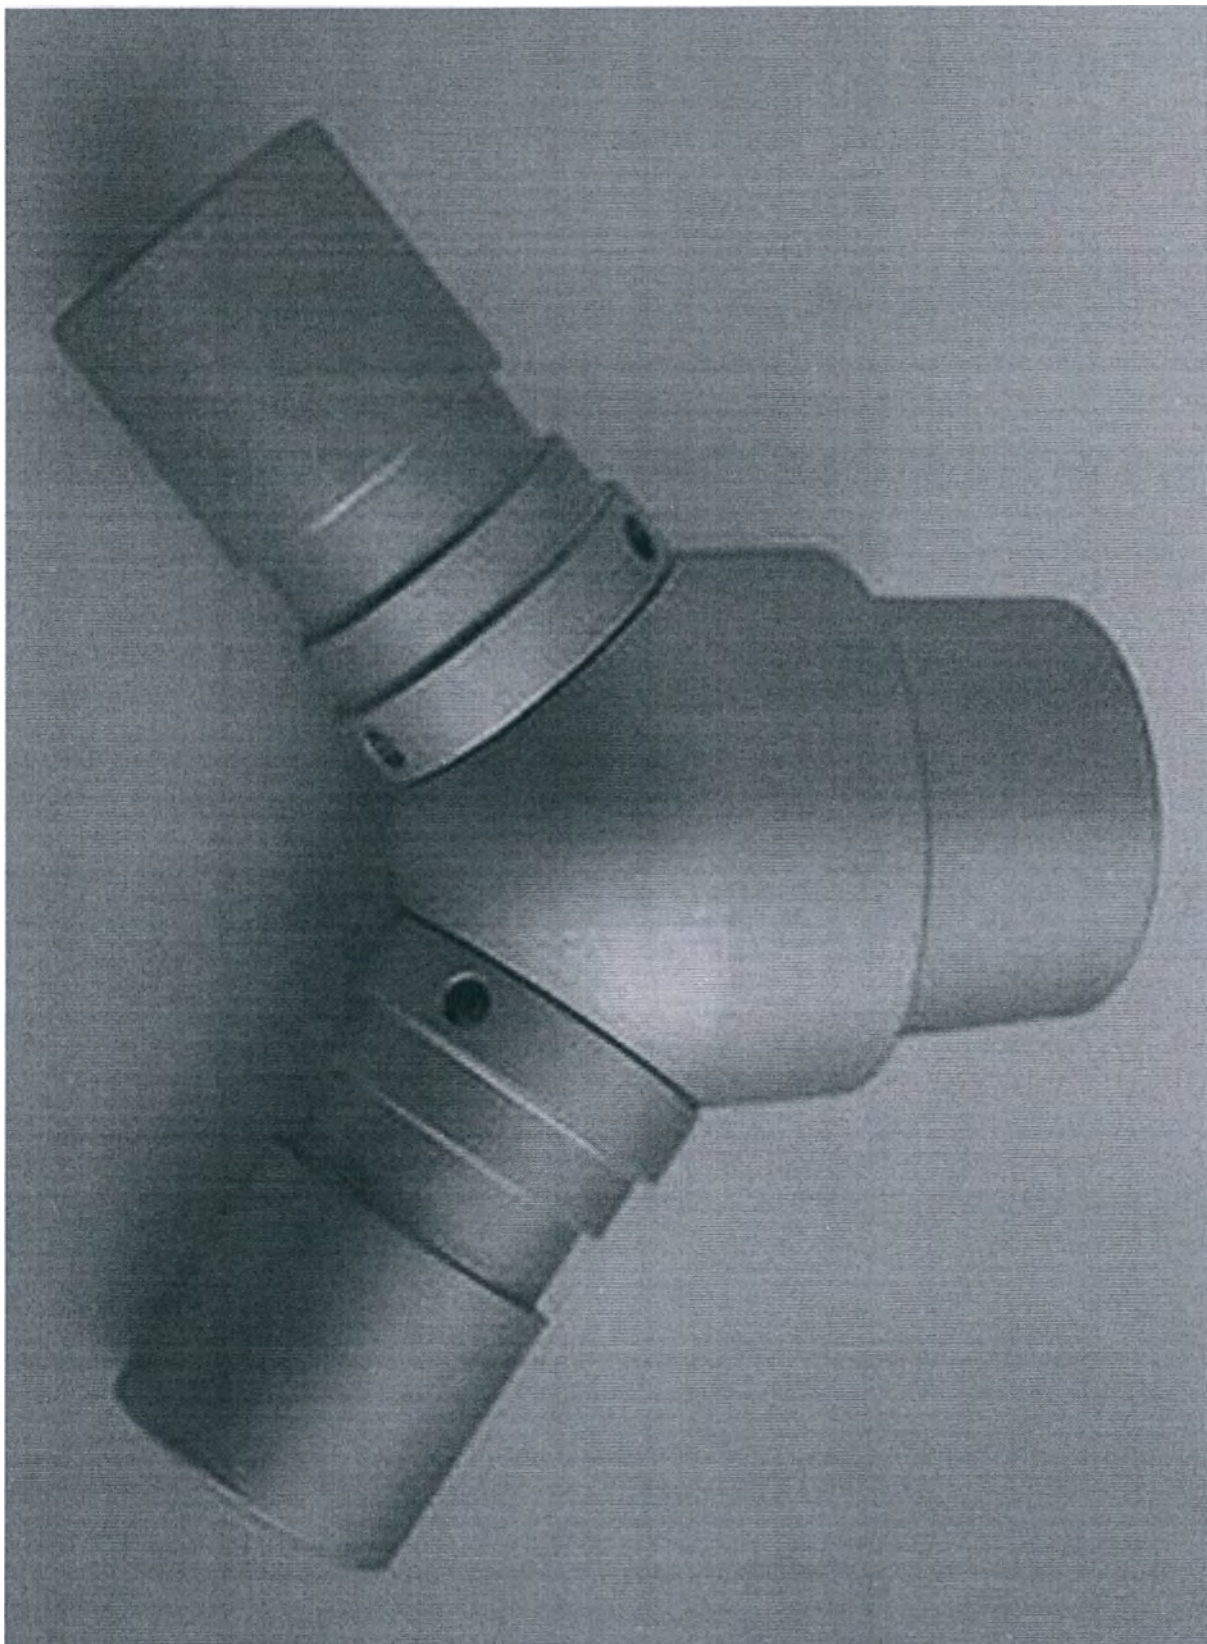


Набор для капнографии (датчик капнографии; адаптер воздушный; фиксатор датчика капнографии) (при необходимости)

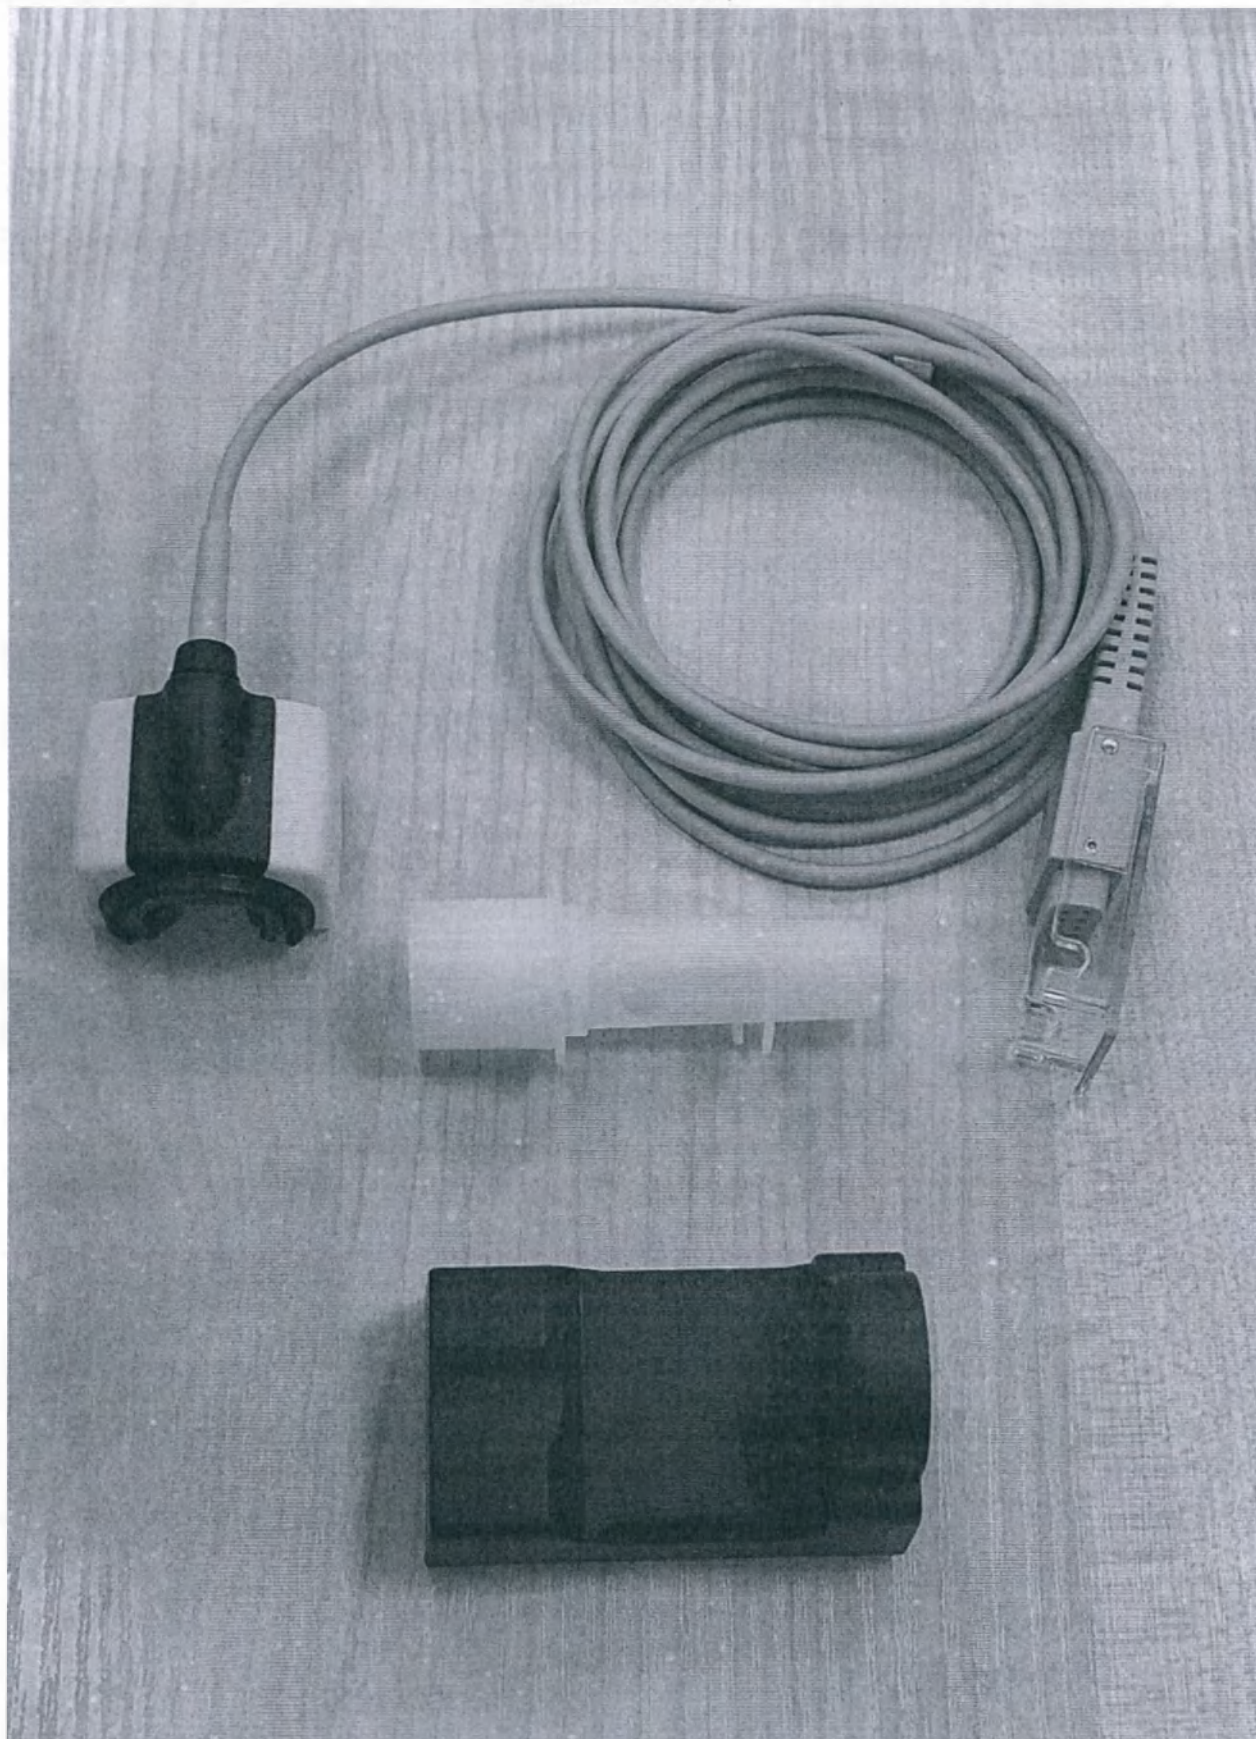


Датчик измерения мультигаса в основном потоке (IRMA AX+) (при необходимости)

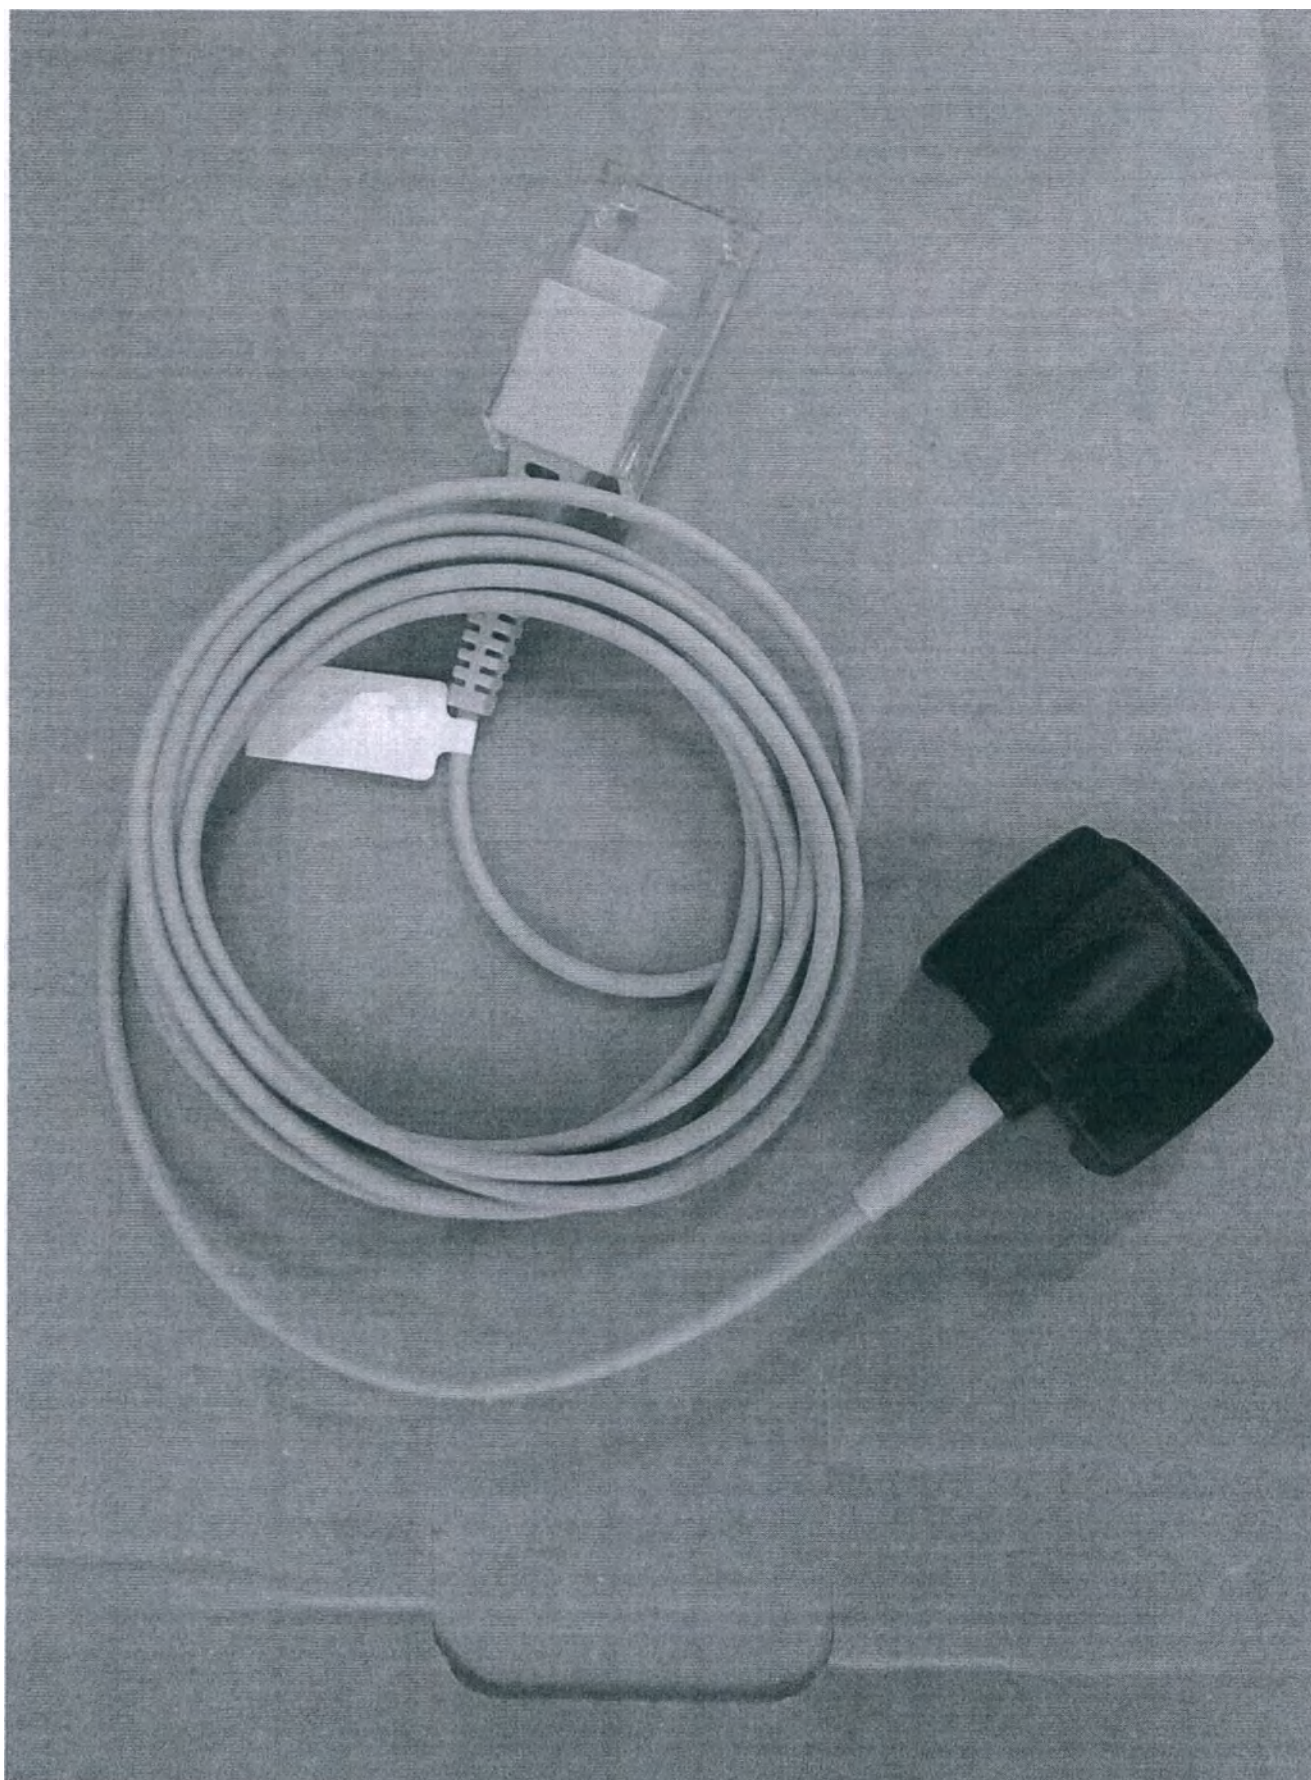

Шланг дыхательный детский (при необходимости)

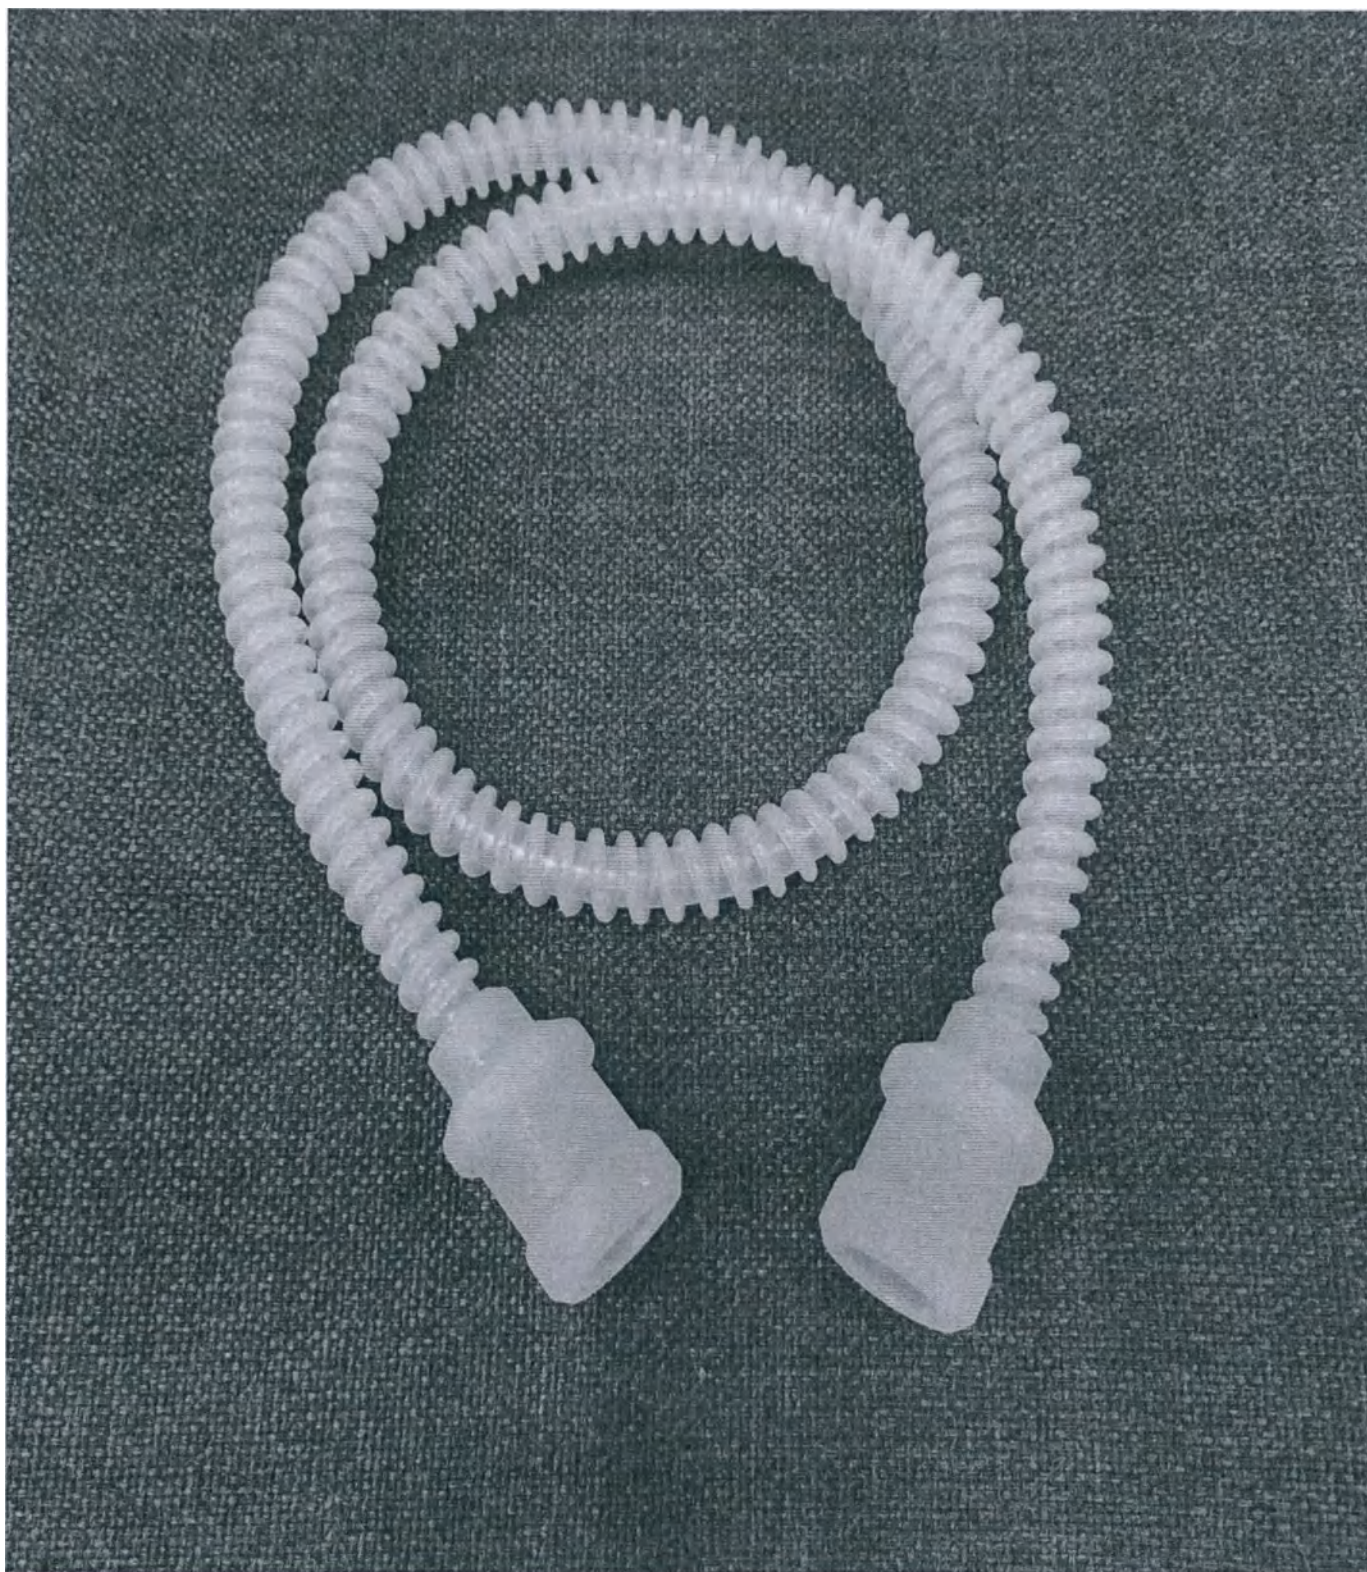

Лицевые маски (взрослые, детские) (при необходимости)

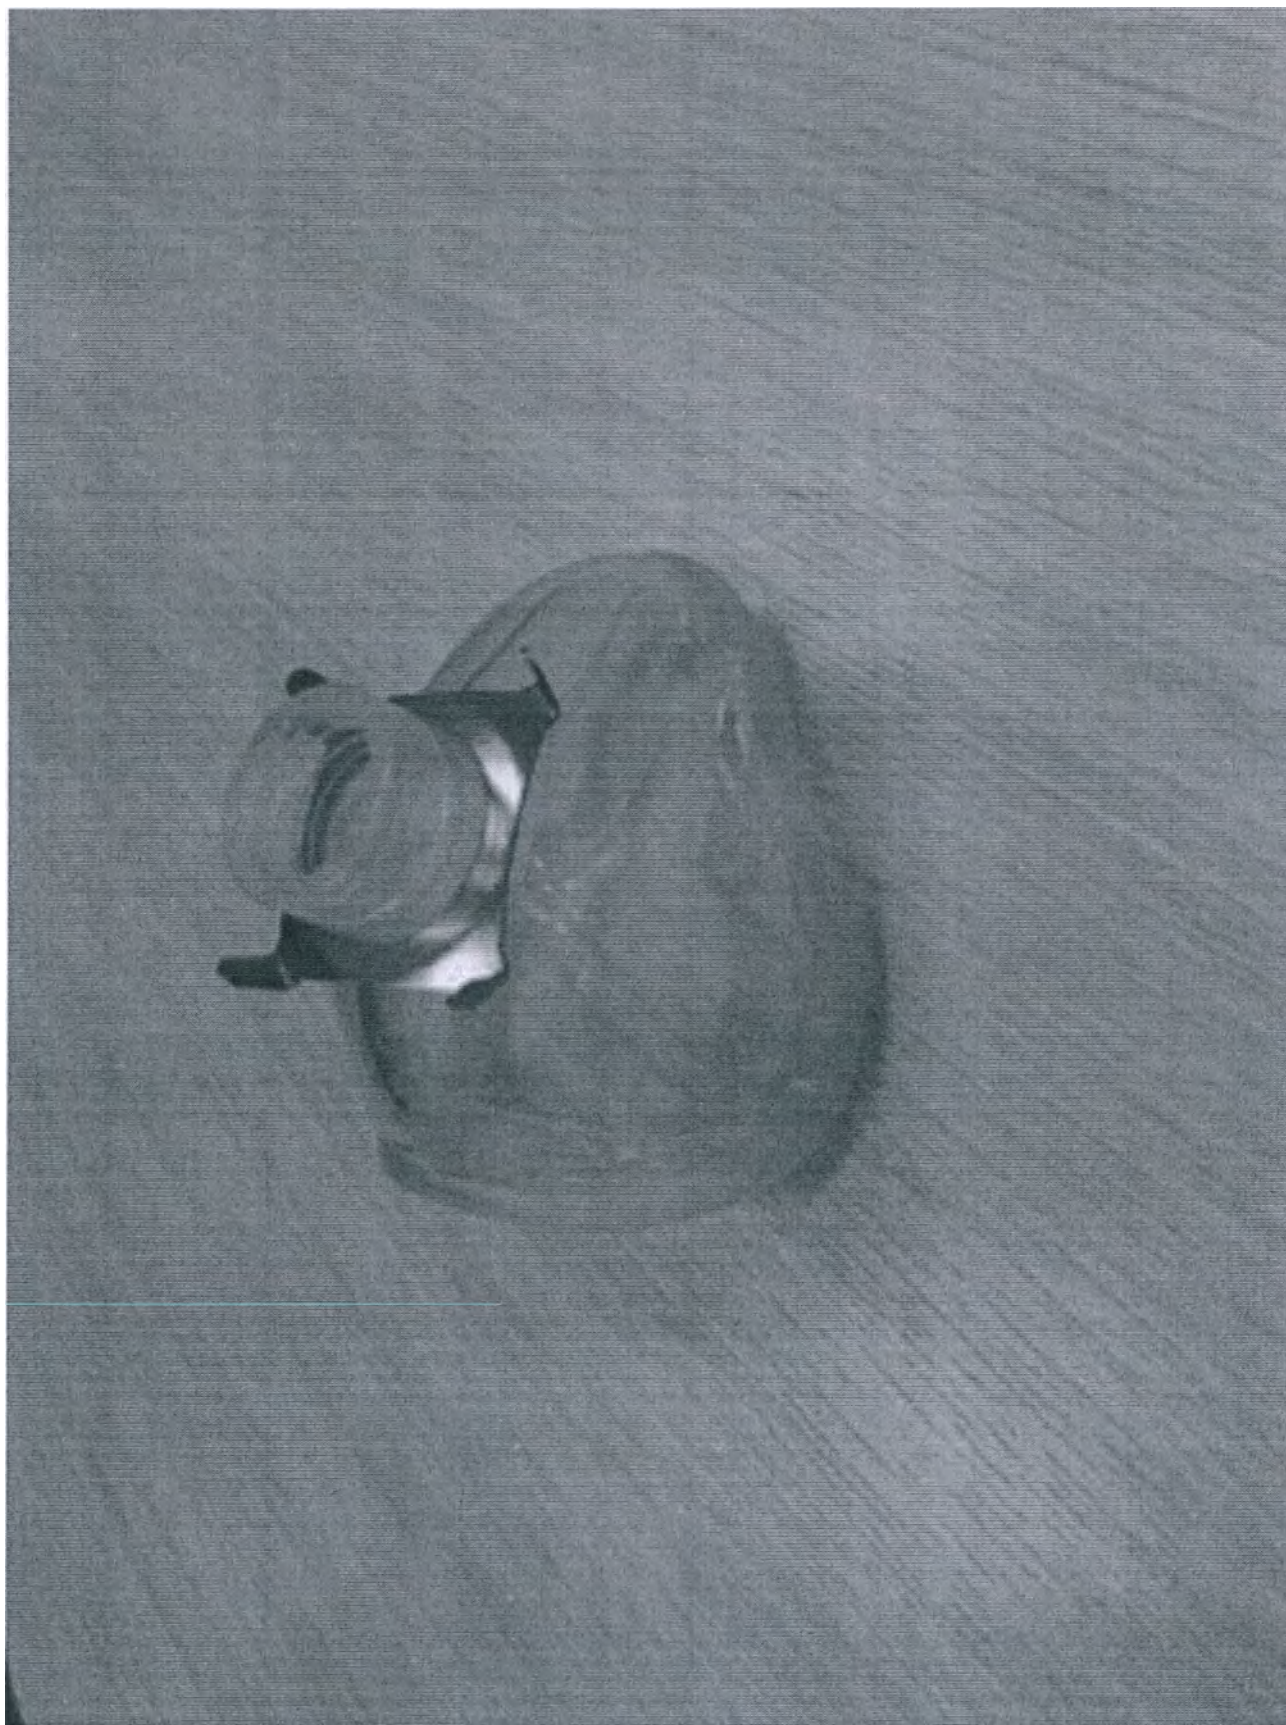

Предохранитель плавкий Т2АН250VАС (КФИП.944460.004.009) (при необходимости)




Предохранитель плавкий F10AH250VAC (КФИП.944460.004.010) (при необходимости)




Кольцо уплотнительное сменное, размер 14х2,65 мм (КФИП.944460.004.022) (при необходимости)



Кольцо уплотнительное сменное, размер 9х1,8 мм (КФИП.944460.004.023) (при необходимости)

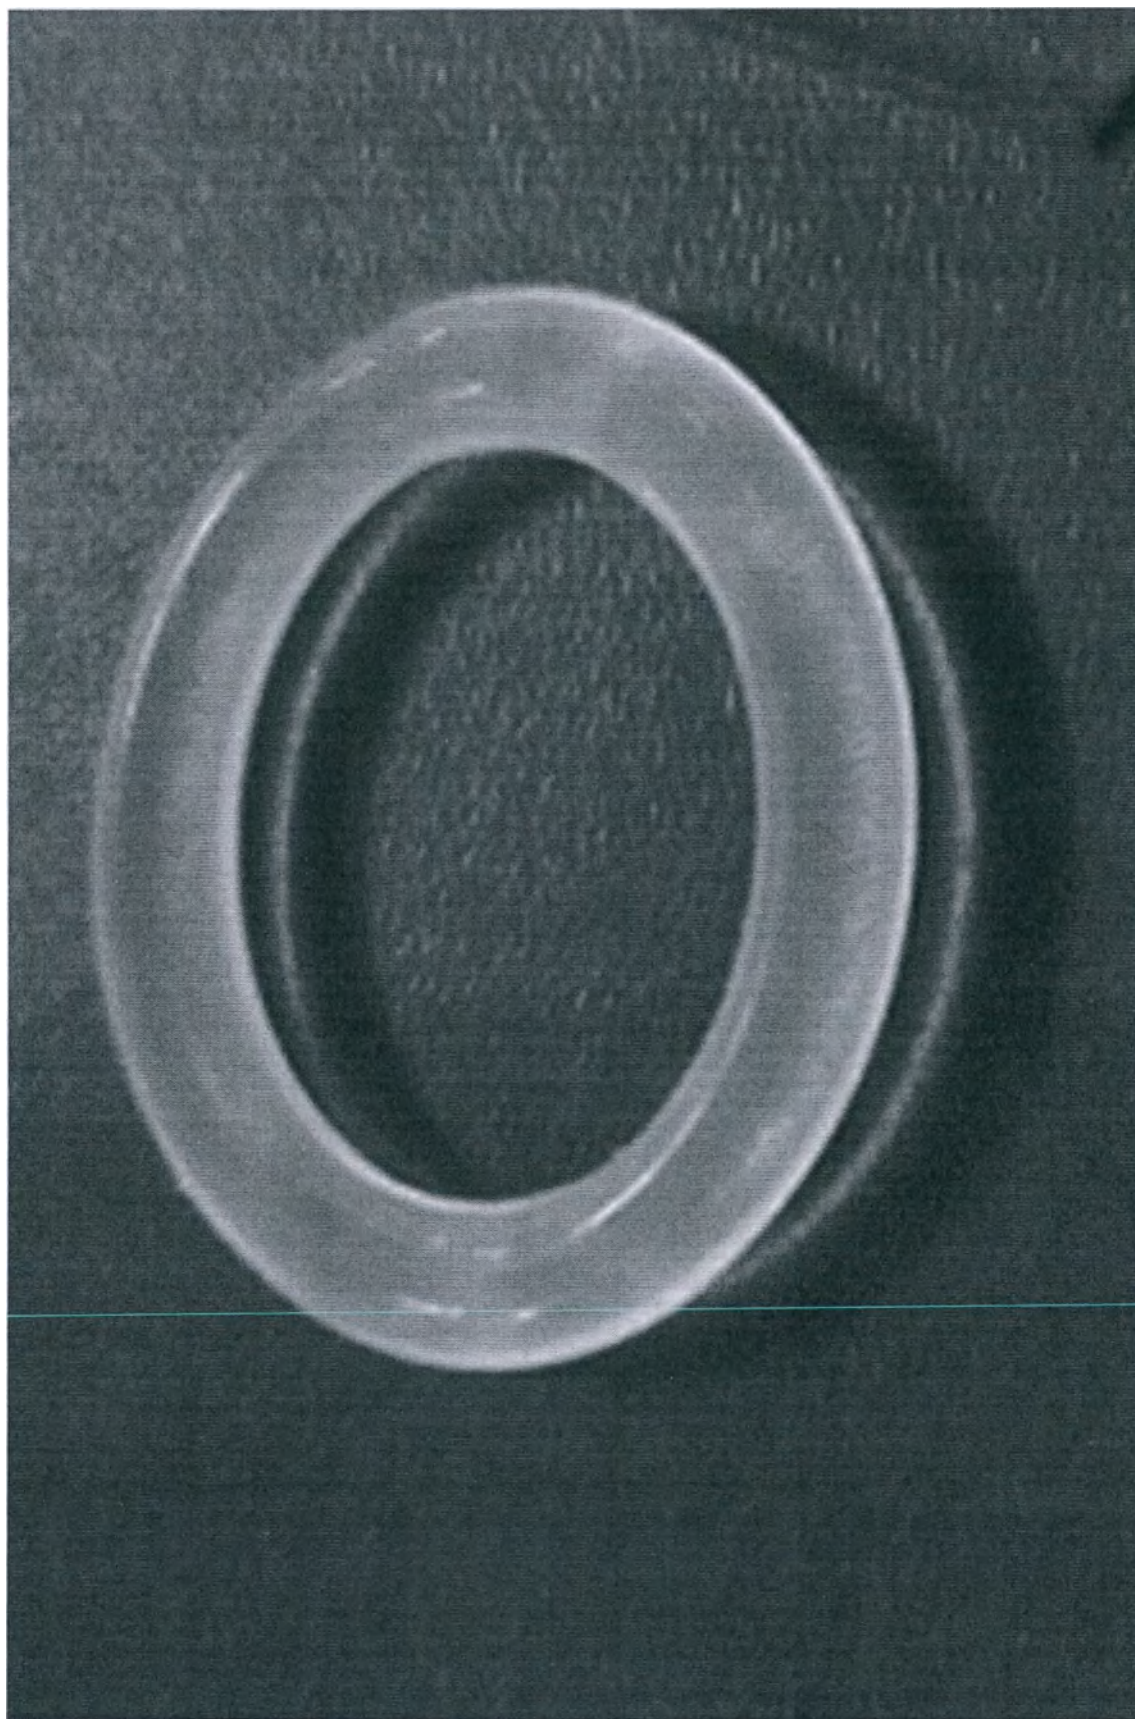

Кольцо уплотнительное сменное, размер 18х1,8 мм (КФИП.944460.004.024) (при необходимости)

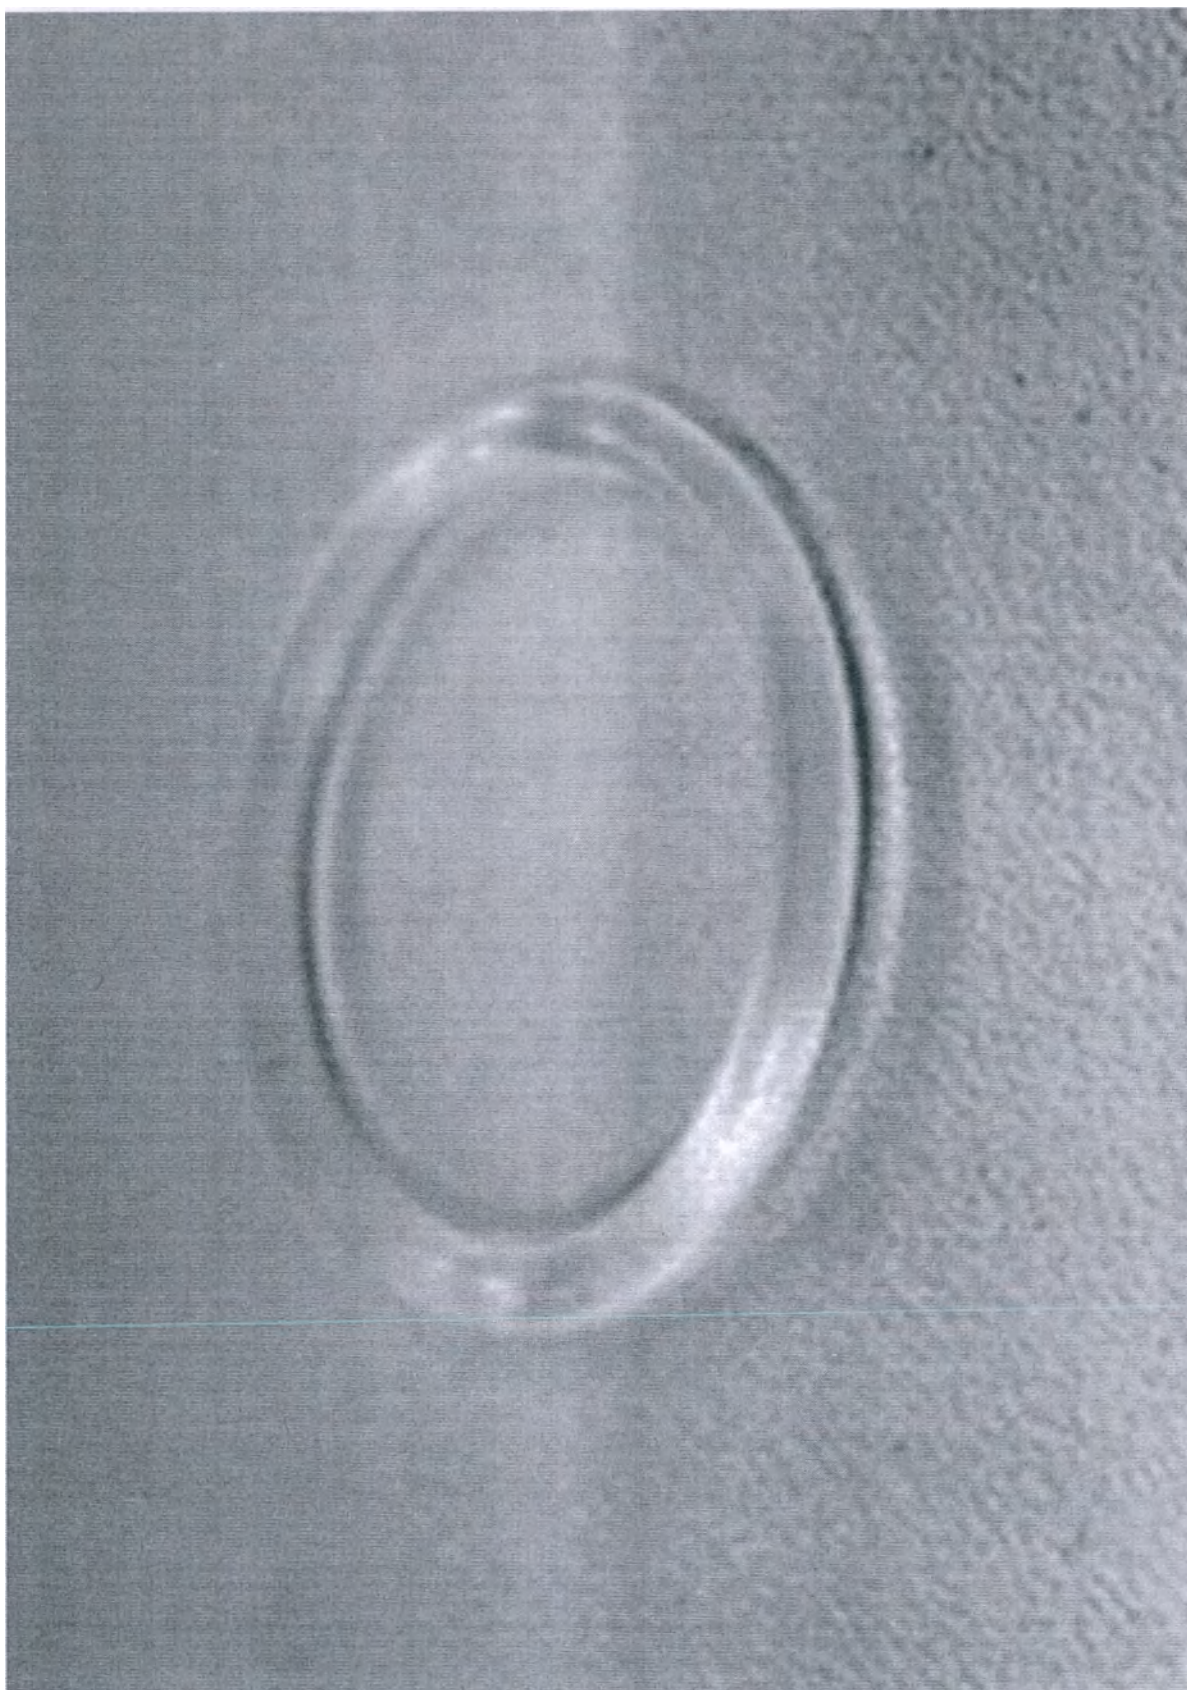


Кольцо уплотнительное сменное, размер 20х1,8 мм (КФИП.944460.004.025) (при необходимости)




Компрессор медицинского воздуха, (при необходимости)



Кабель питания компрессора медицинского воздуха, (при необходимости)

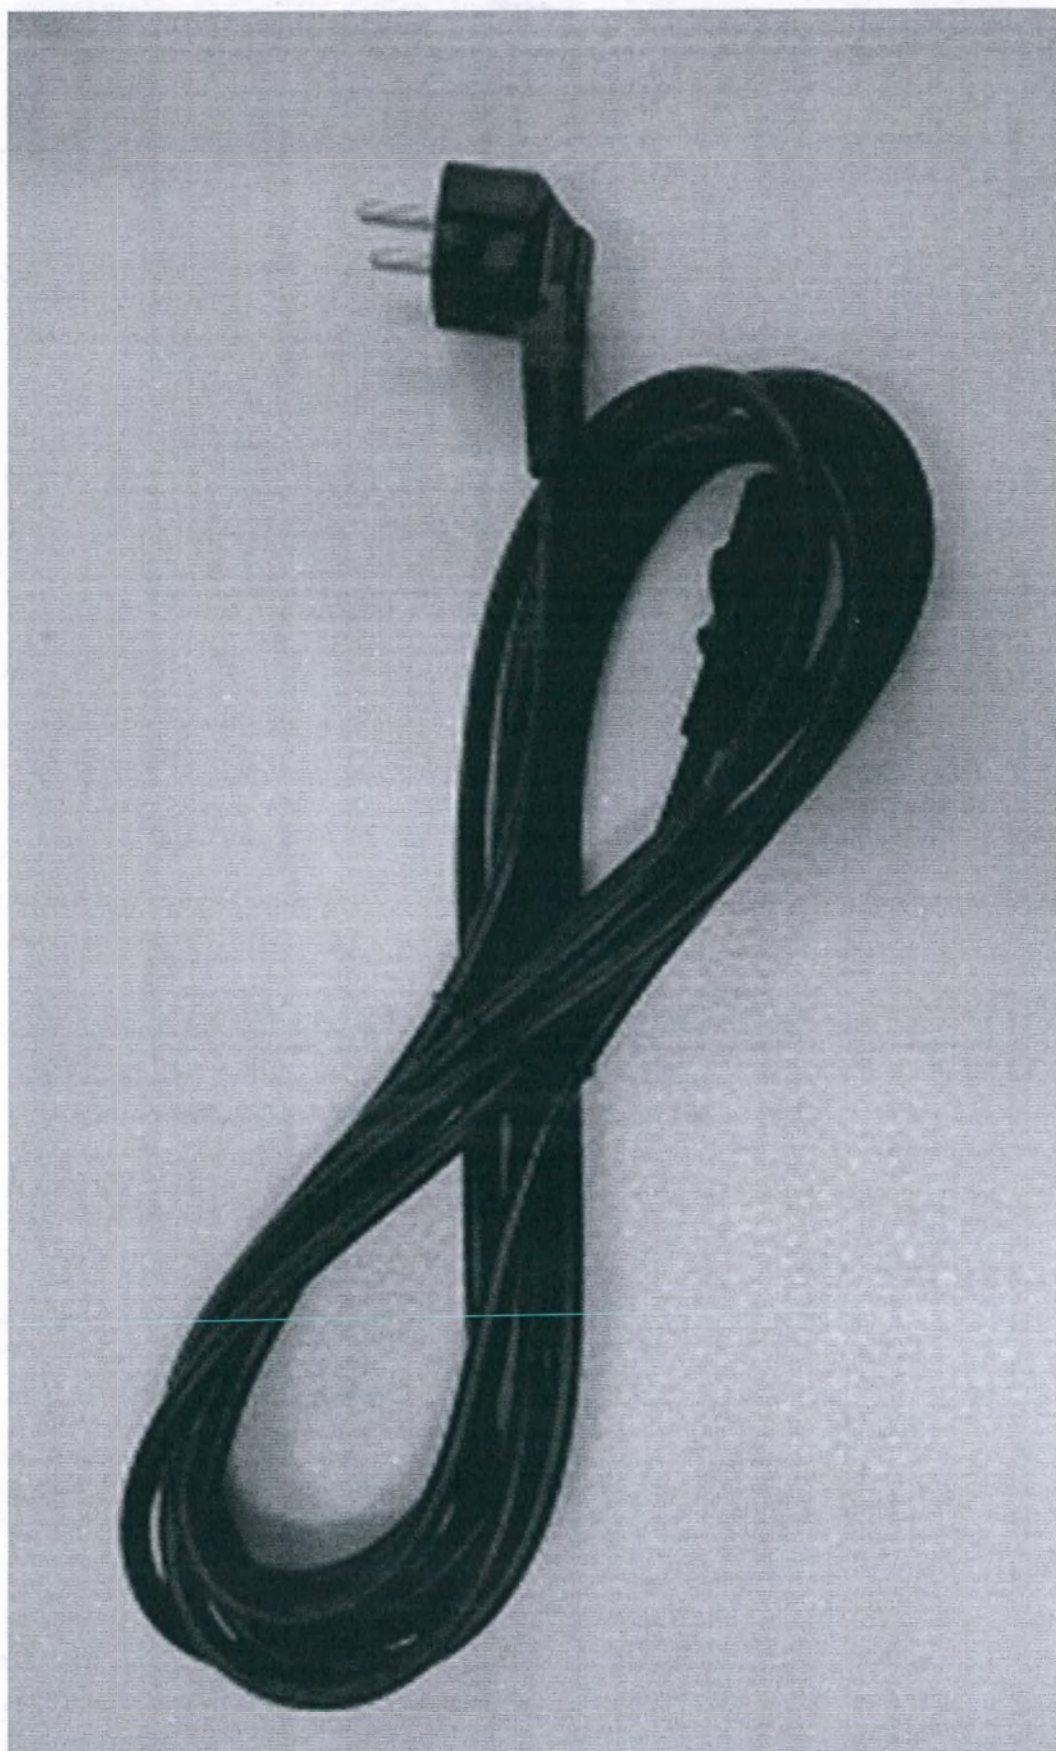


Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 по ТУ 26.60.12-018-32119398-2018
(при необходимости);

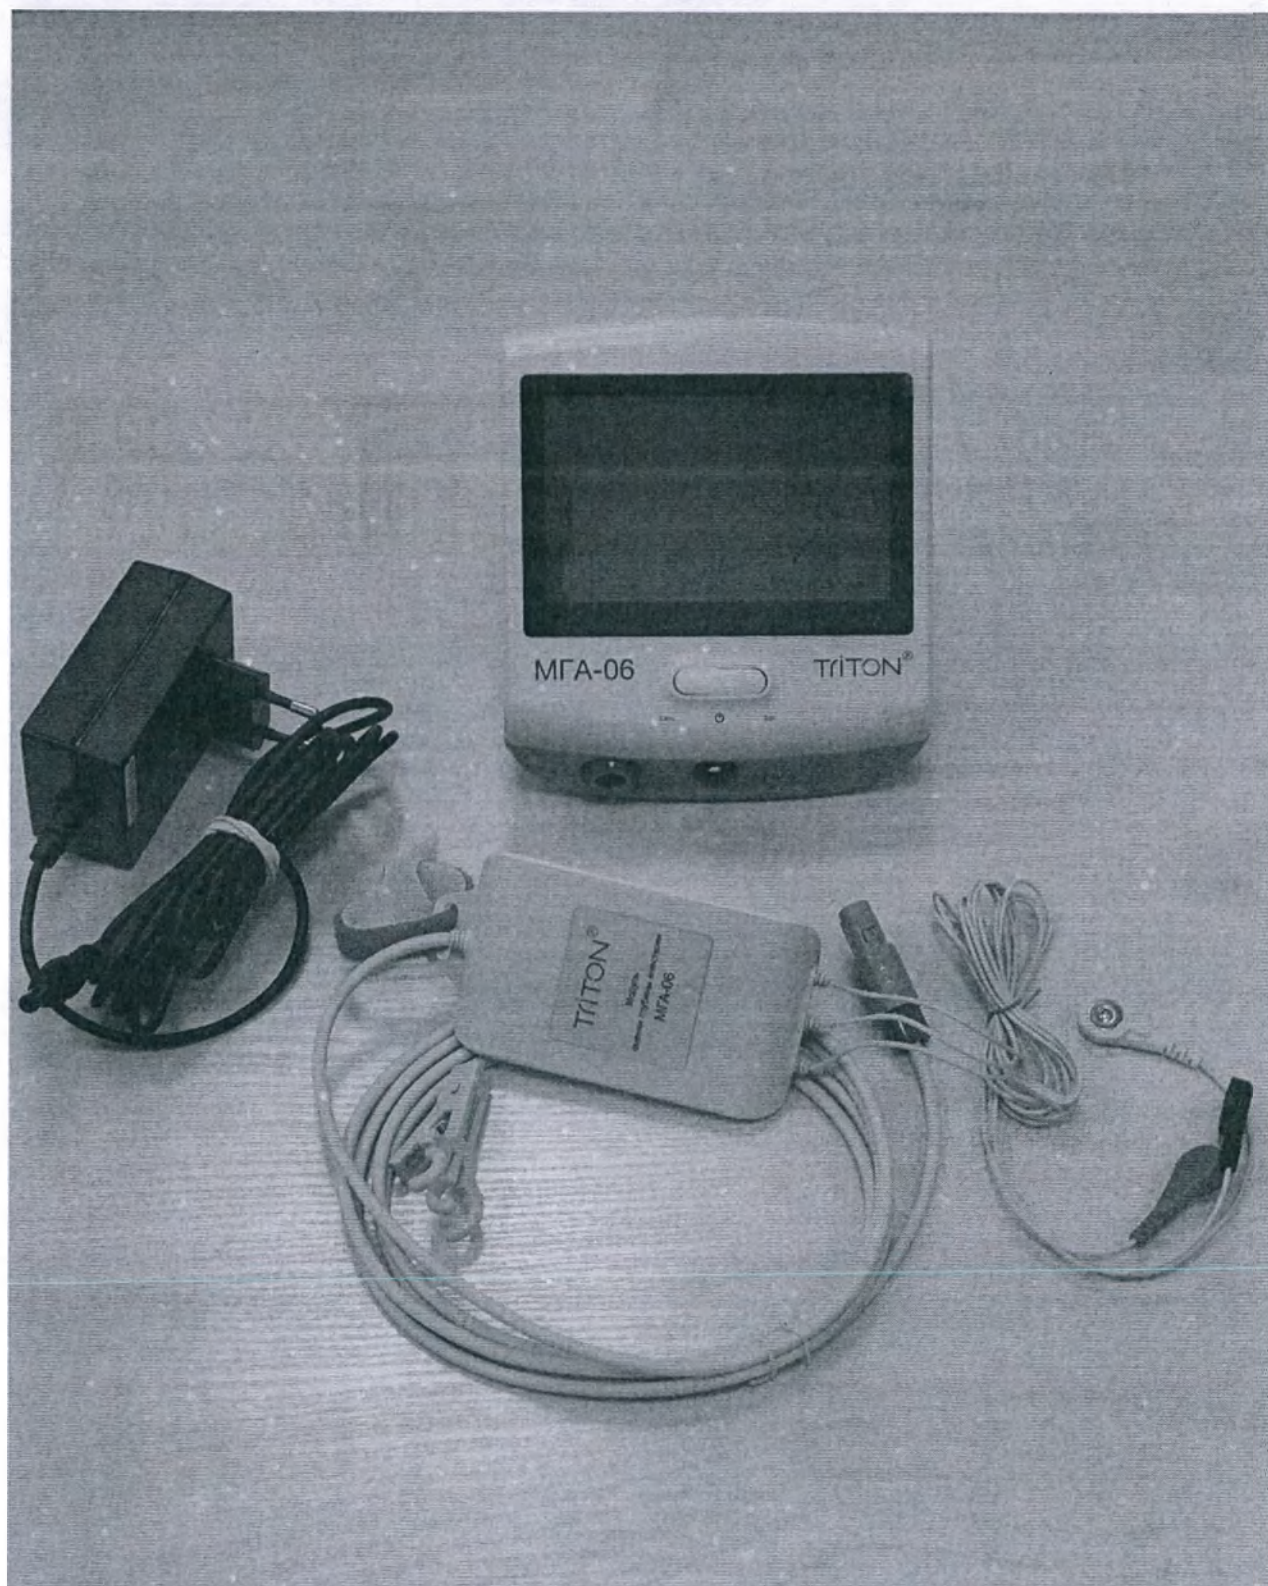

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
41 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»
Яковлев А.А.

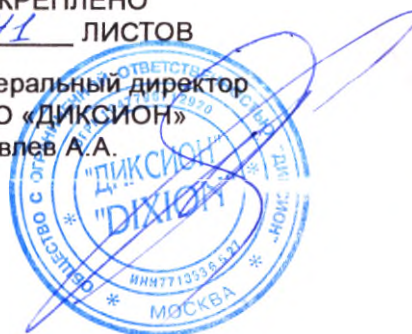

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»

24.12.2021

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)




DIXION


Фотографические изображения медицинского изделия

Комплексы анестезиологические «Практис»
по ТУ 32.50.21-007-74487176-2021, вариант исполнения
«Практис 3700»


Основной блок аппарата ингаляционной анестезии на тележке с тремя выдвижными ящиками, столиком и боковой полкой (КФИП.944460.004-02)

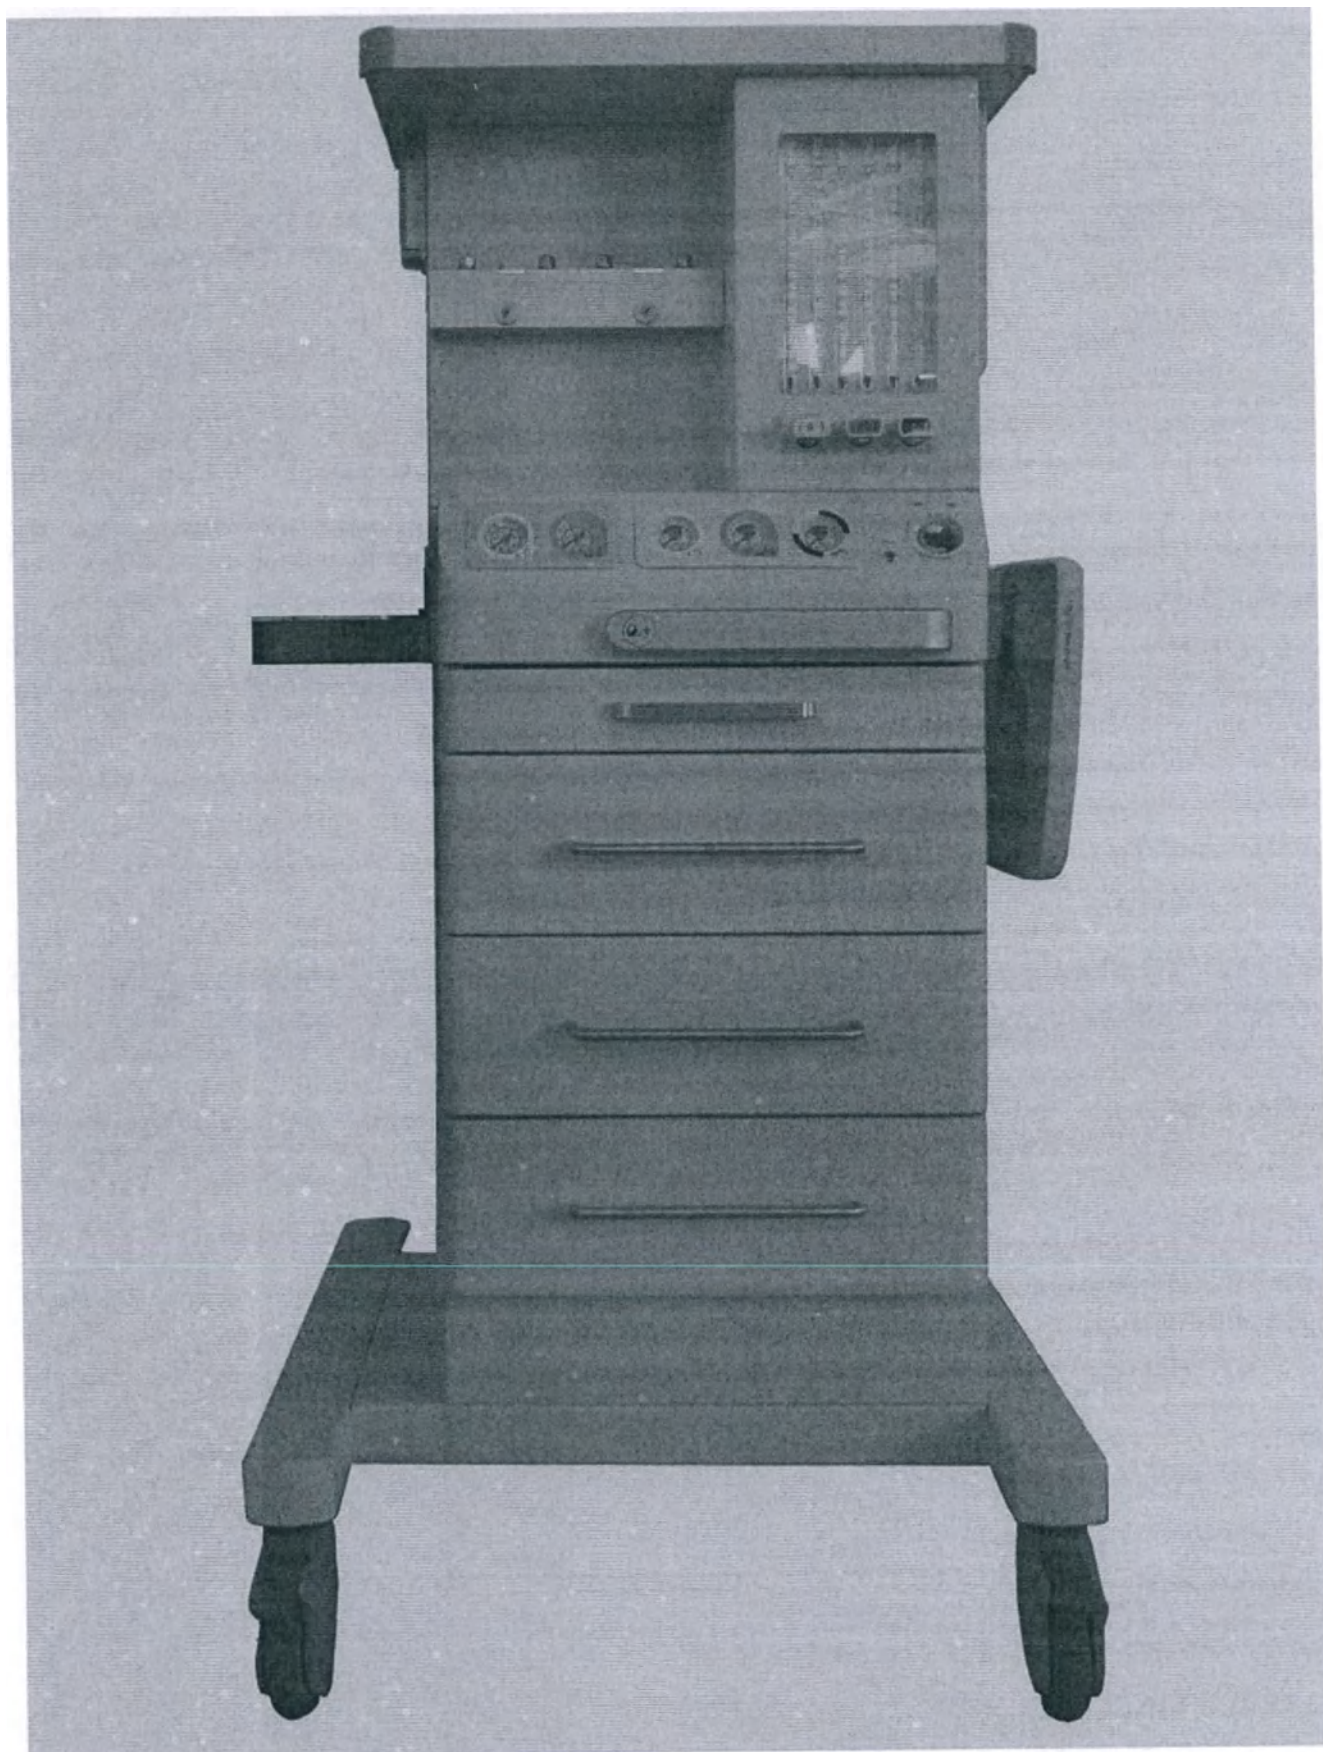


Блок дыхательной системы с абсорбером

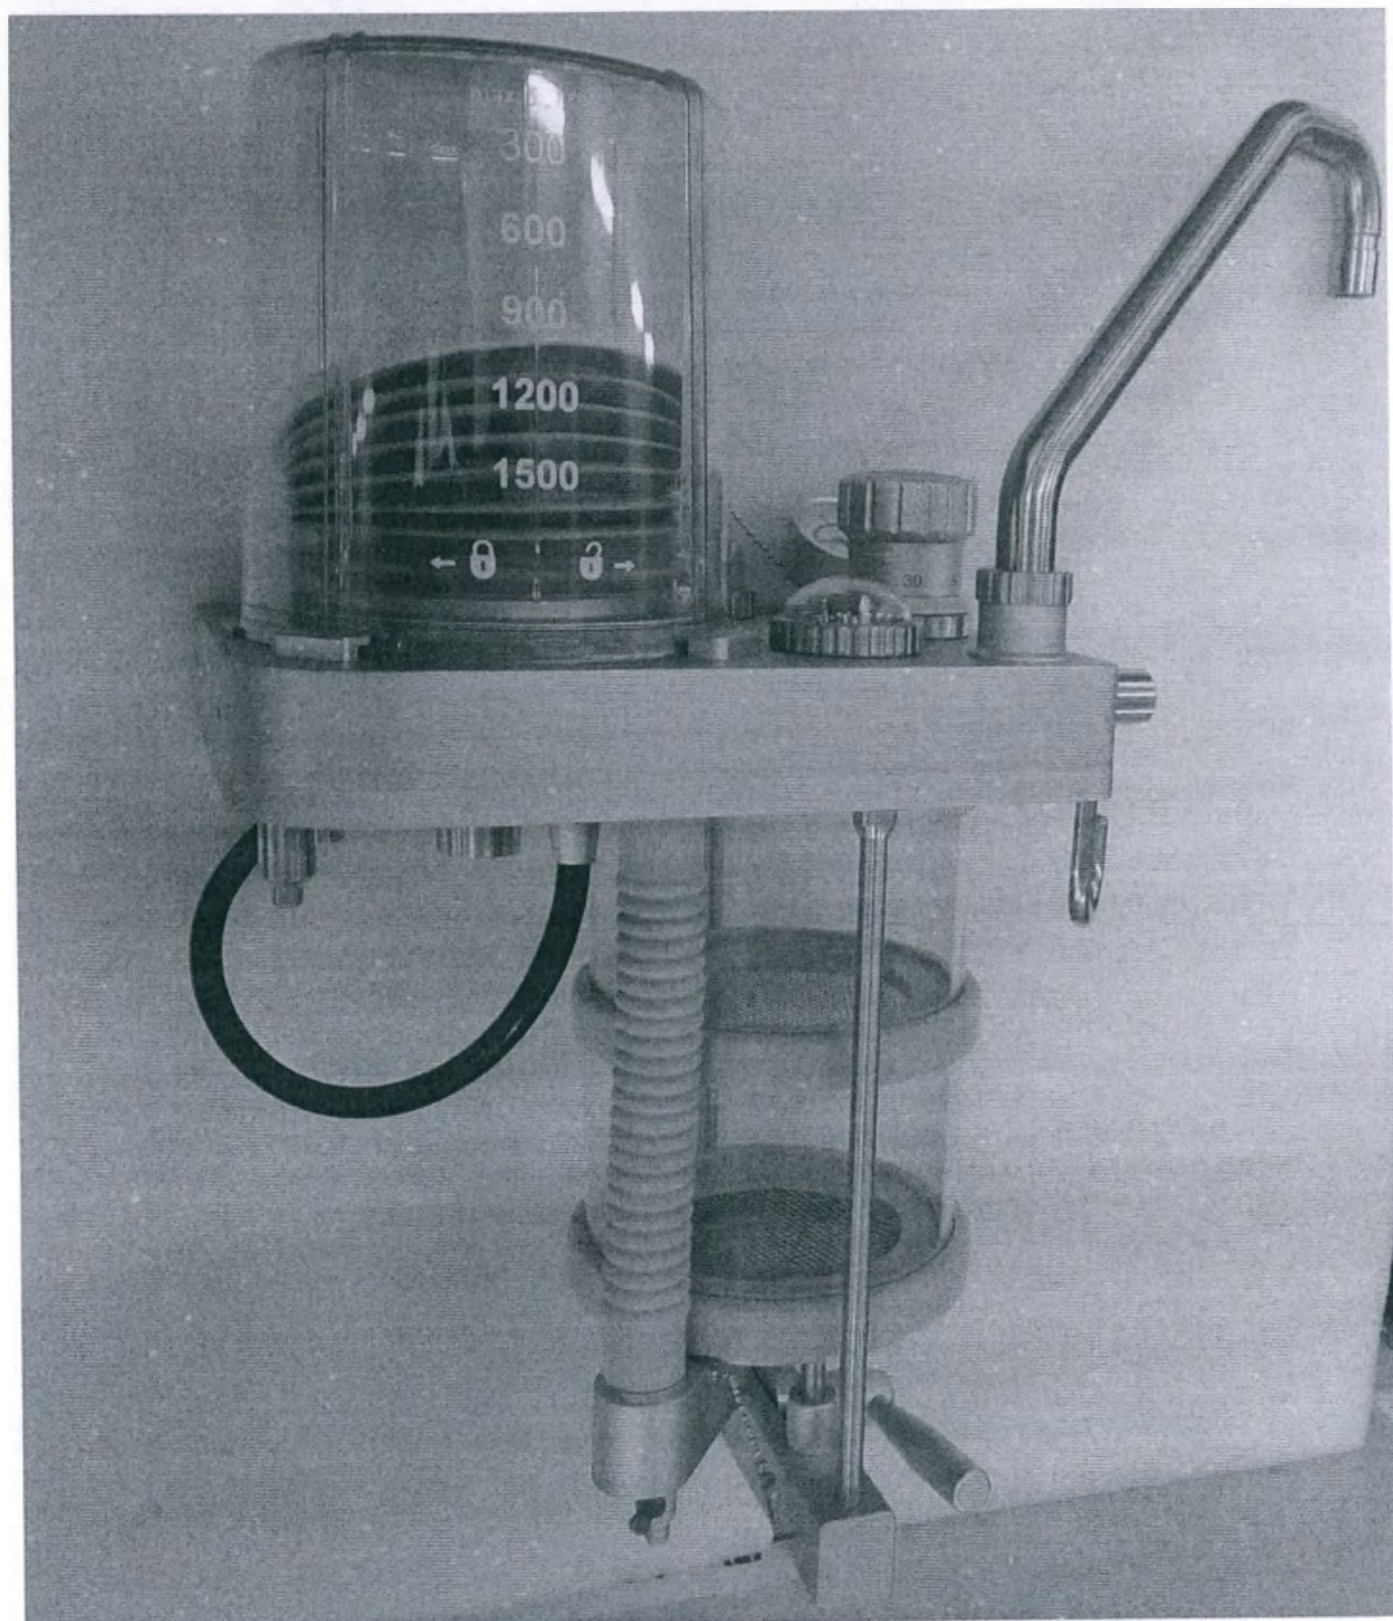

Кабель заземления (КФИП.944460.004.002)

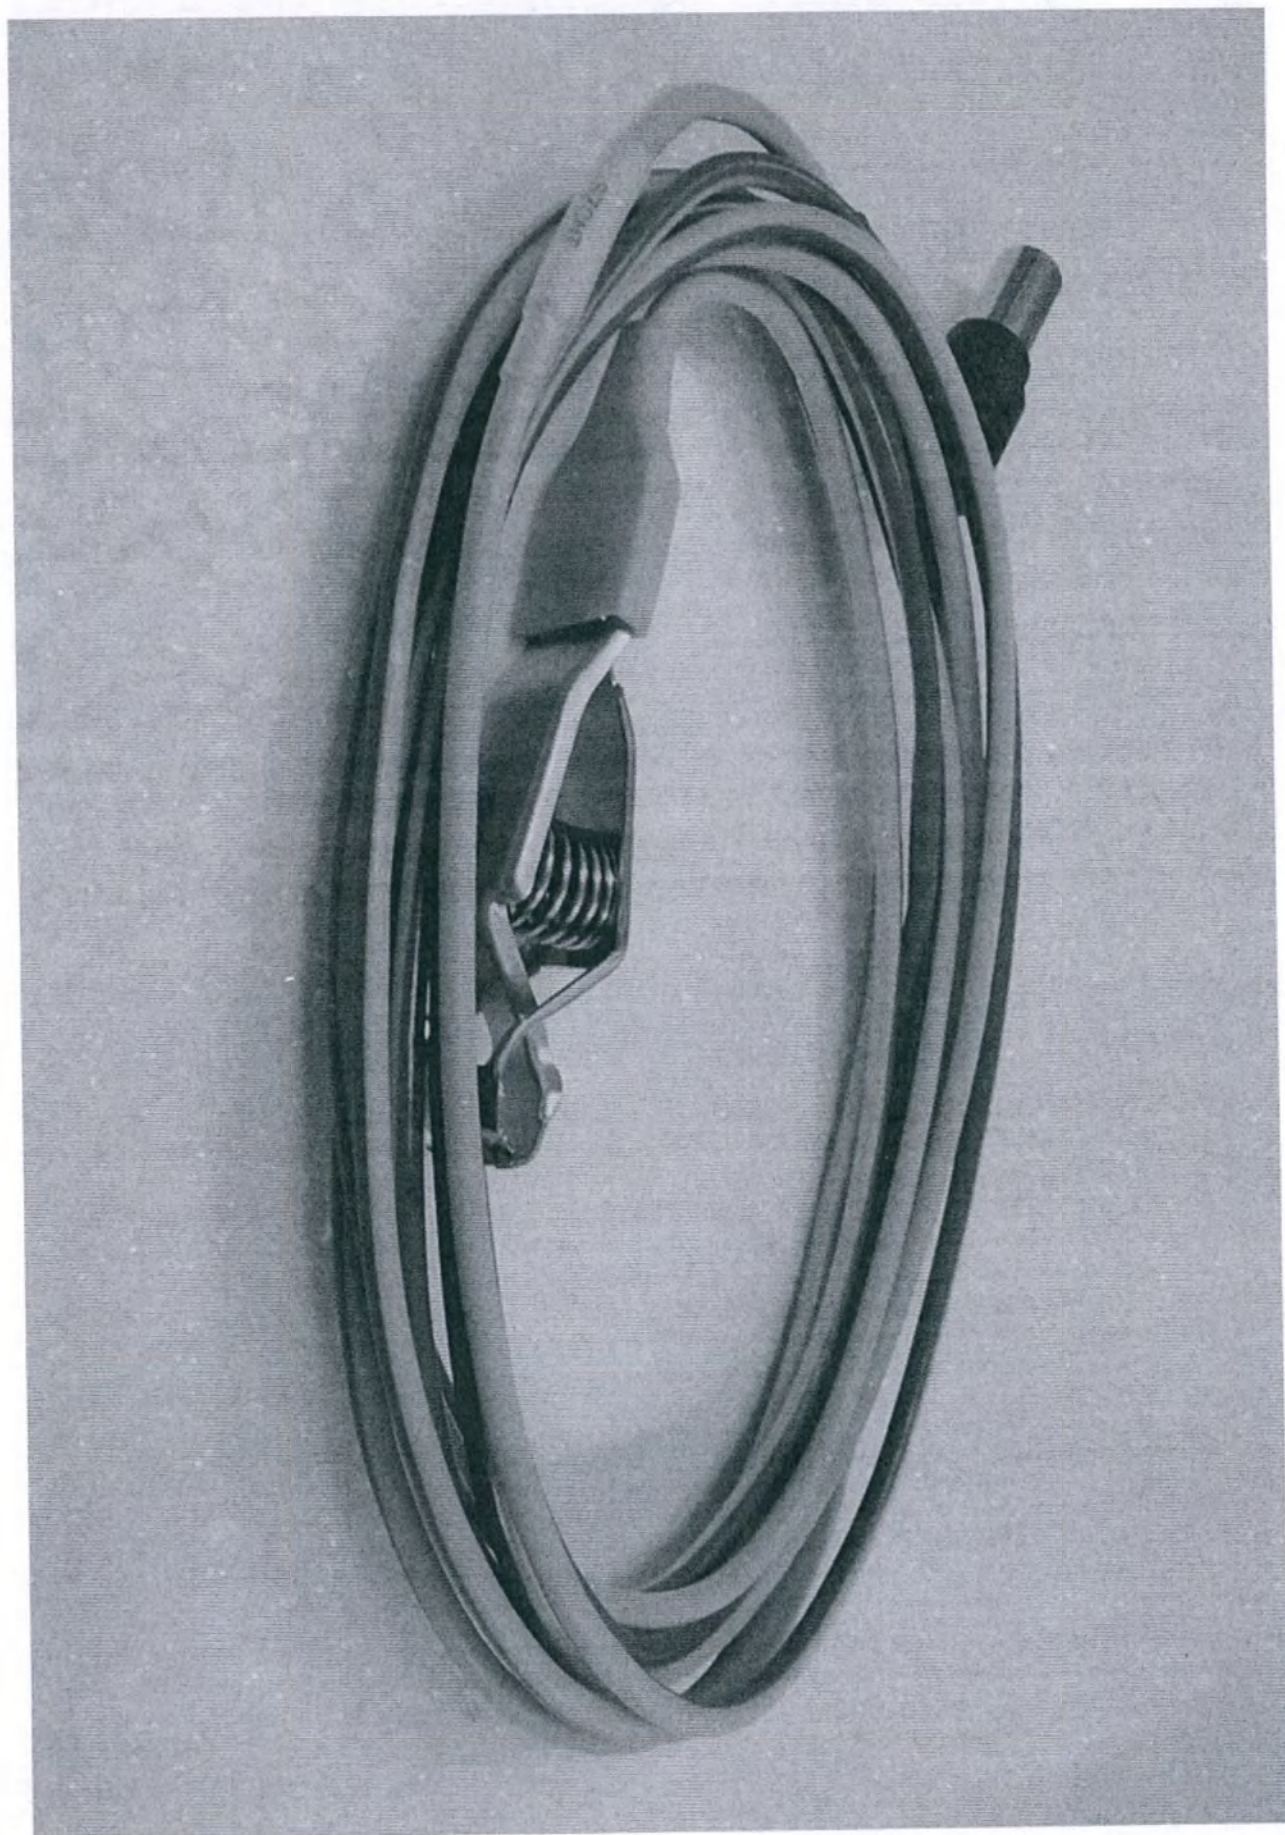

Испаритель анестетика (фторотан (галотан)), (при необходимости)

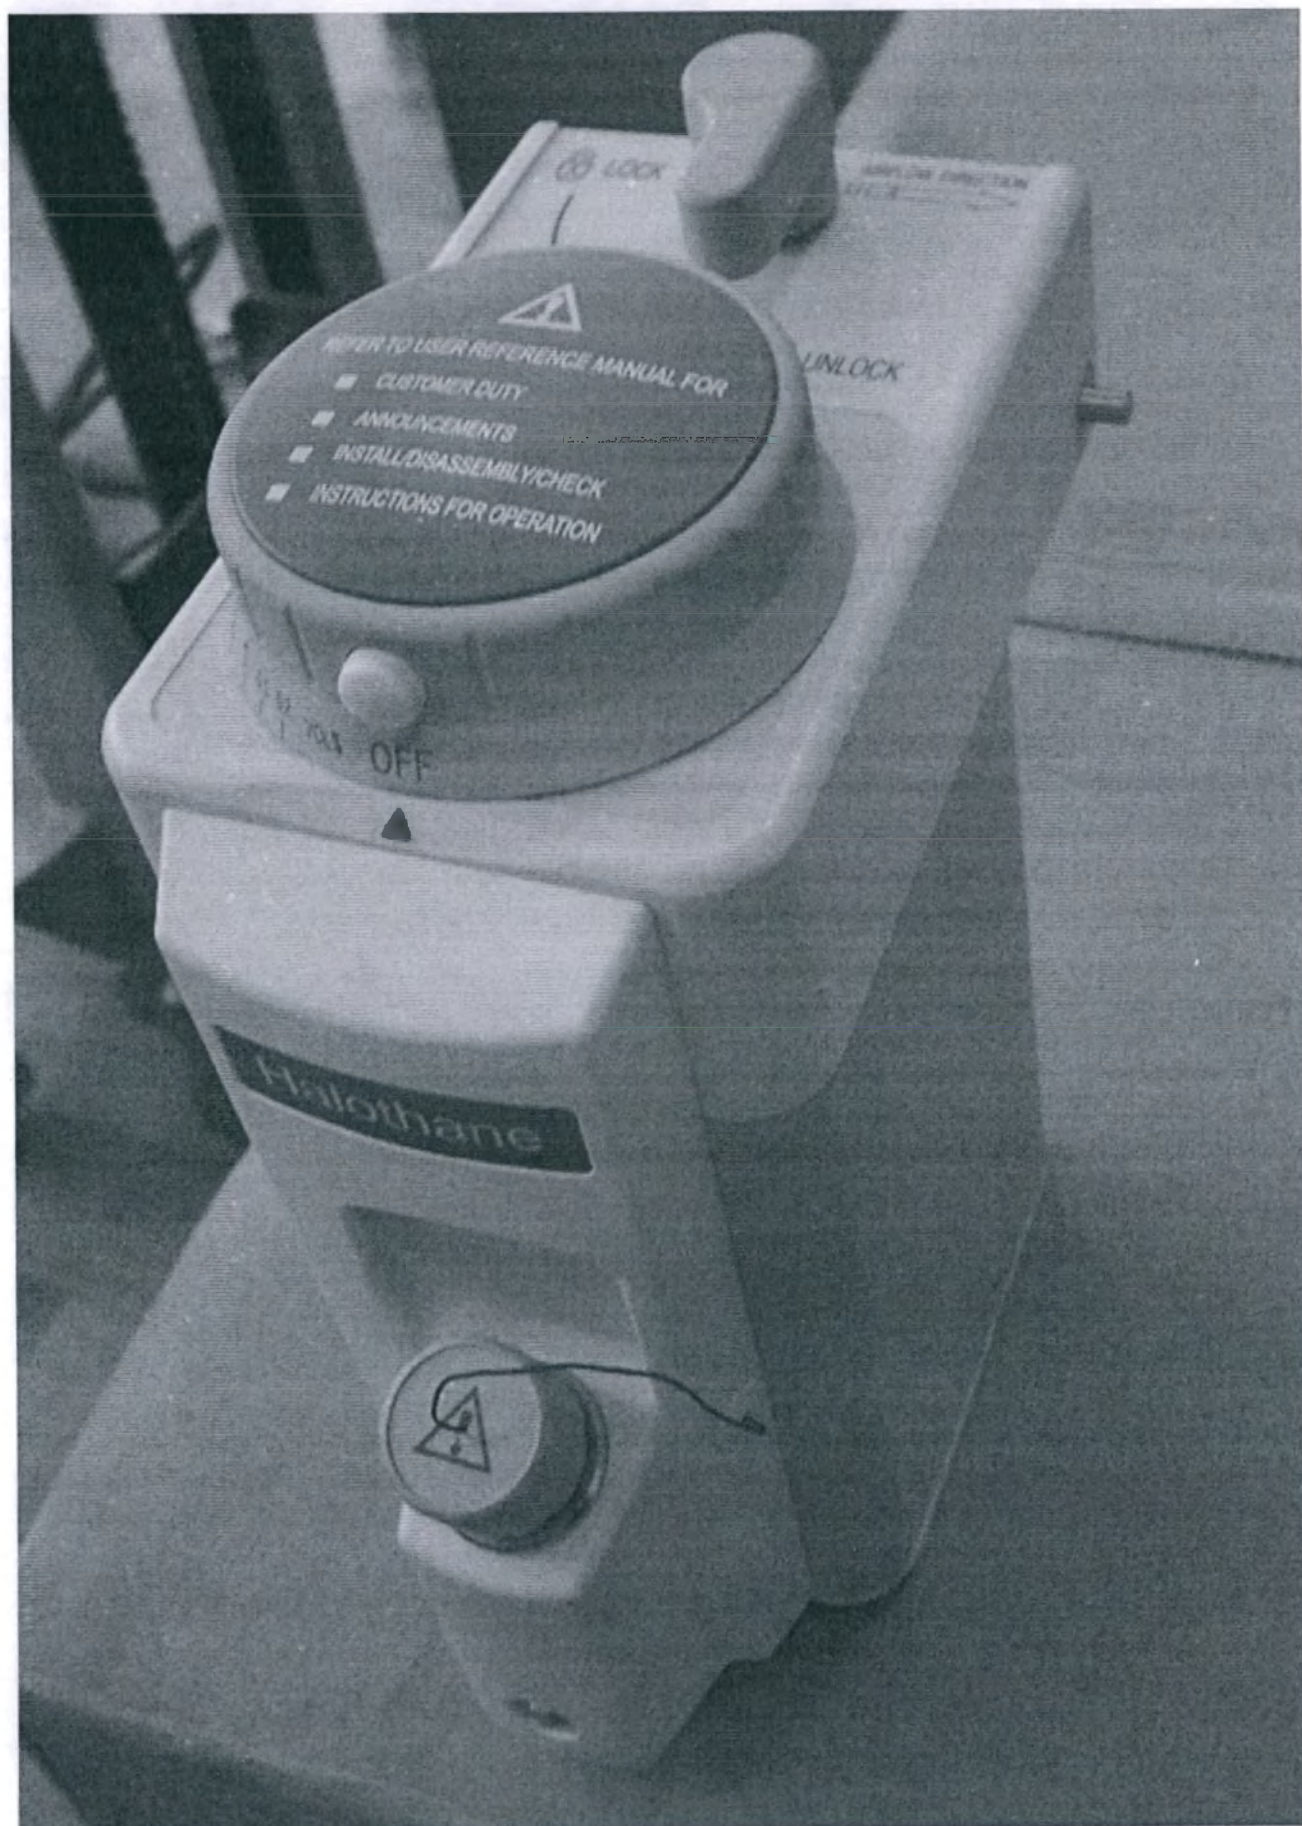

Испаритель анестетика (изофлюран), (при необходимости)




Испаритель анестетика (севофлюран), (при необходимости)




Датчик кислорода, (при необходимости)




Соединительный провод датчика кислорода, (при необходимости)

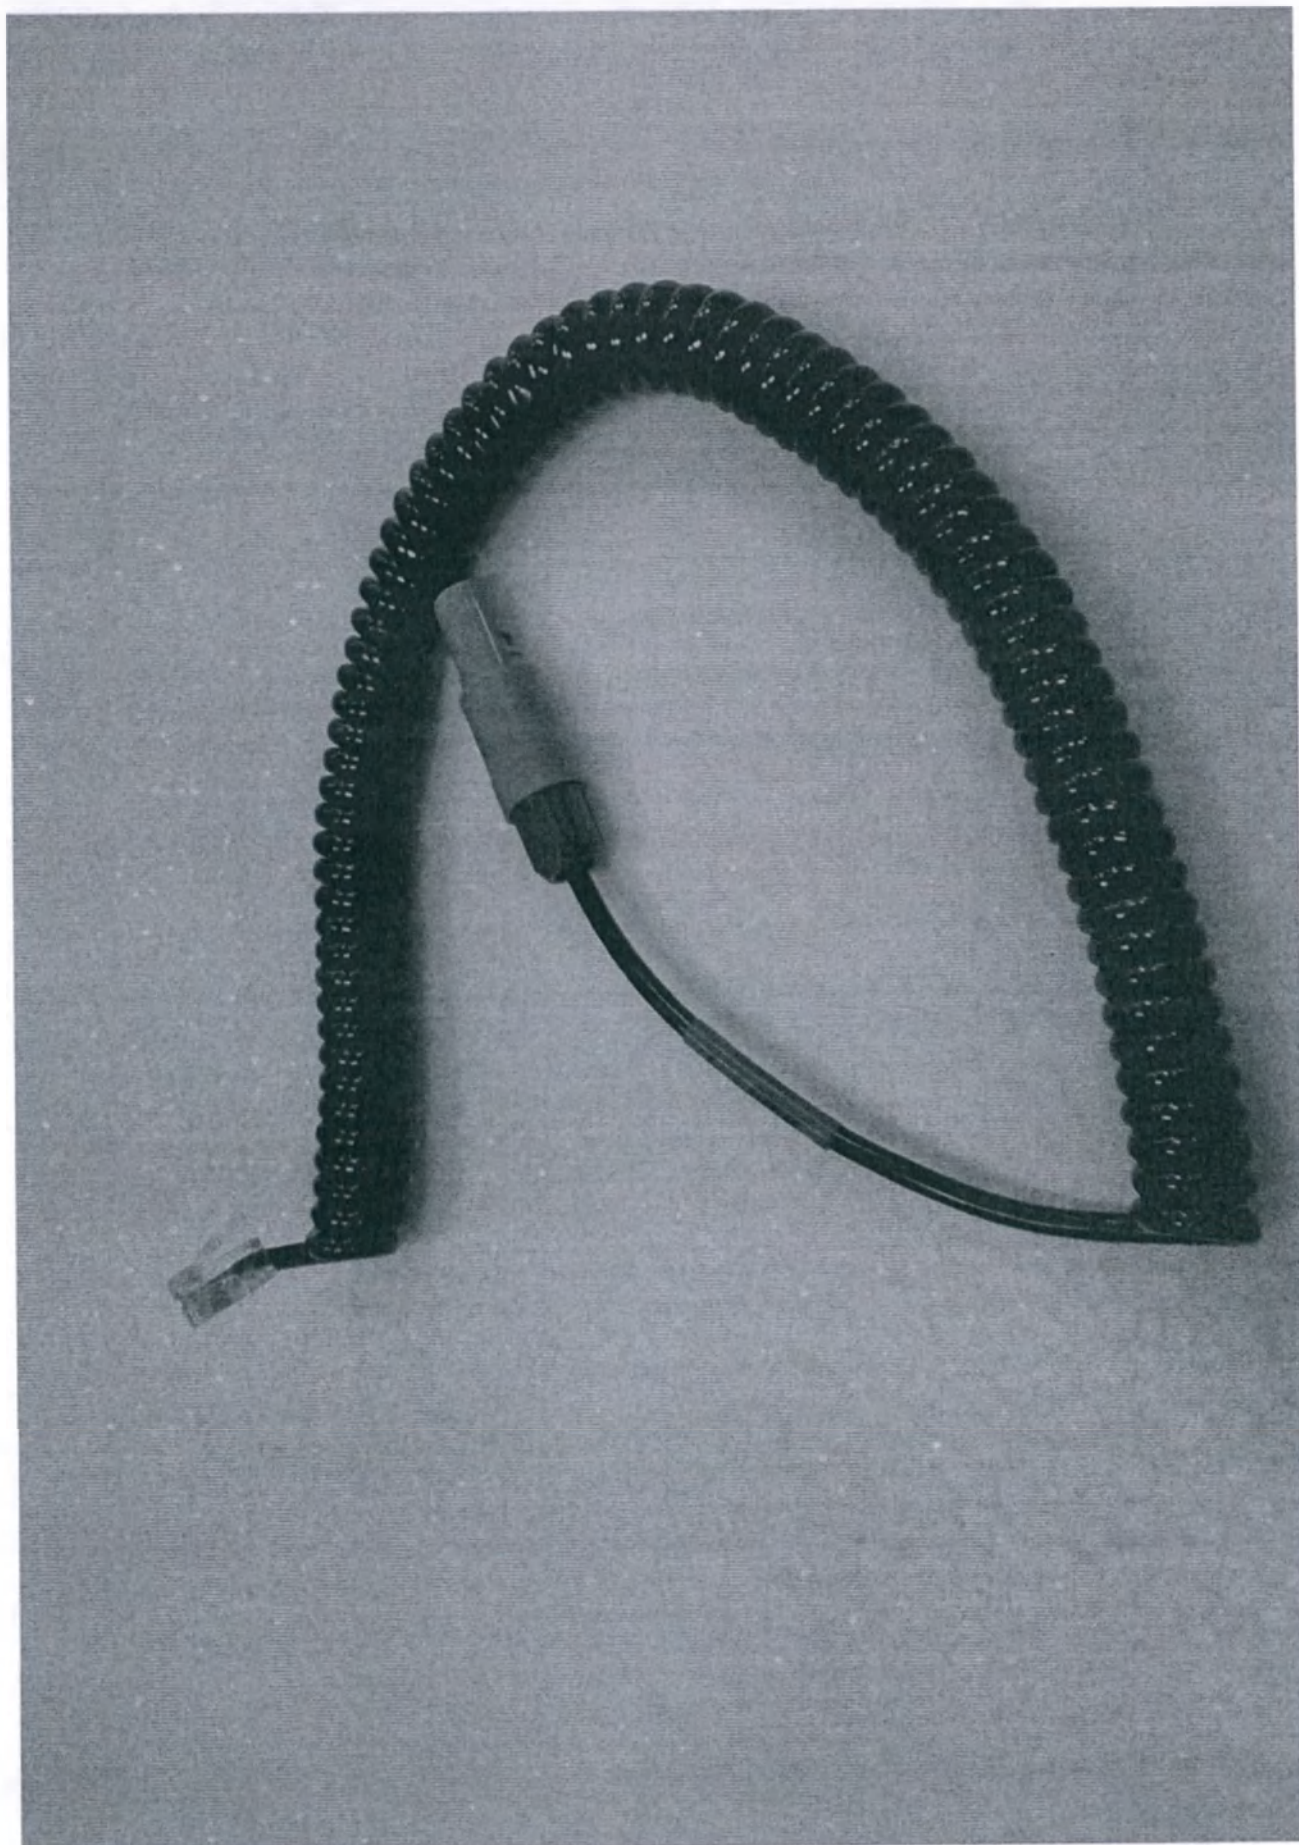


Шланг кислородный, 34I-OXY-GS/NS-5, (при необходимости)

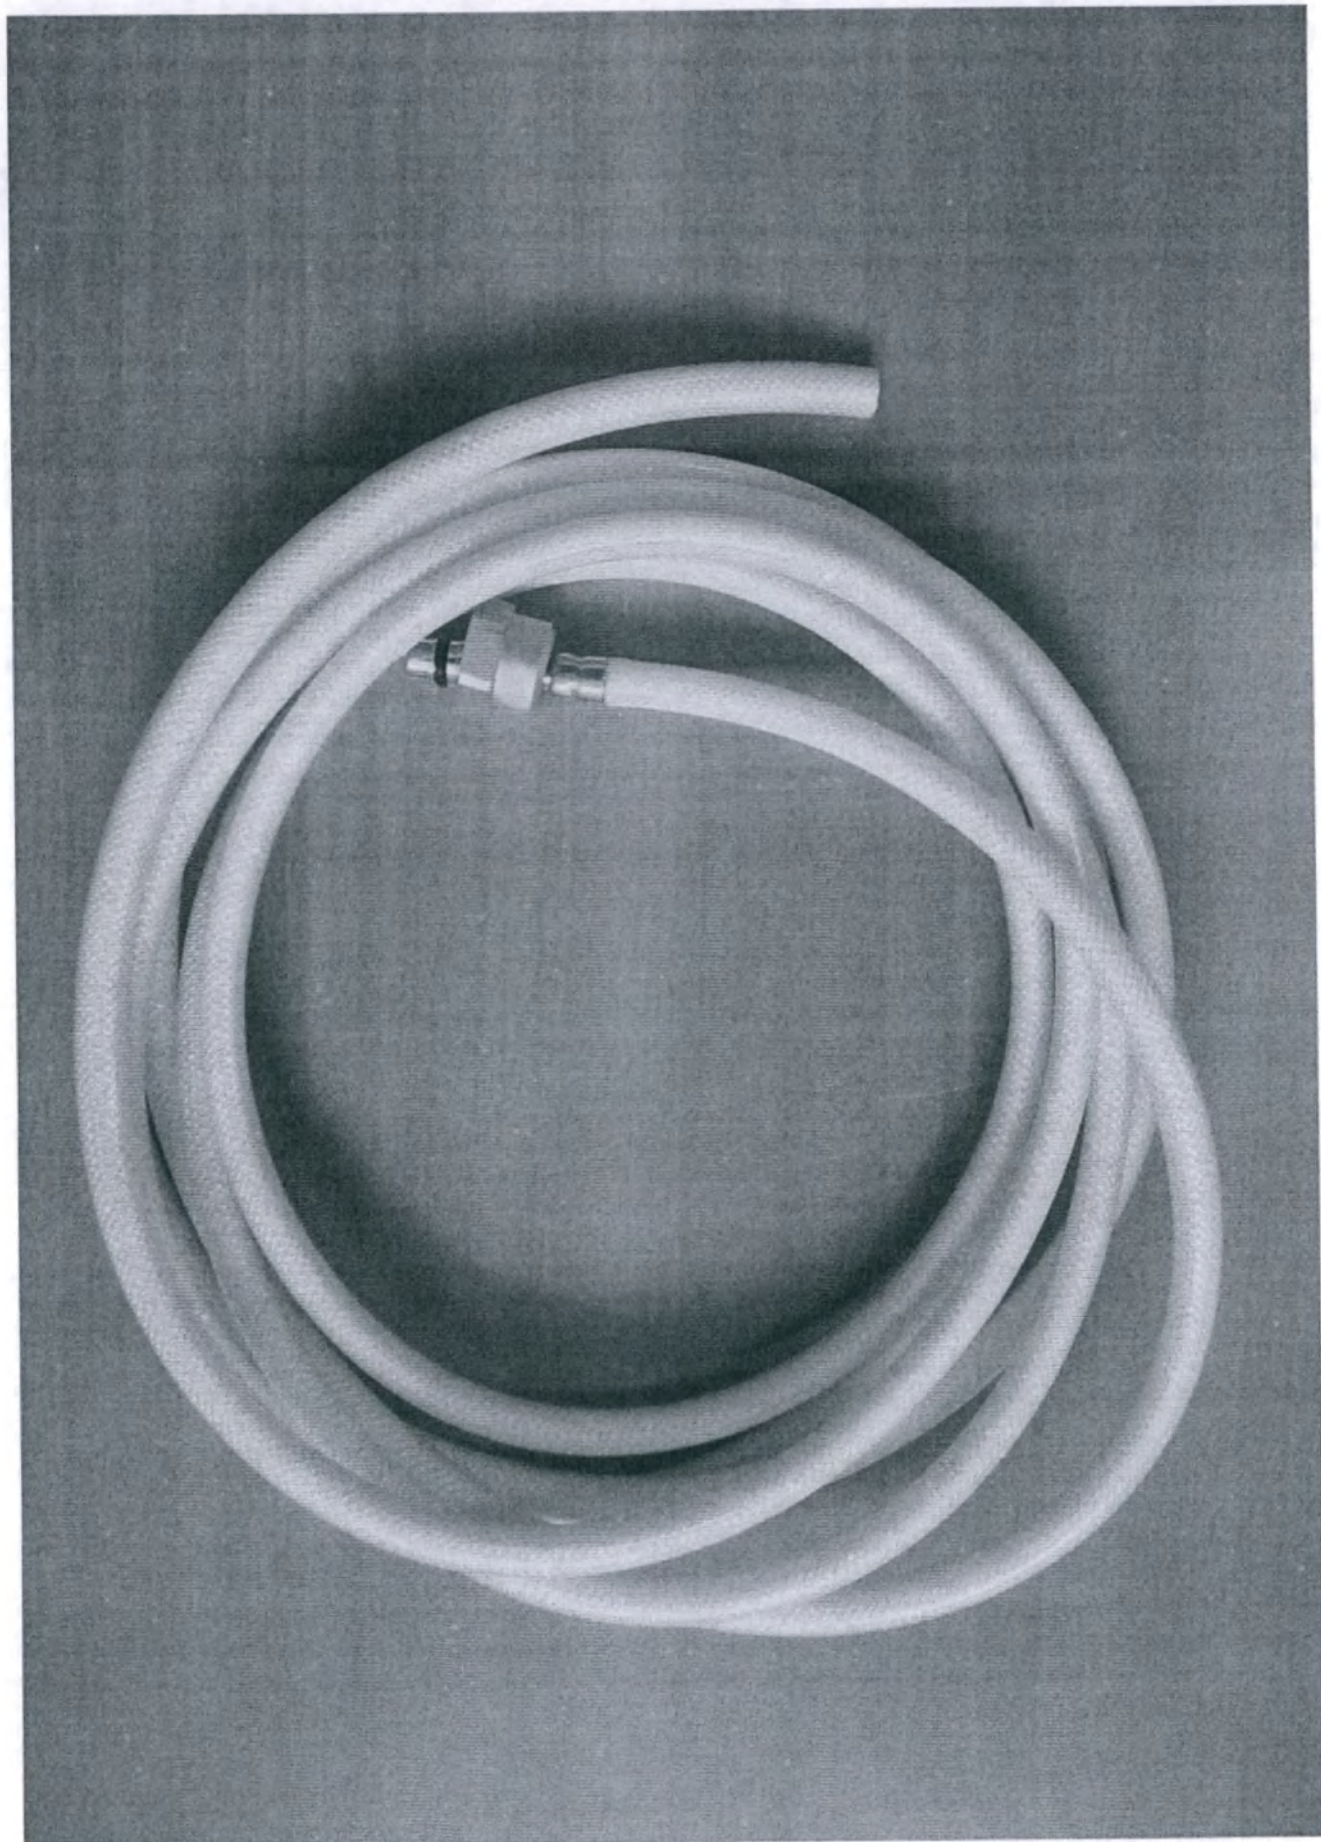

Шланг подачи закиси азота, (при необходимости)

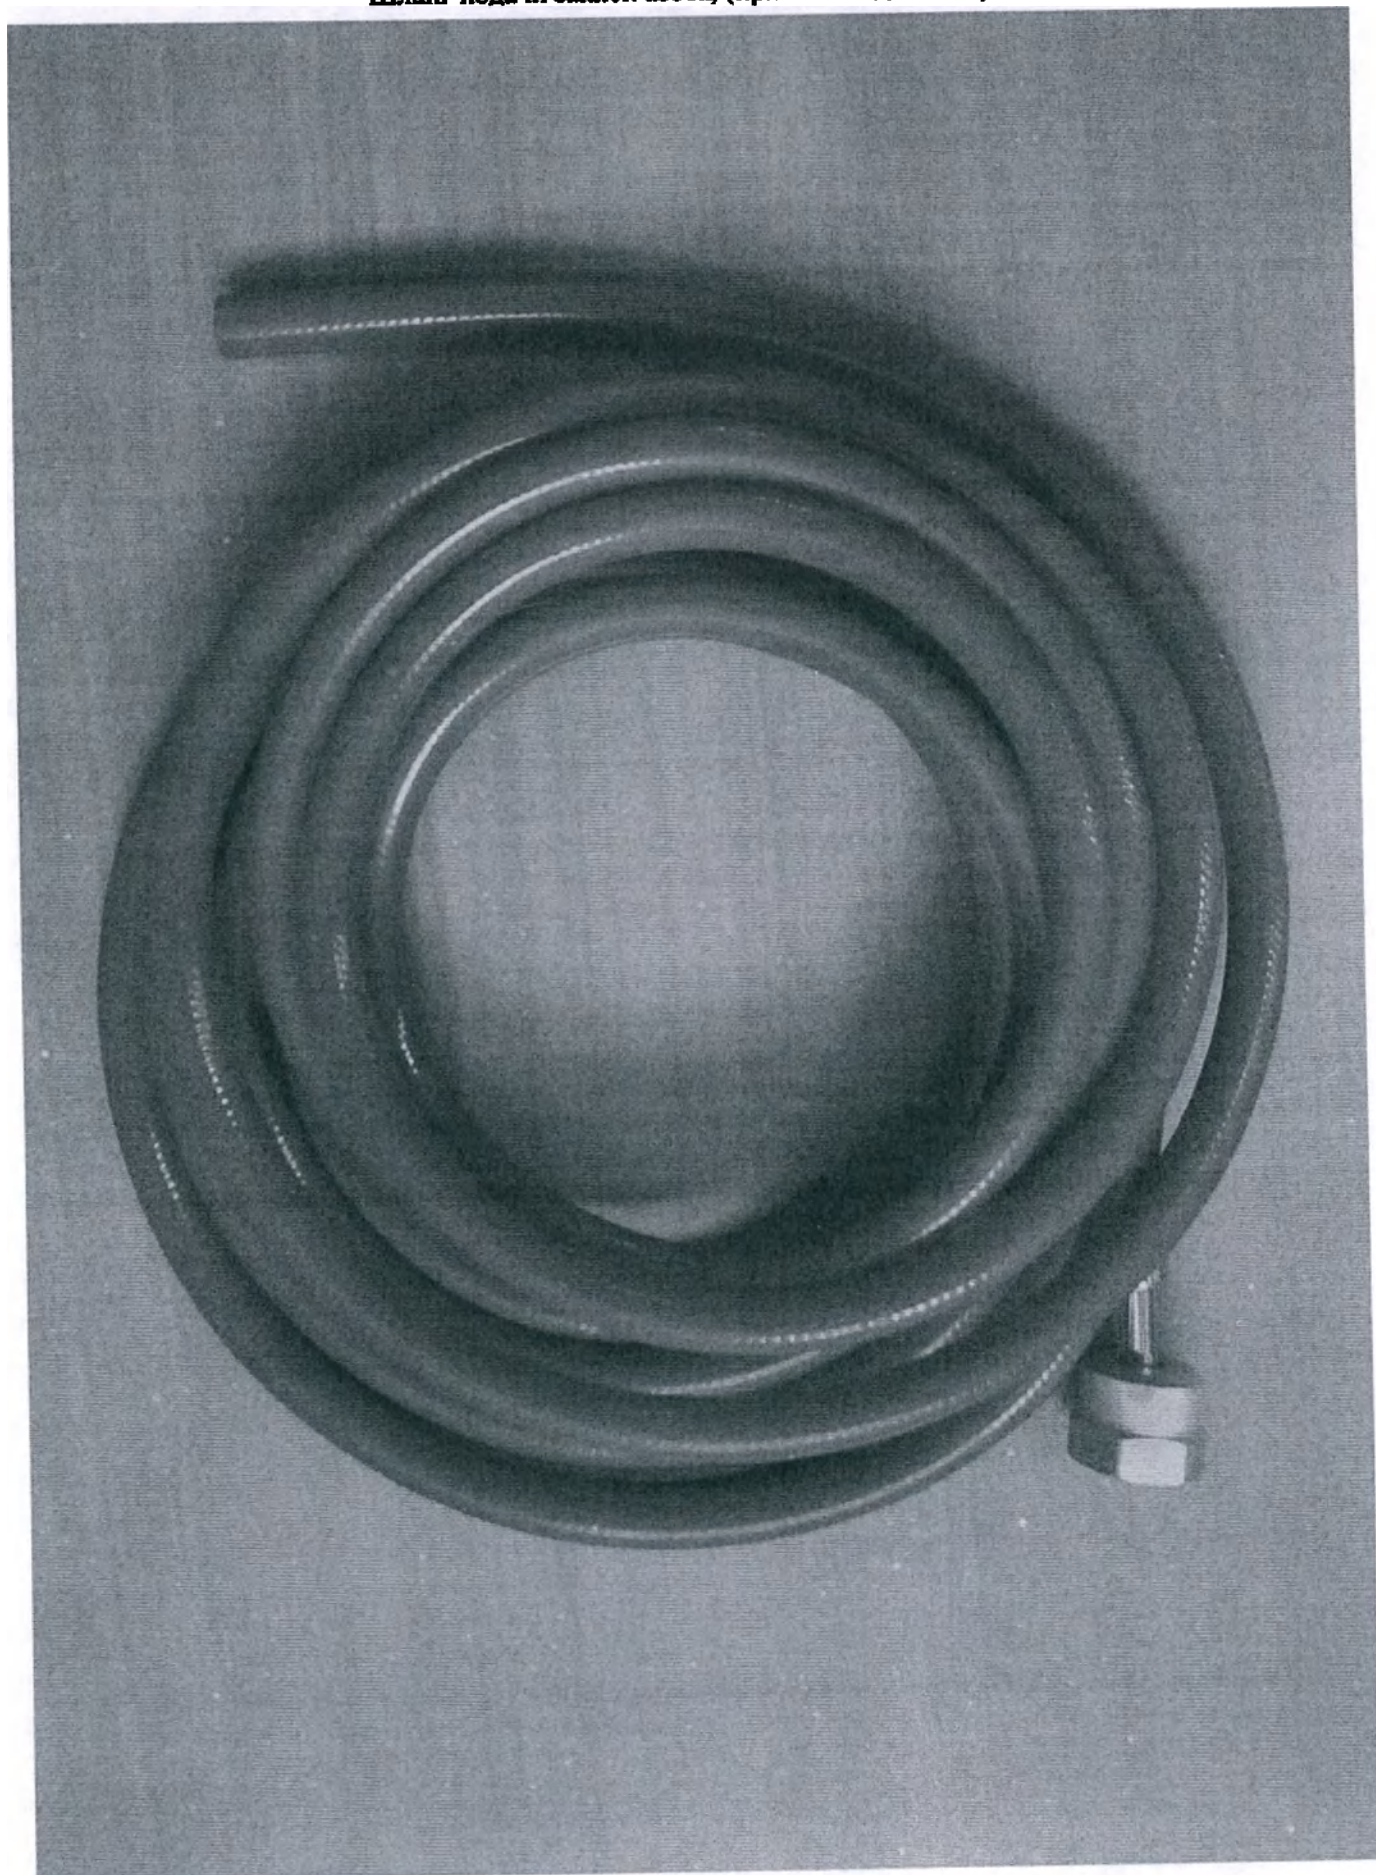


Шланг подачи сжатого воздуха (при необходимости)

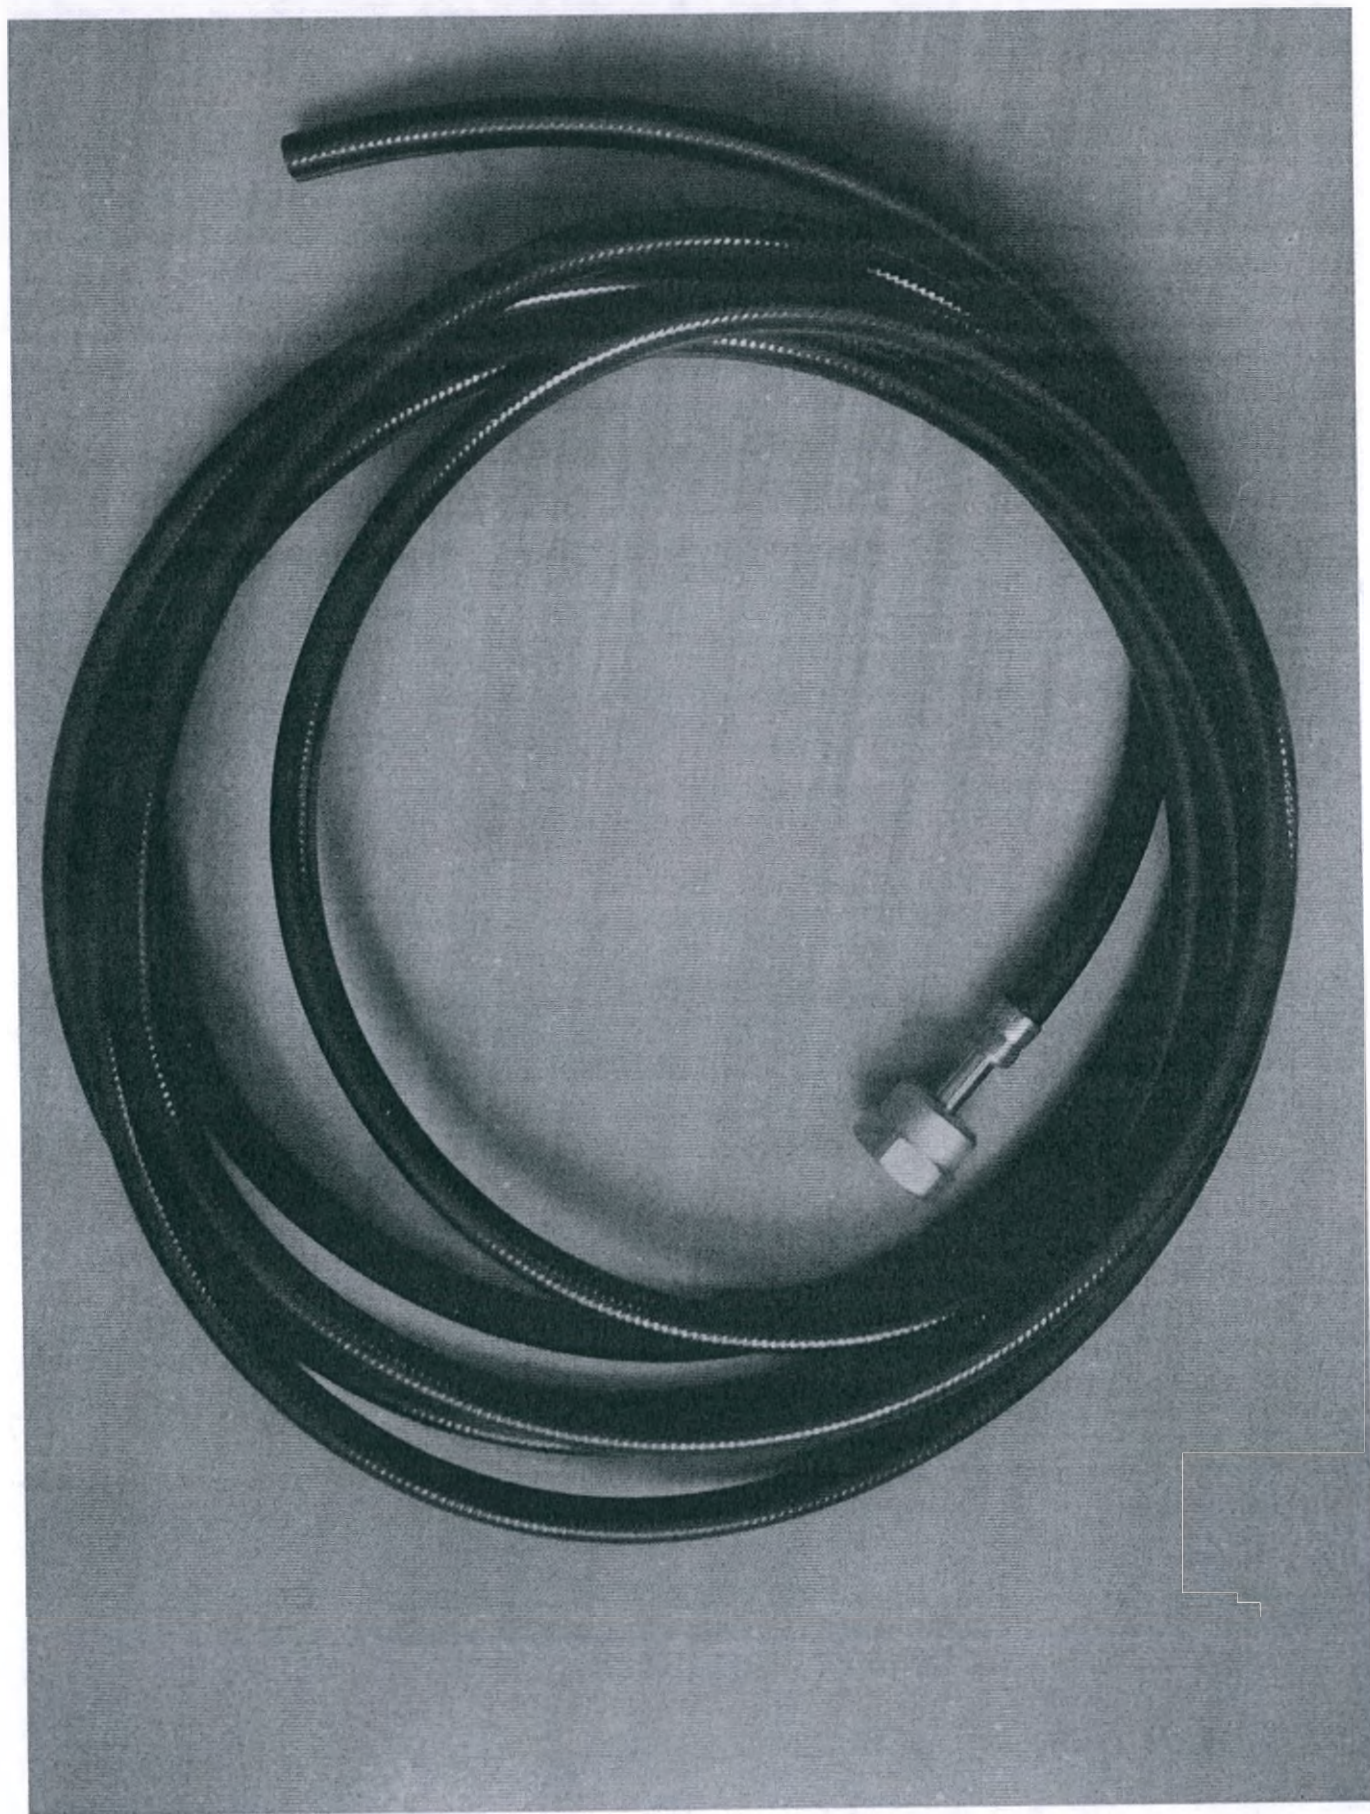

Маска лицевая




Мешок дыхательный 3 л

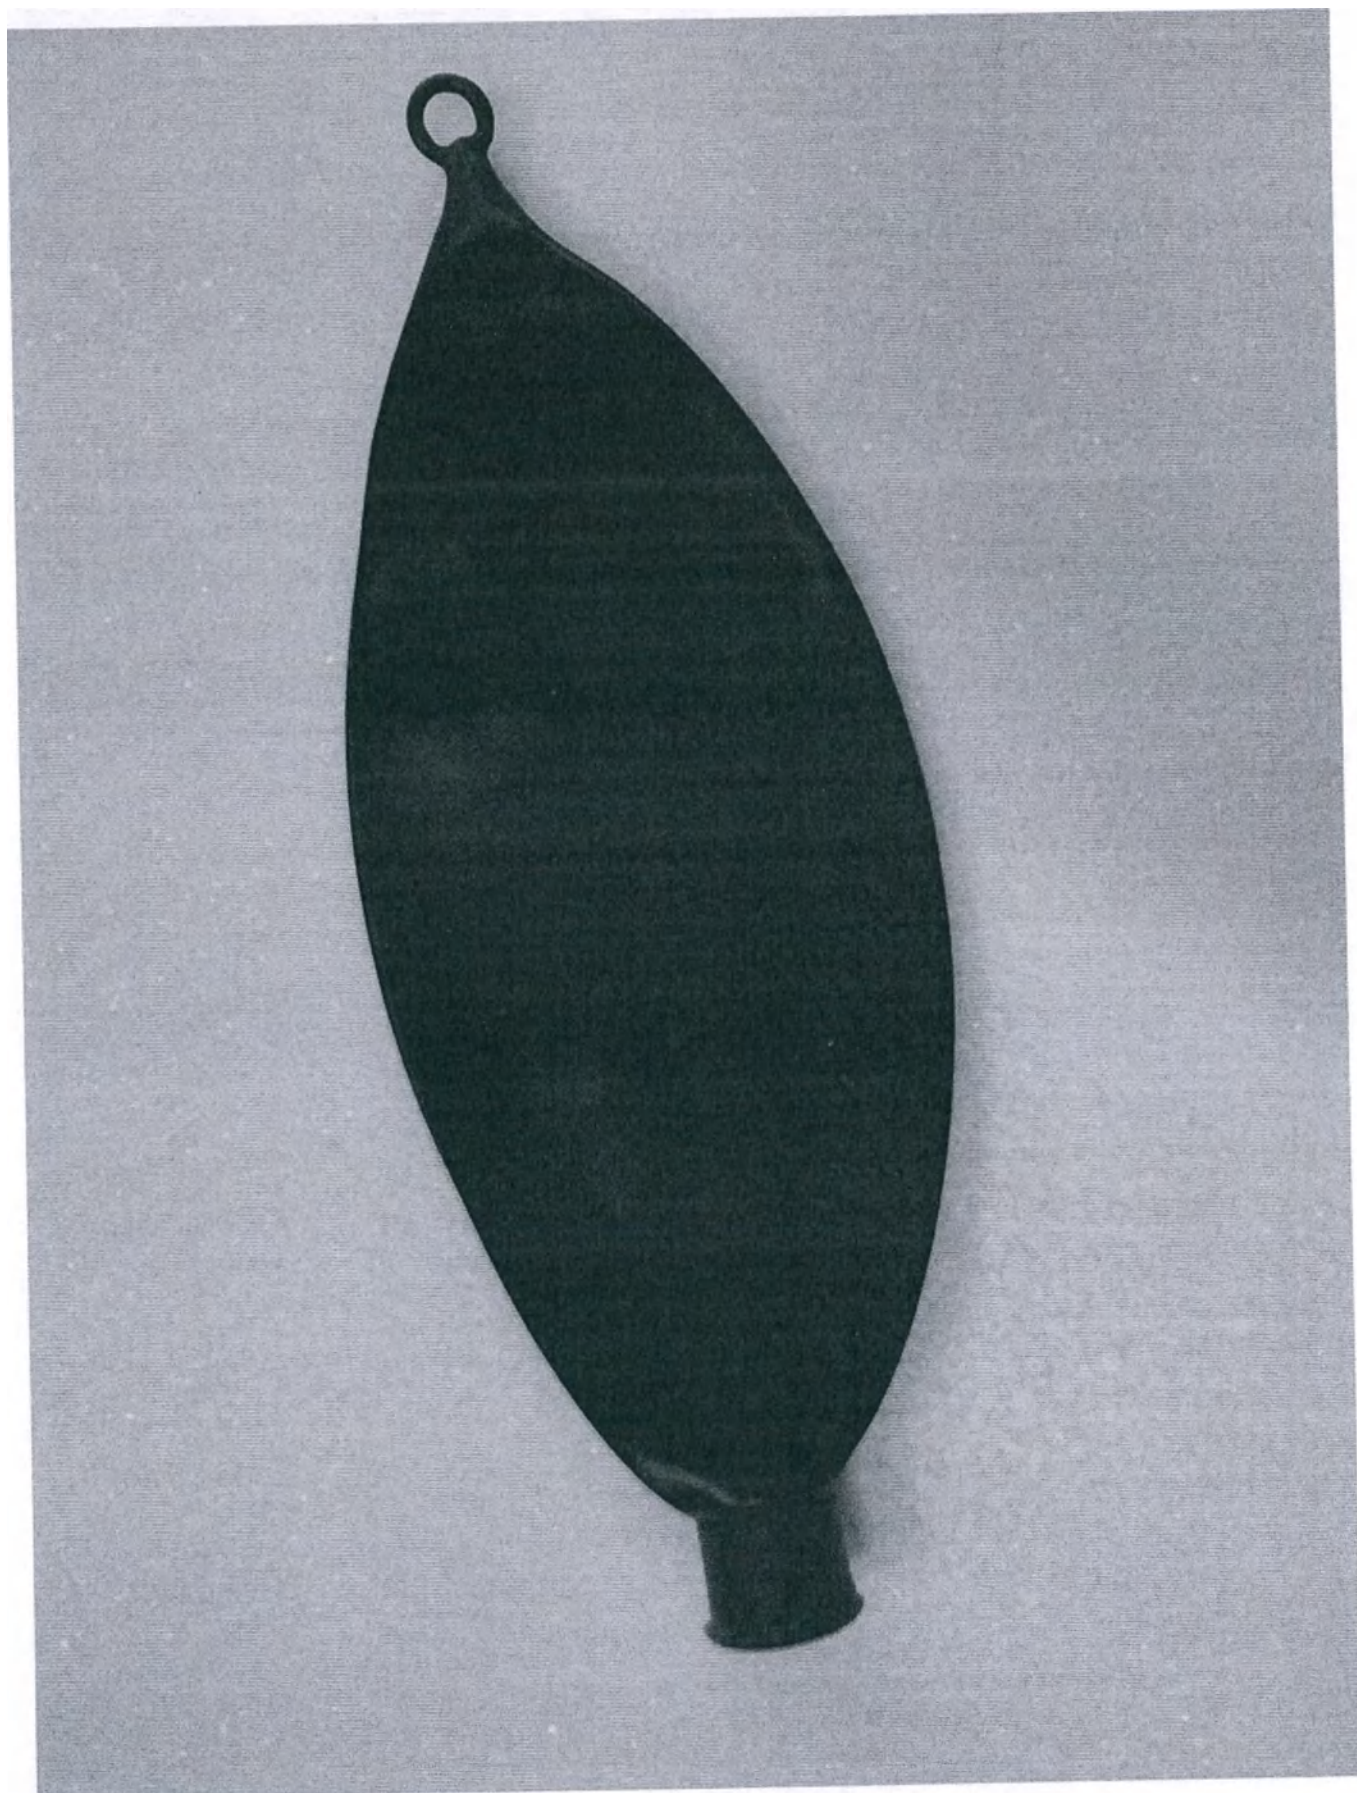

Мешок дыхательный 2л



Адаптер Y-образный

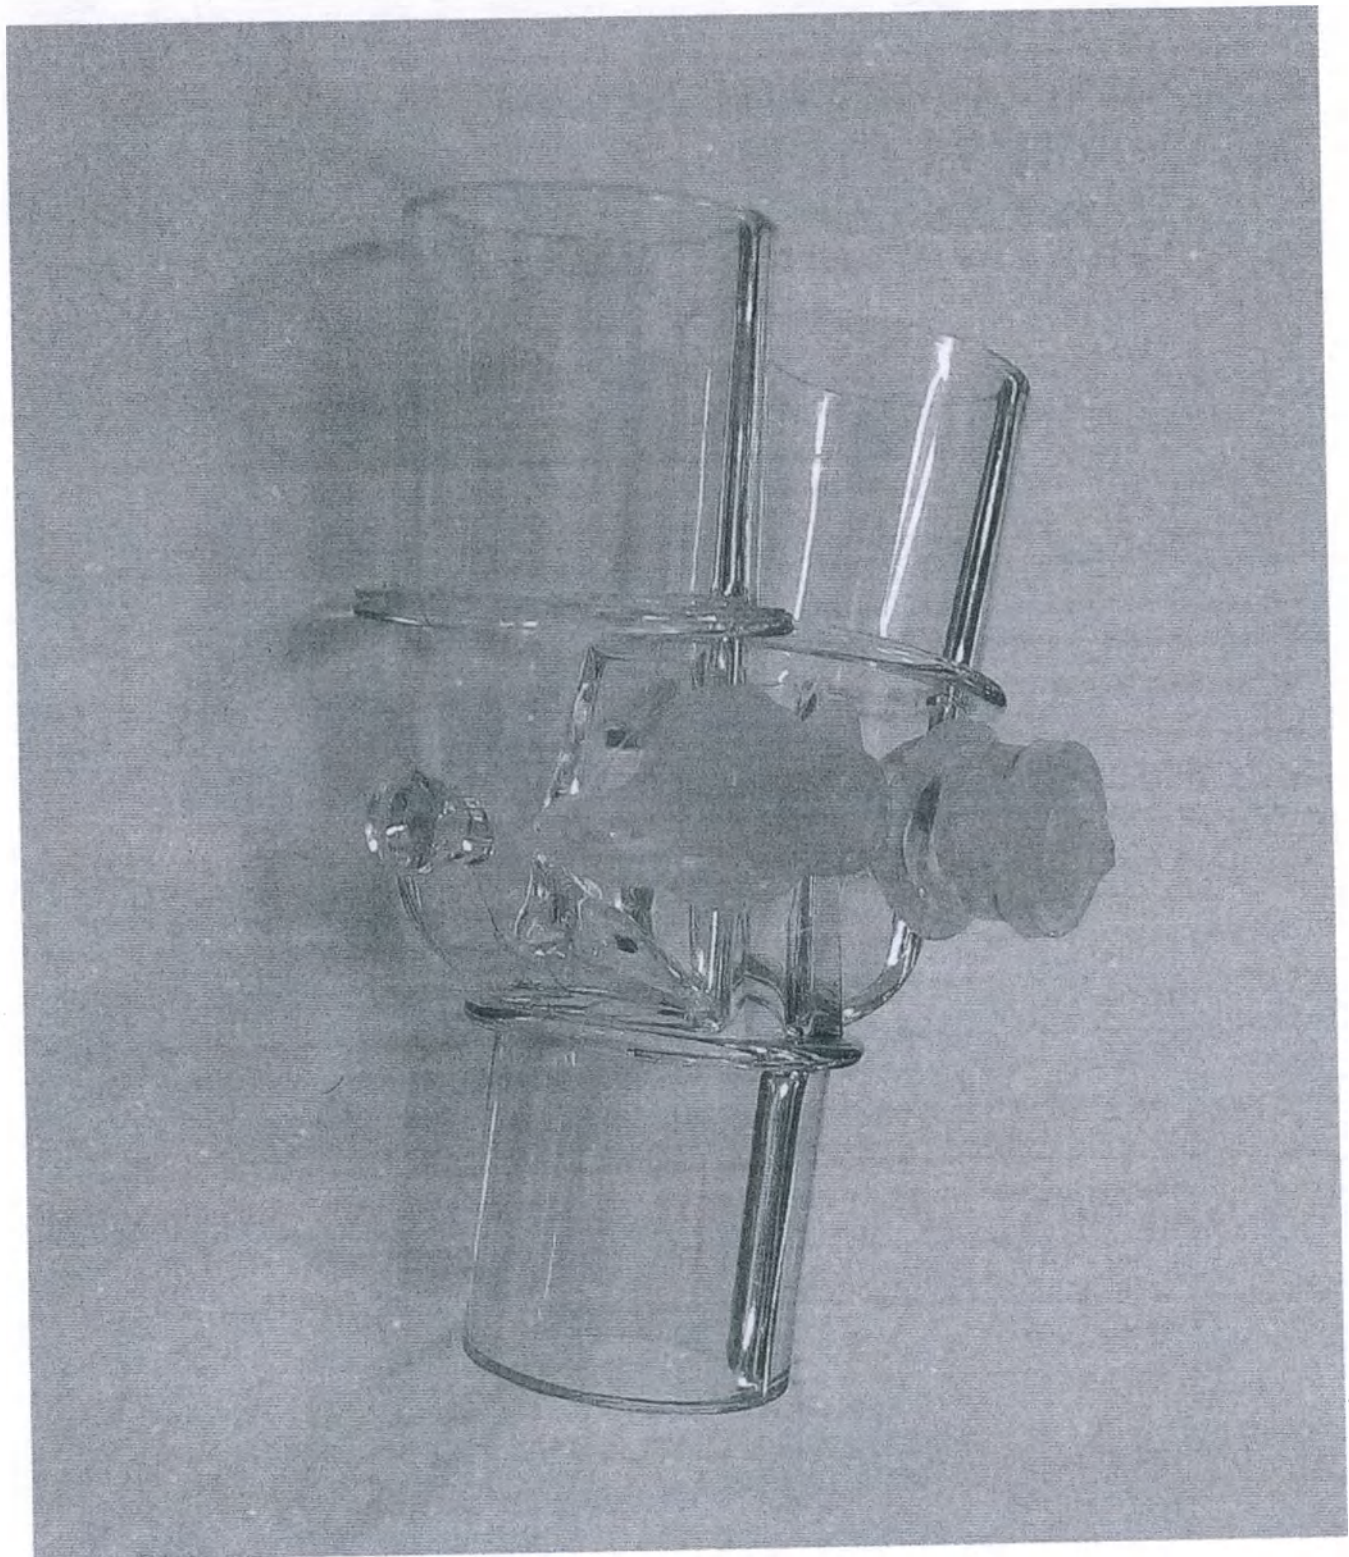


Соединитель прямой




Соединитель угловой




Шланг гофрированный с двумя втулками А-22-100

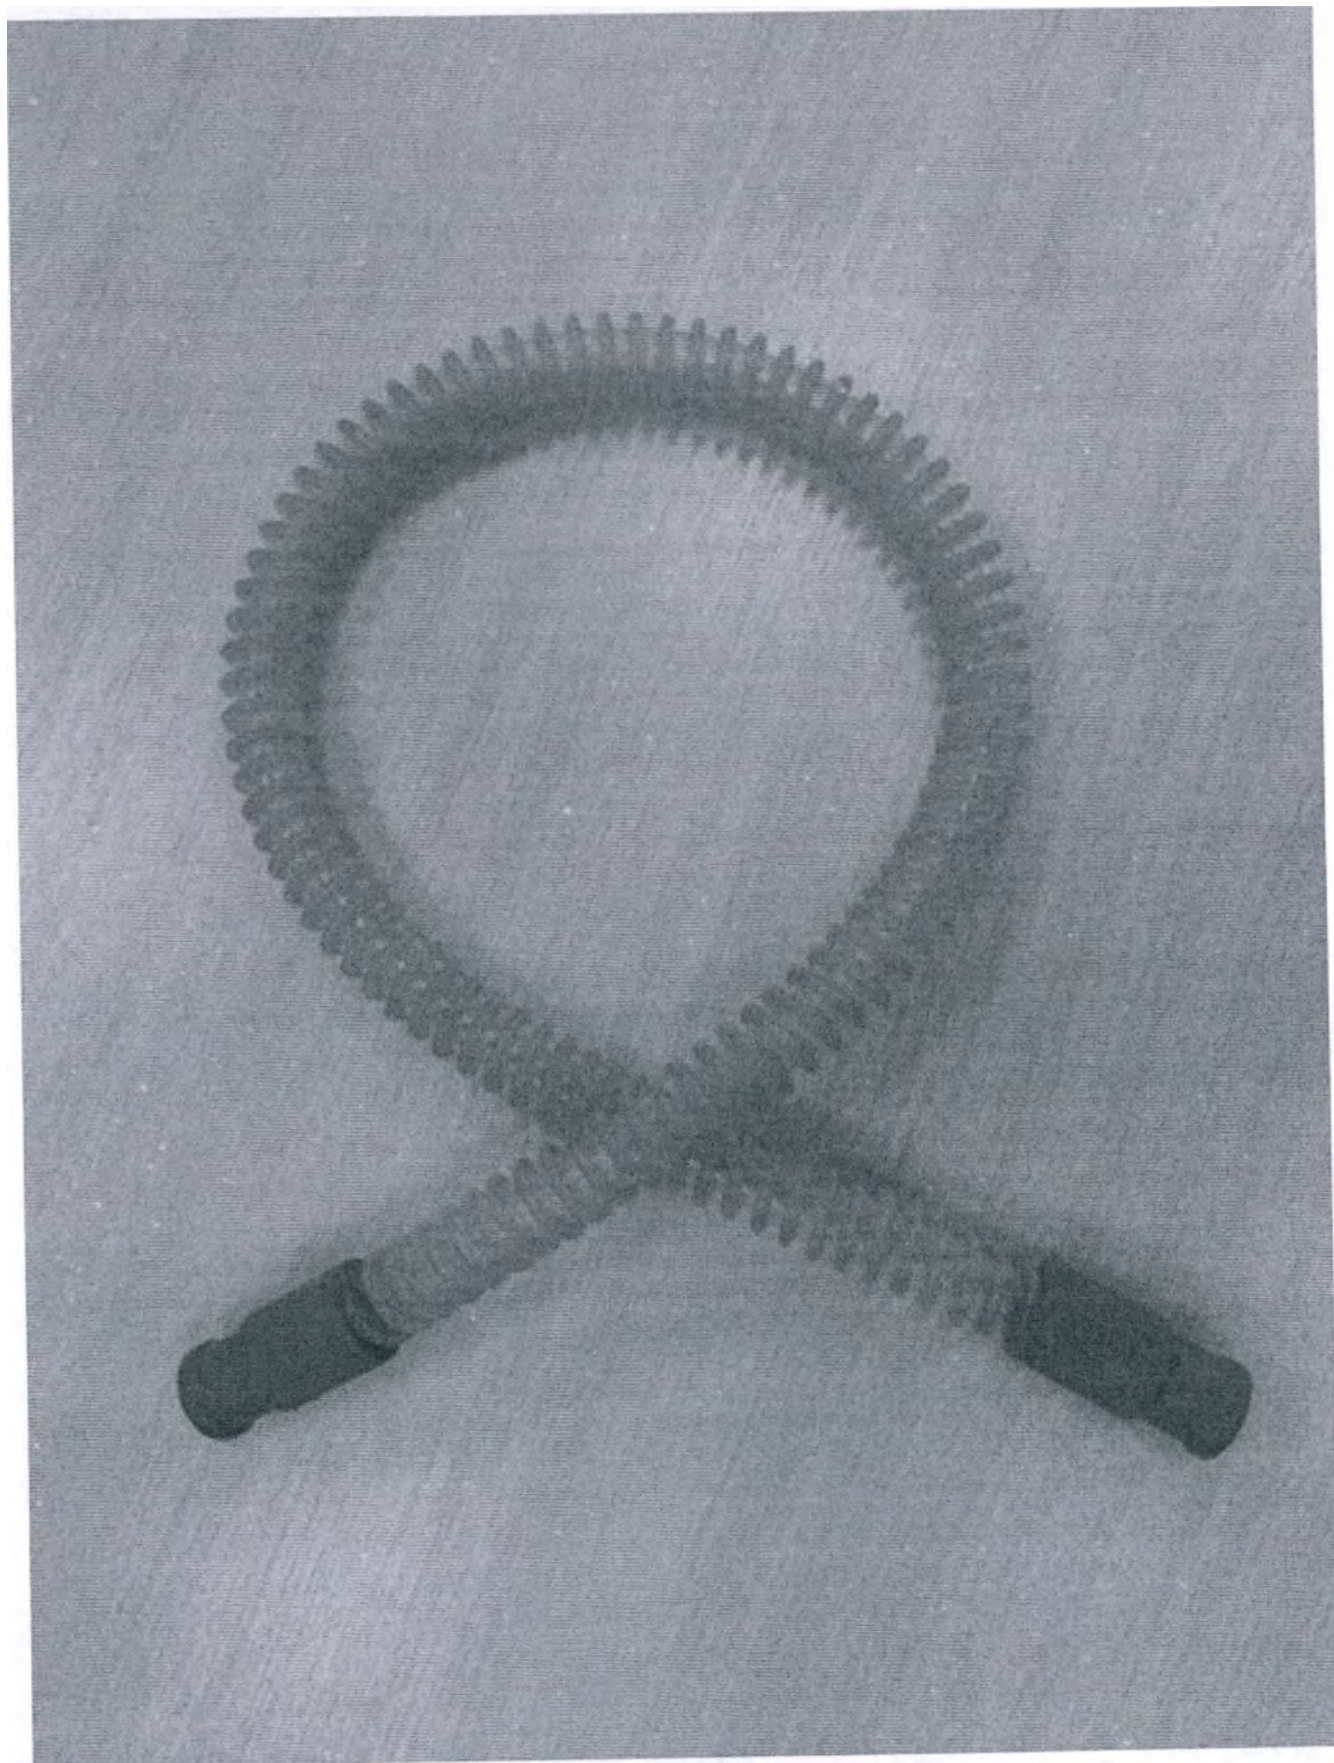


Шланг гофрированный с двумя втулками А-22-60

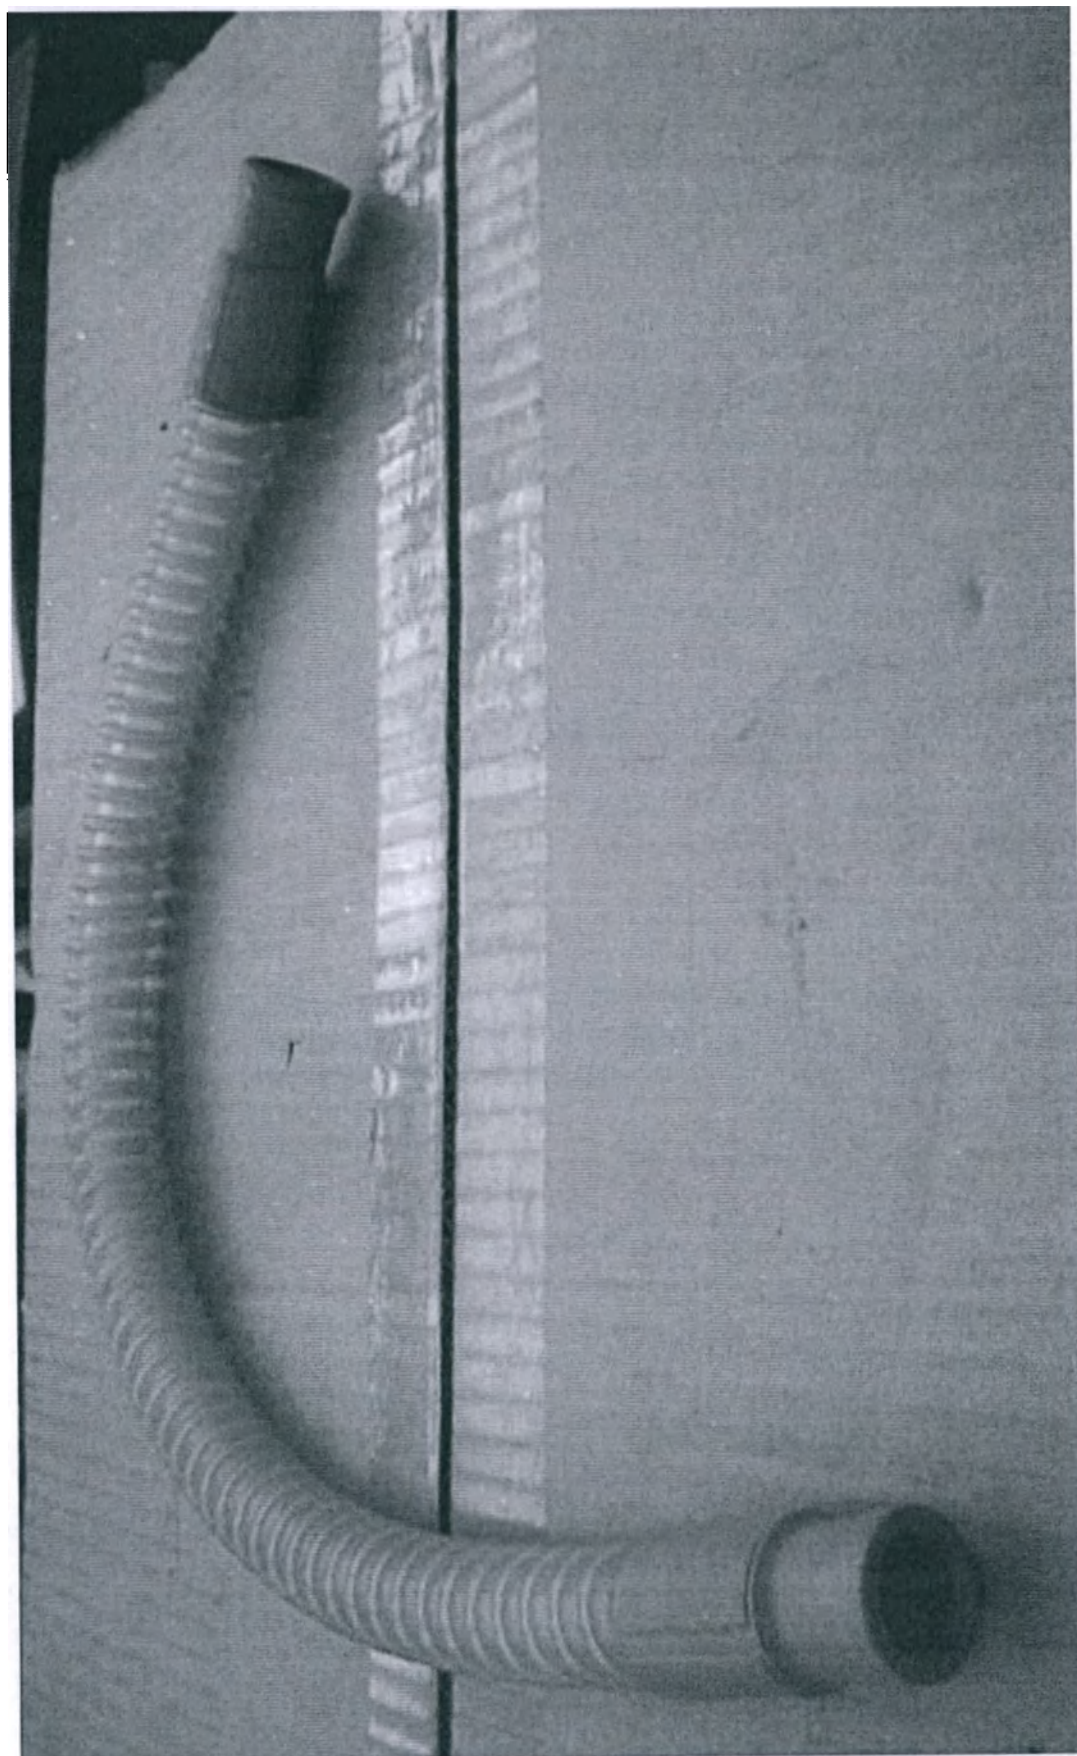


Шланг гофрированный с двумя втулками А-17-60

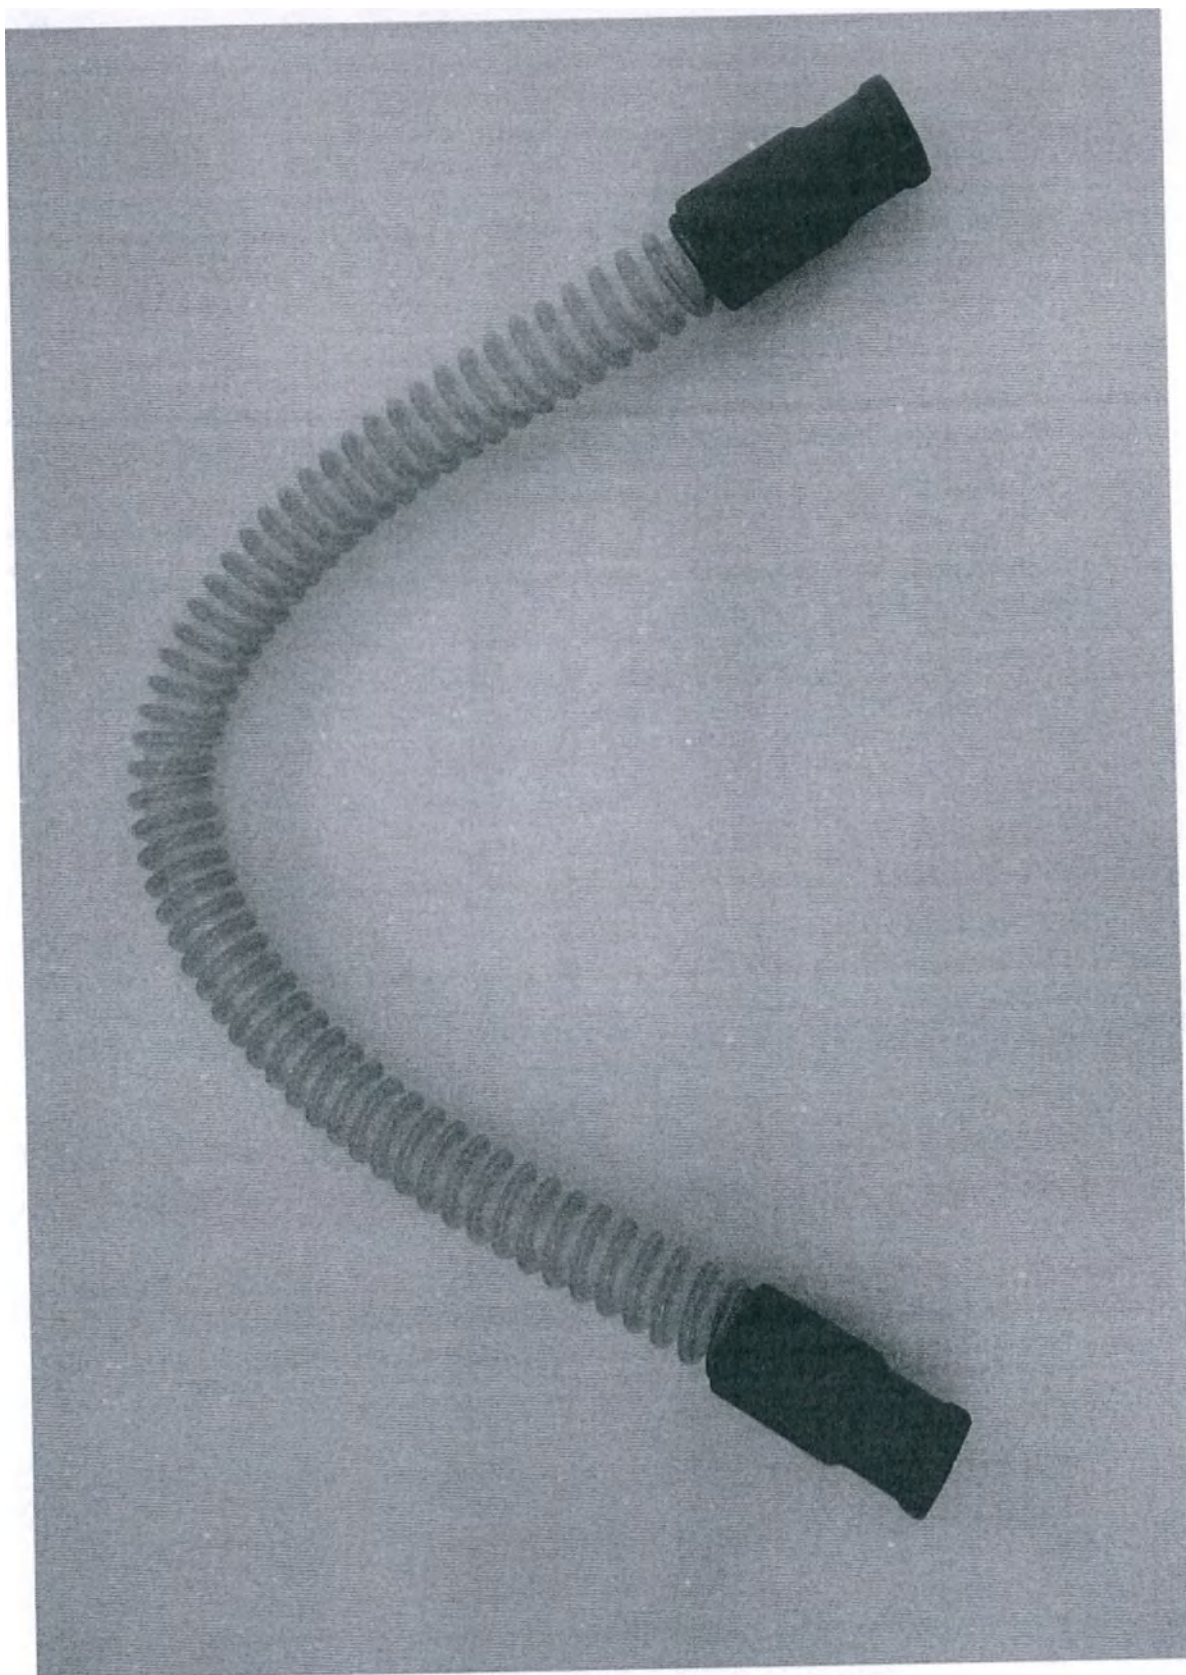


Шланг гофрированный с двумя втулками А-17-80 (при необходимости)

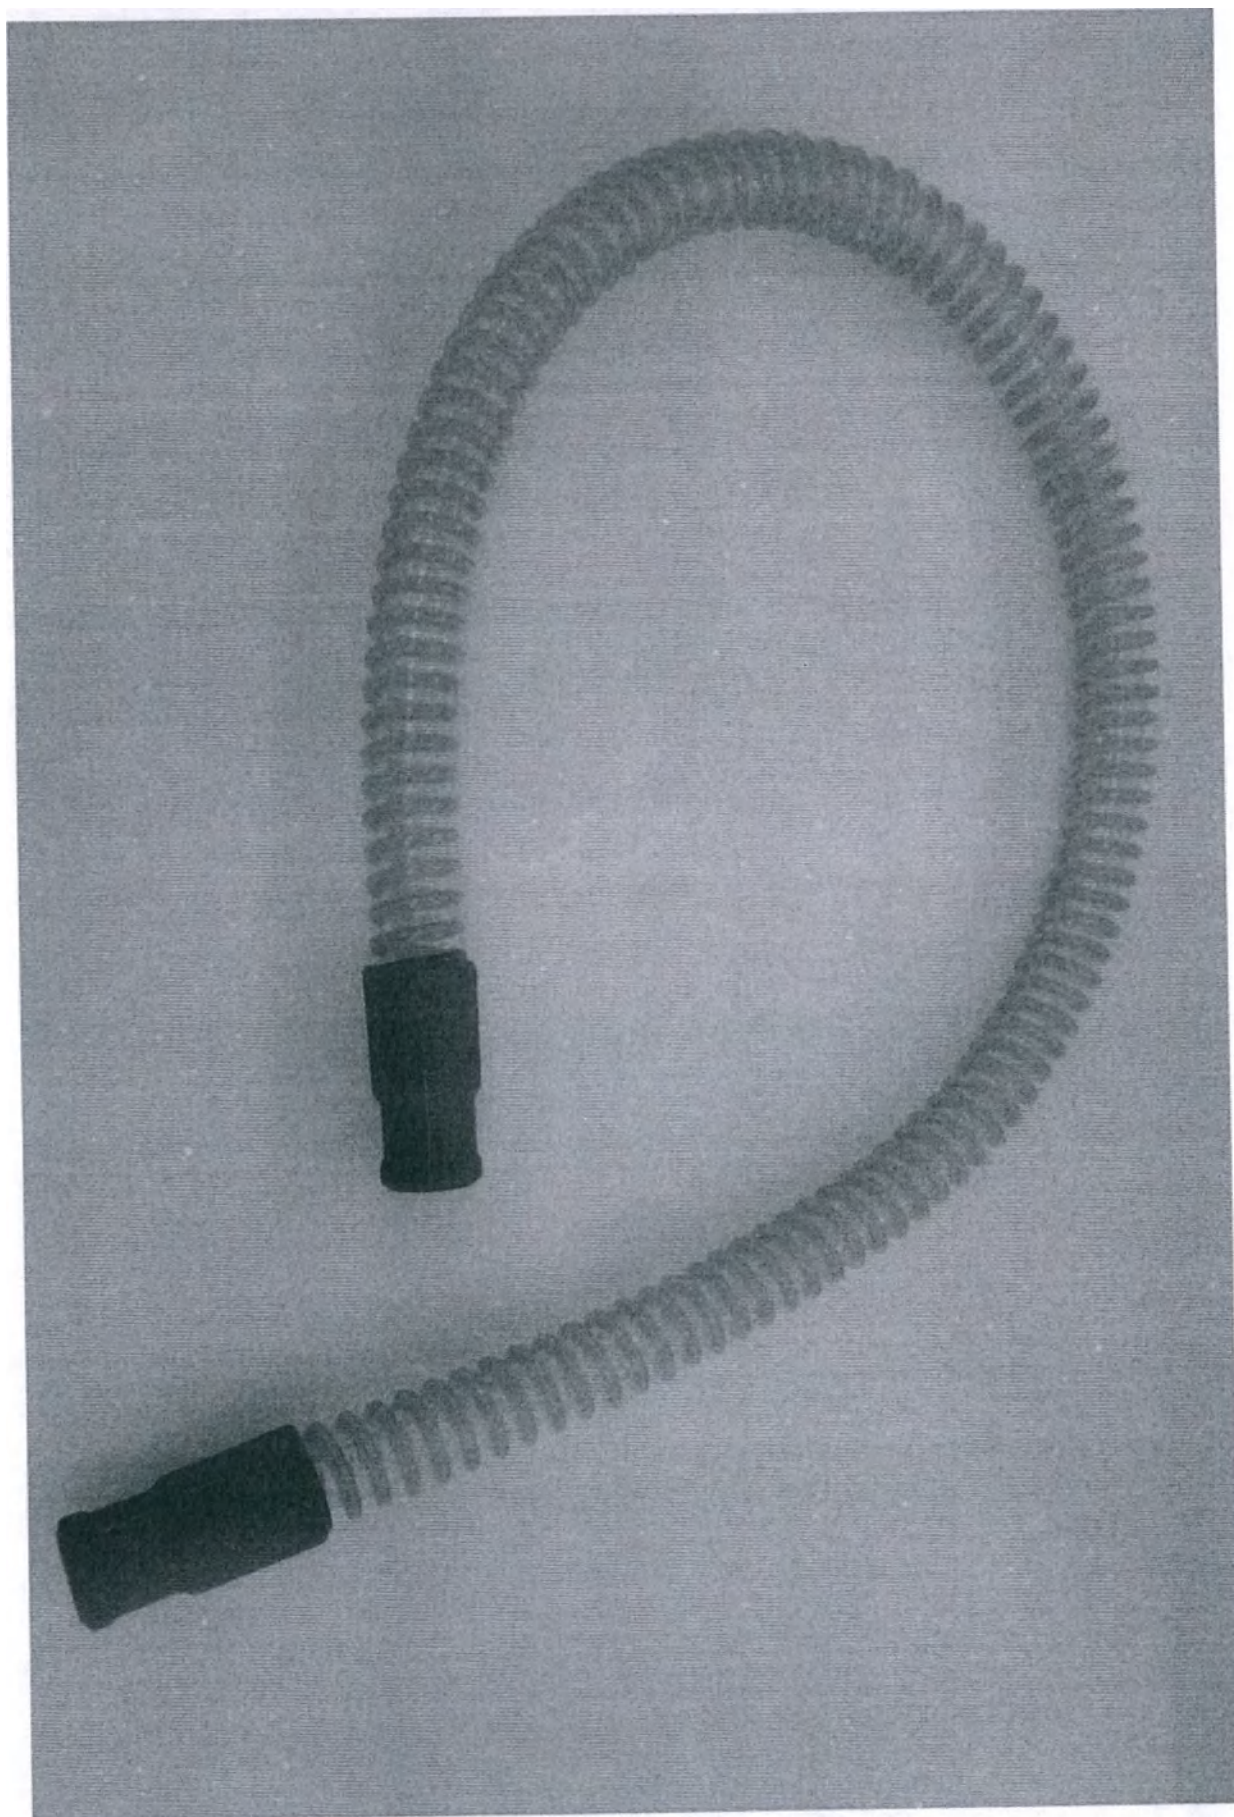


Кронштейн для монитора

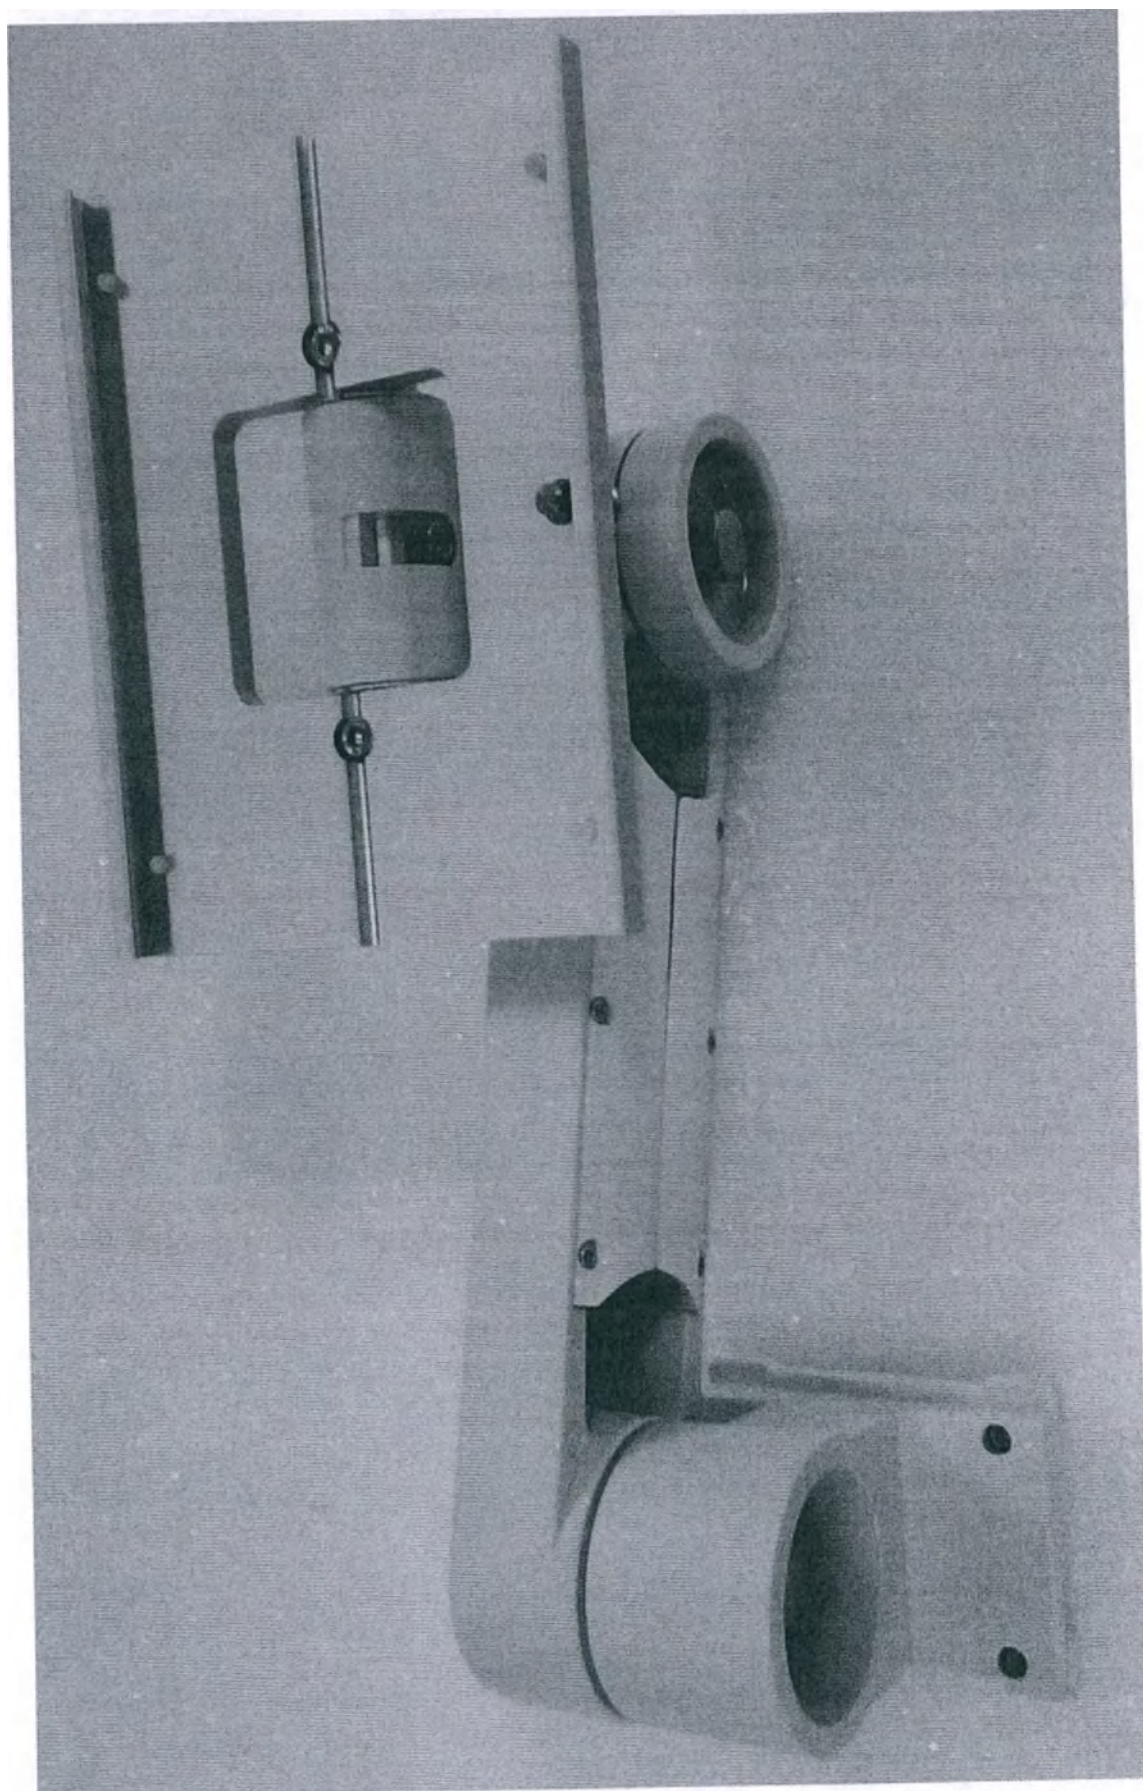


Монитор

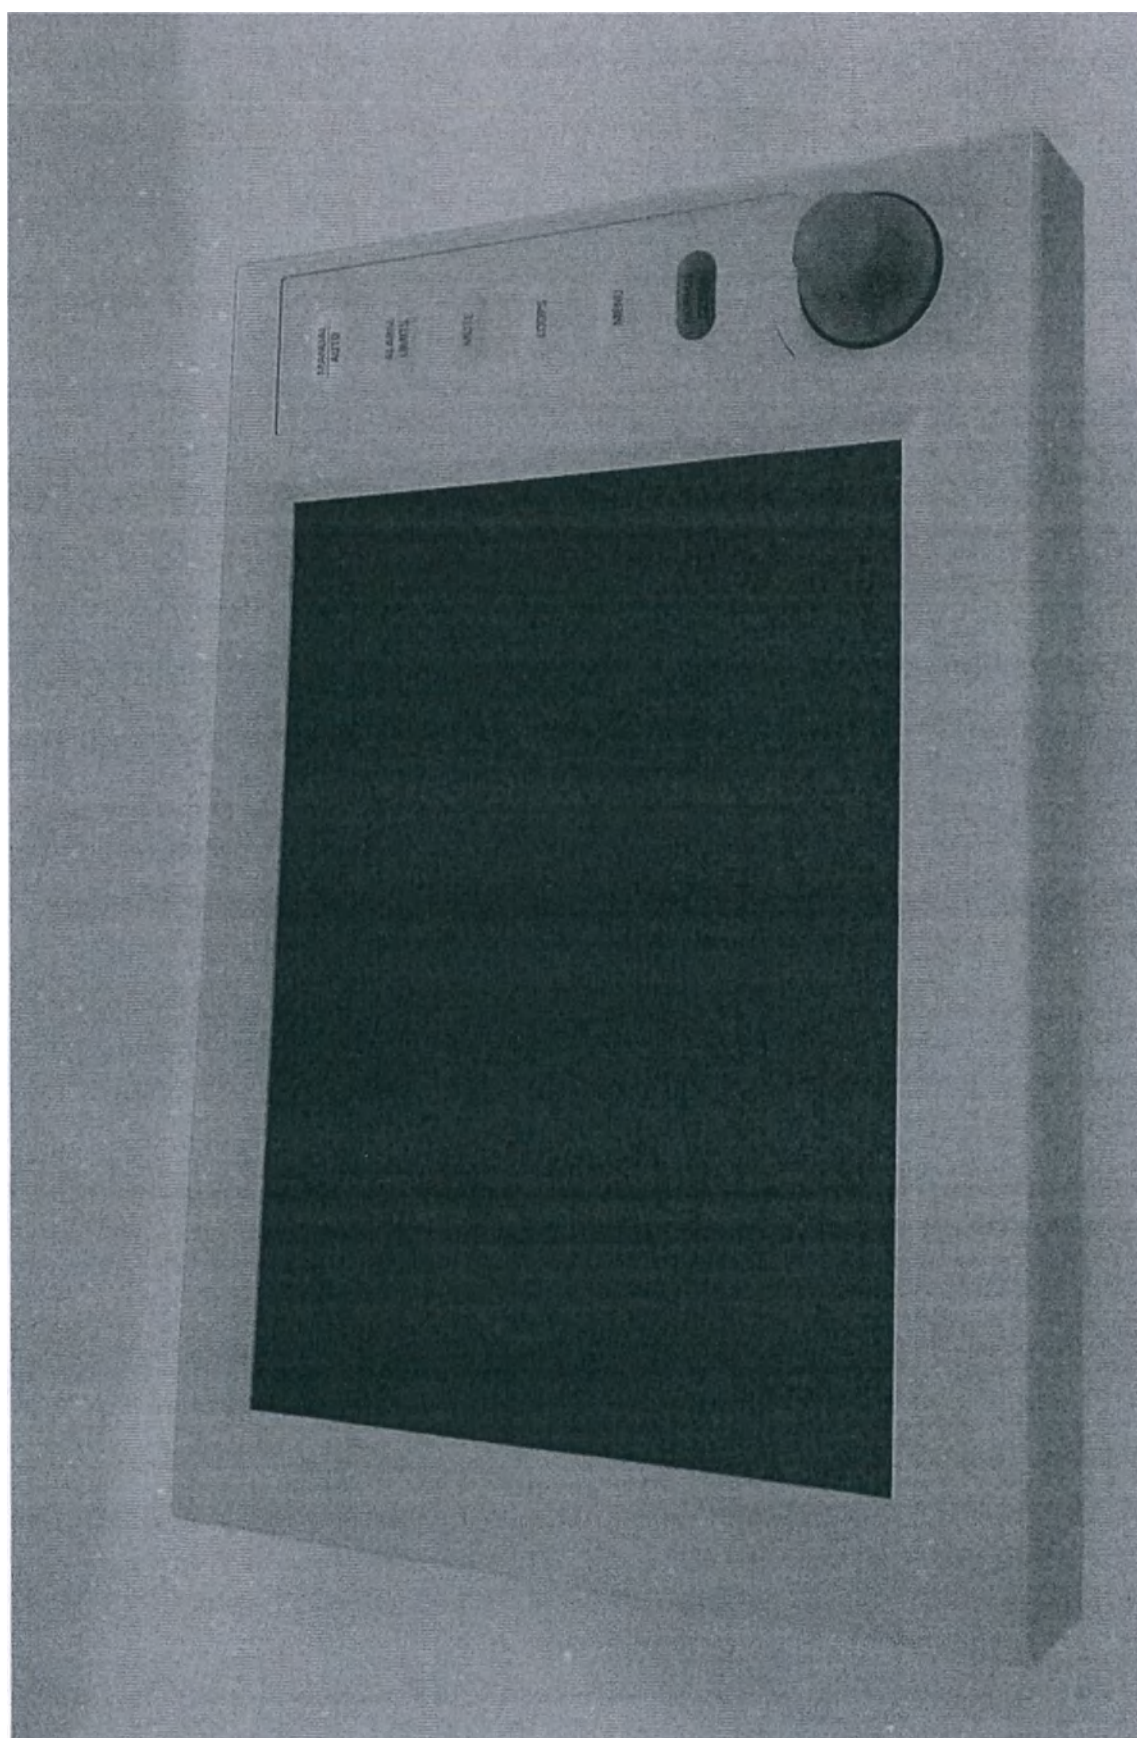

Кабель нагревателя

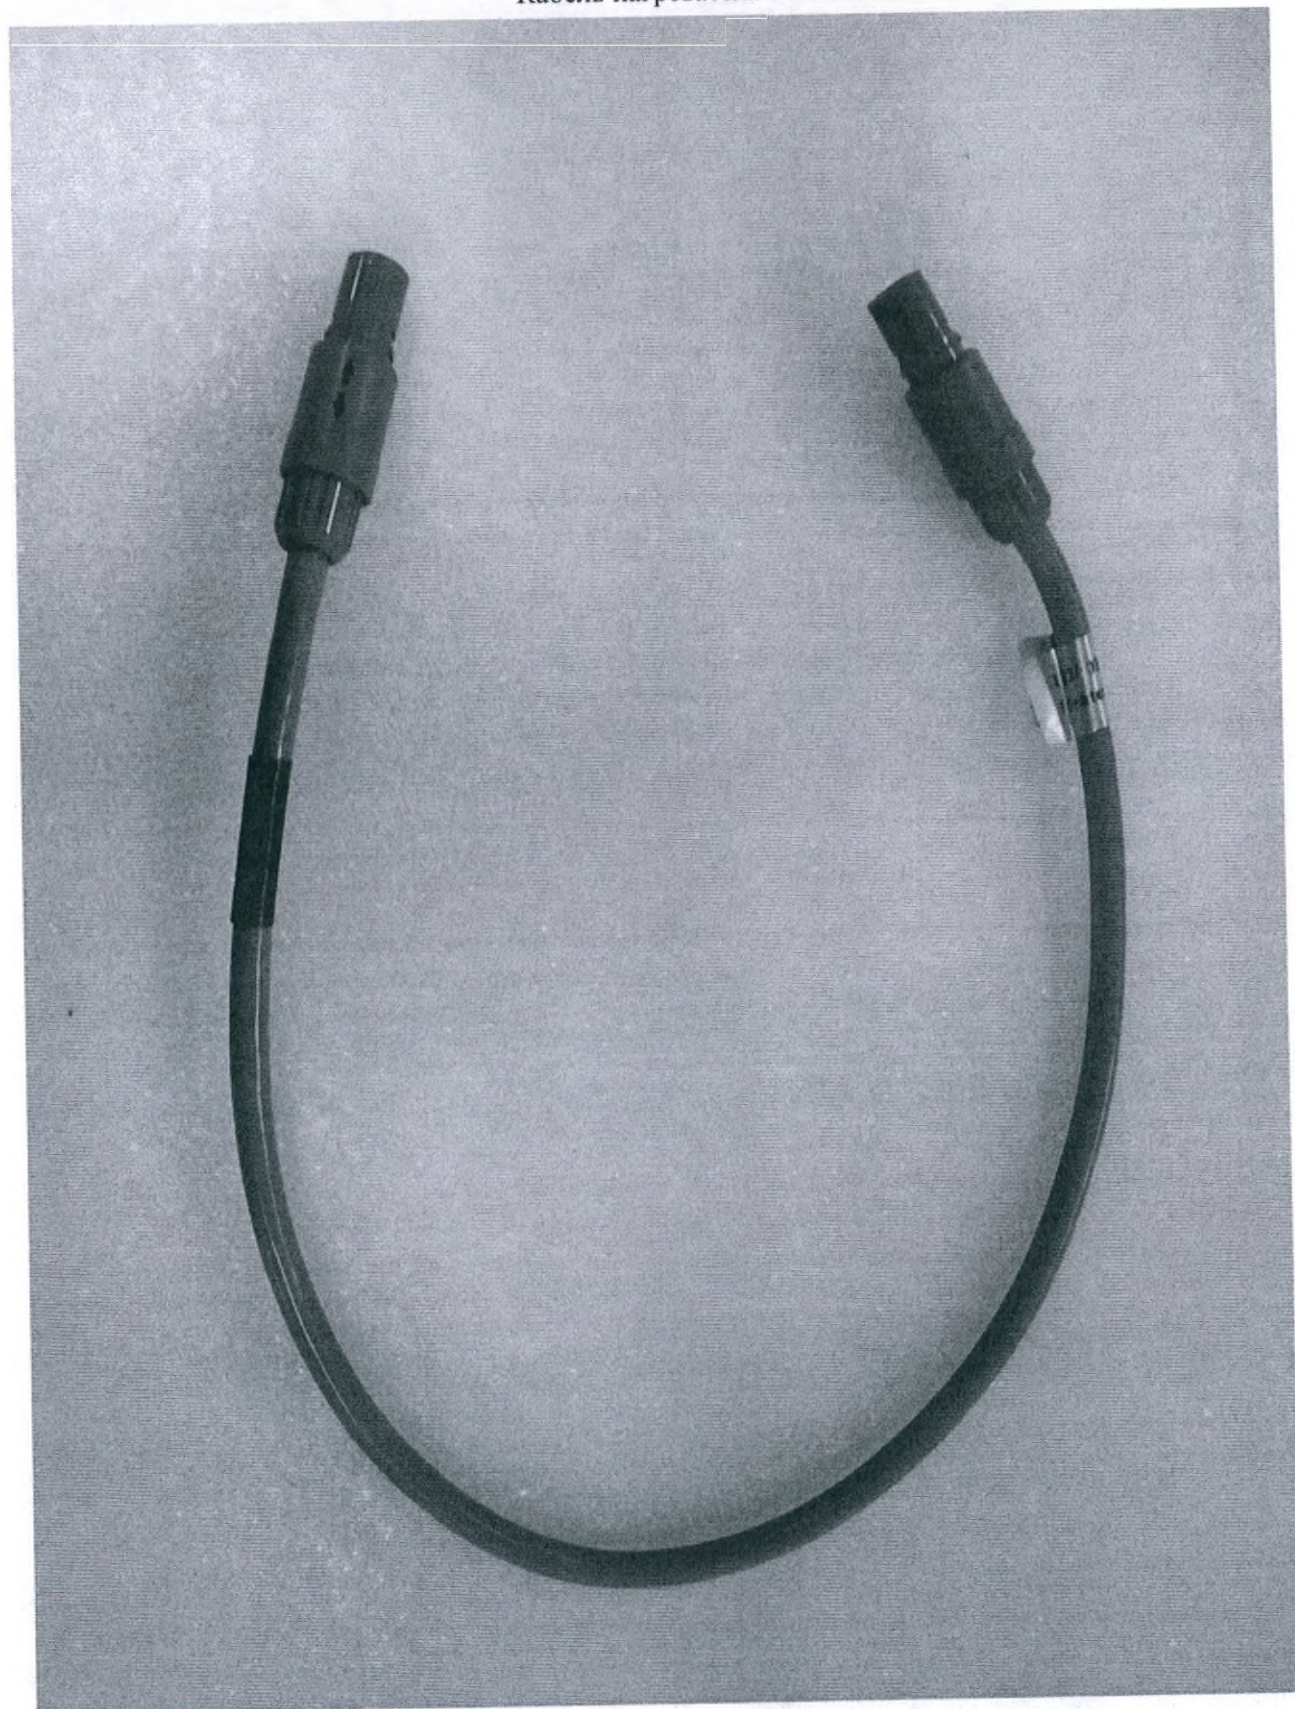


Линия отбора проб

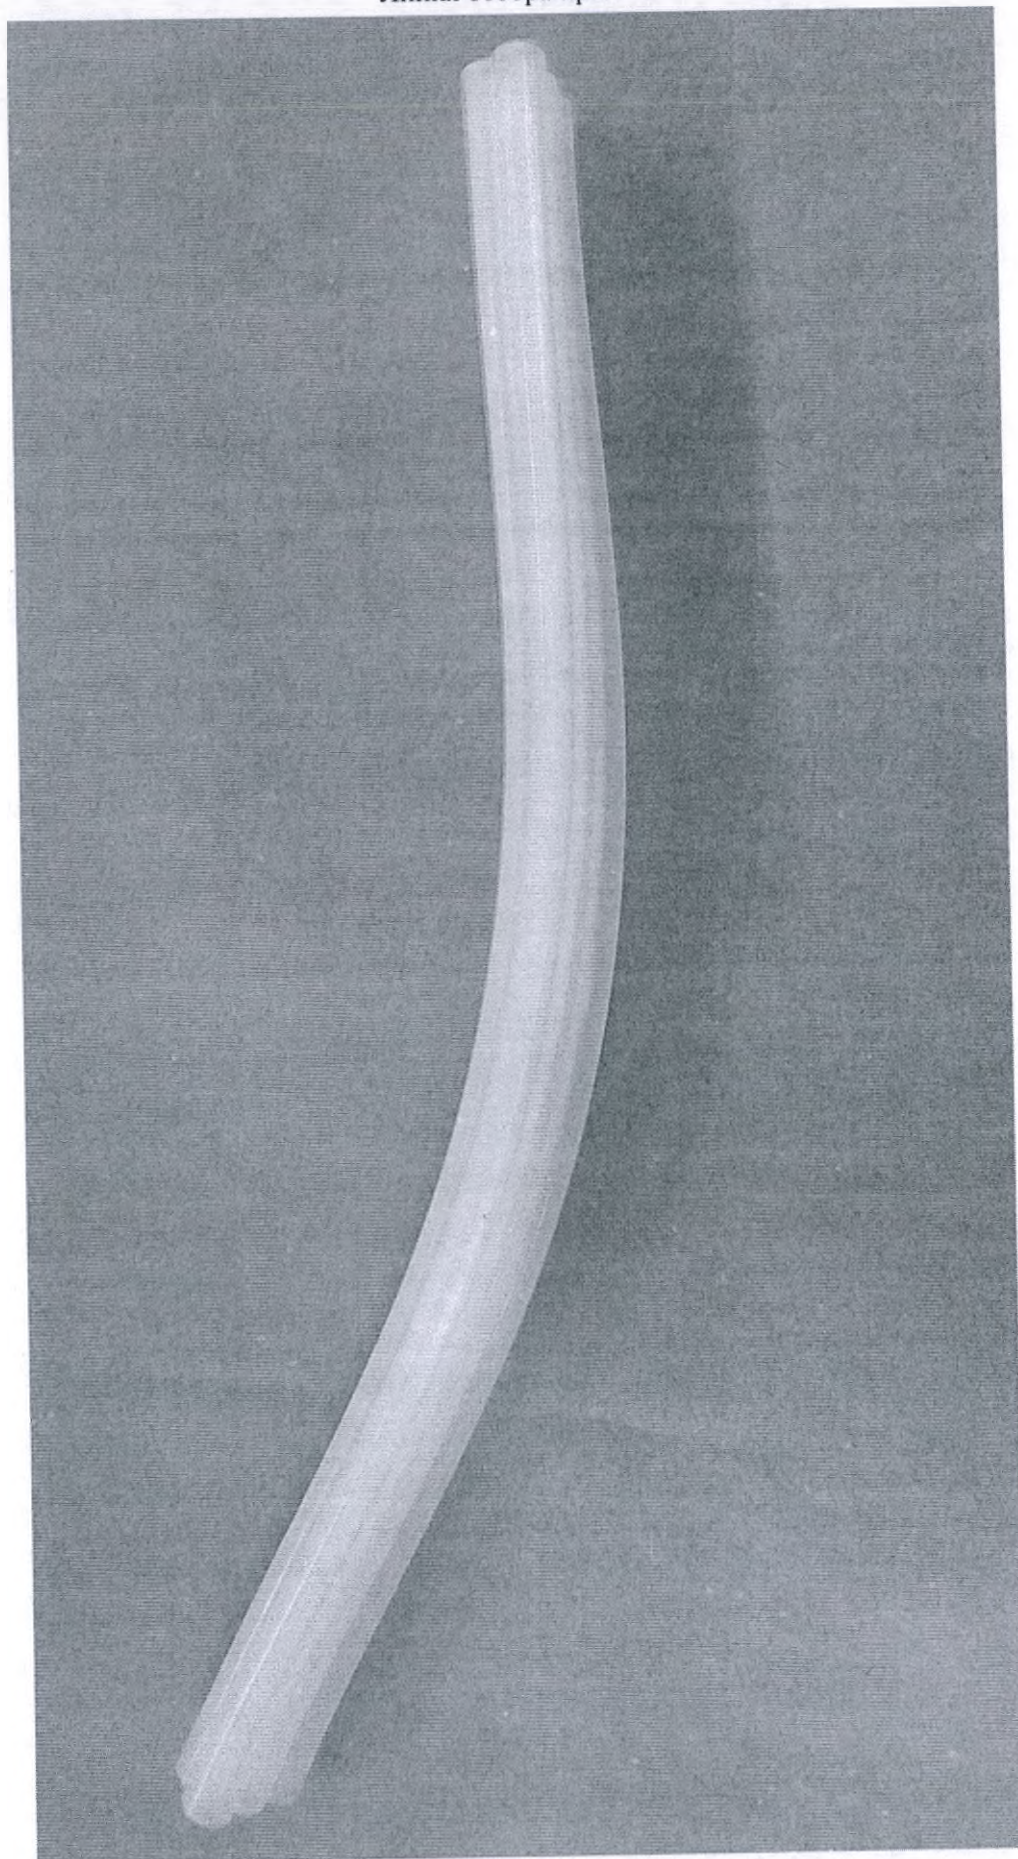


Блок активной эвакуации отработанных газов, (при необходимости)




Шланг блока активной эвакуации отработанных газов, (при необходимости)

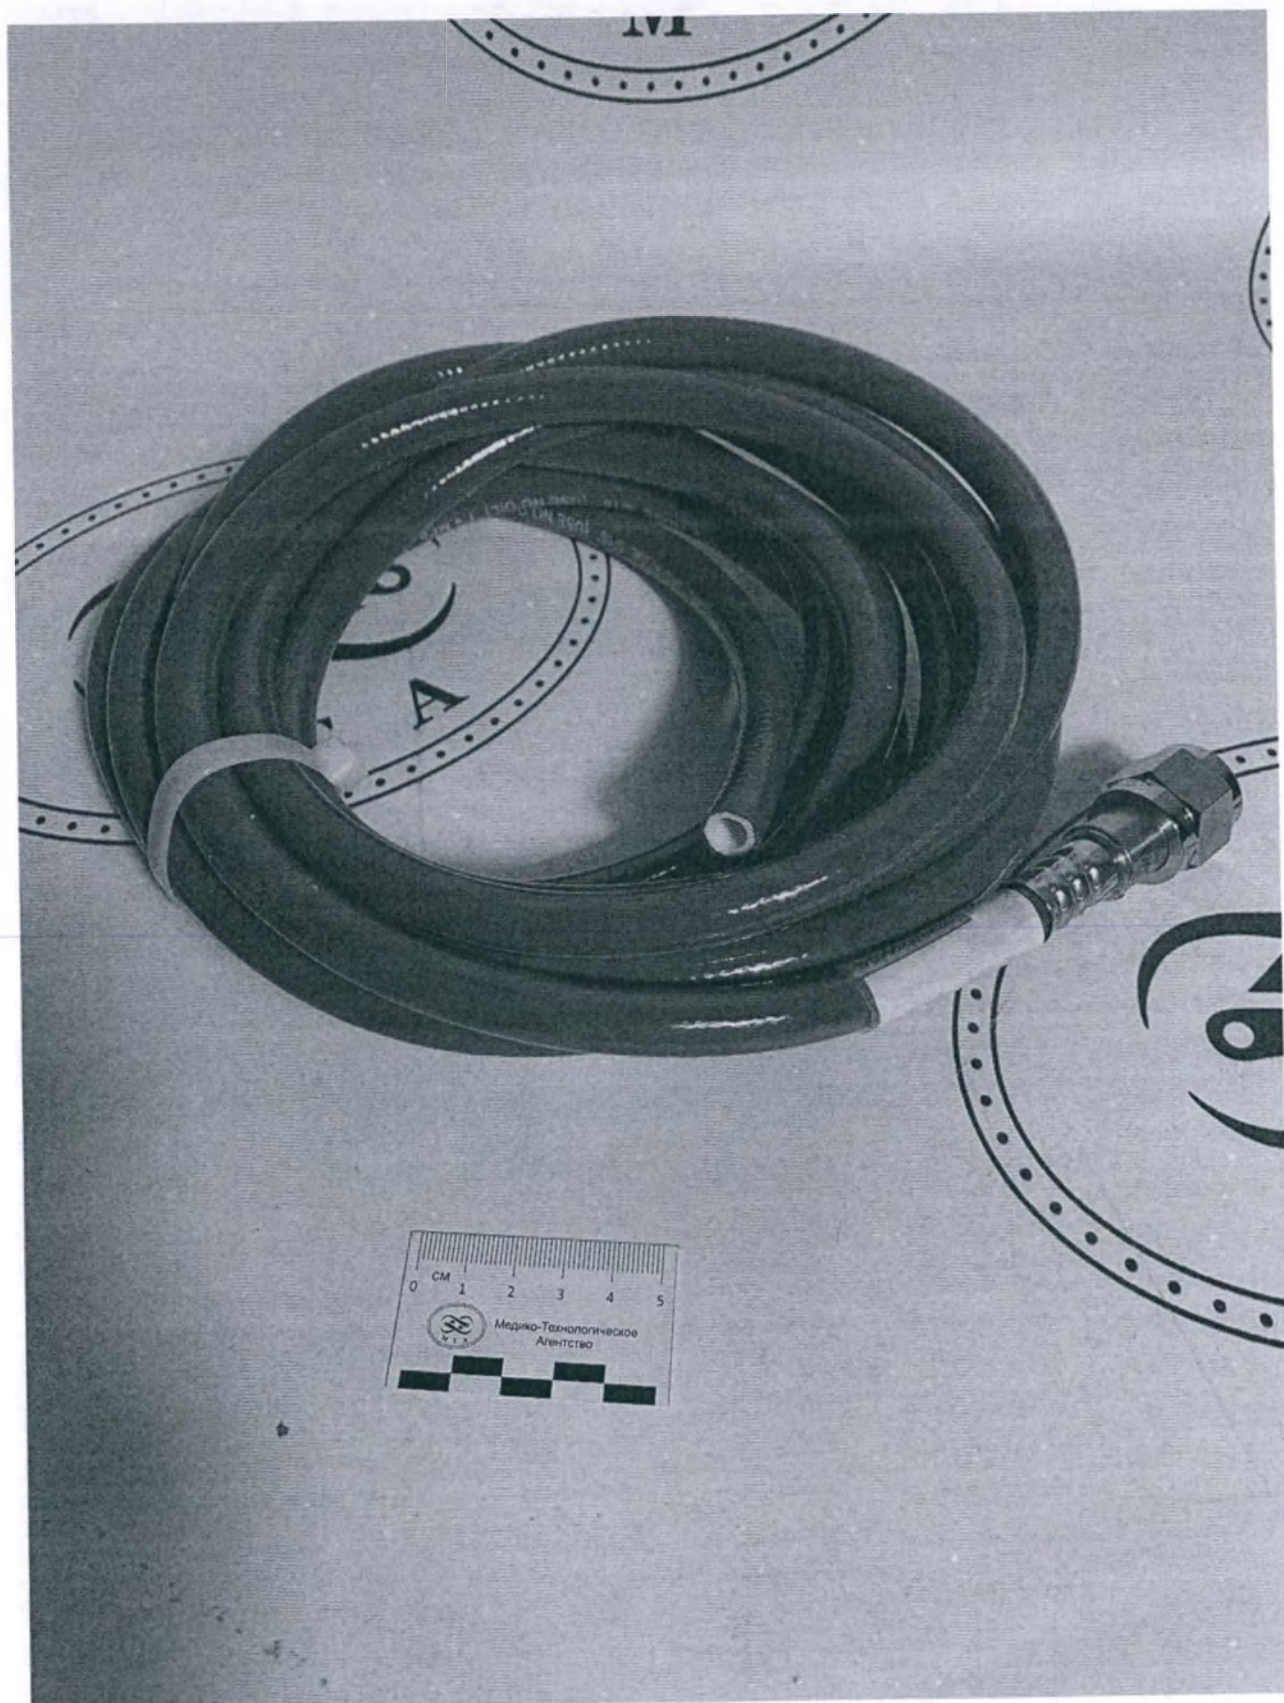


Переходник для блока активной эвакуации отработанных газов (при необходимости)

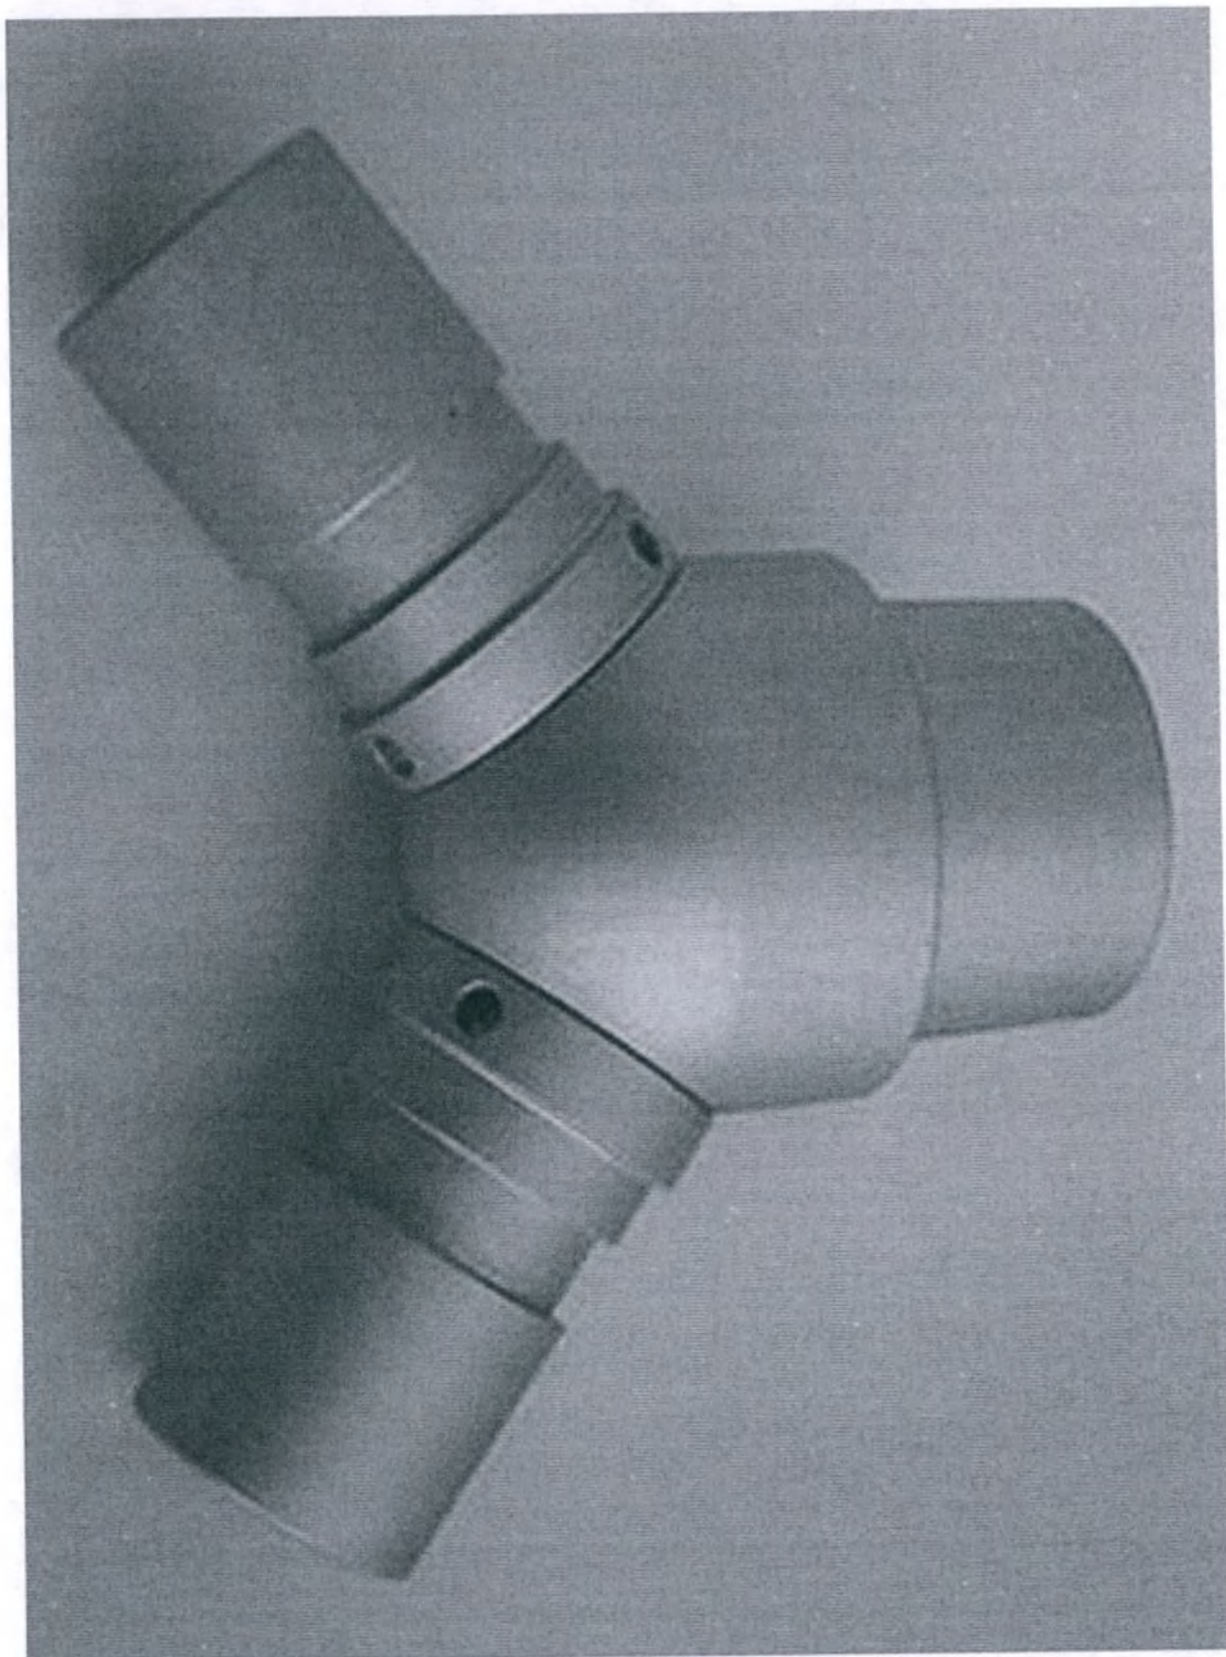


Набор для капнографии (датчик капнографии; адаптер воздушный; фиксатор датчика капнографии)
(при необходимости)

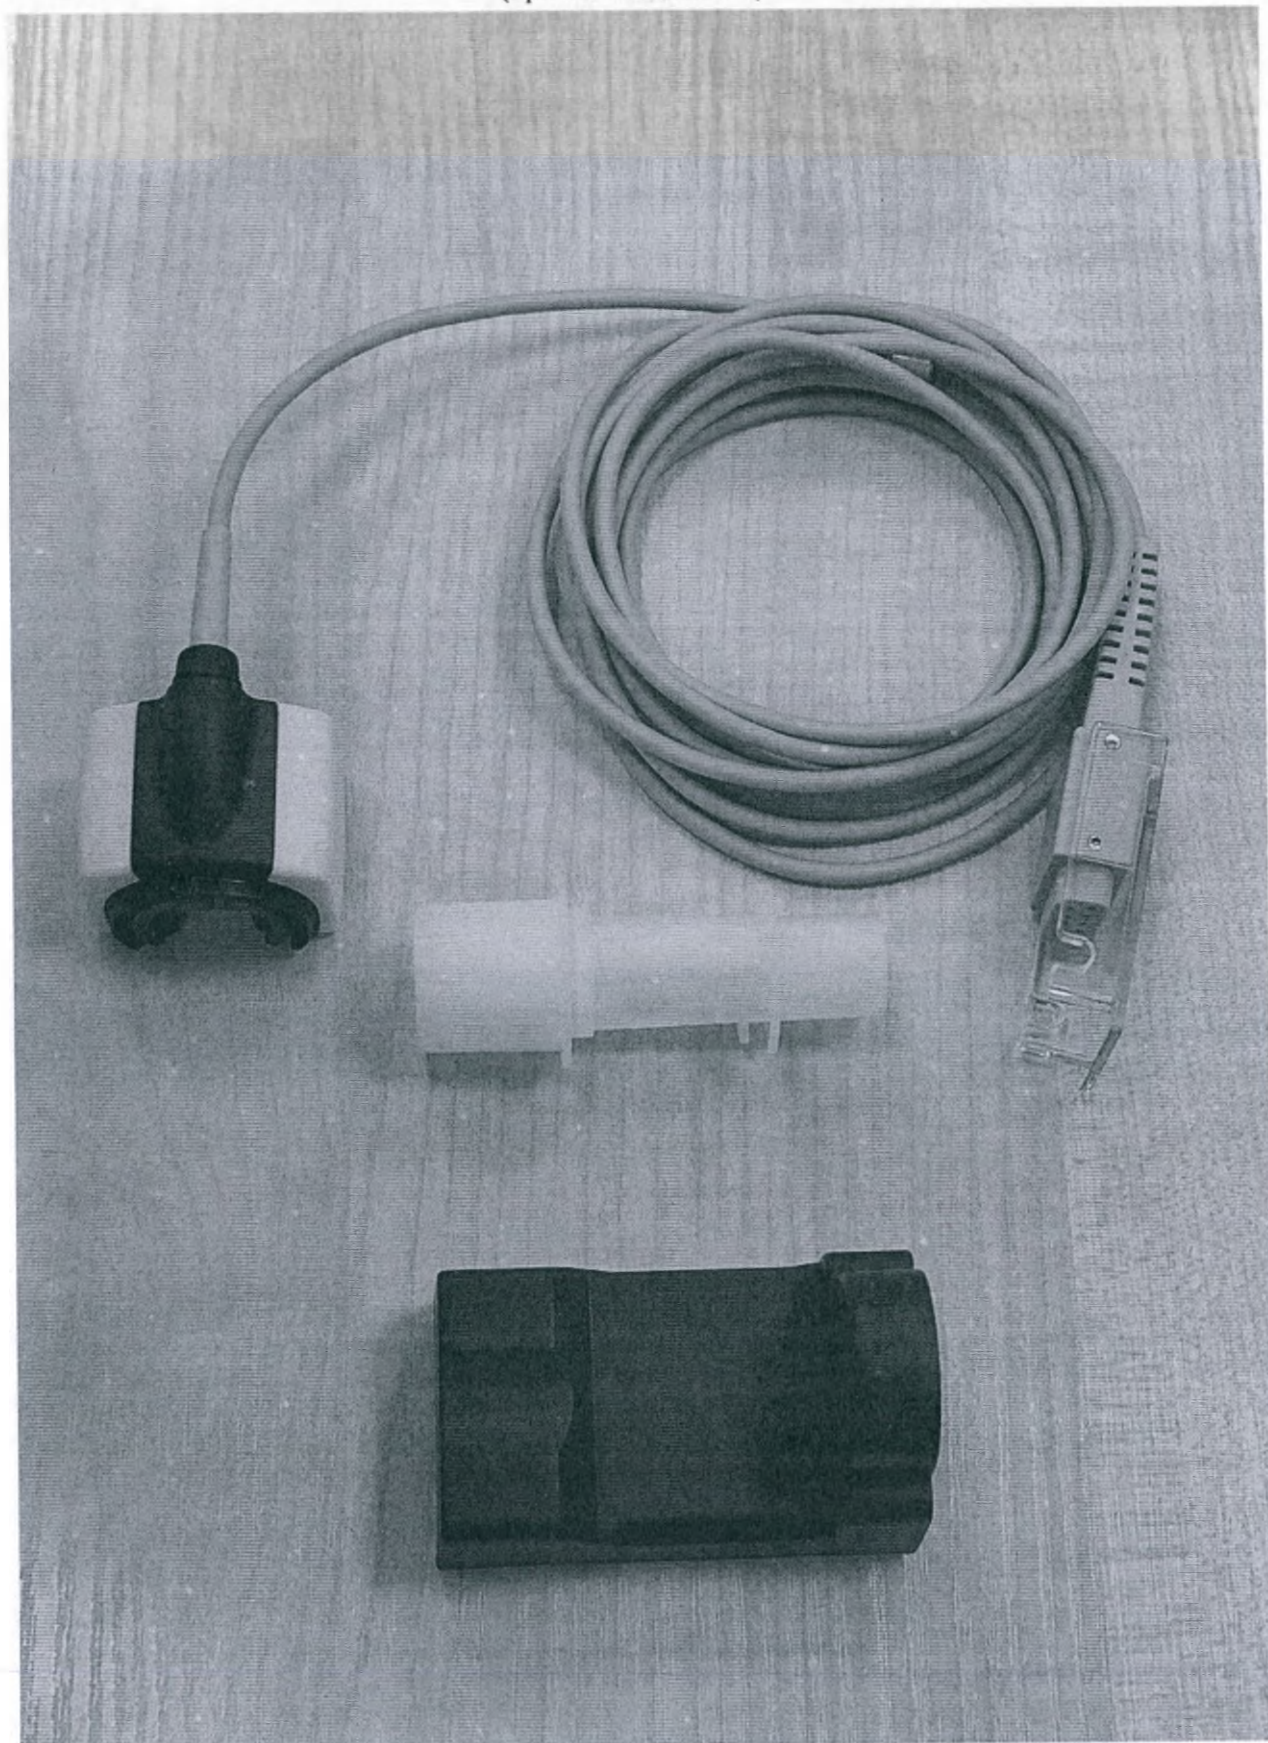


Датчик измерения мультигаса в основном потоке (IRMA AX+) (при необходимости)

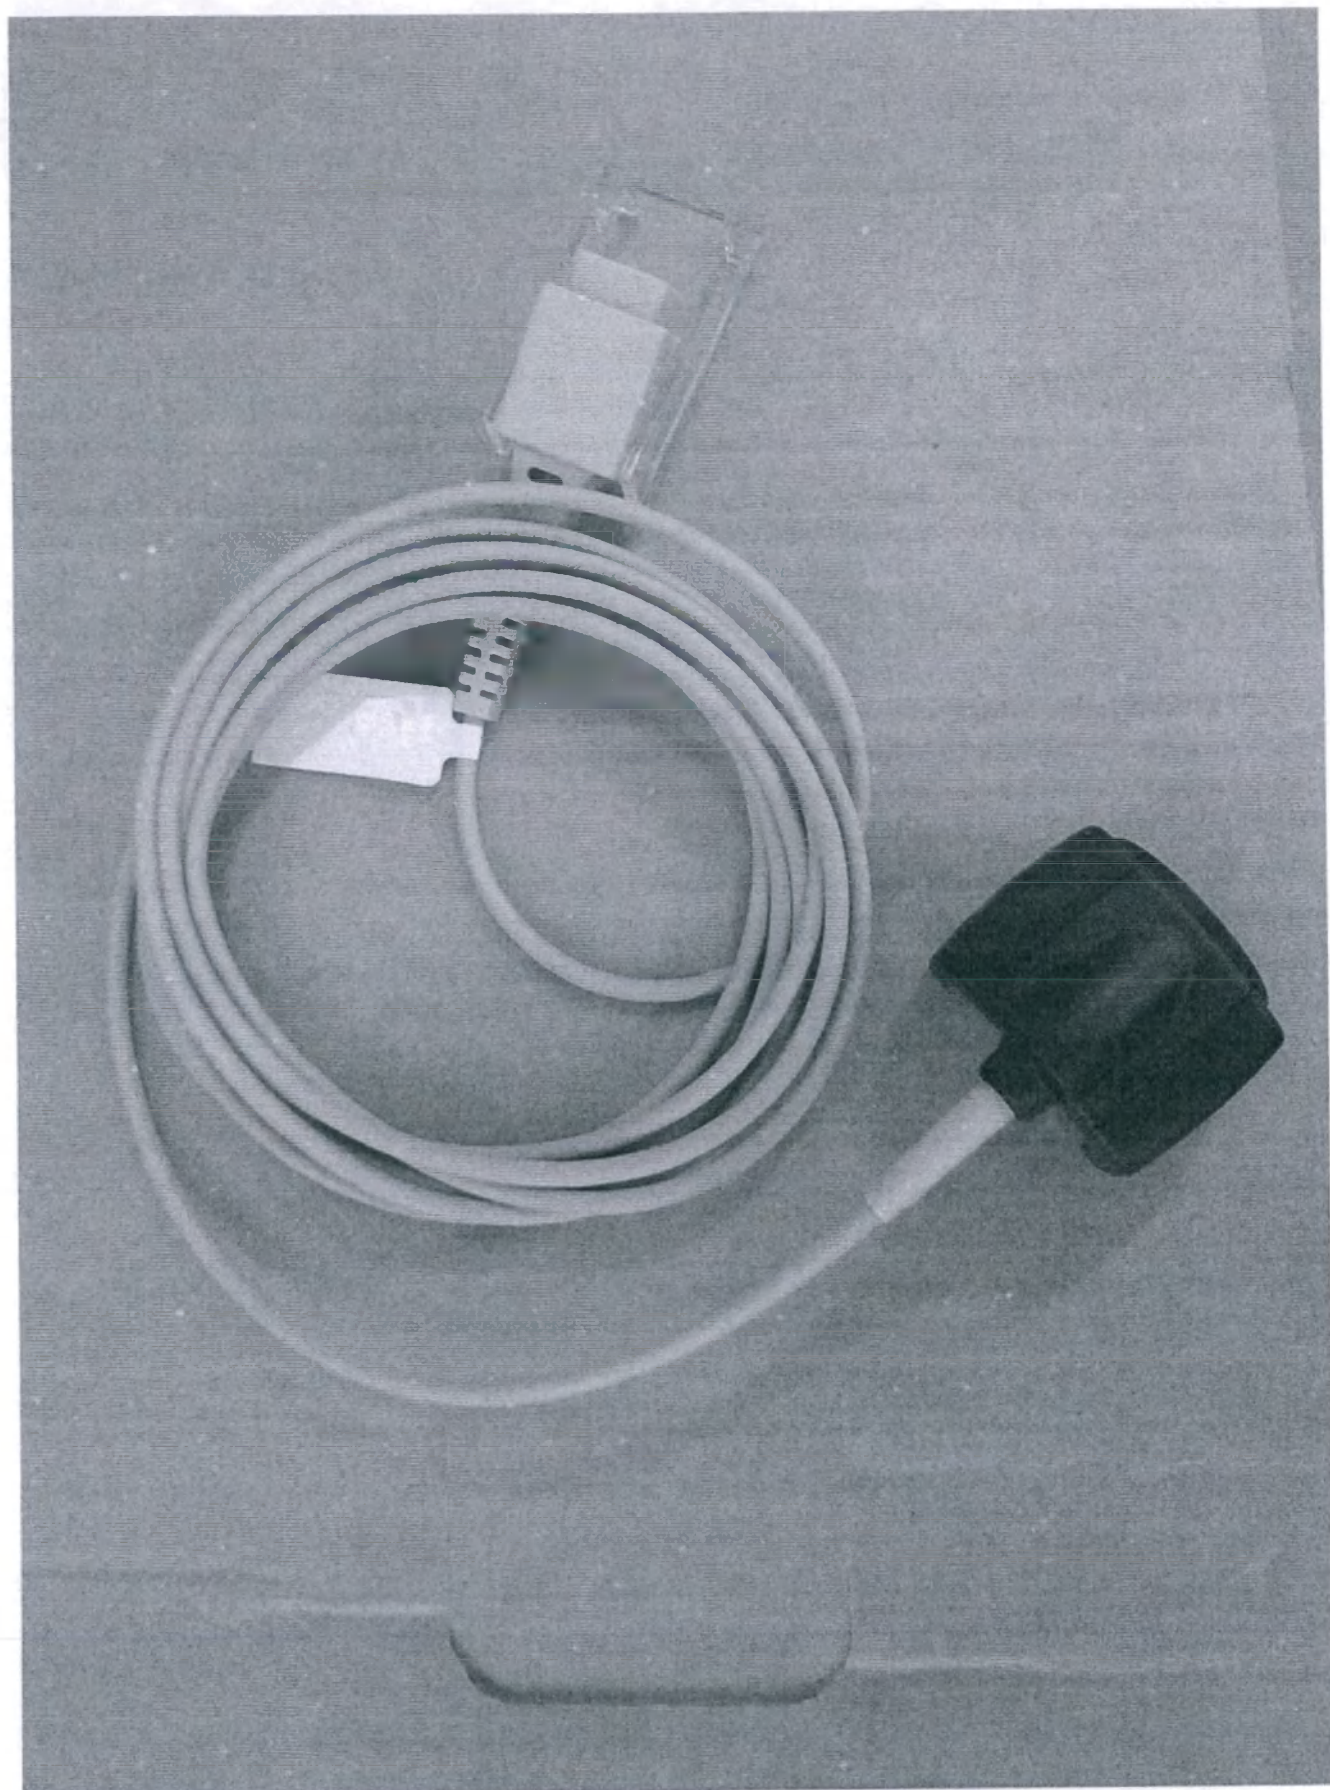

Блок удаления жидкости, (при необходимости)

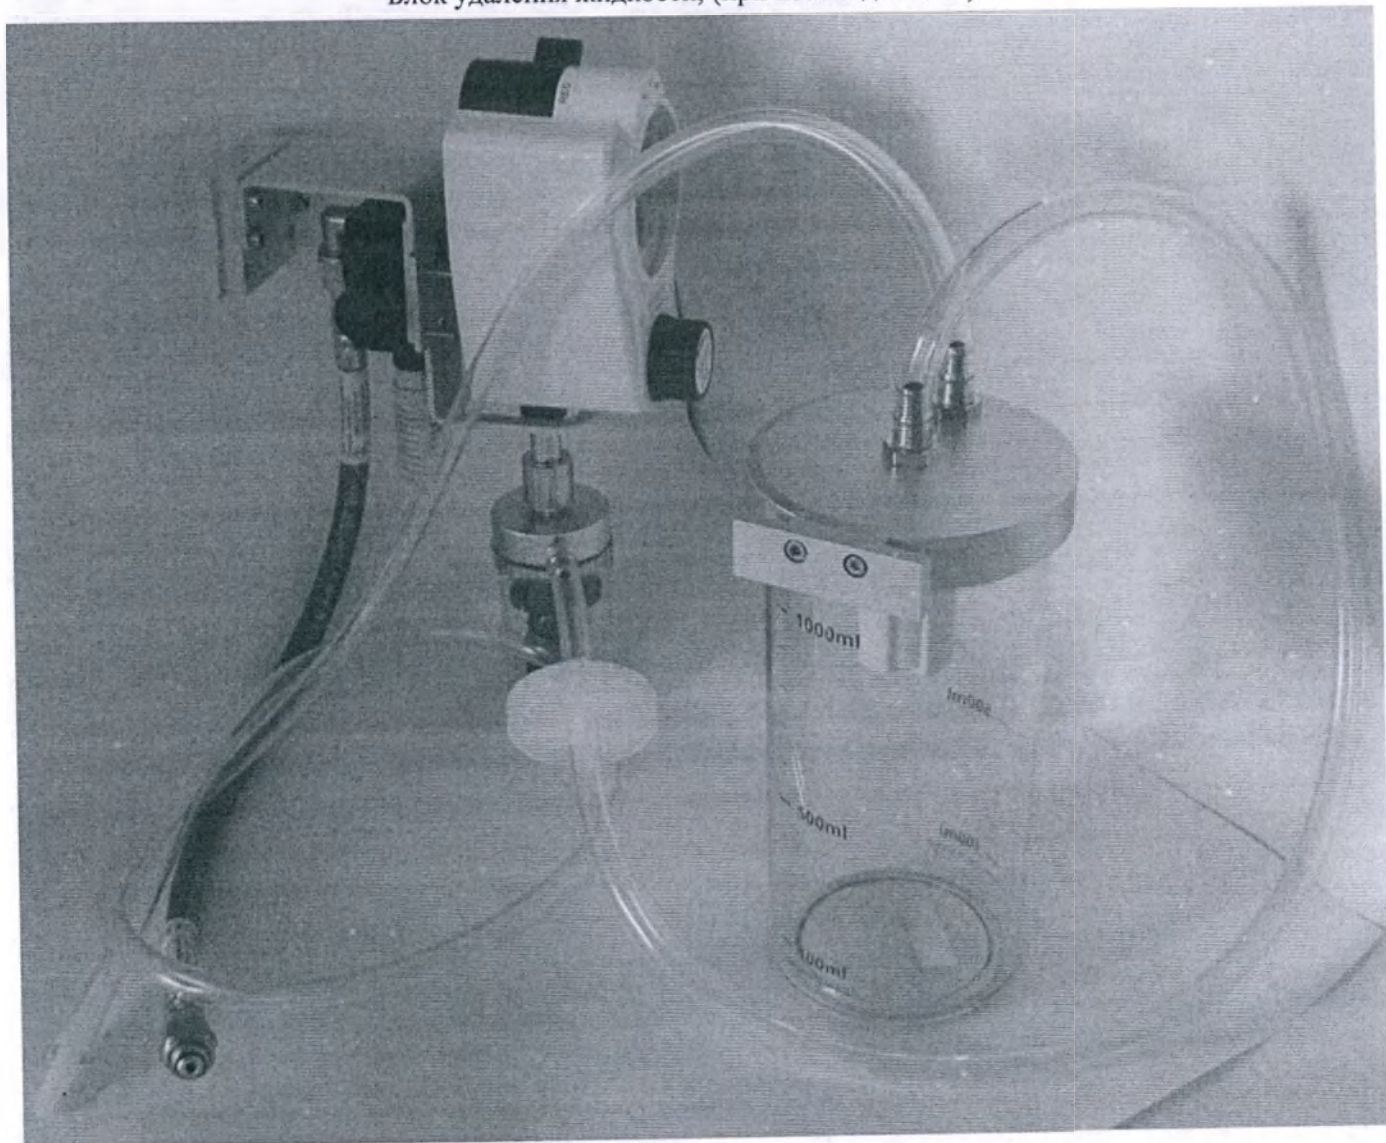


Фильтр для блока удаления жидкости (при необходимости);

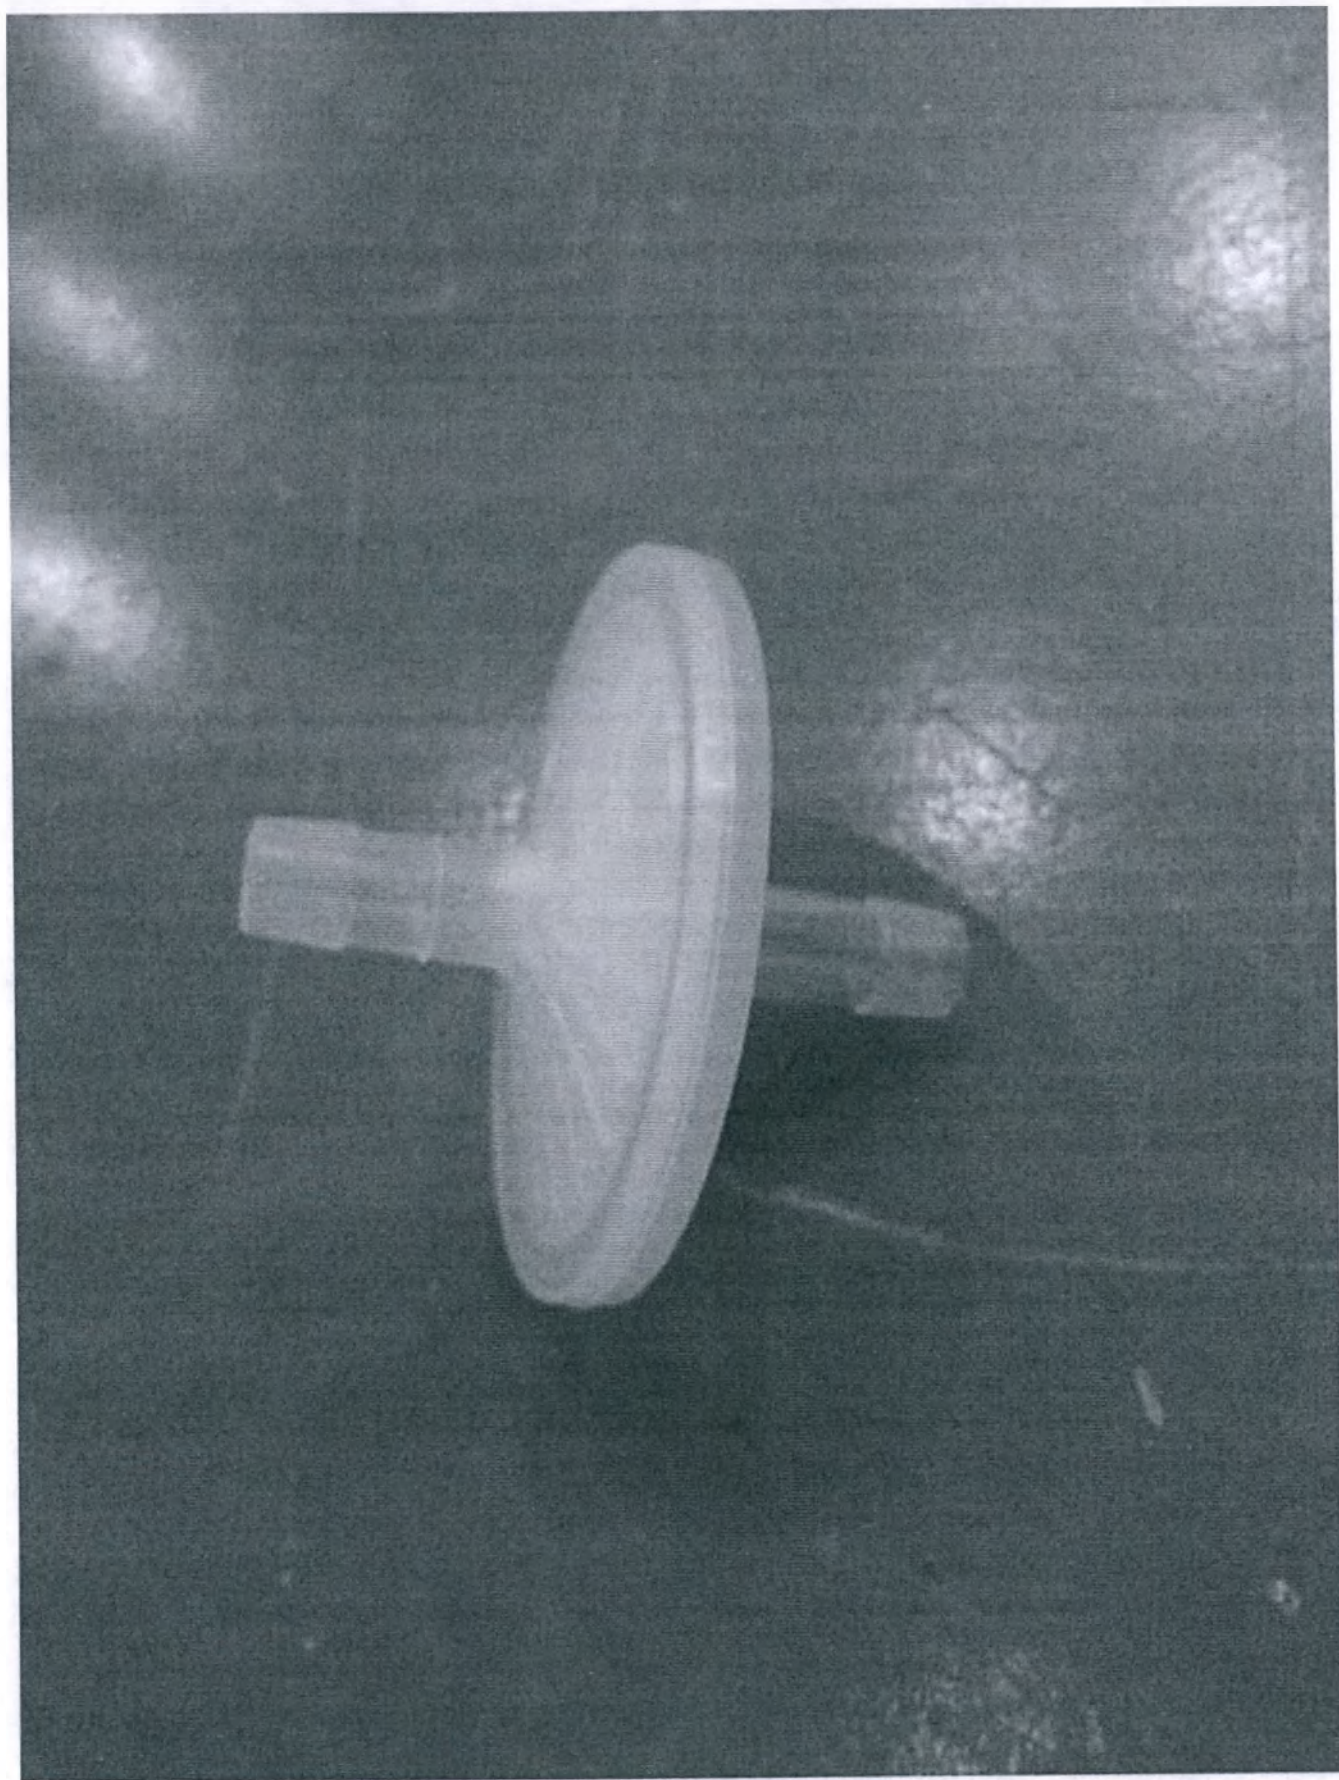

Шланг дыхательный детский (при необходимости)



Лицевые маски (взрослые, детские) (при необходимости)

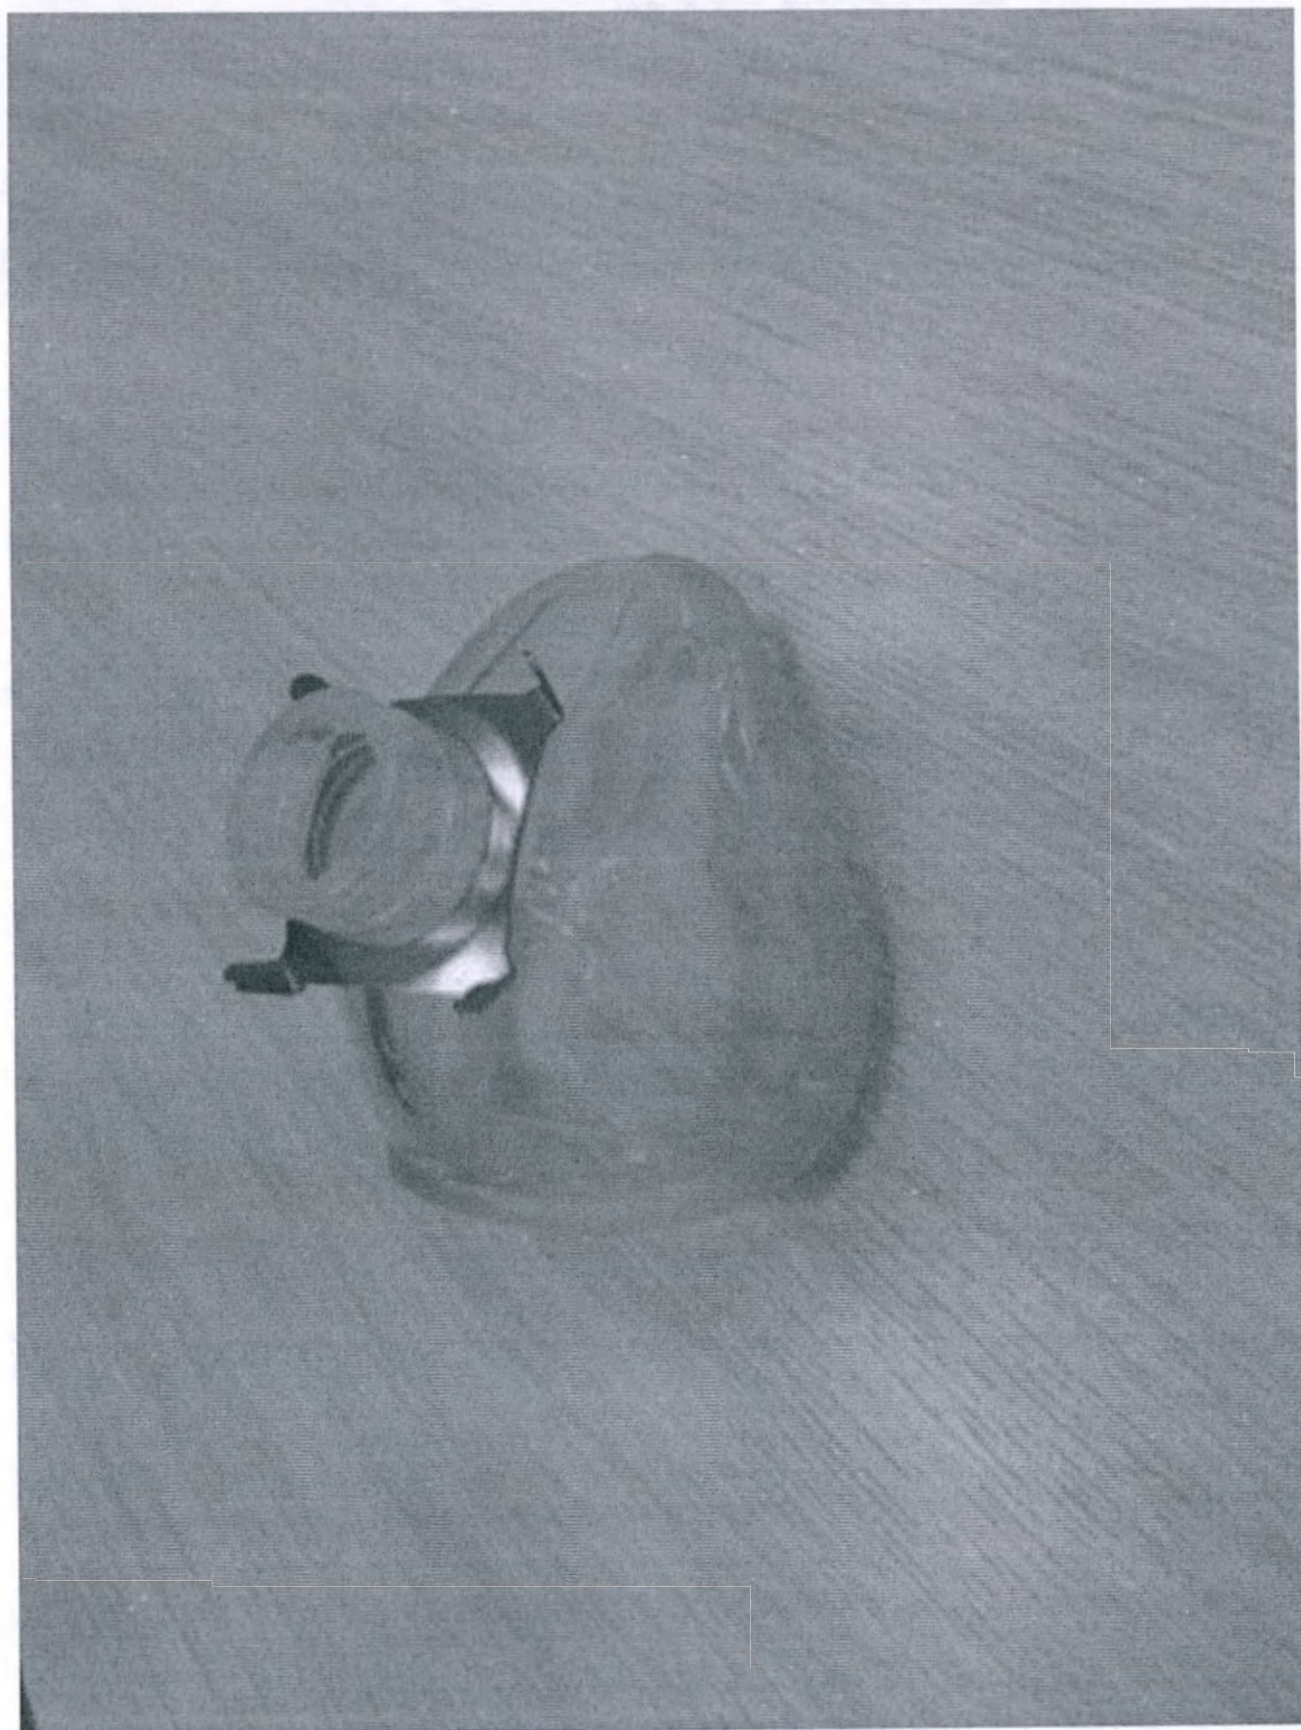


Предохранитель плавкий Т2АН250VАС (КФИП.944460.004.009) (при необходимости)




Предохранитель плавкий F10AH250VAC (КФИП.944460.004.010) (при необходимости)




Кольцо уплотнительное сменное, размер 14х2,65 мм (КФИП.944460.004.022) (при необходимости)

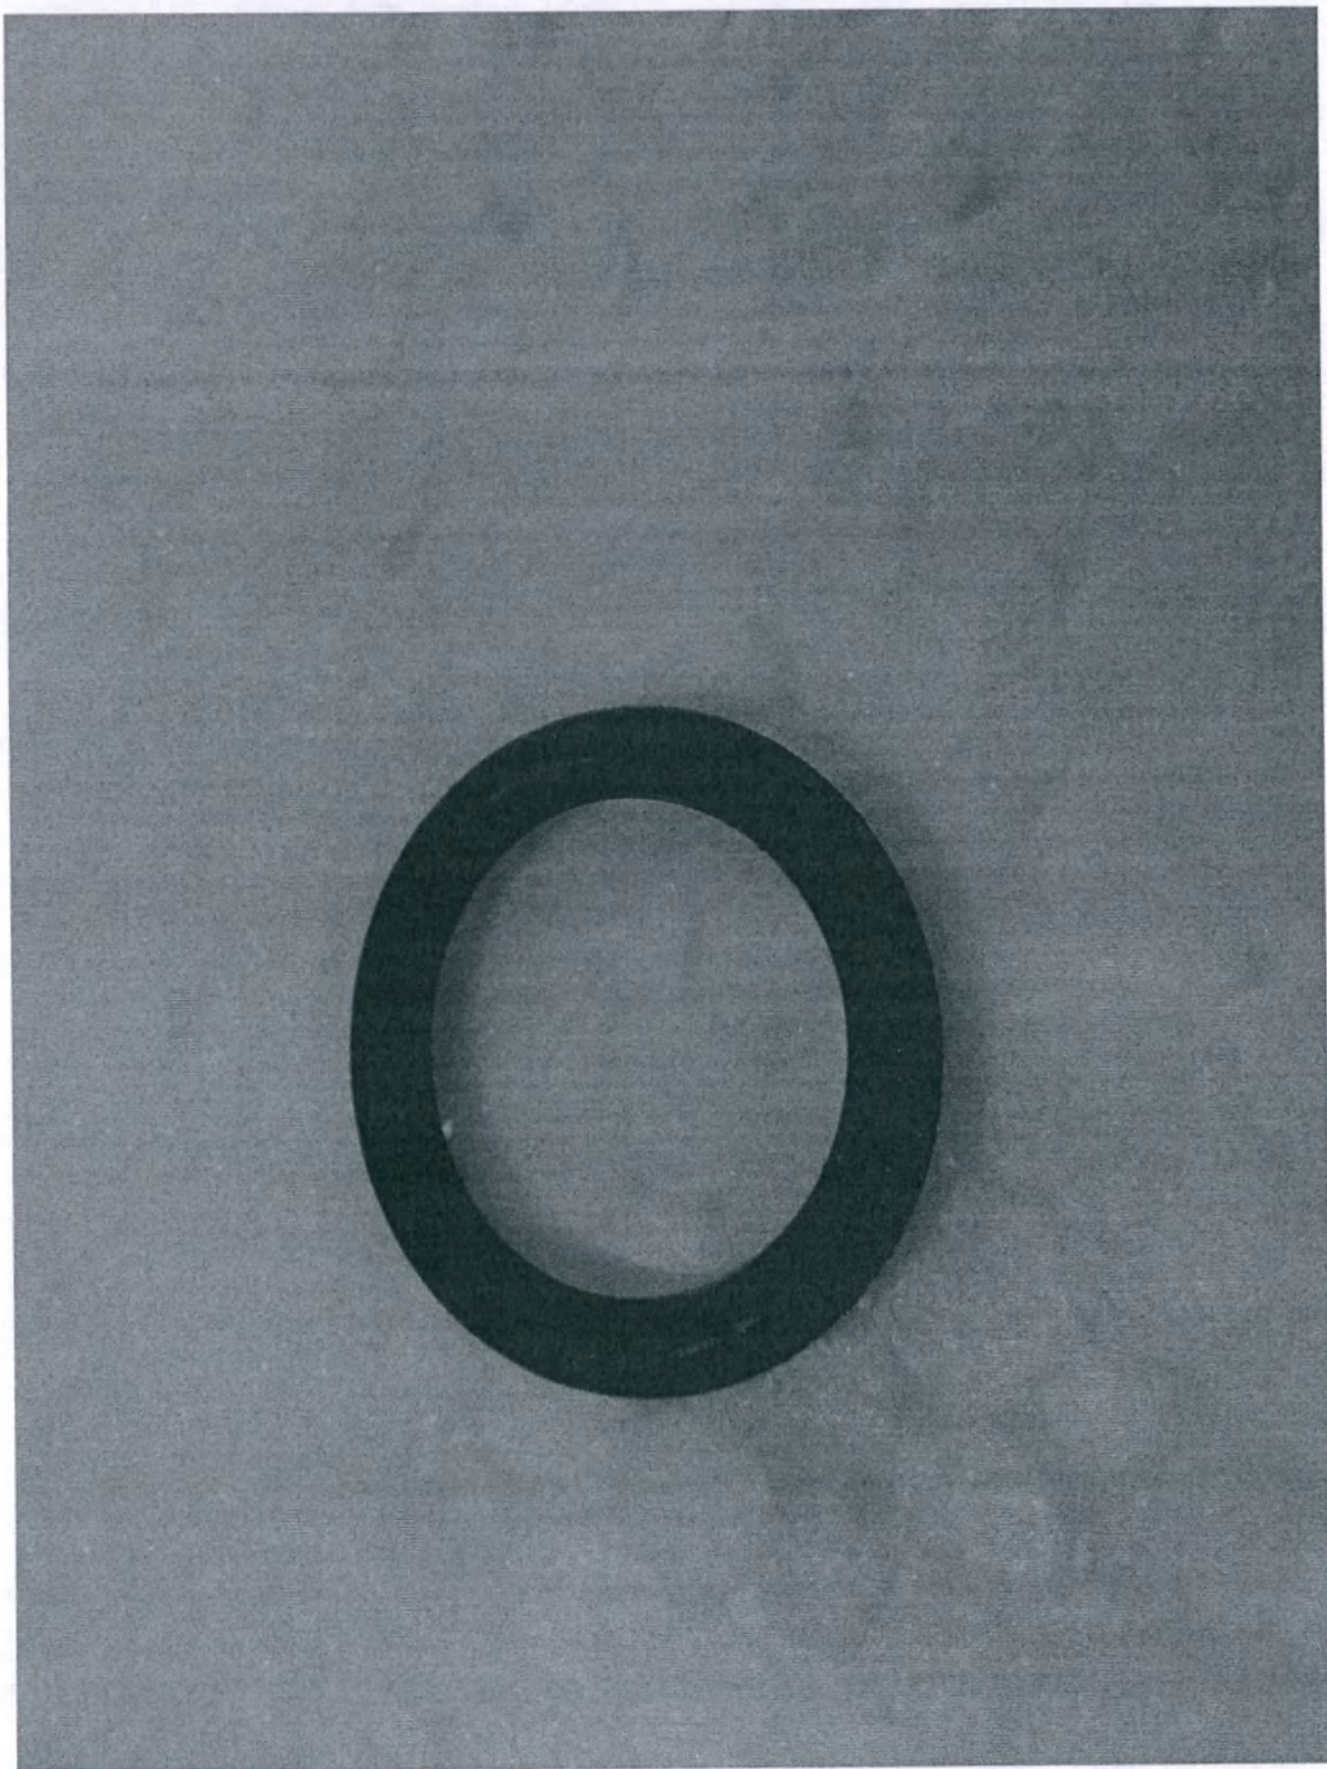

Кольцо уплотнительное сменное, размер 9х1,8 мм (КФИП.944460.004.023) (при необходимости)

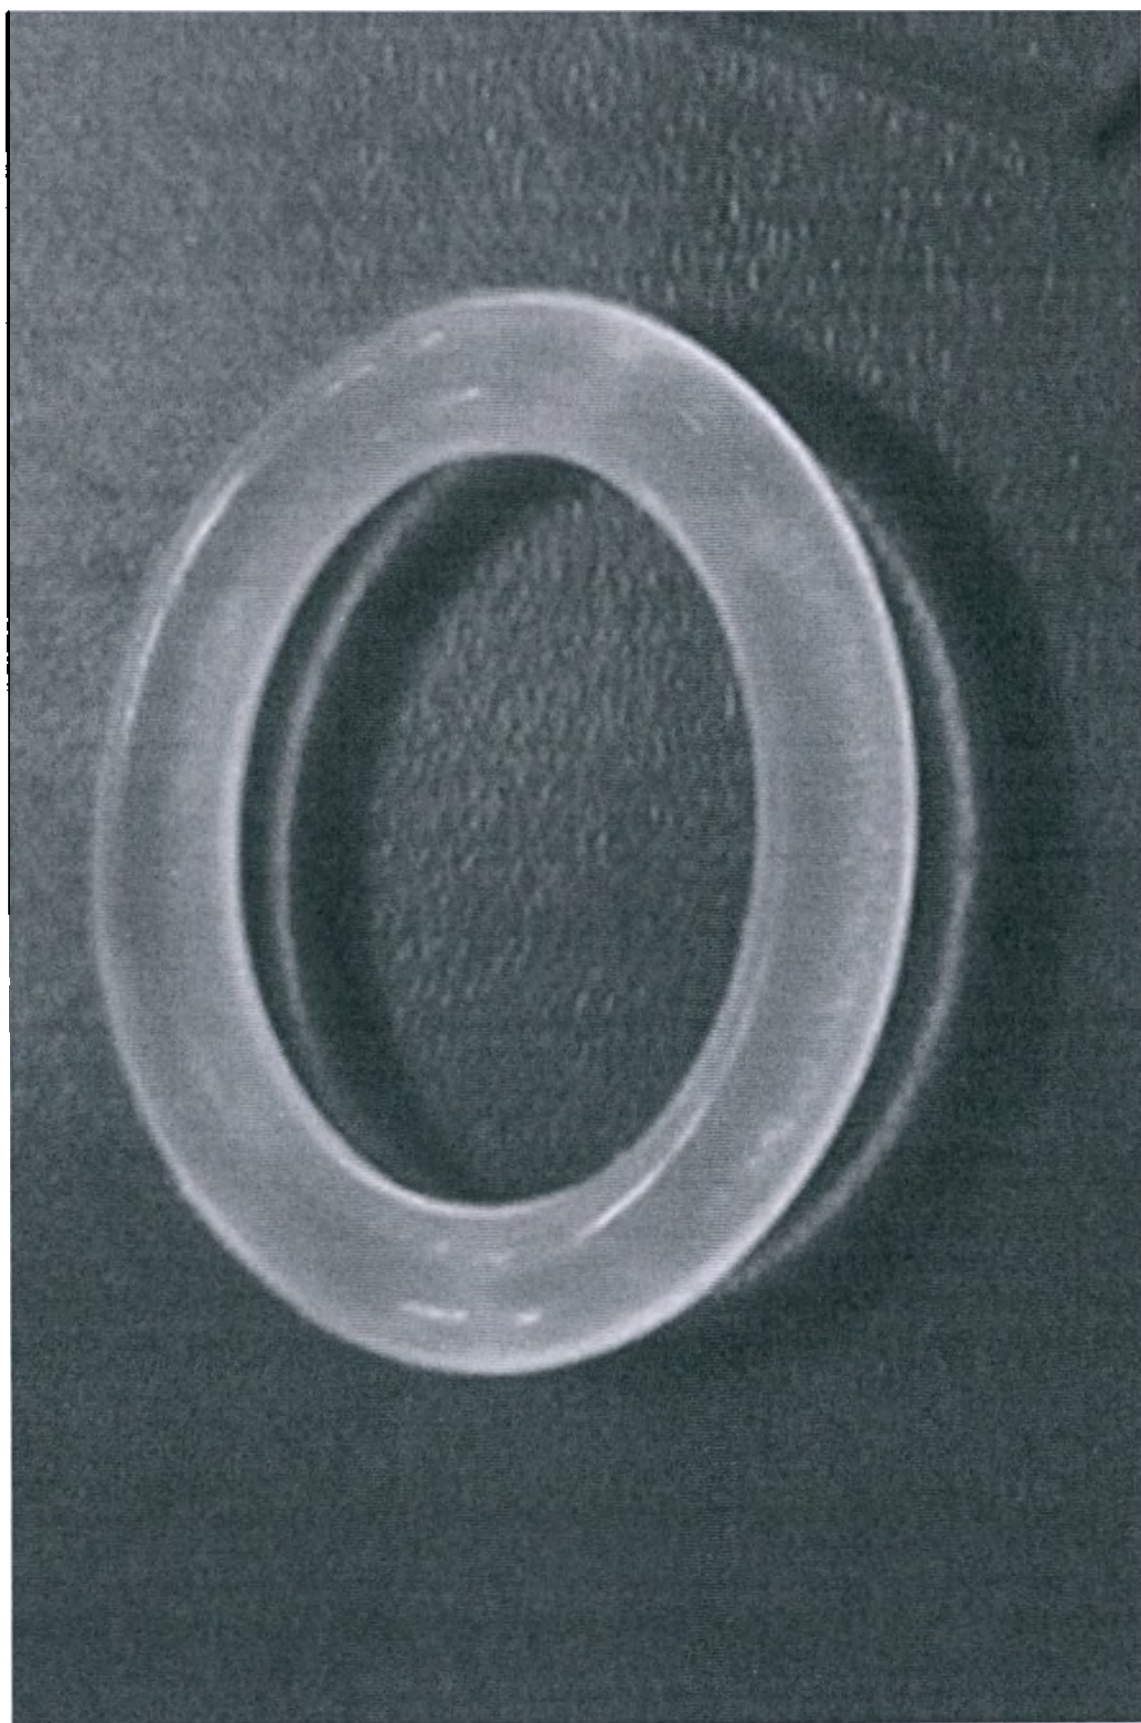

Кольцо уплотнительное сменное, размер 18х1,8 мм (КФИП.944460.004.024) (при необходимости)

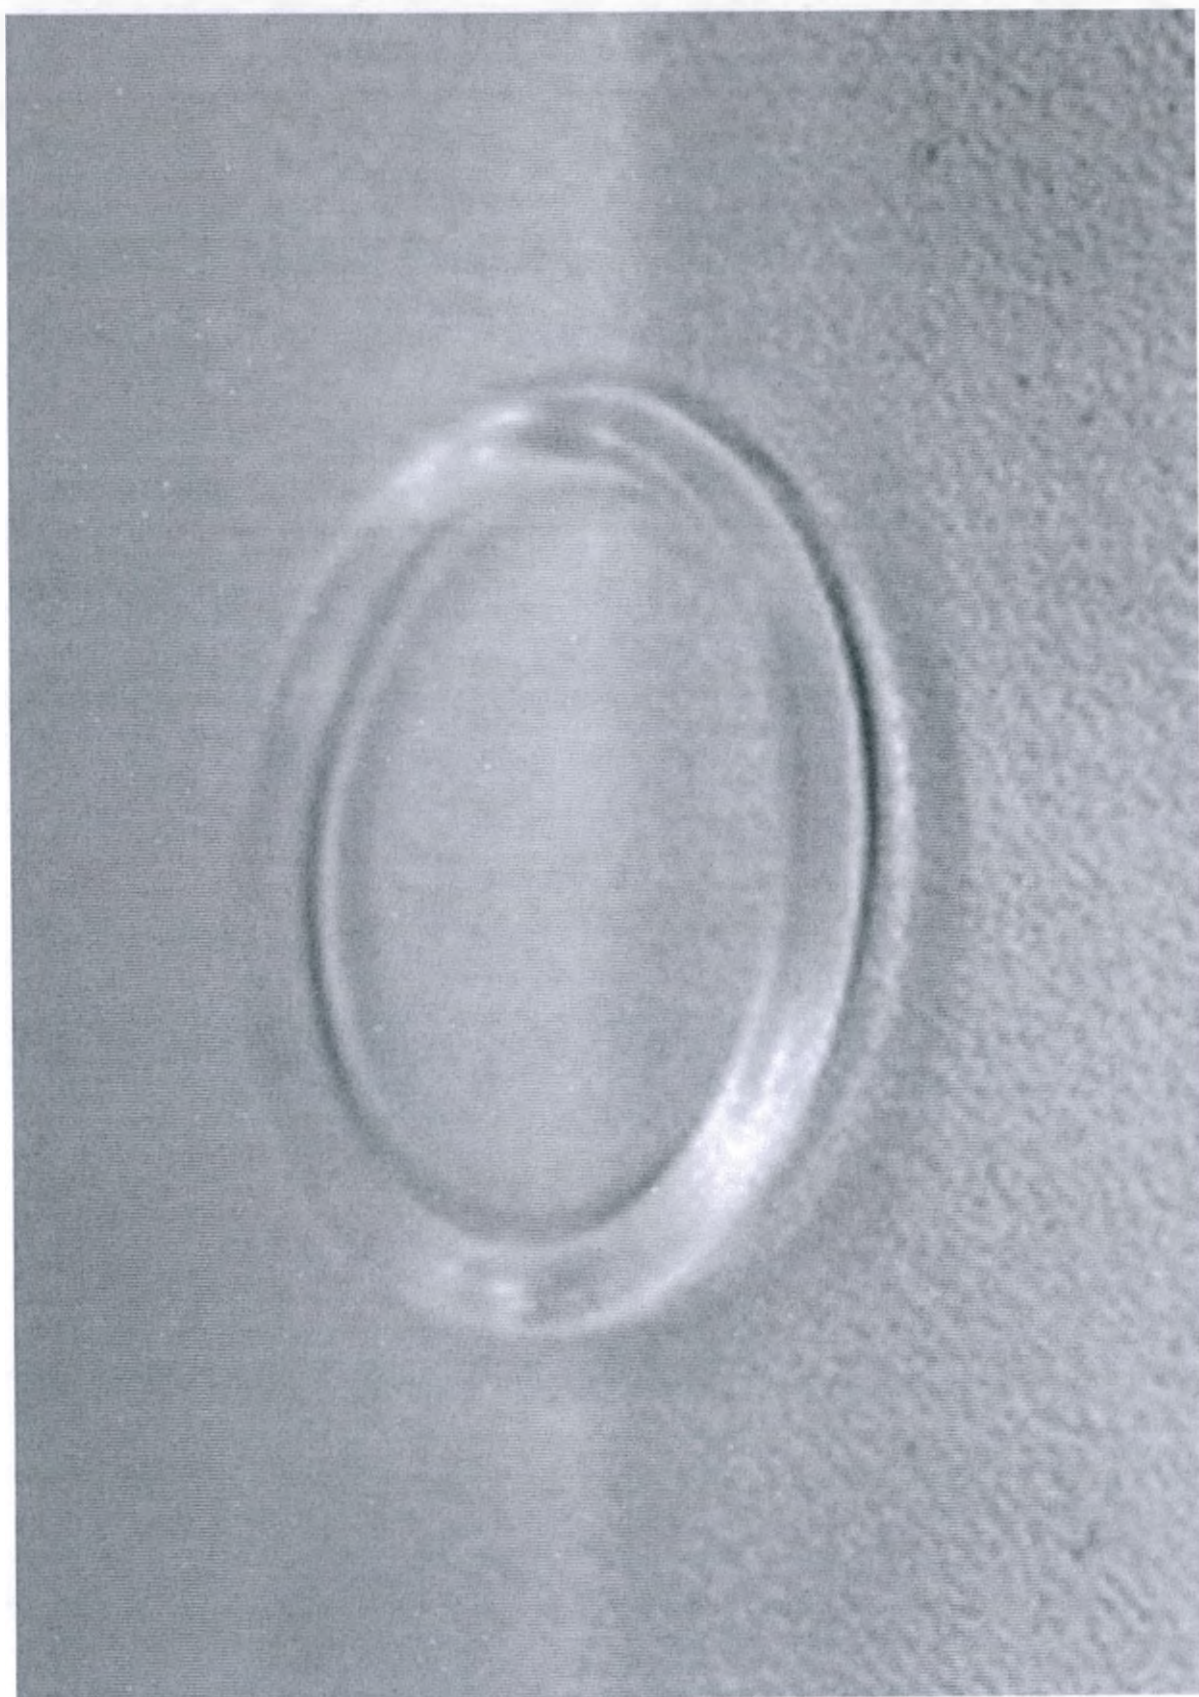


Кольцо уплотнительное сменное, размер 20х1,8 мм (КФИП.944460.004.025) (при необходимости)




Компрессор медицинского воздуха, (при необходимости)



Кабель питания компрессора медицинского воздуха, (при необходимости)

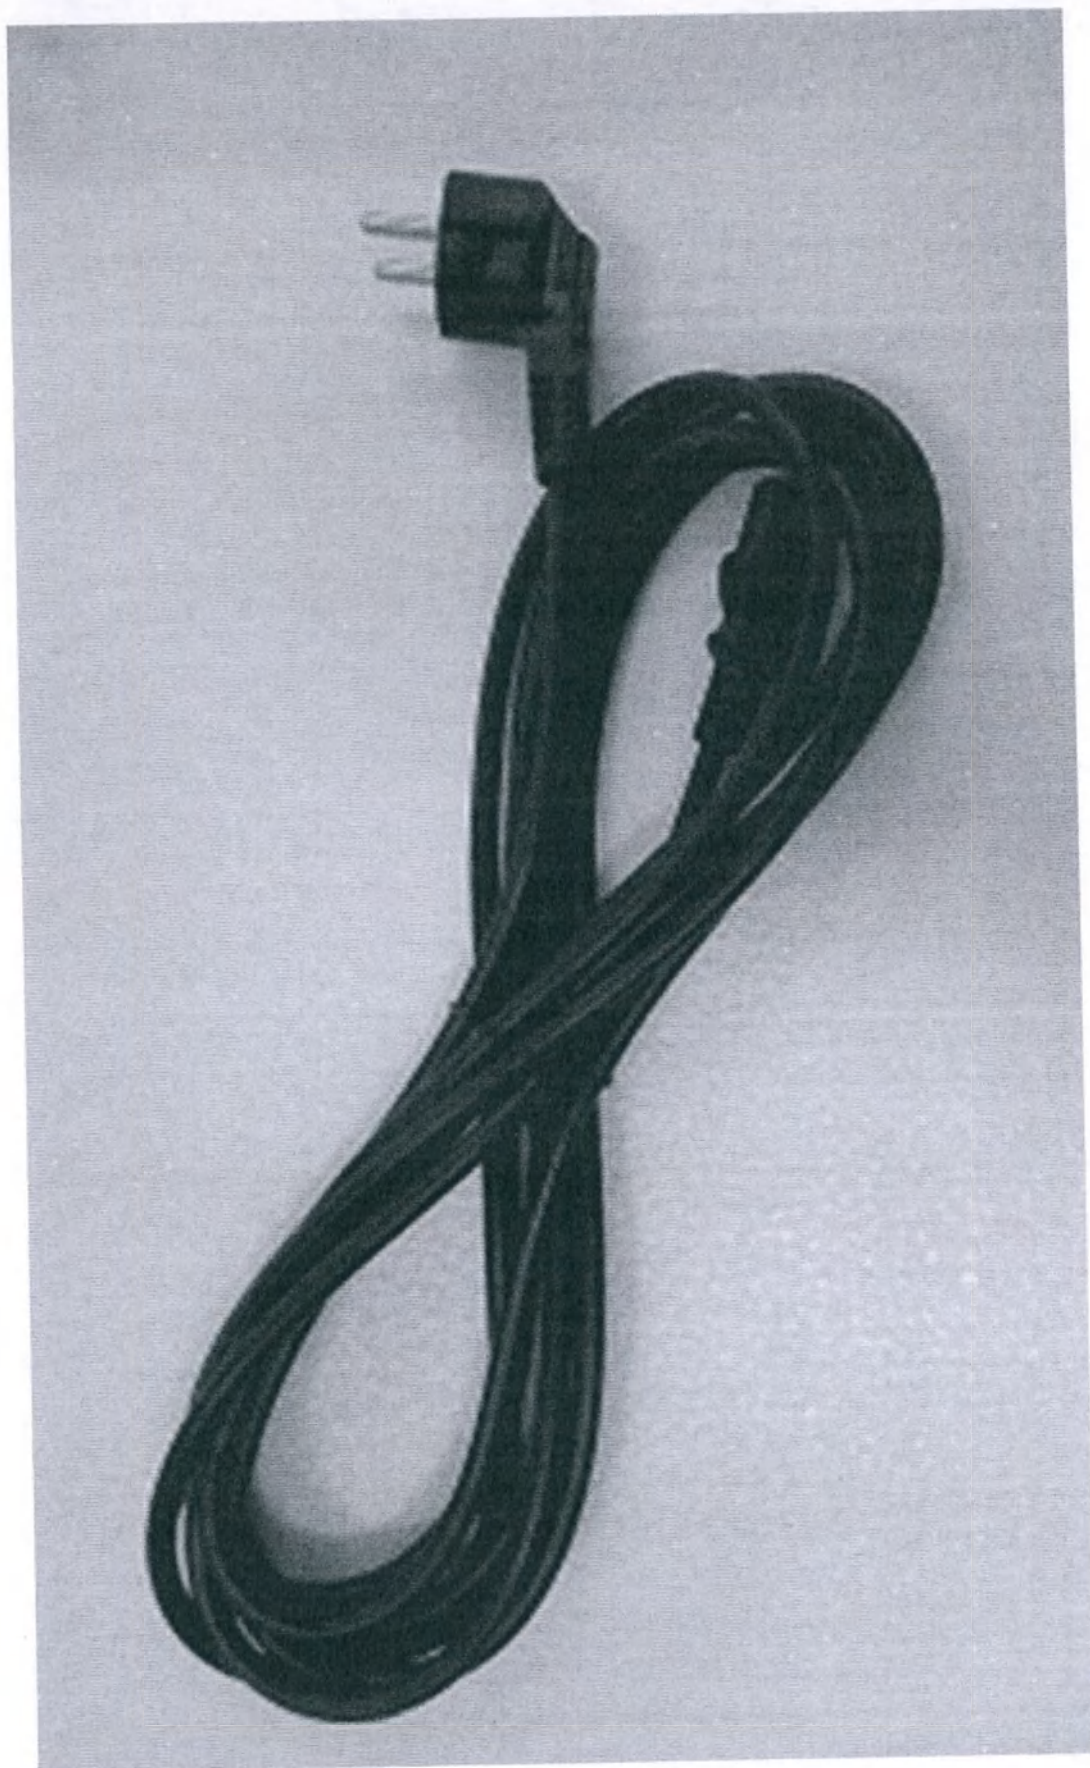

Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 по ТУ 26.60.12-018-32119398-2018
(при необходимости);

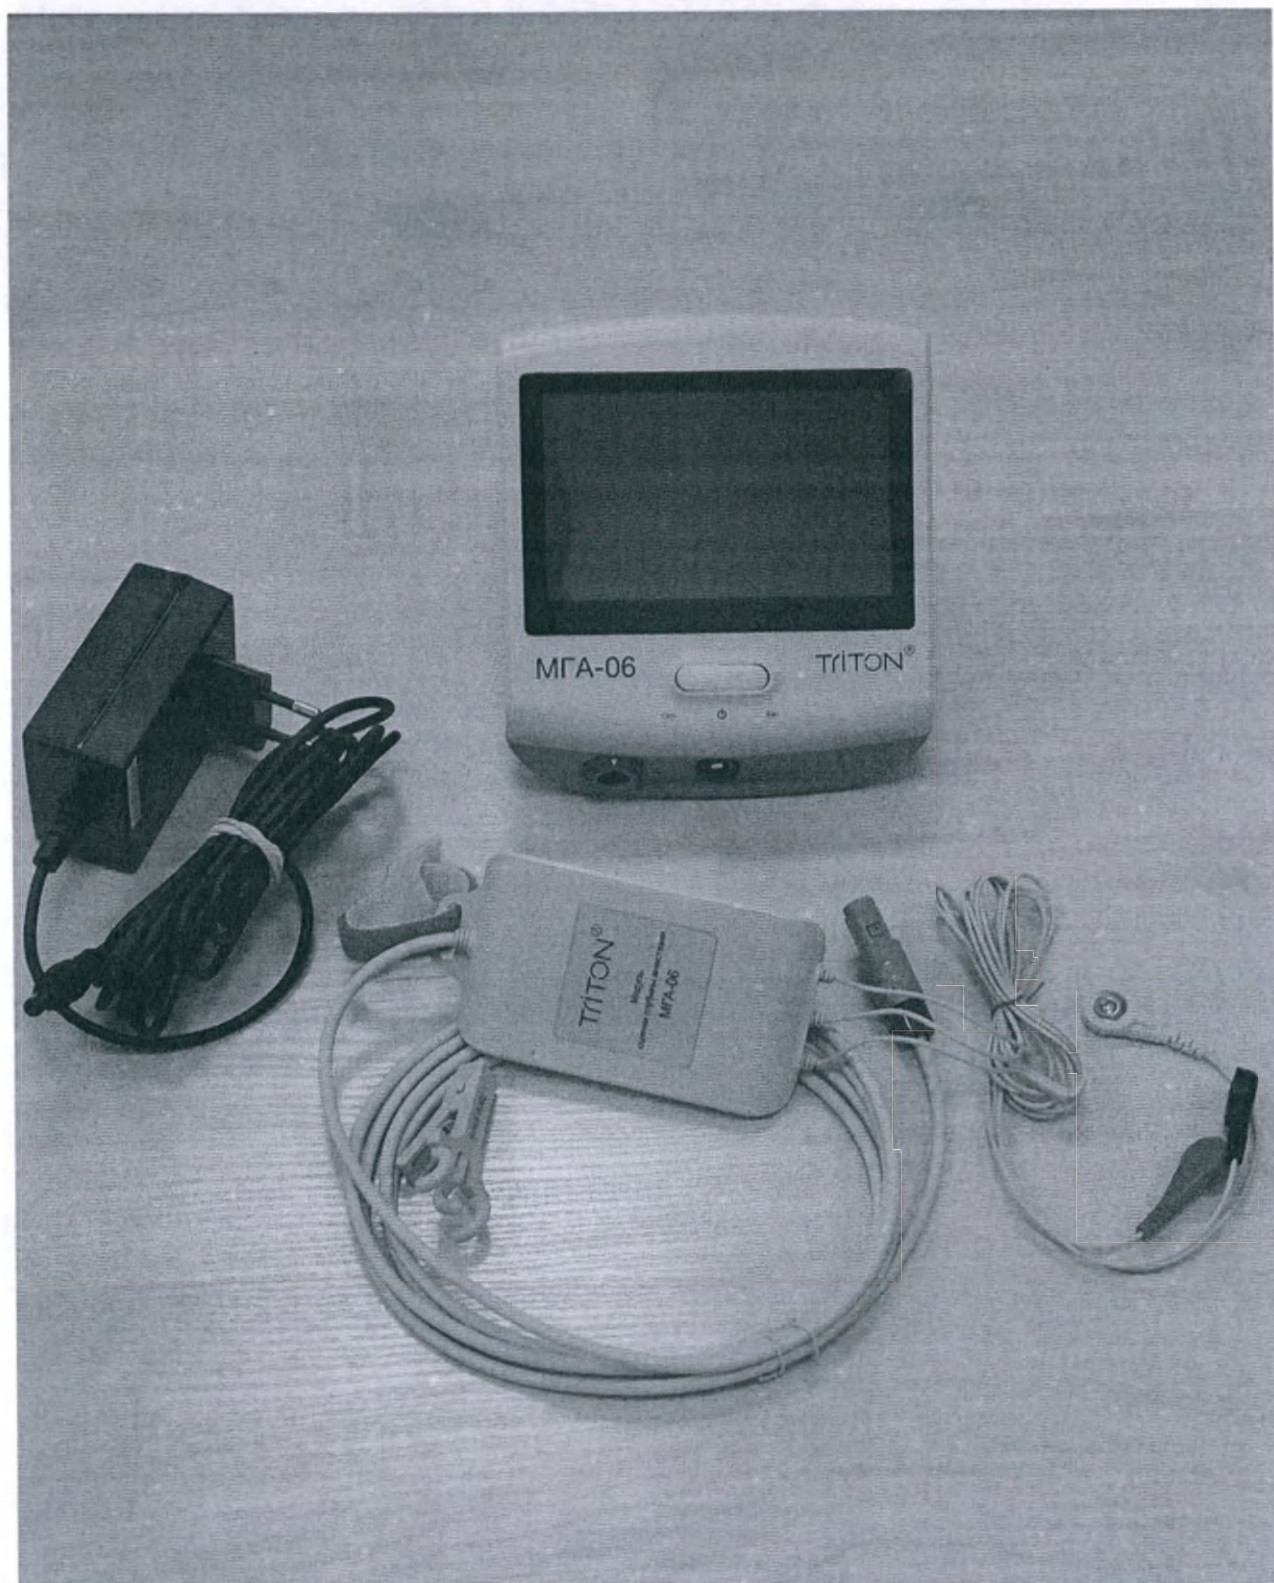

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
44 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»
Яковлев А.А.

