

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медтехника - Р»

В.В. Катая

« 15 » 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Насос инфузионный в вариантах исполнения с принадлежностями»

по ТУ 32.50.50-002-98238288-2020,


зарегистрированный товарный знак MED-MOS

2021





A)

В)

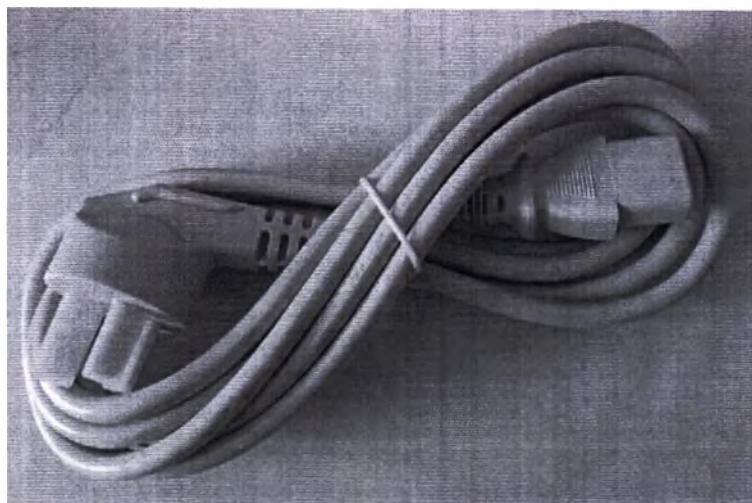


Б)

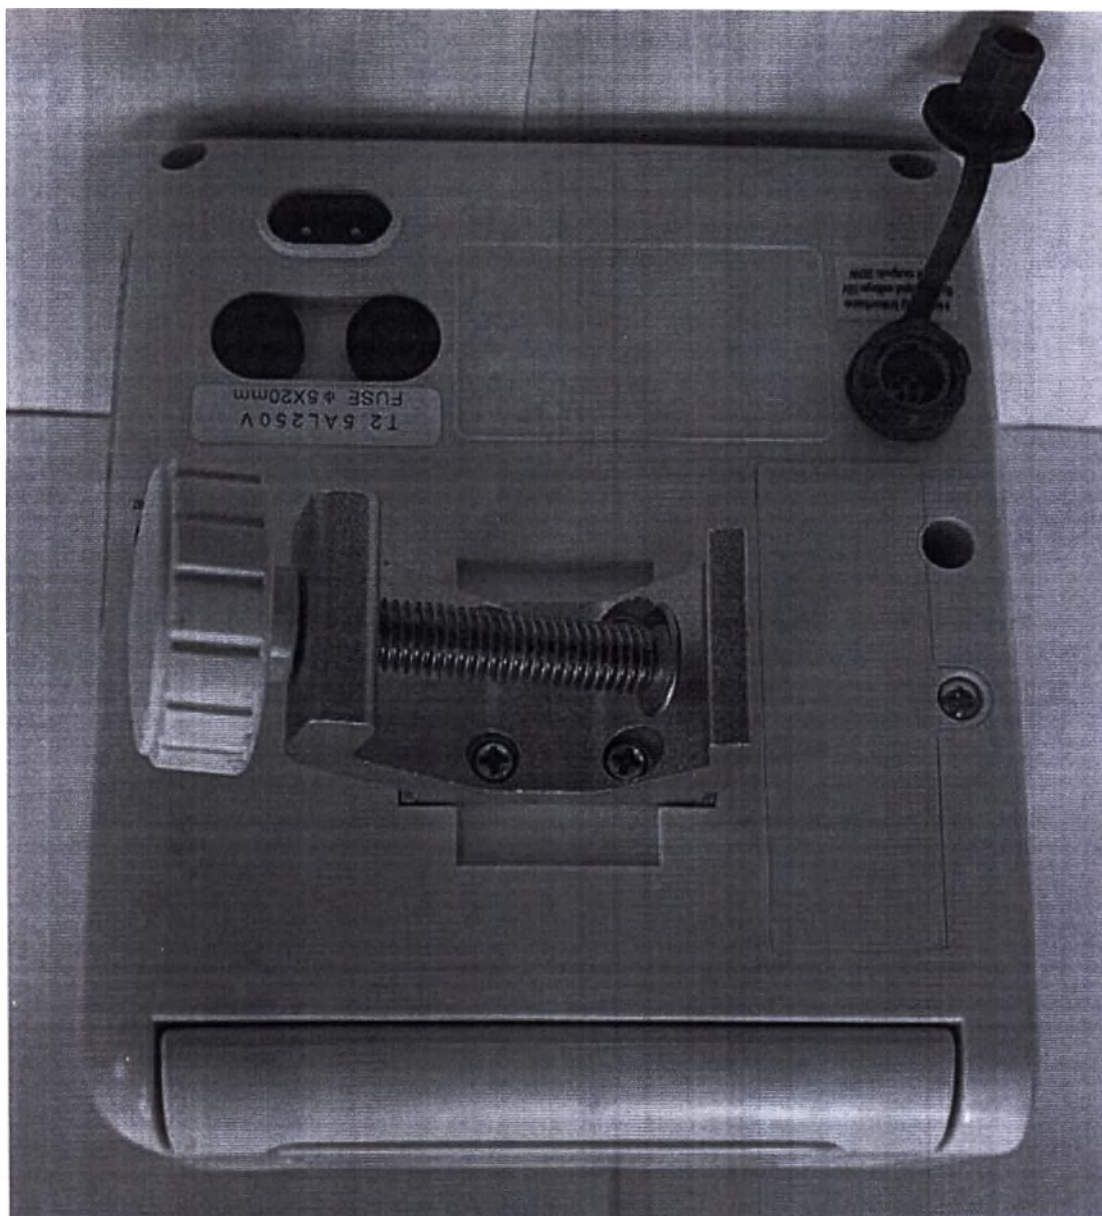

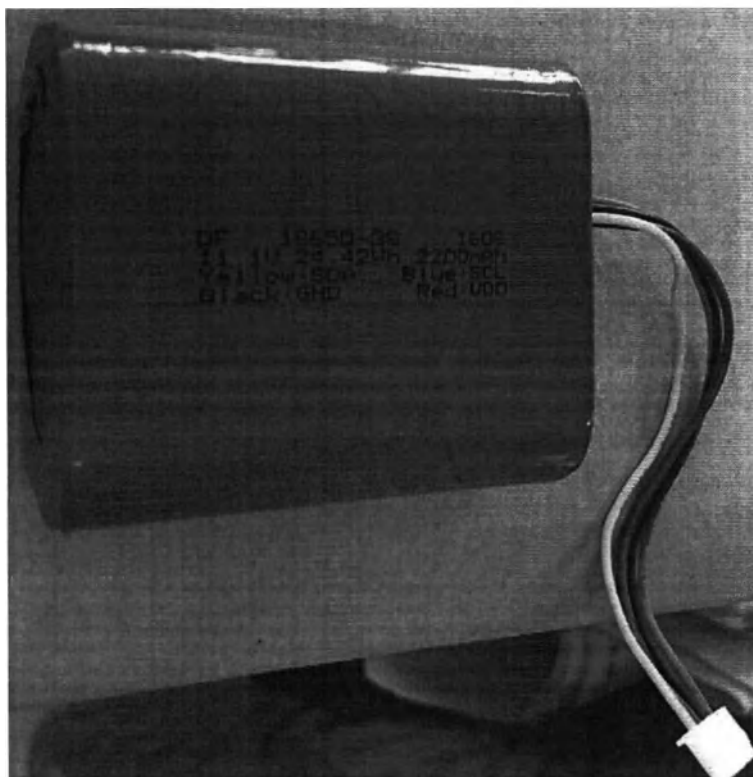


Г)

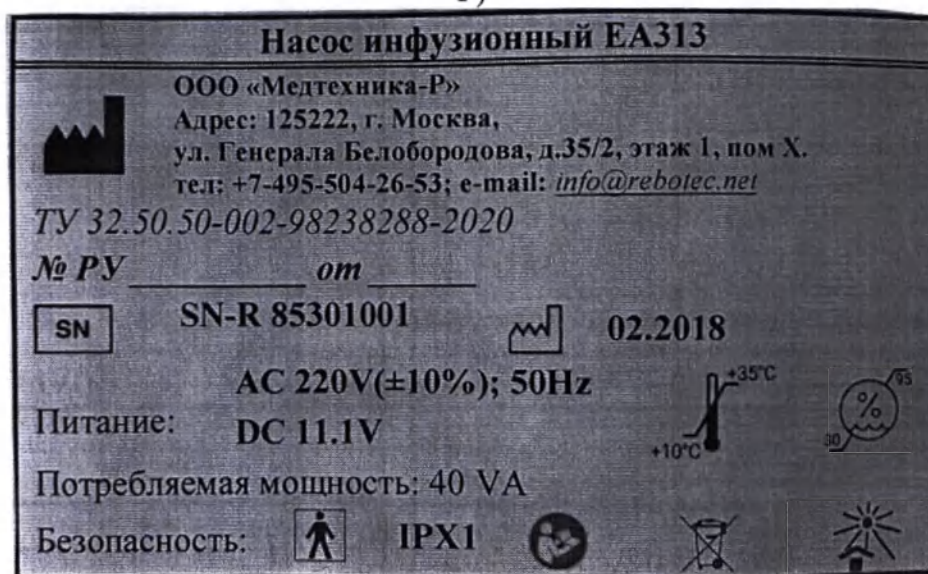


Д)

Рисунок 1 – Фотографическое изображение насоса в варианте исполнения EA313
А) Вид спереди; Б) Вид сзади; В) Кабель питания; Г) Внутренняя батарея; Д) Образец маркировки;


A)

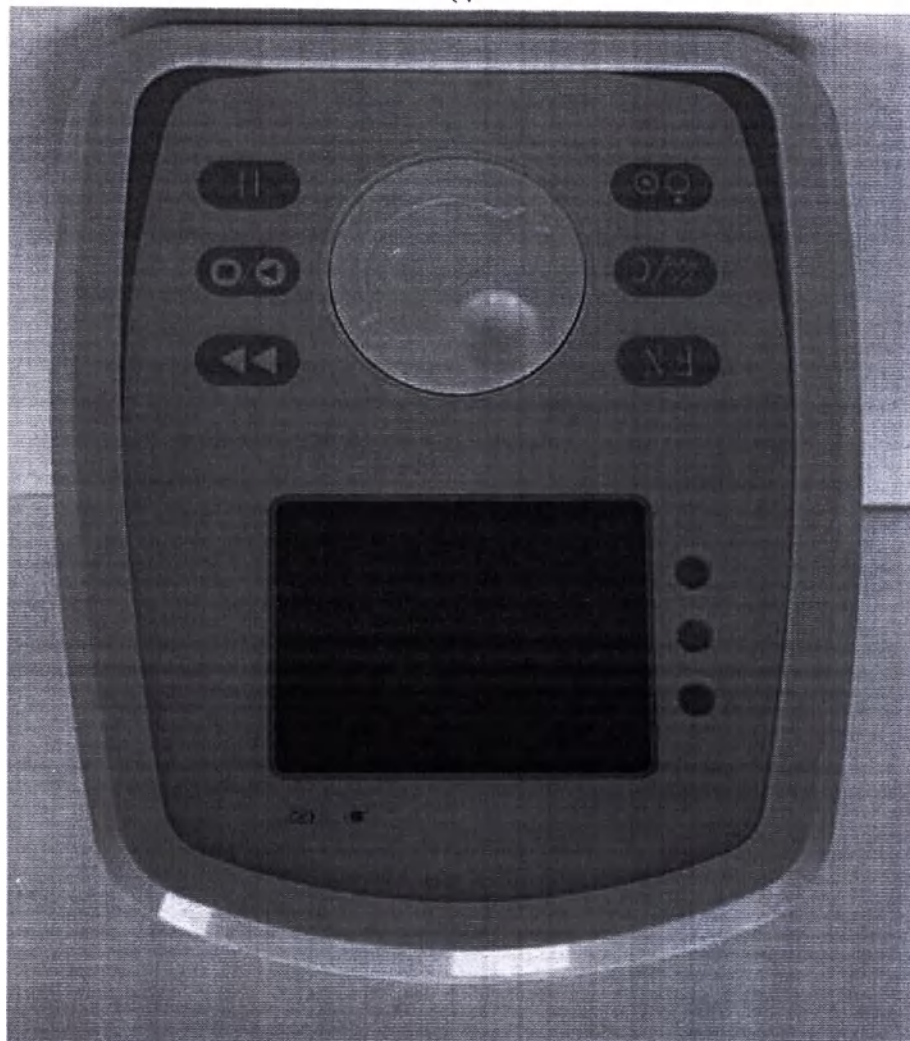

Б)

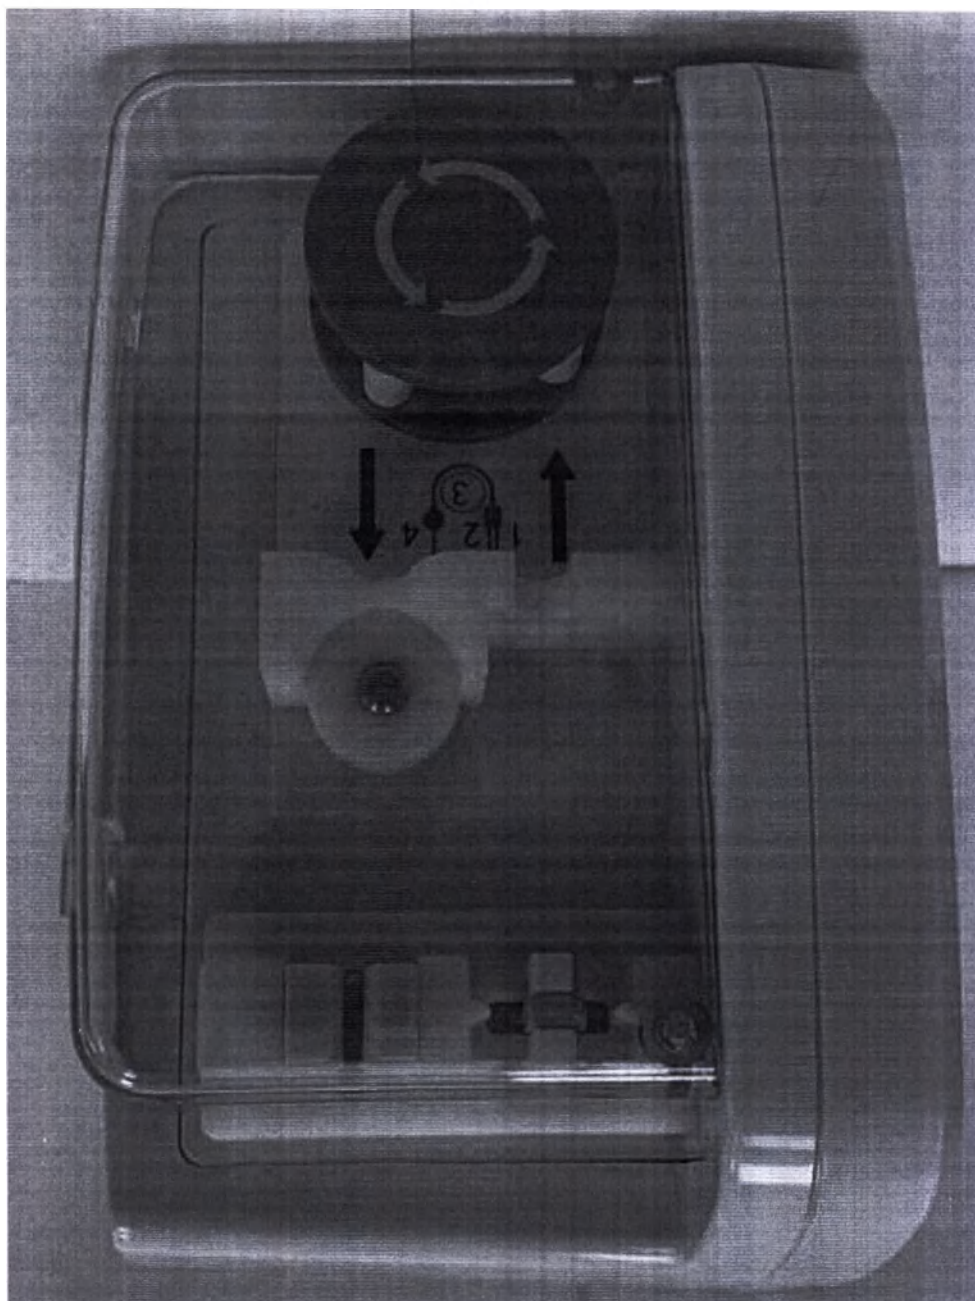

Г)

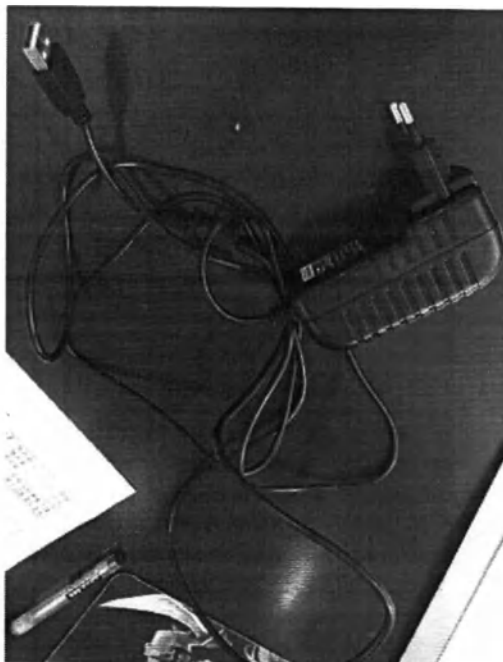


Б)






Д)

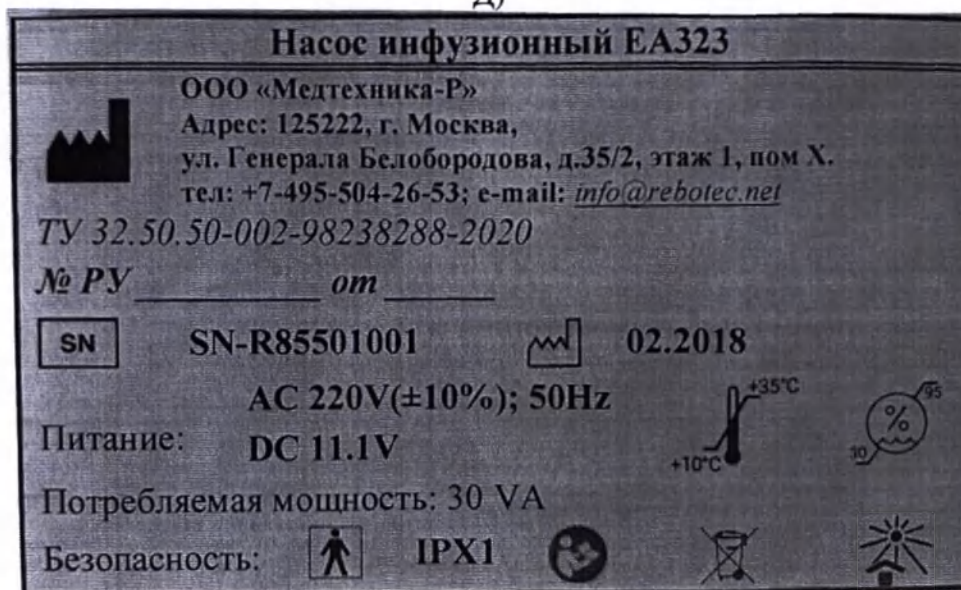


Е)

Рисунок 2 – Фотографическое изображение насоса в варианте исполнения EA323
 А) Вид спереди; Б) Вид сбоку; В) Вид сзади; Г) Блок питания; Д) Внутренняя батарея;
 Е) Образец маркировки


A)

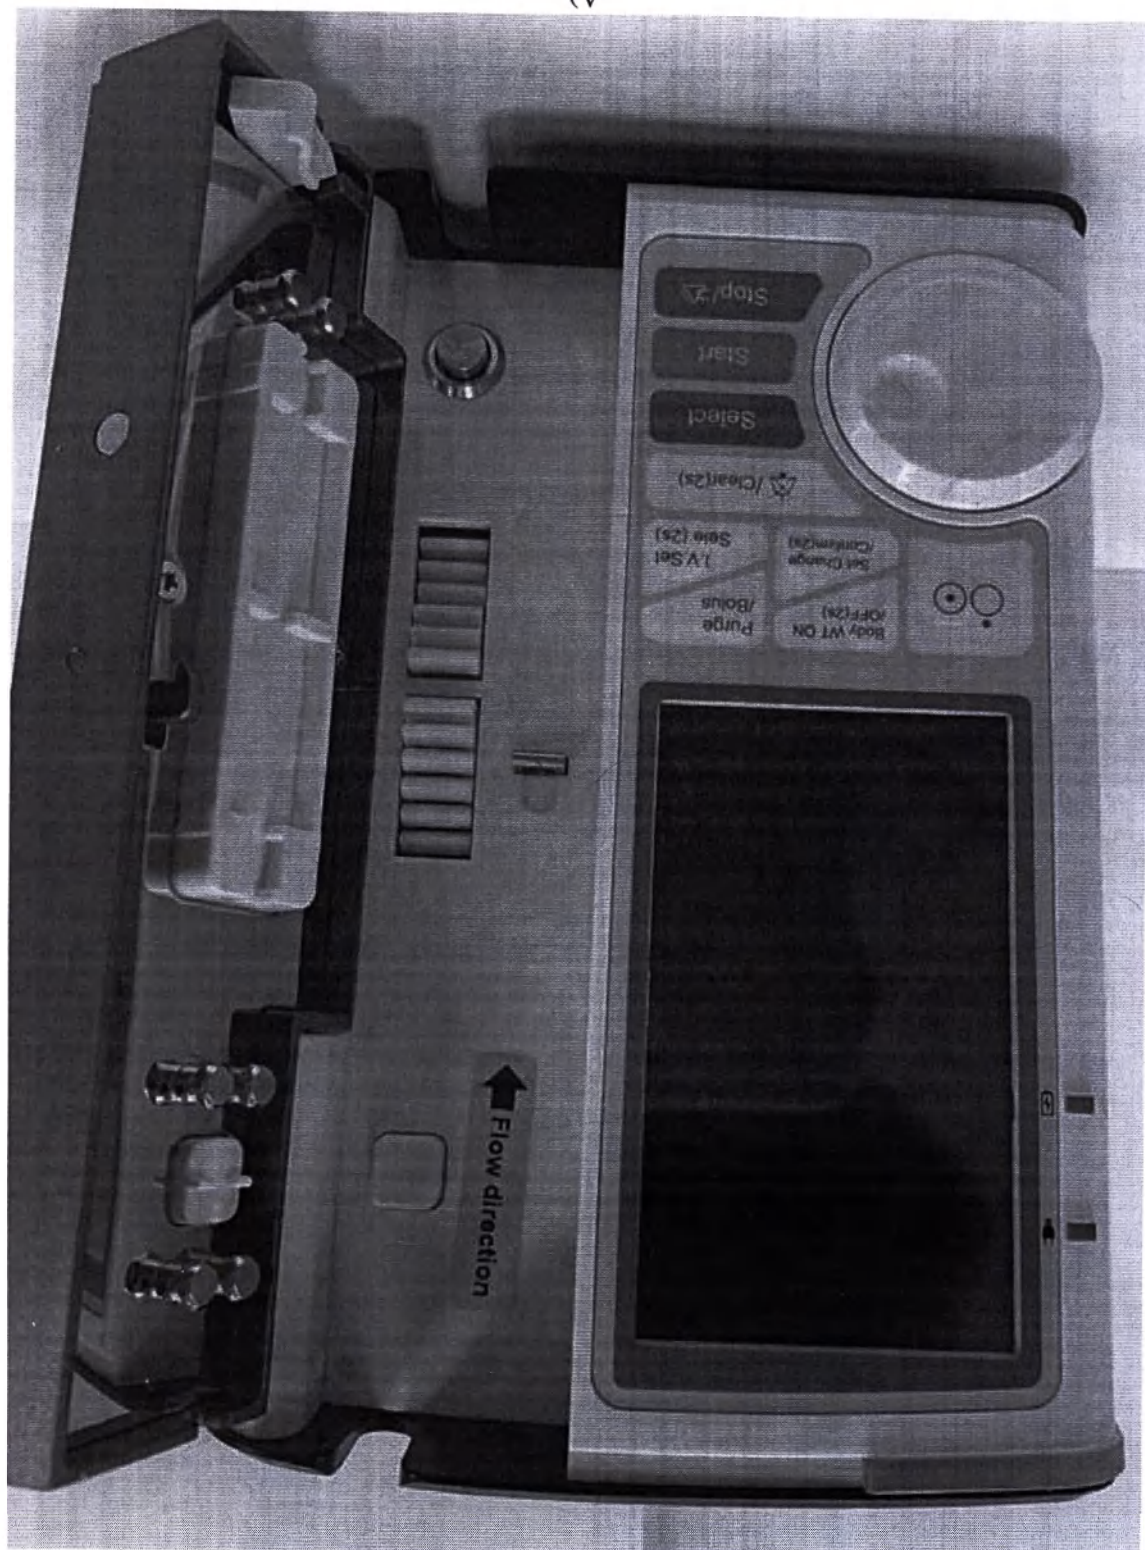


Б)

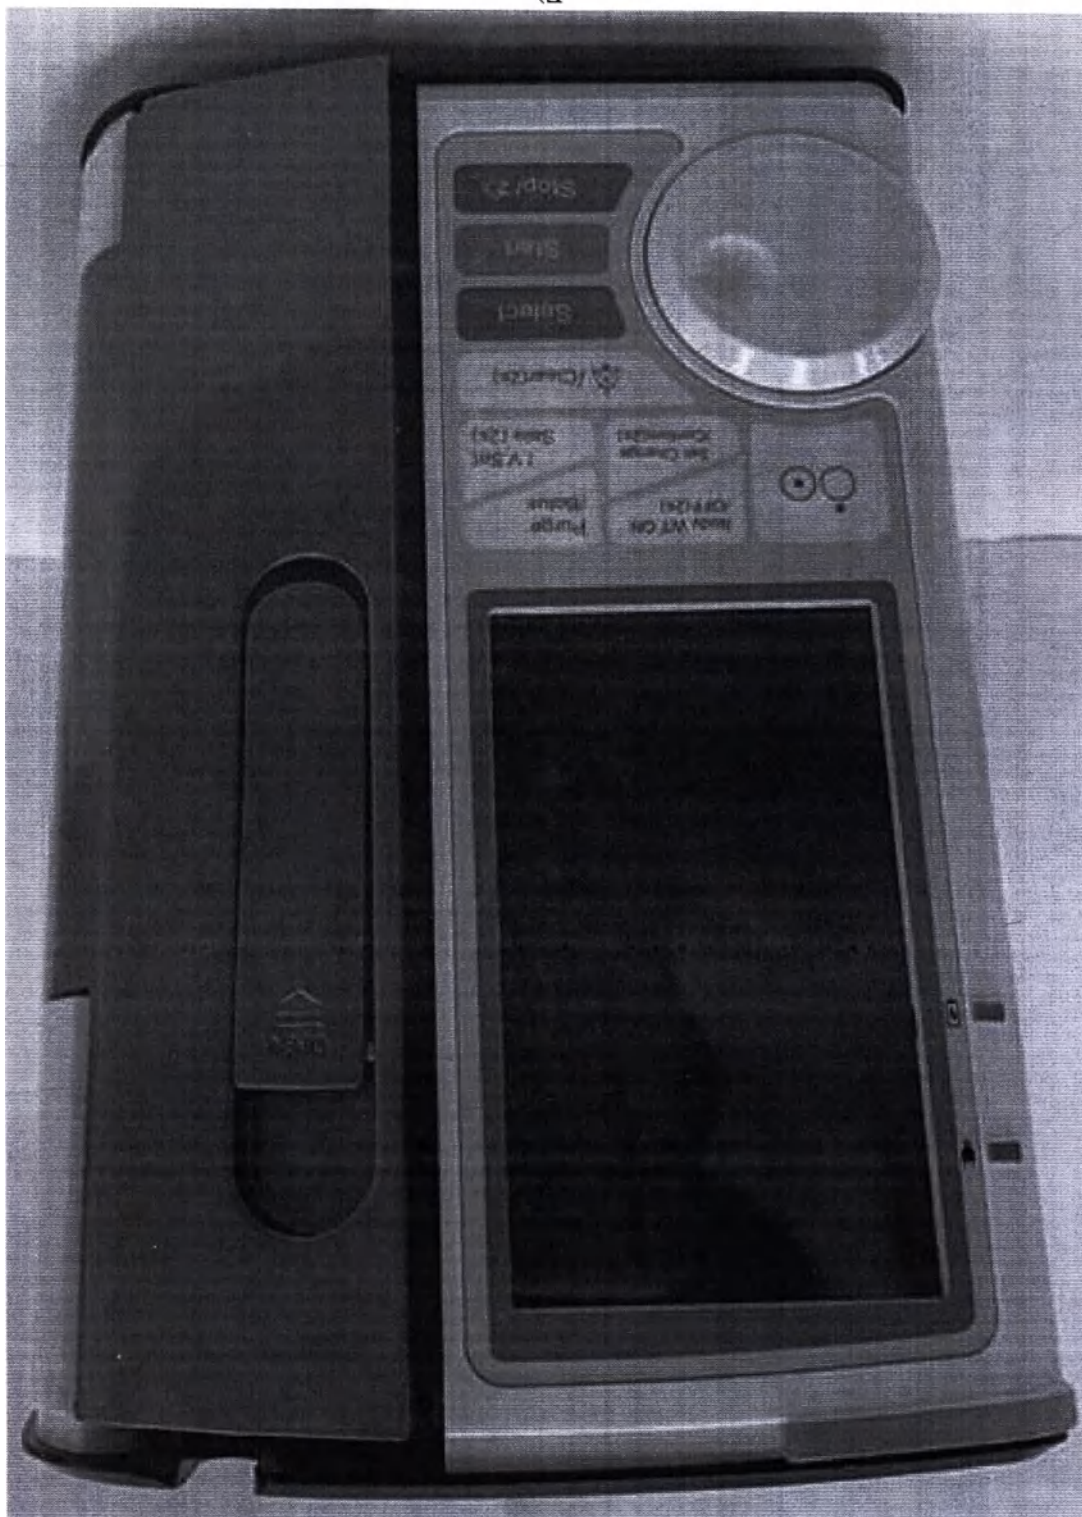

Г)

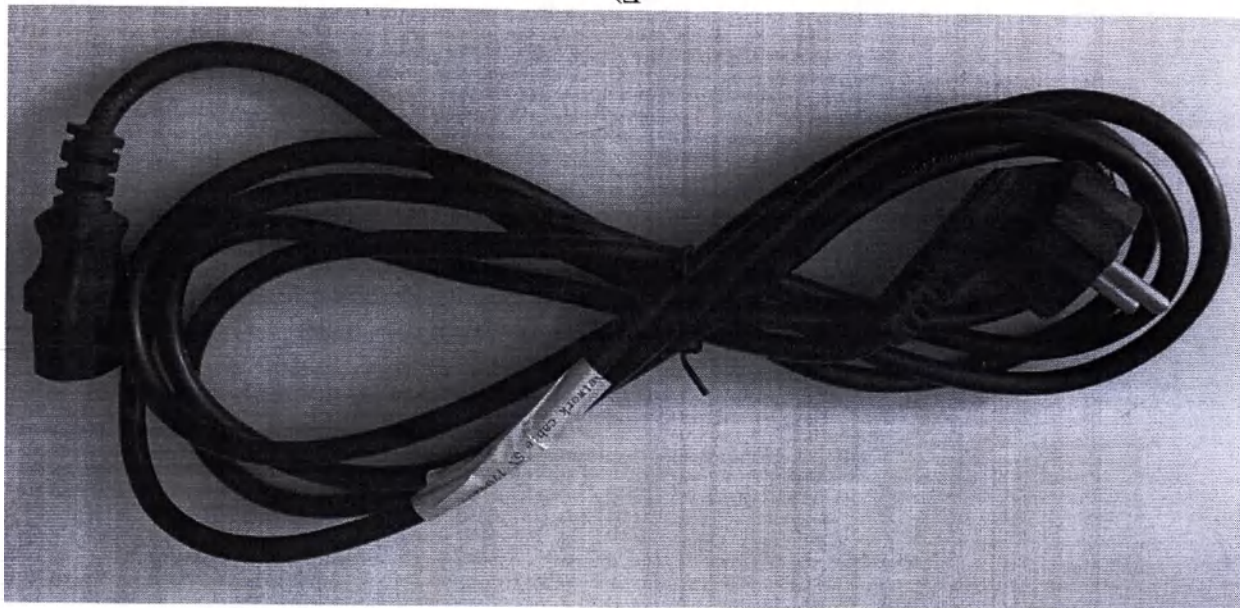


В)

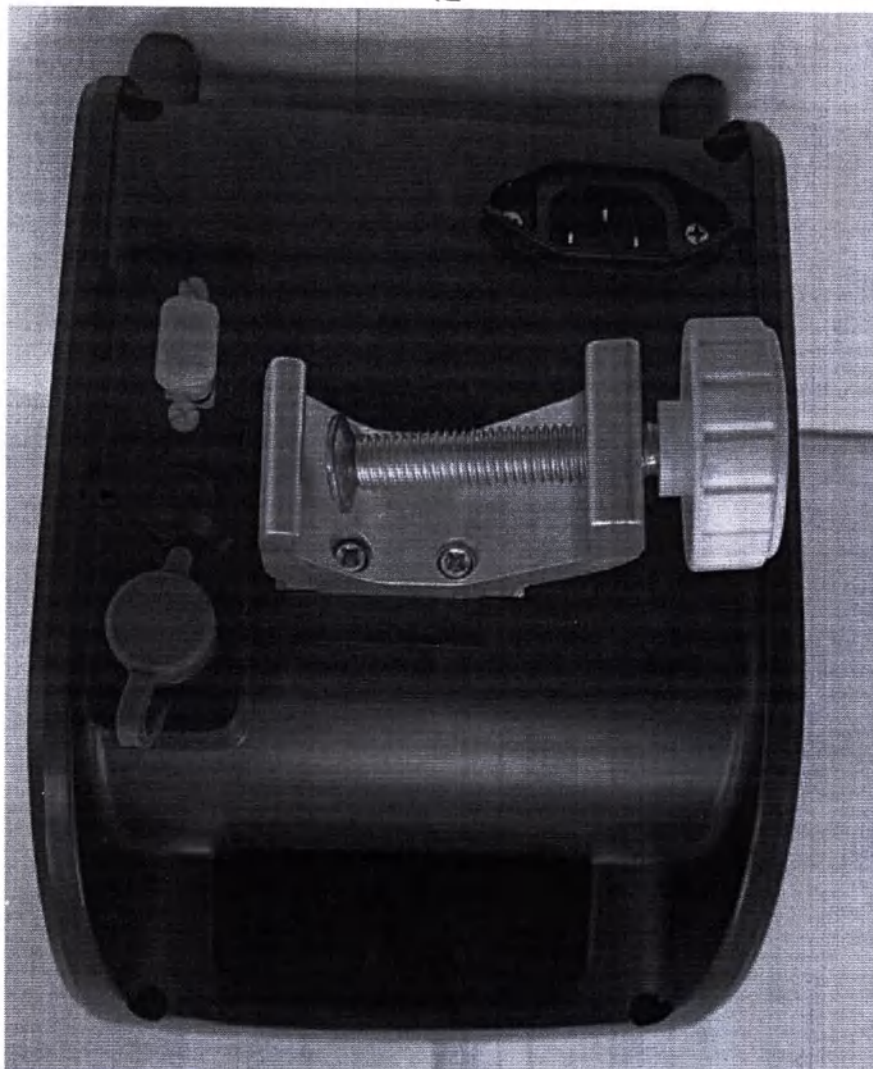



Д)

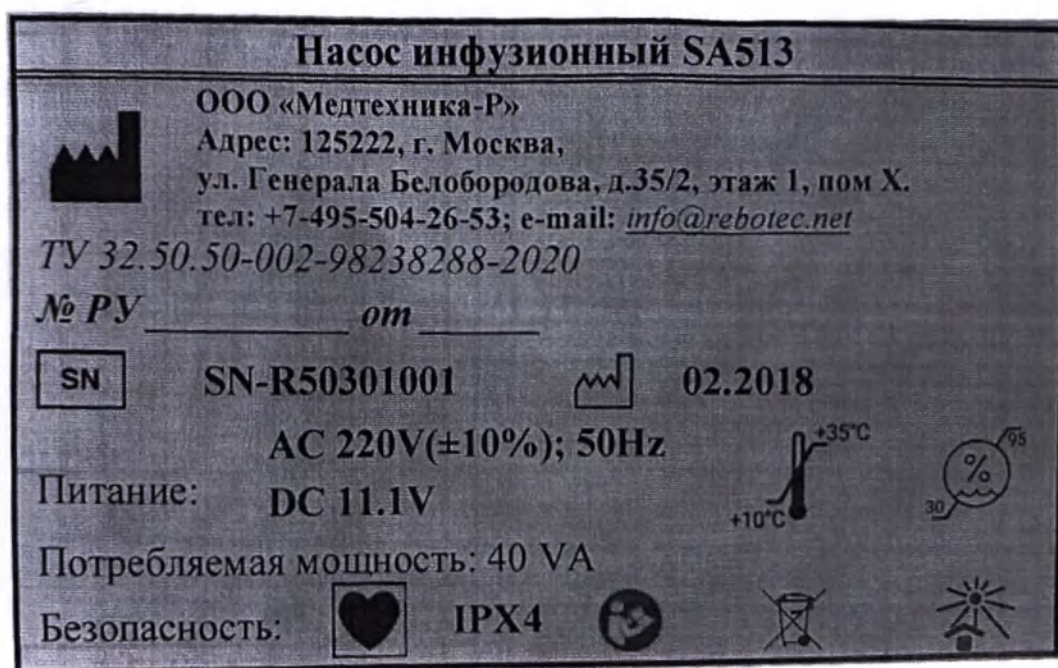


Е)


Рисунок 3 – Фотографическое изображение насоса в варианте исполнения SA513:
 А) Вид спереди с открытой дверцей; Б) Вид спереди; В) Вид сзади; Г) Кабель питания;
 Д) Внутренняя батарея; Е) Образец маркировки;




A)

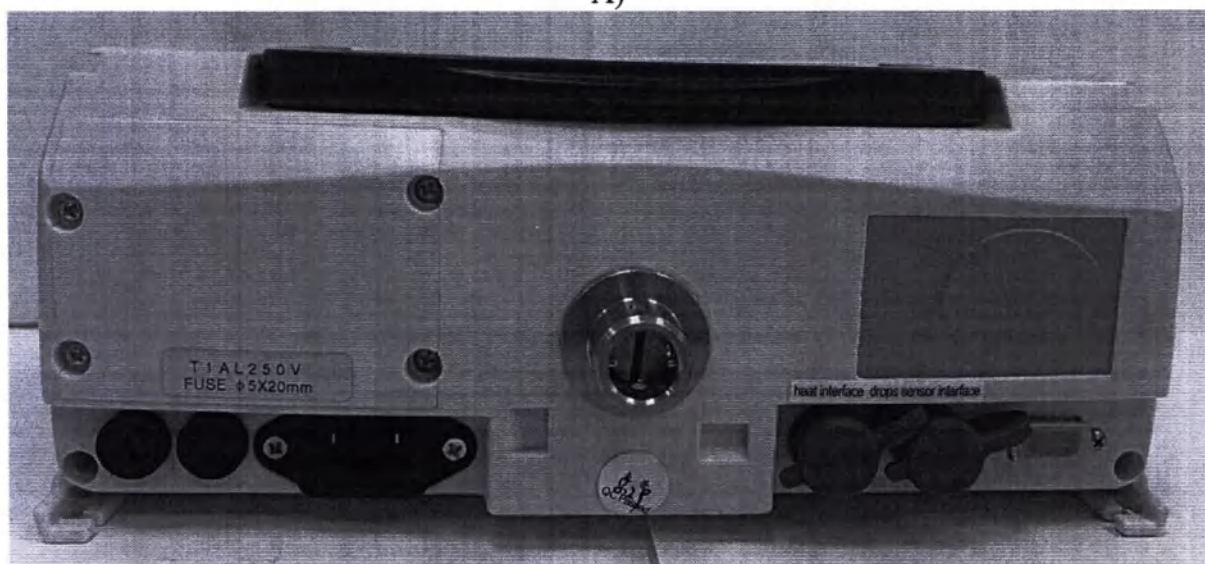


Б)

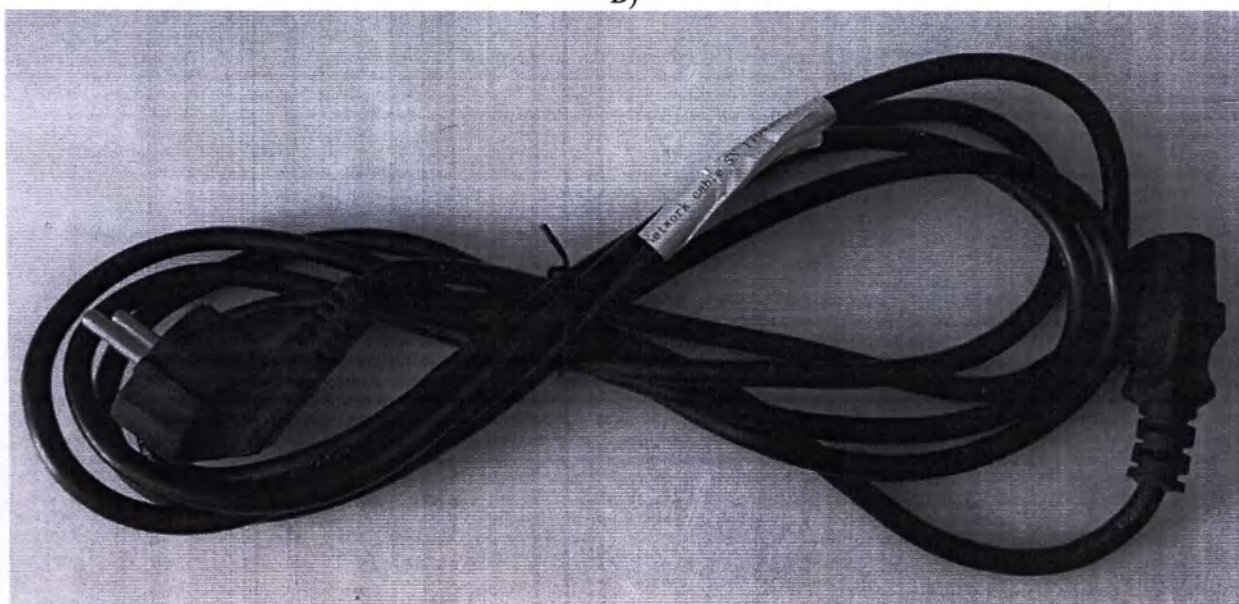

В)

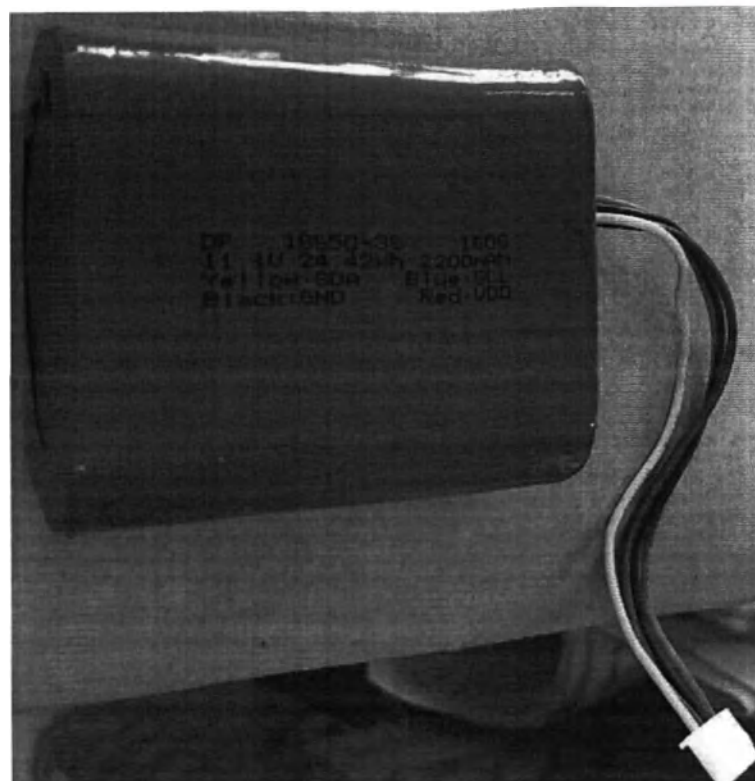


Г)

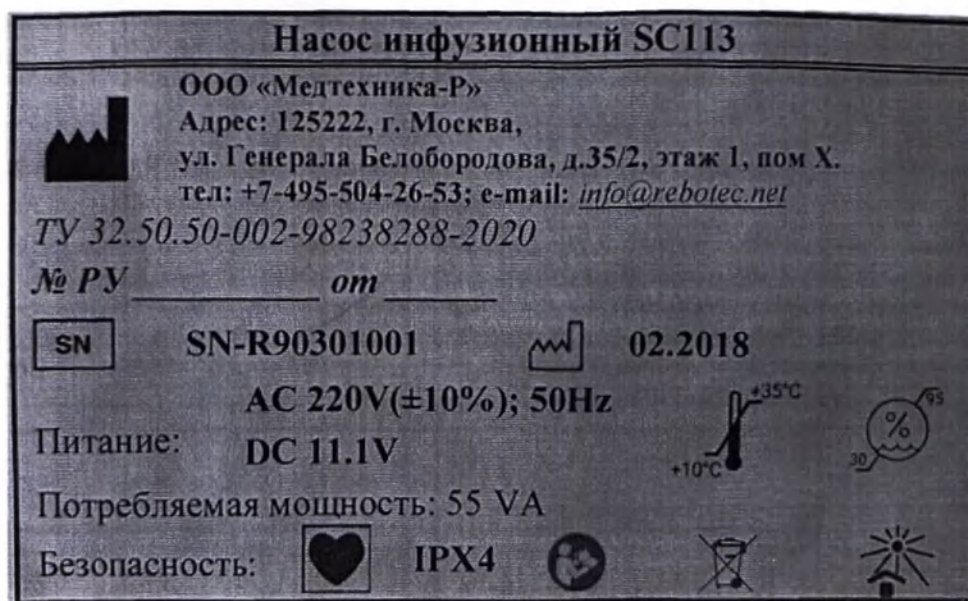



Д)


Рисунок 4 – Фотографическое изображение насоса в варианте исполнения SC113
А) Вид спереди; Б) Вид сзади; В) Кабель питания; Г) Внутренняя батарея;
Д) Образец маркировки



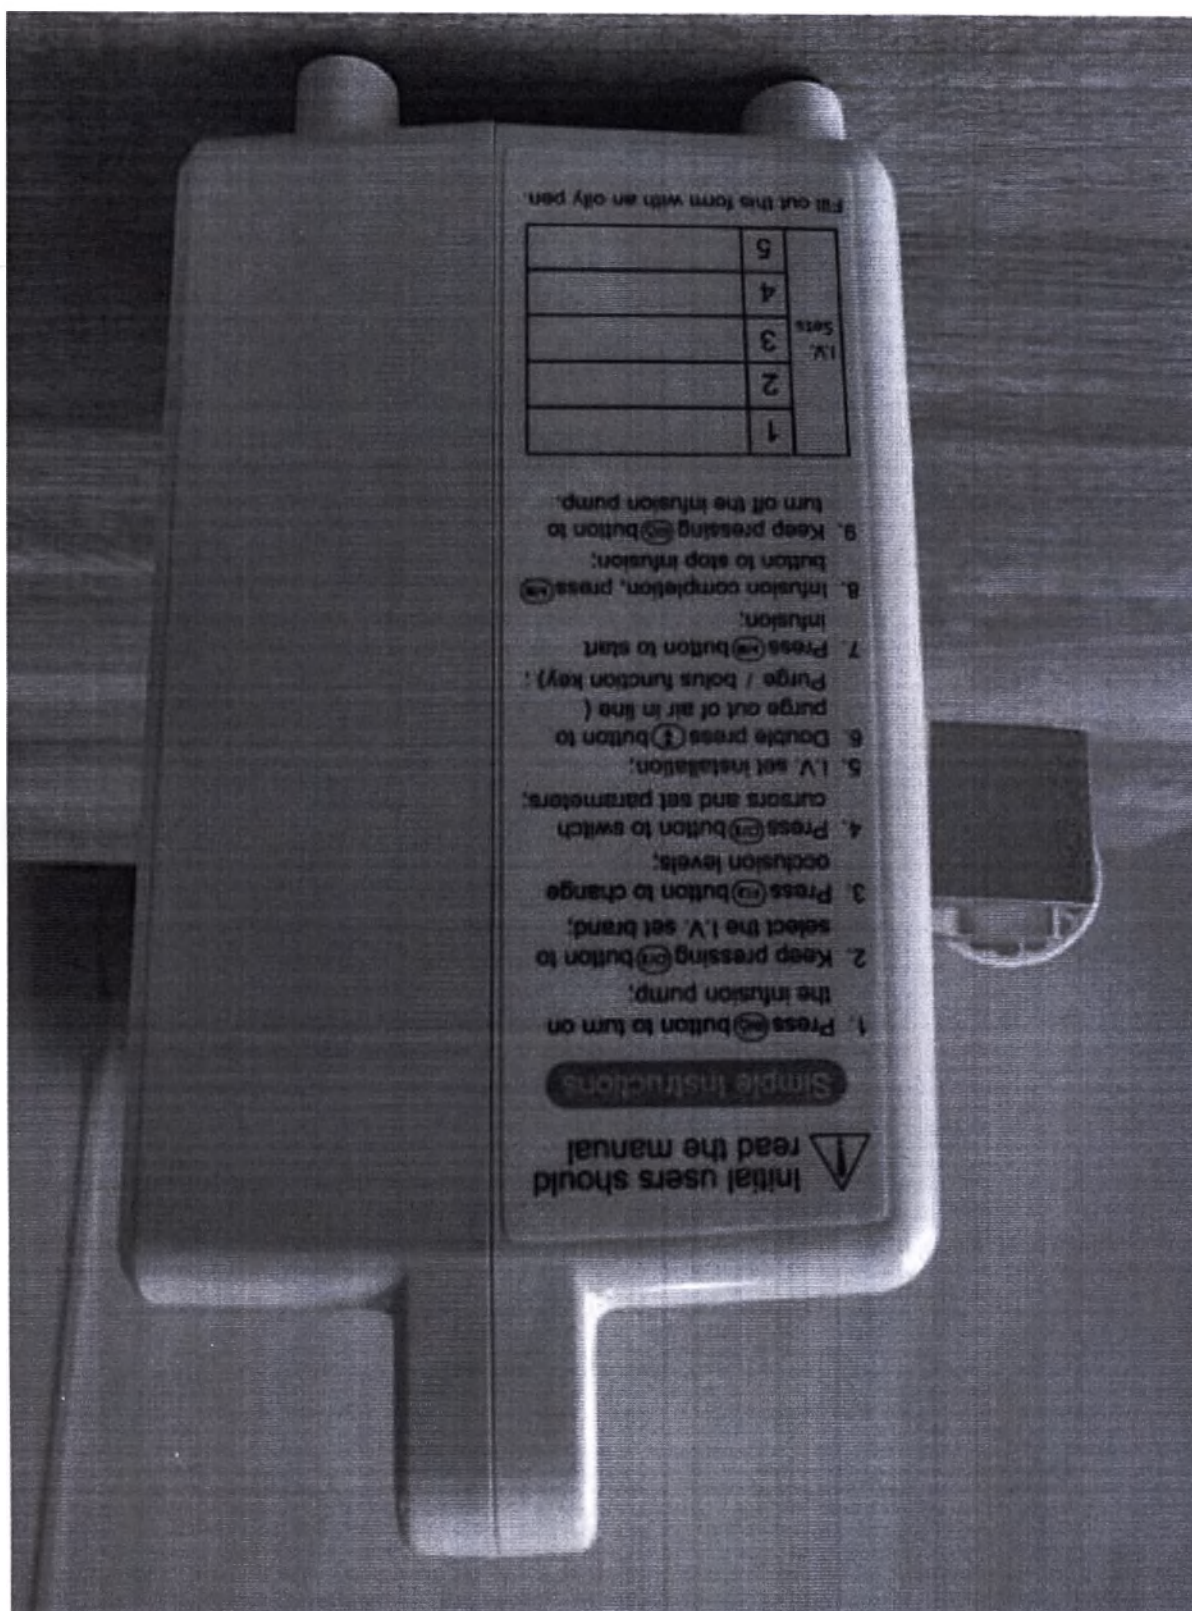

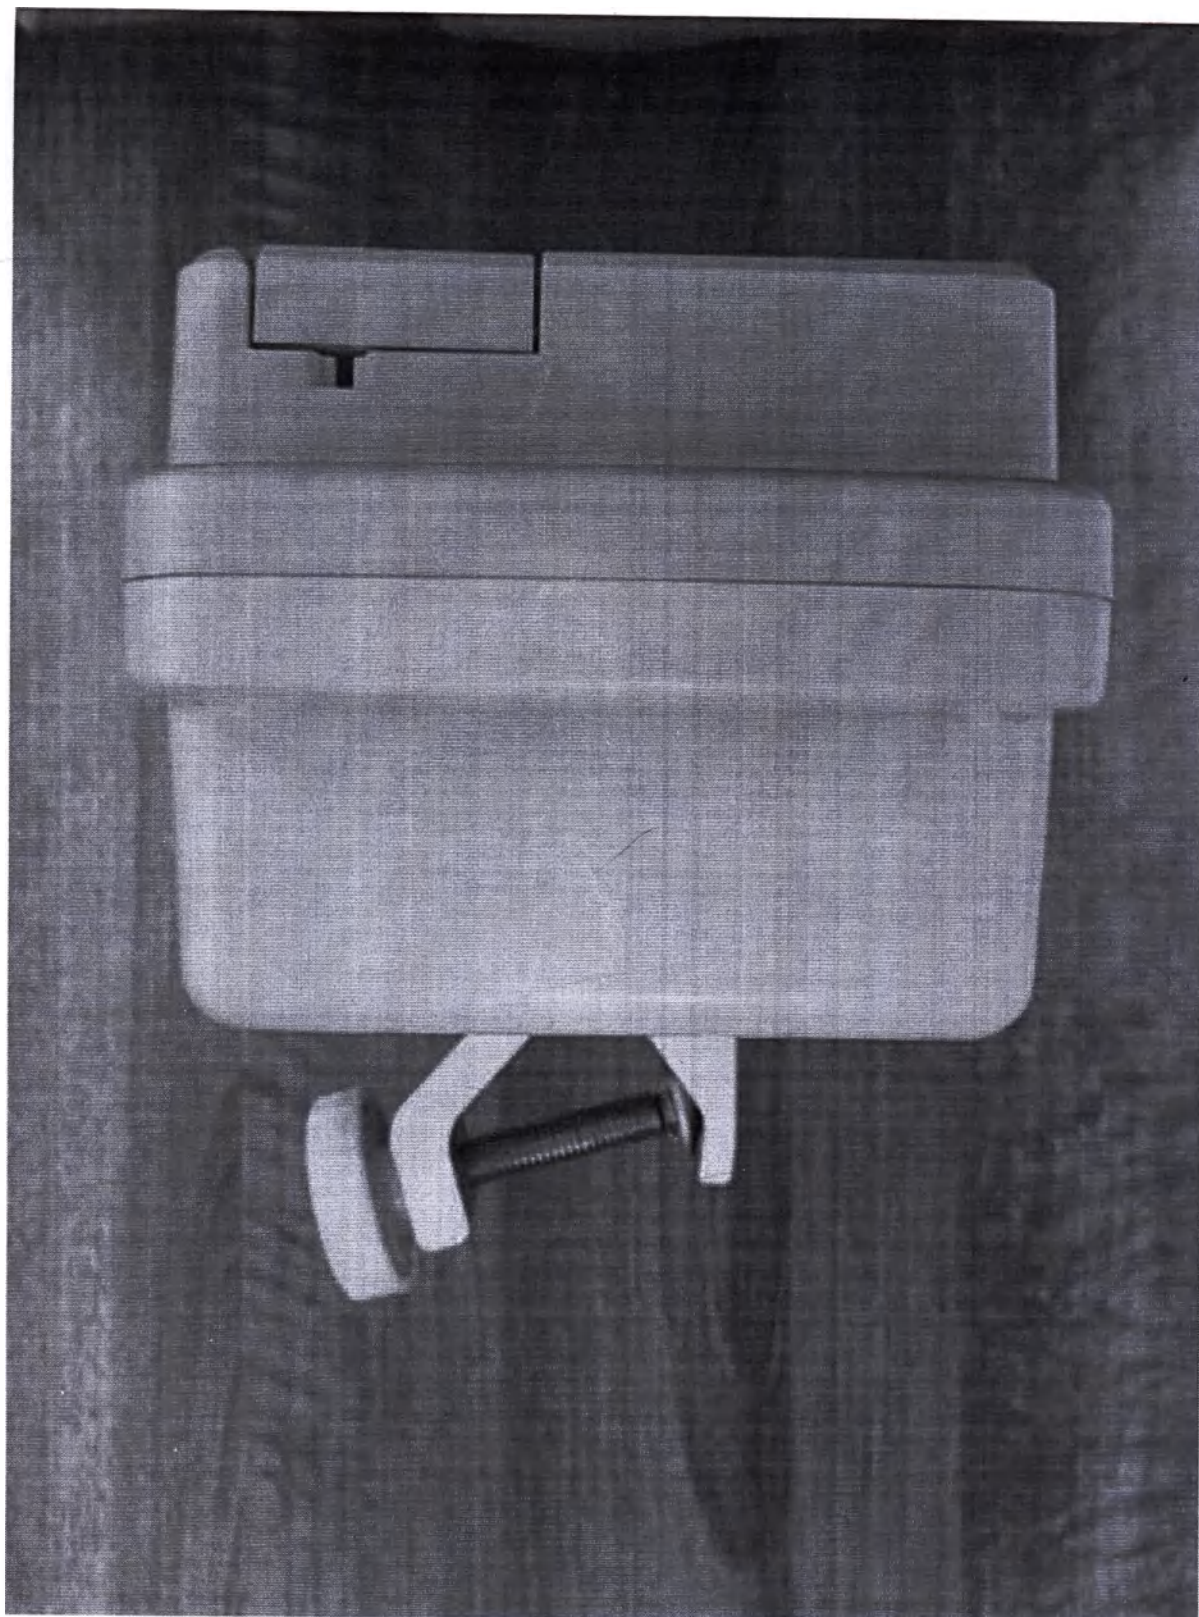

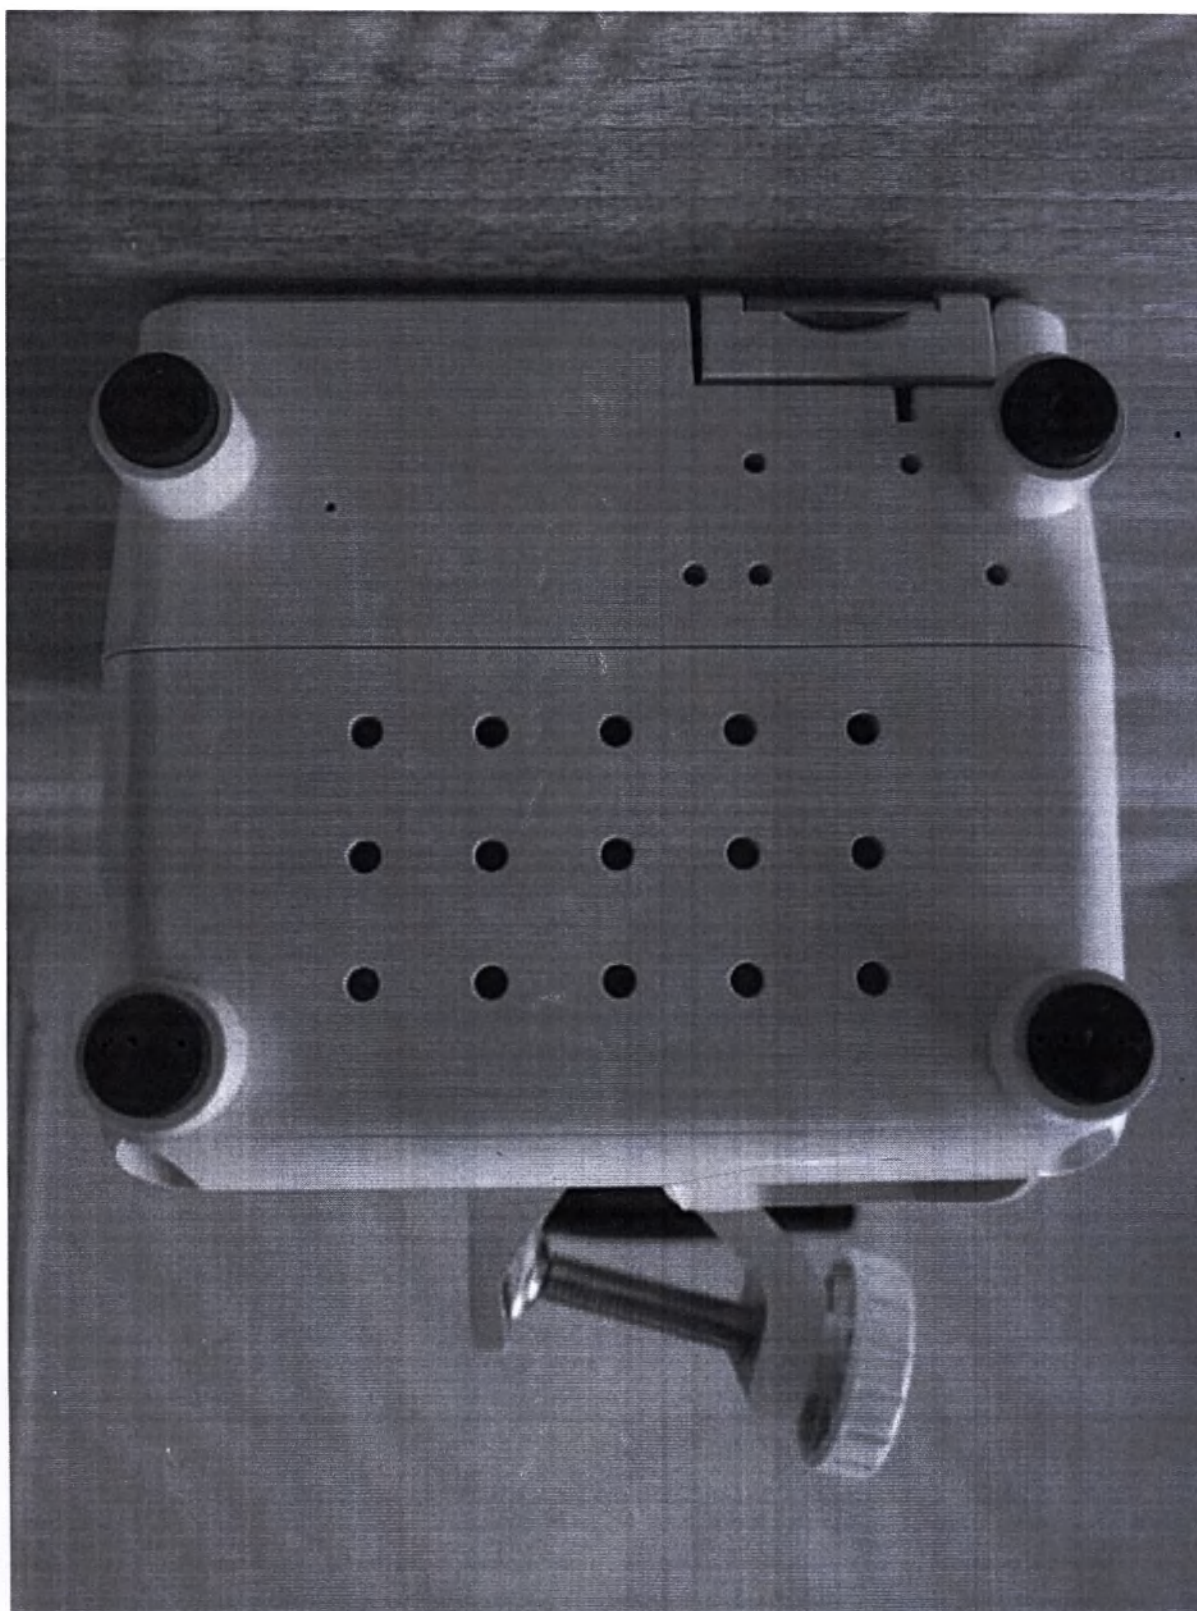

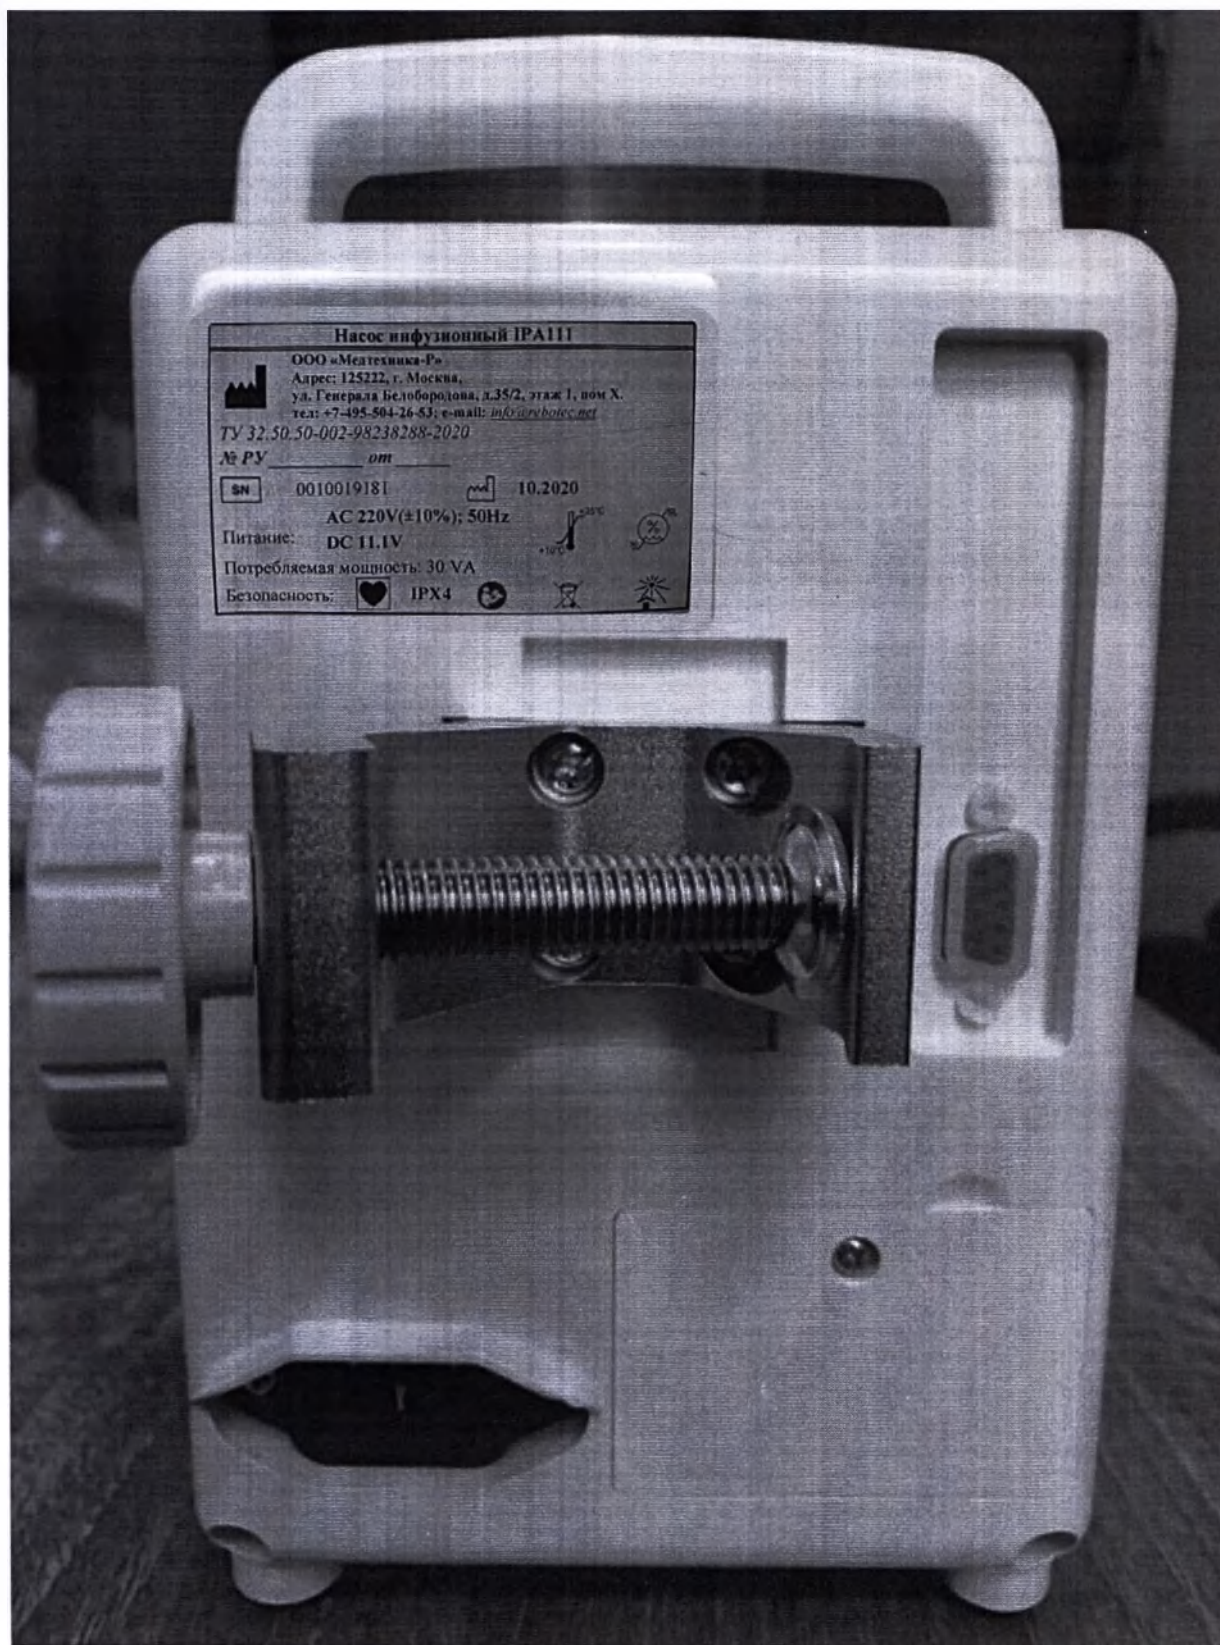

Насос инфузионный ИРА111
ООО «Медтехника-Р»
Адрес: 125222, г. Москва,
Ул. Генерала Белобородова, д.35/2, этаж 1, пом. X.
тел: +7-495-504-26-83; e-mail: info@rybotech.net
ТУ 32.50.50-002-98238288-2020
№ РУ _____ от _____
SN 0010019181 10.2020
AC 220V(±10%); 50Hz
Питание: DC 11.1V
Потребляемая мощность: 30 VA
Безопасность: IPX4


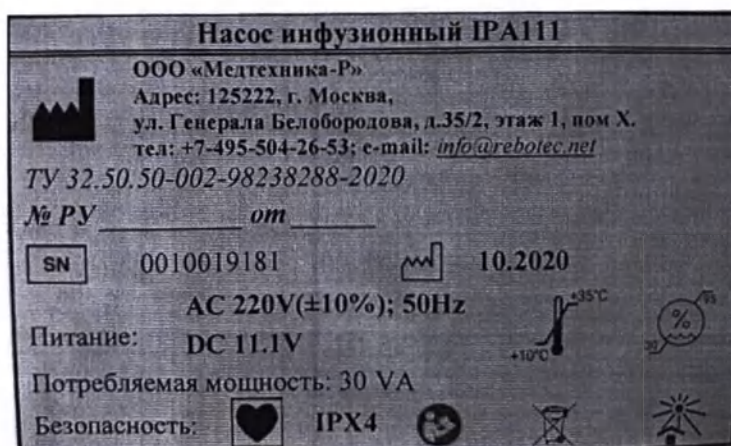


Рисунок 5 – Фотографическое изображение насоса в варианте исполнения IPA111
 А) Вид спереди; Б) Вид сзади;
 Д) Образец маркировки

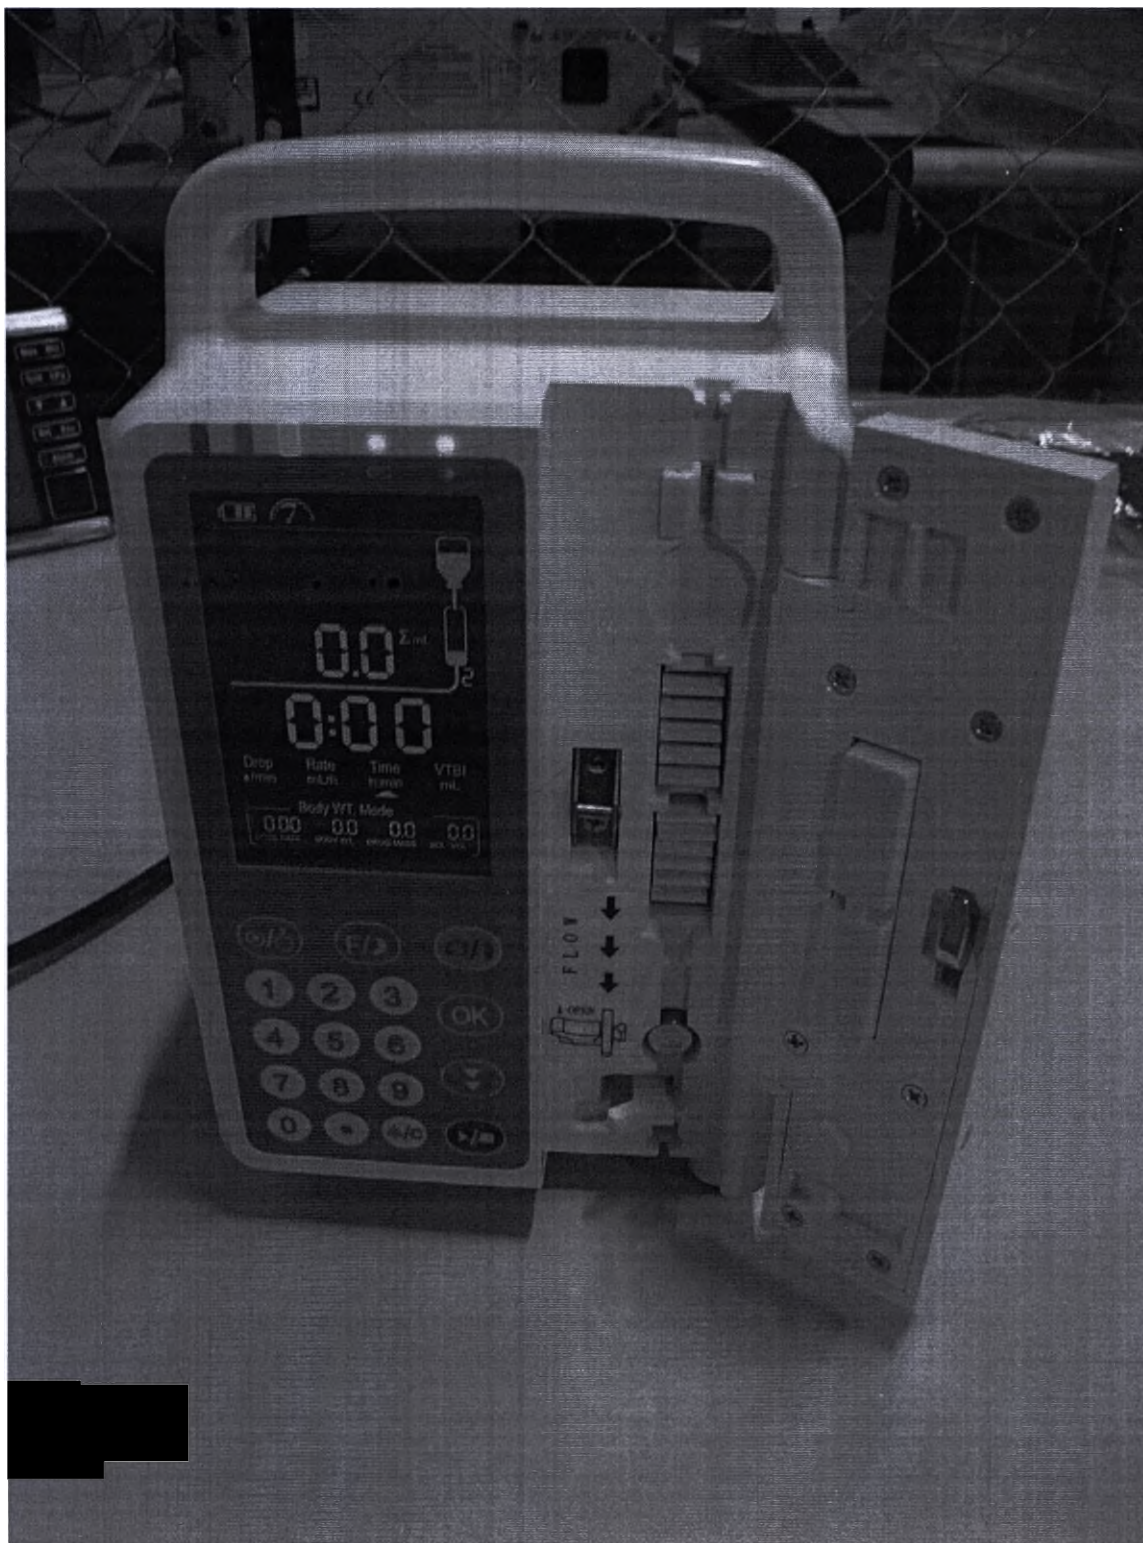

A)

Б)






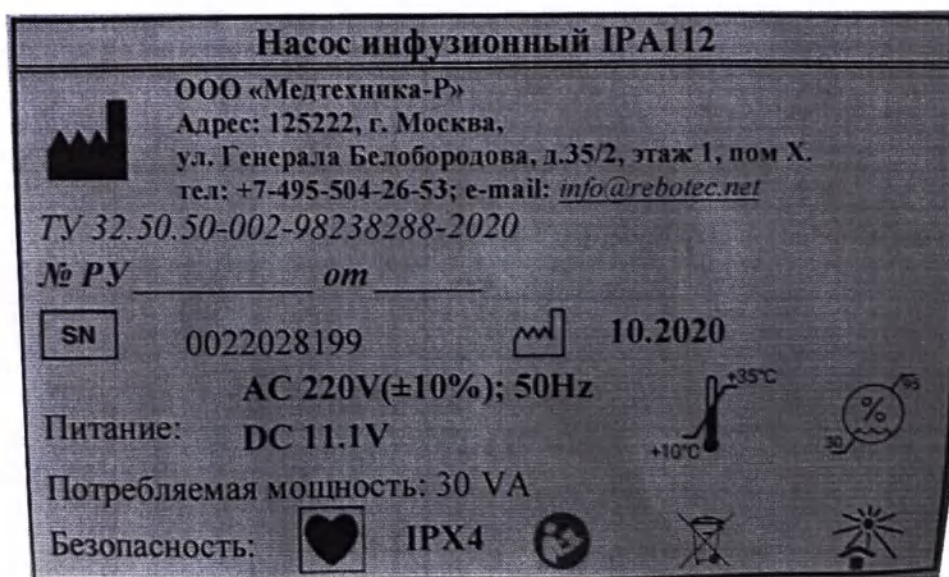


Рисунок 6 – Фотографическое изображение насоса в варианте исполнения IPА112
А) Вид спереди; Б) Вид сзади; В) Кабель питания; Г) Образец маркировки

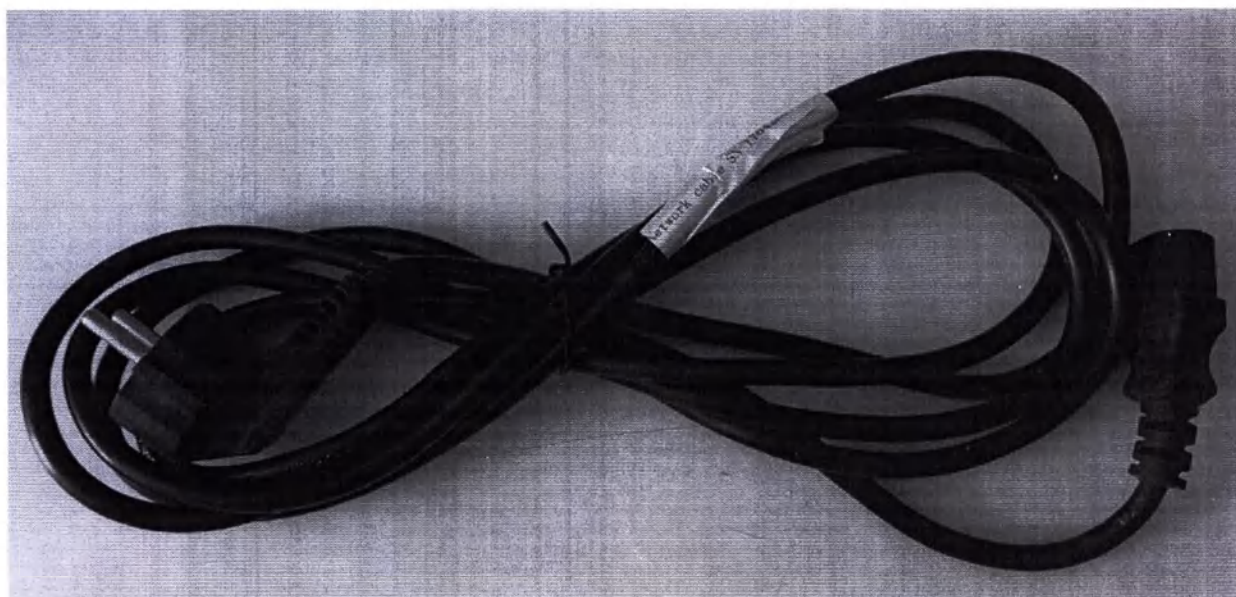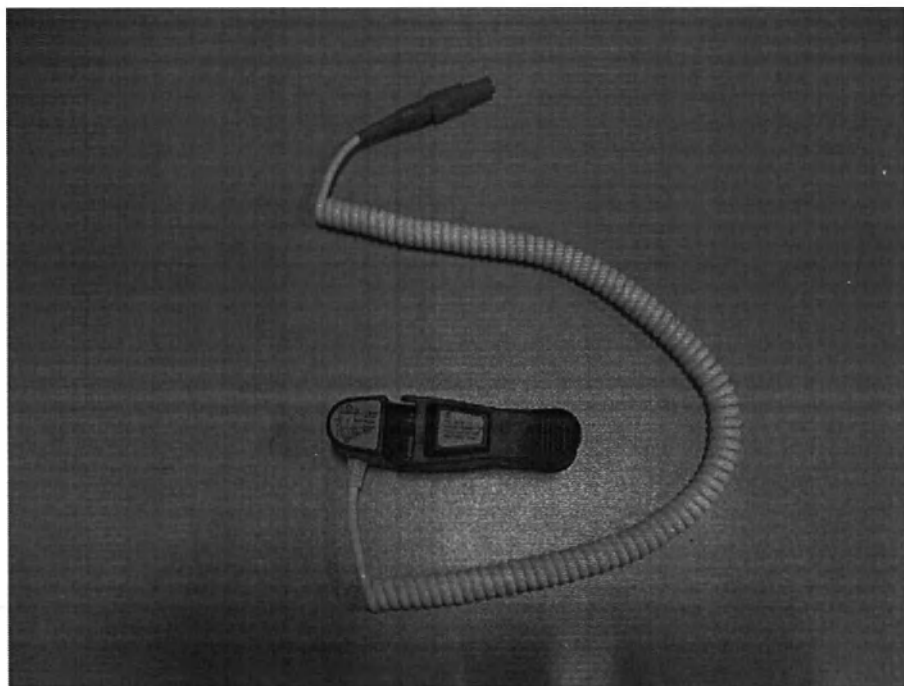


А)

Рисунок 7– Фотографическое изображение принадлежности для насоса в варианте исполнения SC113/EA313/EA323: А) Нагреватель W-E01;

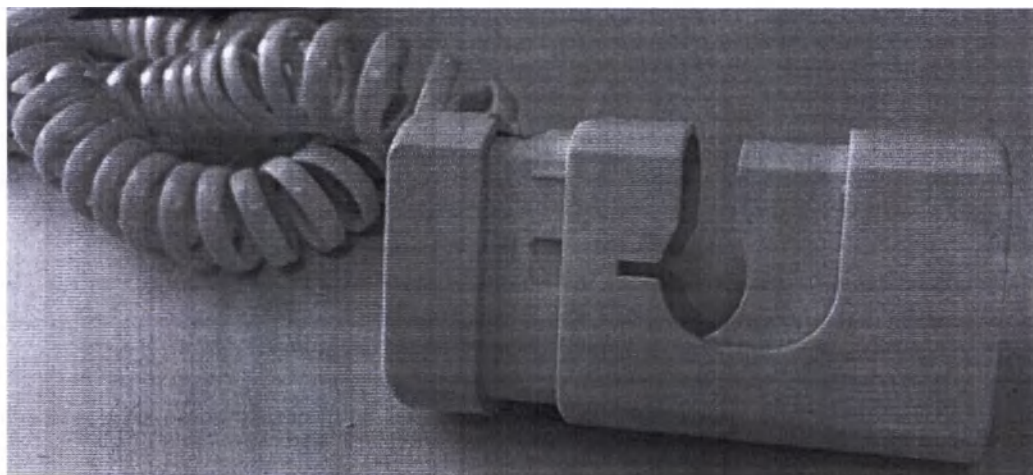


А)

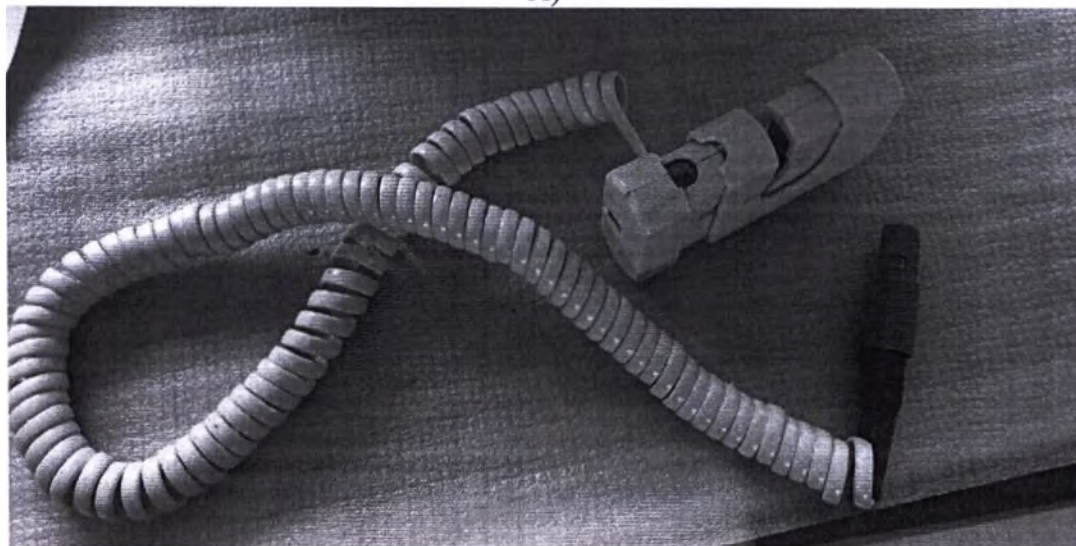


Б)


Рисунок 8 – Фотографическое изображение принадлежности для насоса в варианте исполнения SC113 и SA513: Датчик падения капель А) Вид сверху; Б) Общий вид;

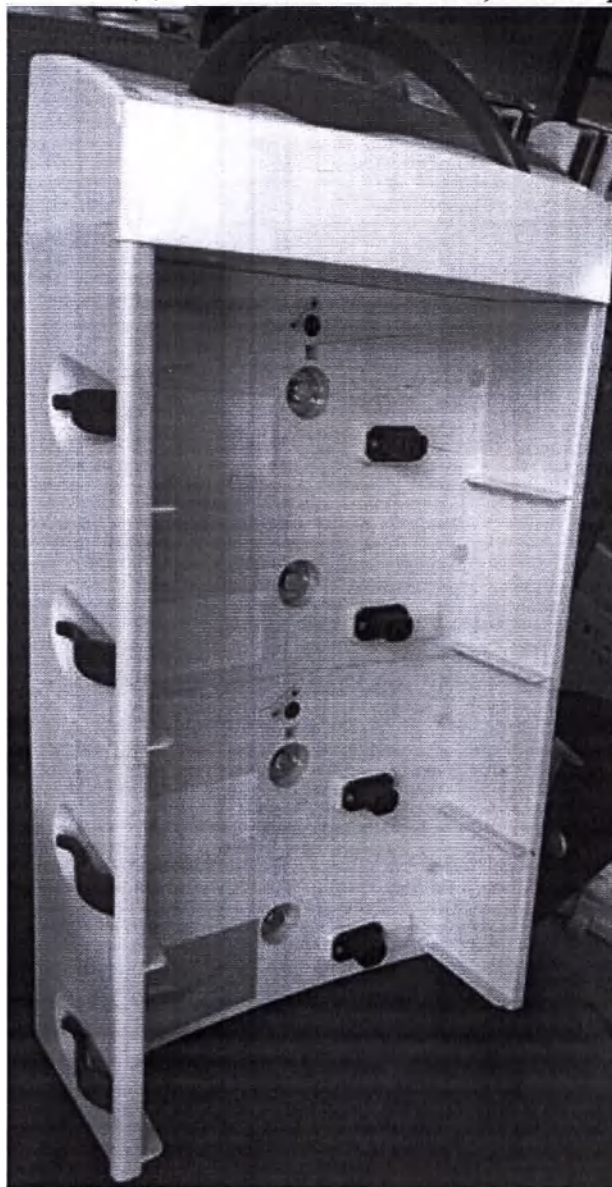

А)

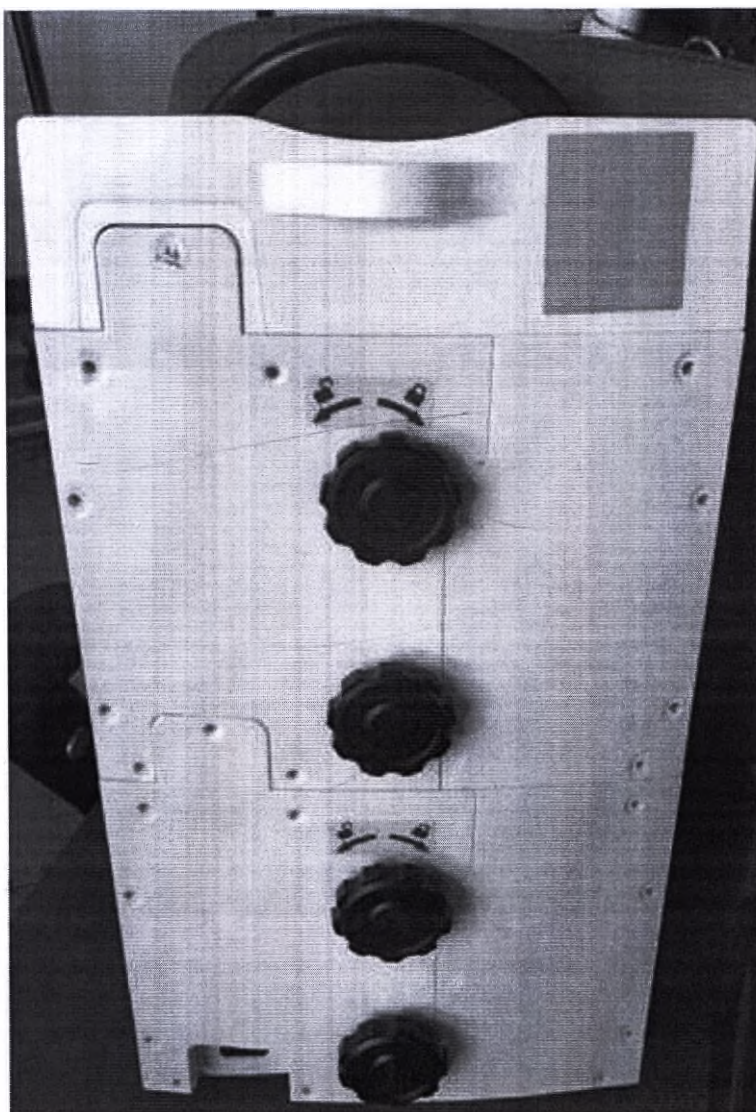


Б)

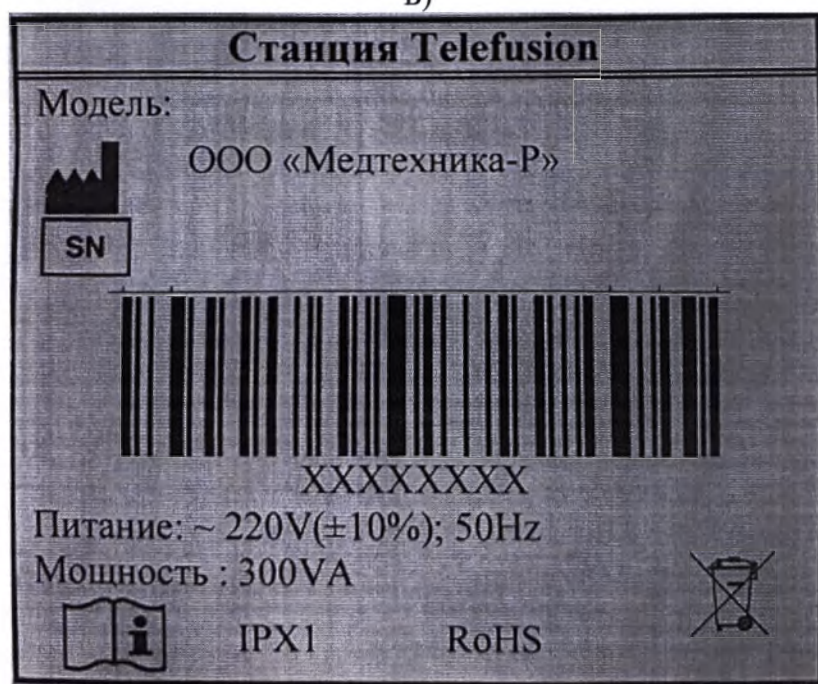

В)

Рисунок 9 – Фотографическое изображение принадлежности: Станция Telefusion
 А) Вид спереди; Б) Вид сзади; В) Образец маркировки

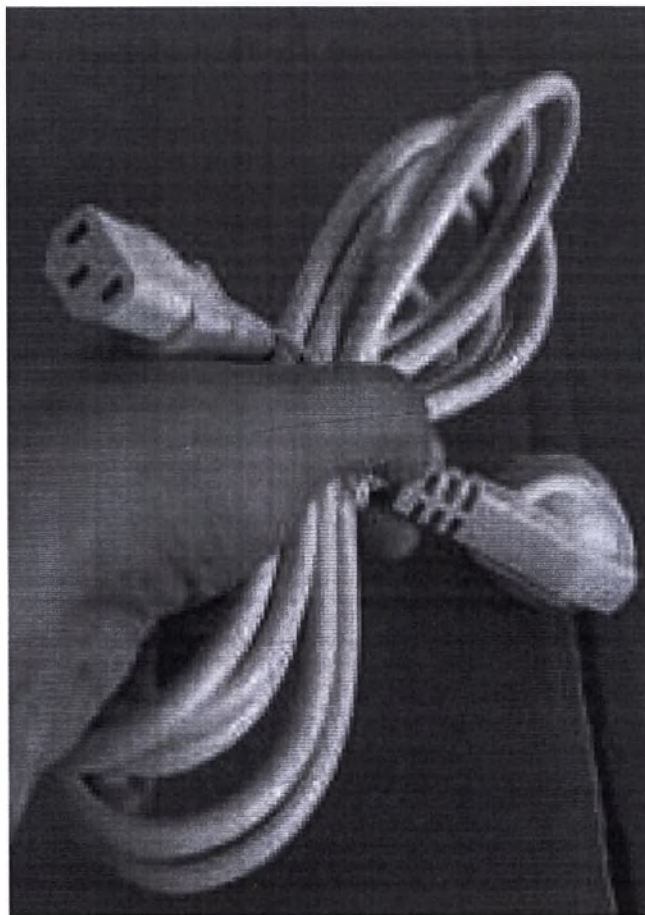


А)



Б)

Рисунок 10 – Фотографическое изображение принадлежности: А) Кабель питания станции Telefusion; Б) Образец маркировки

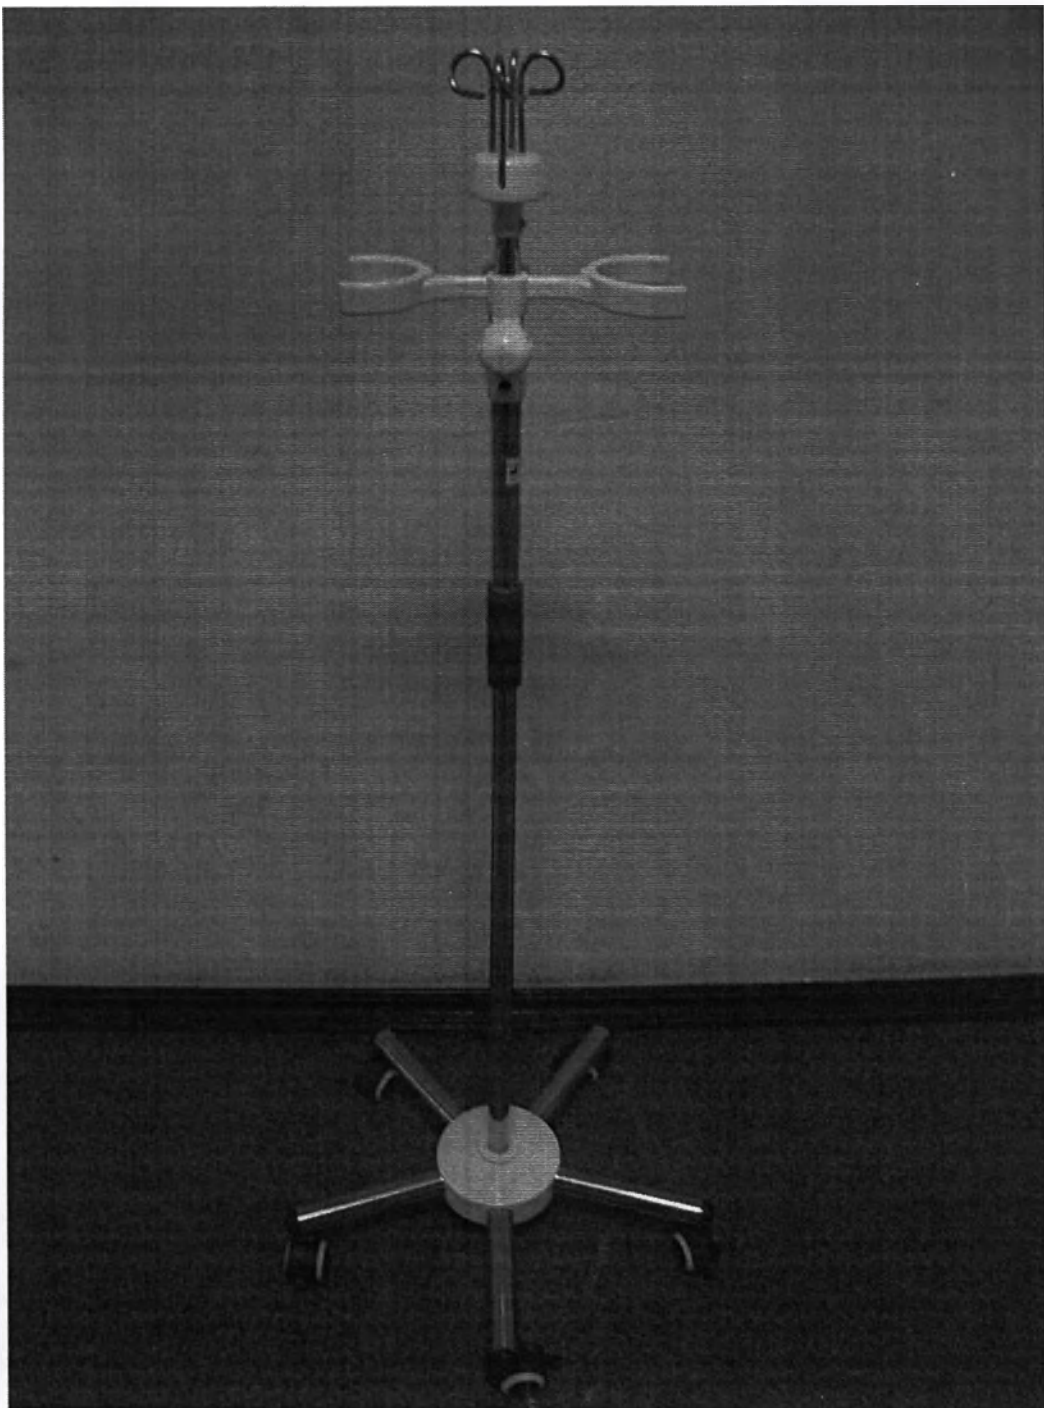

А)



Б)

Рисунок 11 – Фотографическое изображение принадлежности Стойка Telefusion: А) Внешний вид; Б) Маркировка.

Генеральный директор Катая В. В.
Подпись

