

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СЕИЛ ГЛОБАЛ РУС»

П.И. Подорожкин

2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**«Материал оттискный
стоматологический для снятия
слепков полости рта с
принадлежностями»**

(SEIL GLOBAL CO., LTD («СЕИЛ ГЛОБАЛ КО.,
ЛТД»), Корея)

2018



Рис. 1 – Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil Bite Registration


				СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, ГаеЙна-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	
Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями				СК Юроп ГмбХ Центр Арибелла 70Ф1, Льемер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071	
Название модели		Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil Bite Registration			
Состав	- Картридж-туб с оттискным материалом 50 мл - 2 шт.; - Насадка пластиковая смесительная для картриджей-туб с оттискным материалом - 6 шт. - Наконечник внутриротовой пластиковый для насадки пластиковой смесительной для картриджей-туб с оттискным материалом - 3 шт. - Инструкция по использованию - 1 шт.				
	1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию				
	2019.04.13	Тип оттискового материала	Тип I Высоковязкая консистенция		
		 SBI7041451			
Минимальный объем оттискового материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 98 мл					

Рис. 2 – маркировка материала оттискового стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil Bite Registration



Рис.3 – Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil tray

				СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	
Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями				СК Юроп ГмбХ Центр Арабелла 70Ф1, Лёнер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071	
Название модели		Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil tray			
Состав		- Картридж-туб с оттискным материалом 8 шт. по 50 мл; - Насадка пластиковая смесительная для картриджей-туб с оттискным материалом 20 шт. - Инструкция по использованию 1 шт.			
		1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию			
		2019-06		Тип оттискового материала	
		 15°C 25°C		 SL14020721	
Минимальный объем оттискового материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 392 мл					

Рис. 4 – маркировка материала оттискового стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil tray



Рис. 5 – Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil light body

				СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаейва-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820		
Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		EC REP		СК Юроп ГмбХ Центр Арабелла 70Ф1, Льемер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071		
Название модели		Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil light body				
Состав		- Картридж-туб с оттискным материалом 50 мл - 4 шт.; - Насадка пластиковая смесительная для картриджей-туб с оттискным материалом - 12 шт. - Наконечник внутриротовой пластиковый для насадки пластиковой смесительной для картриджей-туб с оттискным материалом - 4 шт. - Инструкция по использованию - 1 шт.				
		1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию				
		2019.05.15		Тип оттискового материала		Тип 3 Низковязкая консистенция
				LOT SL17051621		
Минимальный объем оттискового материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 196 мл						

Рис. 6 – маркировка материала оттискового стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil light body;



Рис. 7 – Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil putty;



 Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		 СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гасйива-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820		
		 СК Юроп ГмбХ Центр Арабелла 70Ф1, Лёненер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071		
Название модели		Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil putty		
Состав	- Банка с пастой-катализатором оттискного материала 300 мл (500 г) - 1 шт. - Банка с пастой-основой оттискного материала 300 мл (500 г) - 1 шт. - Ложка мерная пластиковая - 2 шт. - Инструкция по использованию - 1 шт.			
	1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию			
	2019.05.28	Тип оттискного материала		Тип 0 Плотная консистенция
		 SP17052831		
Минимальный объем оттискного материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 598 мл				

Рис. 8 – маркировка материала оттискного стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil putty



Рис. 9 – Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil light body S LV


 Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		 СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гасеива-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	 1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию		
		СК Юрон ГмбХ Центр Арабелла 70Ф1, Лёненер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071	 2019.02.01	Тип оттискового материала	Тип 3 Низковолокнистая консистенция
Название модели		Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil light body S LV		 15 °C	 25 °C
Состав	- Картридж-туб с оттисковым материалом 6 мл - 20 шт.; - Порошок короткий пластиковый для картриджей-туб с оттисковым материалом - 2 шт. - Порошок длинный пластиковый для картриджей-туб с оттисковым материалом - 2 шт. - Насадка пластиковая смесительная для картриджей-туб с оттисковым материалом - 10 шт. - Наконечник внутриротовой пластиковый для насадки пластиковой смесительной для картриджей-туб с оттисковым материалом - 10 шт. - Инструкция по использованию - 1 шт.			 170201	
				Минимальный объем оттискового материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 100 мл	

Рис. 10 – маркировка материала оттискового стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil light body S LV



Рис. 11 – материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil light body S XLV



 Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		 СЕЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гасйва-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	 1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию				
 СК Юроп ГмбХ Центр Арабелла 70Ф1, Лёвнер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071		 2019.02.01	Тип оттискового материала	Тип 3 Низкая вязкая консистенция			
Название модели		Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil light body S XLV		 15 °C	 25 °C	 170202	
Состав	- Картридж-туб с оттисковым материалом 6 мл - 20 шт.; - Поршень короткий пластиковый для картриджей-туб с оттисковым материалом - 2 шт. - Поршень длинный пластиковый для картриджей-туб с оттисковым материалом - 2 шт. - Насадка пластиковая смесительная для картриджей-туб с оттисковым материалом - 10 шт. - Наконечник внутриворотовой пластиковый для насадки пластиковой смесительной для картриджей-туб с оттисковым материалом - 10 шт. - Инструкция по использованию - 1 шт.					Минимальный объем оттискового материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 100 мл	

Рис. 12 – маркировка материала оттискового стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil light body S XLV



Рис. 13 – материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil Tube Application for Soft Tray


 Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		 СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	 1. Применяется только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию				
		СК Юроп ГмбХ Центр Арабелла 70Ф1, Льемер СТР 44-48, Франкфурт 60528, Германия Тел: +49-69-690-1312 Факс: +49-69-66-1071		2019.09.09	Тип оттискового материала	Тип 2 Консистенция средней вязкости	
Название модели		Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта Smart Sil Tube Application for Soft Tray					 STT17090101
Состав		- Туба с пастой-катализатором оттискового материала 150 мл - 1 шт. - Туба с пастой-основой оттискового материала 150 мл - 1 шт. - Инструкция по использованию - 1 шт.		Минимальный объем оттискового материала, который можно получить, смешав все содержимое внешней упаковки: 298 мл			

Рис. 14 – маркировка материала оттискового стоматологического для снятия слепков полости рта Smart Sil Tube Application for Soft Tray



Рис. 15 – Насадка пластиковая смешительная для картриджей-туб с оттискным материалом New Yellow Mix Tip S130



 Материал оттисковый стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		 СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гасейва-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	
		ЙОВИДЕНТ Интернэшнл Реджентселаан 23, 1217 ЕД ХИЛВЕРСУМ Нидерланды Тел: +31 6 46418849 Факс: +31 87 784 0440	
Принадлежность: насадка пластиковая смесительная для картриджей-туб с оттискным материалом			Количество: 50 шт.
☒ New Yellow Mix Tip S130 ☐ New Green Mix Tip S131 ☐ New Pink Mix Tip S132 ☐ New Blue Mix Tip S133 ☐ New Core Mix Tip S123 ☐ New Resin Cement Tip-S S124 ☐ New Resin Cement Tip-L S125 ☐ New Blue Cement Tip-L S141 ☐ New Temporary Crown Tip S142 ☐ Yellow Mix Tip S130-A ☐ Green Mix Tip S131-A ☐ Core Mix Tip S123-A ☐ Resin Cement Tip-S S124-A ☐ Resin Cement Tip-L S125-A ☐ New Auto Mix Tip S134 ☐ New Auto Mix Tip-Yellow S135 ☐ New Core Mix Tip-L S140 ☐ New Core Mix Tip-B S136 ☐ New Resin Cement Tip-BS S137 ☐ New Resin Cement Tip-BL S138 ☐ New Blue Mix Tip-B S139			
	1. Используется только квалифицированными специалистами 2. Использование неподходящей насадки может привести к утечке оттискового материала 3. Возможно аллергическая реакция у пациентов с повышенной чувствительностью к материалу насадки. 4. Не использовать насадки при поврежденной упаковке.		
	Одноразовое использование		
	15 °C  25 °C	LOT D24-170807-02	

Рис. 16 – маркировка насадок пластиковых смесительных для картриджей-туб с оттискным материалом



Рис. 17 – Наконечник внутриротовой пластиковый для насадки пластиковой смесительной для картриджей-туб с оттискным материалом Yellow oral tip S115;



Рис. 18 – маркировка наконечников внутриротовых пластиковых для насадки пластиковой смесительной

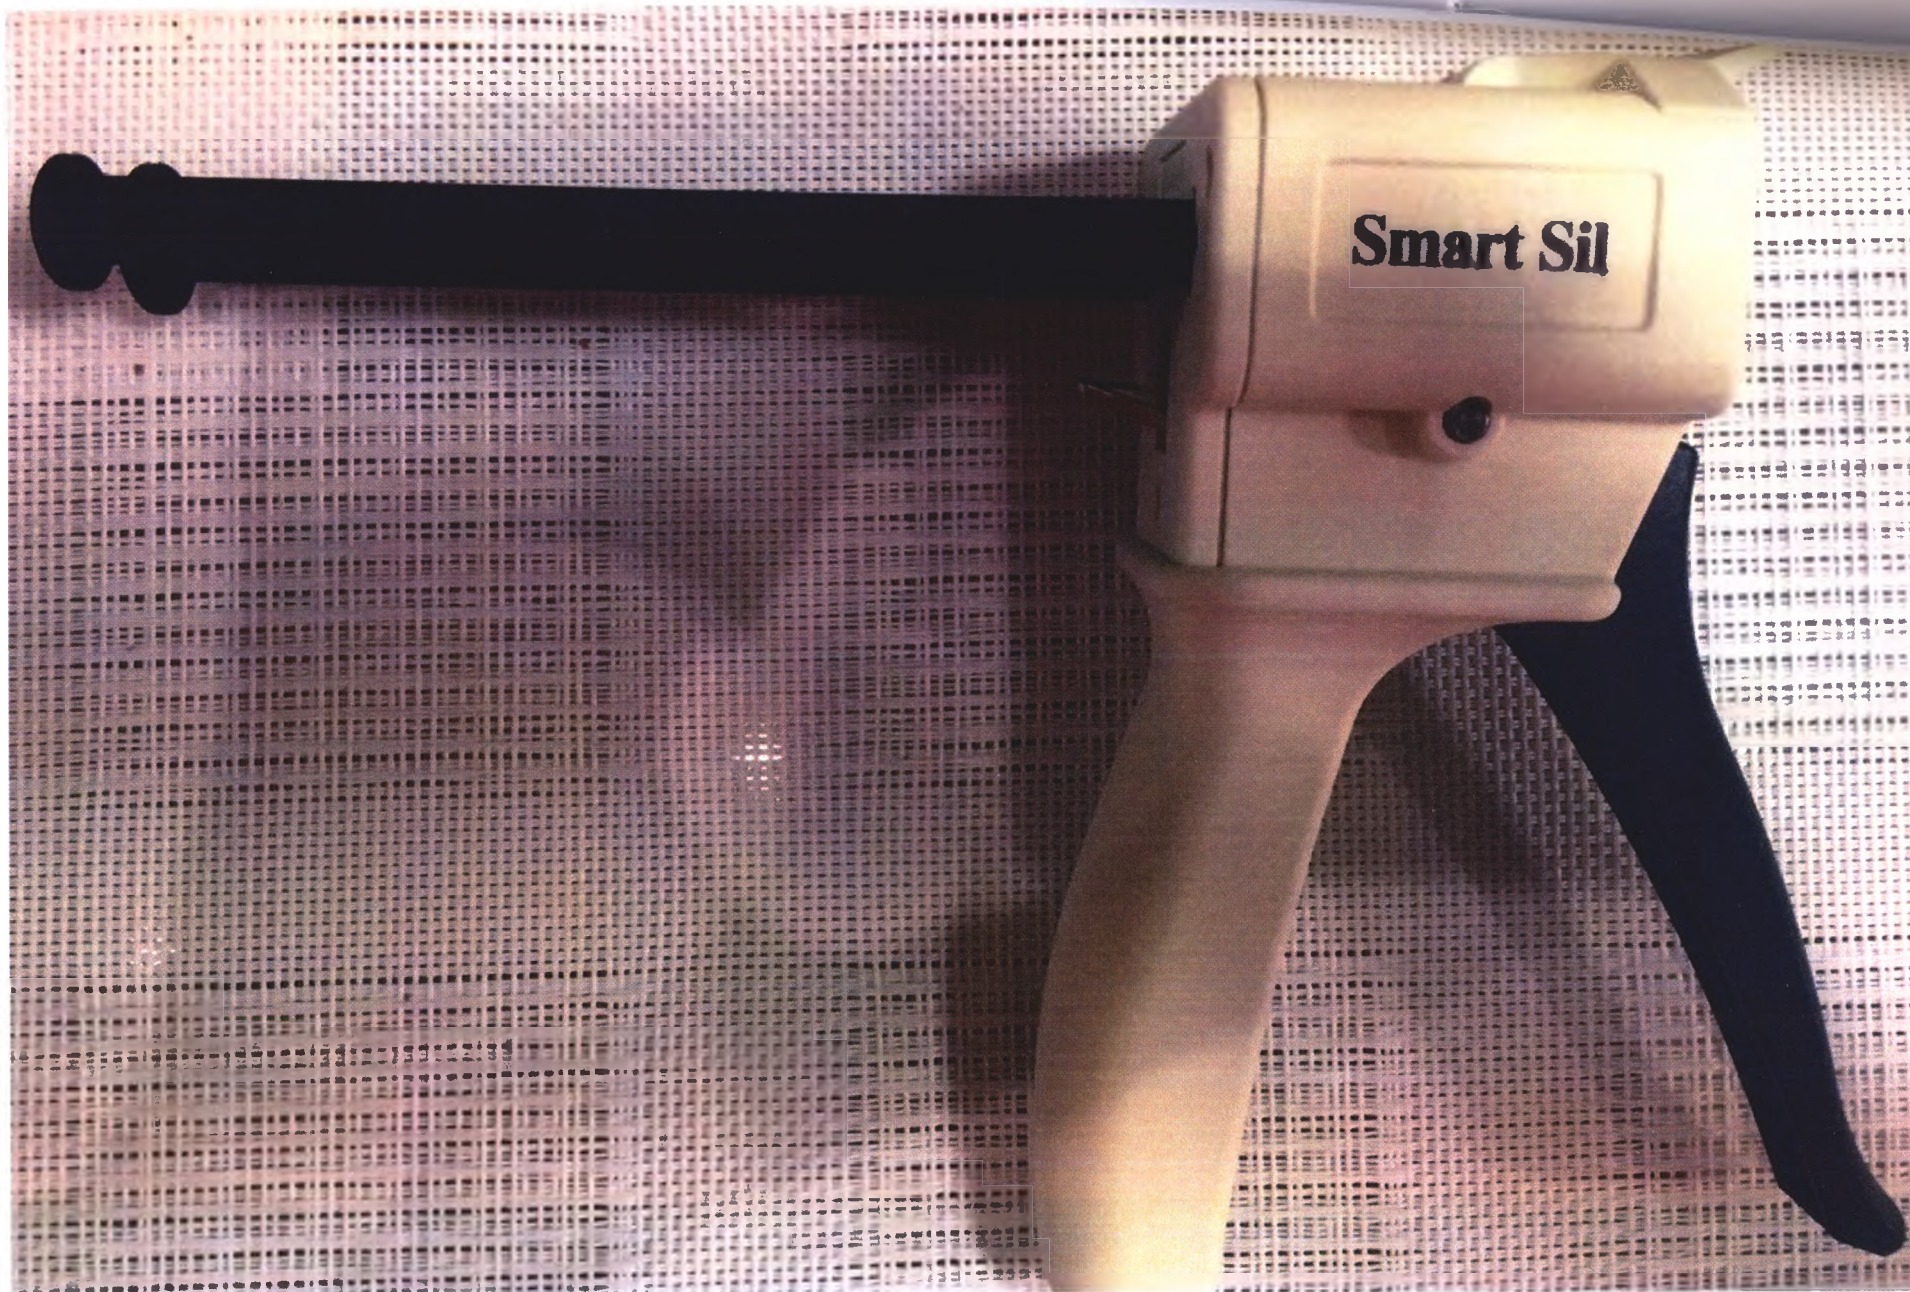


Рис.19 – пистолет для смешивания оттисковых материалов DentiAnn Smart Sil;

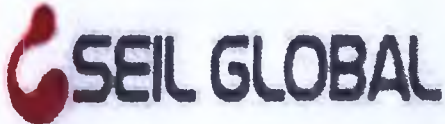



 Материал оттискный стоматологический для снятия слепков полости рта с принадлежностями		СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820		
		ЙОВИДЕНТ Интернэшнл Реджентеселаан 23, 1217 ЕД ХИЛВЕРСУМ Нидерланды Тел: +31 6 46418849 Факс: +31 87 784 0440		
Принадлежность: пистолет для смешивания оттискных материалов DentiAnn Smart Sil		Количество: 1 шт.		
	1. Используется только квалифицированными специалистами 2. Не использовать пистолет для смешивания оттискных материалов при поврежденной упаковке. 3. Обратитесь к инструкции по использованию.			
	2017.03.01			
LOT D24-170810-07				

Рис.20 – маркировка пистолета для смешивания оттискных материалов DentiAnn Smart Sil;


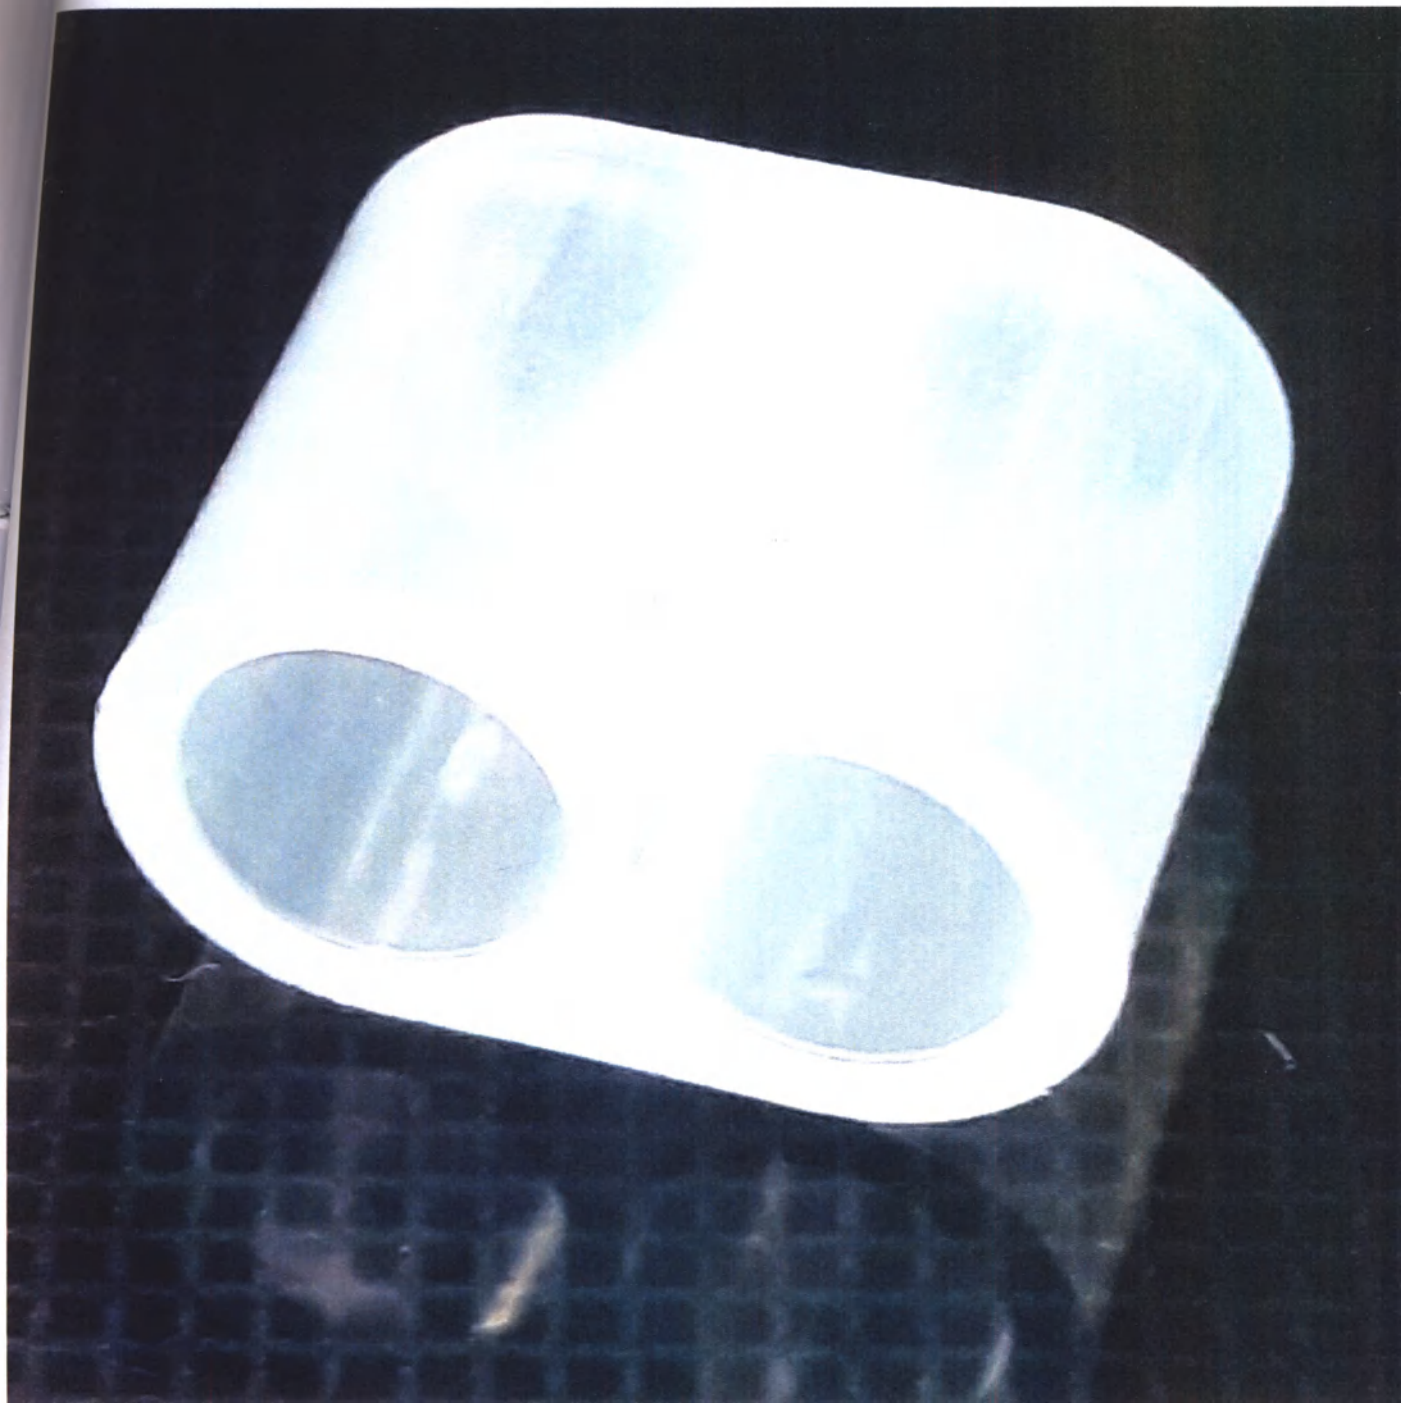


Рис.21 — соединитель пластиковый Cartridge Connector для картриджей-туб с оттисковыми материалами;



Материал оттисковый
стоматологический для
снятия слепков полости рта
с принадлежностями

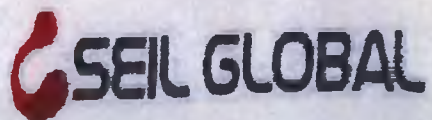

СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД.
191, Гаейва-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея
Тел: +82-51-465-5456
Факс: +82-51-462-6820

EC REP

ЙОВИДЕНТ Интернэшнл
Реджентеселаан 23, 1217 ЕД ХИЛВЕРСУМ
Нидерланды
Тел: +31 6 46418849 Факс: +31 87 784 0440

Принадлежность: соединитель пластиковый Cartridge Connector
для картриджей-туб с оттисковыми материалами


Количество: 3 шт.



1. Используется только квалифицированными специалистами
2. Не использовать соединители при поврежденной упаковке.



Одноразовое
использование



2017.03.01



15 °C 25 °C



D24-170809-05

Рис.22 – маркировка соединителей пластиковых Cartridge Connector для картриджей-туб с оттисковыми материалами;

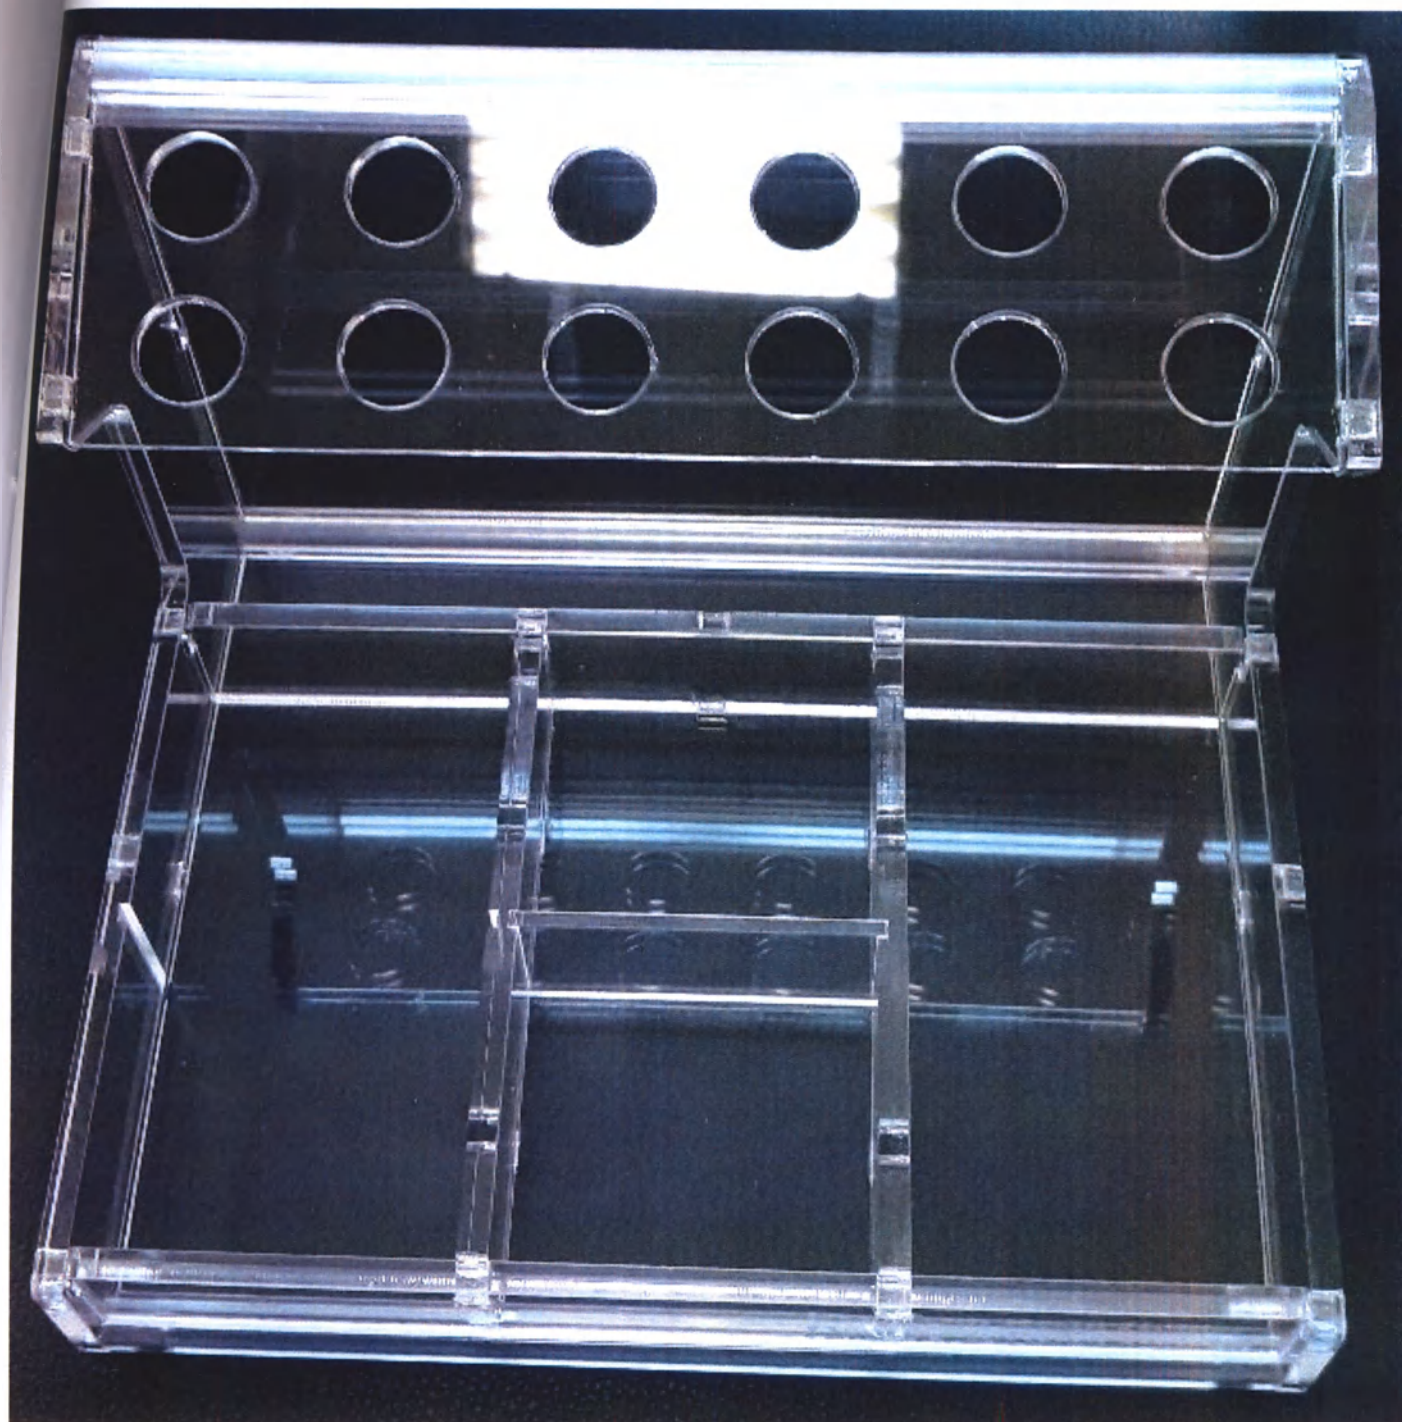


Рис.23 – Подставка-держатель DentiAnn 12 Syringe Resin Holder;


 Материал оттискный стоматологический для снятия полости рта с принадлежностями		СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаейва-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел.: +82-51-465-5456 Факс.: +82-51-462-6820		
		СК ЮРОП ГмбХ Центр Аабелла 70Ф1, Льемер СТР 44-48, Франкфурт 6052, Германия Тел.: +49-69-690-1312 Факс.: +49-69-66-1071		
Комплект поставки*: • Материал оттискный стоматологический Smart Sil Bite Registration – 1 уп. • Принадлежности: 1) Пистолет для смешивания оттискных материалов DentiAnn Smart Sil – 1 шт. 2) Соединитель пластиковый Cartridge Connector для картриджей-туб с оттискными материалами – 3 шт 3) Подставка-держатель в исполнении DentiAnn 12 Syringe Resin Holder – 1 шт.		1. Применять только в стоматологии 2. Не применять при поврежденной упаковке 3. Обратитесь к инструкции по использованию		
		SB17041451		
		2019-06		
				



Рис.24 – макет маркировки транспортной упаковки изделия;

Всего промисов, промисловых
и скреплено печатью
25 (двадцать пять) листов,
Генеральный директор
Семь Губаев Руслан



Поговорочки Т.А.