

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«14» марта 2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**«Ложки оттискные стоматологические
для снятия слепков полости рта»**

**(SEIL GLOBAL CO., LTD («СЕИЛ ГЛОБАЛ КО.,
ЛТД»), Корея)**

2018



Рис. 1– Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: US



Рис. 2– Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: LS



Рис. 3– Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: UM



Рис. 4 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: LM



Рис. 5 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: P1



Рис. 6 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: UL



Рис. 7 — Ложка оттисковая стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: LL



Рис. 8 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении:
РА



Рис. 9 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: РВ



Рис. 10 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: Р2

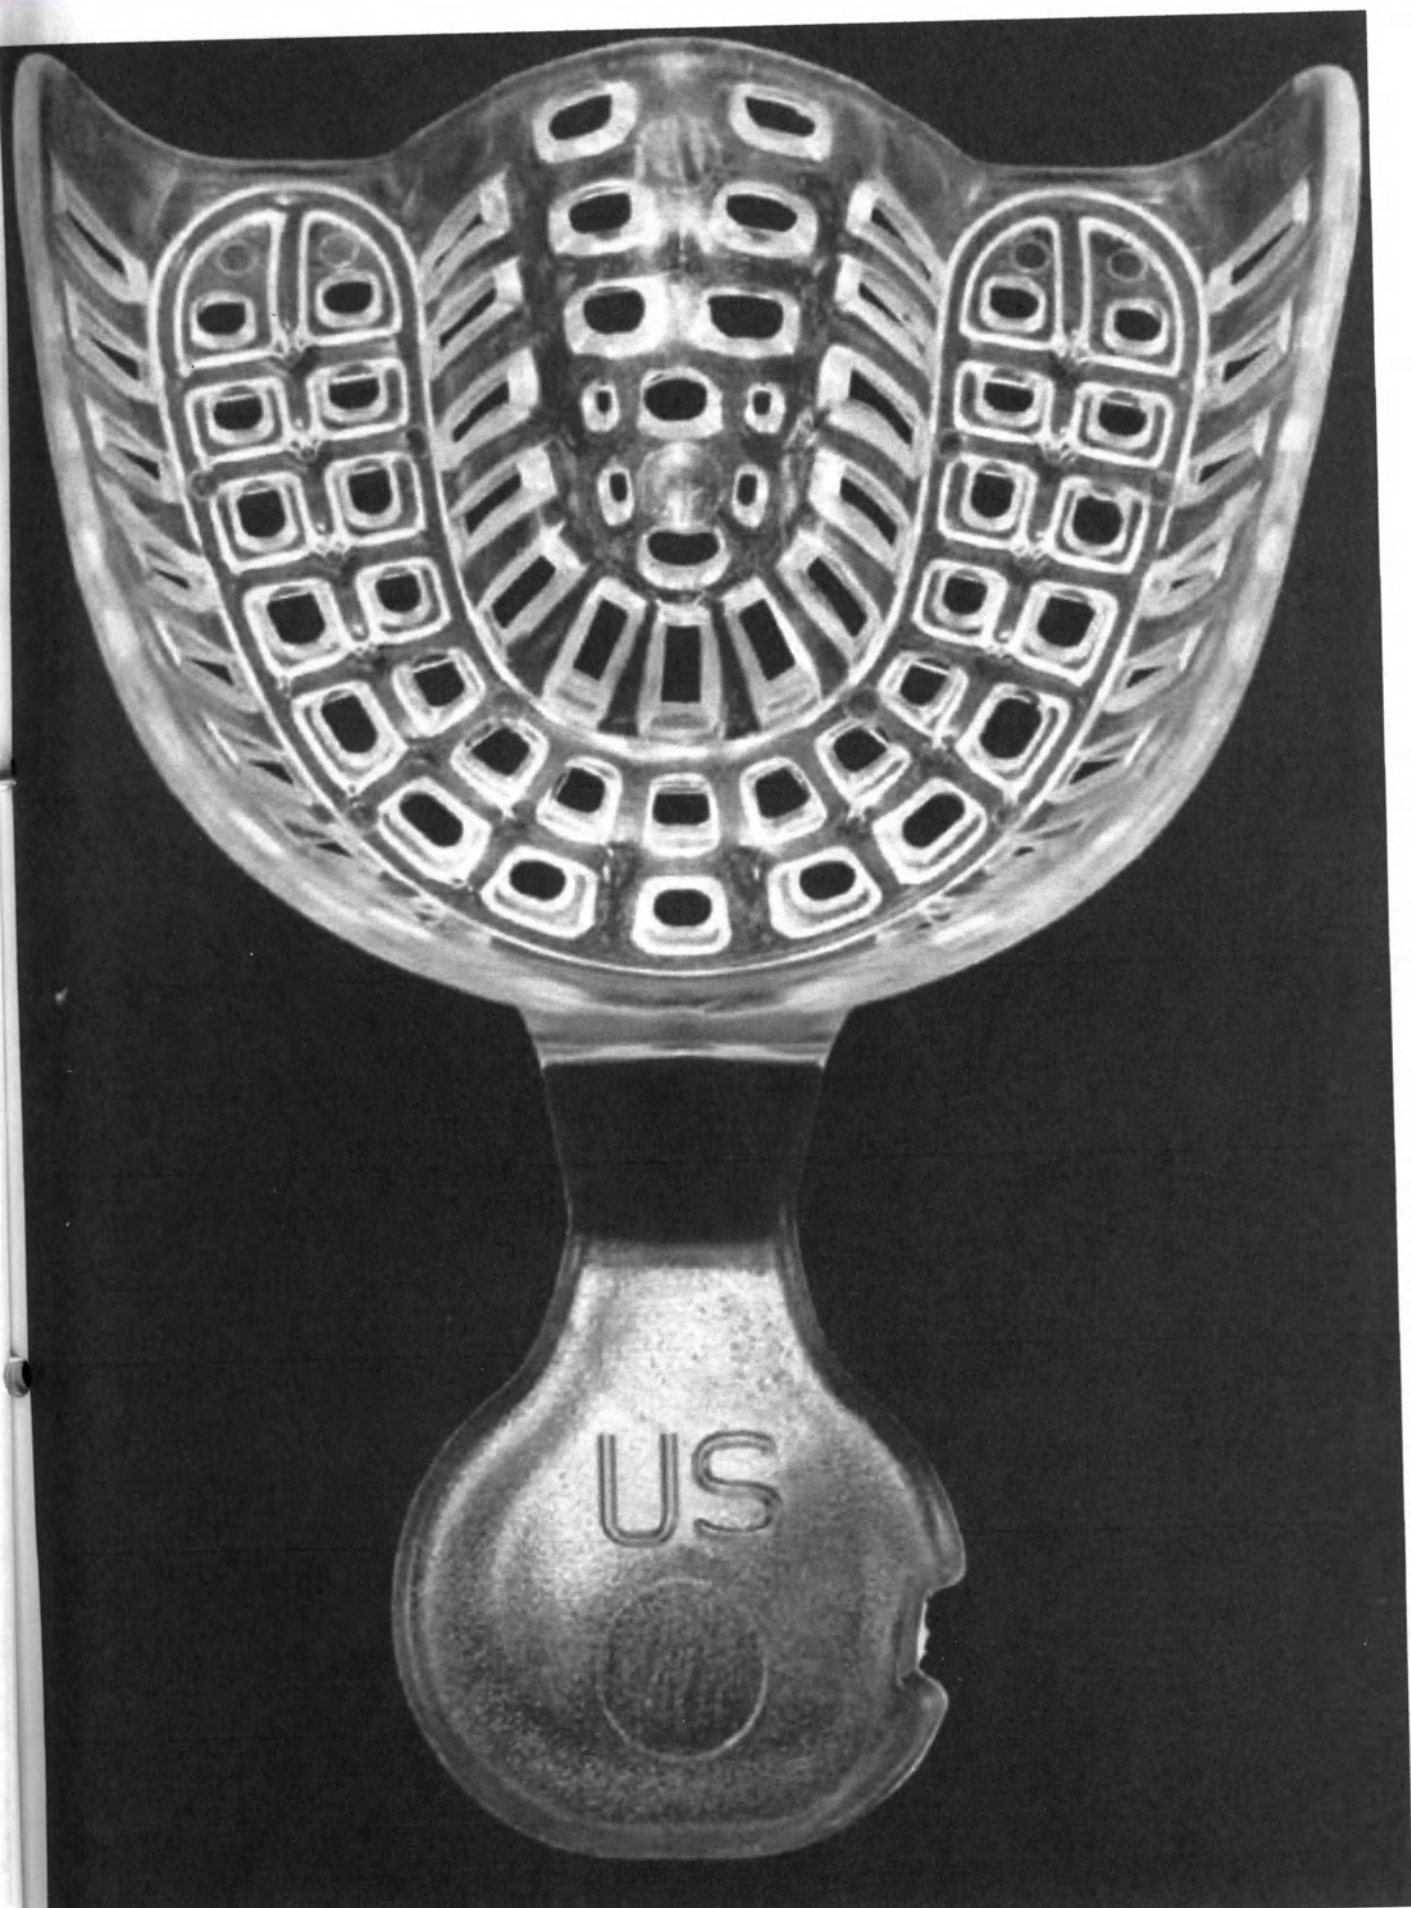


Рис. 11 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: US

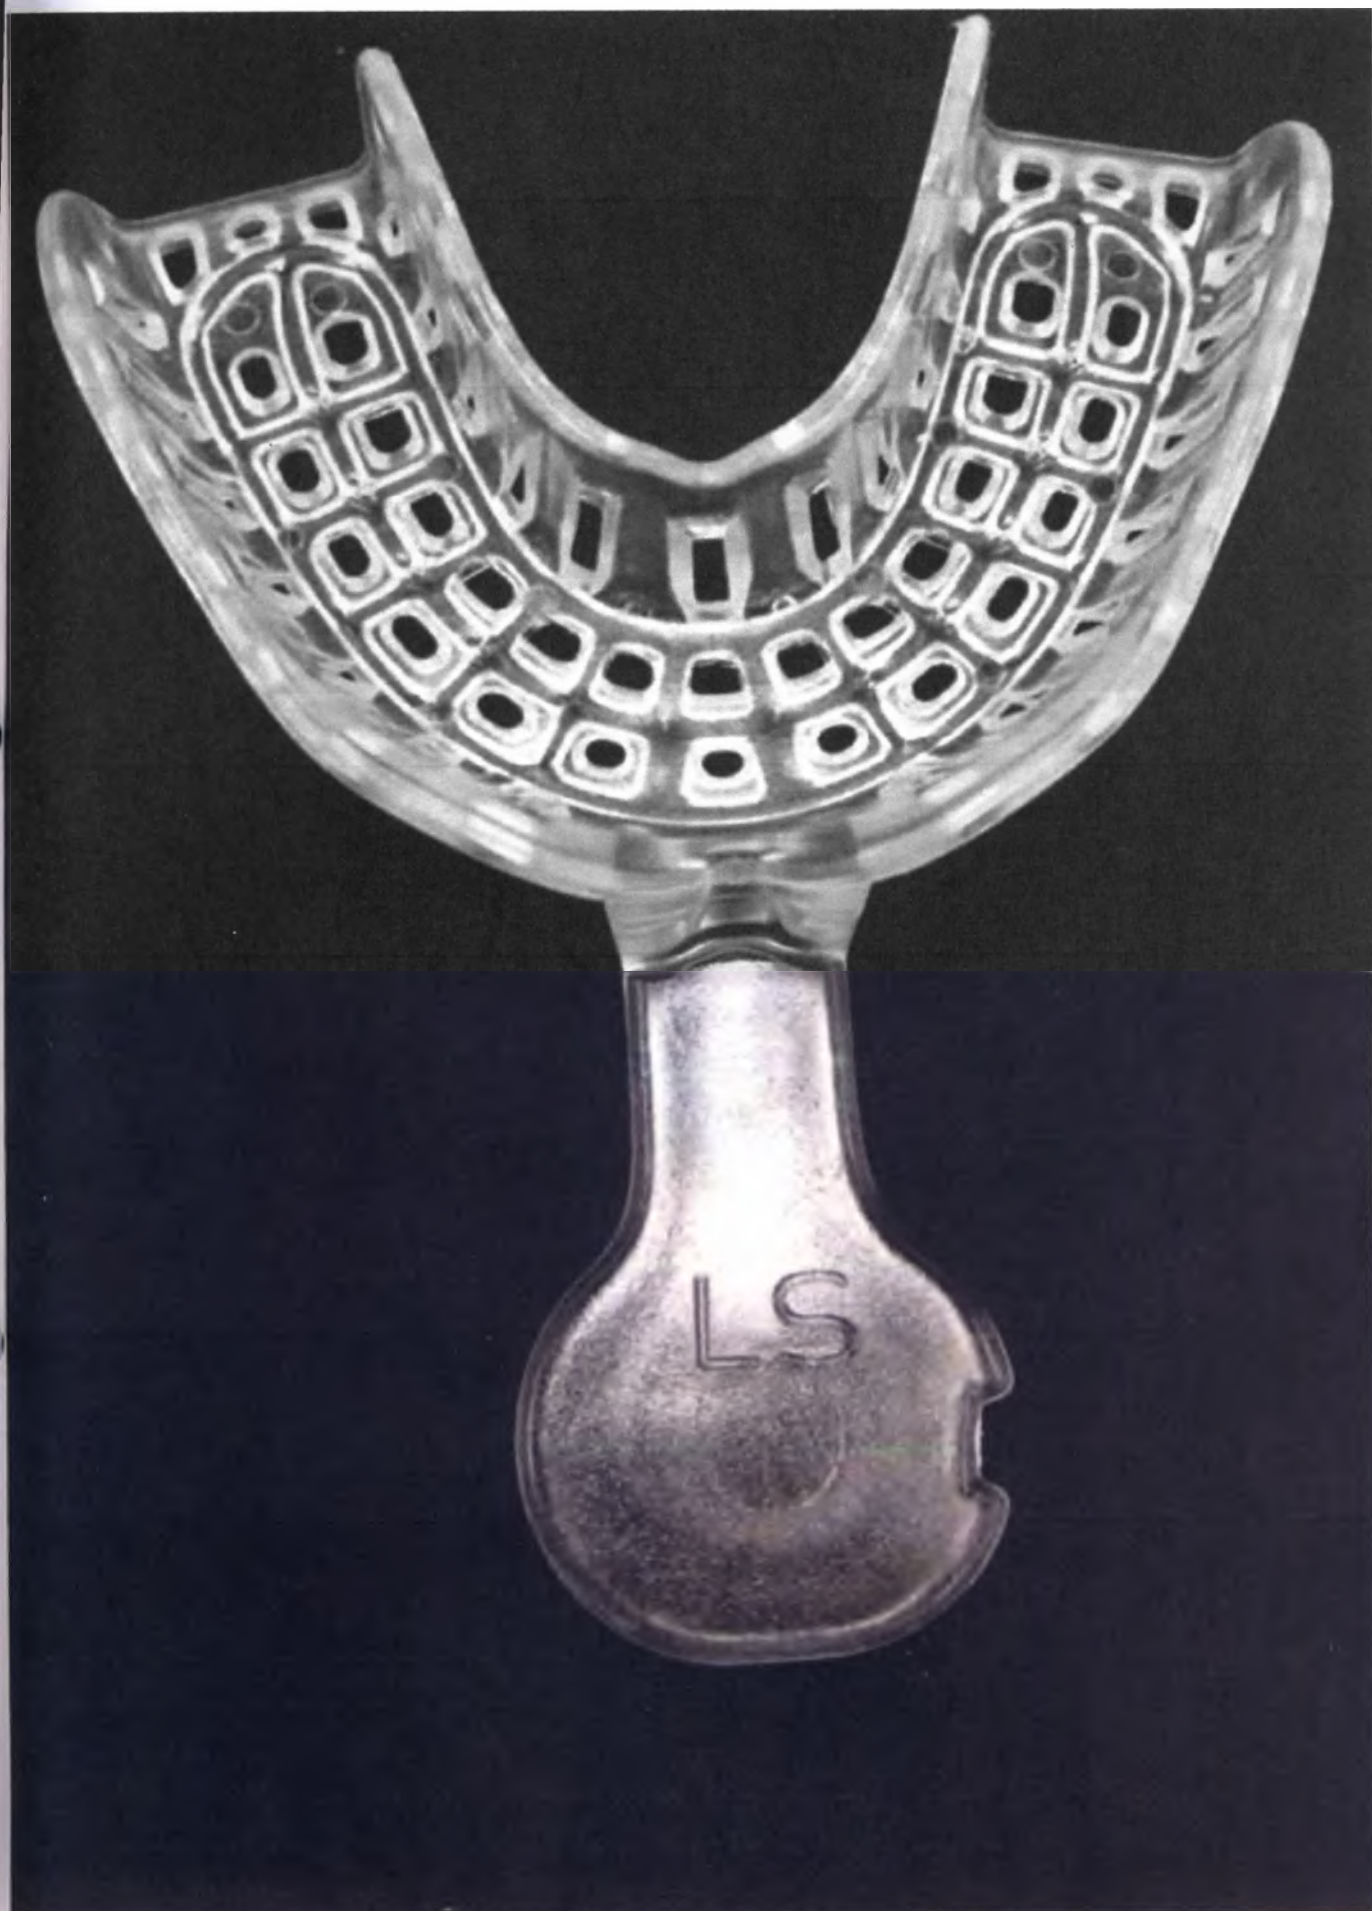


Рис. 12 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: LS



Рис. 13 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: UM

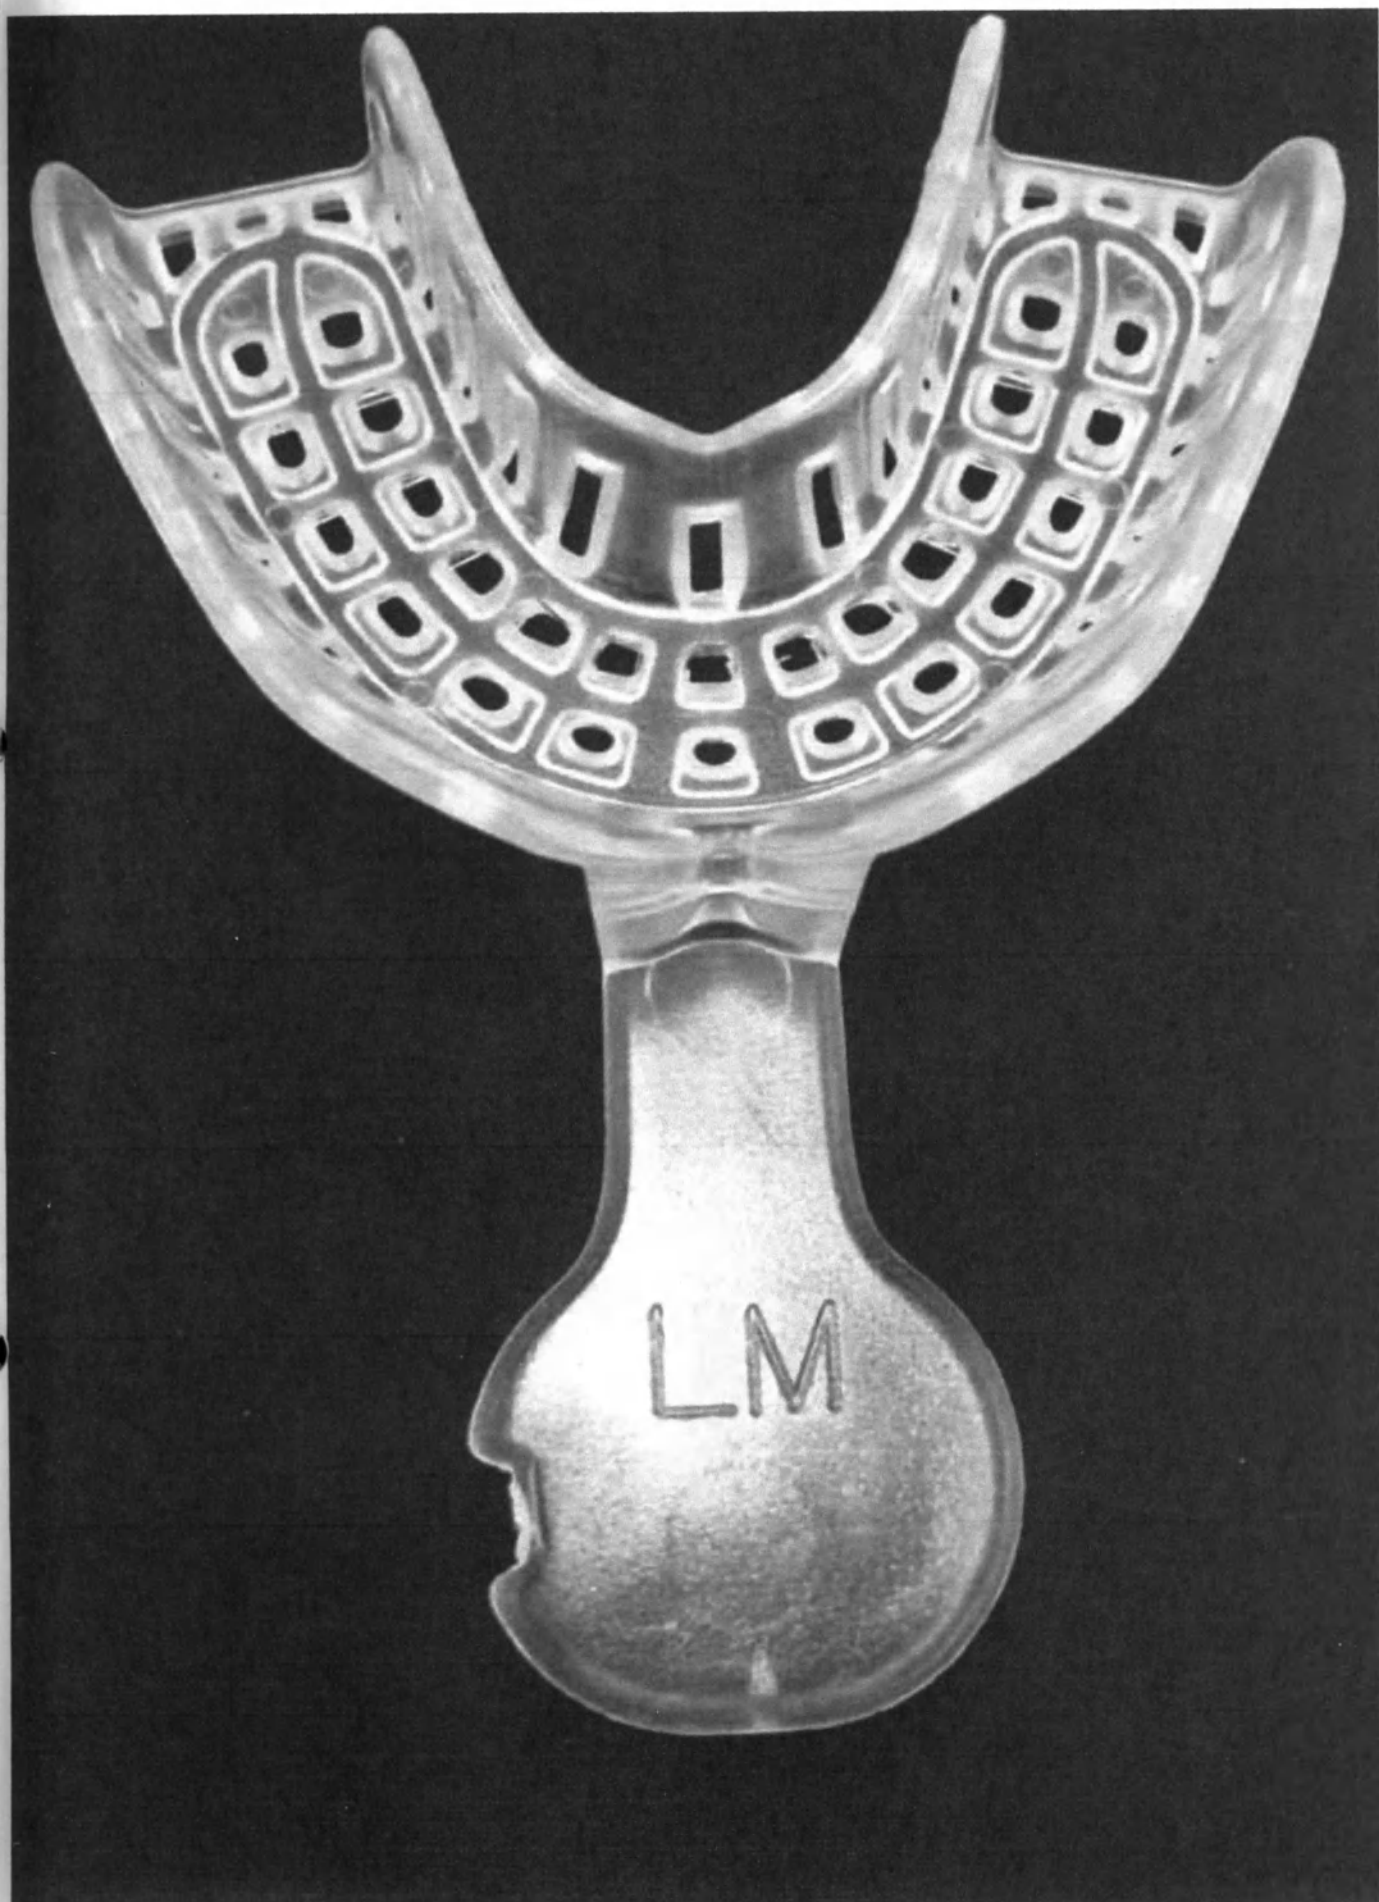


Рис. 14 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: LM

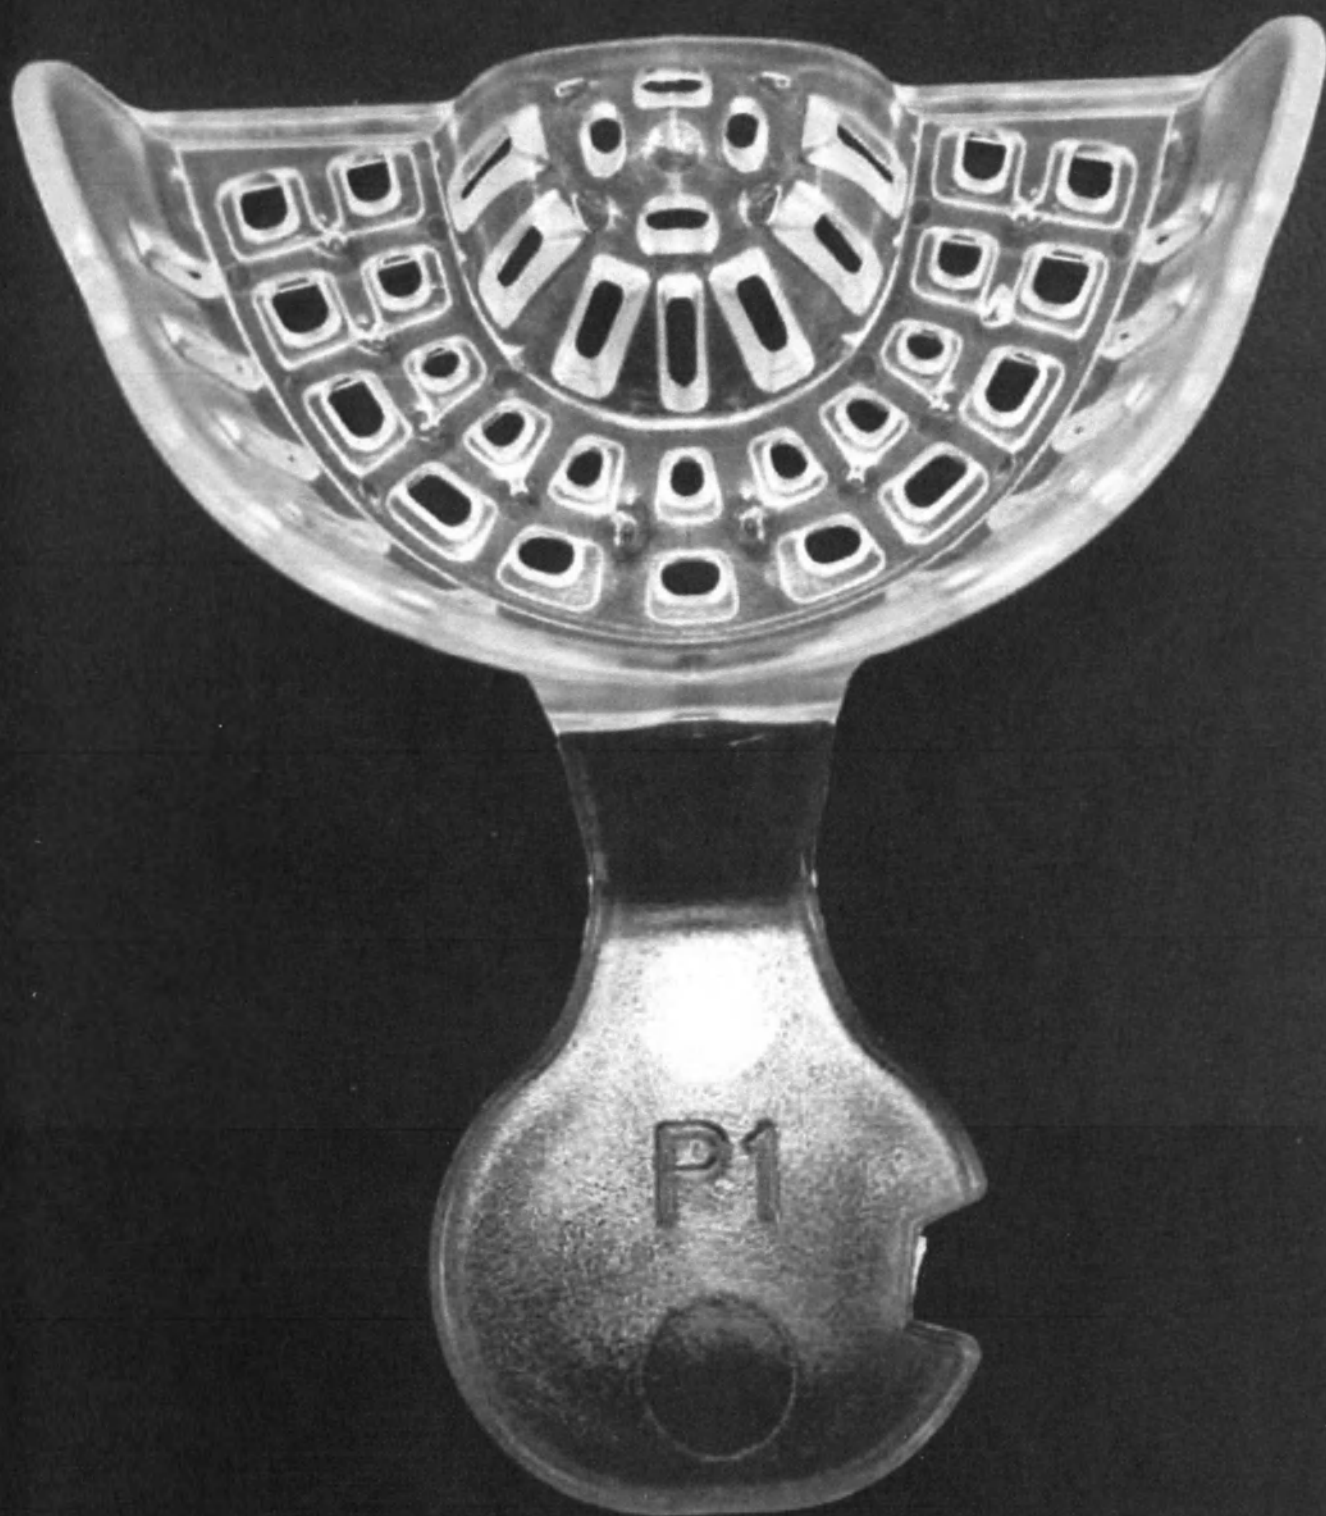


Рис. 15 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: P1



Рис. 16 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: UL



Рис. 17 – Ложка оттисковая стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: LL



Рис. 18 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: РА



Рис. 19 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: РВ



Рис. 20 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении: P2



Рис. 21 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Bite Tray в исполнении: #1 Posterior



Рис. 22 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Bite Tray в исполнении: 2 Sideless Posterior



Рис. 23 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Bite Tray в исполнении: #3 Full Arch

24 из 30



Рис. 24 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Bite Tray в исполнении: №4 Anterior



Рис. 25 – Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков полости рта Bite Tray в исполнении: #5 Quadrant




 Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта Plastic tray		 СЕИЛГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	
			ЙОВИДЕНТ Интернэшнл Реджентеселаан 23, 1217 ЕД ХИЛВЕРСУМ Нидерланды Тел: +31 6 46418849 Факс: +31 87 784 0440
Название модели	✓ US □ LS □ UM □ LM □ UL □ LL □ PA □ PB □ P1 □ P2		Количество: 48 шт.
	1. Применяется только квалифицированным персоналом. 2. Движение пациента во время процедуры может привести к травмам. 3. Порезы на деснах могут привести к развитию инфекции. 4. Не использовать изделие при поврежденной упаковке.		
	Одноразовое использование		
	12°C 25°C	20.07.2017	
	 D24-170609-05		

Рис. 26 – Маркировка ложек оттисковых стоматологических для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении US (48 шт./уп)




 SEIL GLOBAL Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта Implant tray			СЕИЛГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаейва-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел: +82-51-465-5456 Факс: +82-51-462-6820	
		EC REP	ЙОВИДЕНТ Интернэшнл Реджентеселаан 23, 1217 ЕД ХИЛВЕРСУМ Нидерланды Тел: +31 6 46418849 Факс: +31 87 784 0440	
Название модели	☐ US ☐ LS ☐ UM ☐ LM ☒ UL ☐ LL ☐ PA ☐ PB ☐ P1 ☐ P2		Количество: 40 шт.	
	1. Применяется только квалифицированным персоналом. 2. Движение пациента во время процедуры может привести к травмам. 3. Порезы на деснах могут привести к развитию инфекции. 4. Не использовать изделие при поврежденной упаковке.			
	Одноразовое использование		20.07.2017	
			LOT D24-170611-01	

Рис. 27 – Маркировка ложек оттисковых стоматологических для снятия слепков полости рта Implant Tray в исполнении UL (40 шт./уп)



Ложки оттисковые
стоматологические
для снятия слепков
полости рта
Bite tray



СЕИЛГЛОБАЛ КО., ЛТД.

191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея

Тел: +82-51-465-5456

Факс: +82-51-462-6820

EC REP

ЙОВИДЕНТ Интернэшнл

Реджентселаан 23, 1217 ЕД ХИЛВЕРСУМ

Нидерланды

Тел: +31 6 46418849 Факс: +31 87 784 0440

Название
модели

✓#1 Posterior ☐#2 Sideless posterior
☐#3 Full Arch ☐#4 Anterior ☐#5 Quadrant

Количество:


50 шт.



1. Применяется только квалифицированным персоналом.
2. Движение пациента во время процедуры может привести к травмам.
3. Порезы на деснах могут привести к развитию инфекции.
4. Не использовать изделие при поврежденной упаковке.



Одноразовое
использование



20.07.2017



12°C 25°C

LOT

D24-170610-01

Рис.28 – Маркировка ложек оттисковых стоматологических для снятия слепков полости рта Bite Tray в исполнении #1 Posterior (50 шт./уп)



 Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта Plastic tray в исполнении DentiAnn Tray100		СЕИЛ ГЛОБАЛ КО., ЛТД. 191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел.: +82-51-465-5456 Факс.: +82-51-462-6820	
		ЙОВИДЕНТ Интернэшнл 191, Гаеява-ро, Кымджон-гу, Пусан, Корея Тел.: +82-51-465-5456 Факс.: +82-51-462-6820	
Комплект поставки: Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении: DentiAnn Tray100 (100 шт./уп): -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта US – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта LS – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта UM – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта LM – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта P1 – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта UL – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта LL – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта PA – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта PB – 10 шт; -Ложки оттисковые стоматологические для снятия слепков полости рта P2 – 10 шт -Инструкцию по применению.		1. Применяется только квалифицированным персоналом 2. Движение пациента во время процедуры может привести к травмам. 3. Порезы на деснах могут привести к развитию инфекции. 4. Не использовать при поврежденной упаковке	
	Количество: 100 шт.		
		D25-170609-01	
			
		20.07.2017	
			

Рис.29 – Маркировка транспортной упаковки ложек оттисковых стоматологических для снятия слепков полости рта Plastic Tray в исполнении DentiAnn Tray100 (100 шт./уп)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 30 листа (-ов)

Генеральный Директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

