


Фотографические изображения медицинского изделия

Томограф магнитно-резонансный SIGNA Architect с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела Регистрации и сертификации Россия и СНГ ООО «ДжиИ Хэлскеа»

 А. П. Харитоновна

« 23 » 2022 г.



GE Medical Systems, LLC



3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI 53188 USA



SIGNA Architect

CE 0197



380/400/415 V3~, 50/60 Hz

480 V3~, 60 Hz

≤ 99 kVA_{cont}, ≤ 123 kVA_{nom}



2019-06

EC

REP

GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC FRANCE



EAC

Томограф магнитно-резонансный
SIGNA Architect с принадлежностями

Сделано в США



Manufactured For:
GE Medical Systems, LLC
3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI 53188 USA

REF **SIGNA Architect**

380/400/415 V3~, 50/60 Hz

480 V3~, 60 Hz

$\leq 99 \text{ kVA}_{\text{cont.}}$, $\leq 123 \text{ kVA}_{\text{mom}}$



2019-06



0197



Manufactured By:
**GE Healthcare (Tianjin)
Company Limited**

NO. 266 Jingsan Road
Tianjin Airport Economic Area,
Tianjin P.R. China 300308

EC

REP

GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC FRANCE



EAC

Томограф магнитно-резонансный
SIGNA Architect с принадлежностями

Сделано в Китае





Консоль управления.







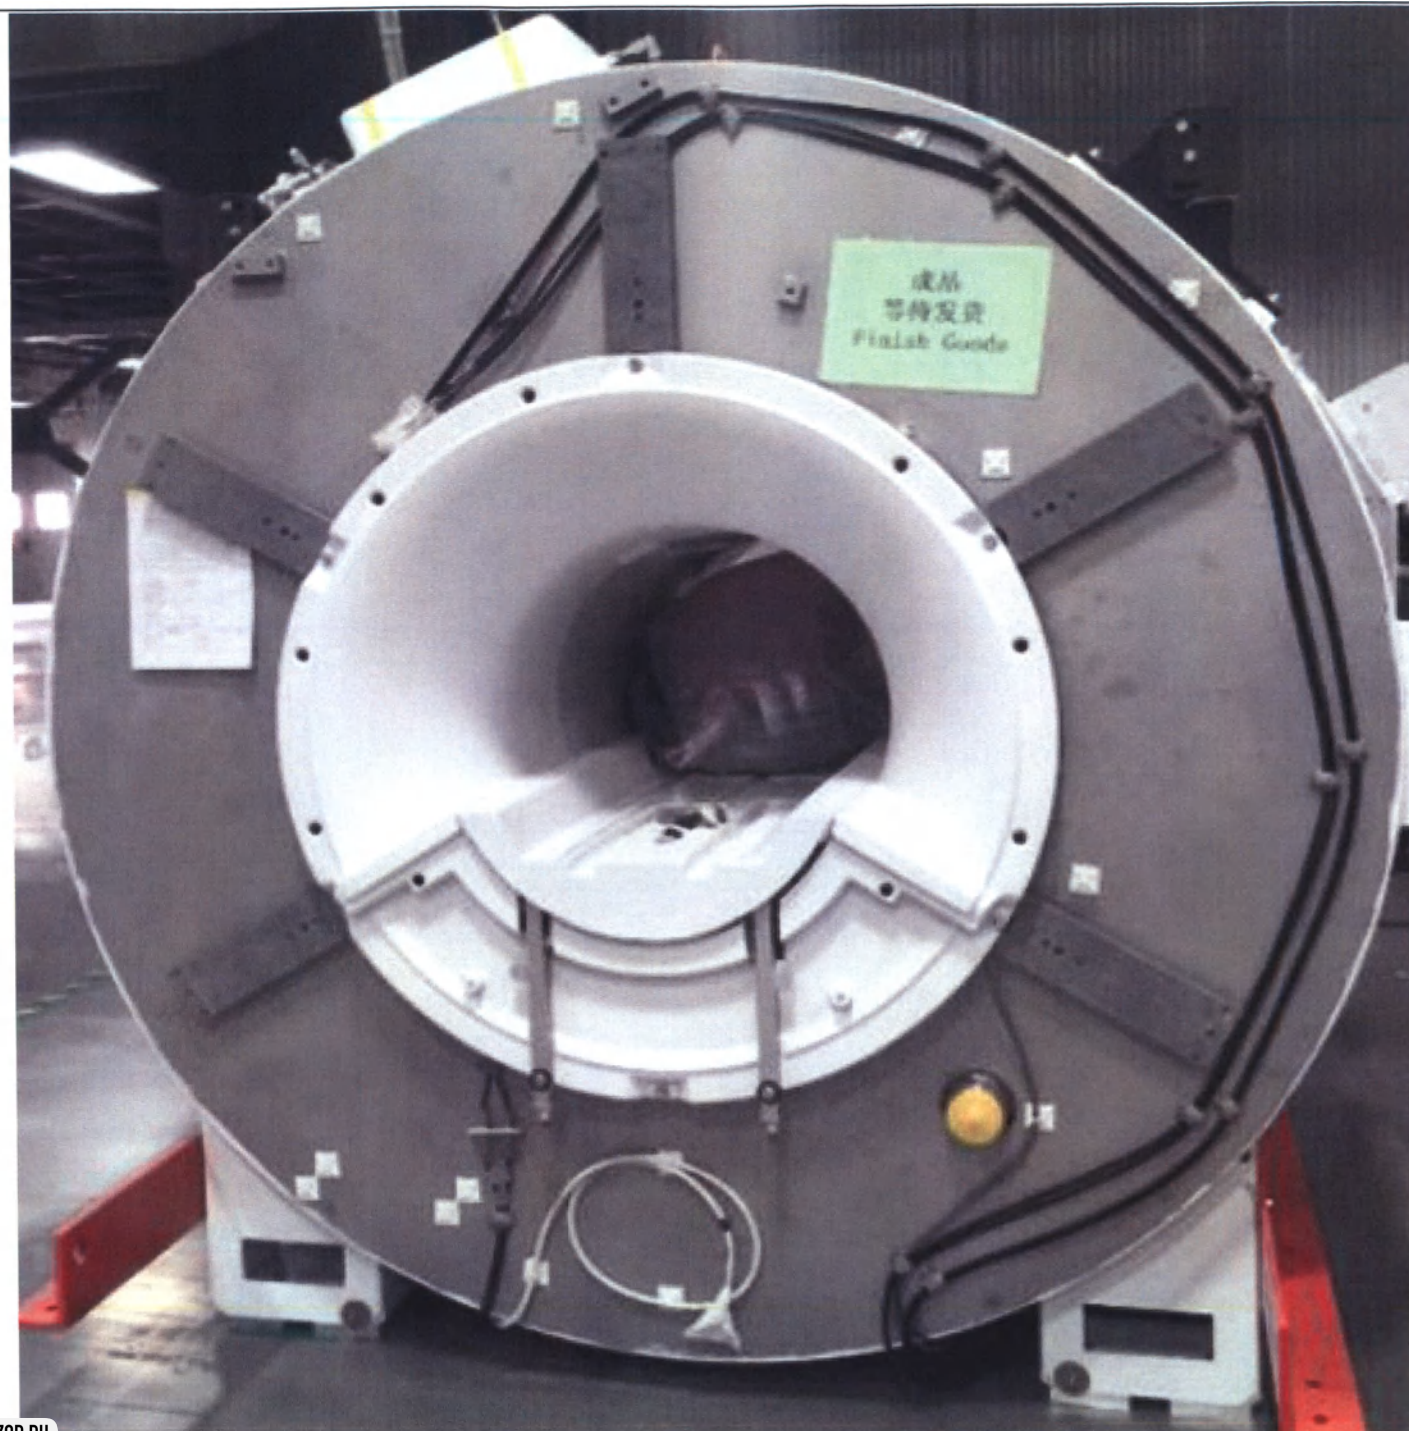

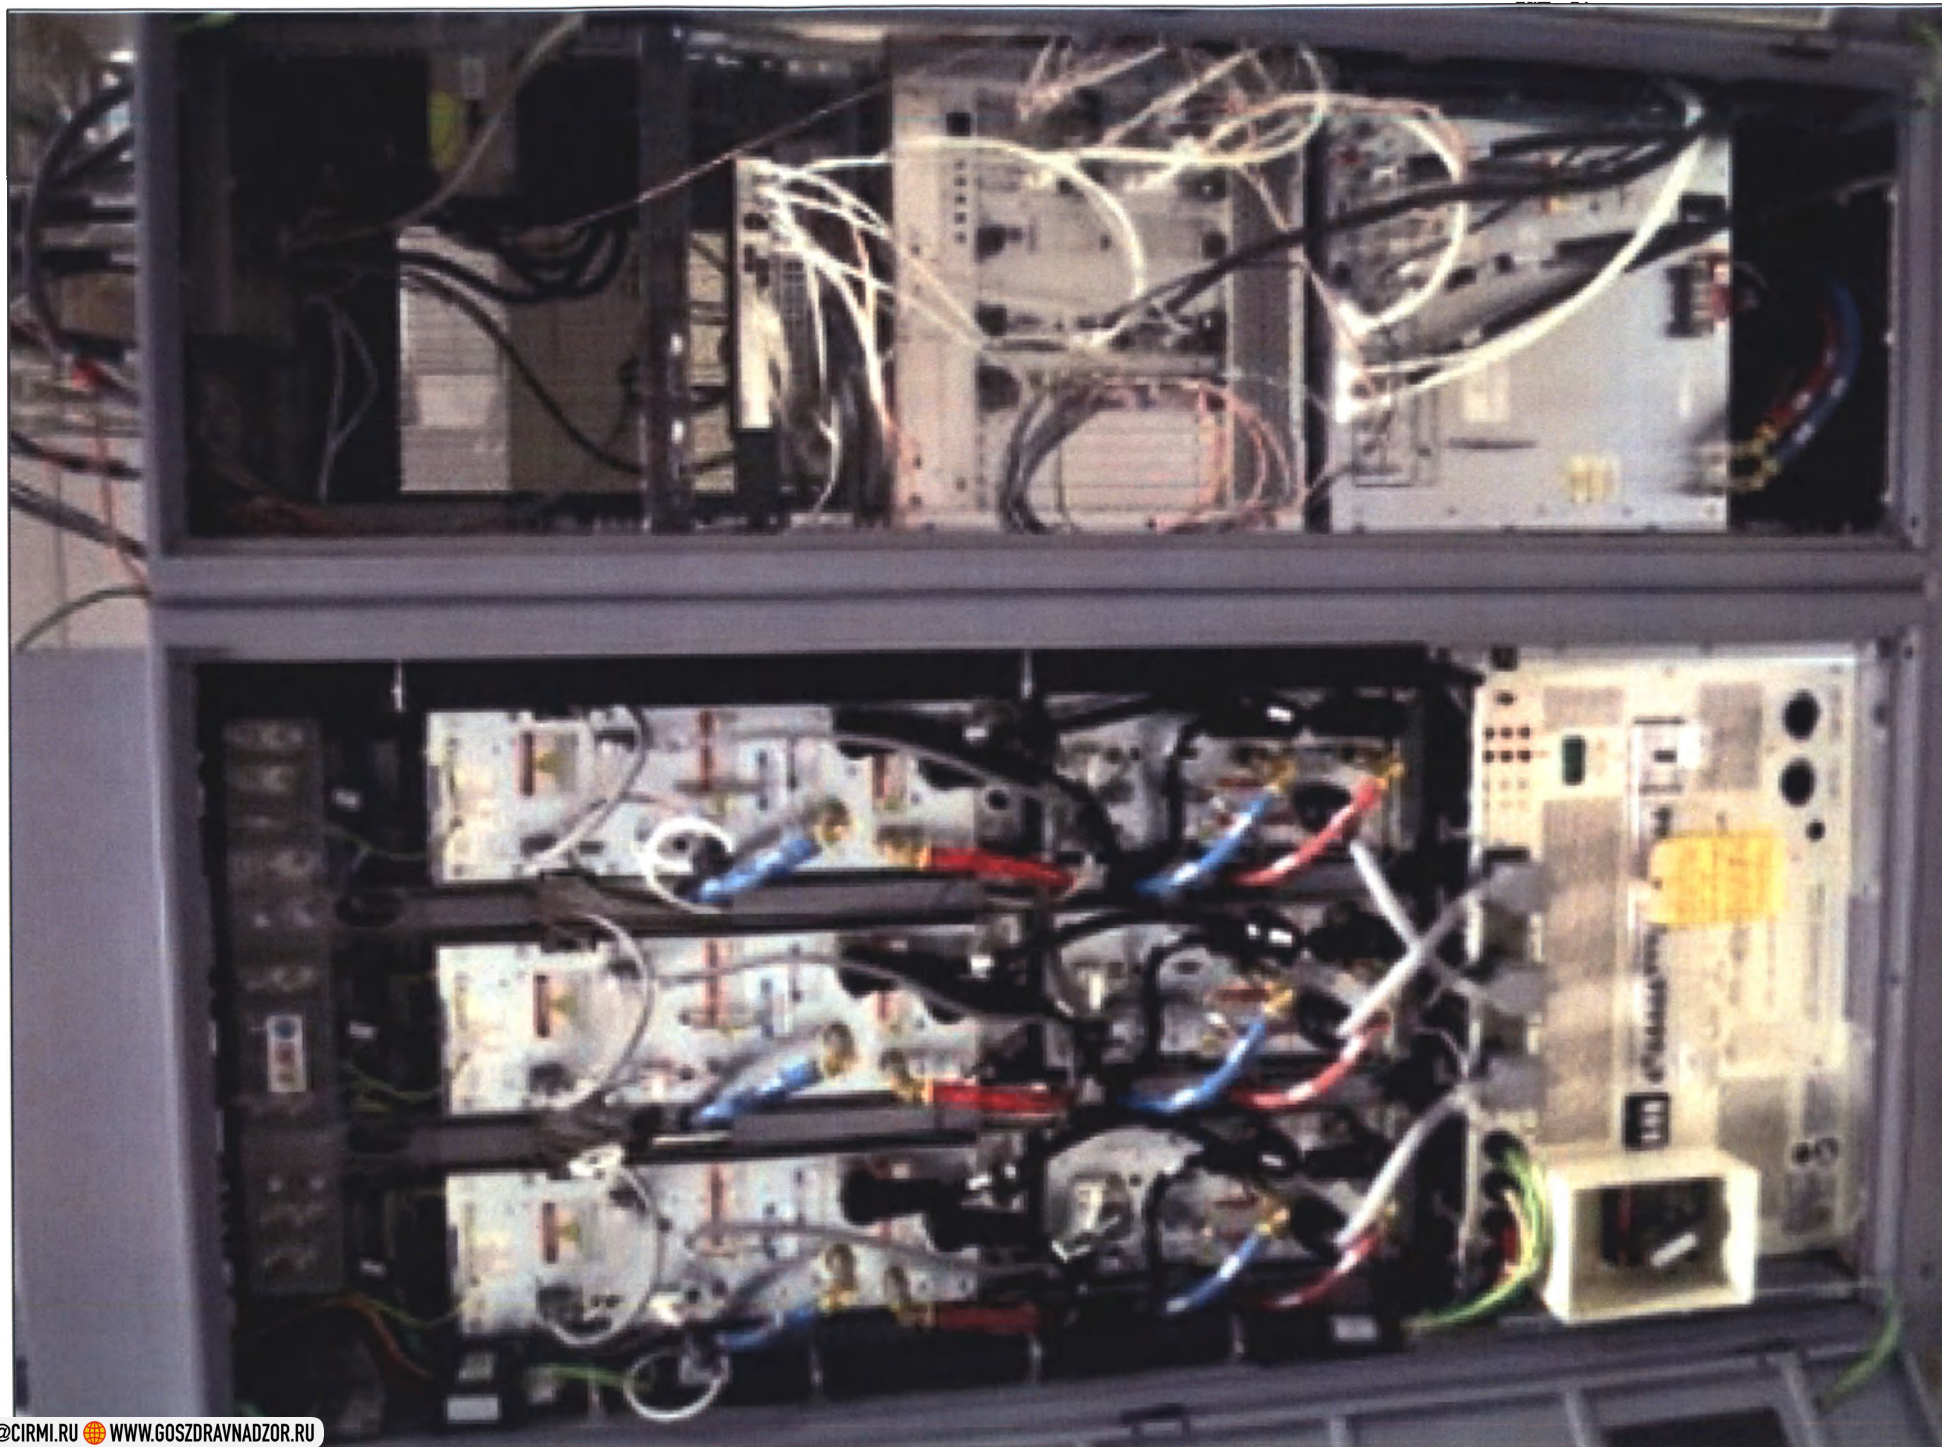

Шафы управления системой



Квадратурная катушка для головы (при необходимости)



























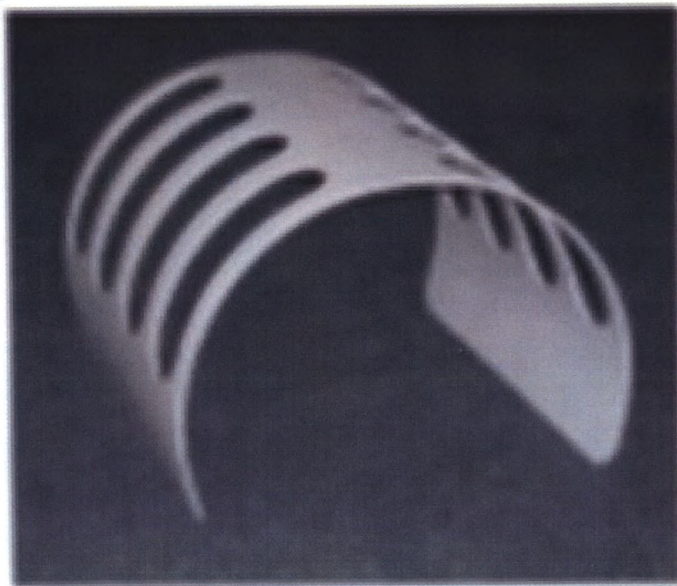

1



2

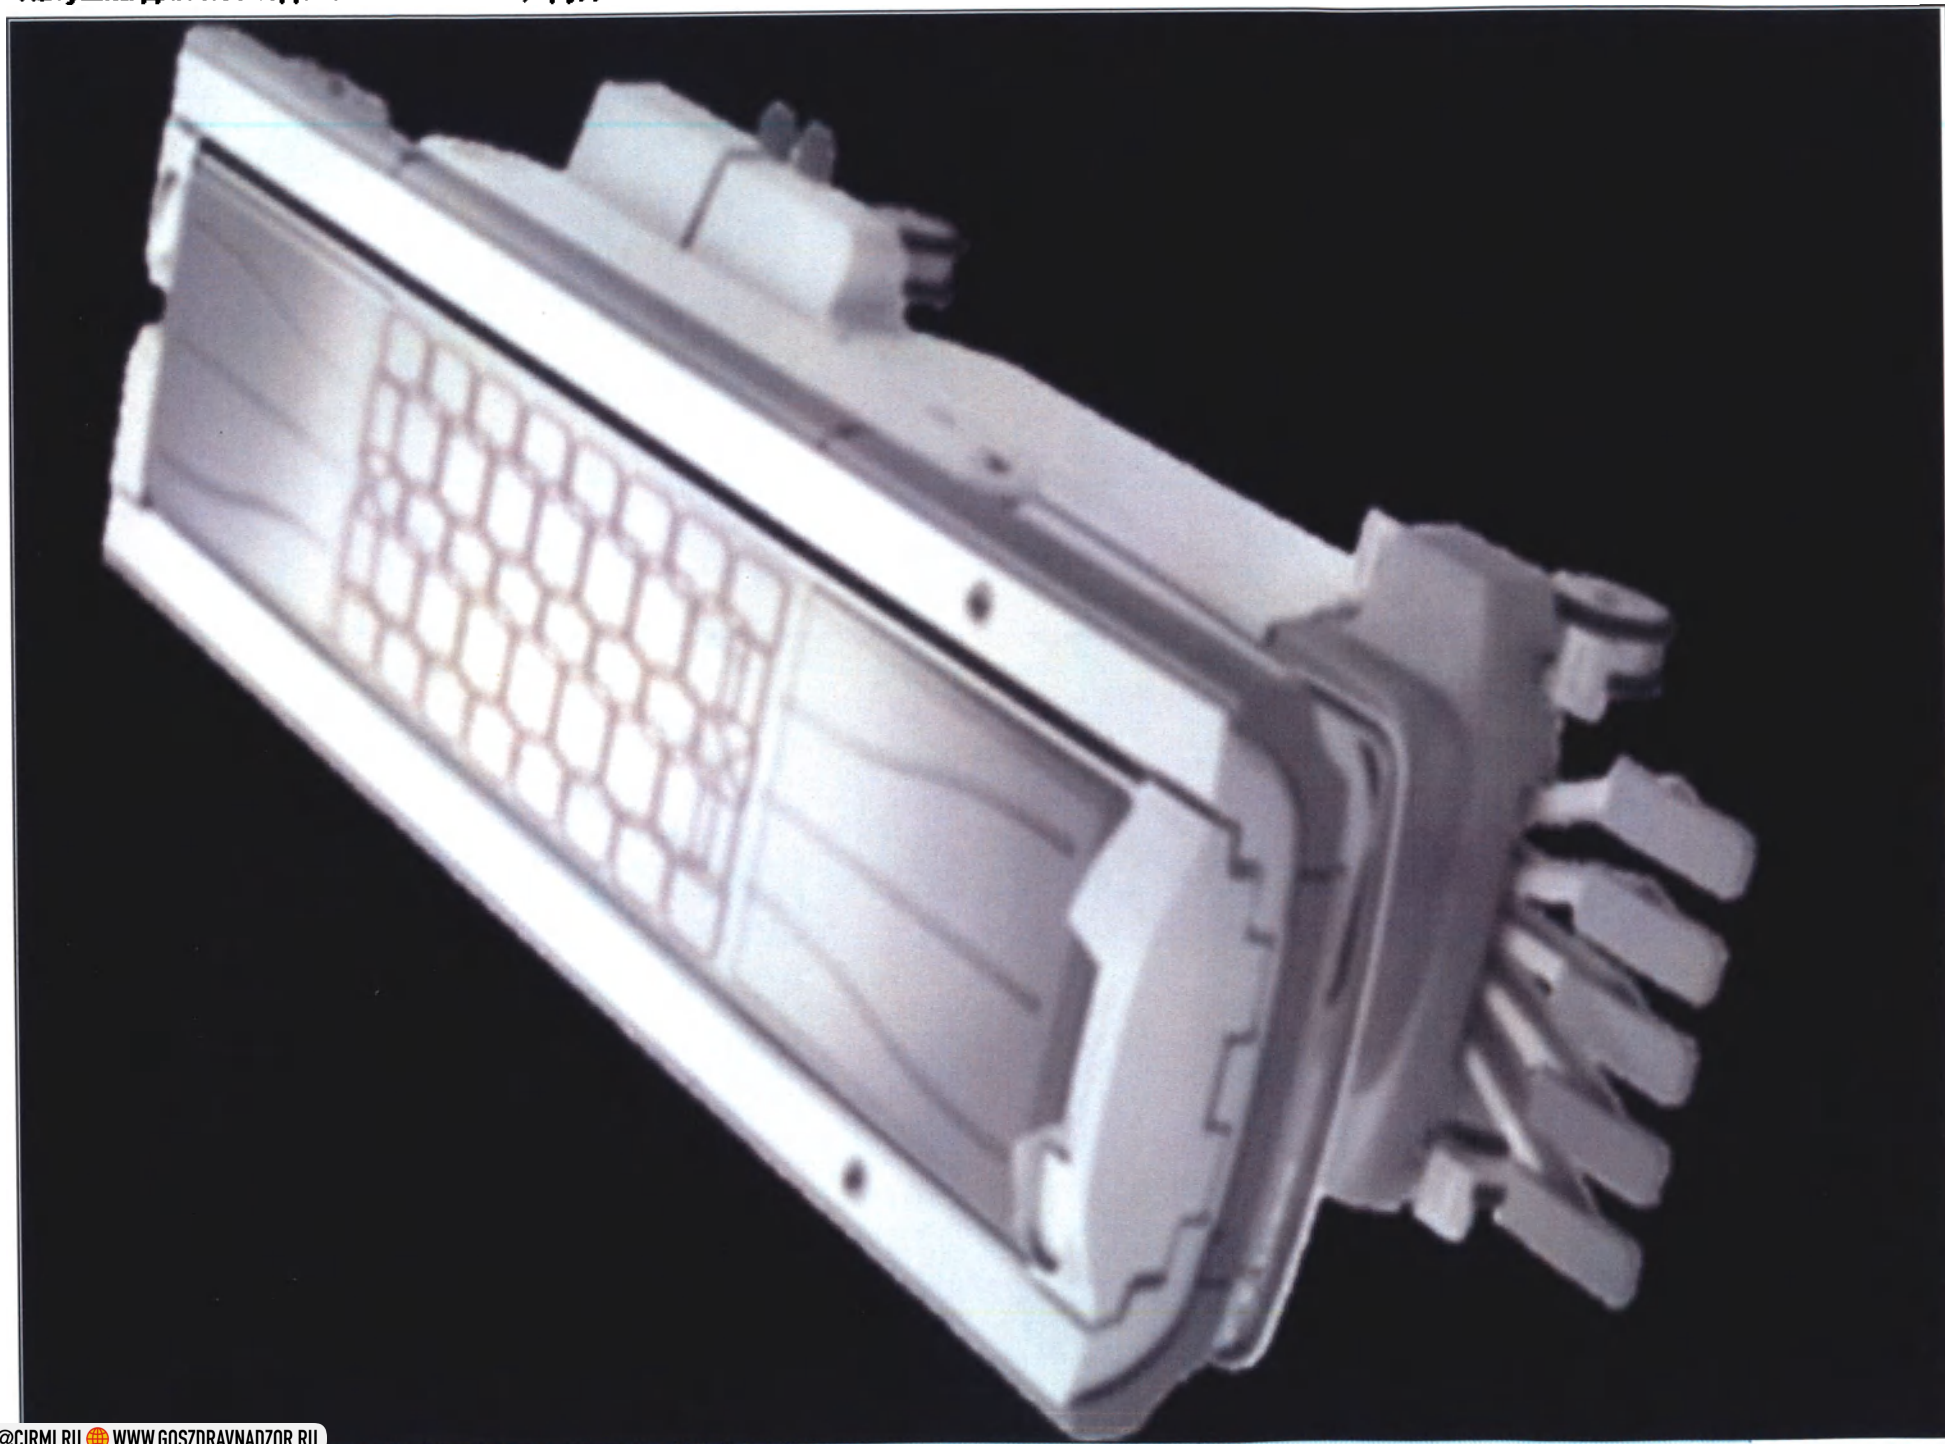









Катушки для исследования с технологией AIR (при необходимости).








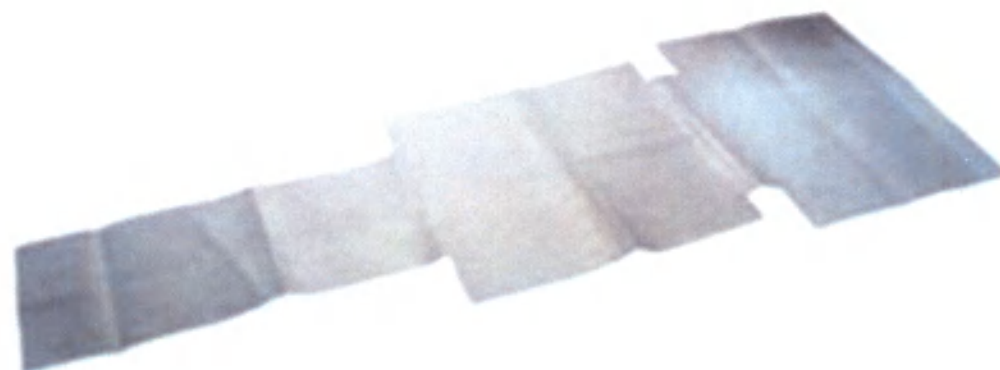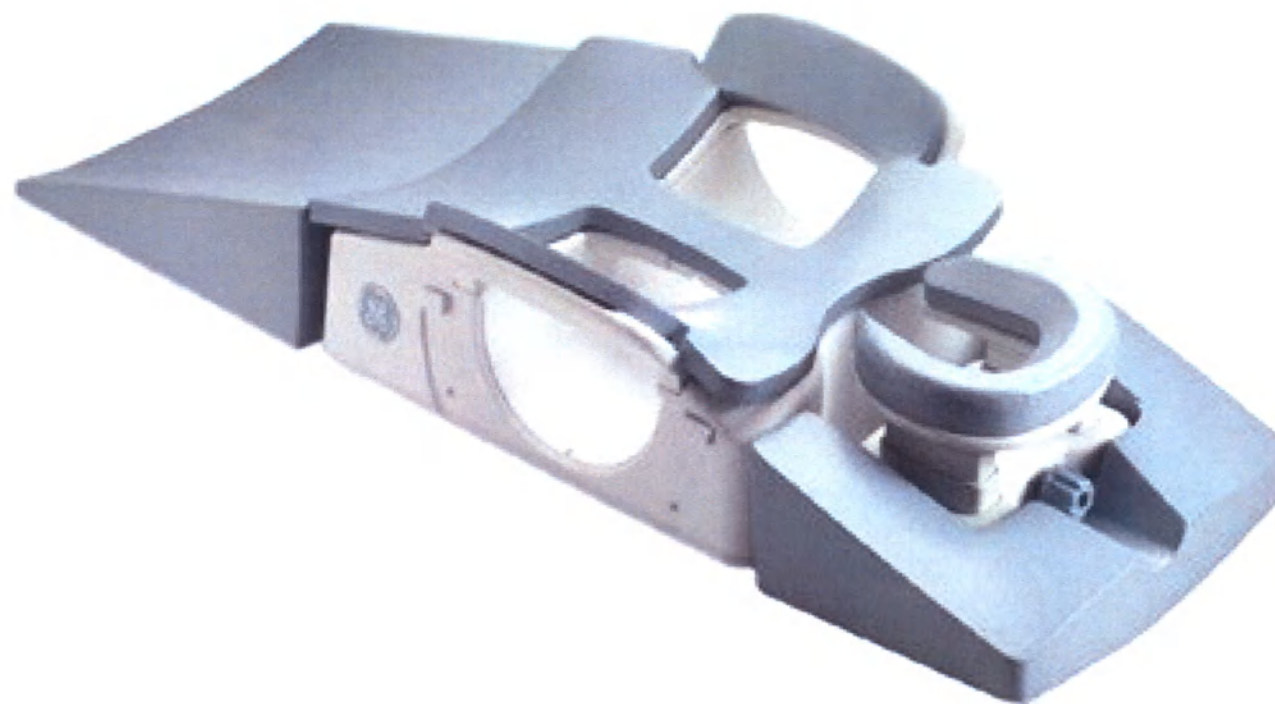





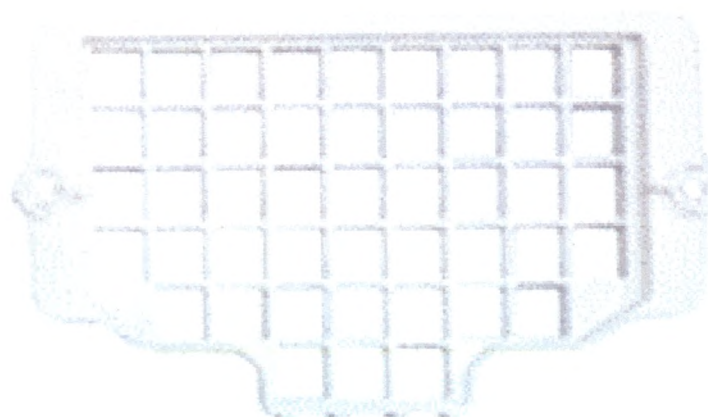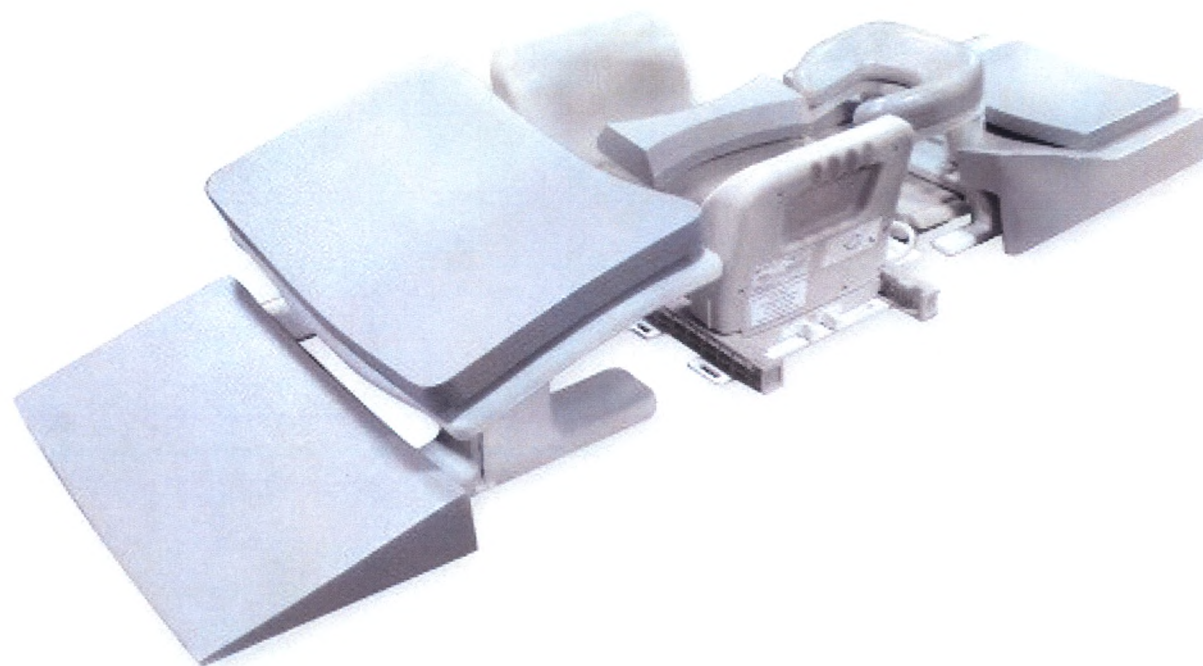

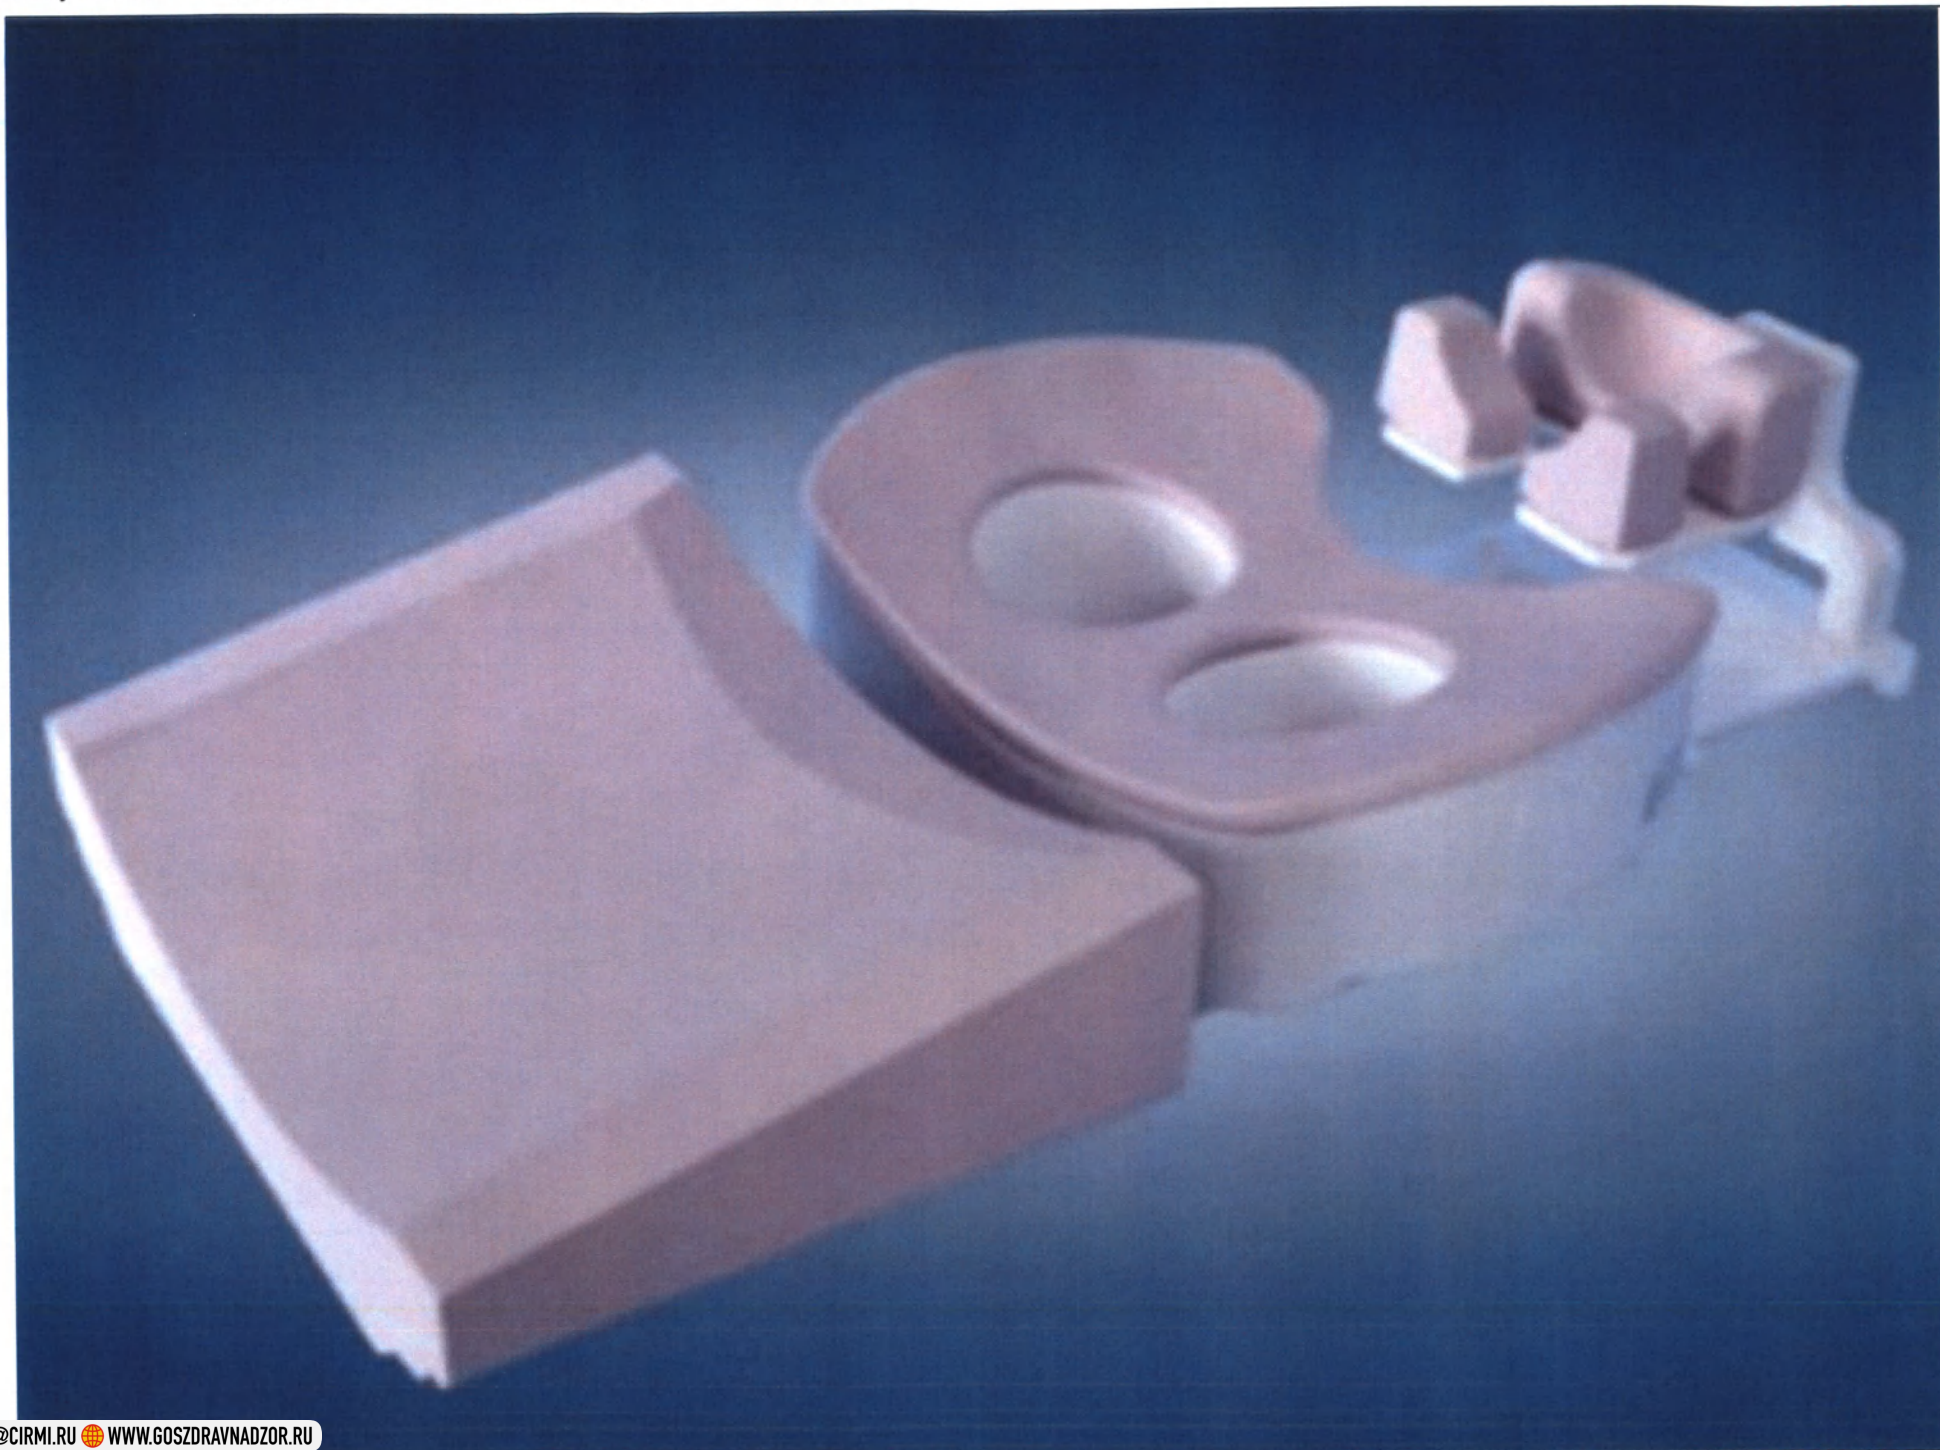







Катушка для исследования коленного сустава (при необходимости).



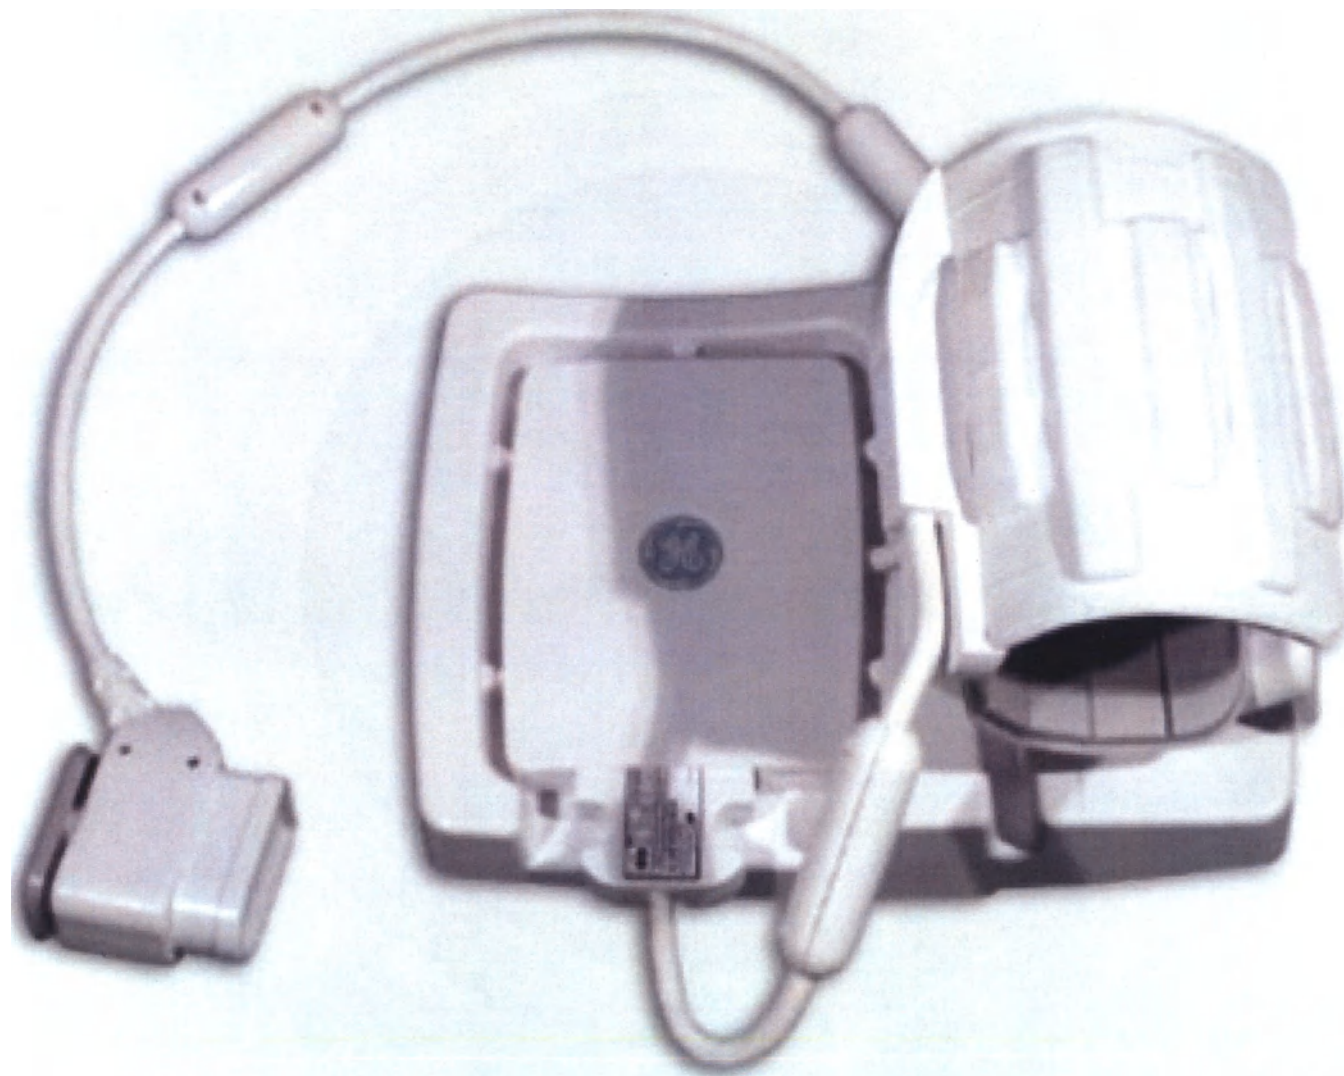

Устройство для ослабления виброакустических шумов (при необходимости).

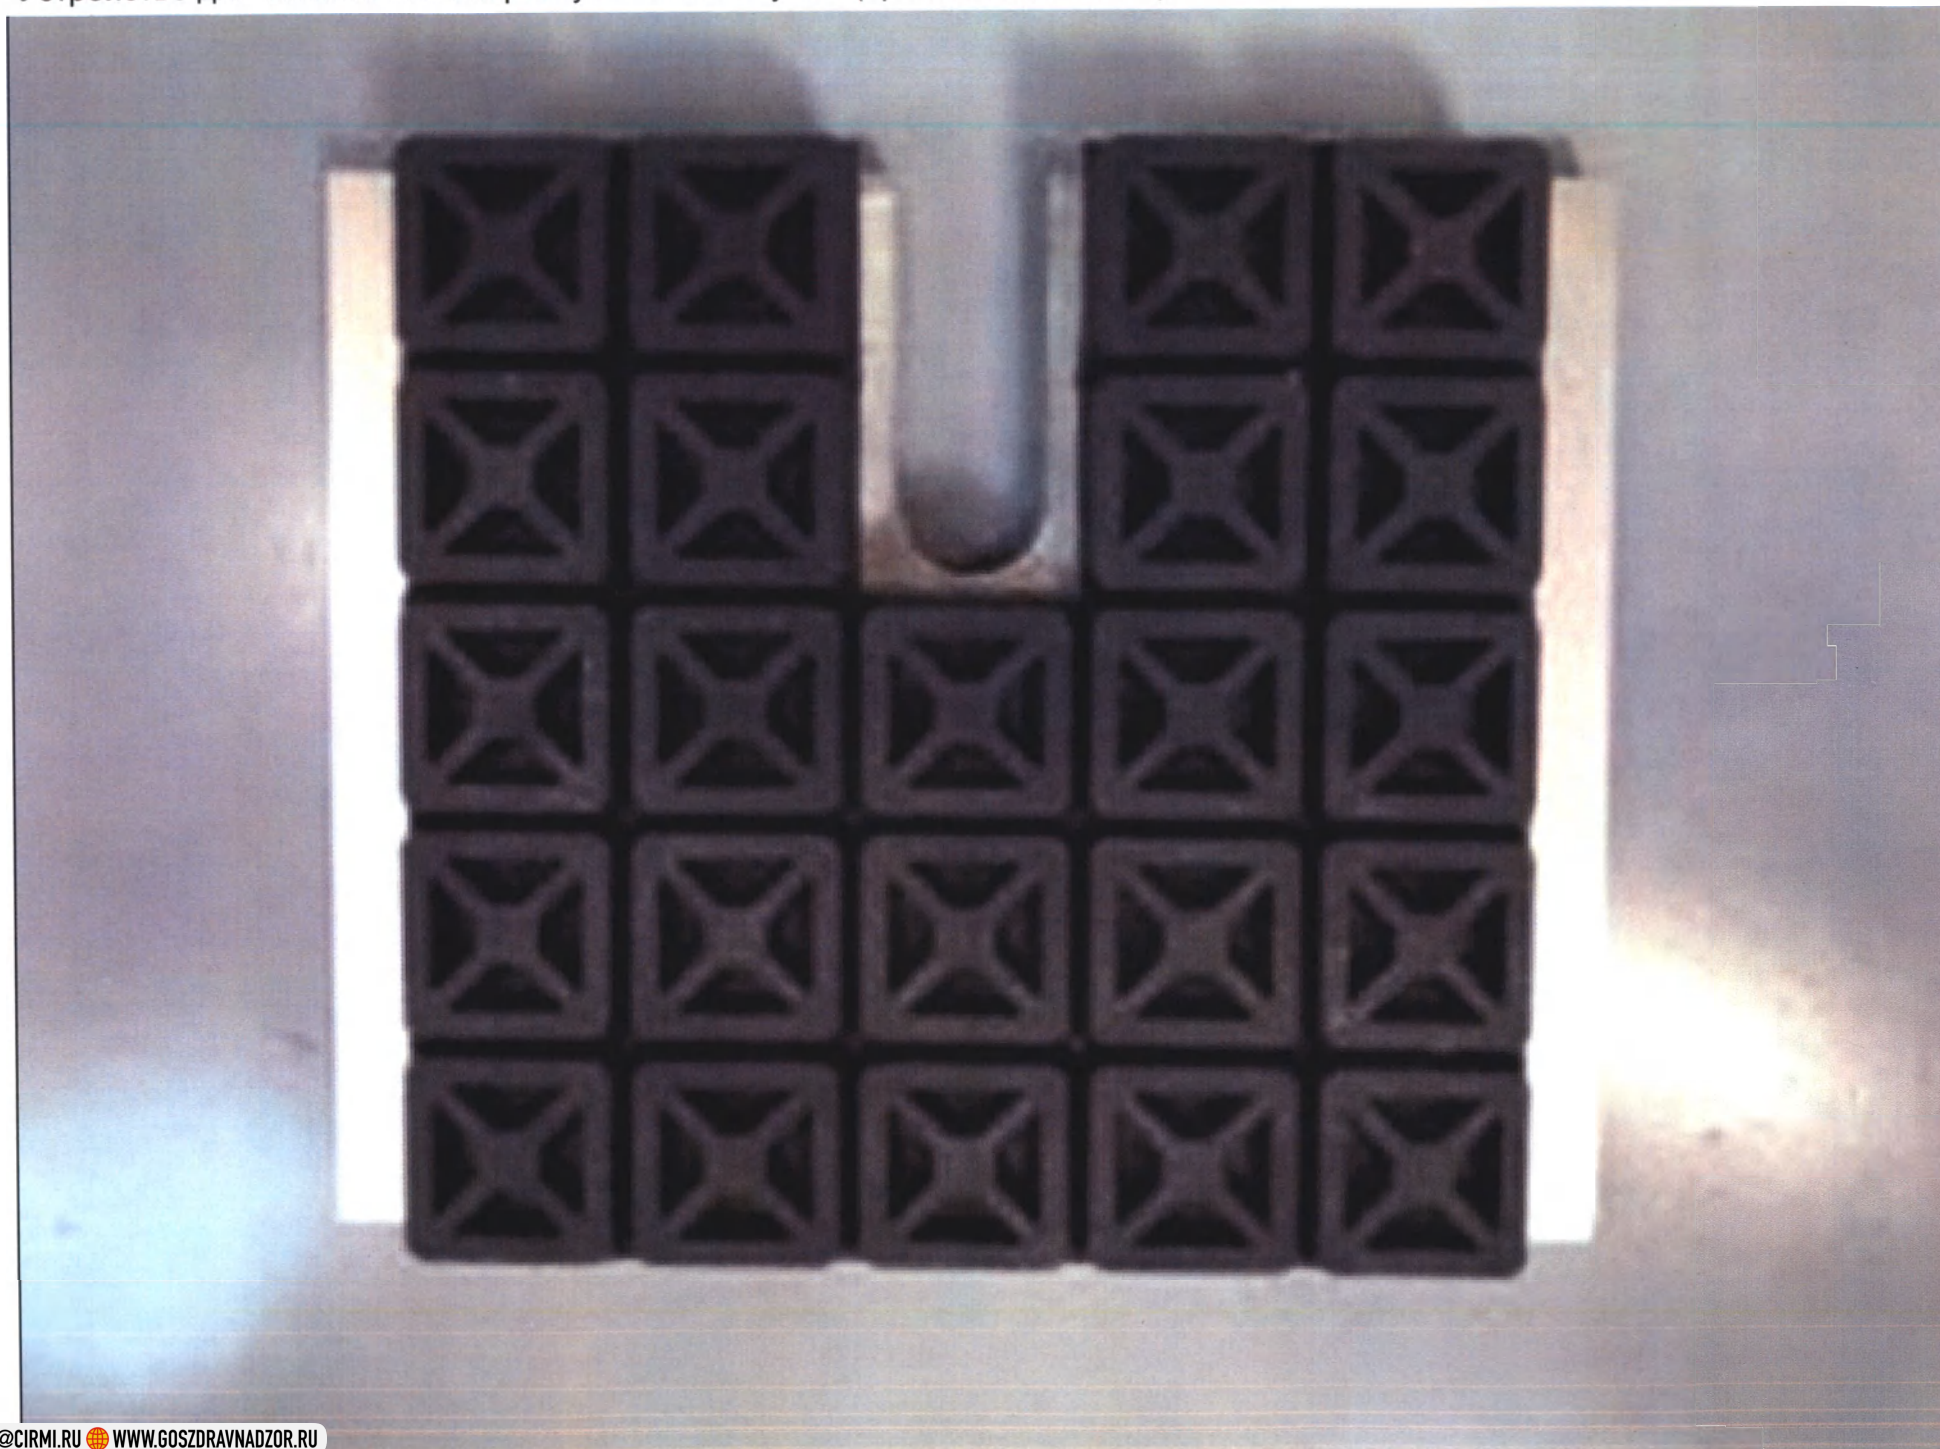

Охлаждающая жидкость (при необходимости)



SIGNA™ Architect

Руководство оператора SIGNA™ Works



SIGNA™ Architect
29.1 Руководство оператора, русский язык
5860860-1RU (2021-07) Ред. 2
© 2021 General Electric Company
Все права защищены.

Конфиденциальность и безопасность для систем МРТ


Руководство оператора




Конфиденциальность и безопасность для систем МРТ
Руководство оператора, версия 29.1, русский язык
5860821-1RU (12.2020) Ред. 1
© General Electric Company, 2020
Все права сохранены.






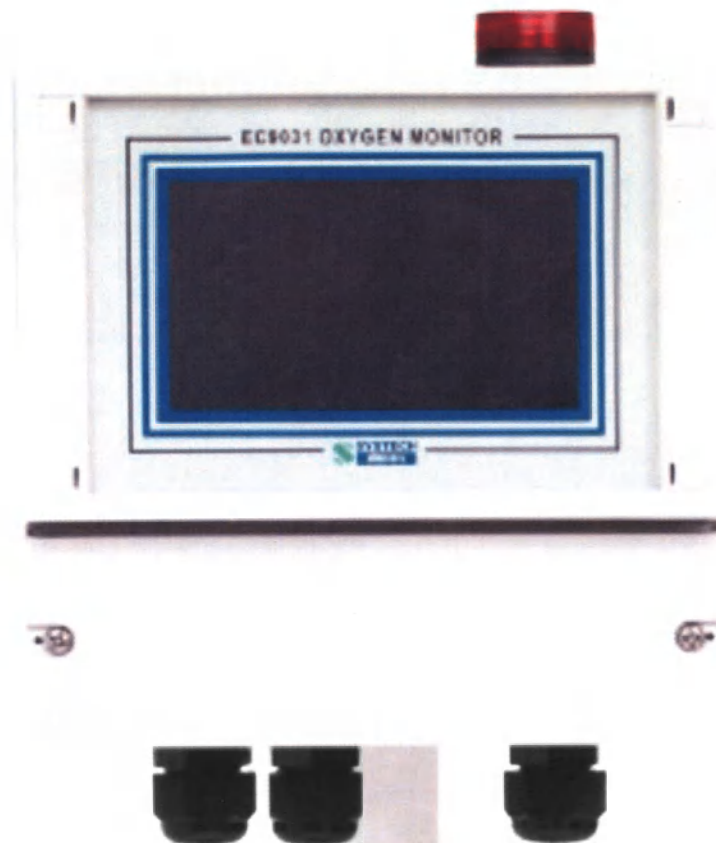

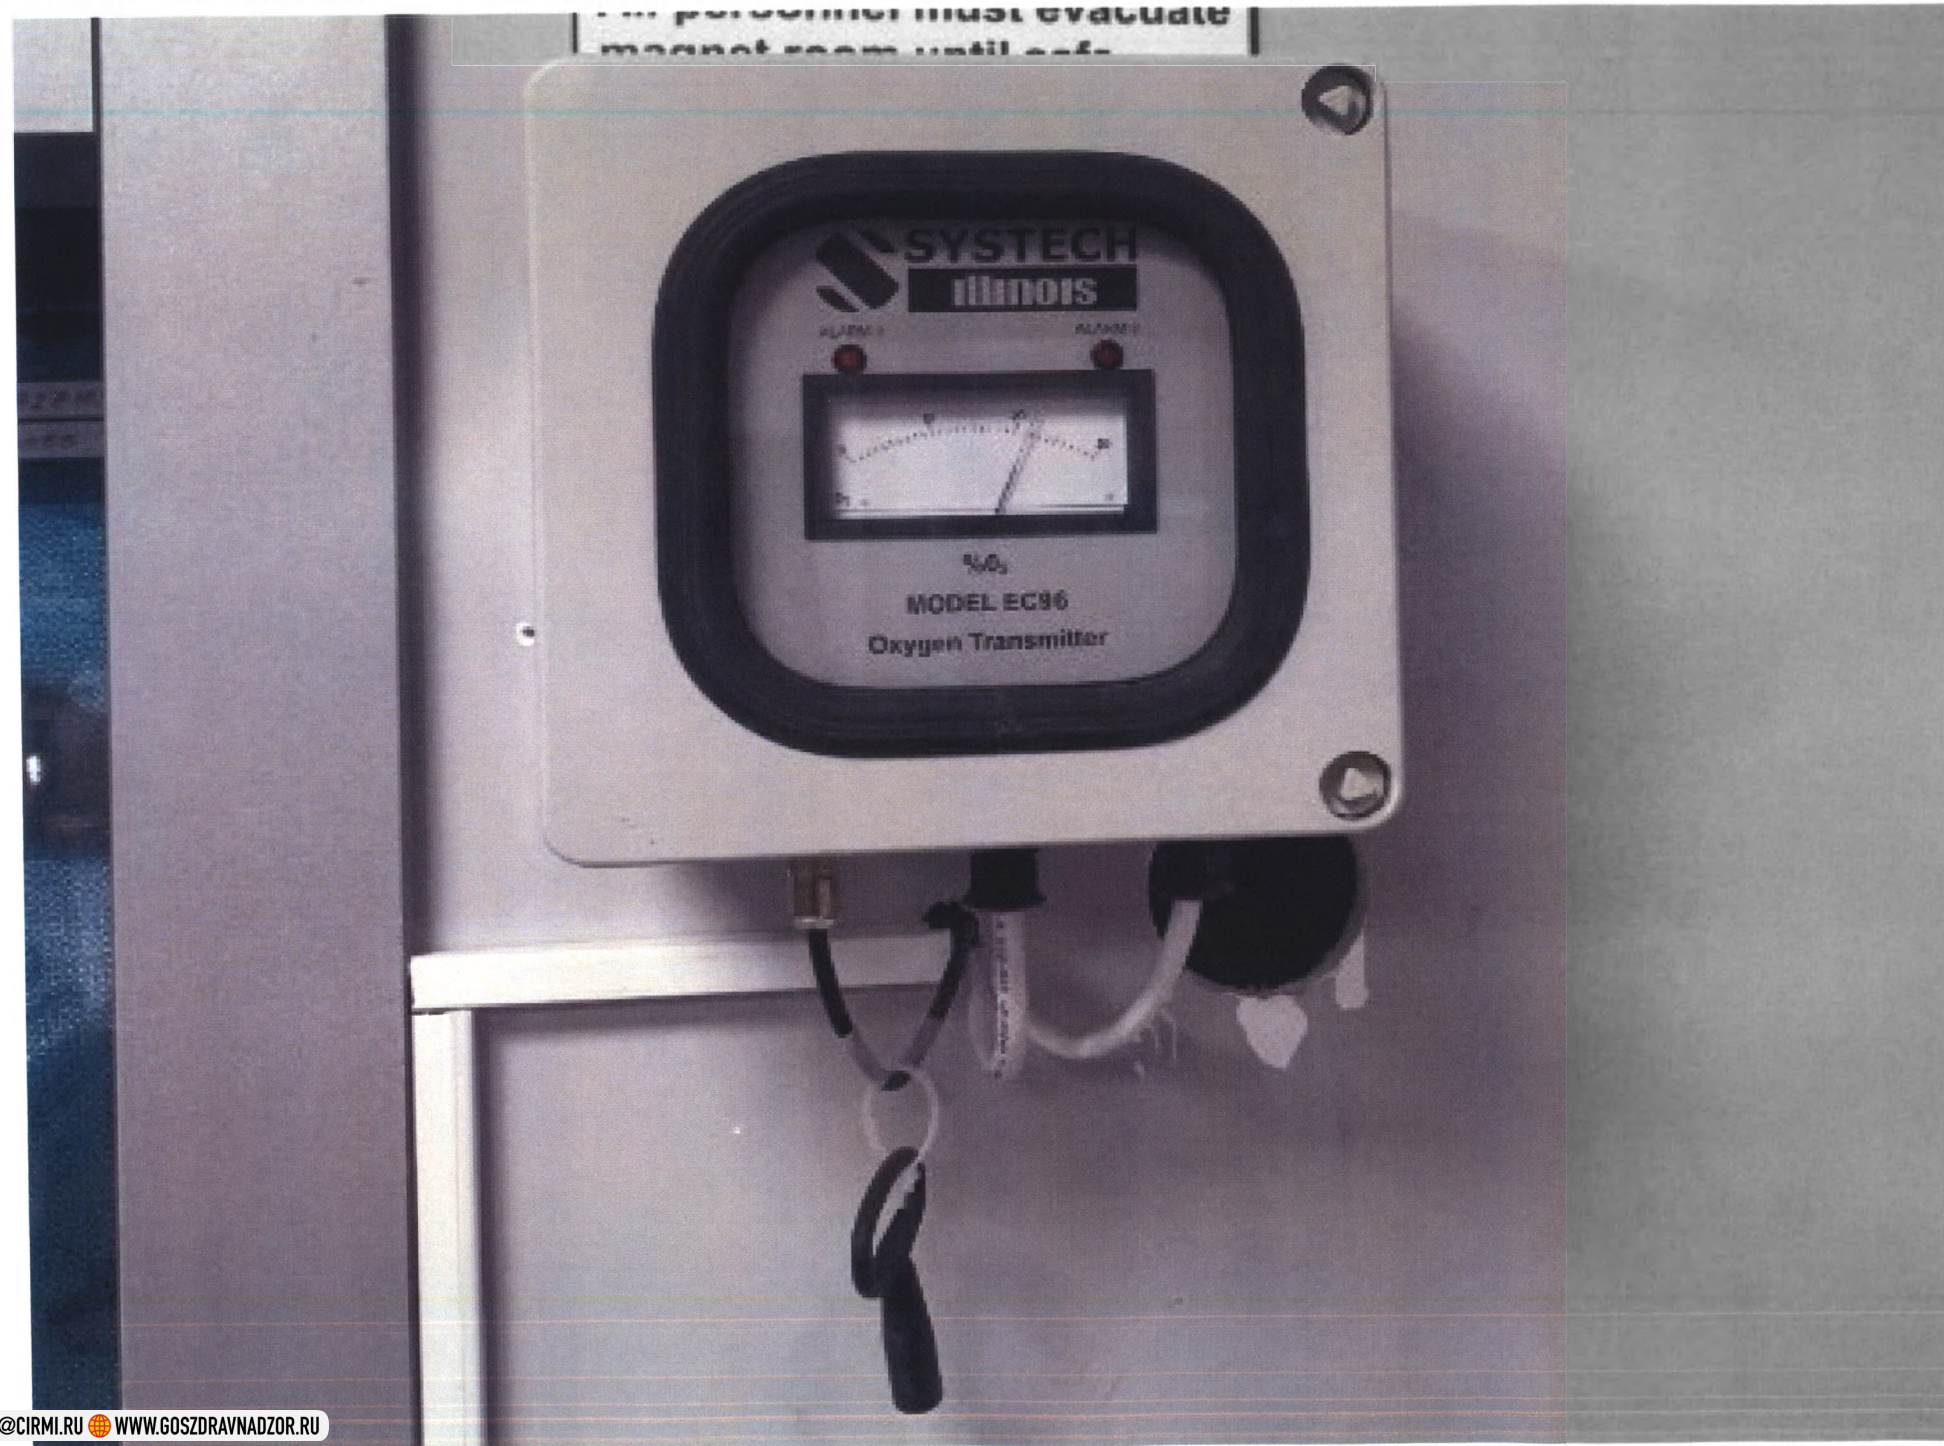

Охладитель-теплообменник основных компонентов МРТ (при необходимости).

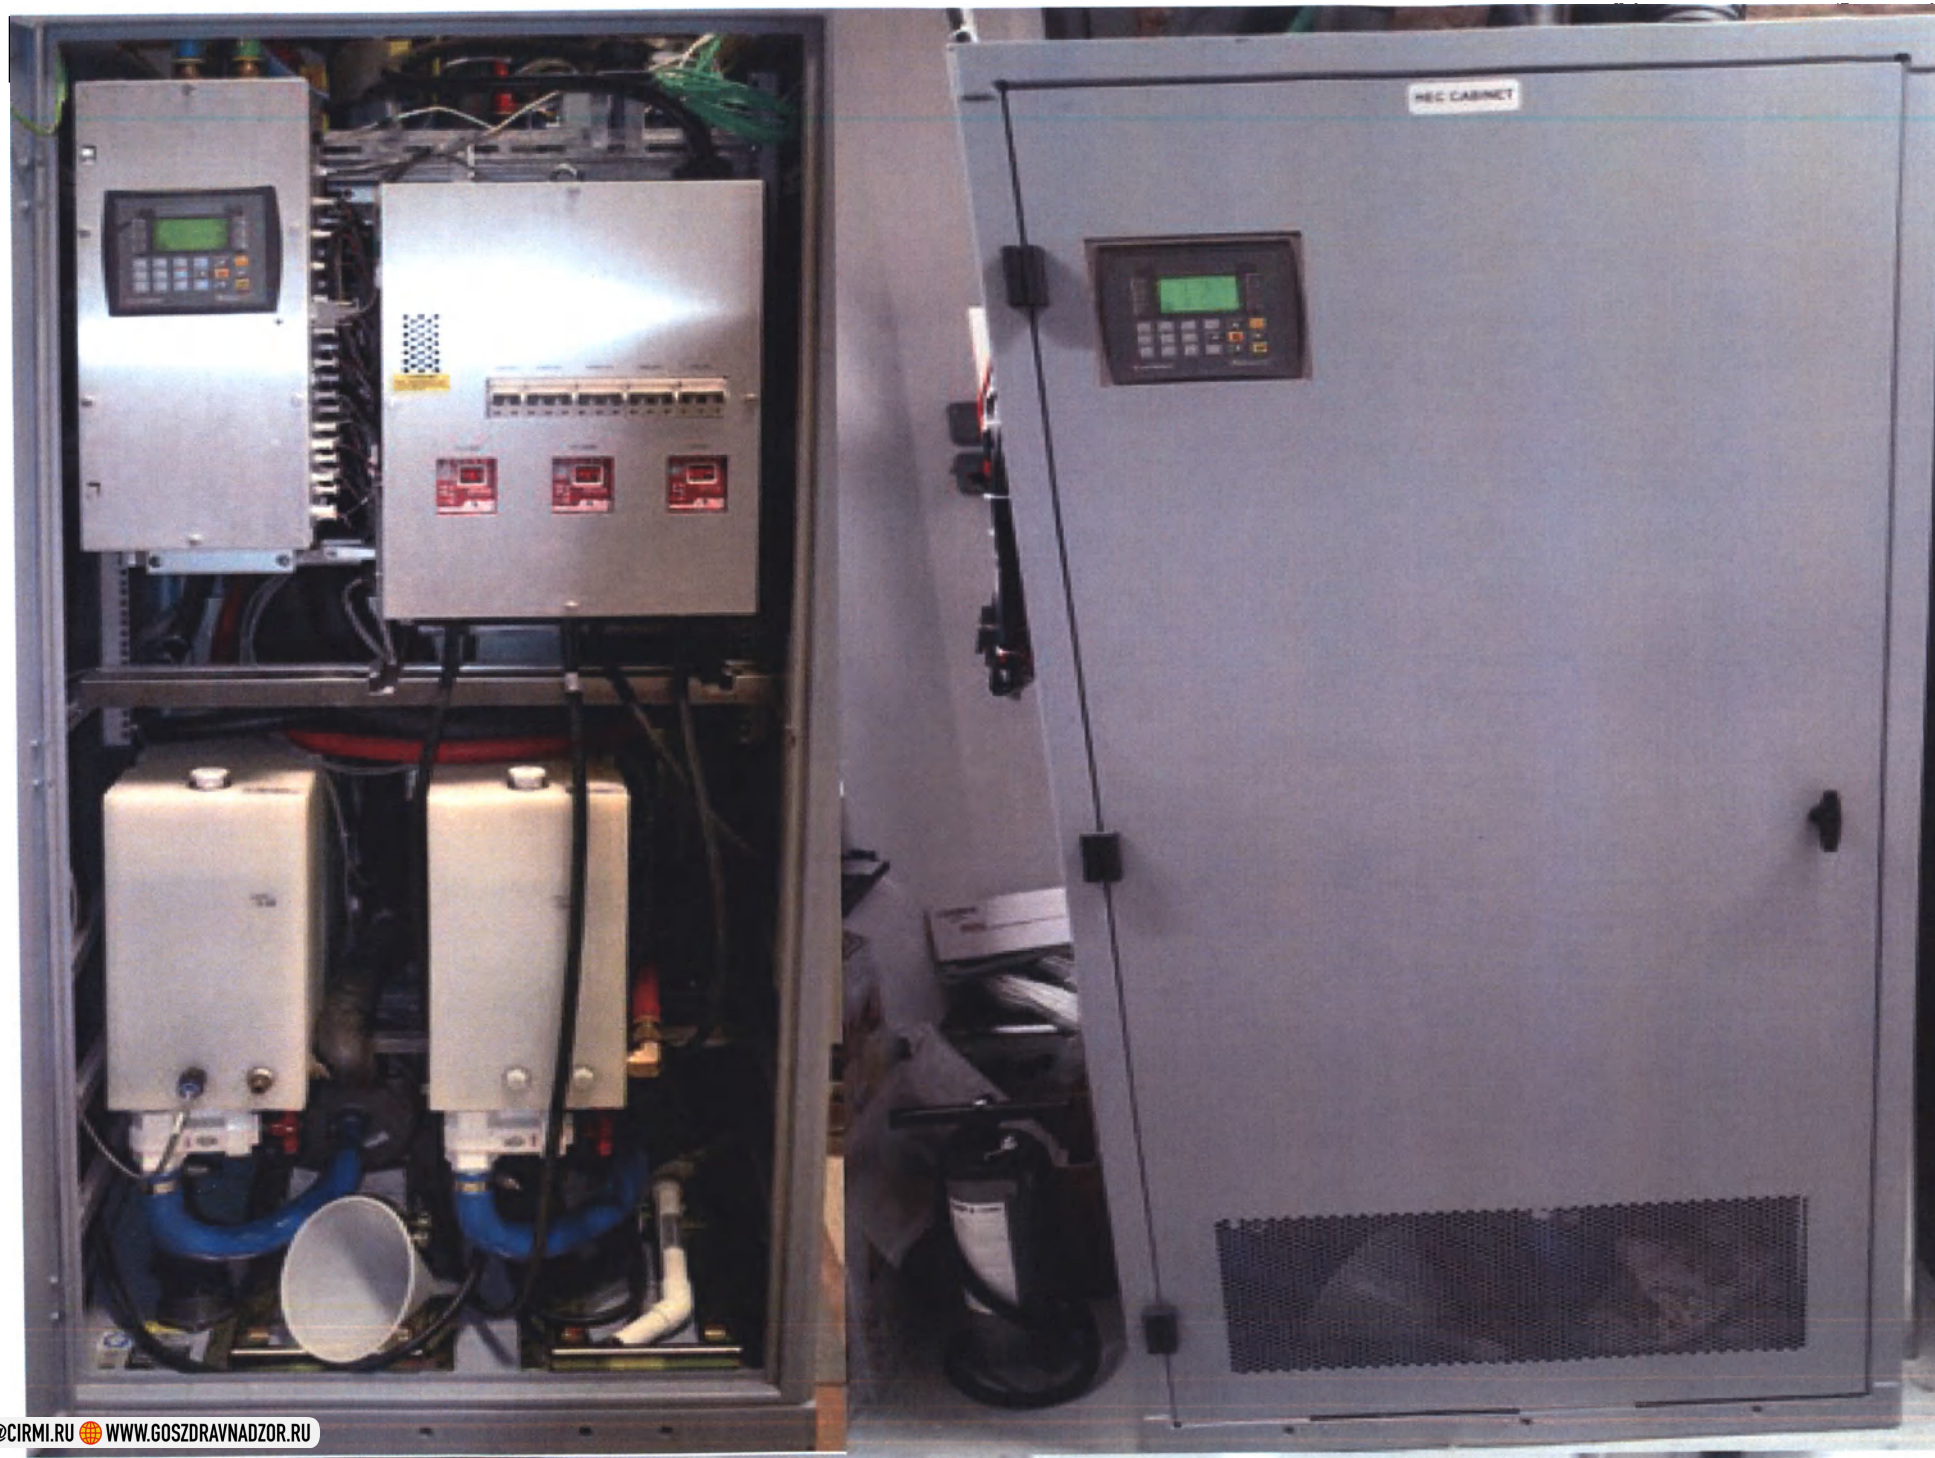



Охладитель-теплообменник основных компонентов МРТ (при необходимости).



Панель РЧ фильтров (при необходимости)



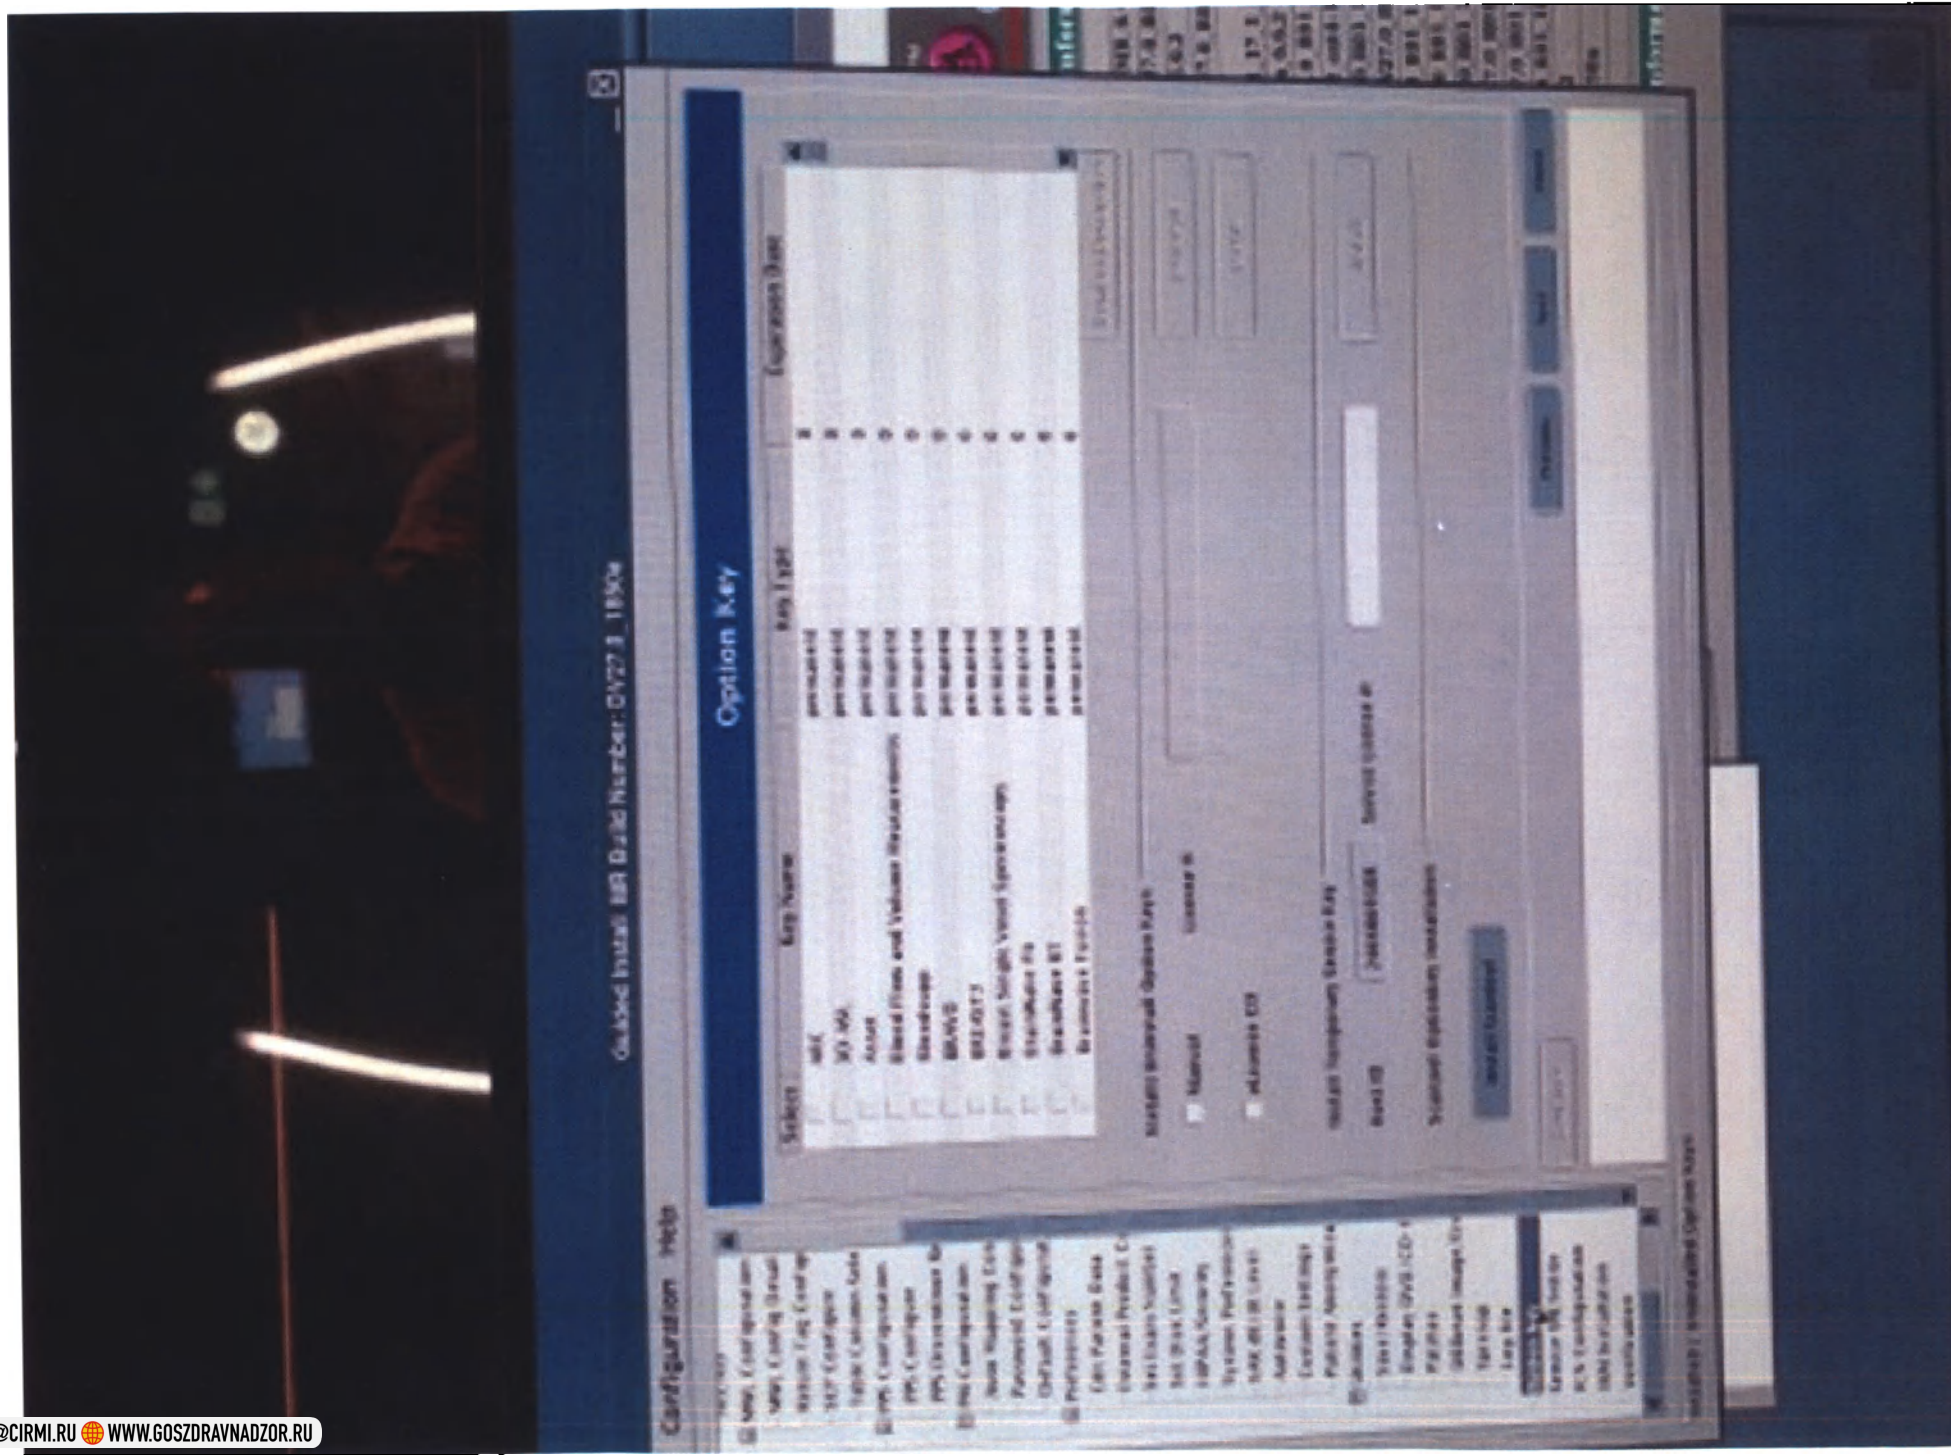

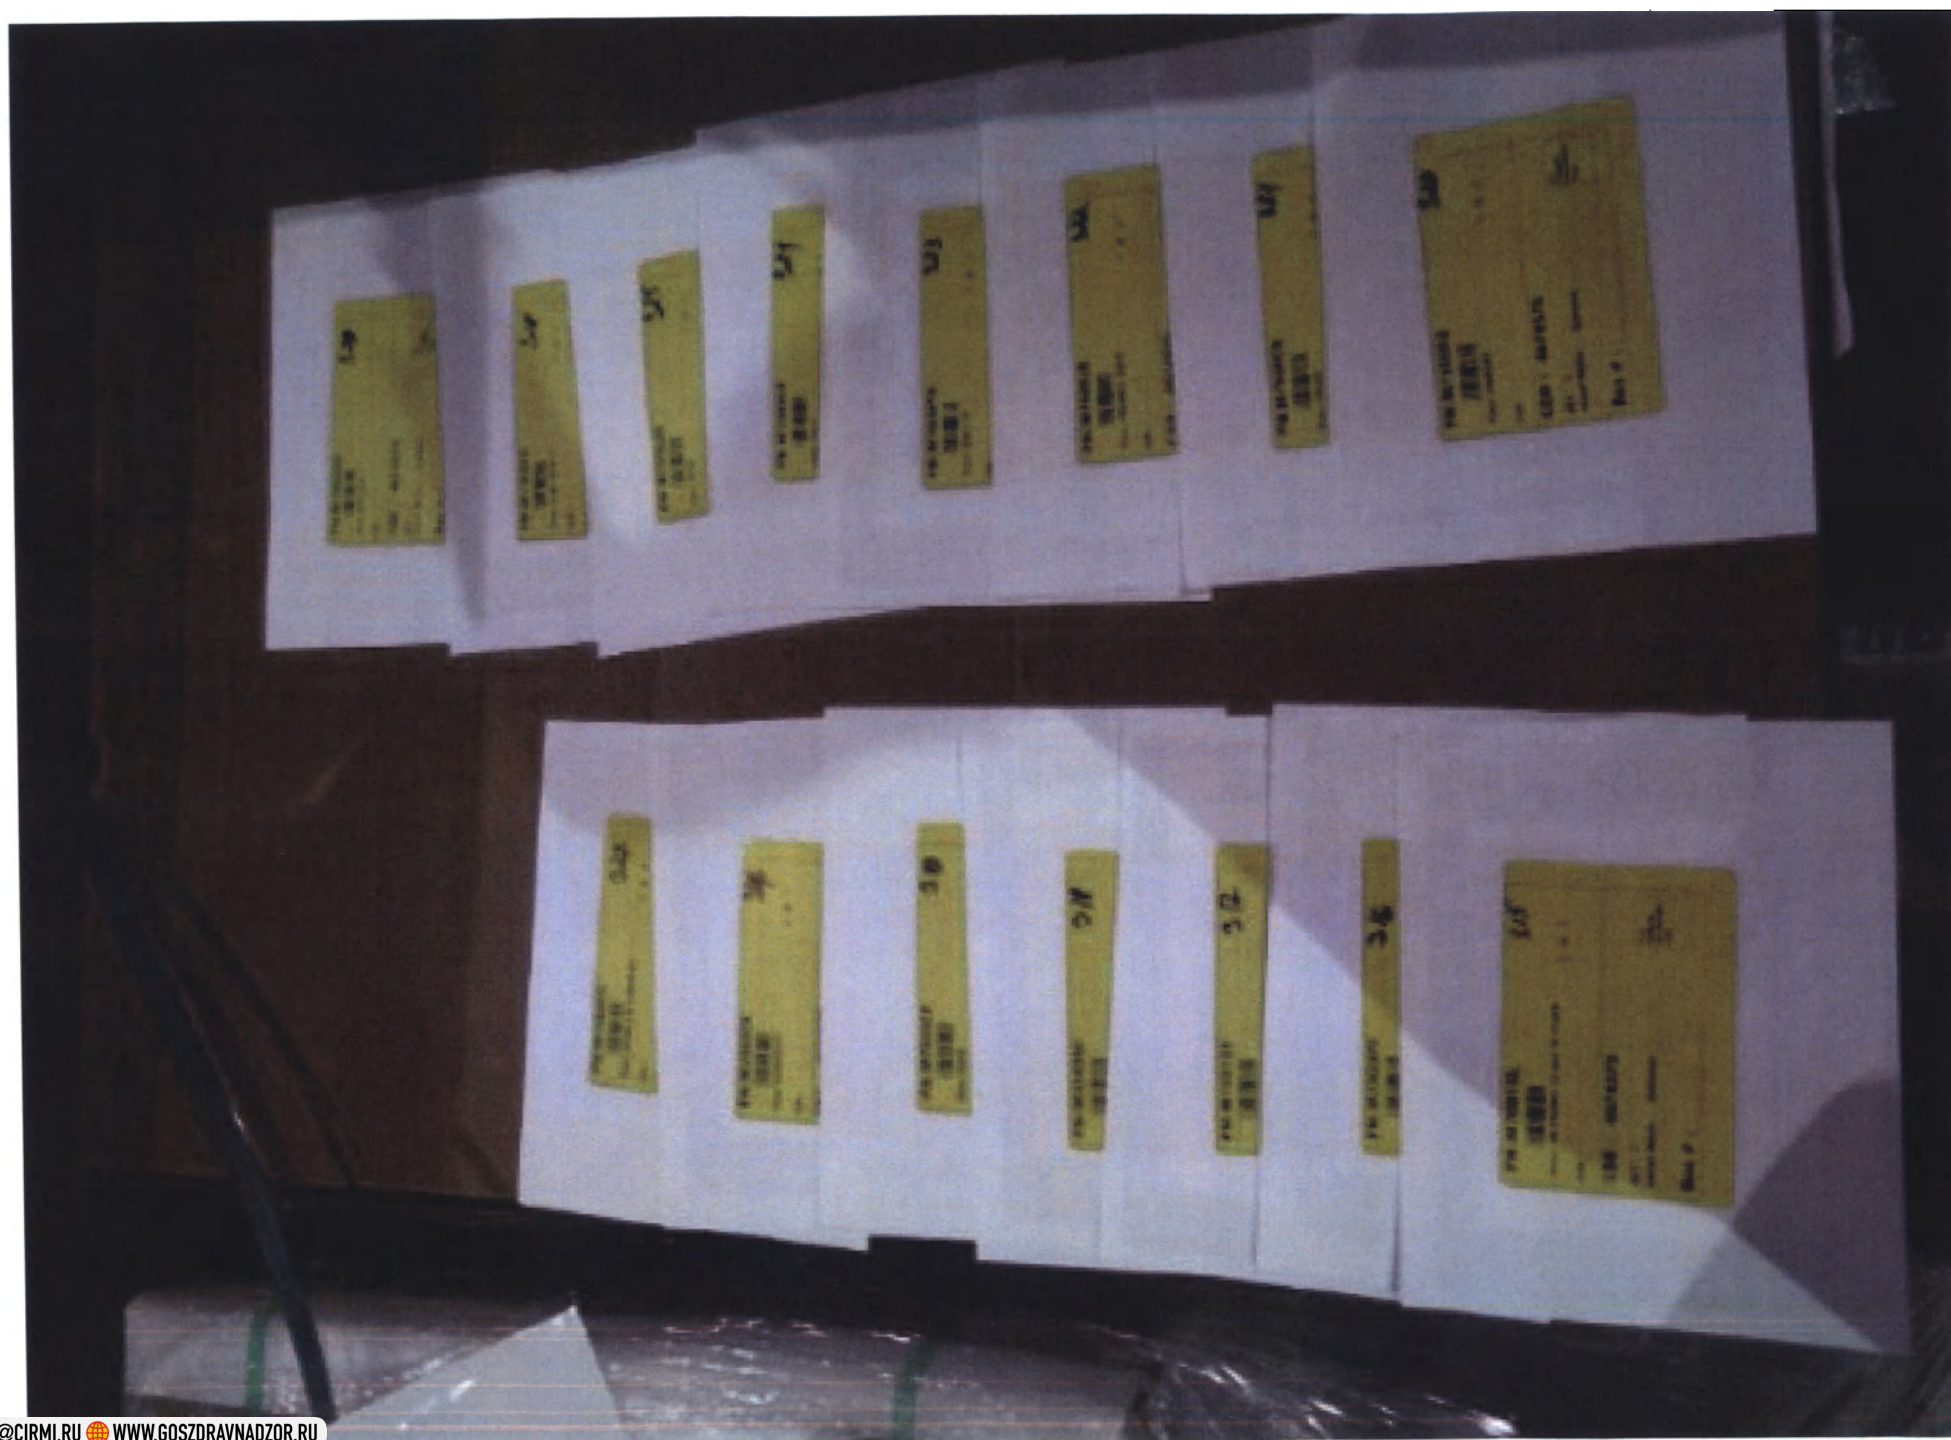






Рабочие станции для обработки данных Advantage WorkStation (при необходимости).




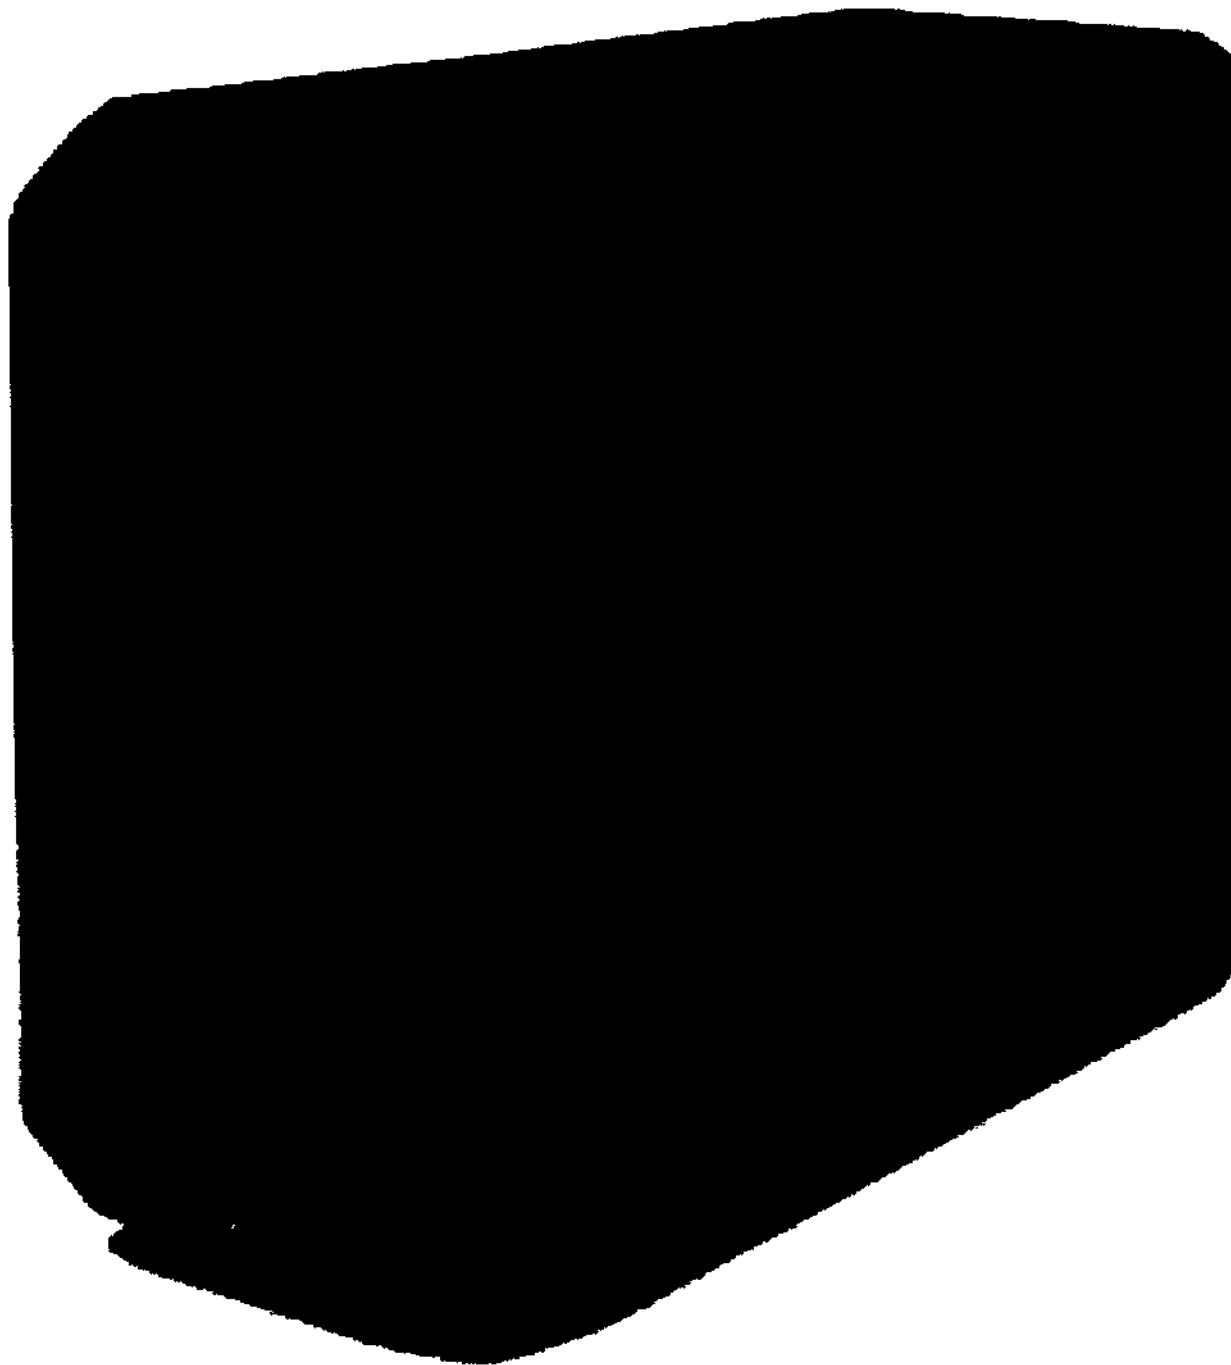





Силовой распределительный щит питания специальный (при необходимости).

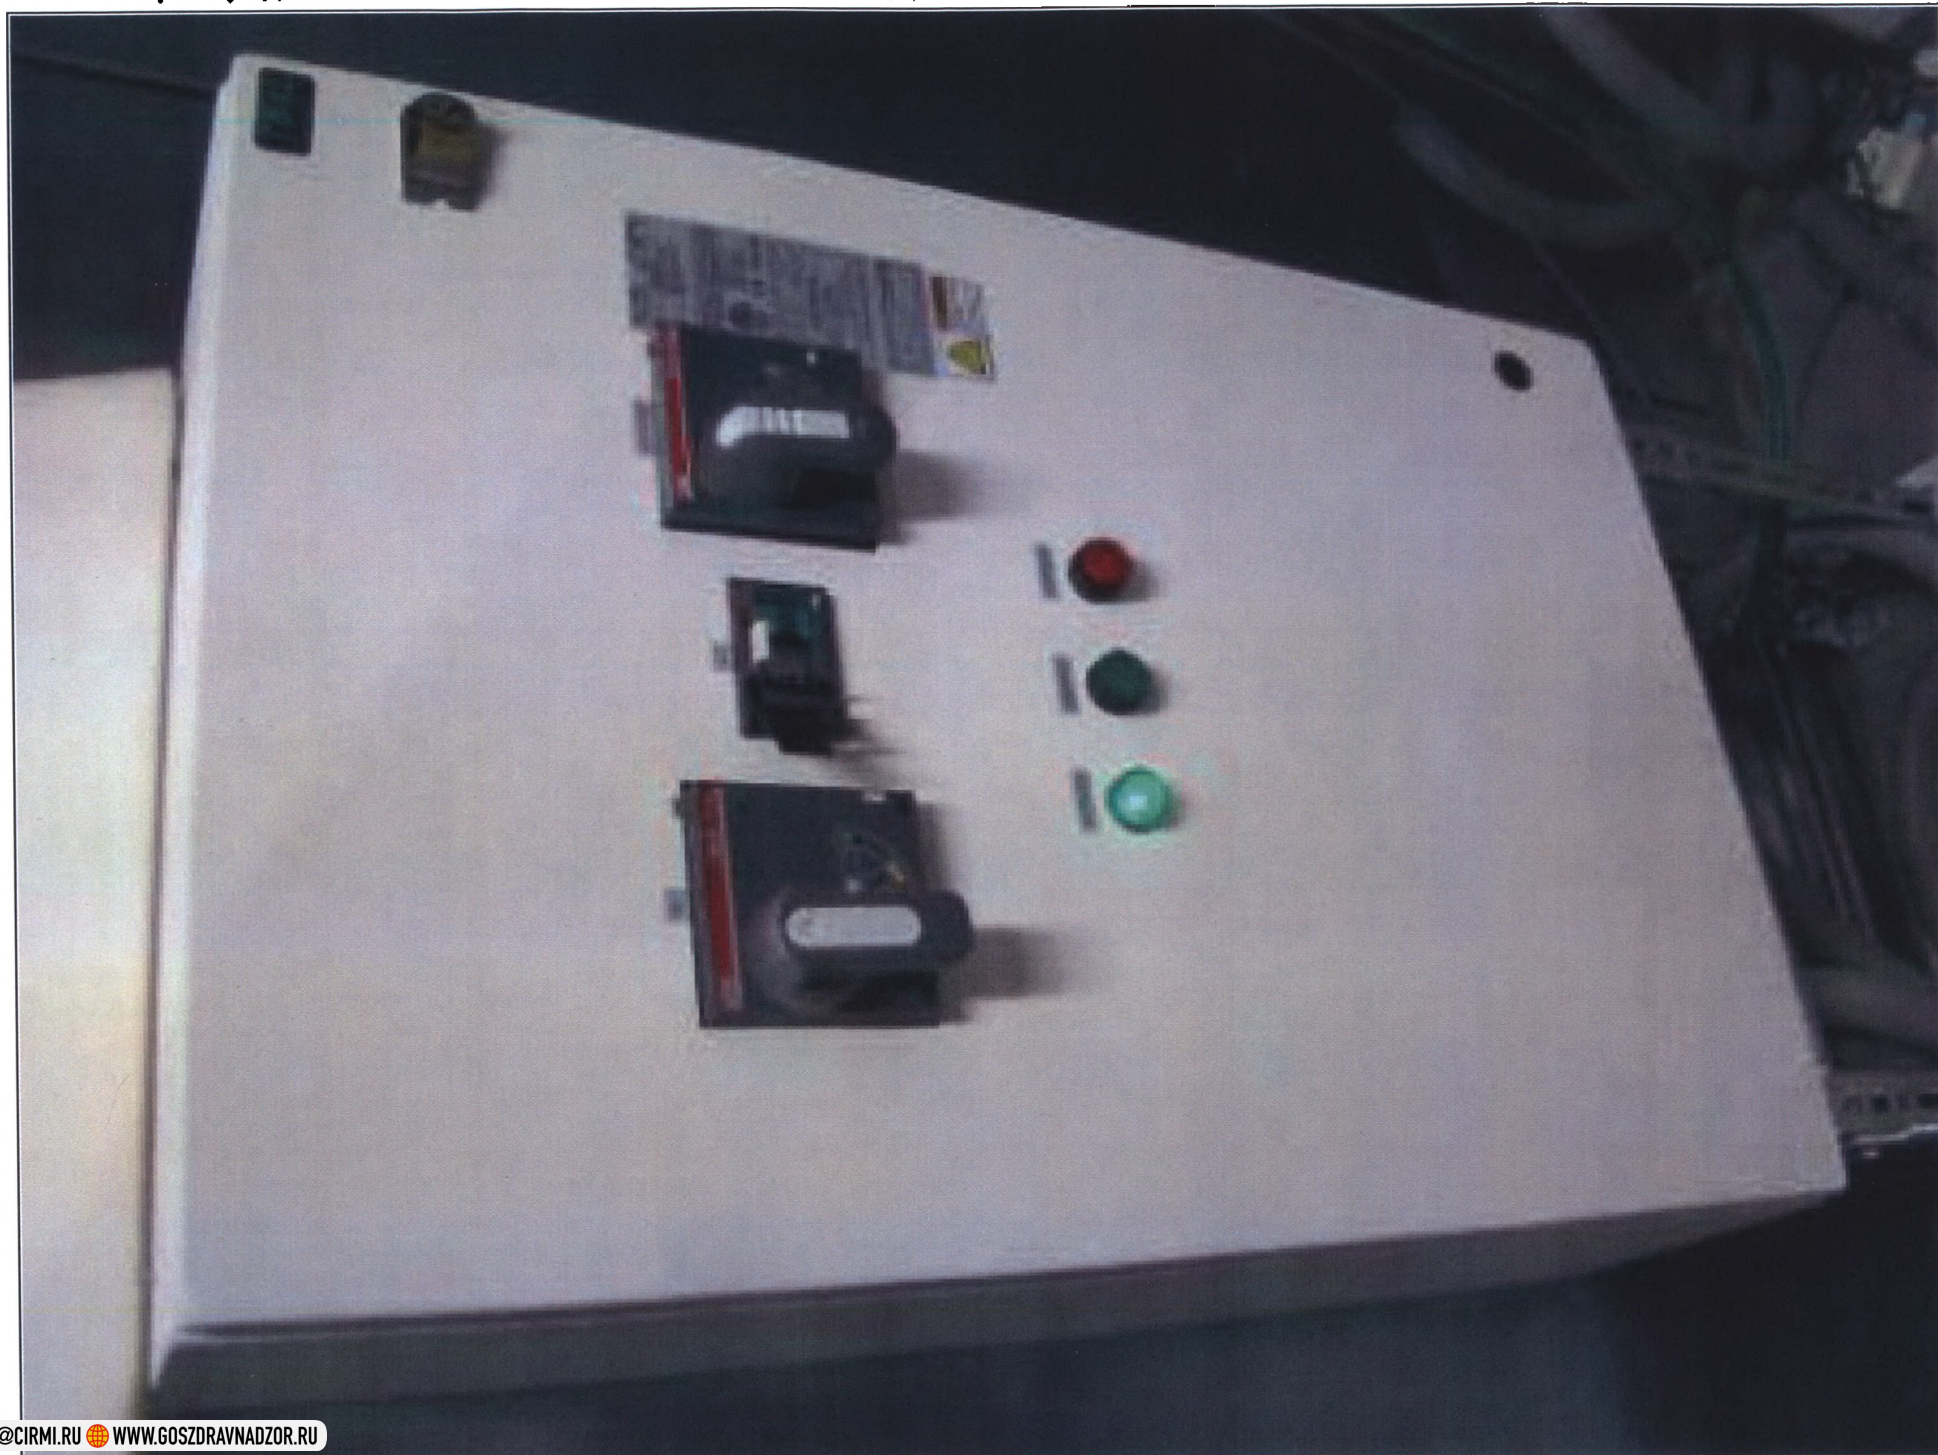




Стол пациента (при необходимости).



Столы пациента (при необходимости).




Блок охлаждения (при необходимости).

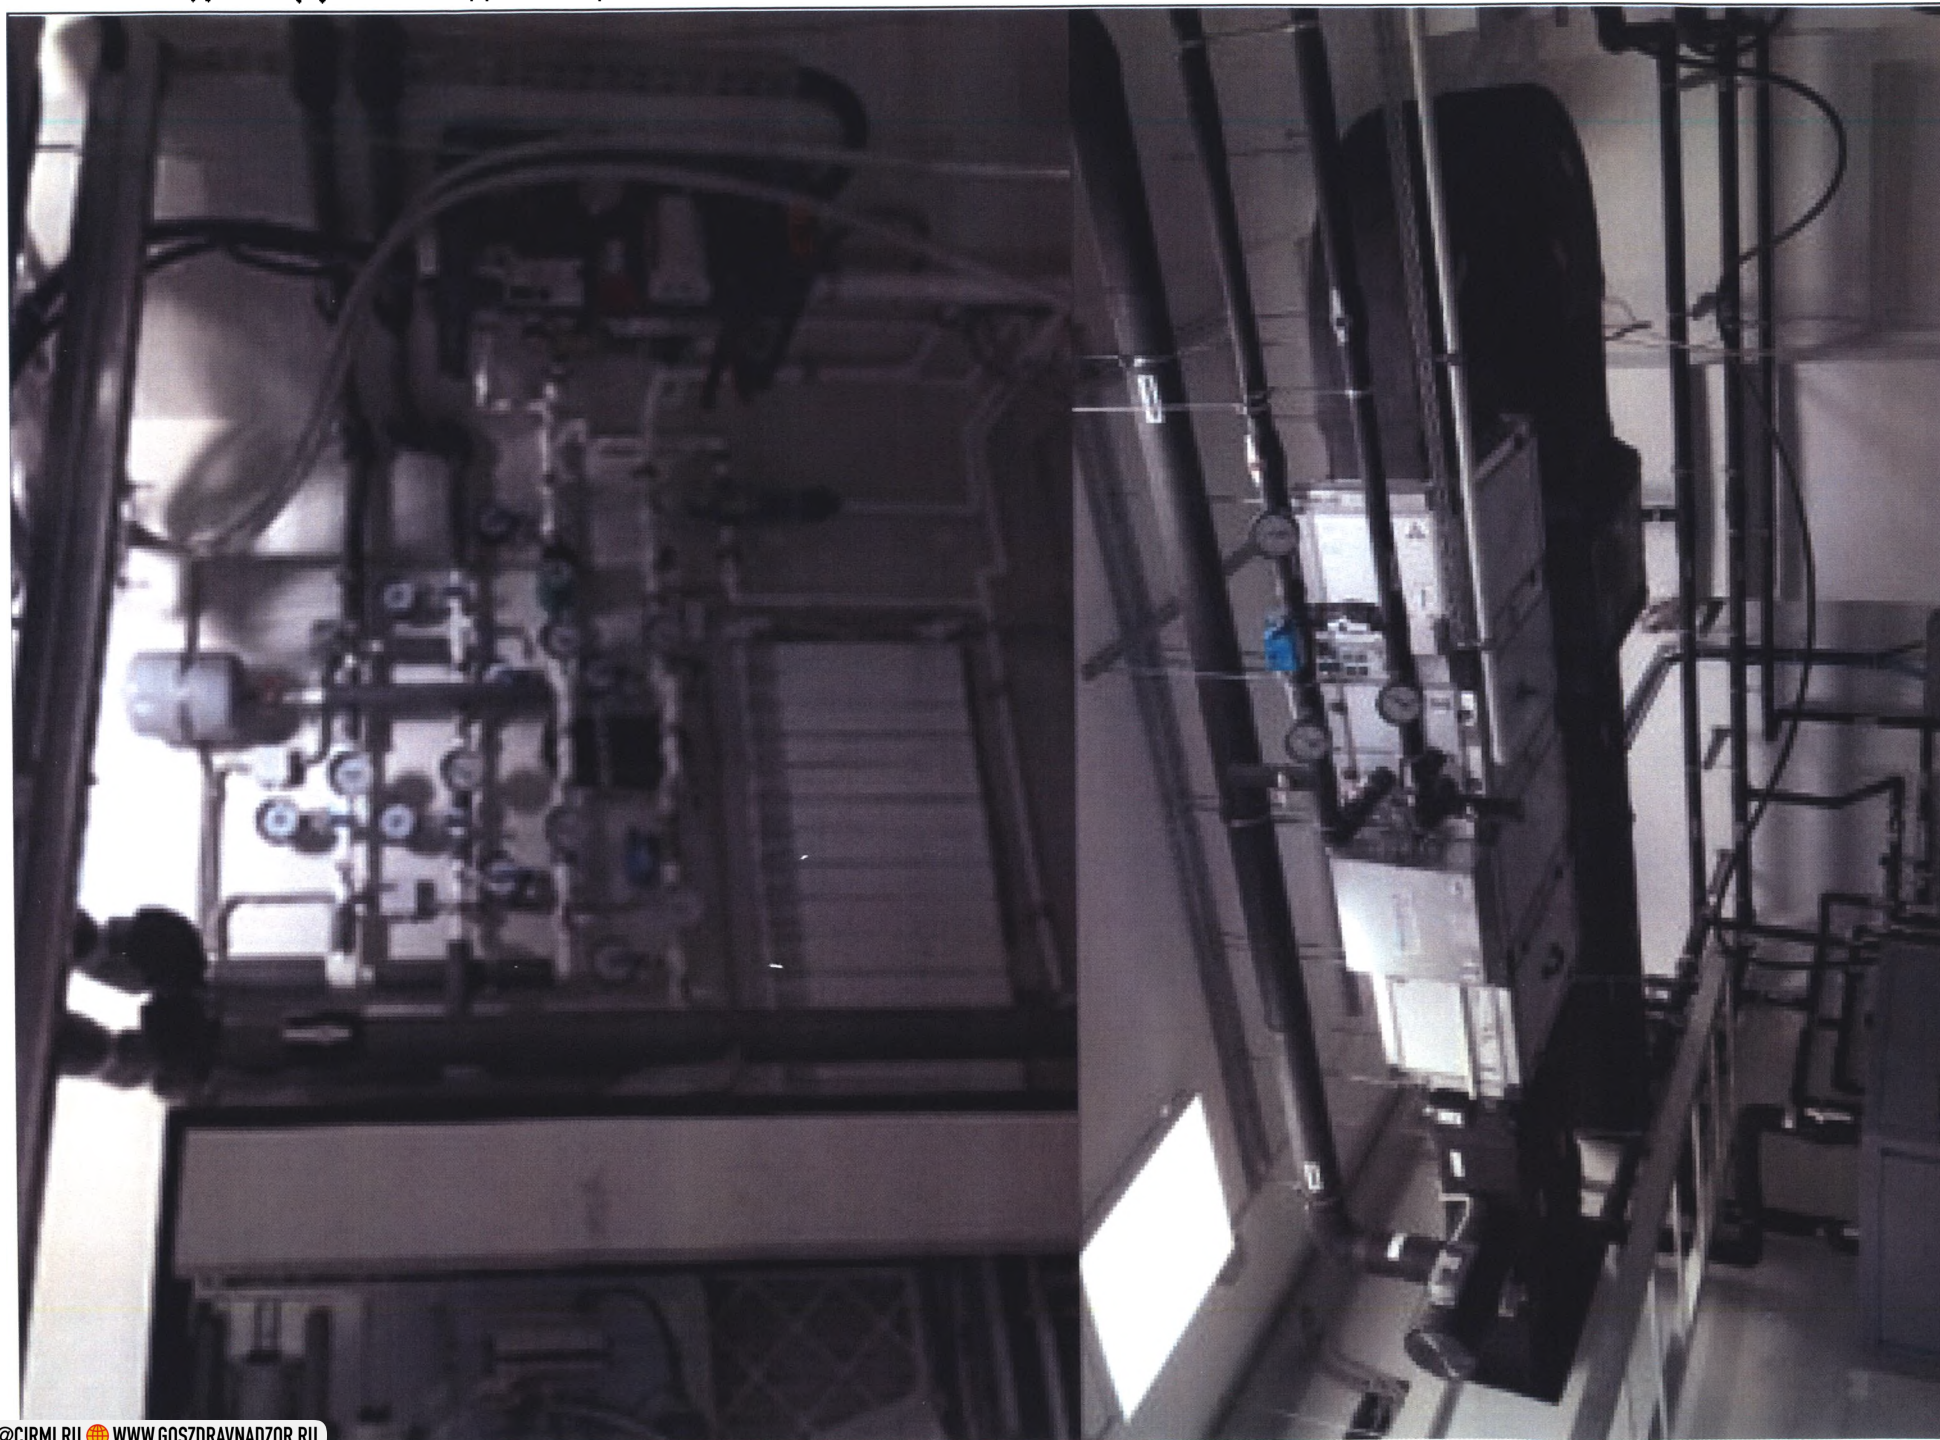

Блок охлаждения (при необходимости).



Блок охлаждения (при необходимости).

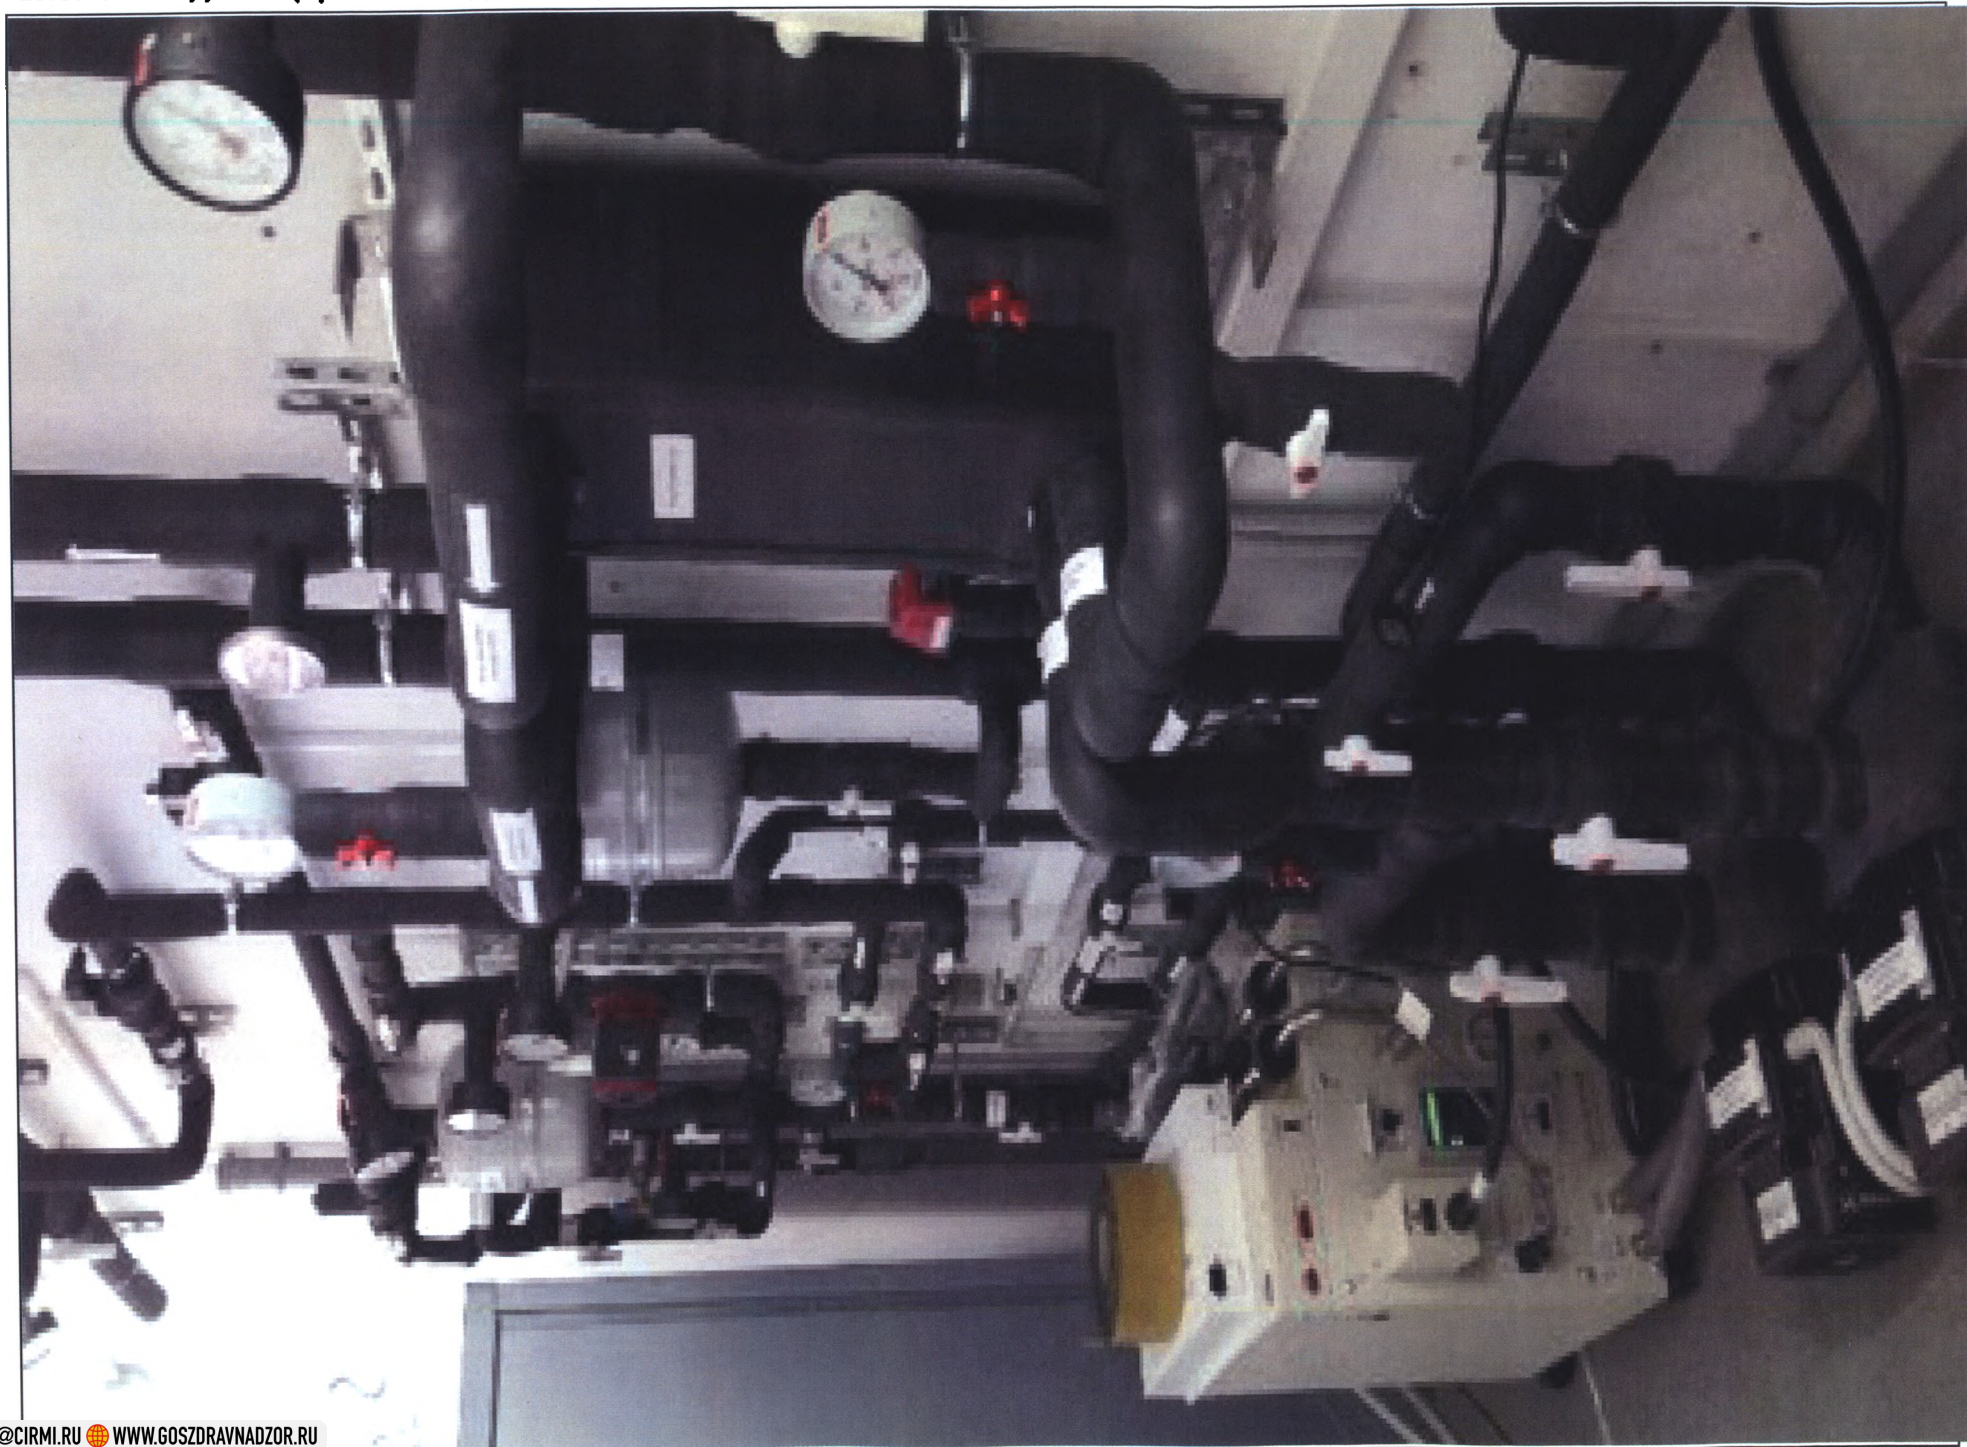

Блок охлаждения (при необходимости).



Блок охлаждения (при необходимости).



Блок охлаждения (при необходимости).



Блок охлаждения (при необходимости).


















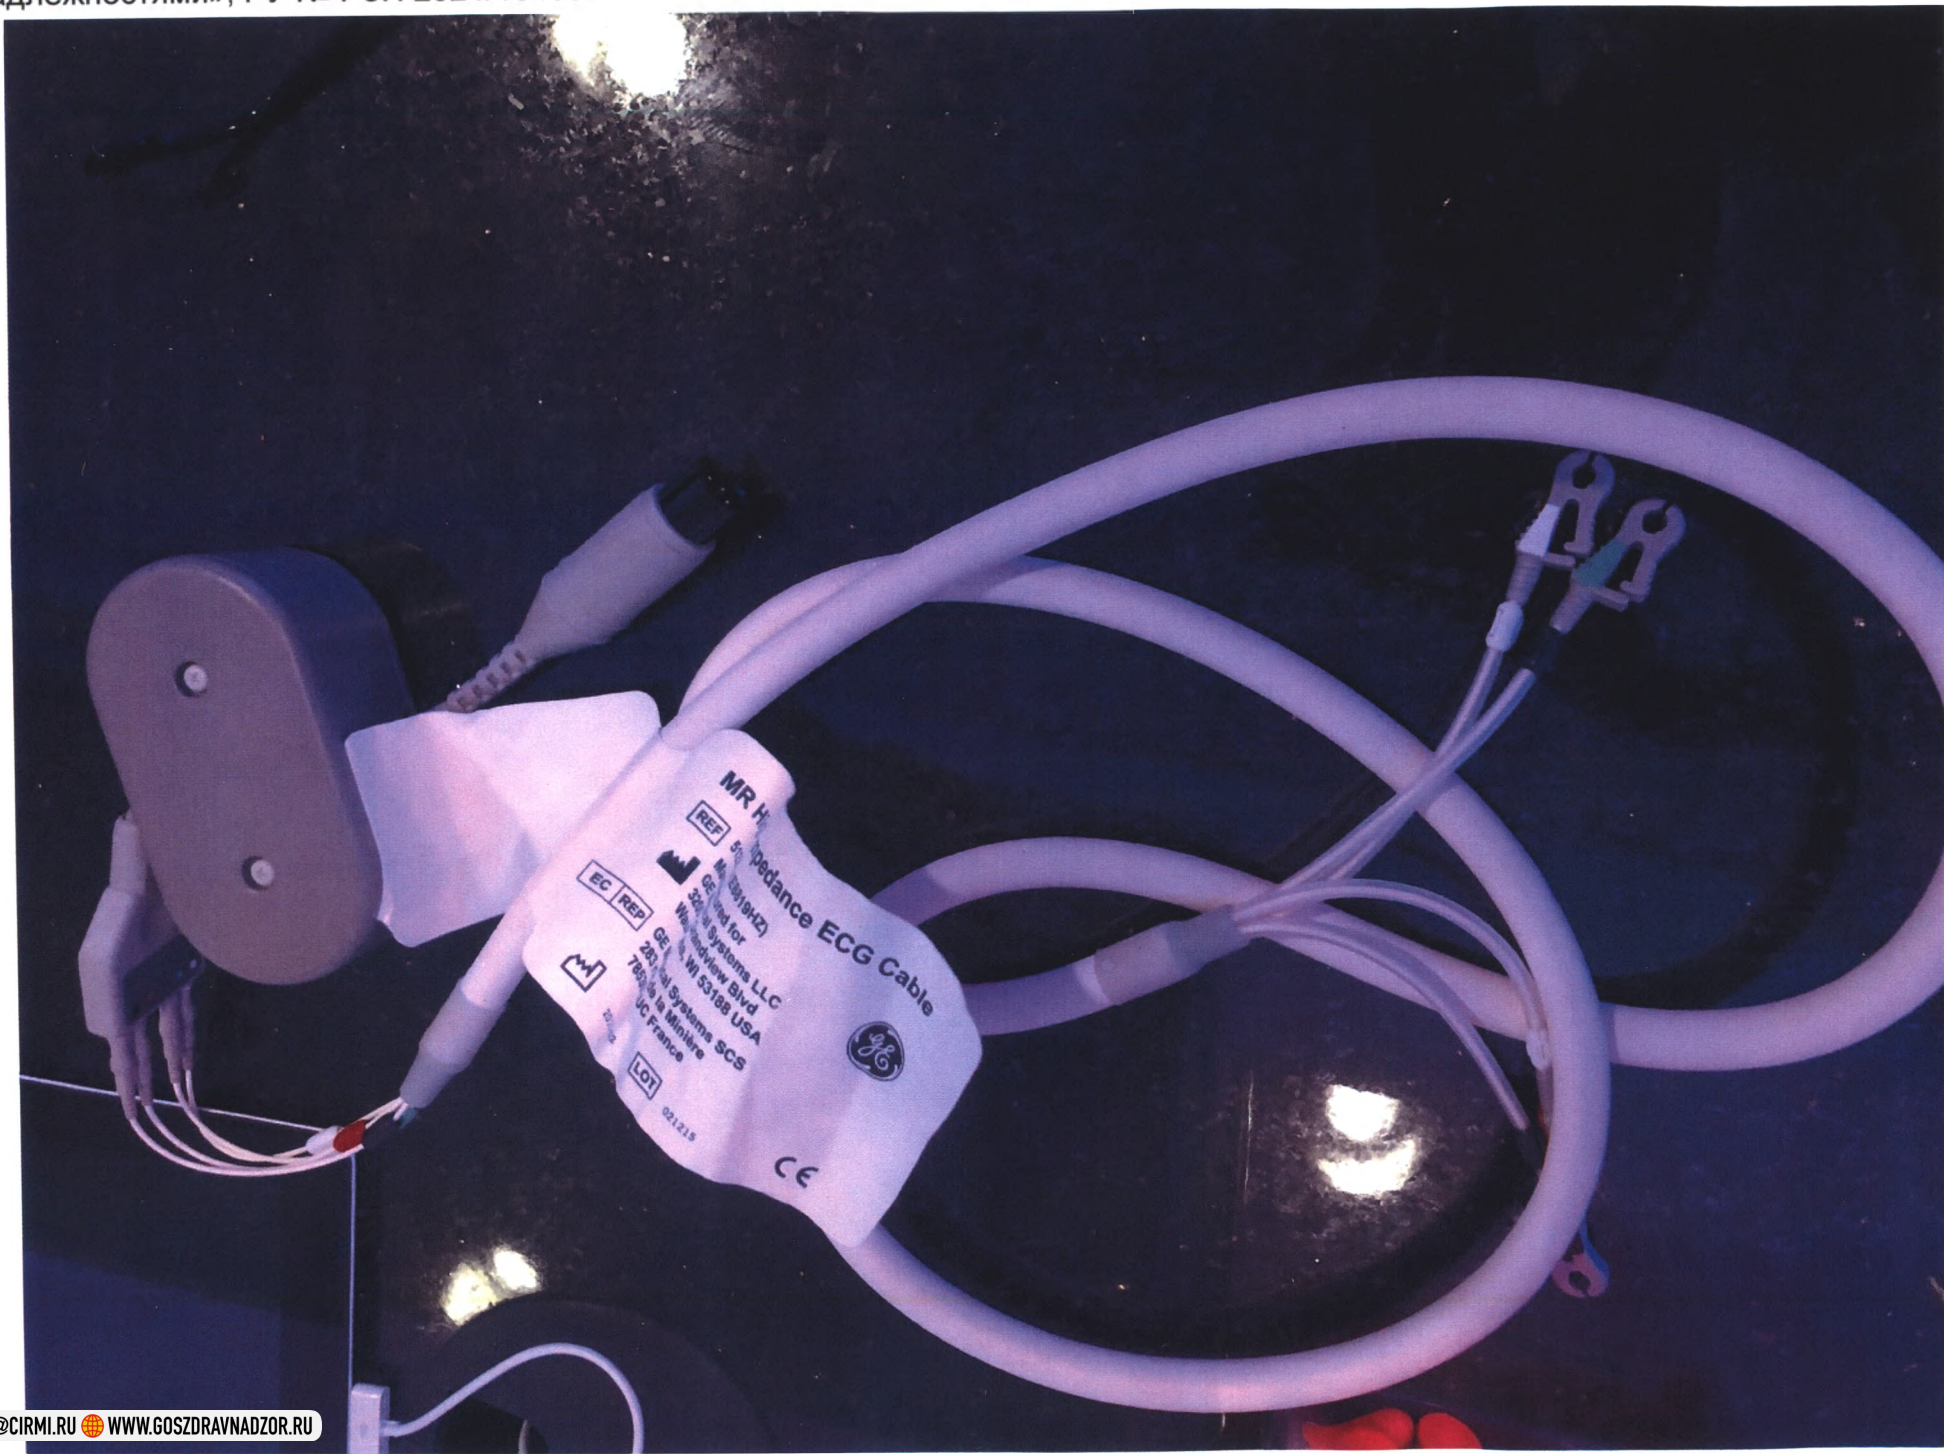

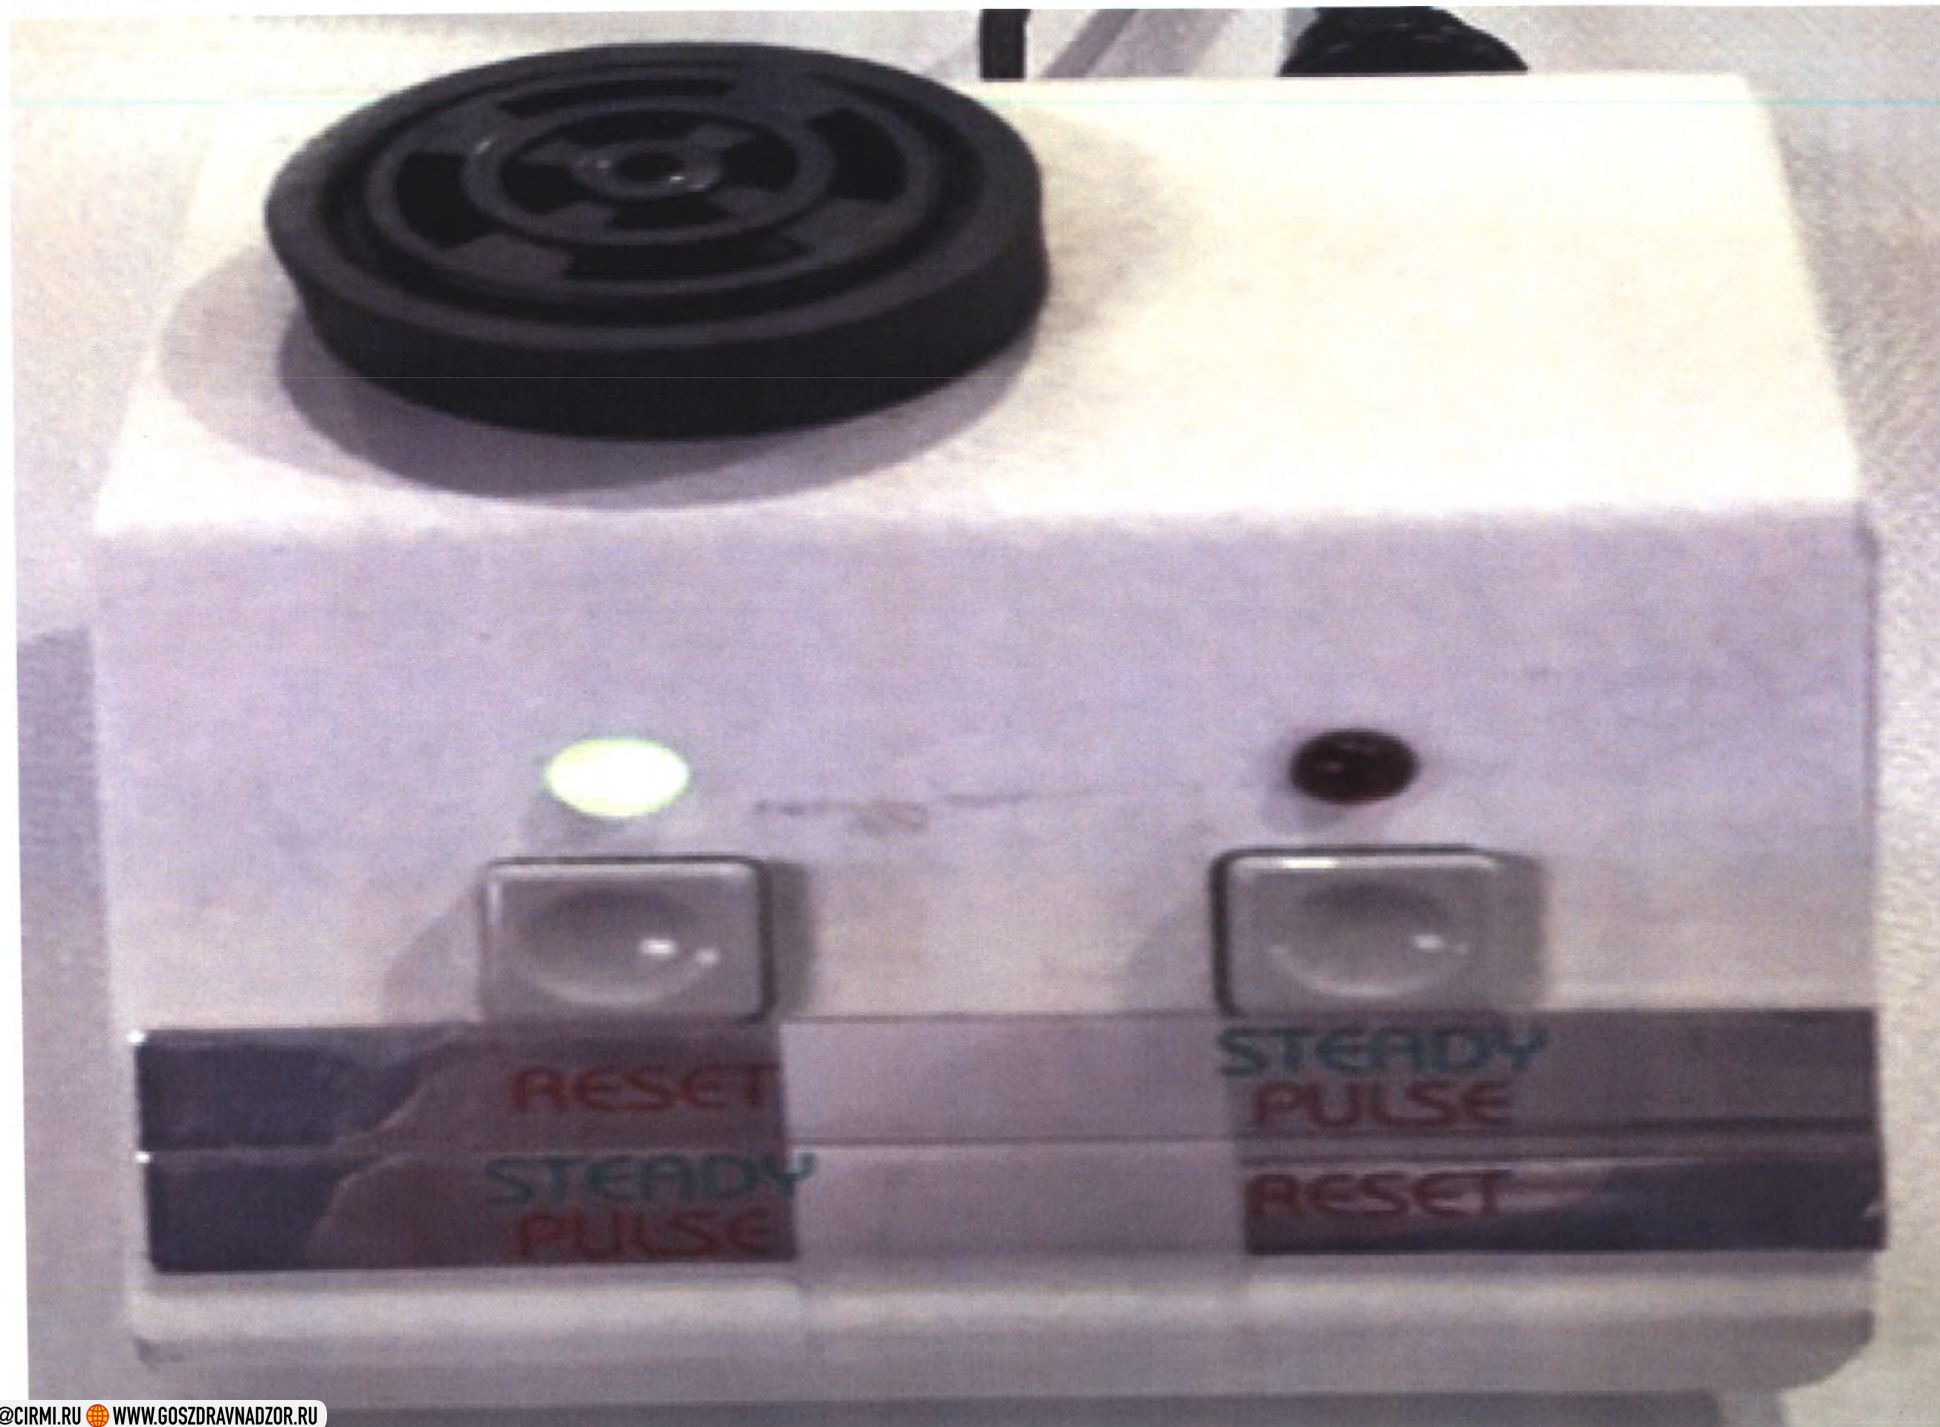






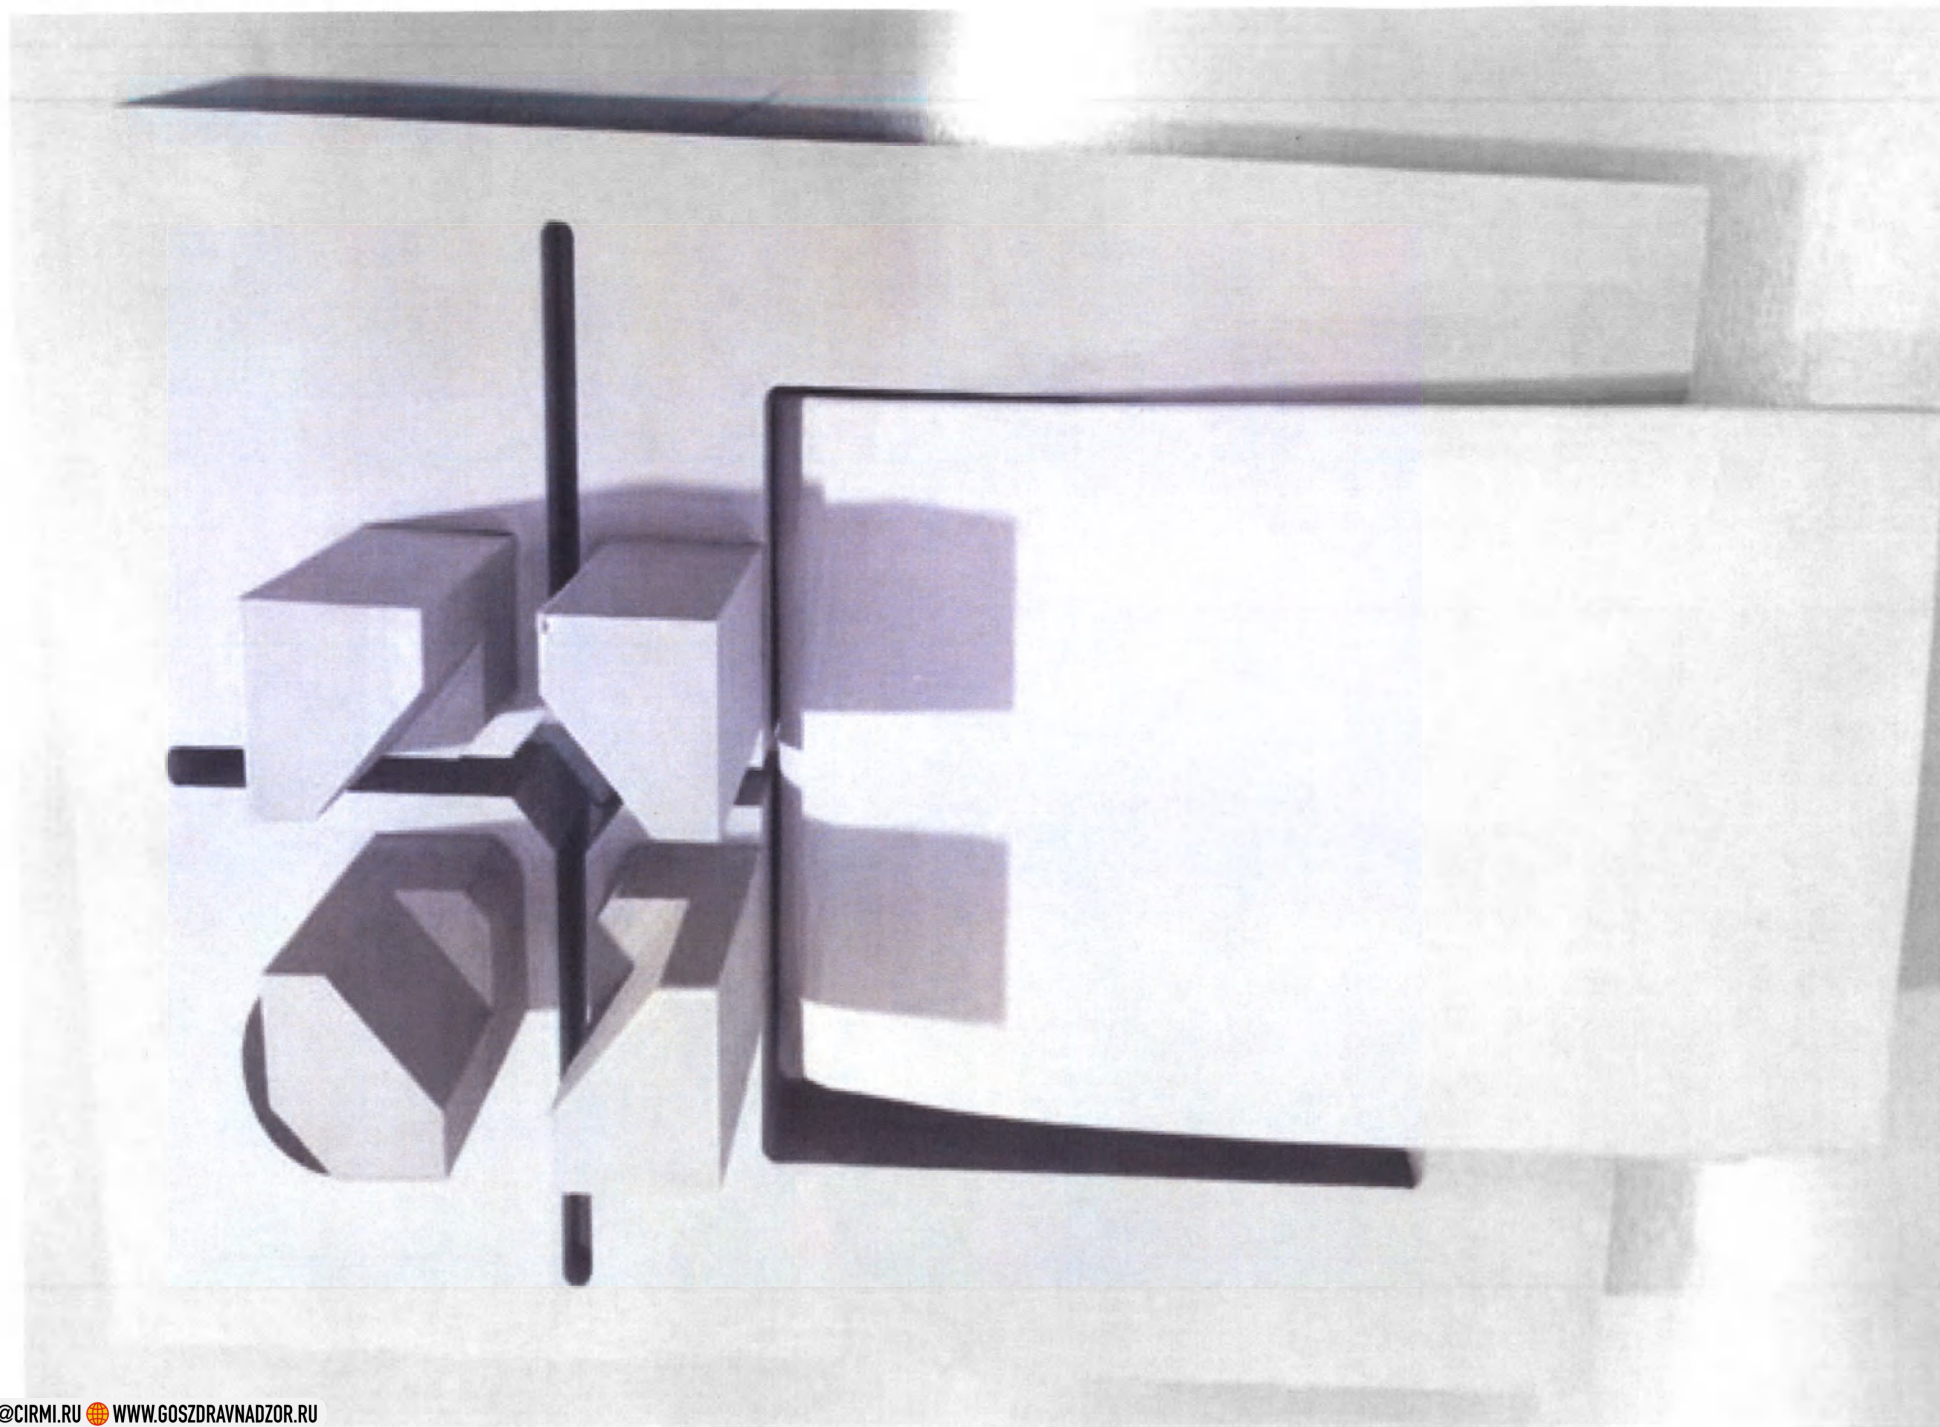



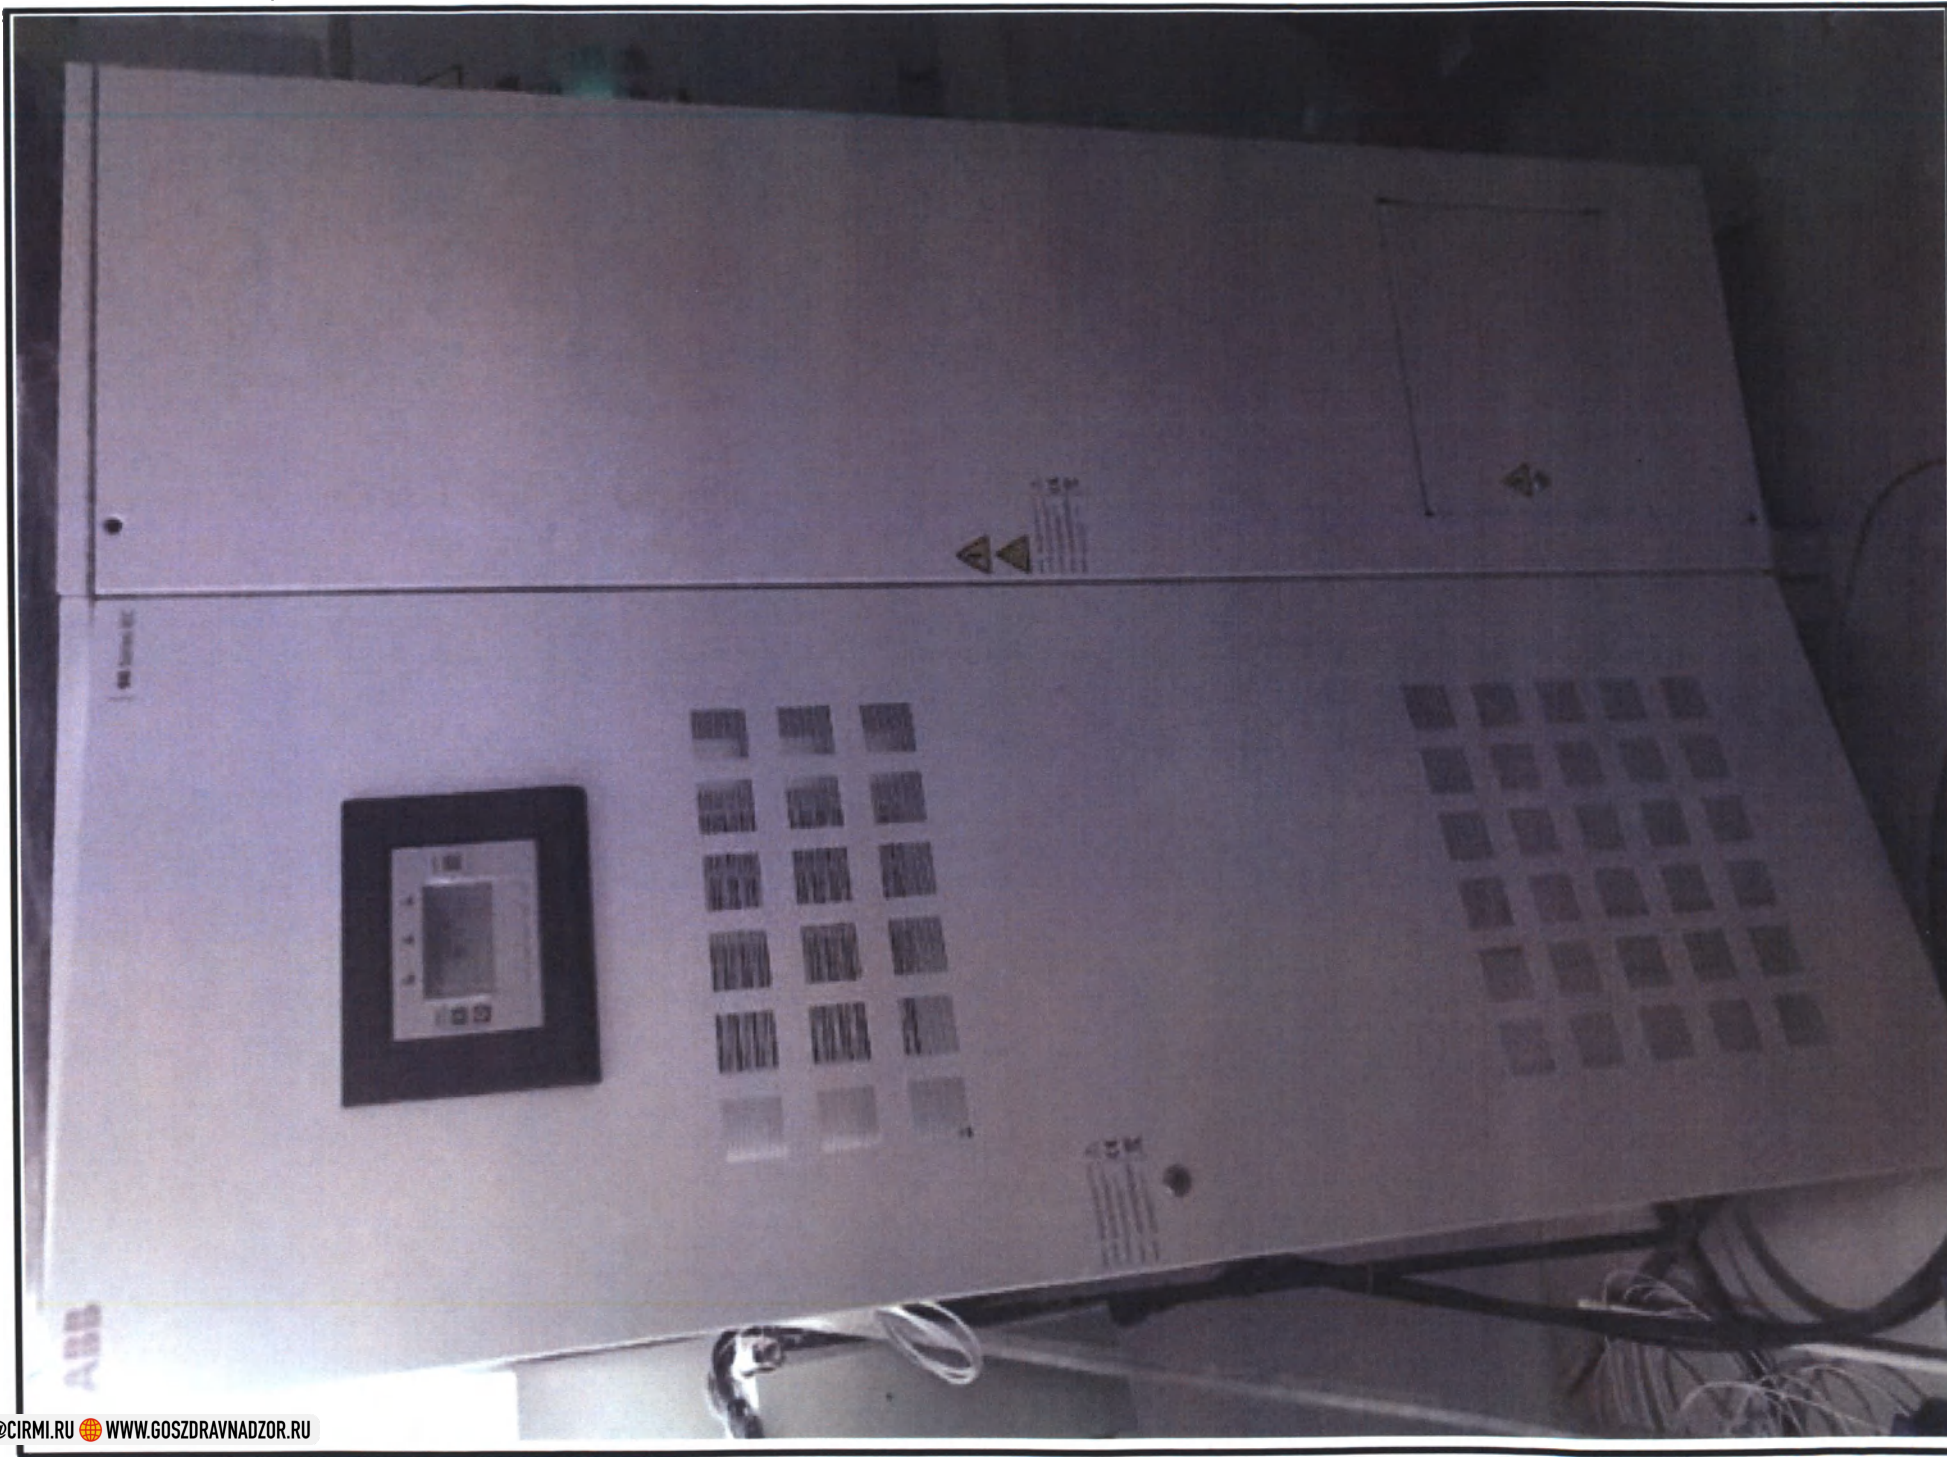

























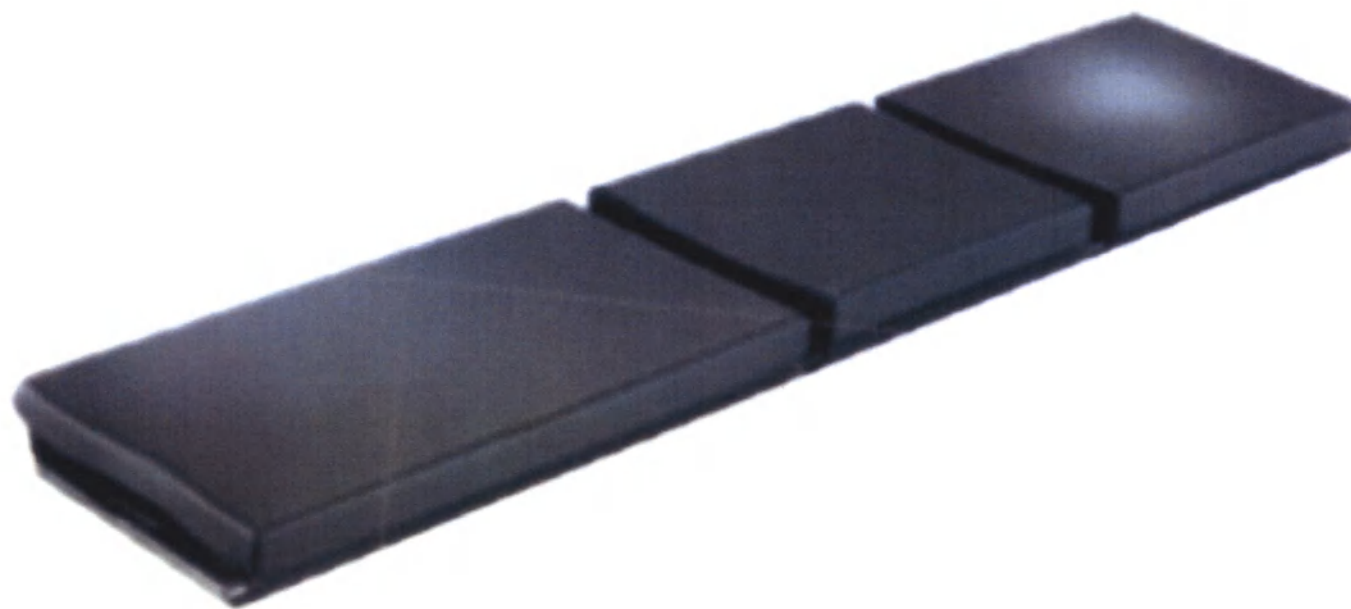




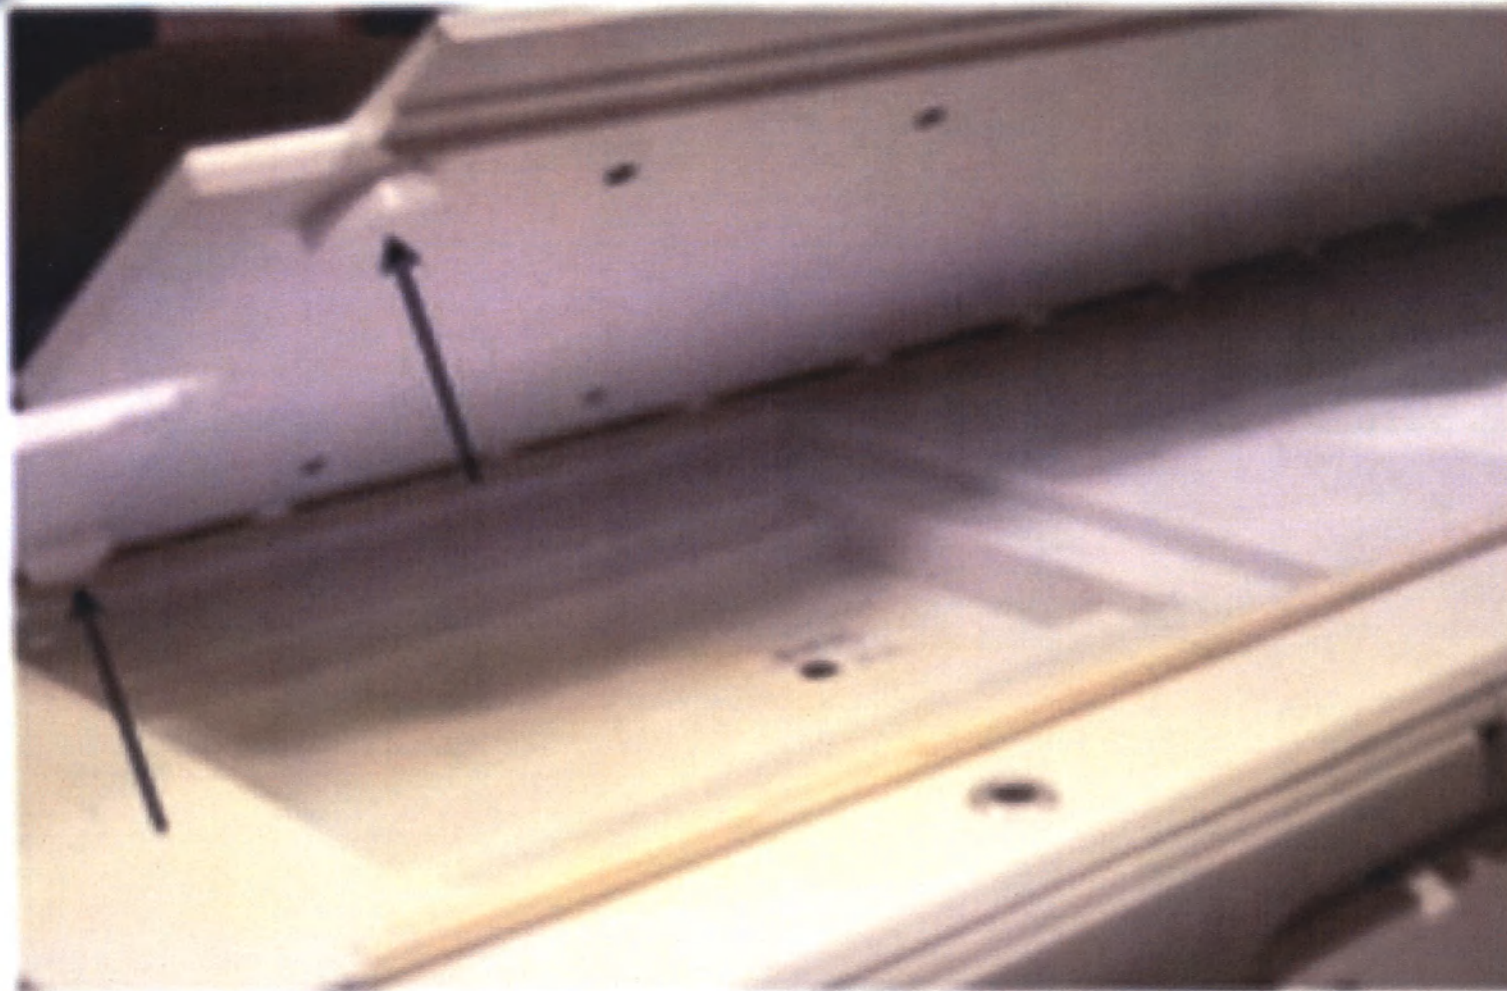




Консоль управления томографом

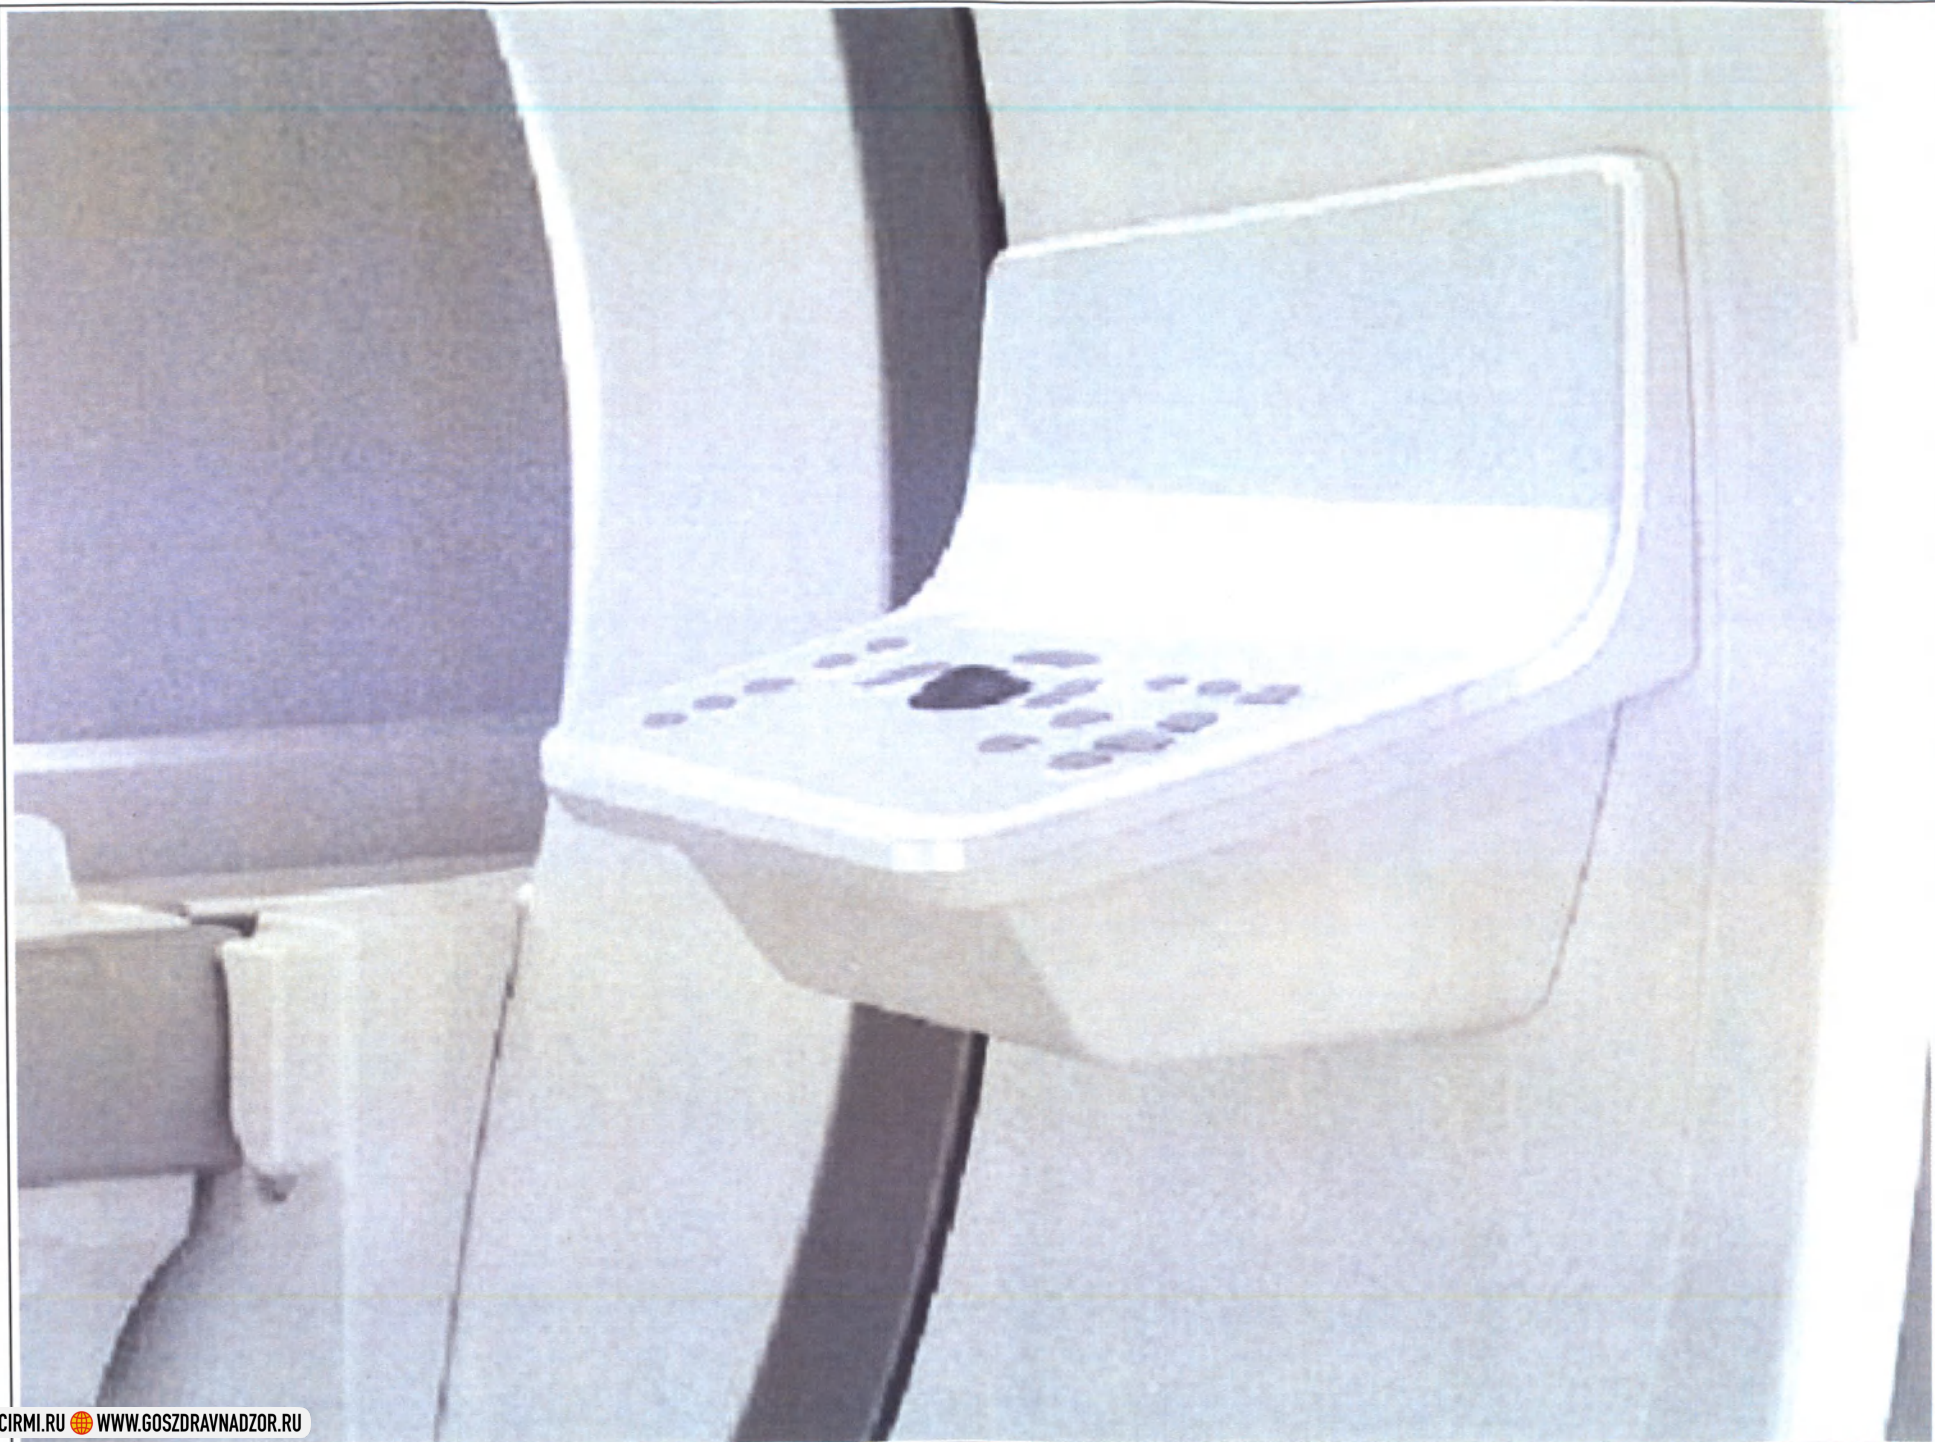


Кресло оператора



Устройство для многоядерной спектроскопии

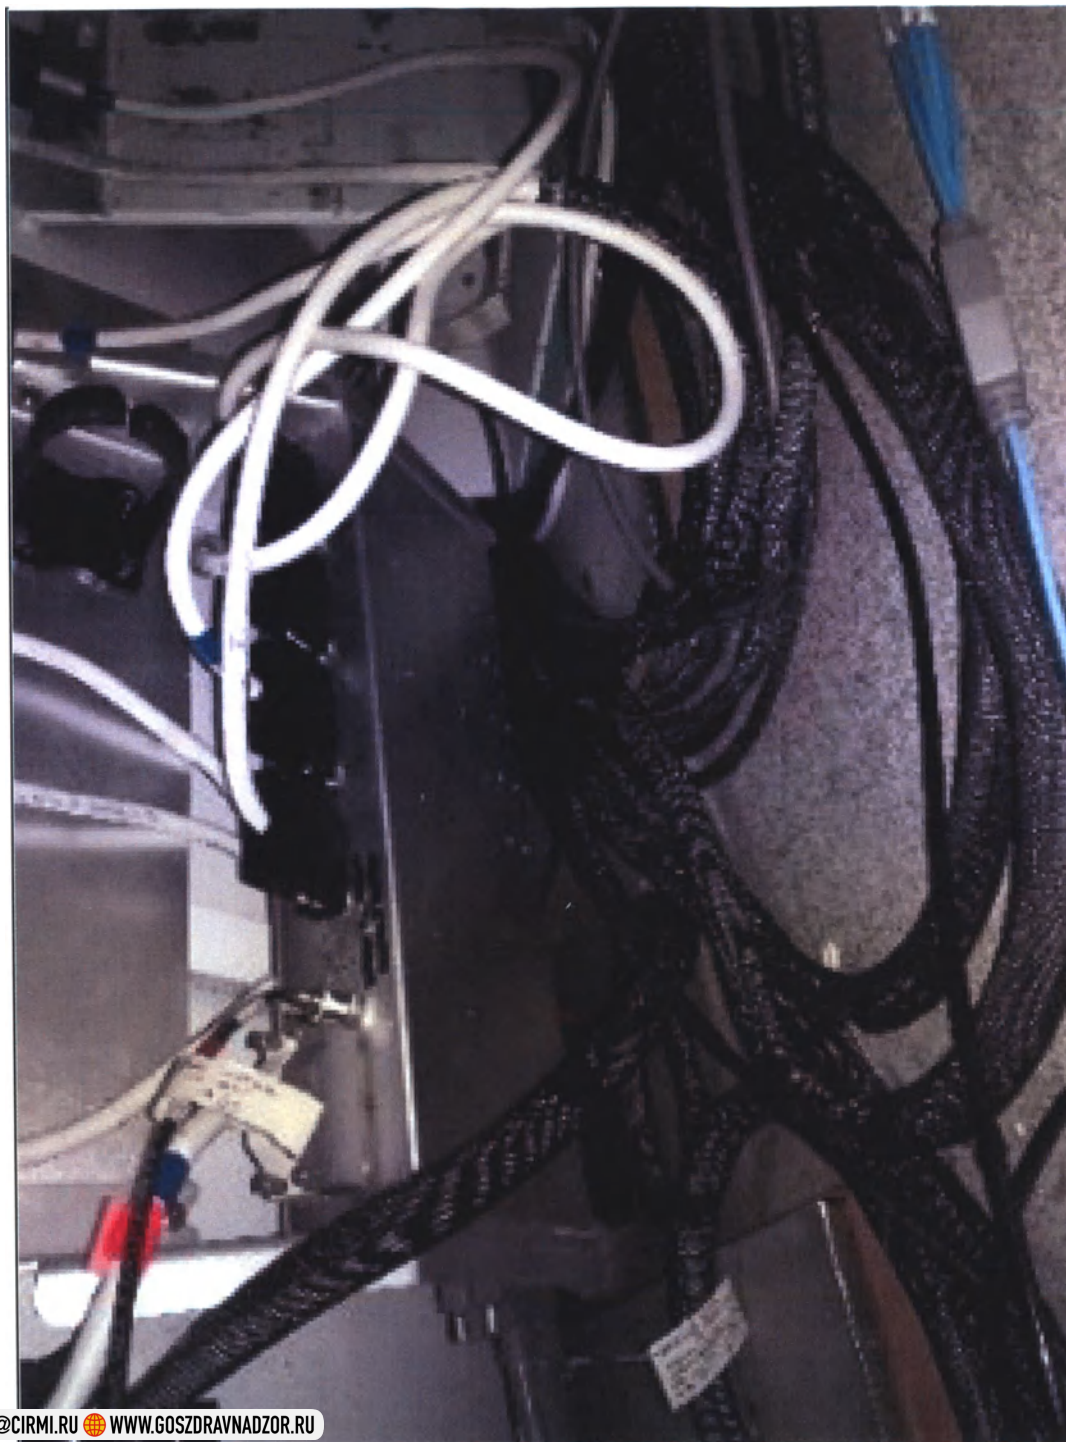

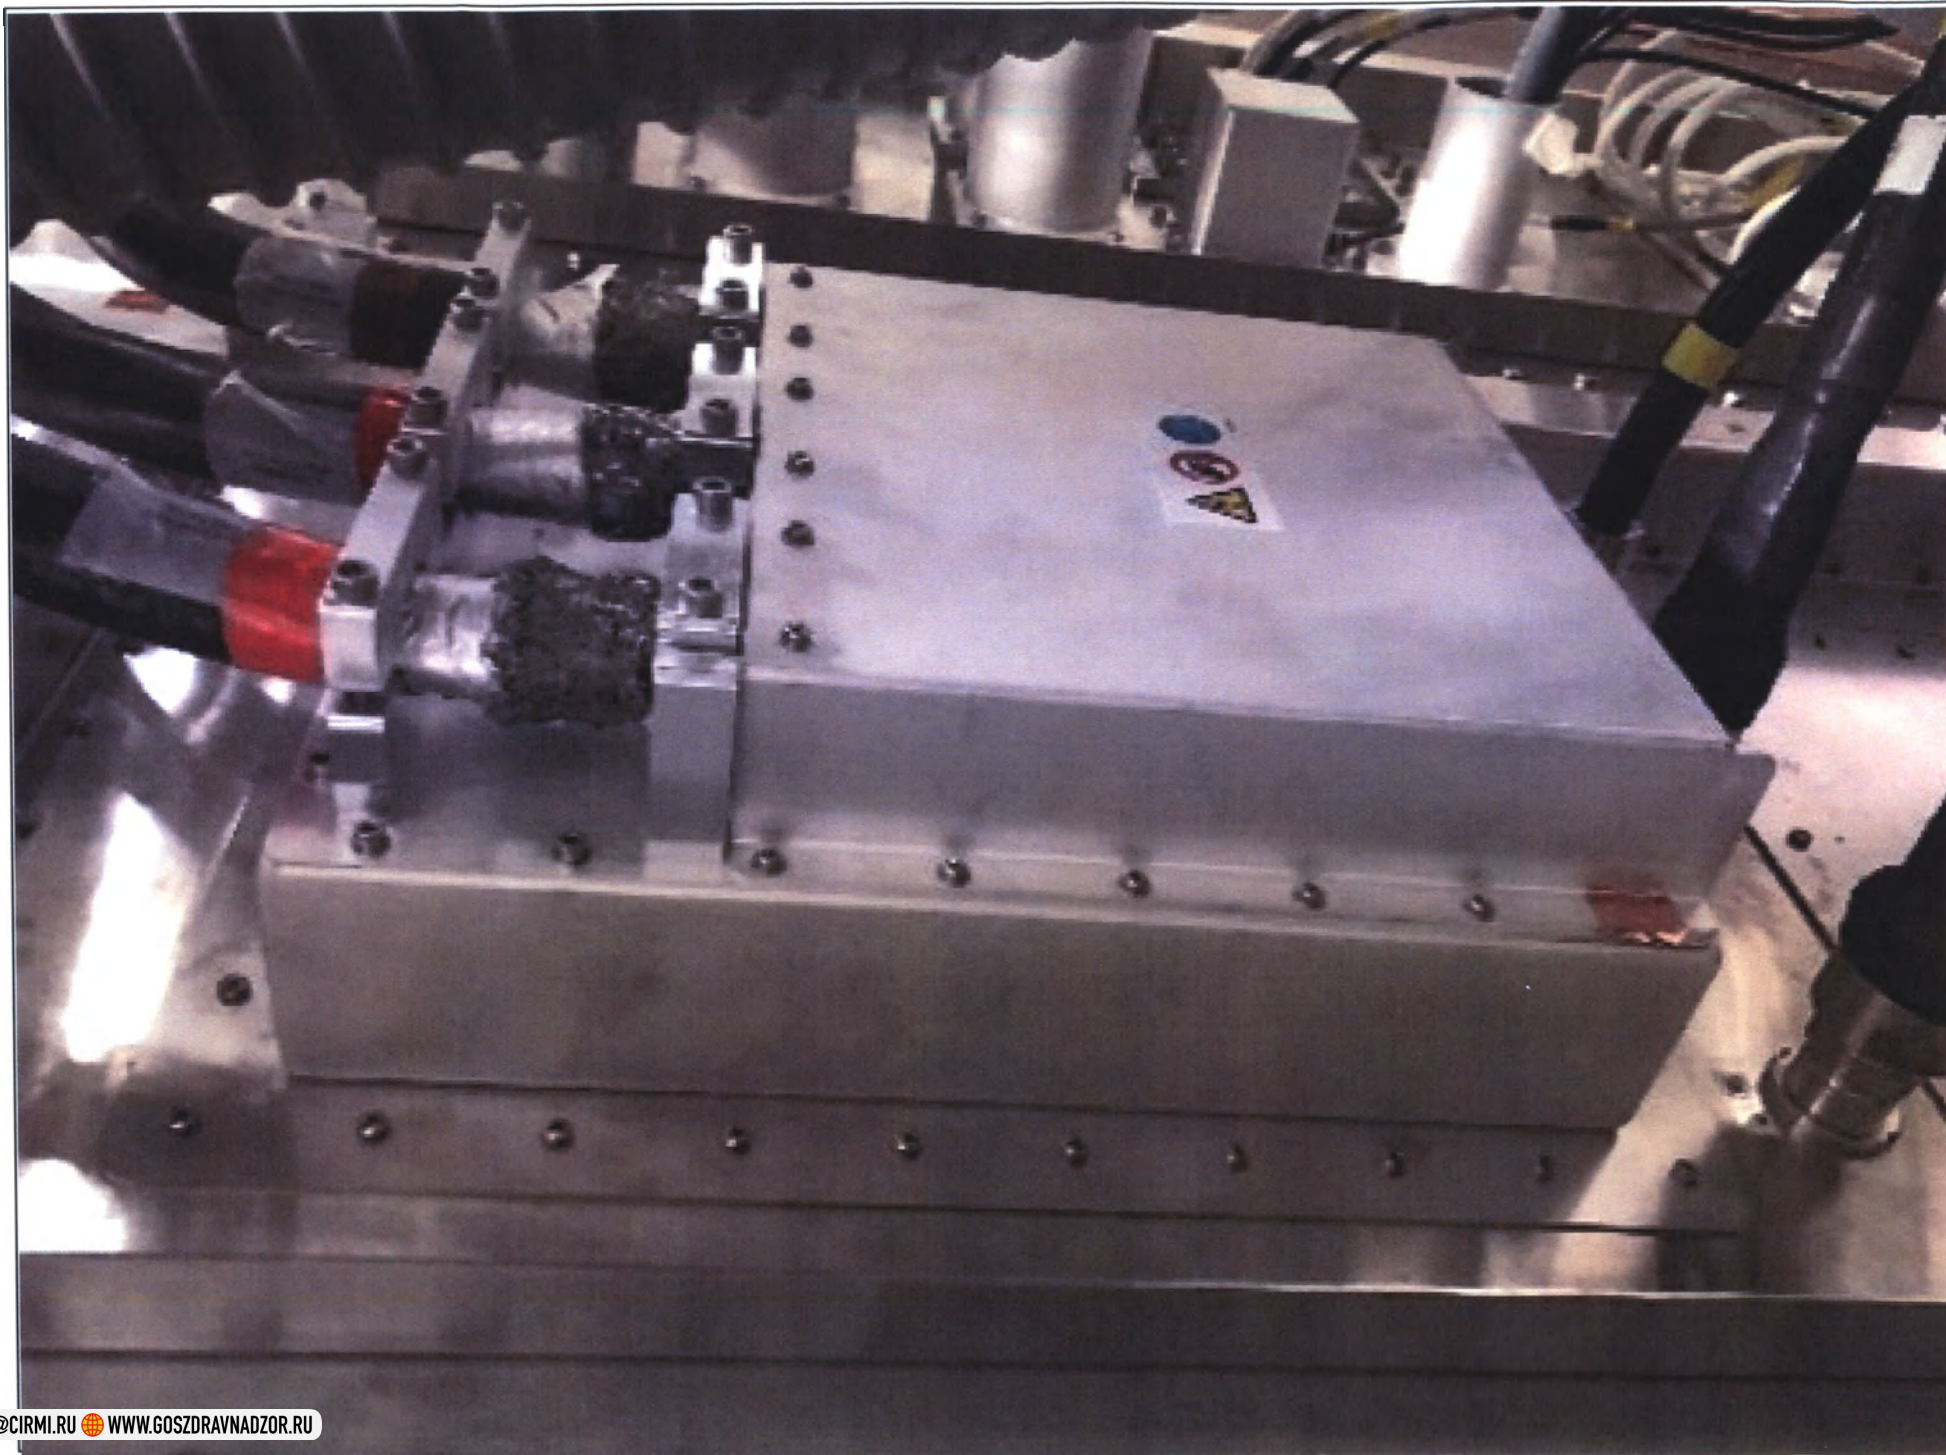












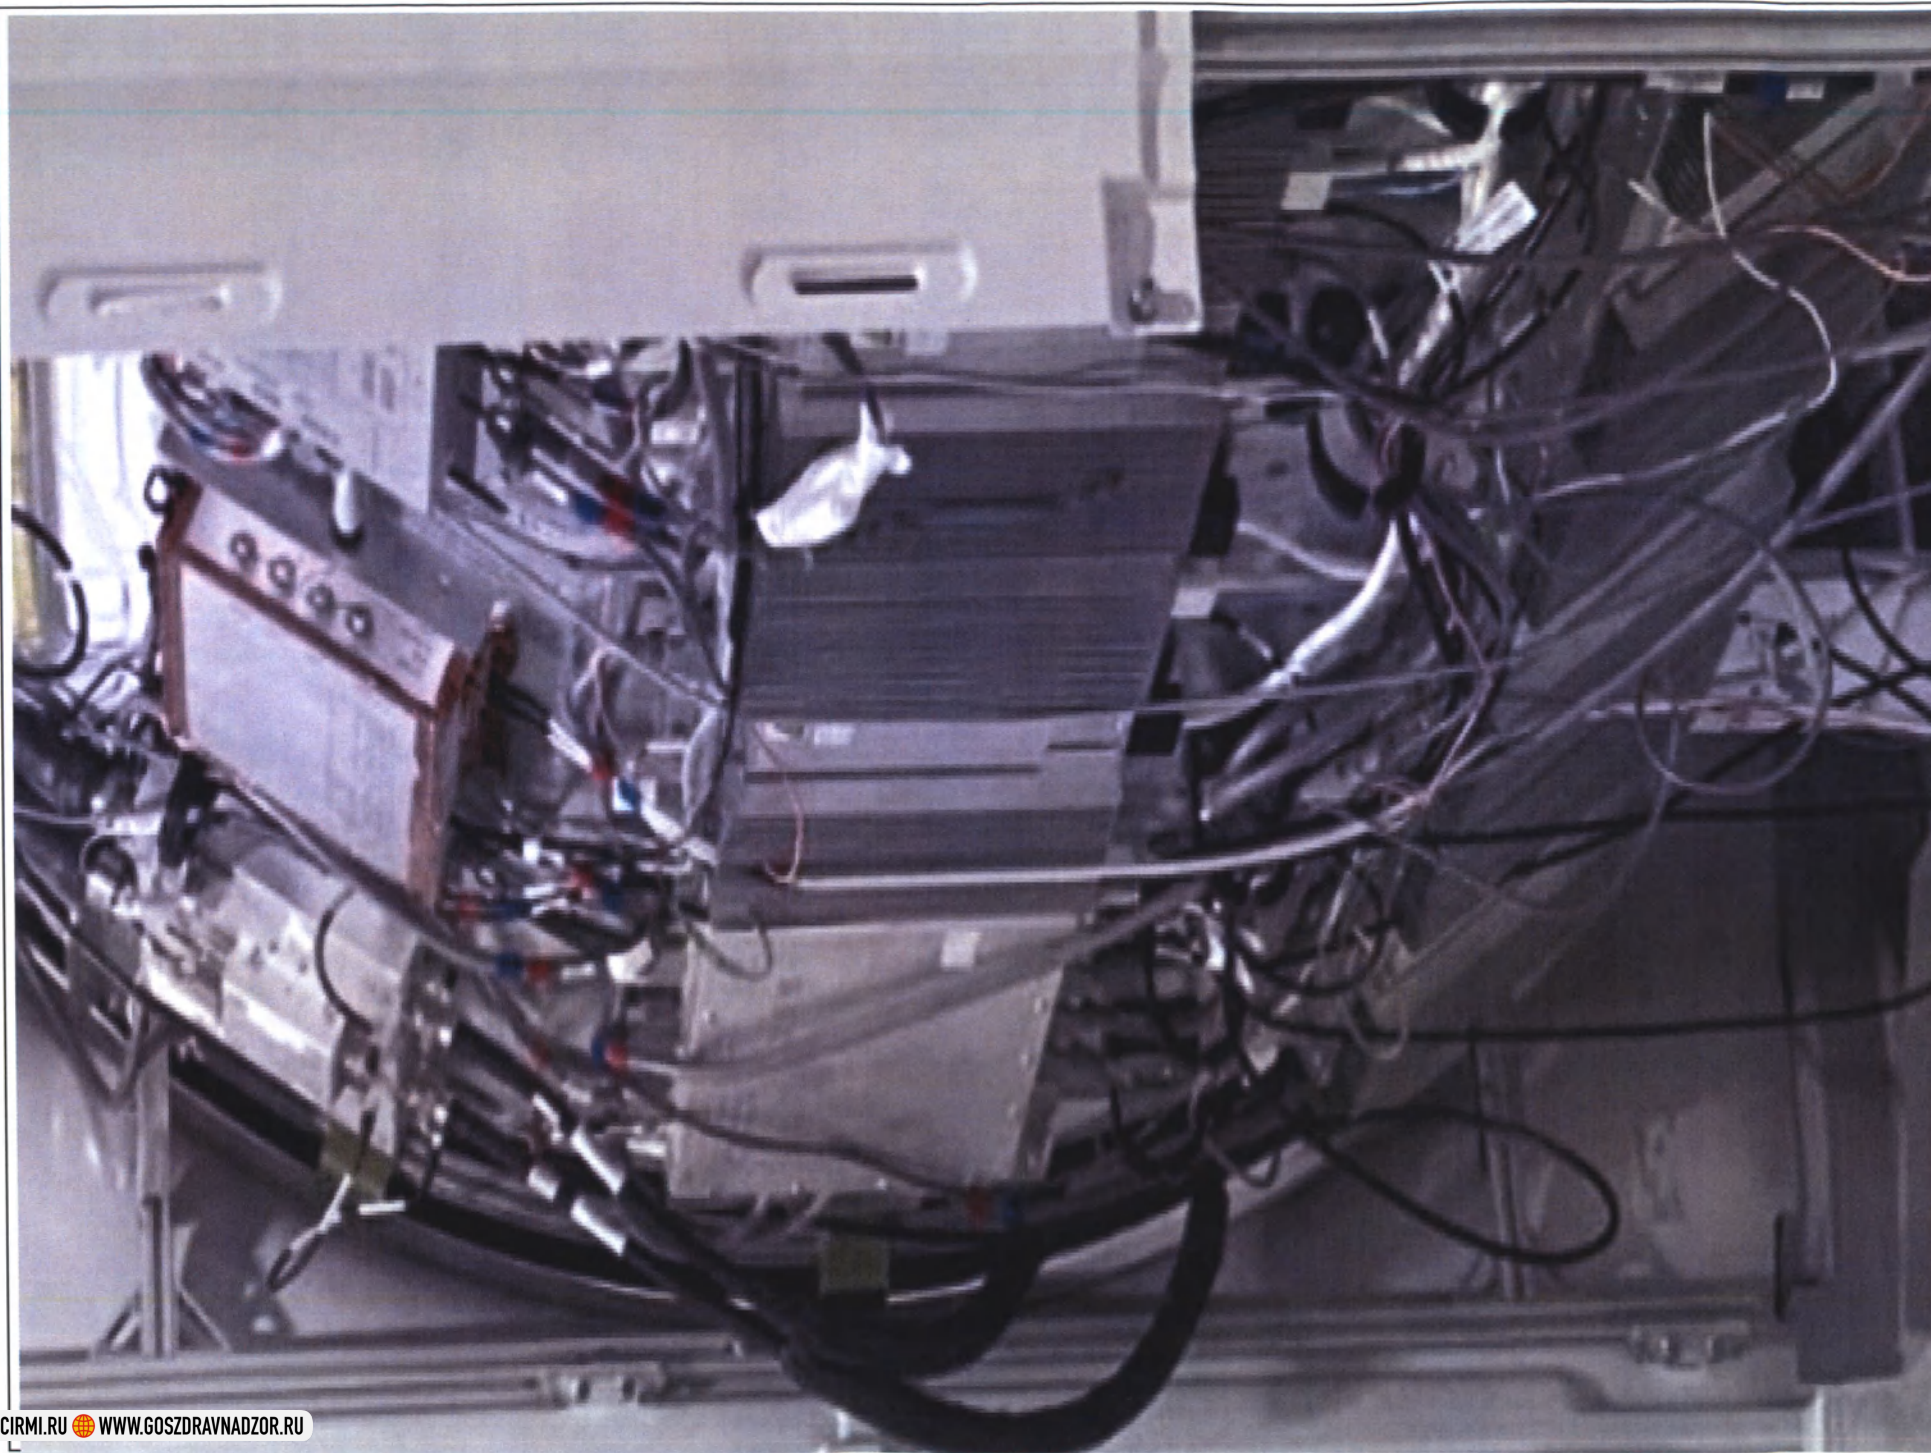

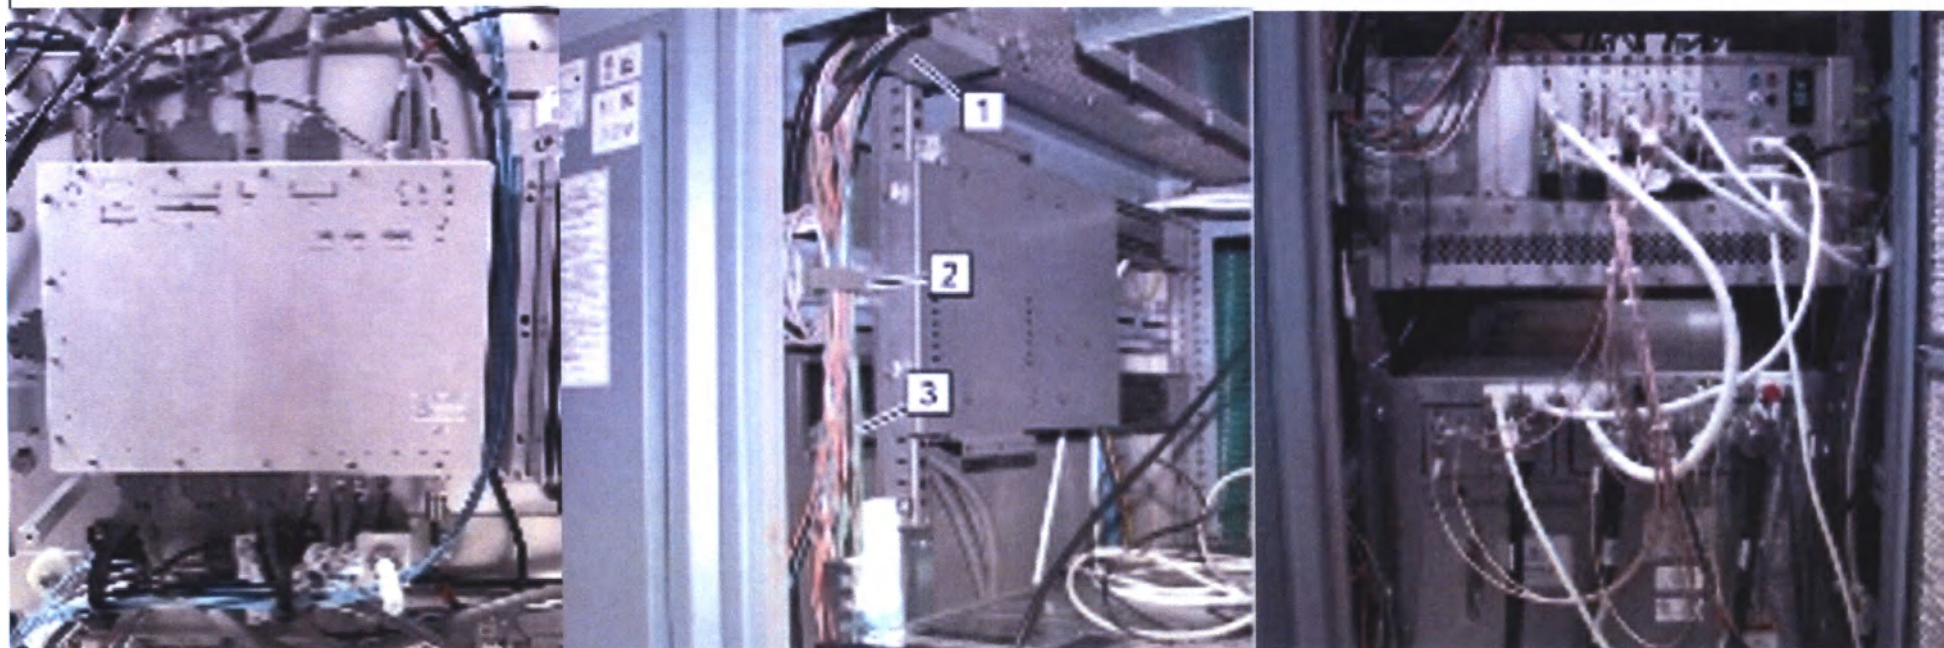


Наушники для снижения акустического шума во время исследования

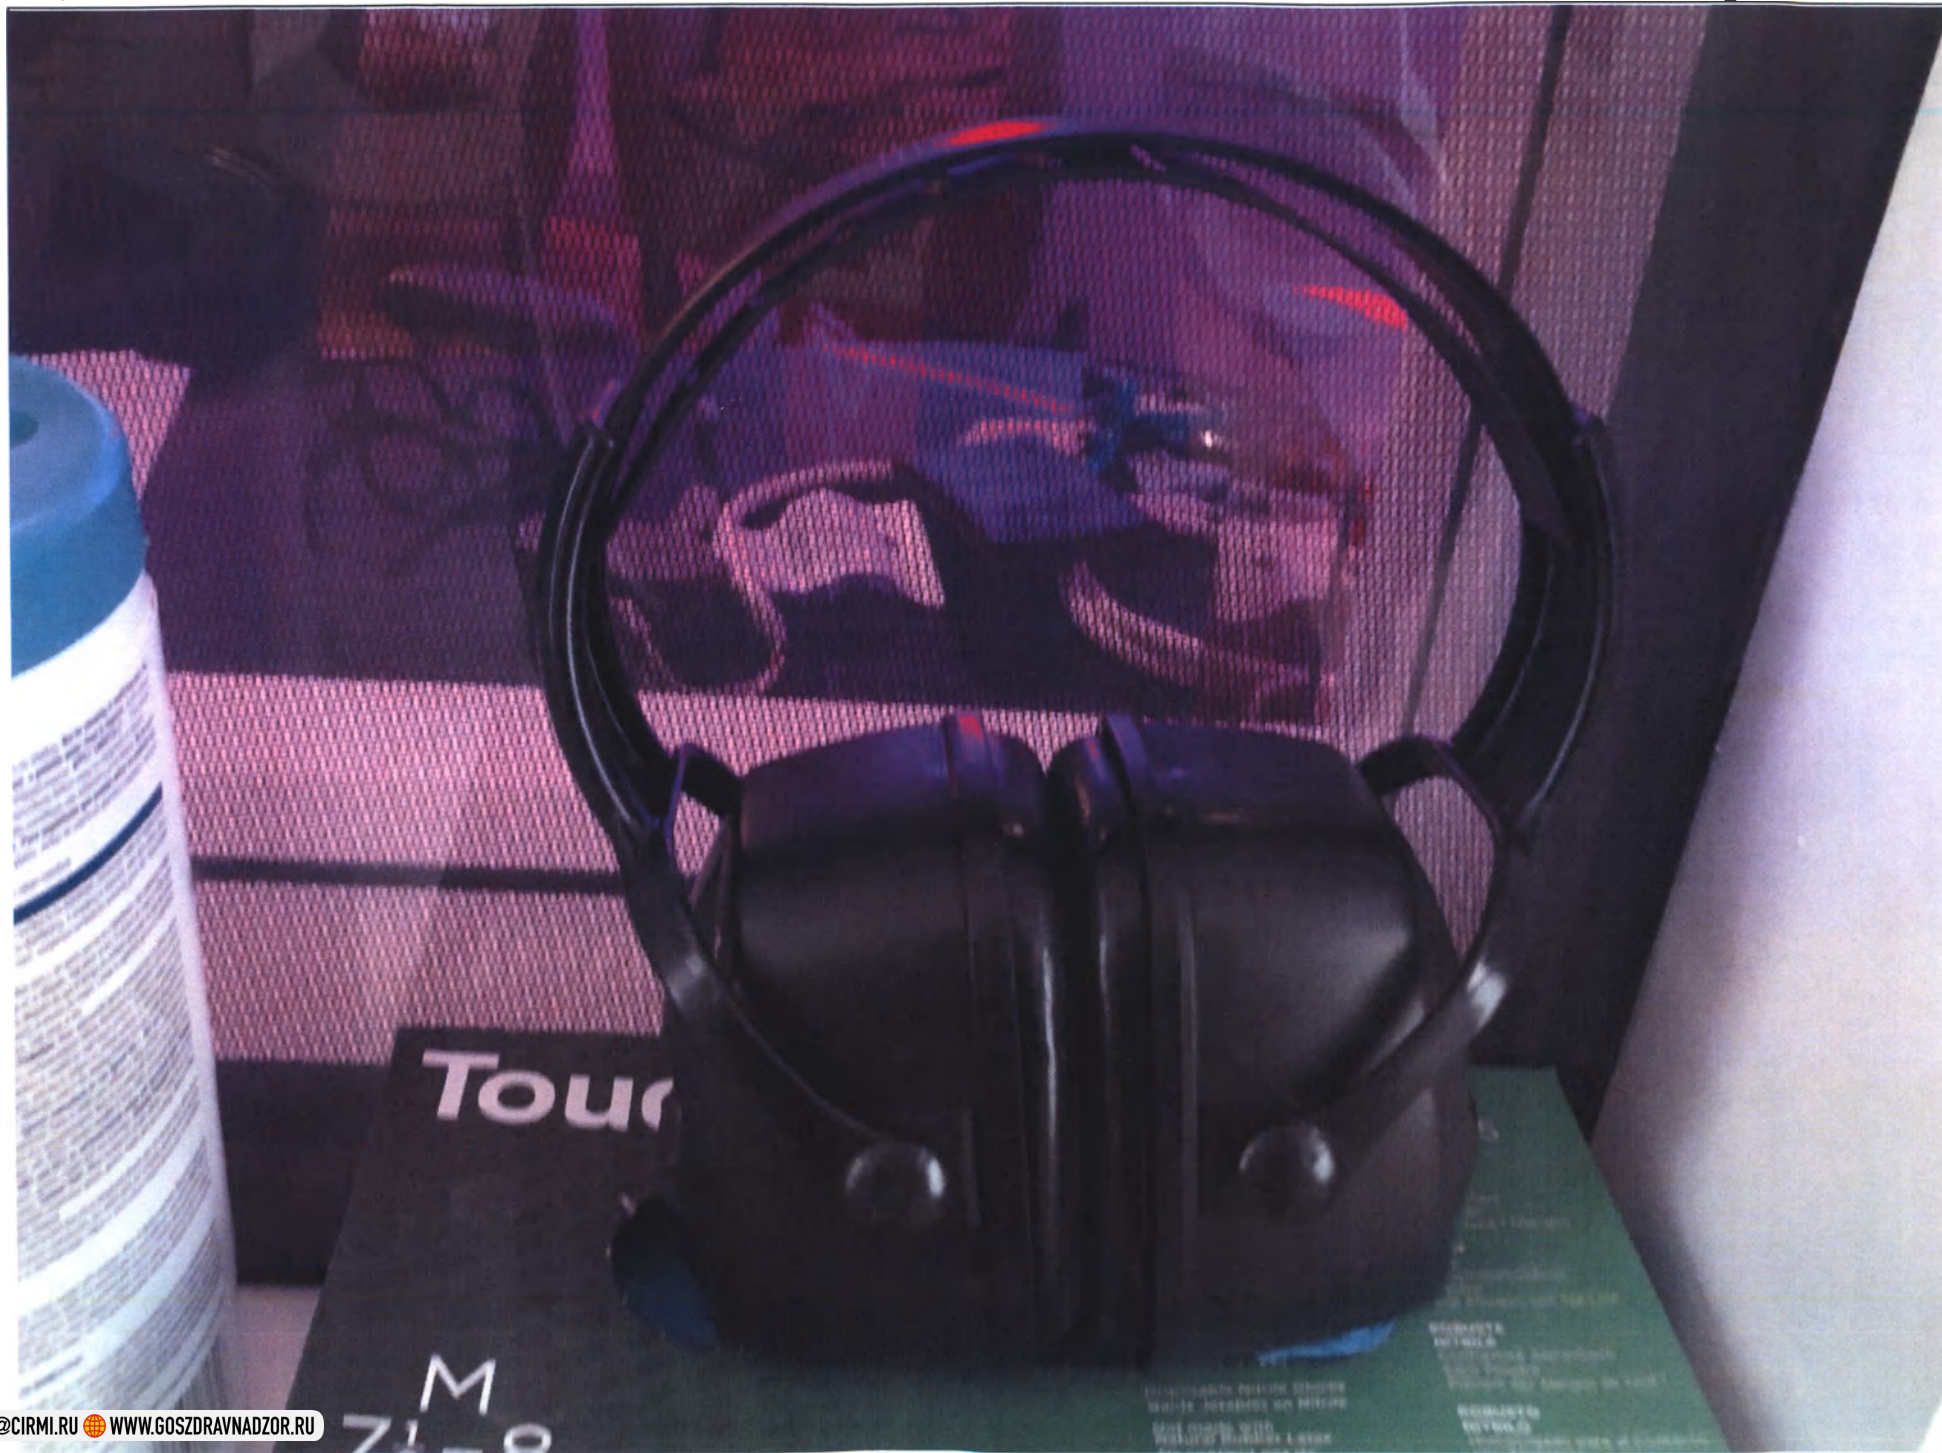





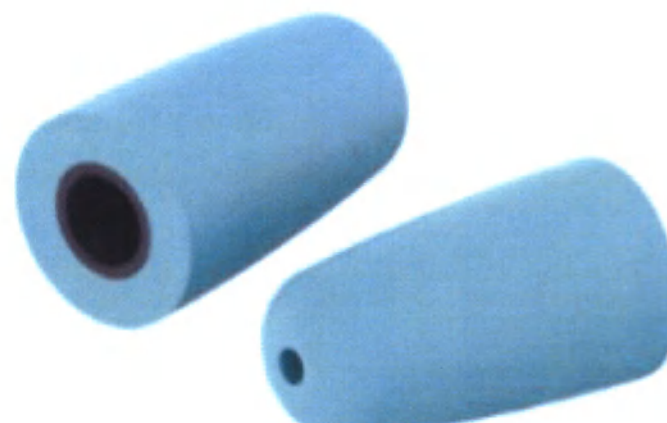



Service License

Service License Expiration

Service License	Expiry Date
A+_BAY13BNET2014062419...	2014-07-24 22:02:29 UTC
A_BAY13BNET20140624190...	2014-07-24 22:02:25 UTC
C_BAY13BNET20140624190...	2014-07-24 22:02:33 UTC
ClassM	2014-06-28

Refresh

Remove

The Safenet Sentinel key is not supported on this system

To order new licenses , please refer to "Service Licensing" in the Service Documentation.

This Service License ID will be needed when requesting new licenses.

Service License ID

Pw132V4PDf2-MjyFG

License files to enable service tools should be copied to a CD, DVD, or USB memory stick. To install, first insert media, then click the "CD/DVD" or "USB" button.

Insert media before clicking.

CD/DVD


USB


View Log


Eject USB Service Key


Столы оператора



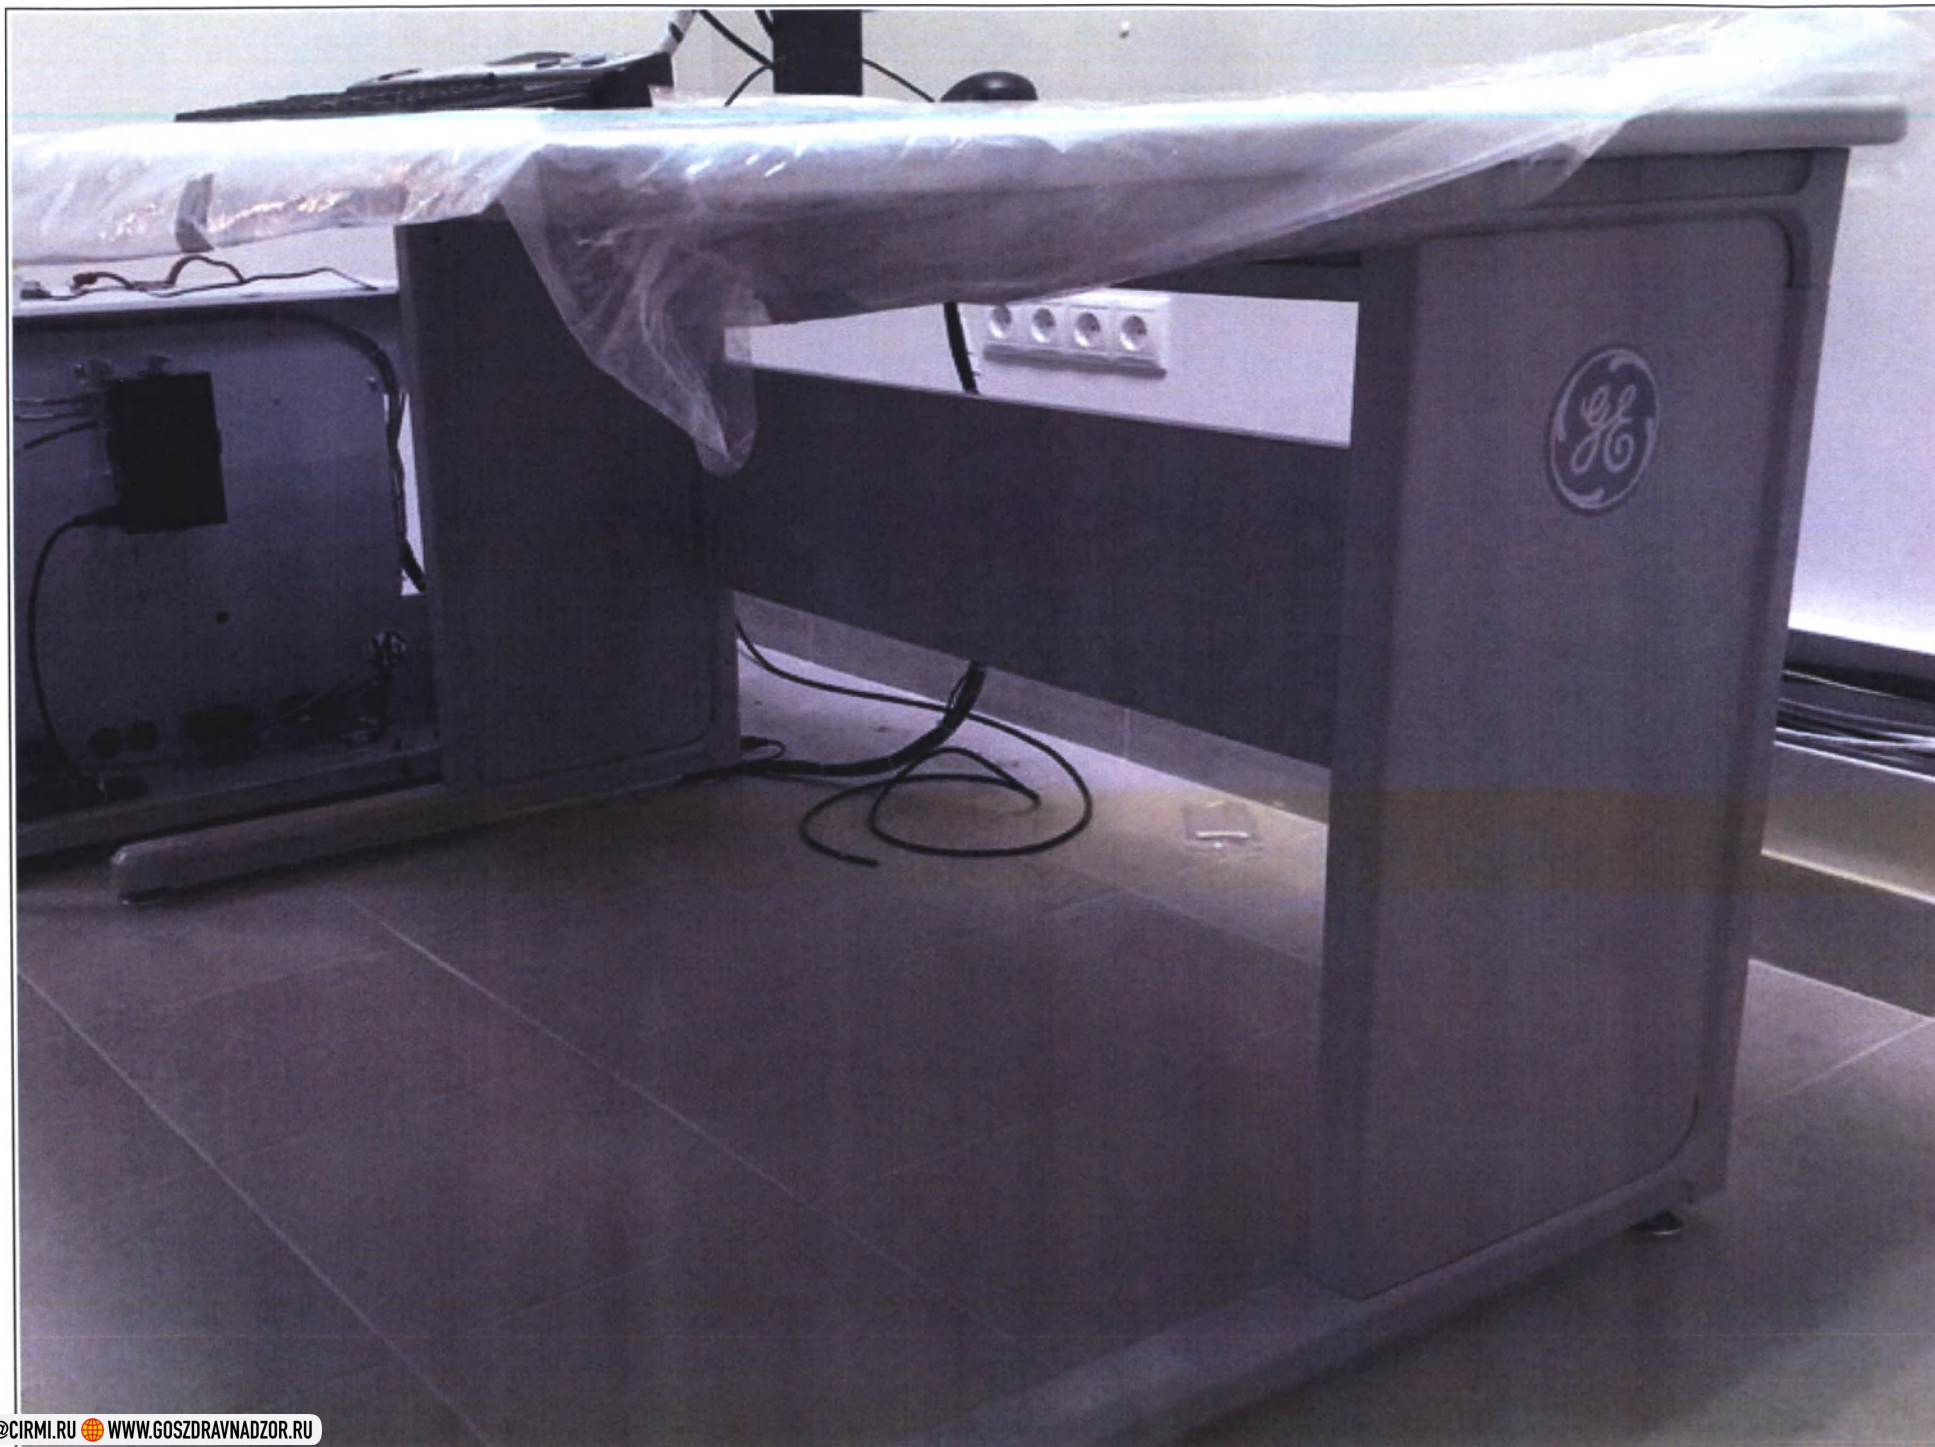


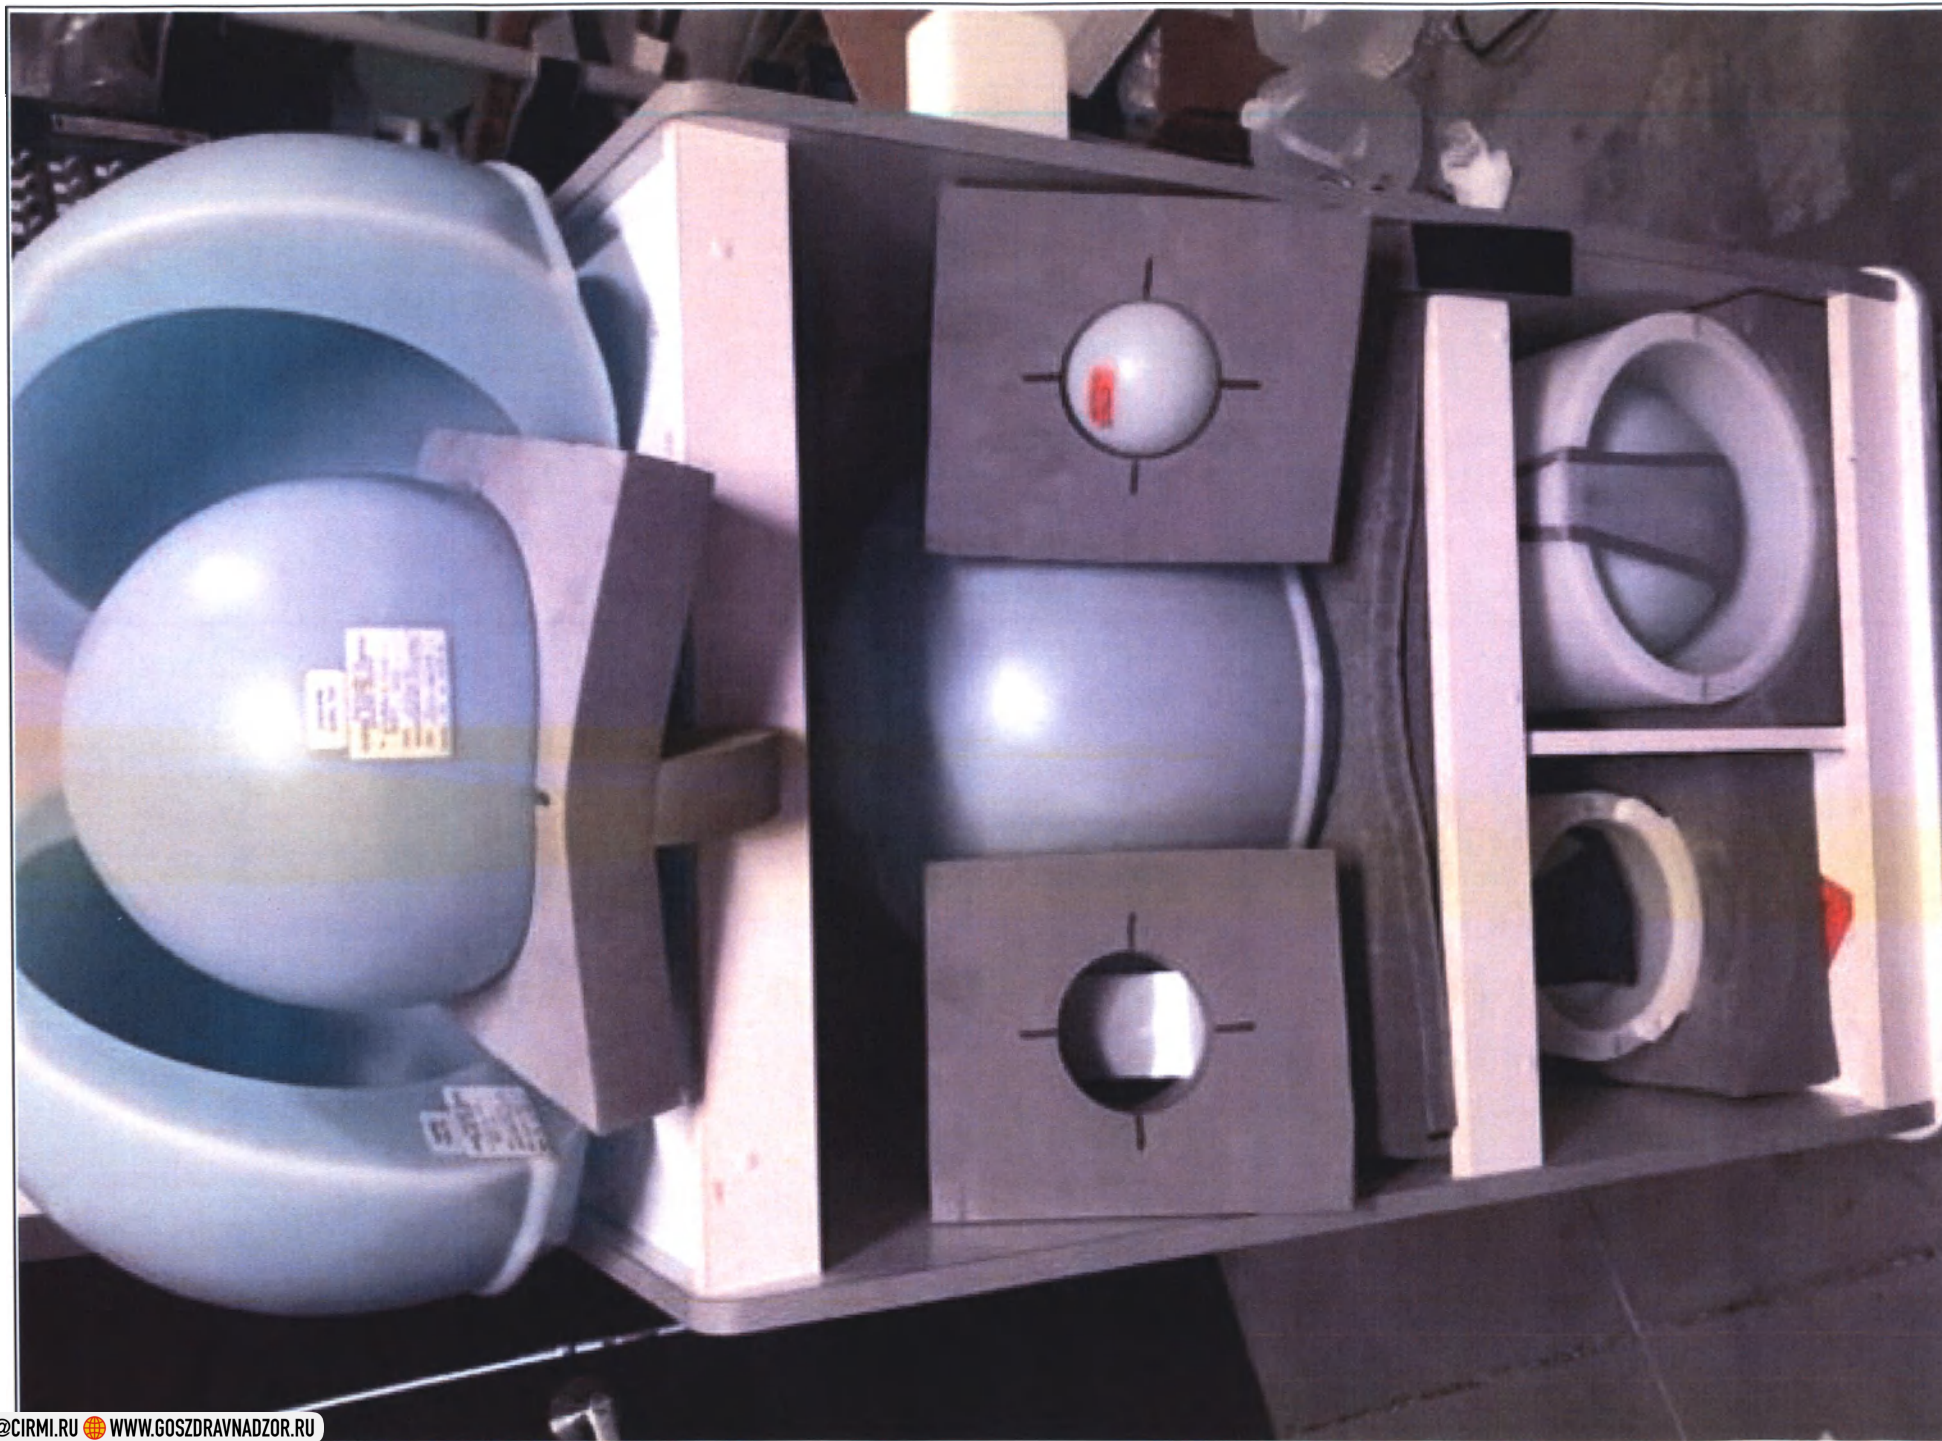




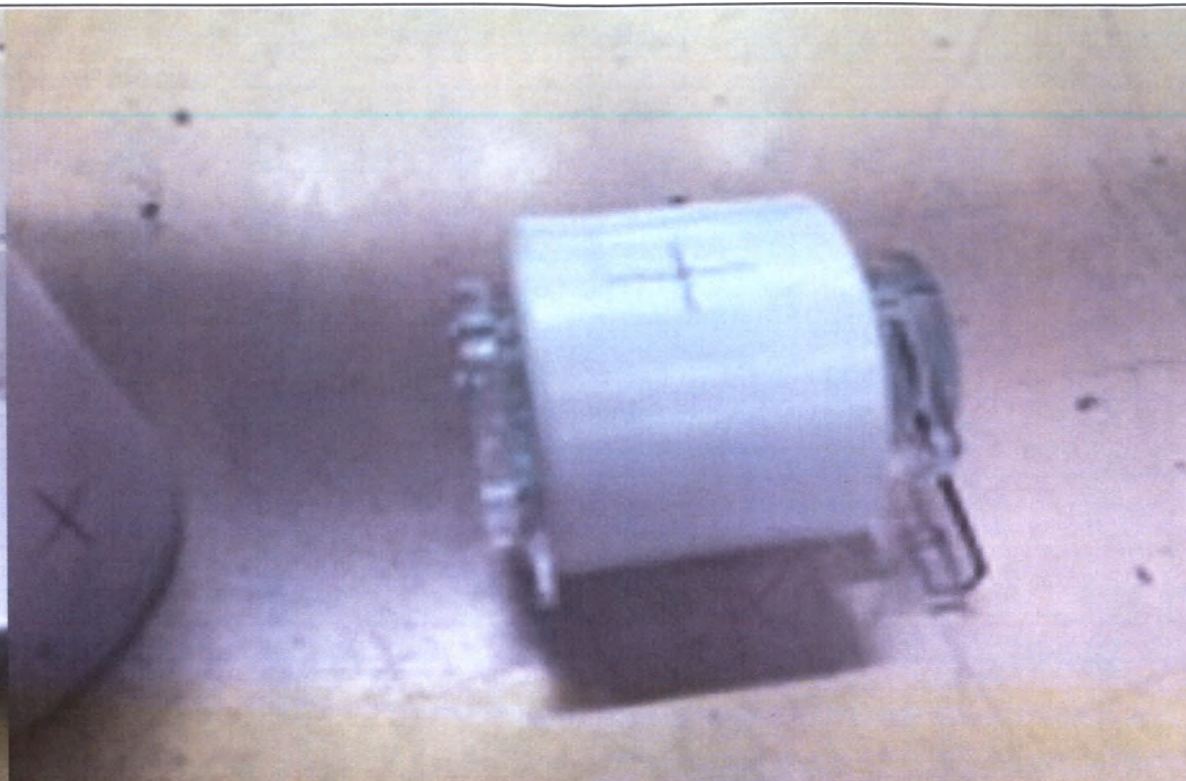


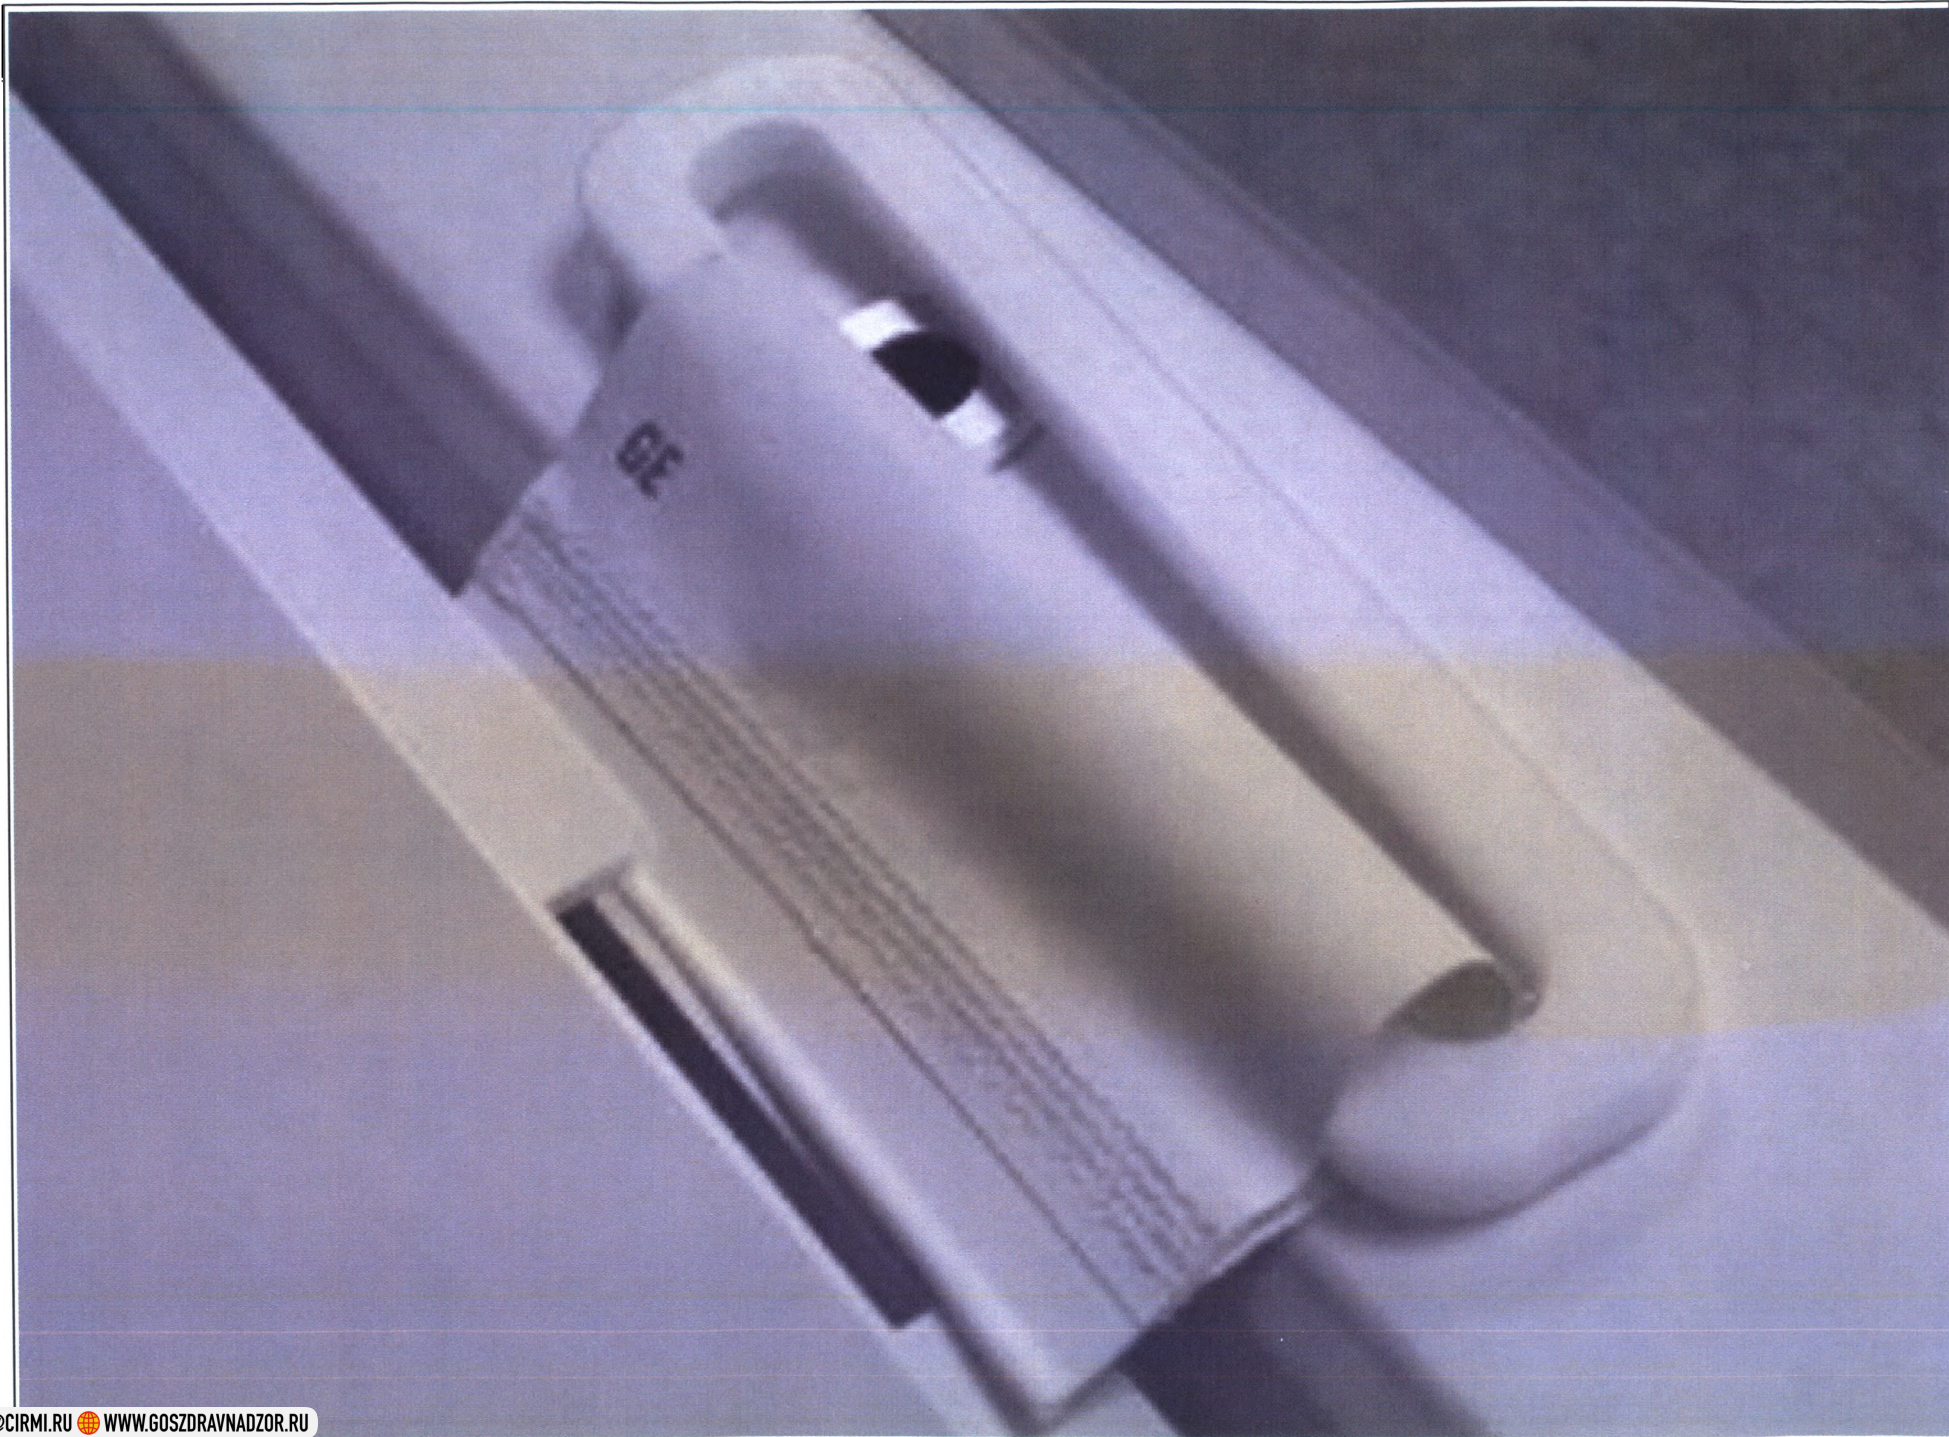




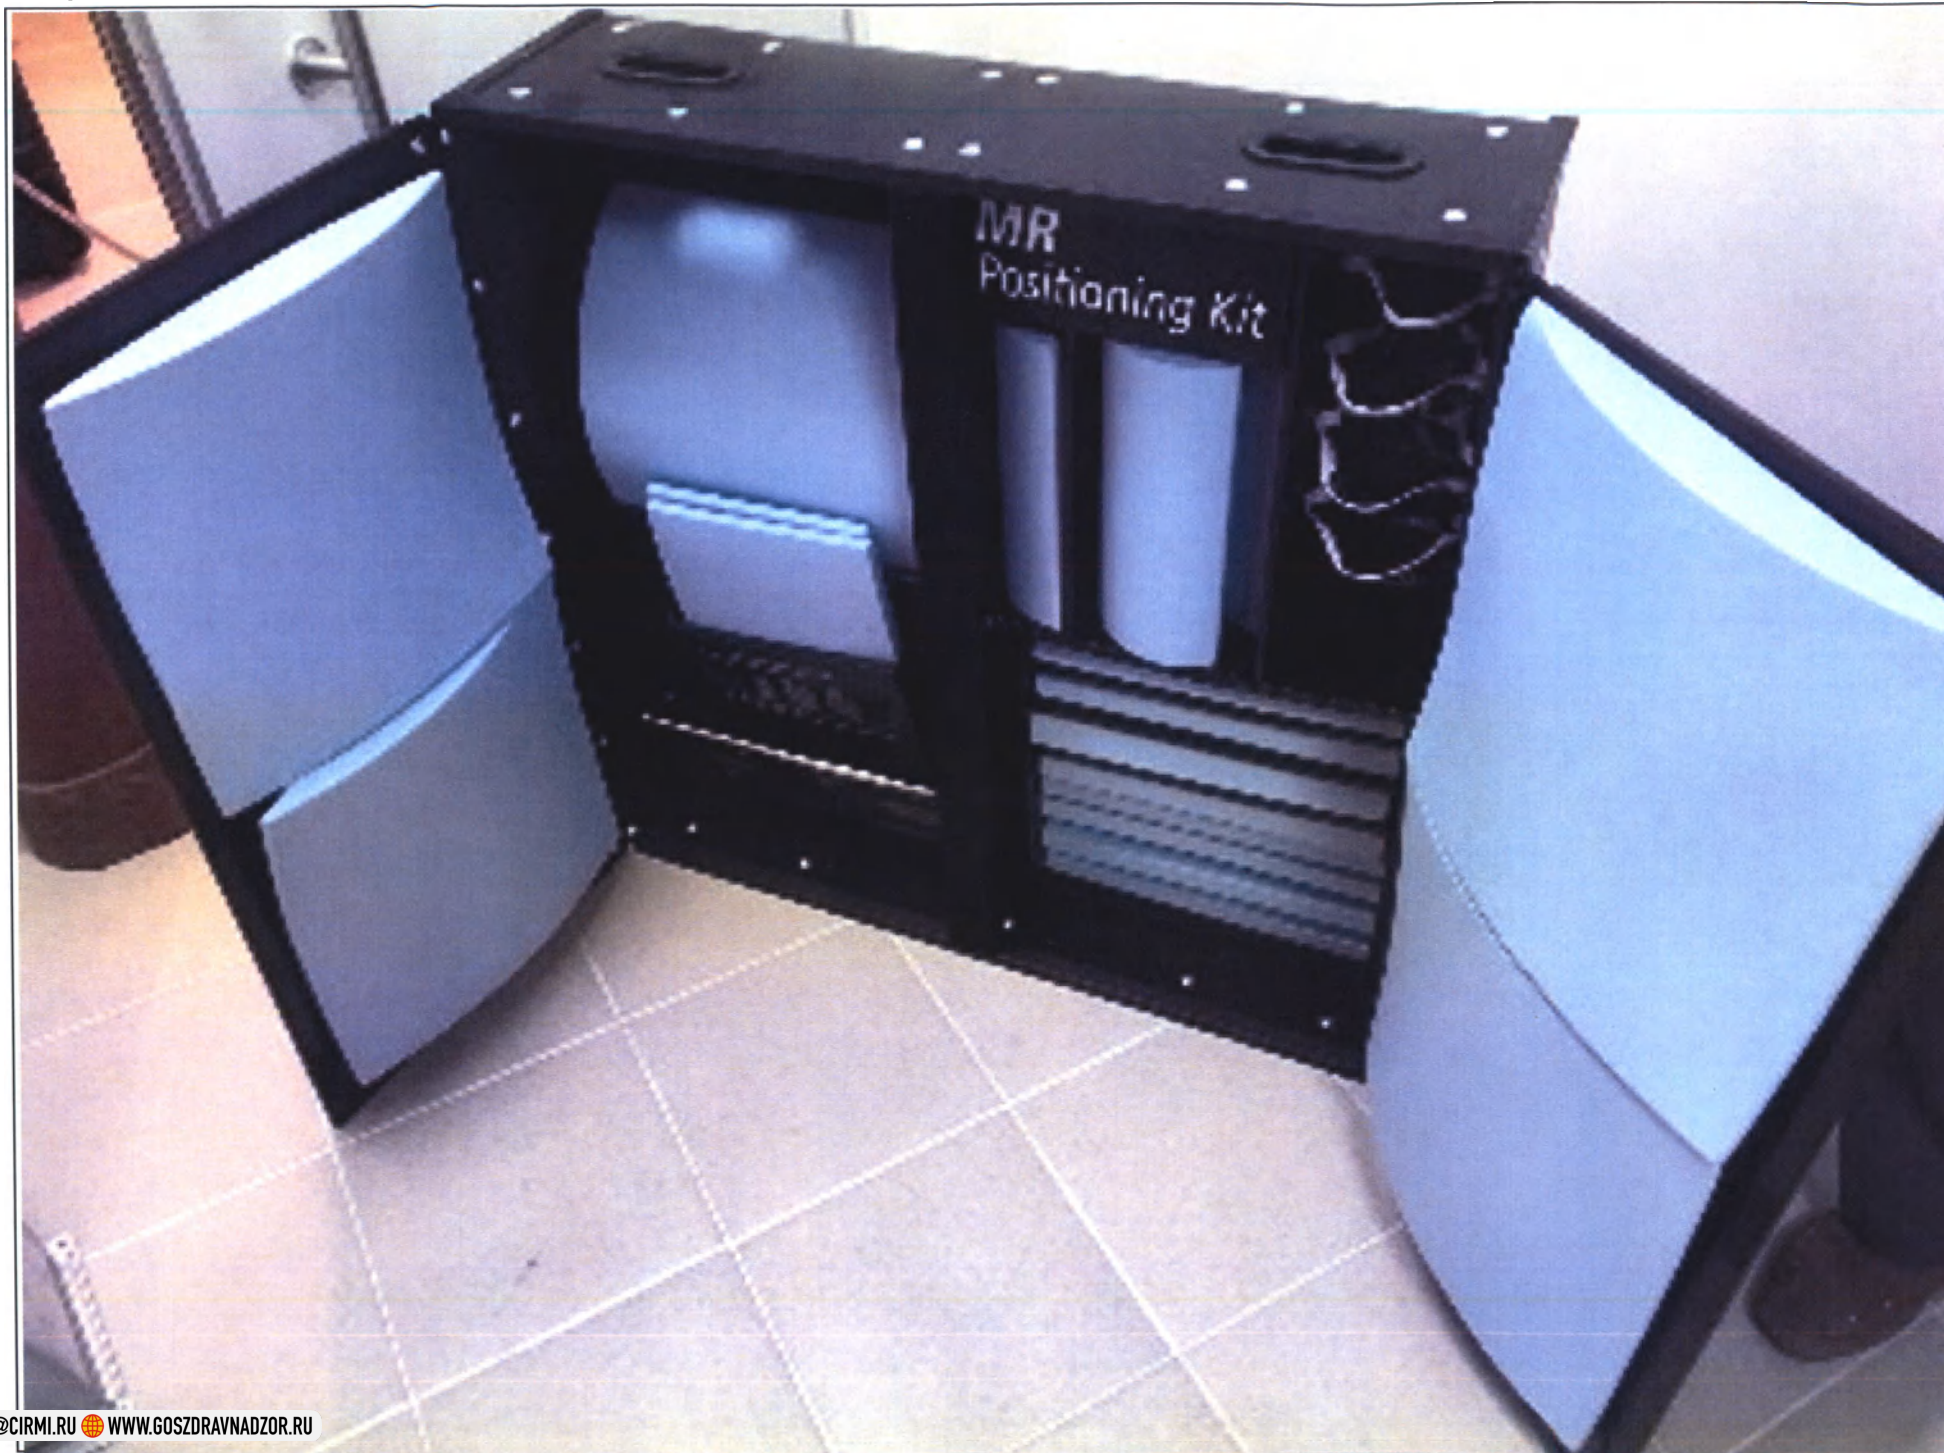

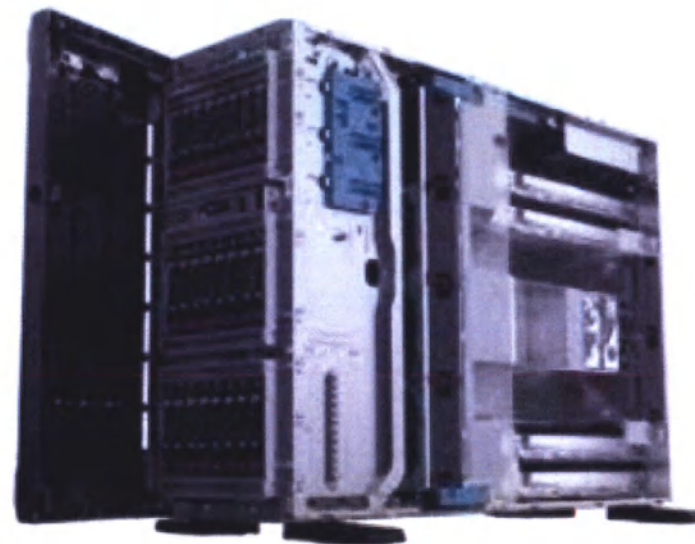

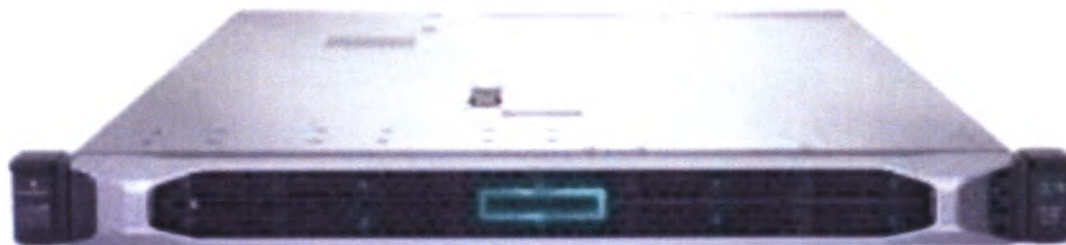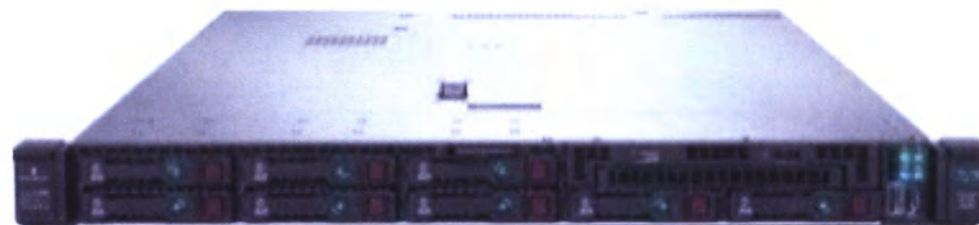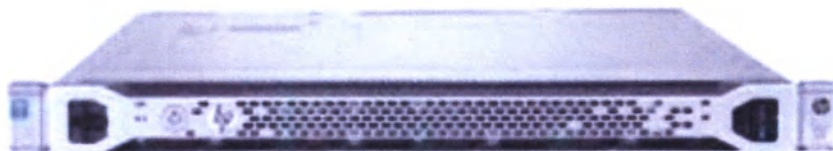



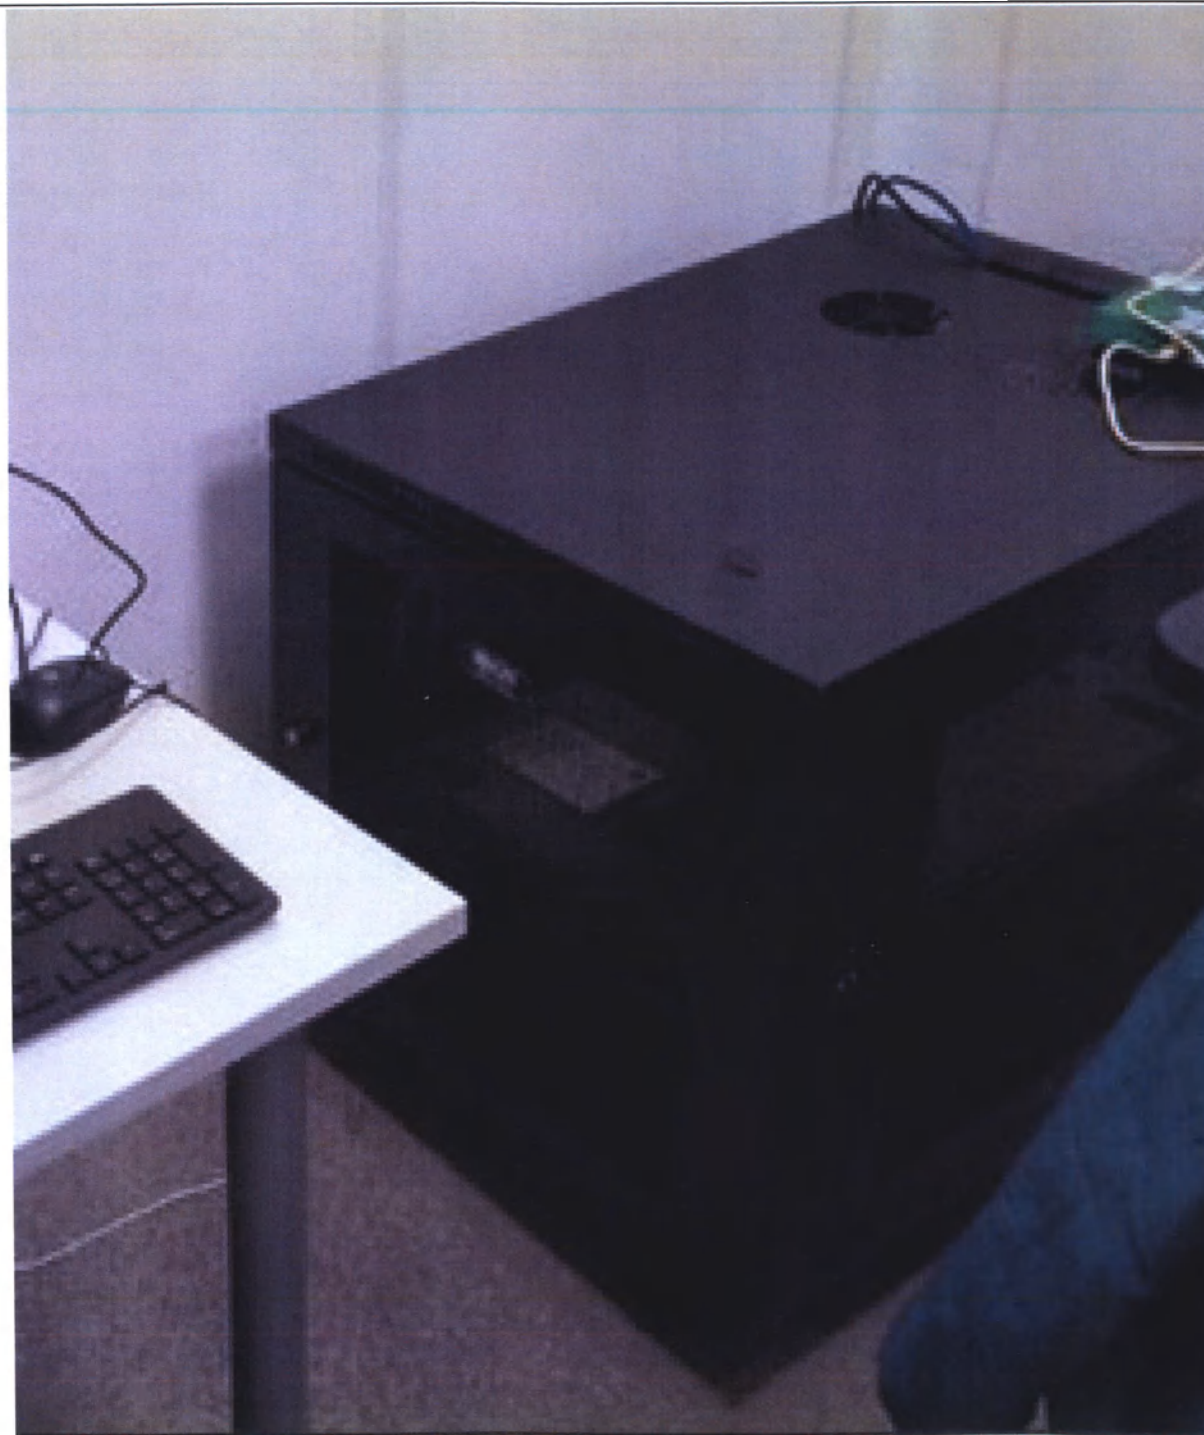















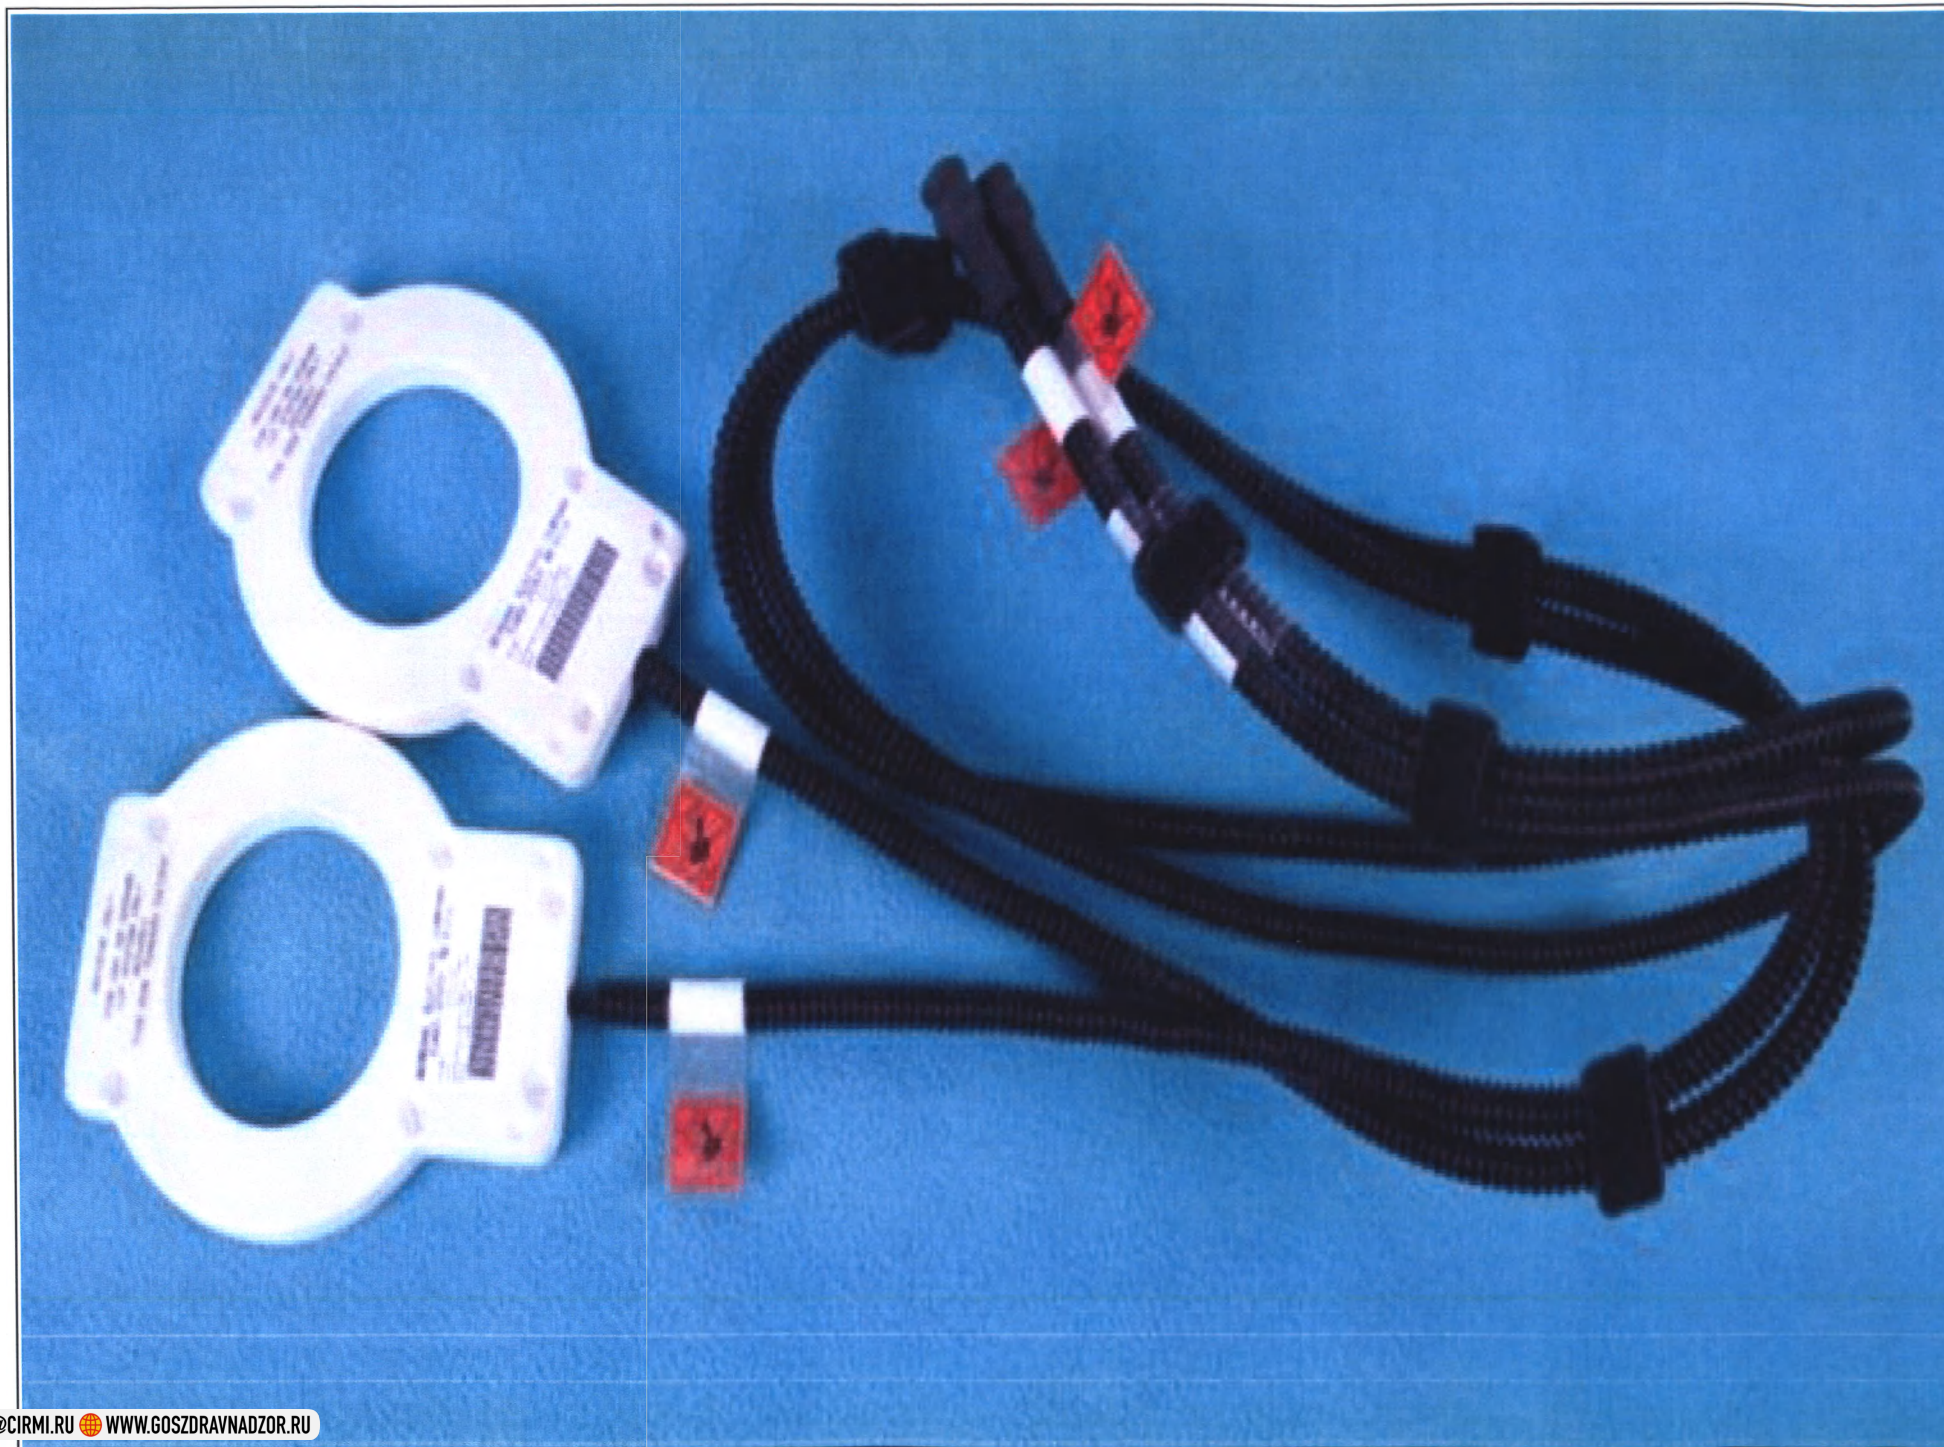

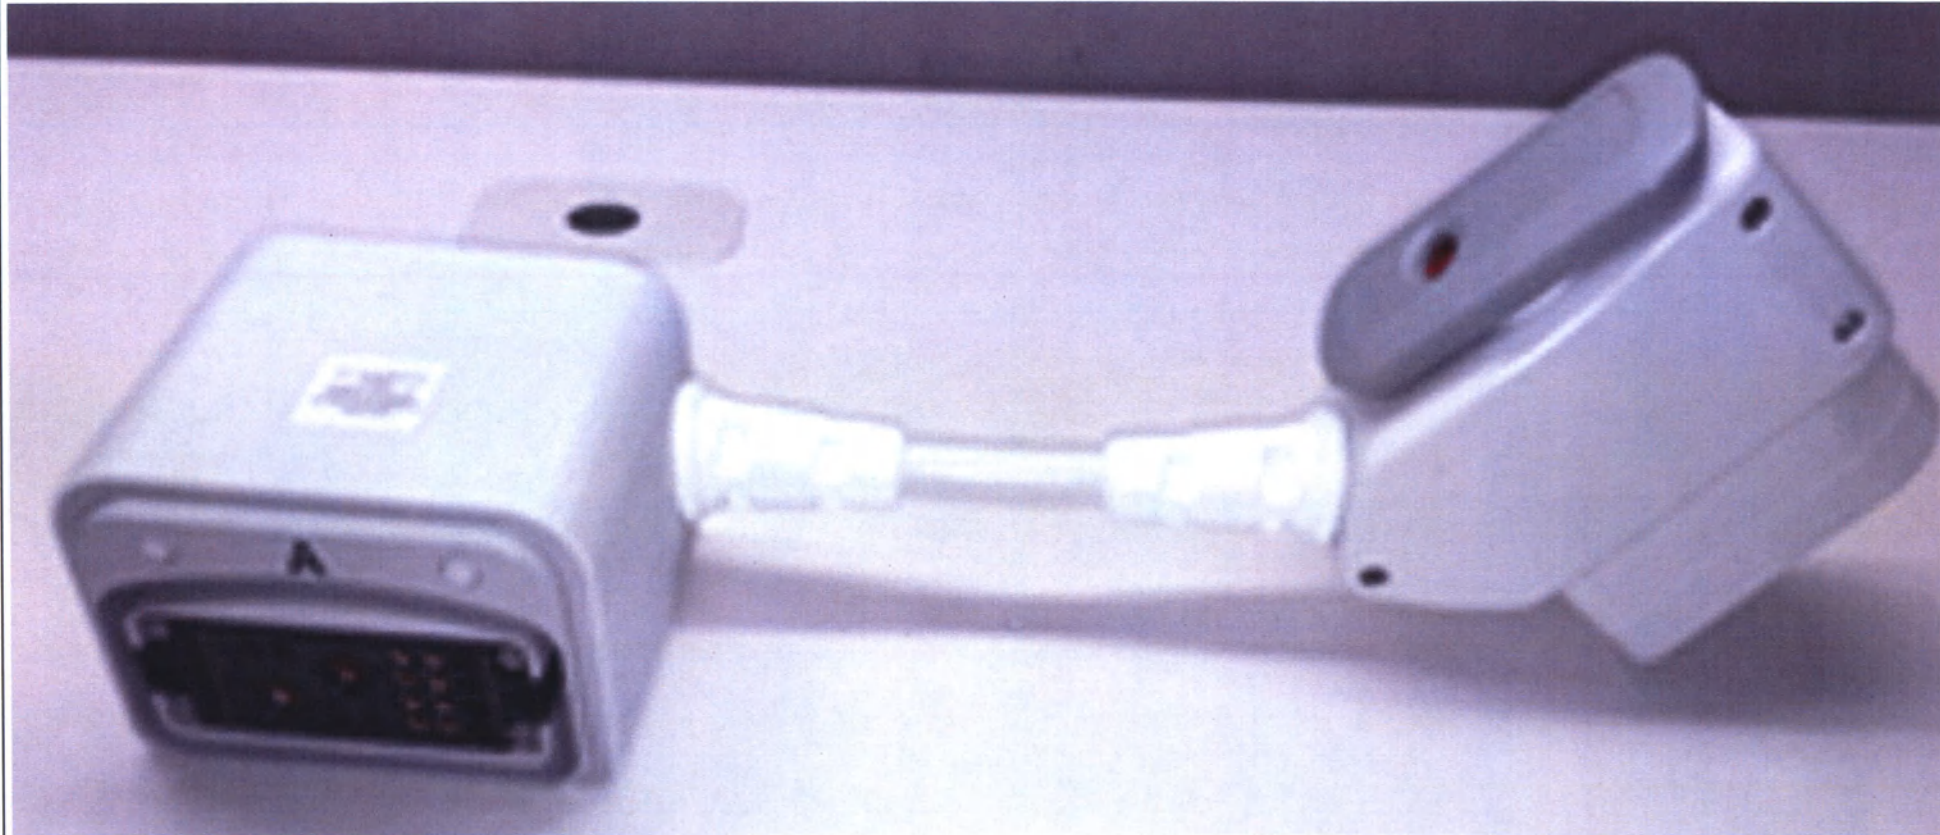












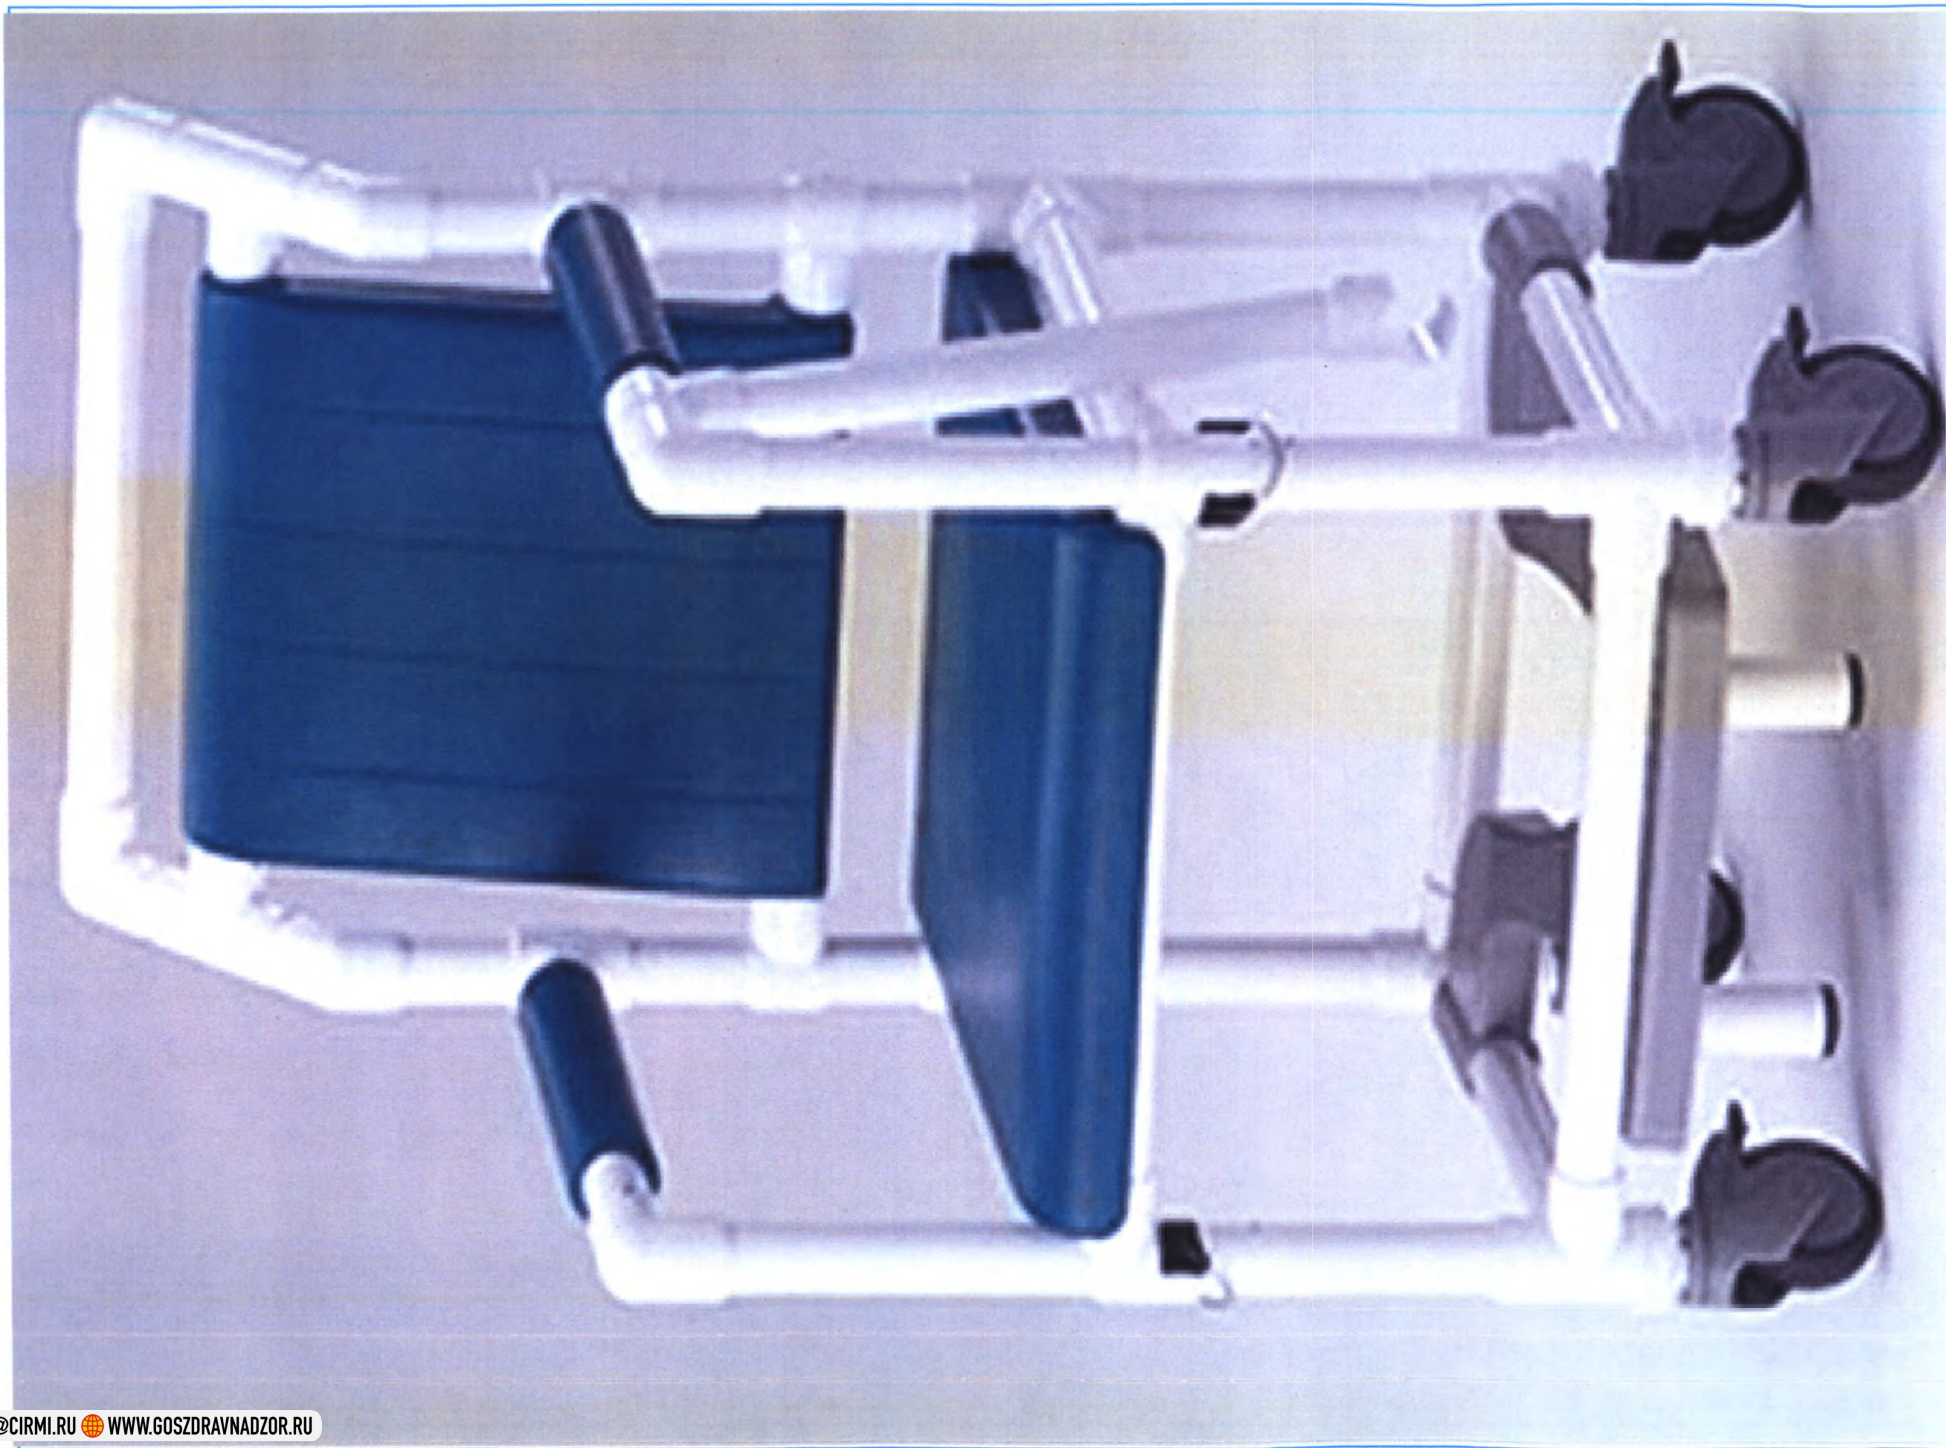














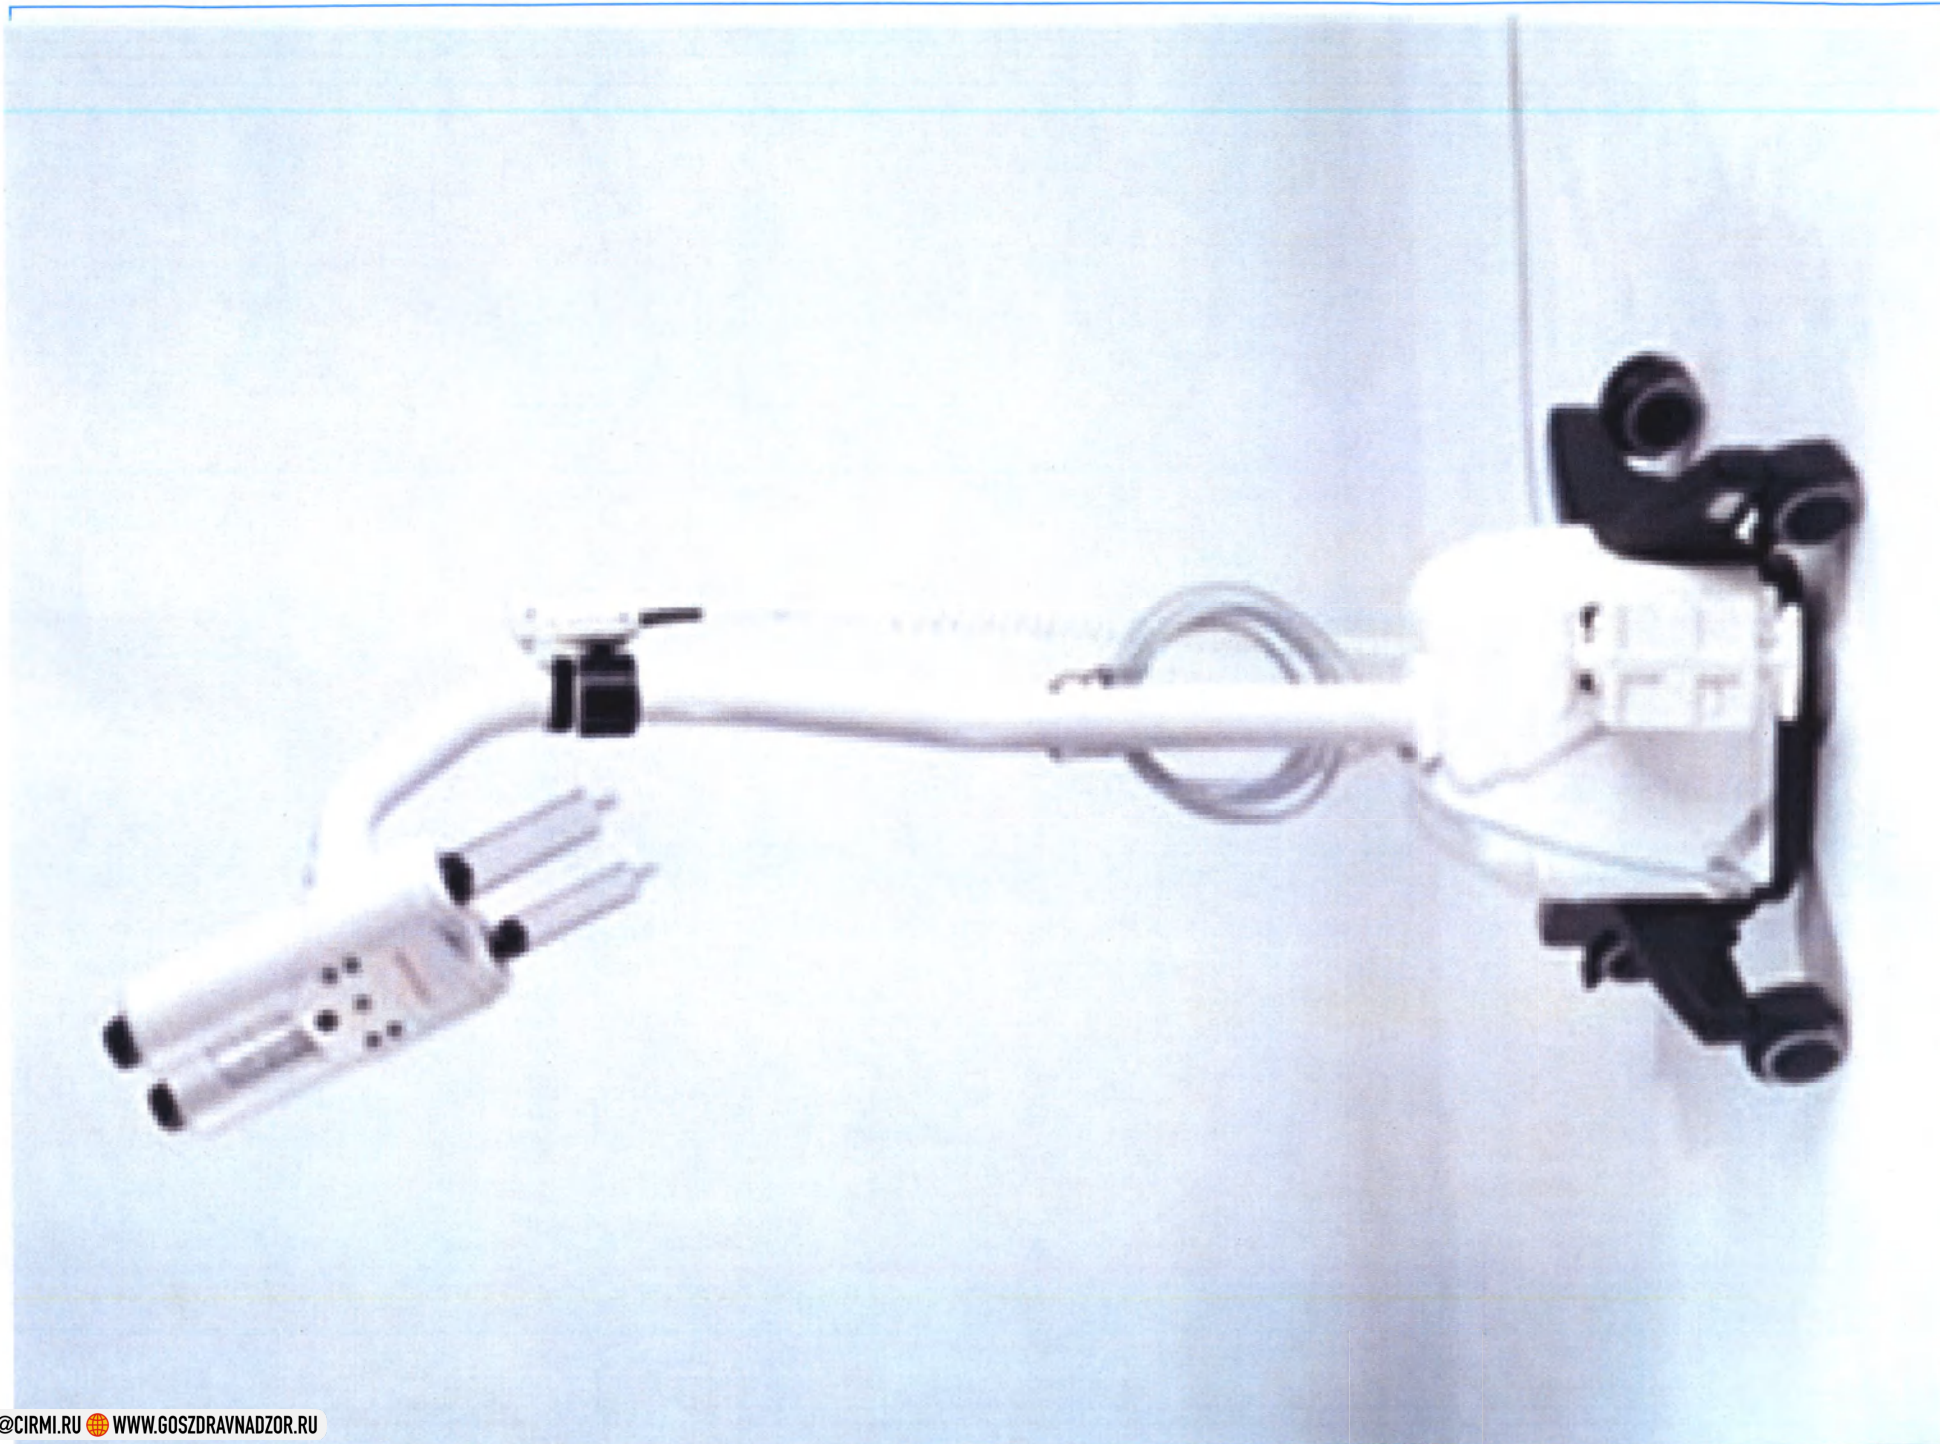



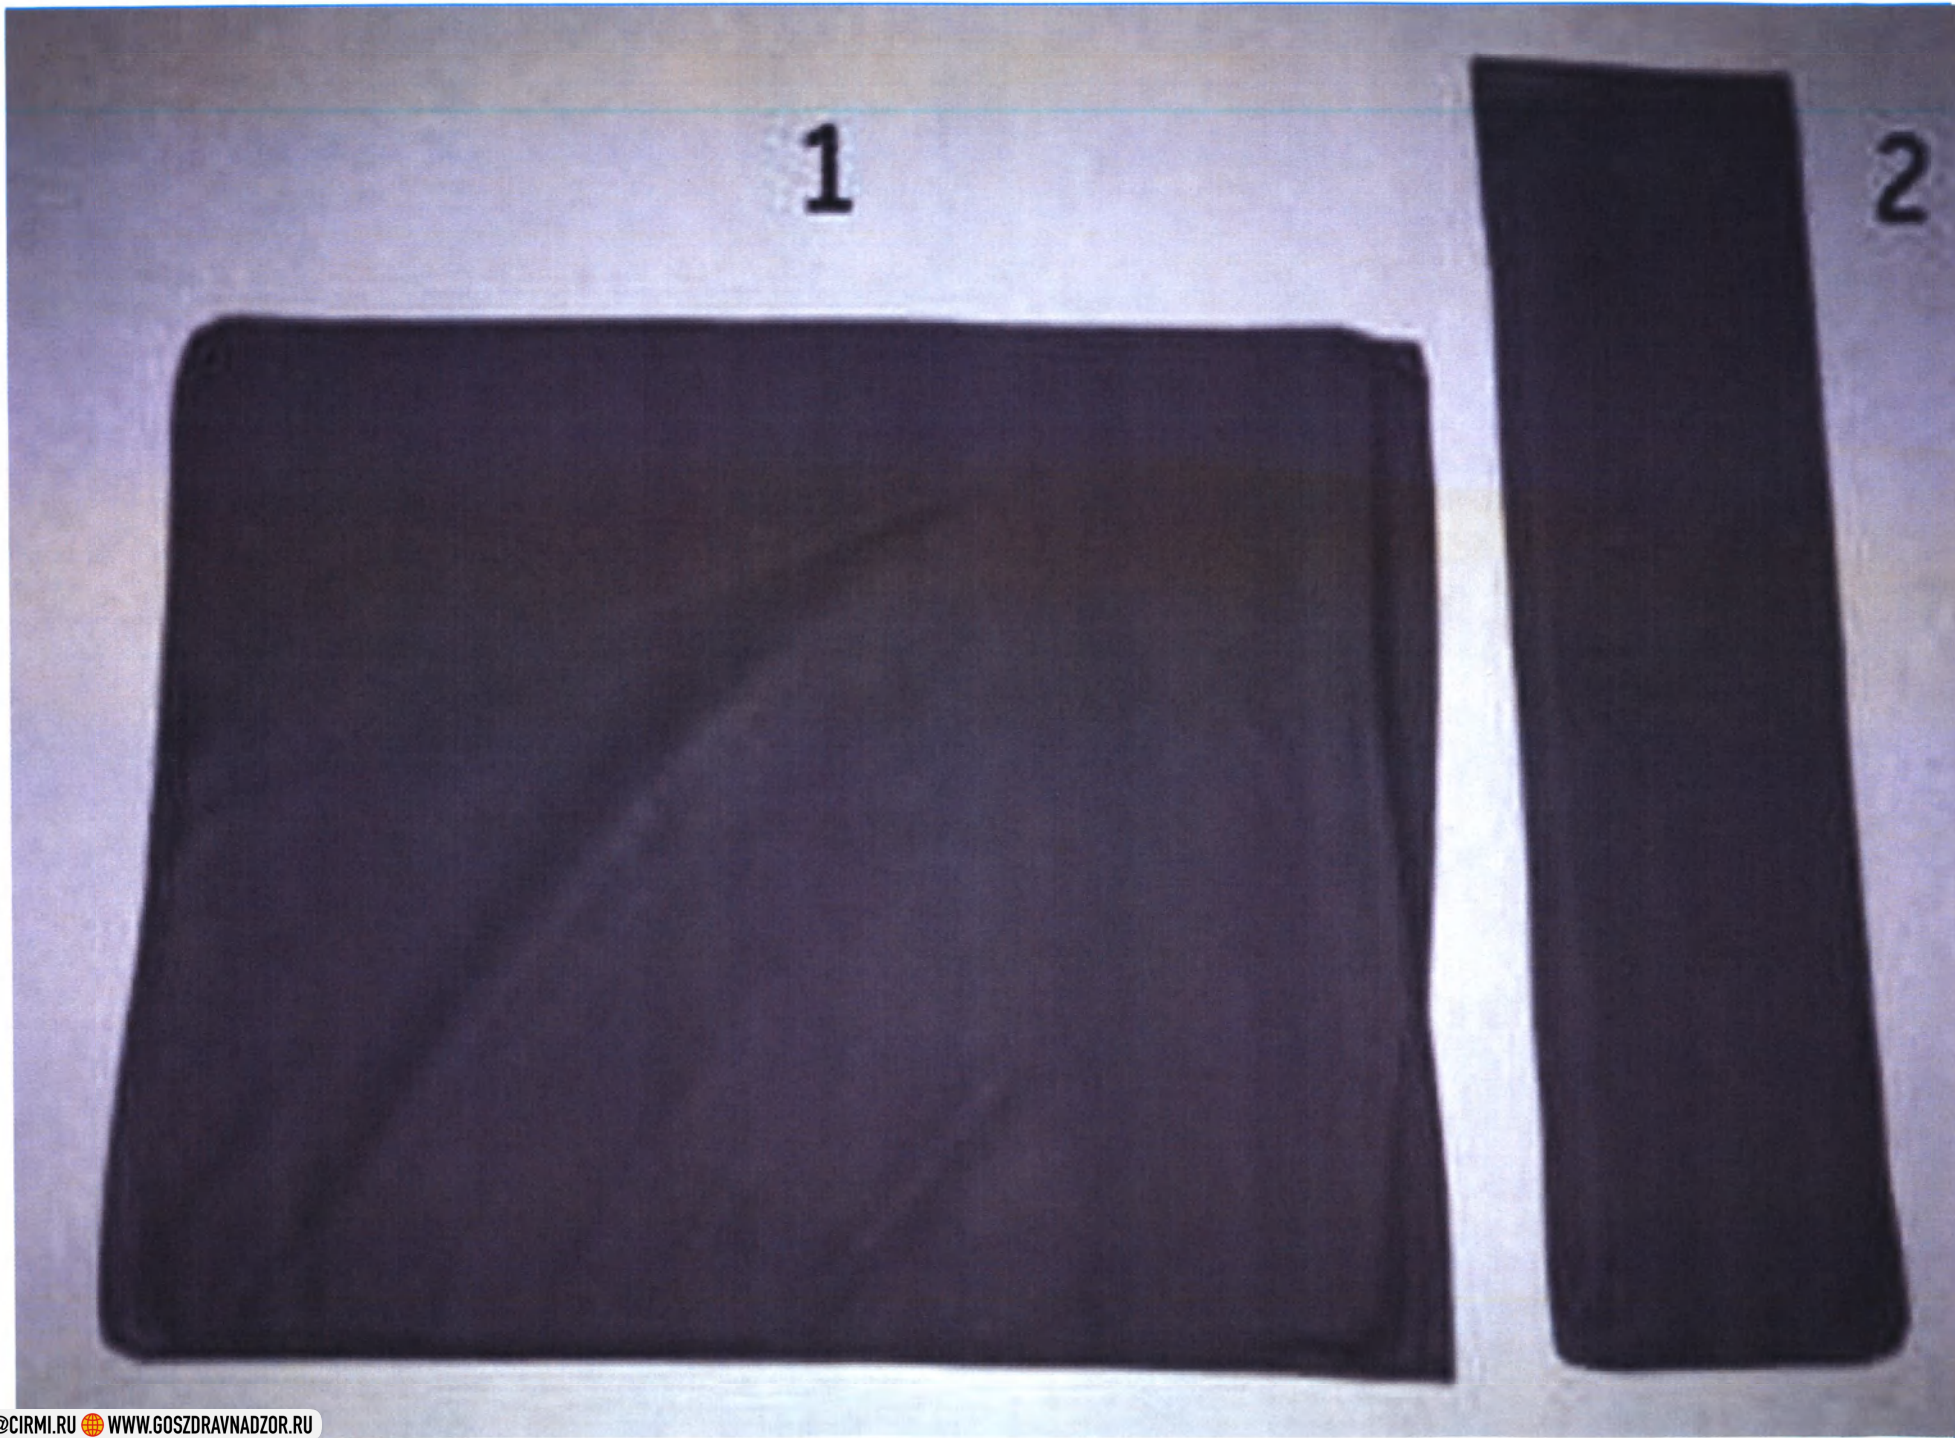

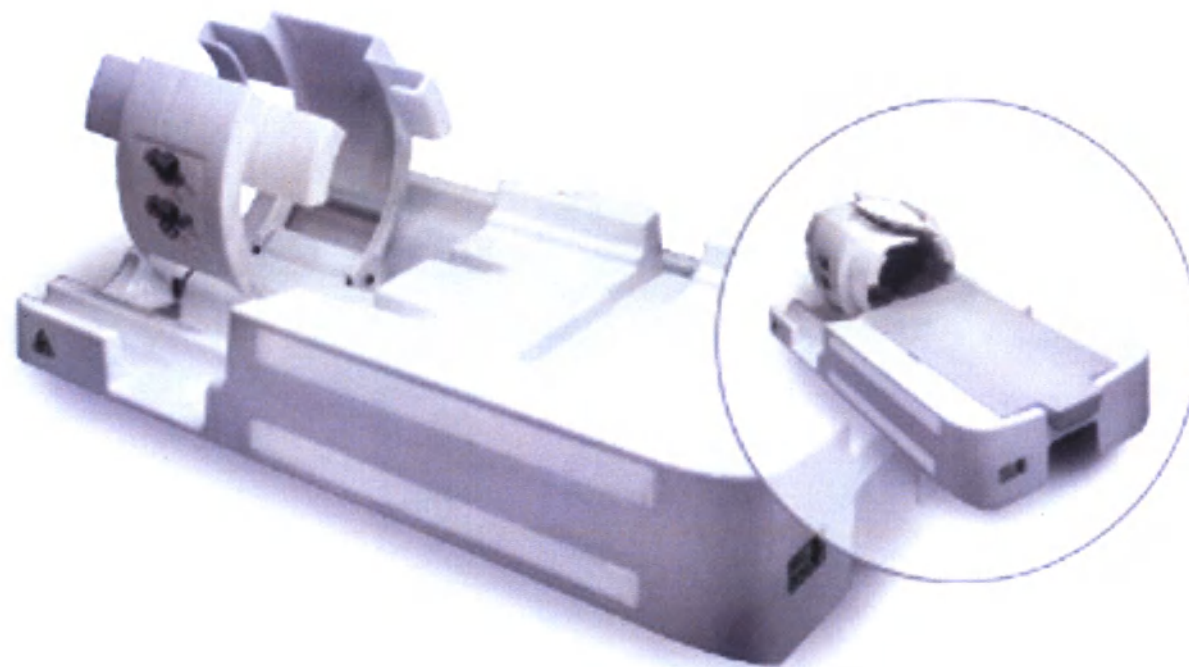










Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея)

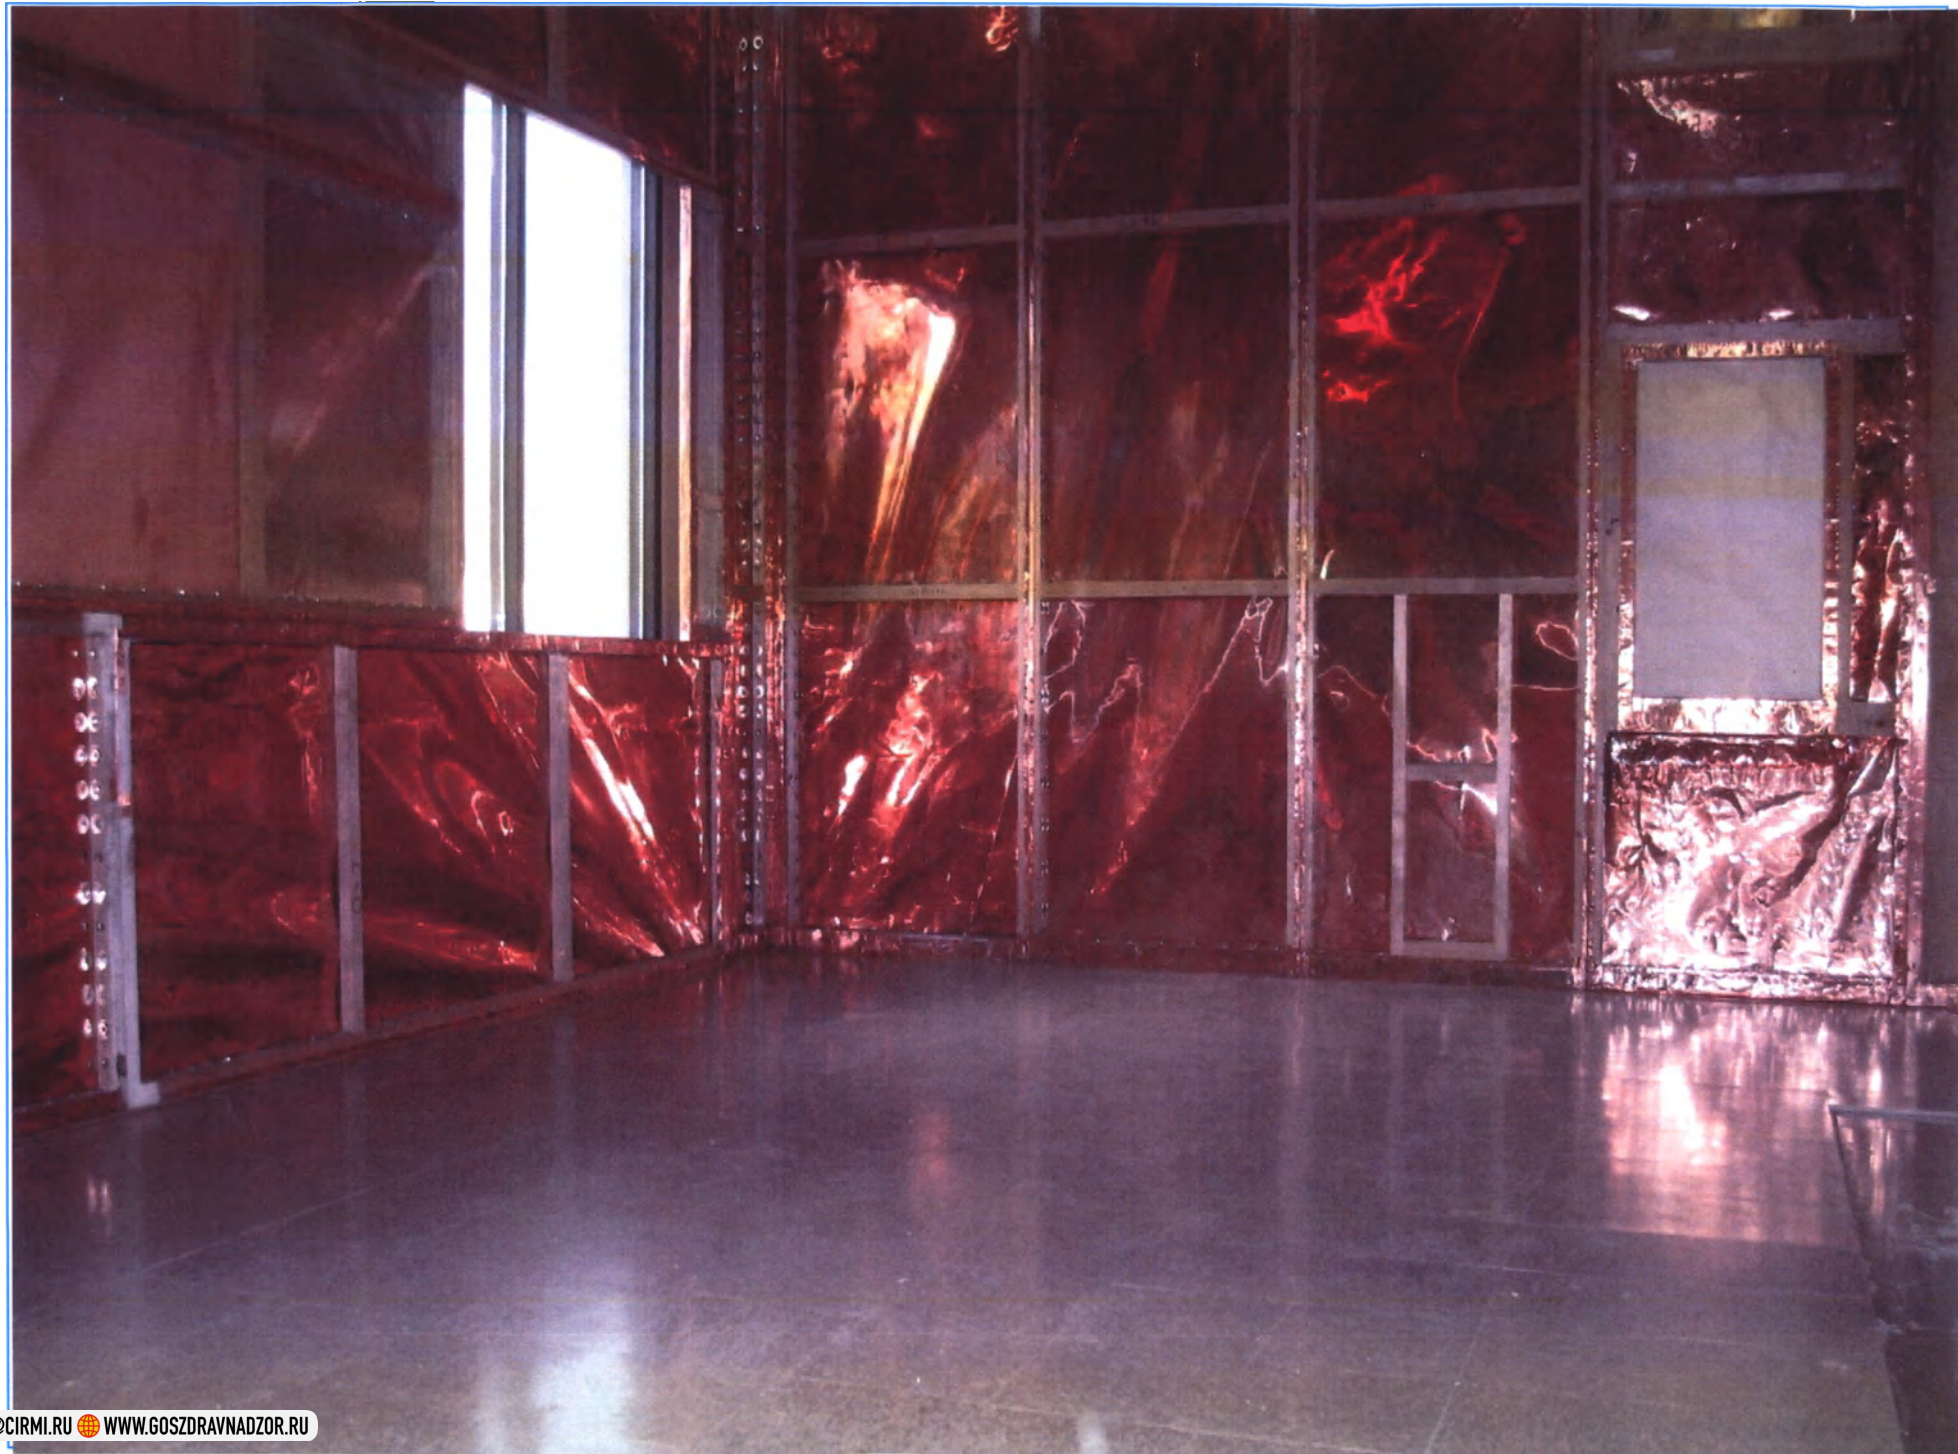











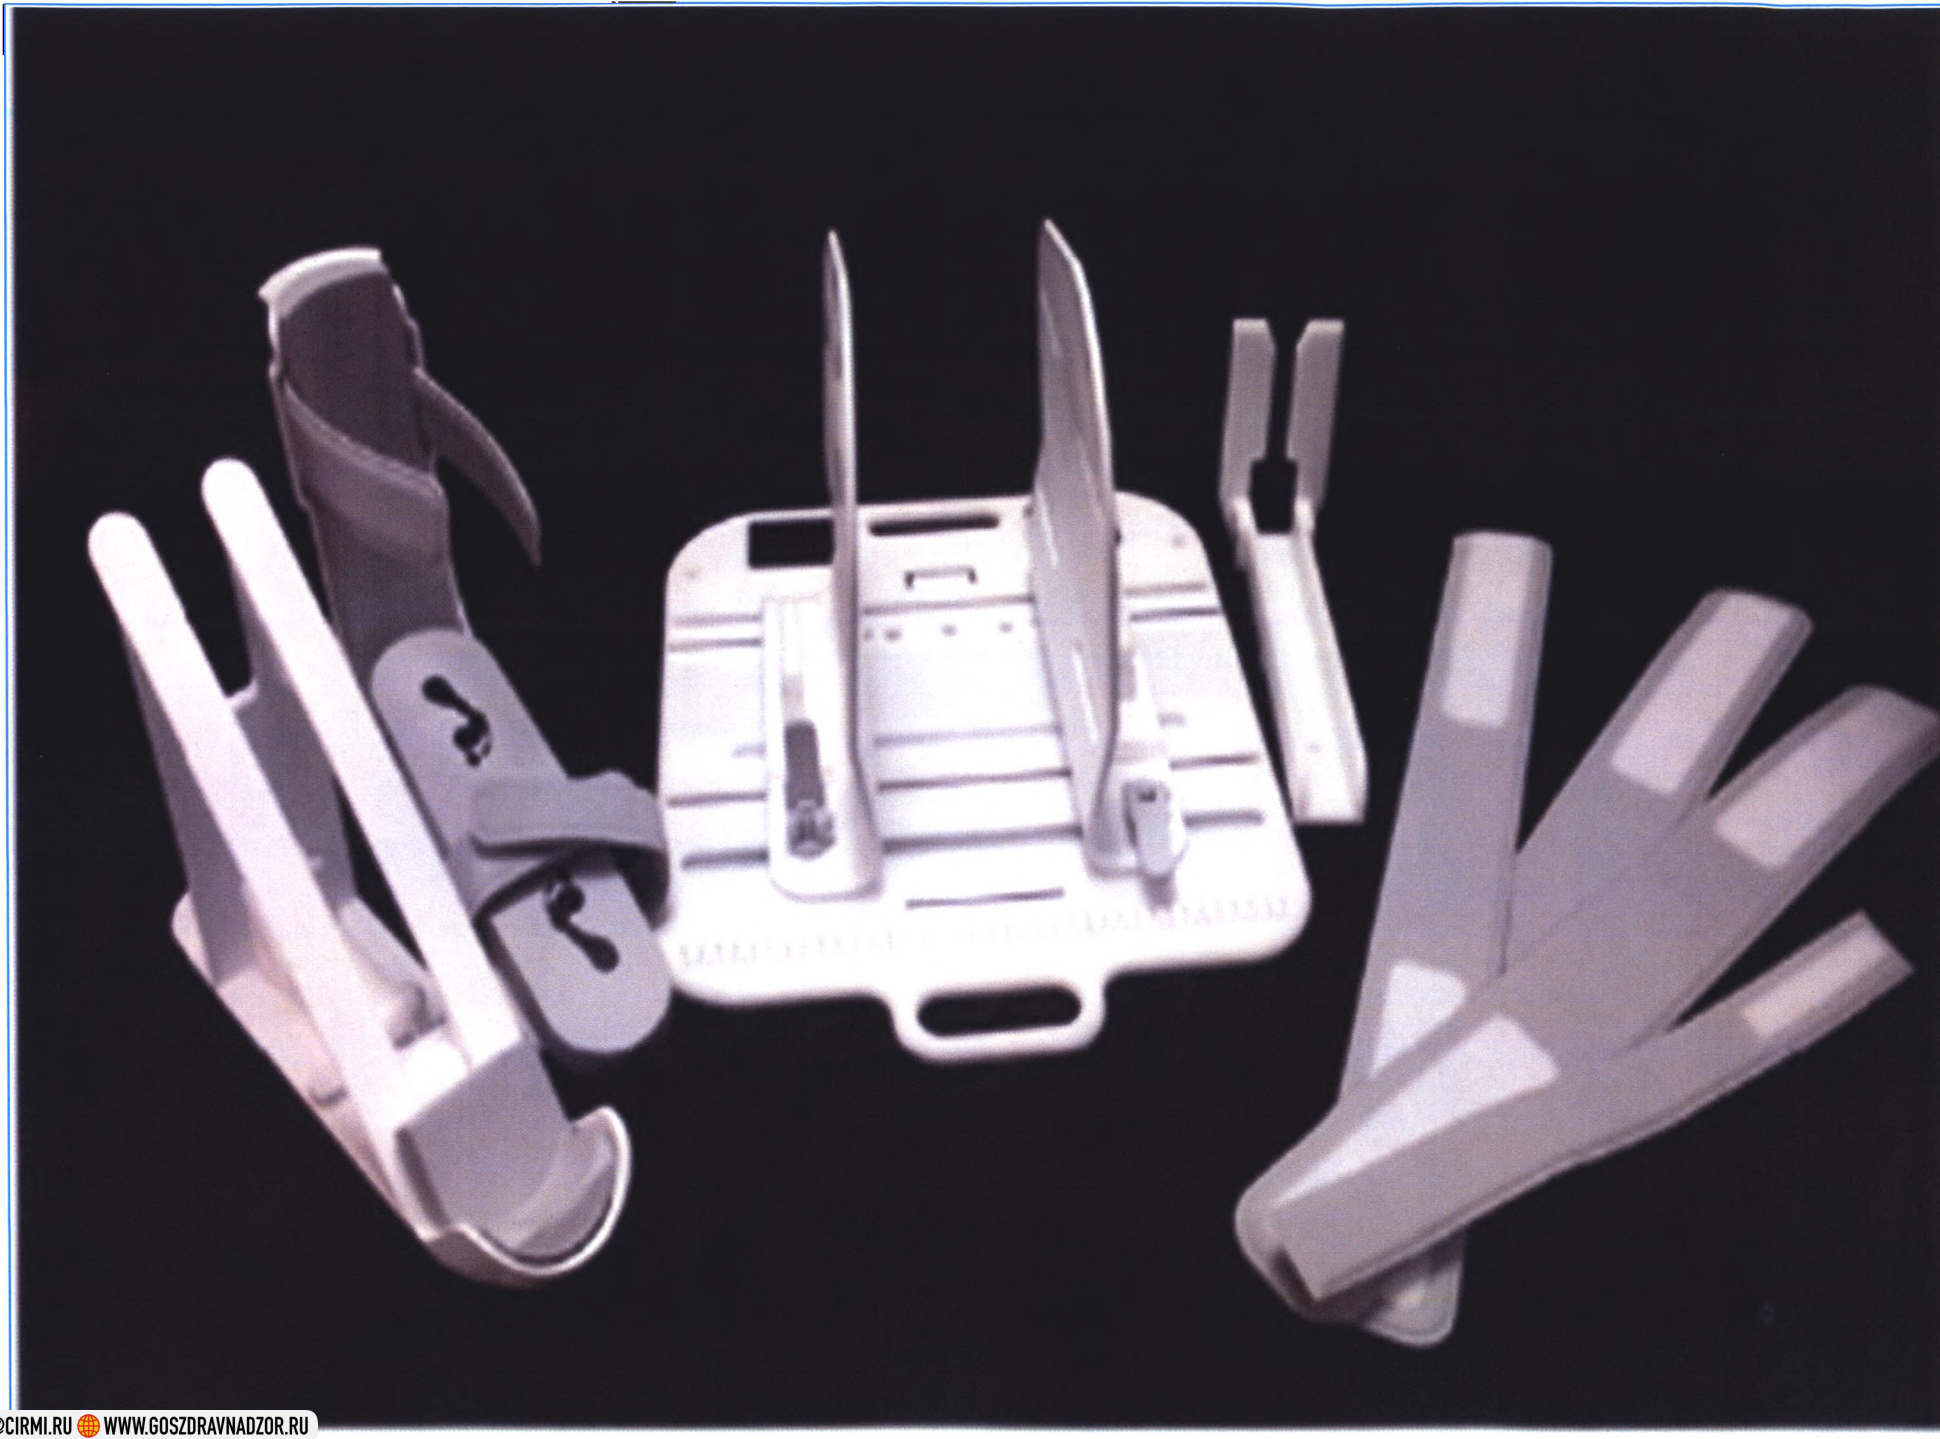


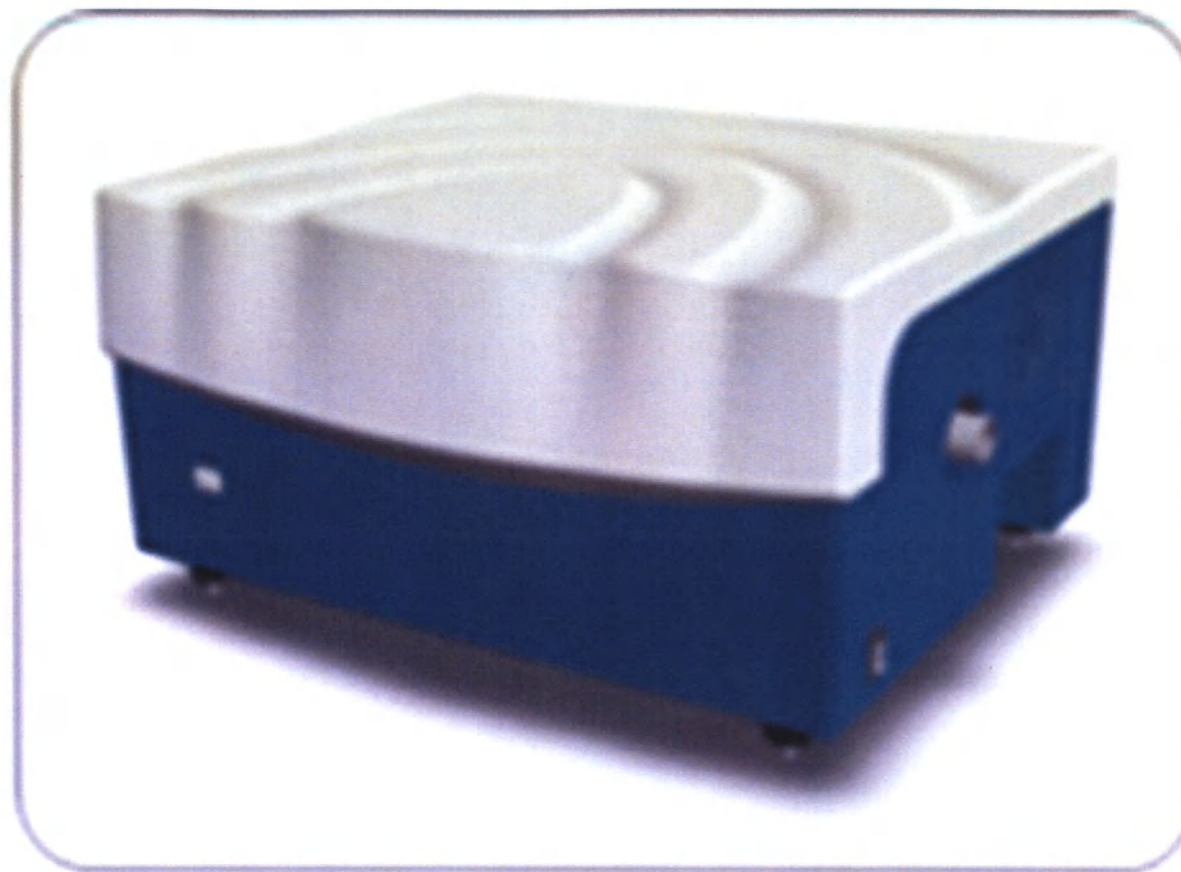






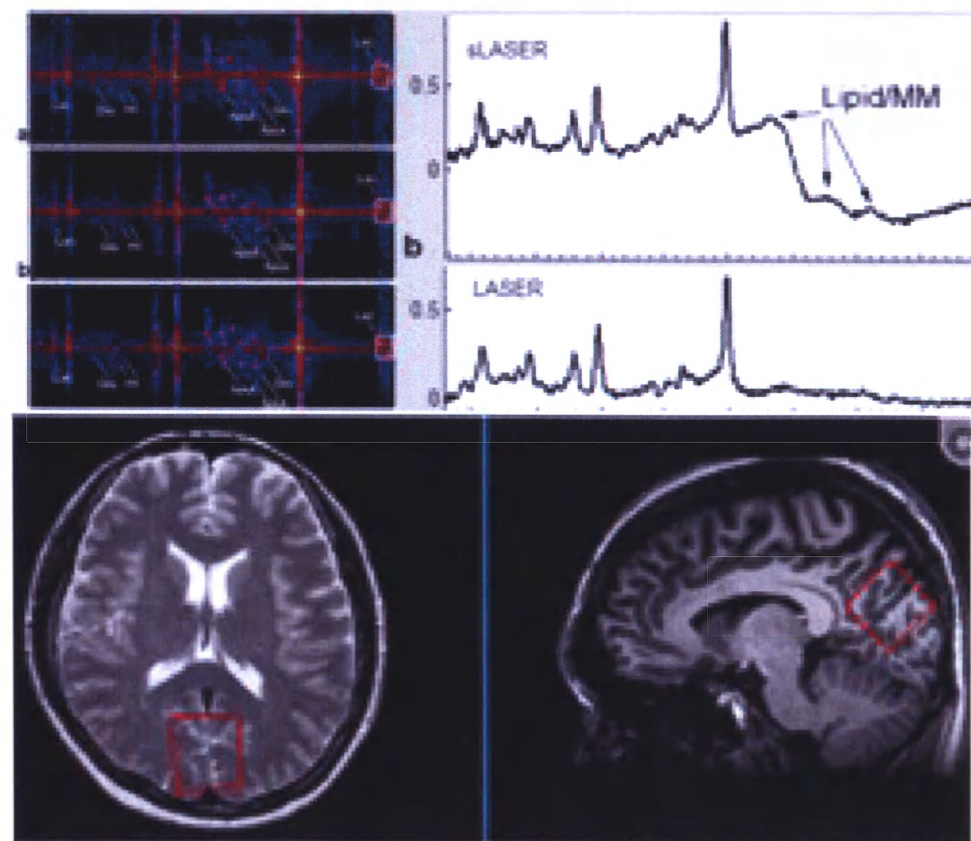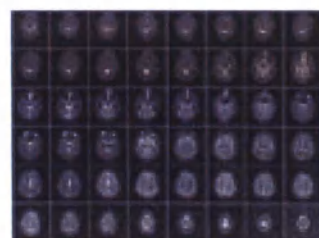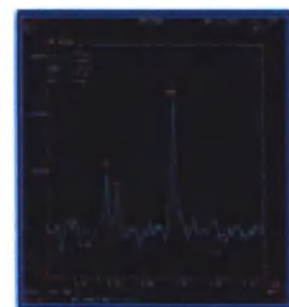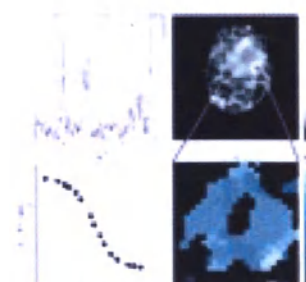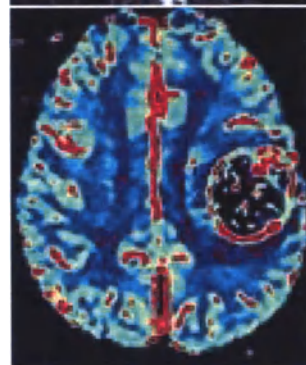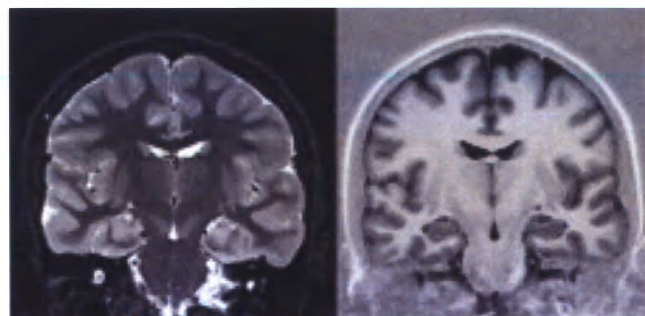


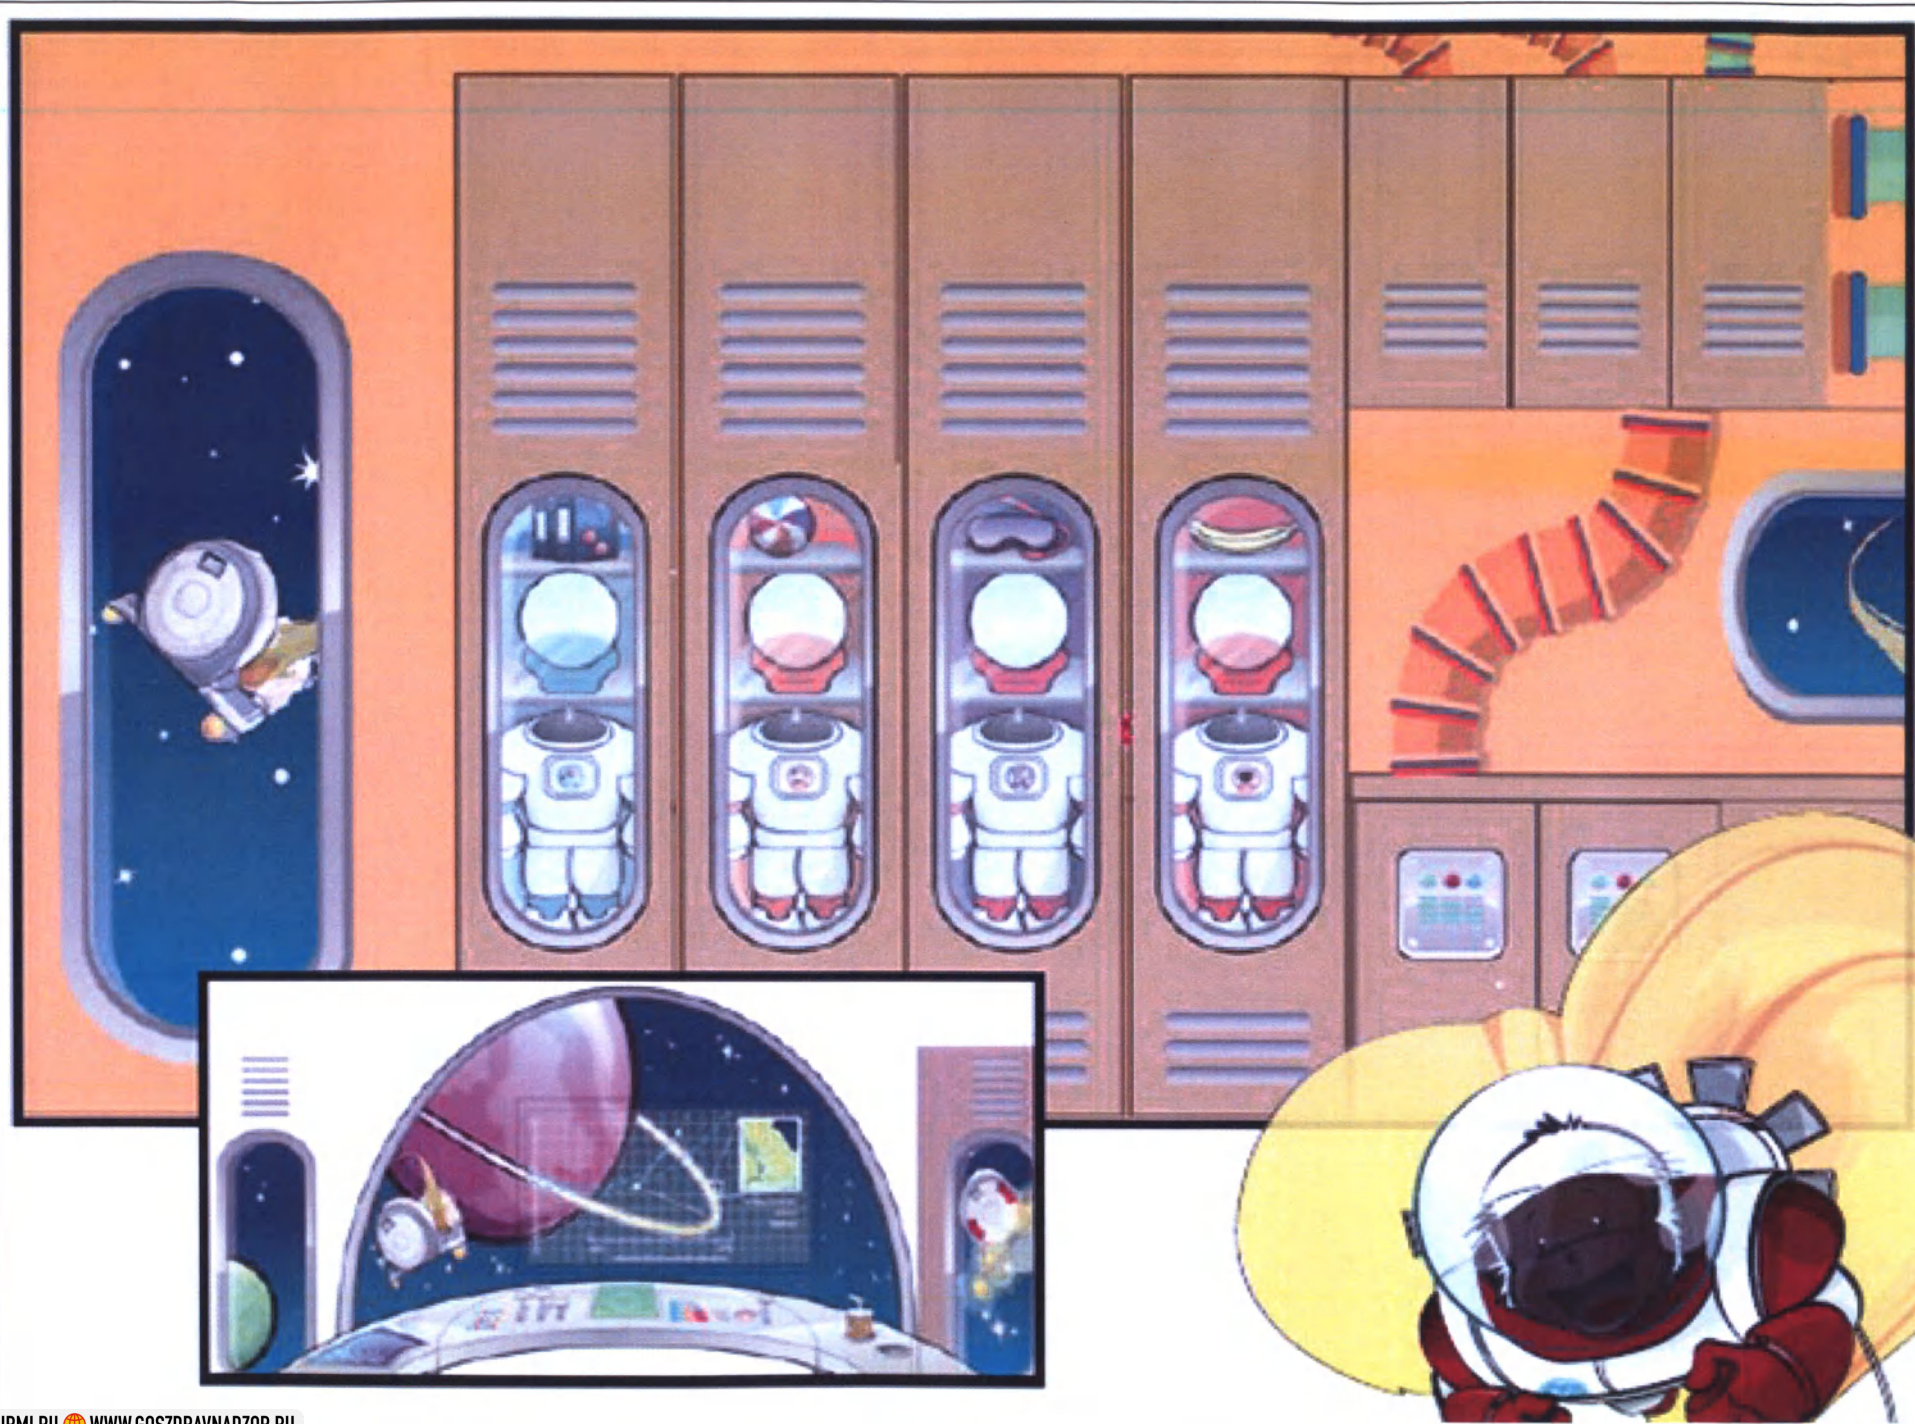




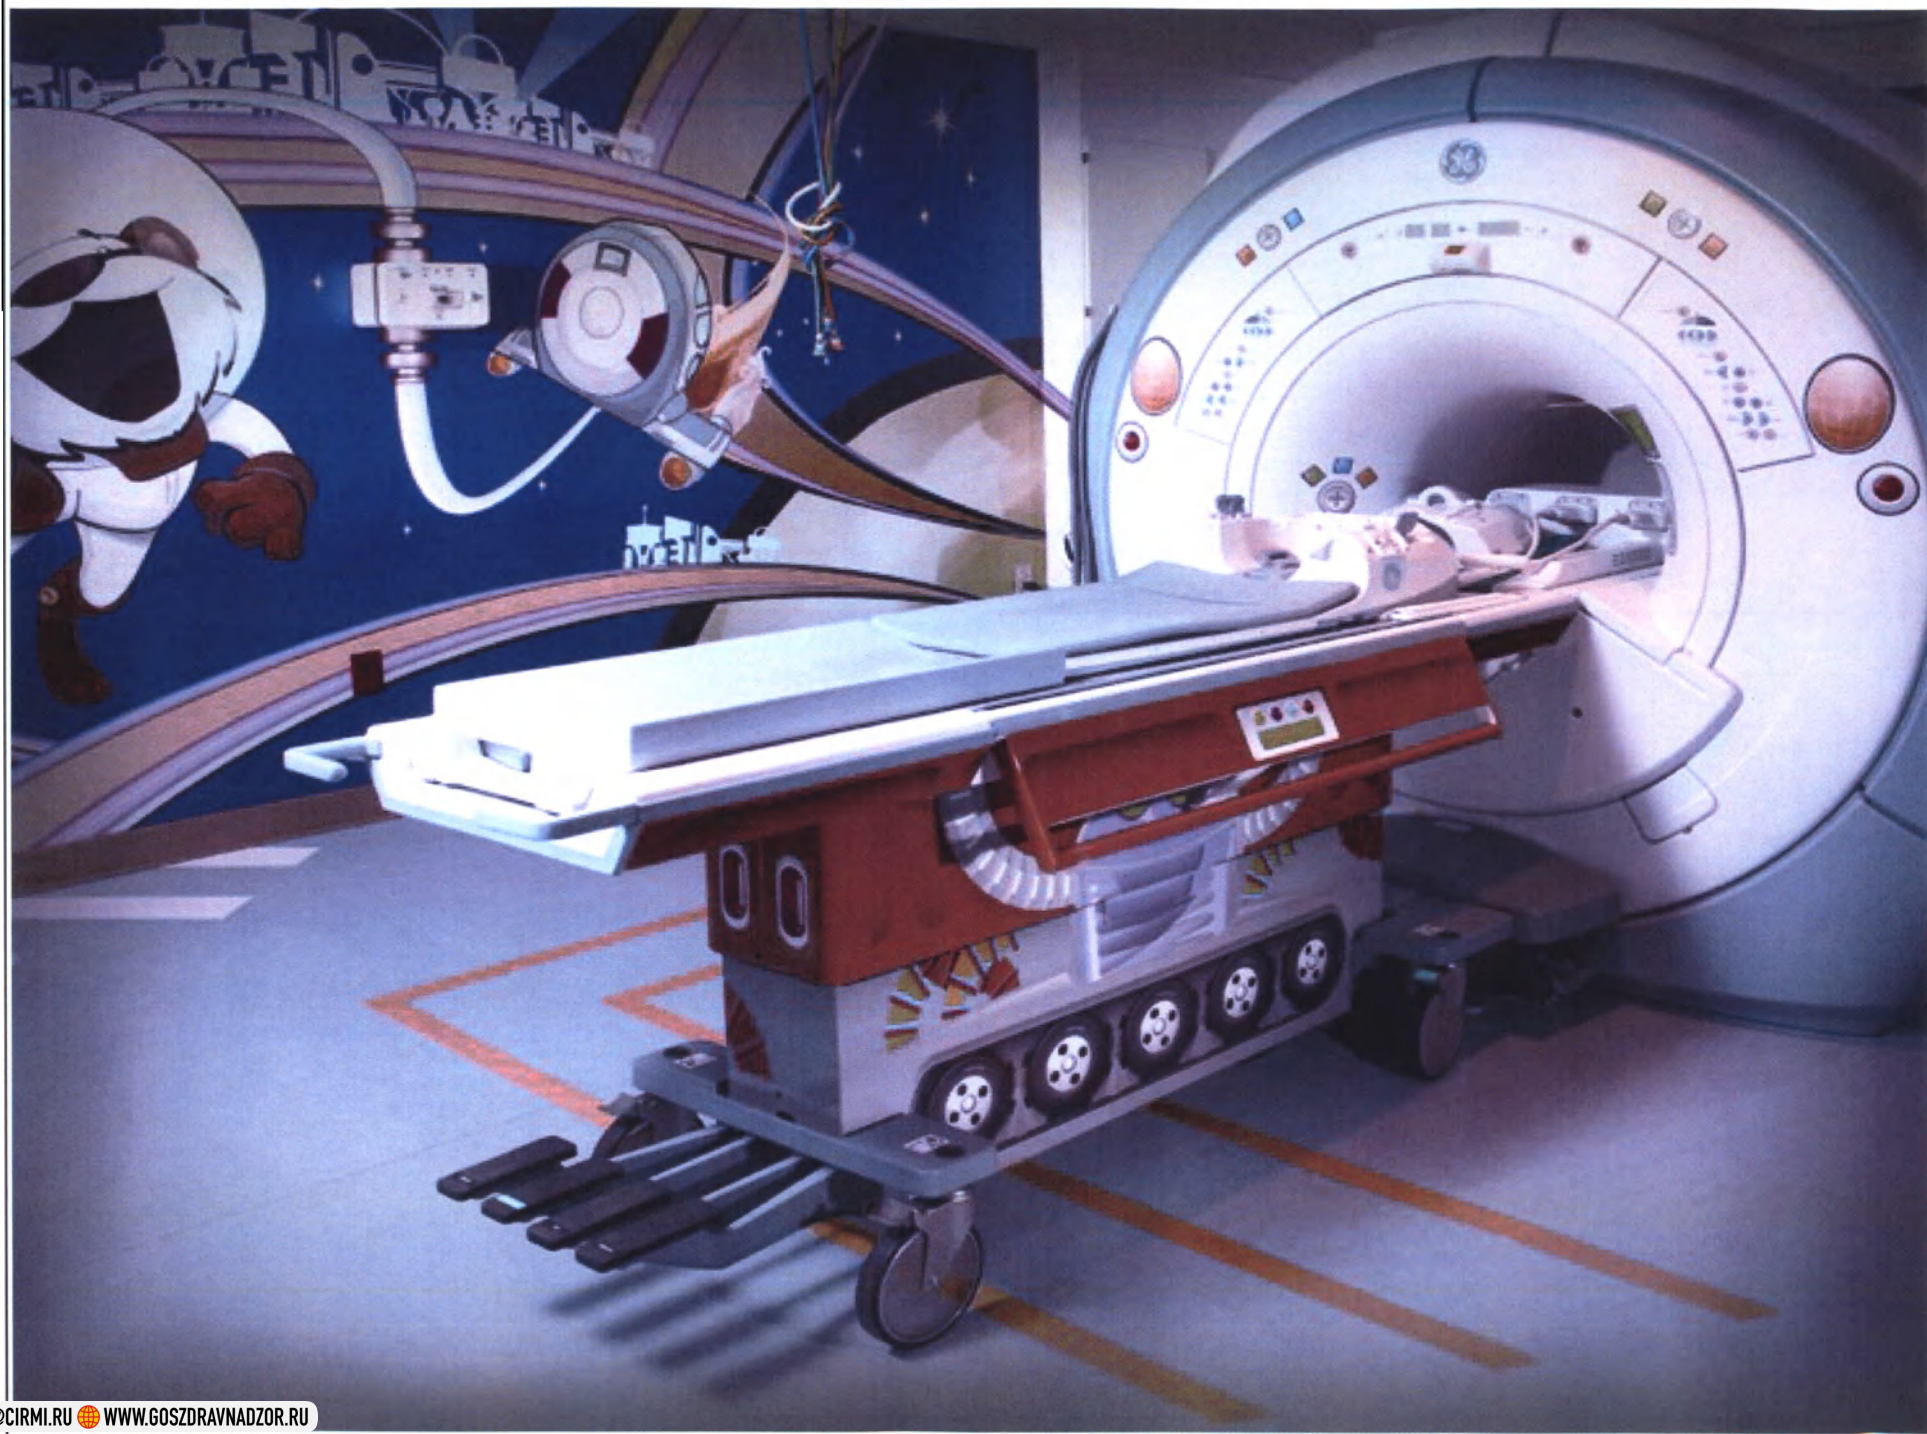



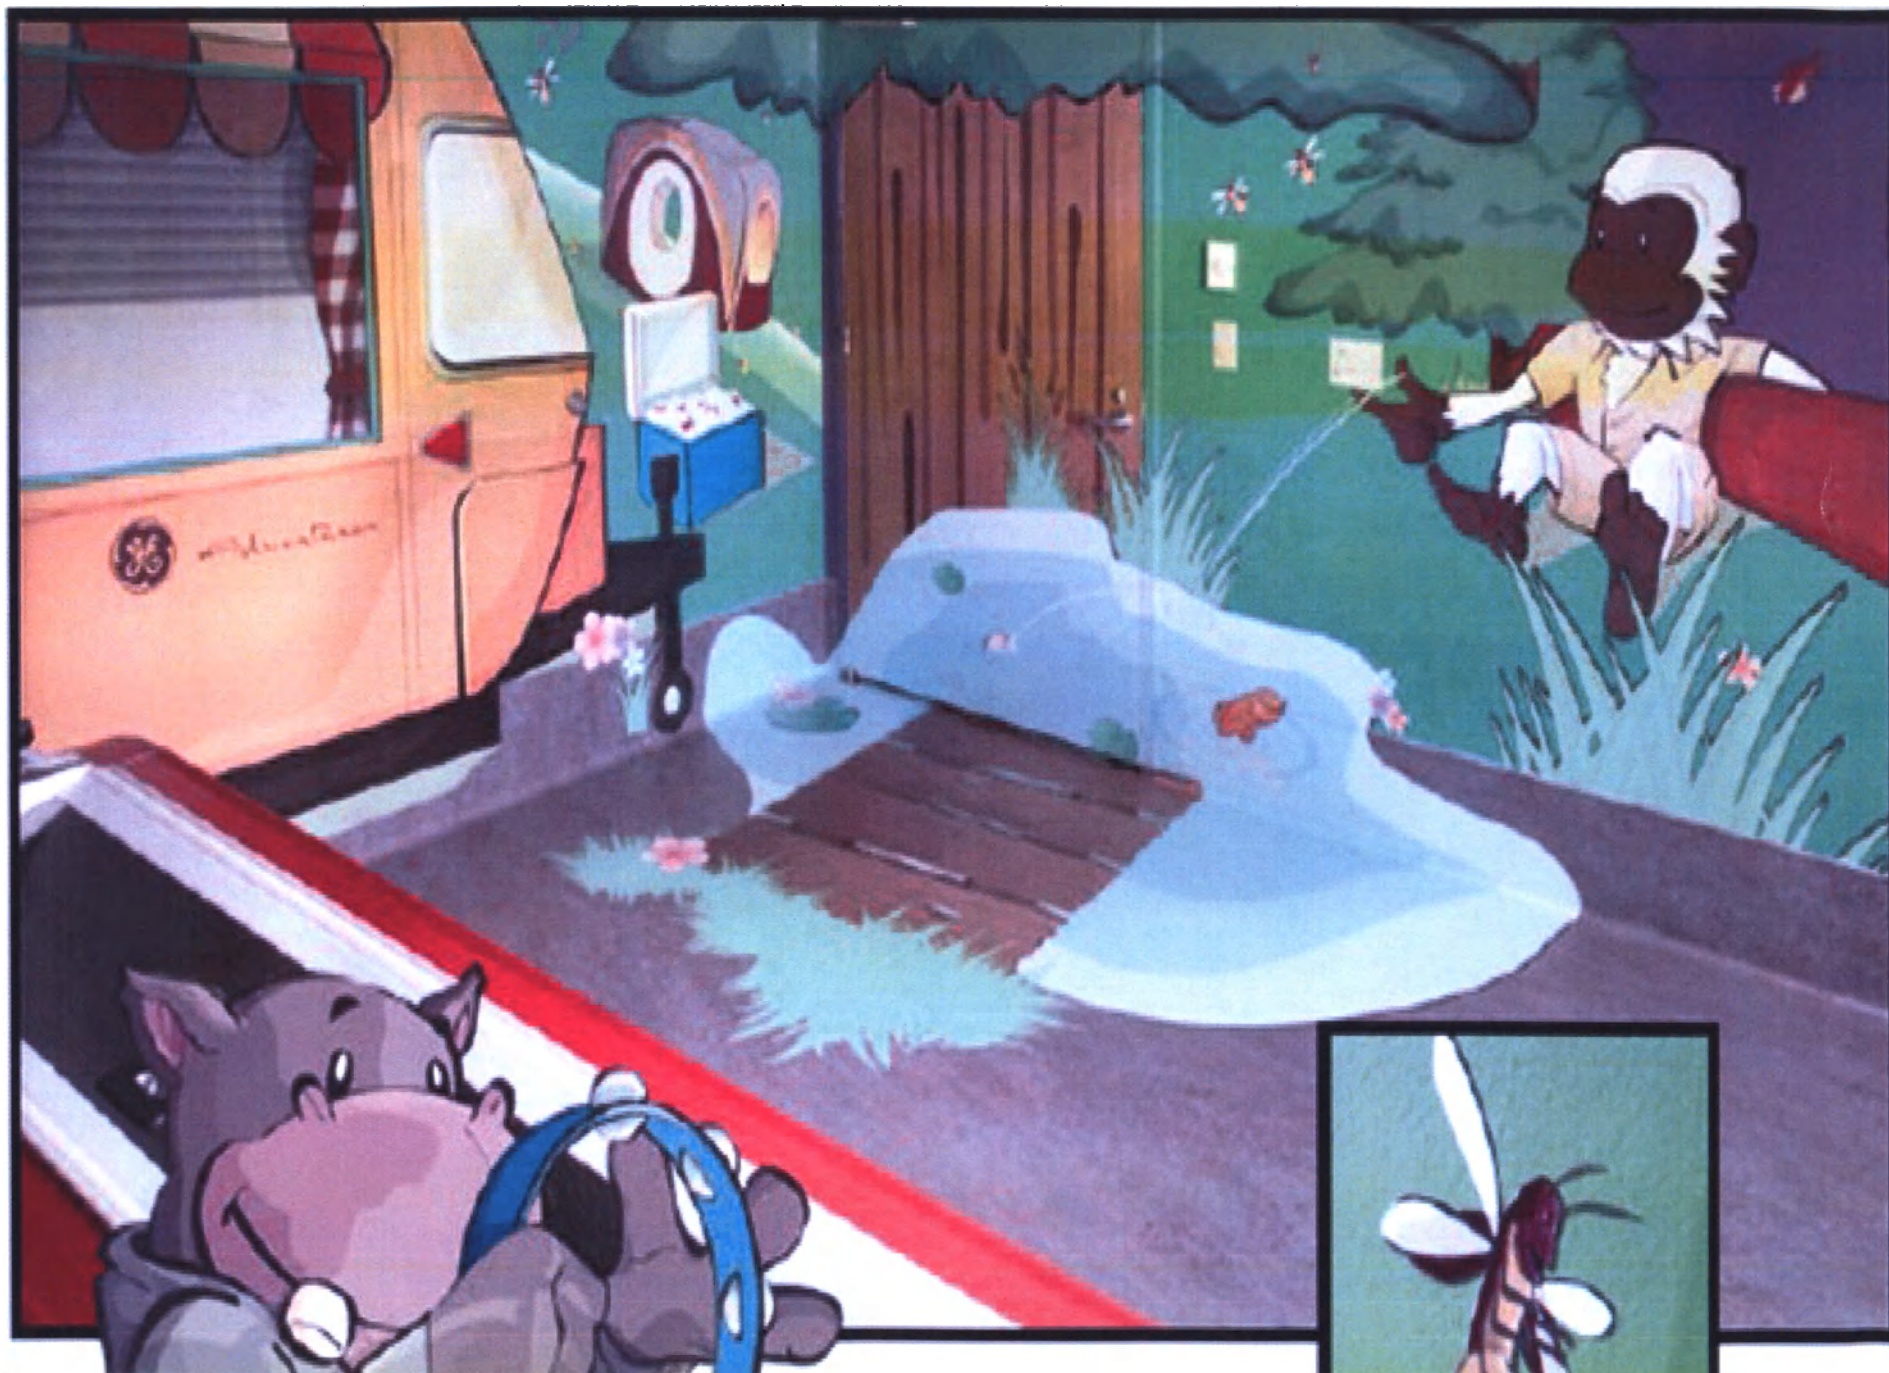

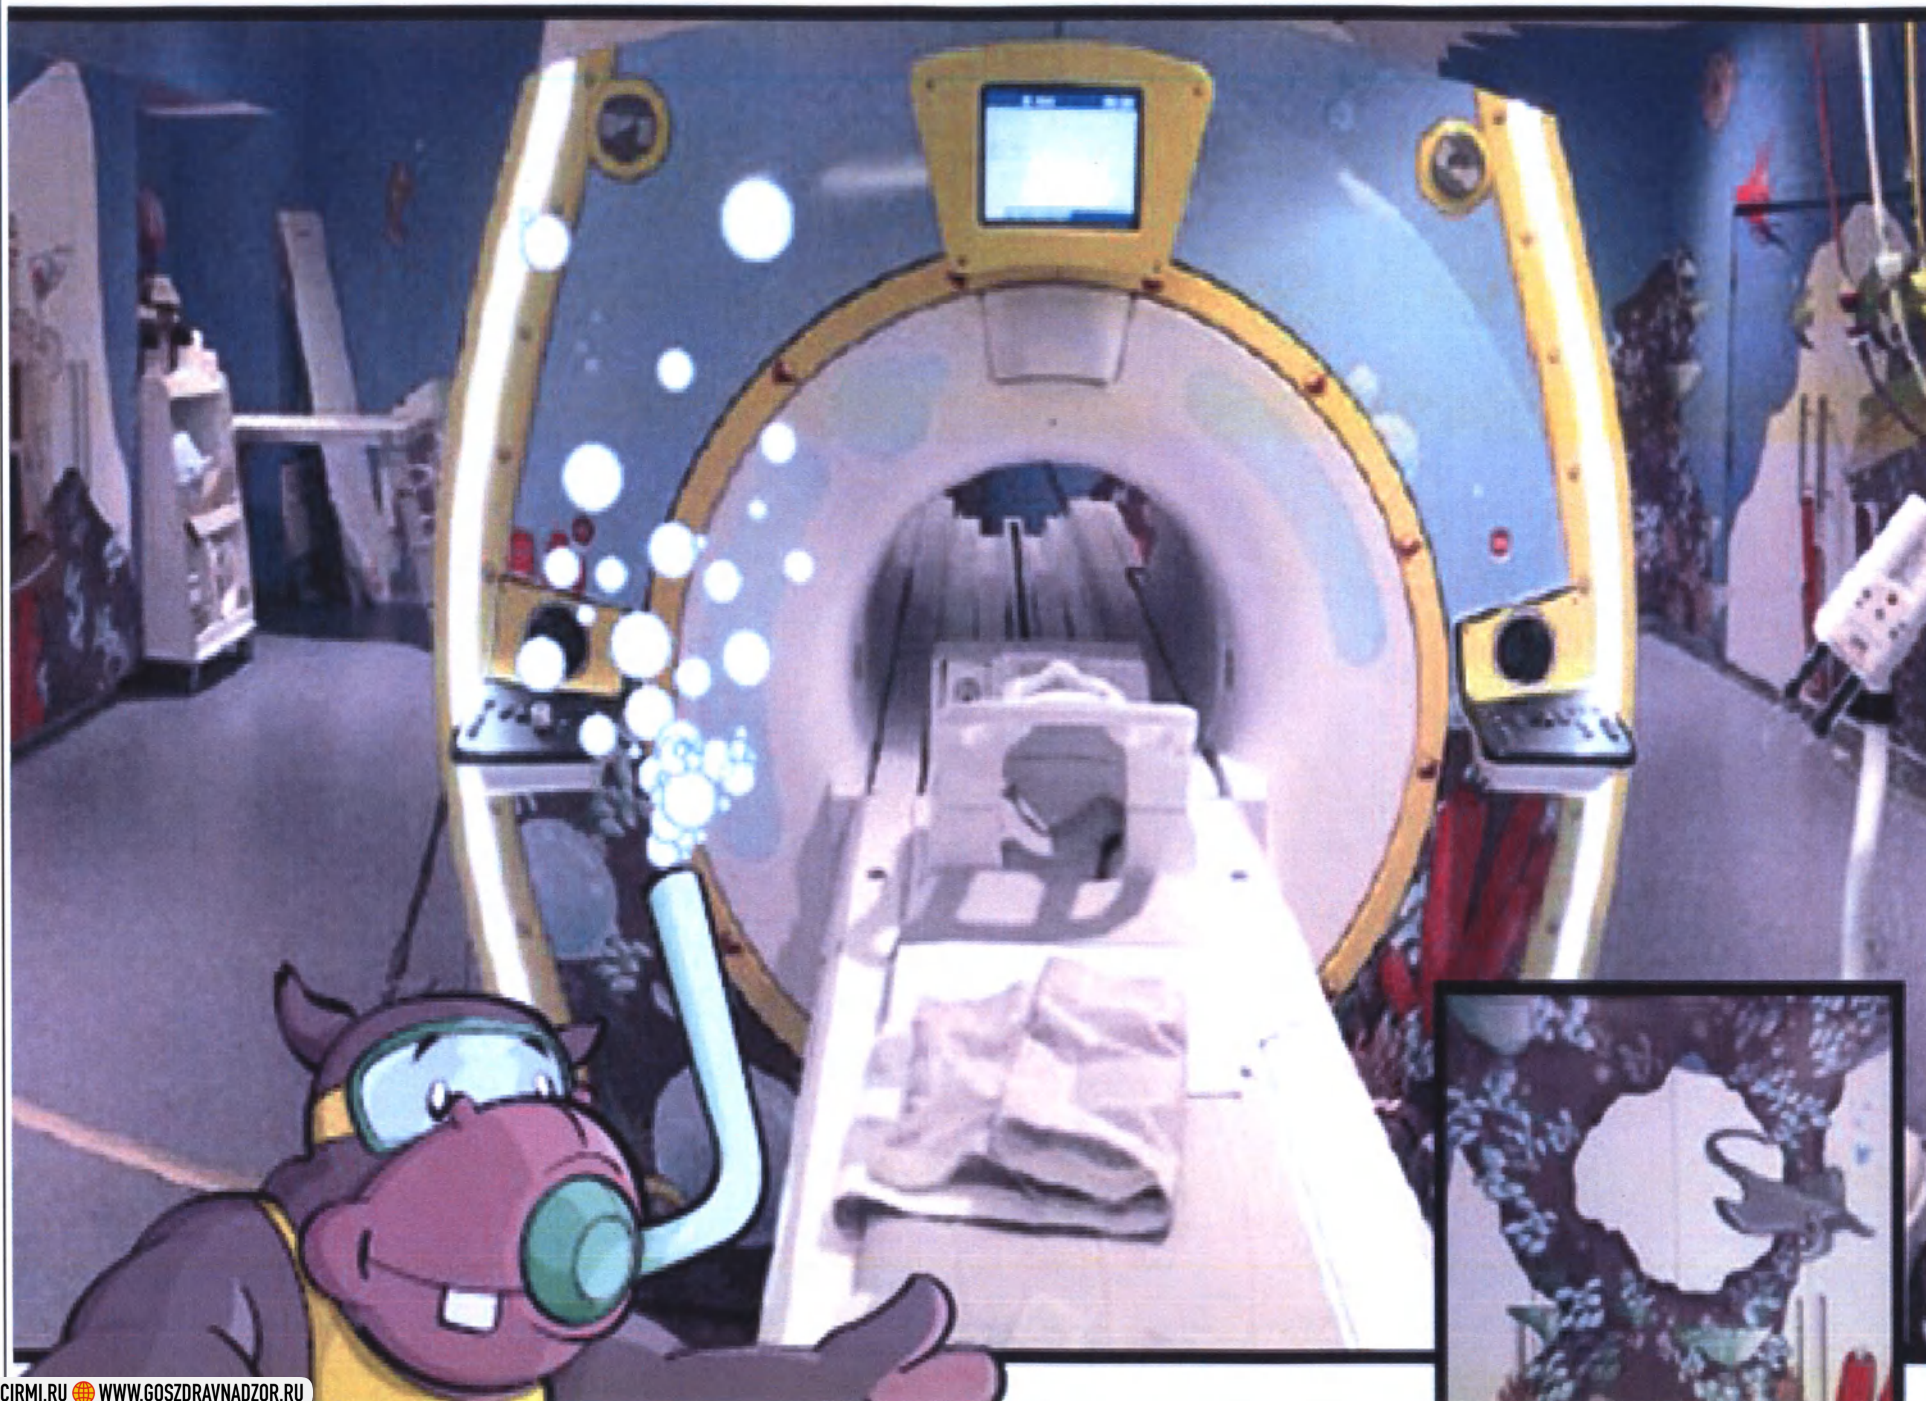



ПРОШУ
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 164 Л.

Shavitov

