



**Общество с ограниченной ответственностью «Линтекс»  
(ООО «Линтекс»)**

Лифляндская ул., дом 6, литера К, Санкт-Петербург, 190020

Тел. (812) 313-39-19; Тел./факс (812) 385-44-30

e-mail: [info@lintex.ru](mailto:info@lintex.ru); <http://www.lintex.ru>

ОКПО 56257679; ОГРН 1037851036167; ИНН 7826083684; КПП 783901001

**ФОТОГРАФИИ**

медицинского изделия

**«Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии  
«Линтекс», стерильные»  
по ТУ 9393-005-56257679-2006**

Генеральный директор  
ООО «Линтекс»

И. И. Жуковская

Дата 19.05.2021 г.




## СОДЕРЖАНИЕ


|     |                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Исполнения медицинского изделия                                    | 3  |
| 2   | Барьерная система для стерилизации исполнений медицинского изделия | 22 |
| 2.1 | Носители исполнений медицинского изделия                           | 23 |
| 2.2 | Внутренний и внешний пакеты                                        | 31 |
| 2.3 | Макеты этикеток исполнений медицинского изделия                    | 33 |
| 3   | Защитная упаковка медицинского изделия                             | 39 |

## **1. ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


ЭСФИЛ® стандартный, ЭСФИЛ® легкий, ЭСФИЛ® тяжелый, ЭСФИЛ® усиленный, ЭСФИЛ® усиленный, УНИФЛЕКС стандартный, УНИФЛЕКС тяжелый, КАРБОФЛЕКС, ФЛЕКСИЛЕН стандартный, ФЛЕКСИЛЕН легкий, ФЛЕКСИЛЕН объемный, УроСлинг®, УроСлинг® 1, ЭСЛАН стандартный, ЭСЛАН легкий, ЭСЛАН тяжелый, ФТОРЭКС® и Туннелера.

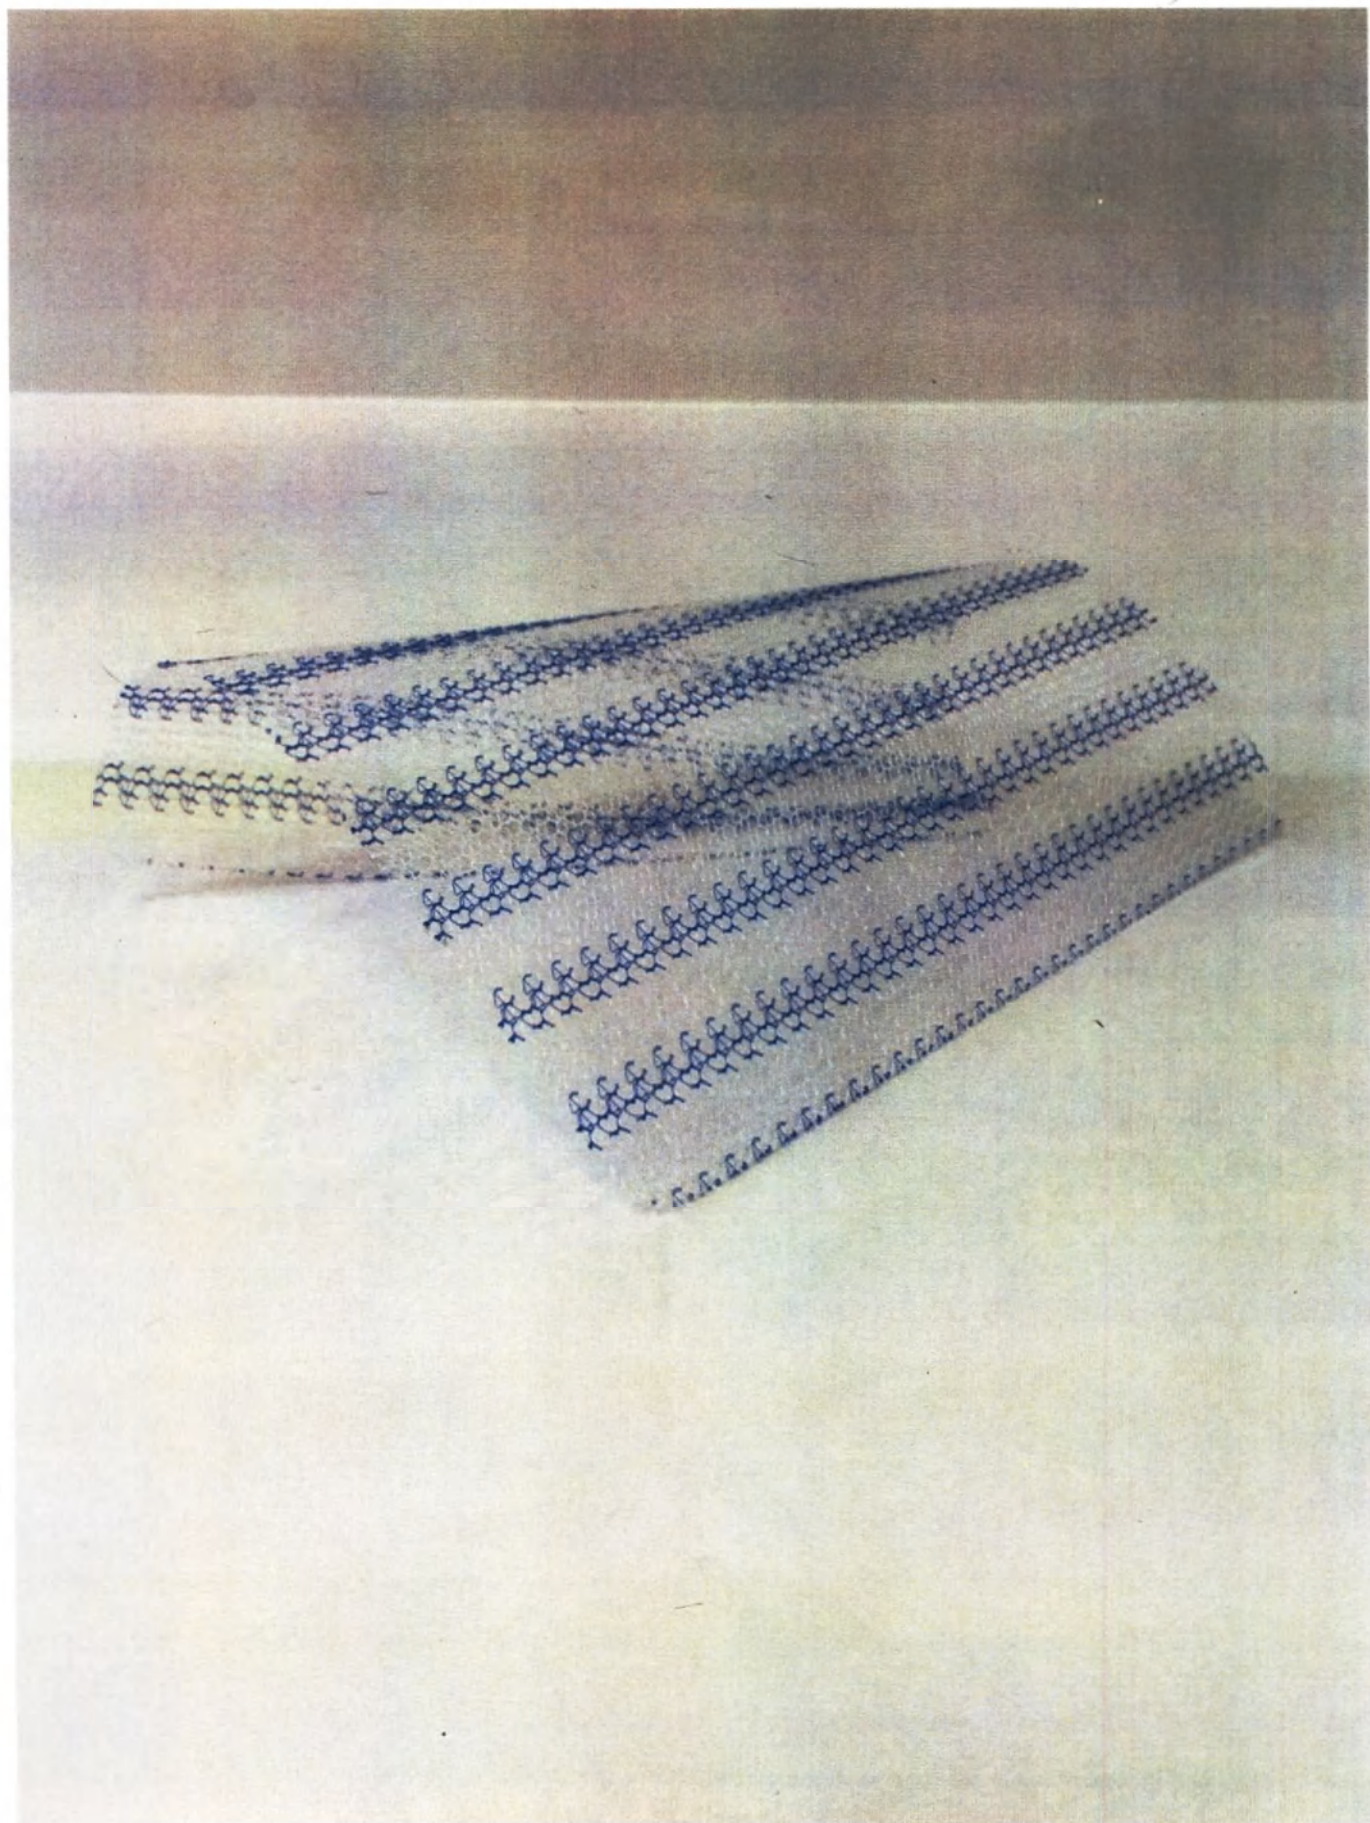


Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии  
ЭСФИЛ® стандартный

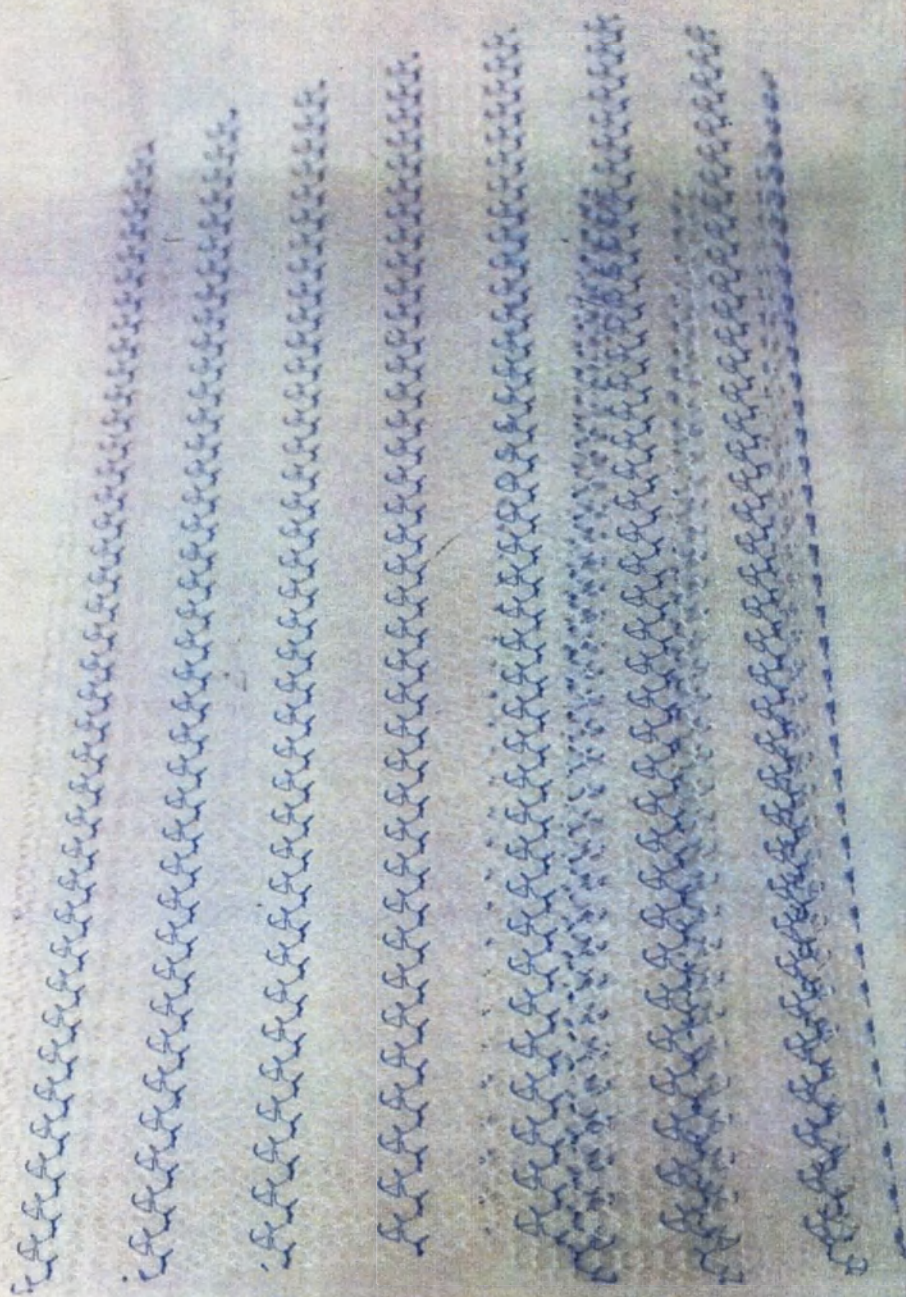

Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии  
ЭСФИЛ® легкий

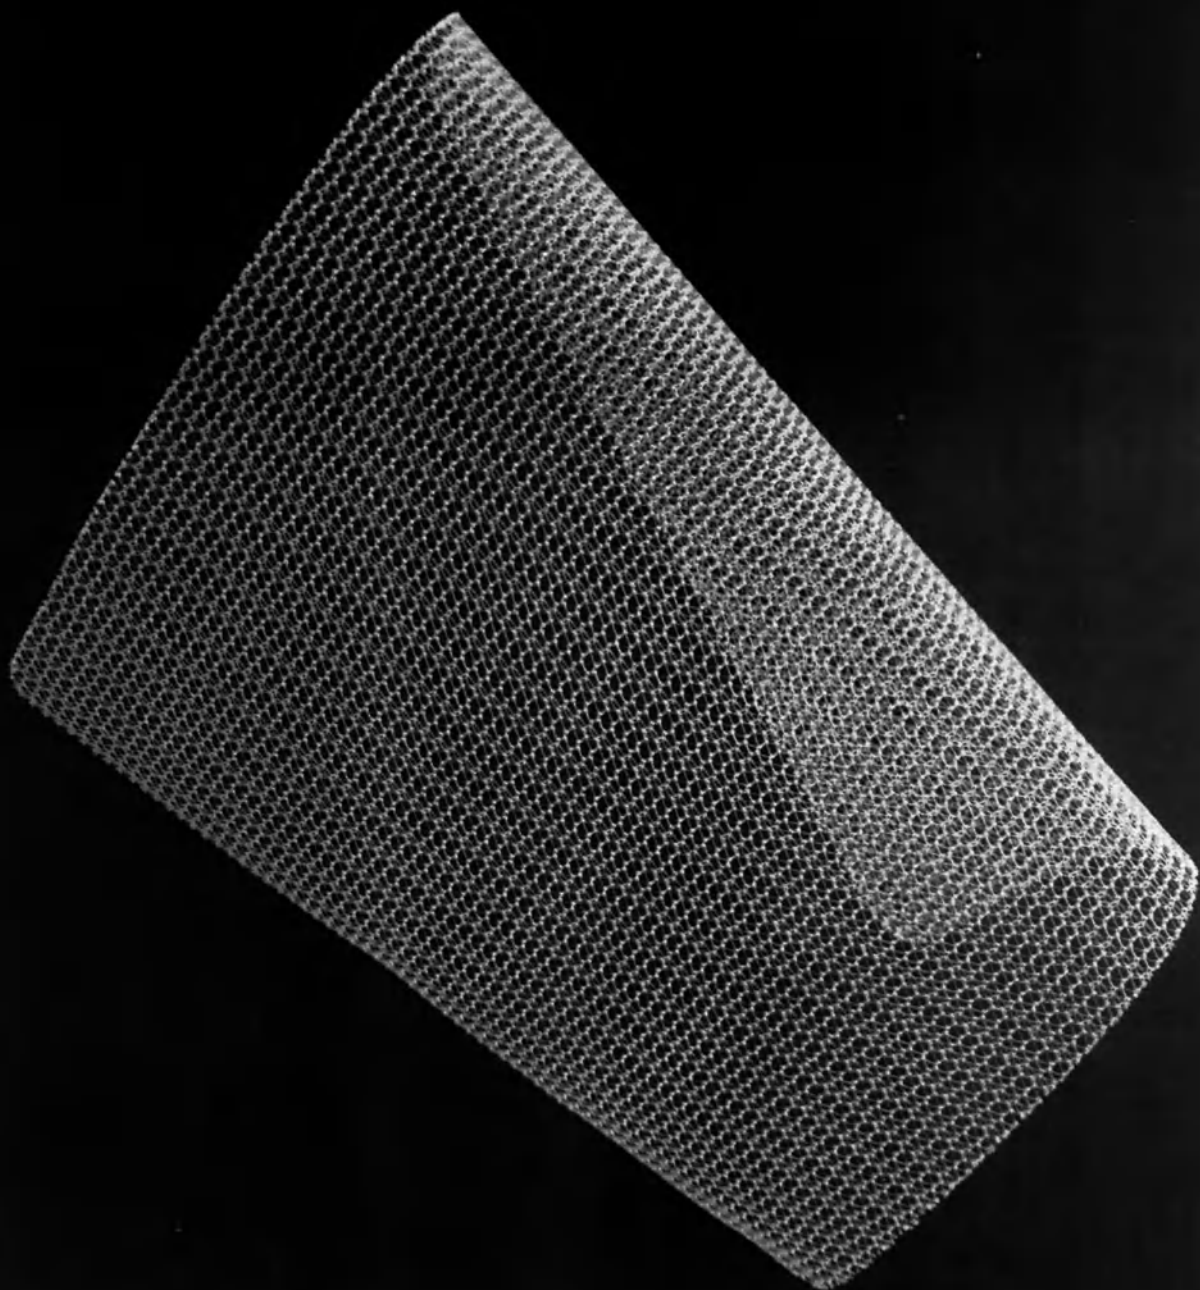


Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии  
ЭСФИЛ® тяжелый

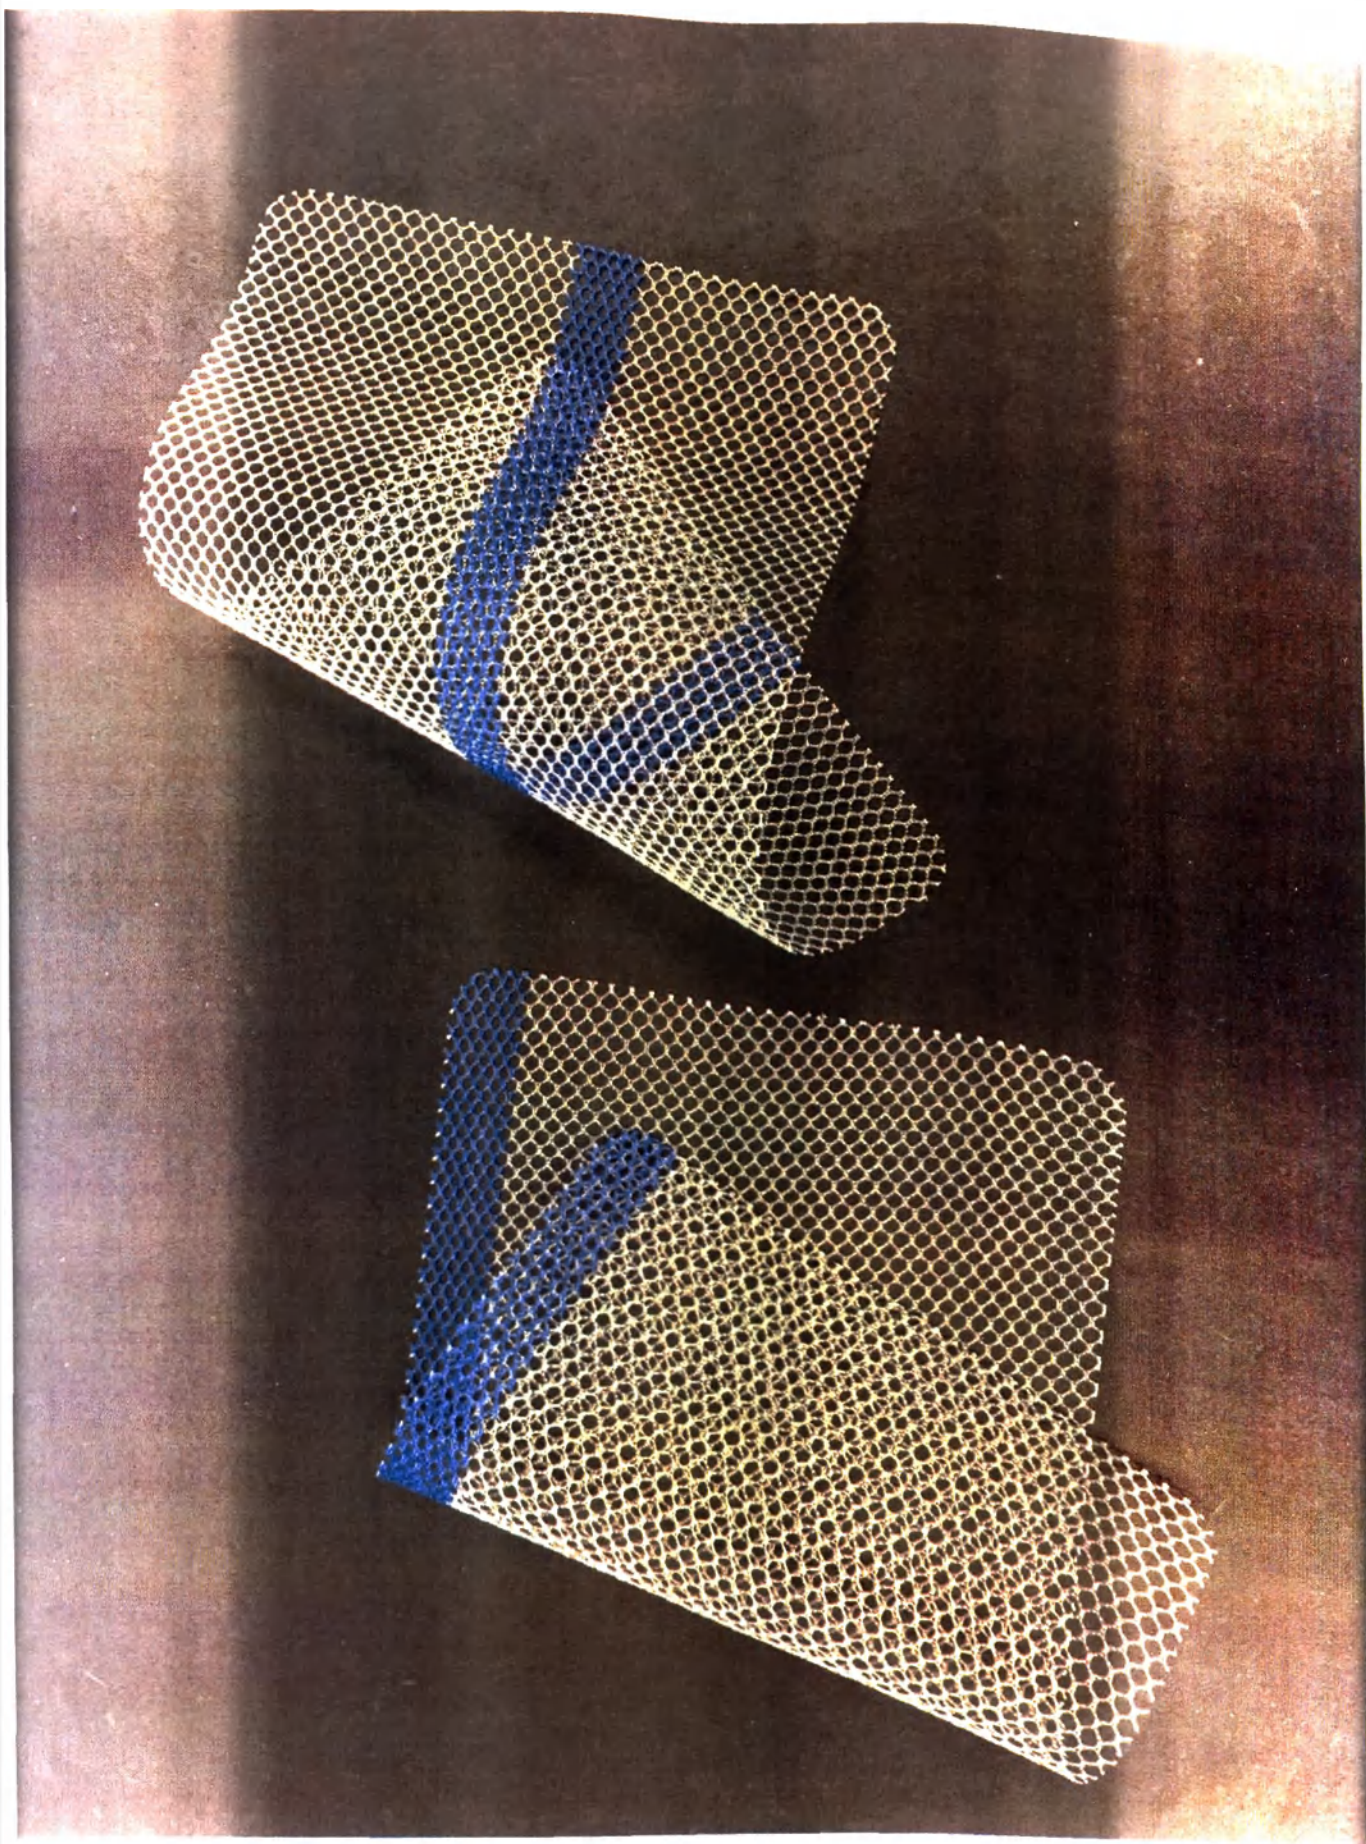


Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии  
ЭСФИЛ® усиленный




Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии  
ЭСФИЛ® усиленный 1

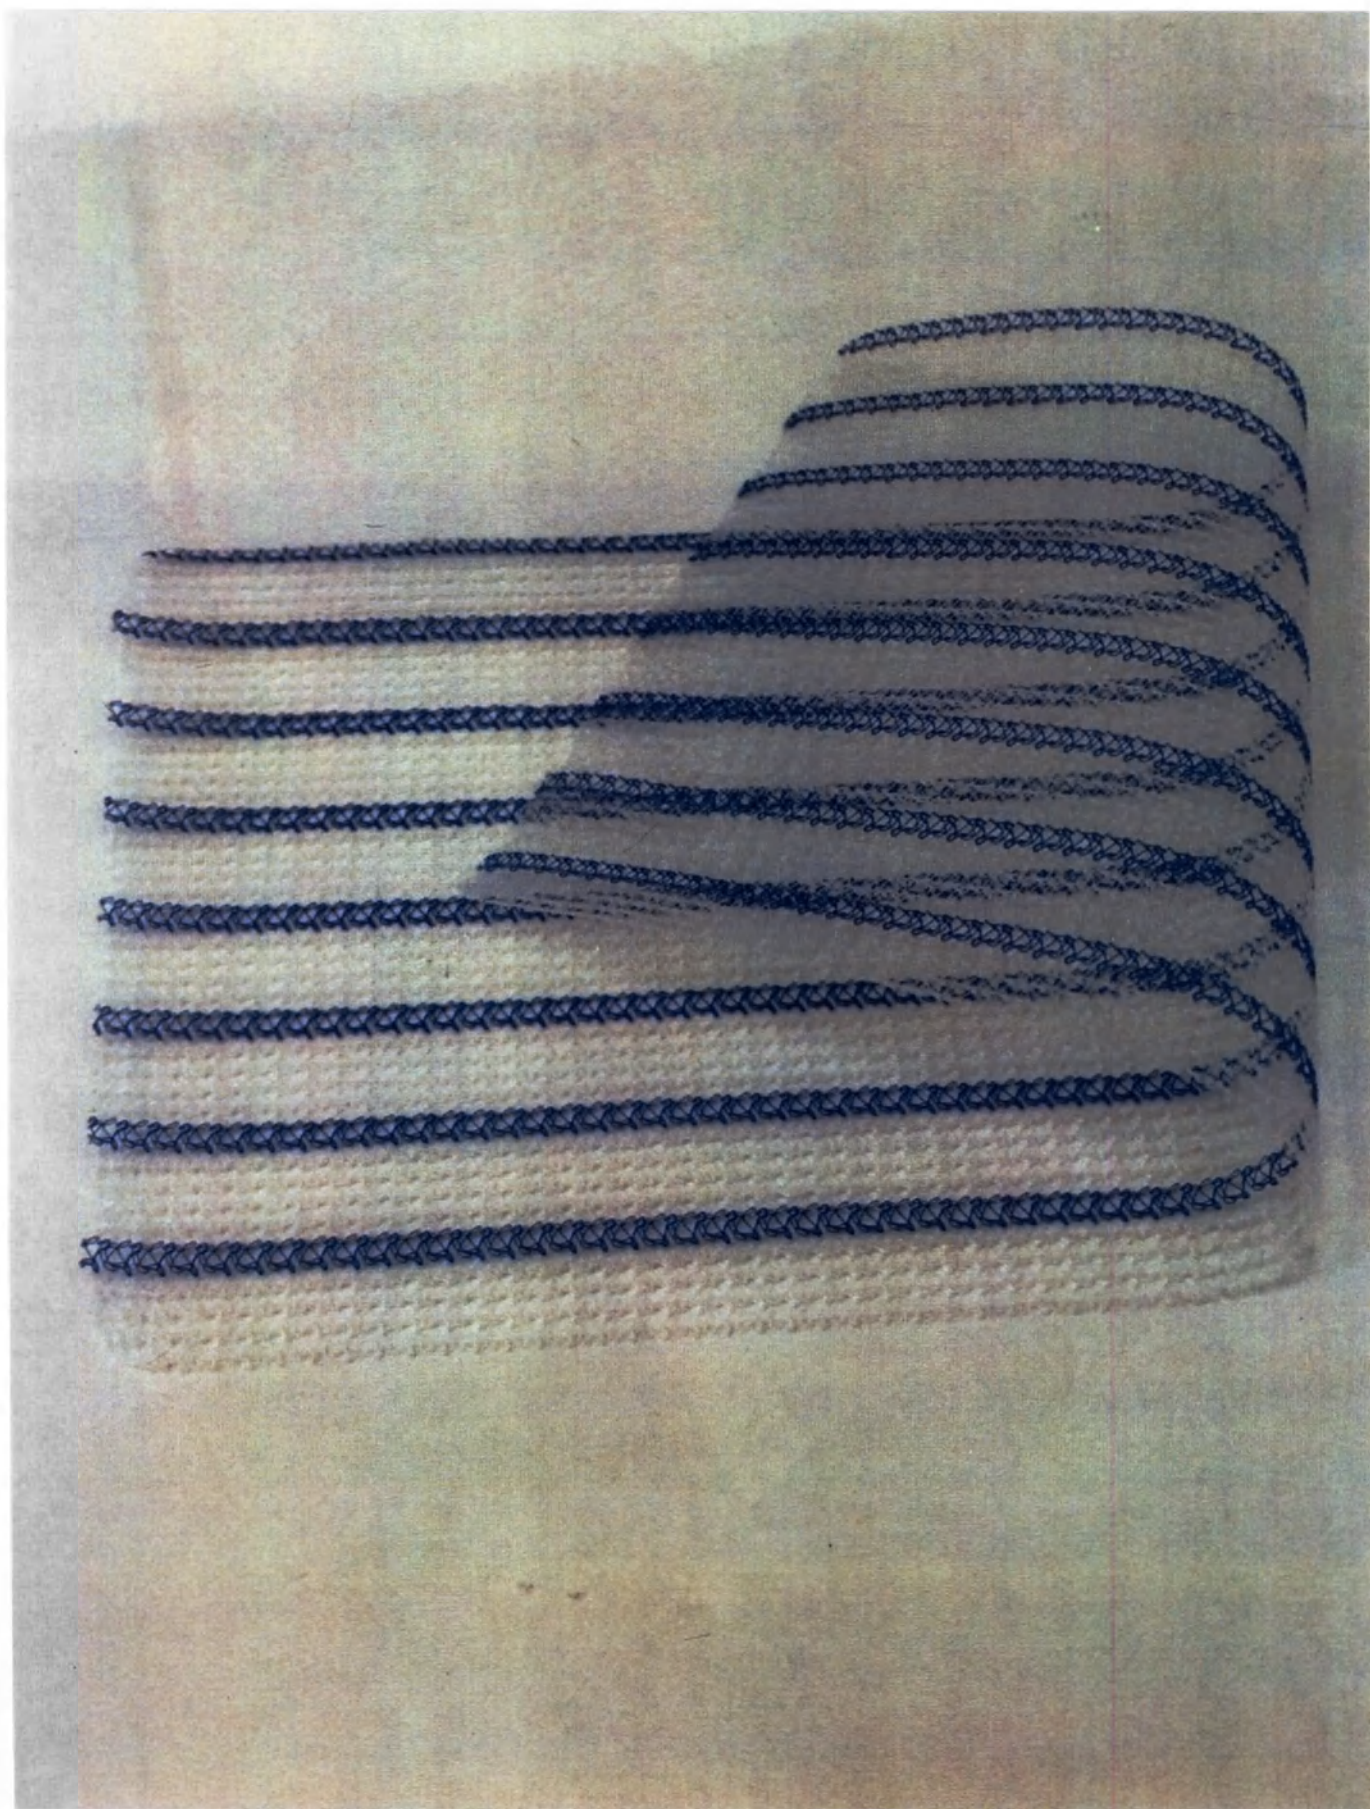


Эндопротез-сетка поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии  
УНИФЛЕКС стандартный

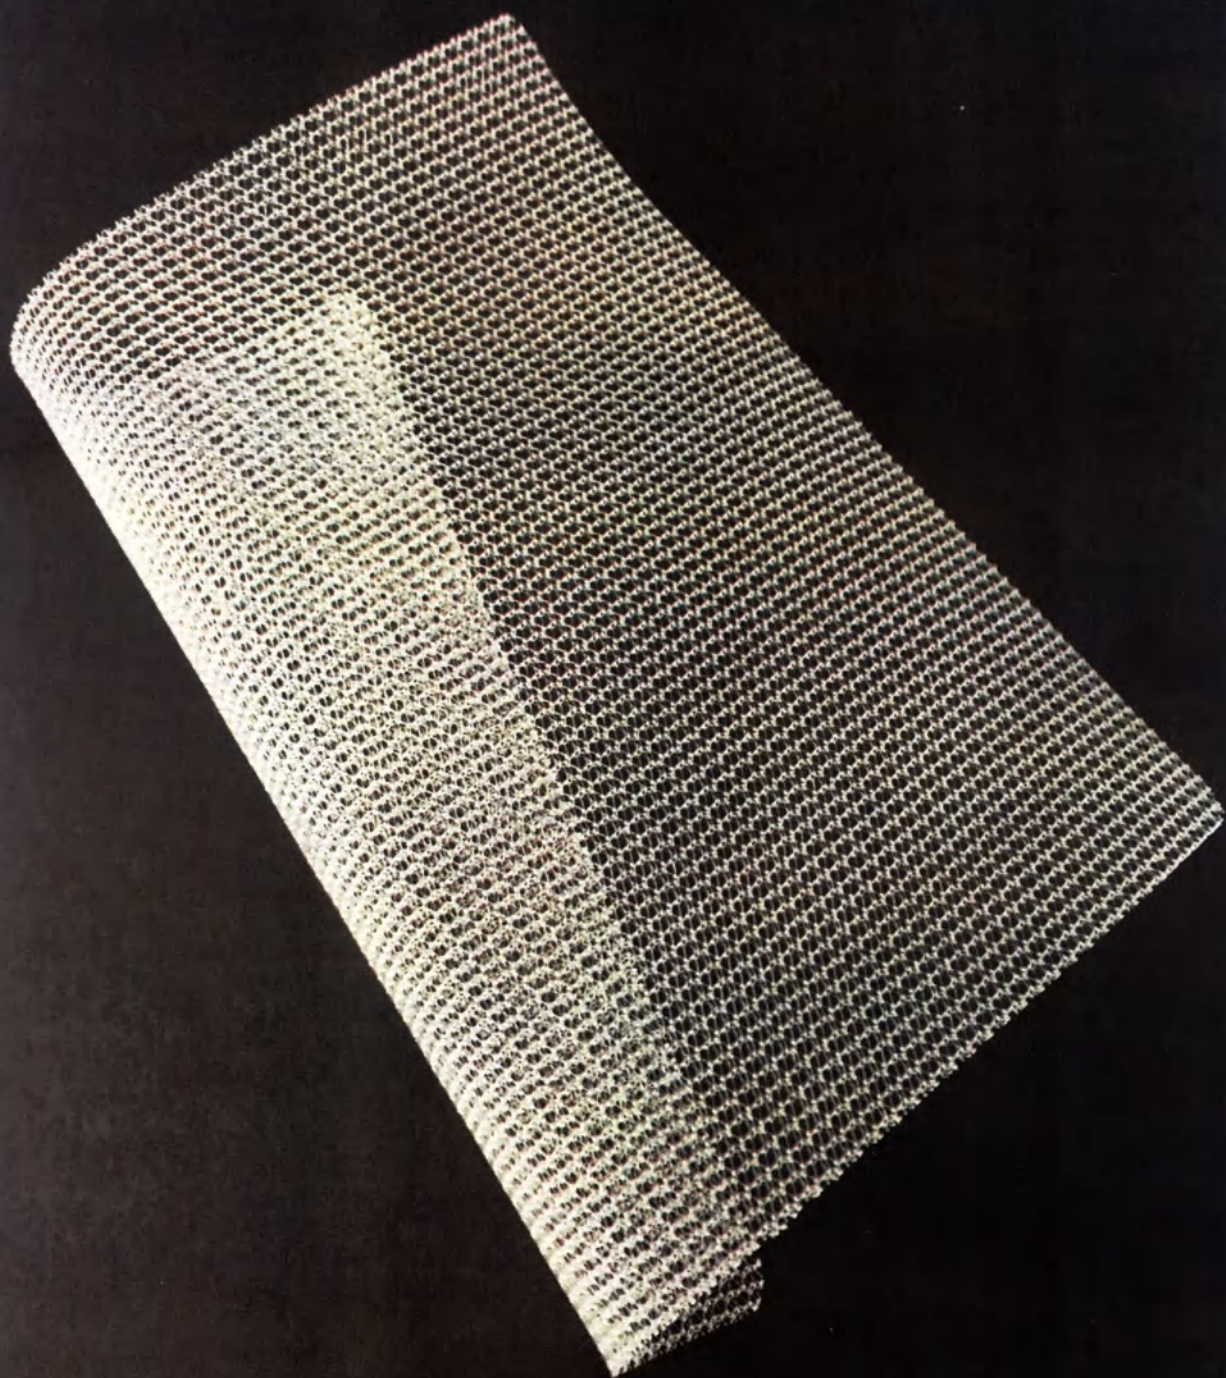


Эндопротез-сетка поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии  
УНИФЛЕКС тяжелый

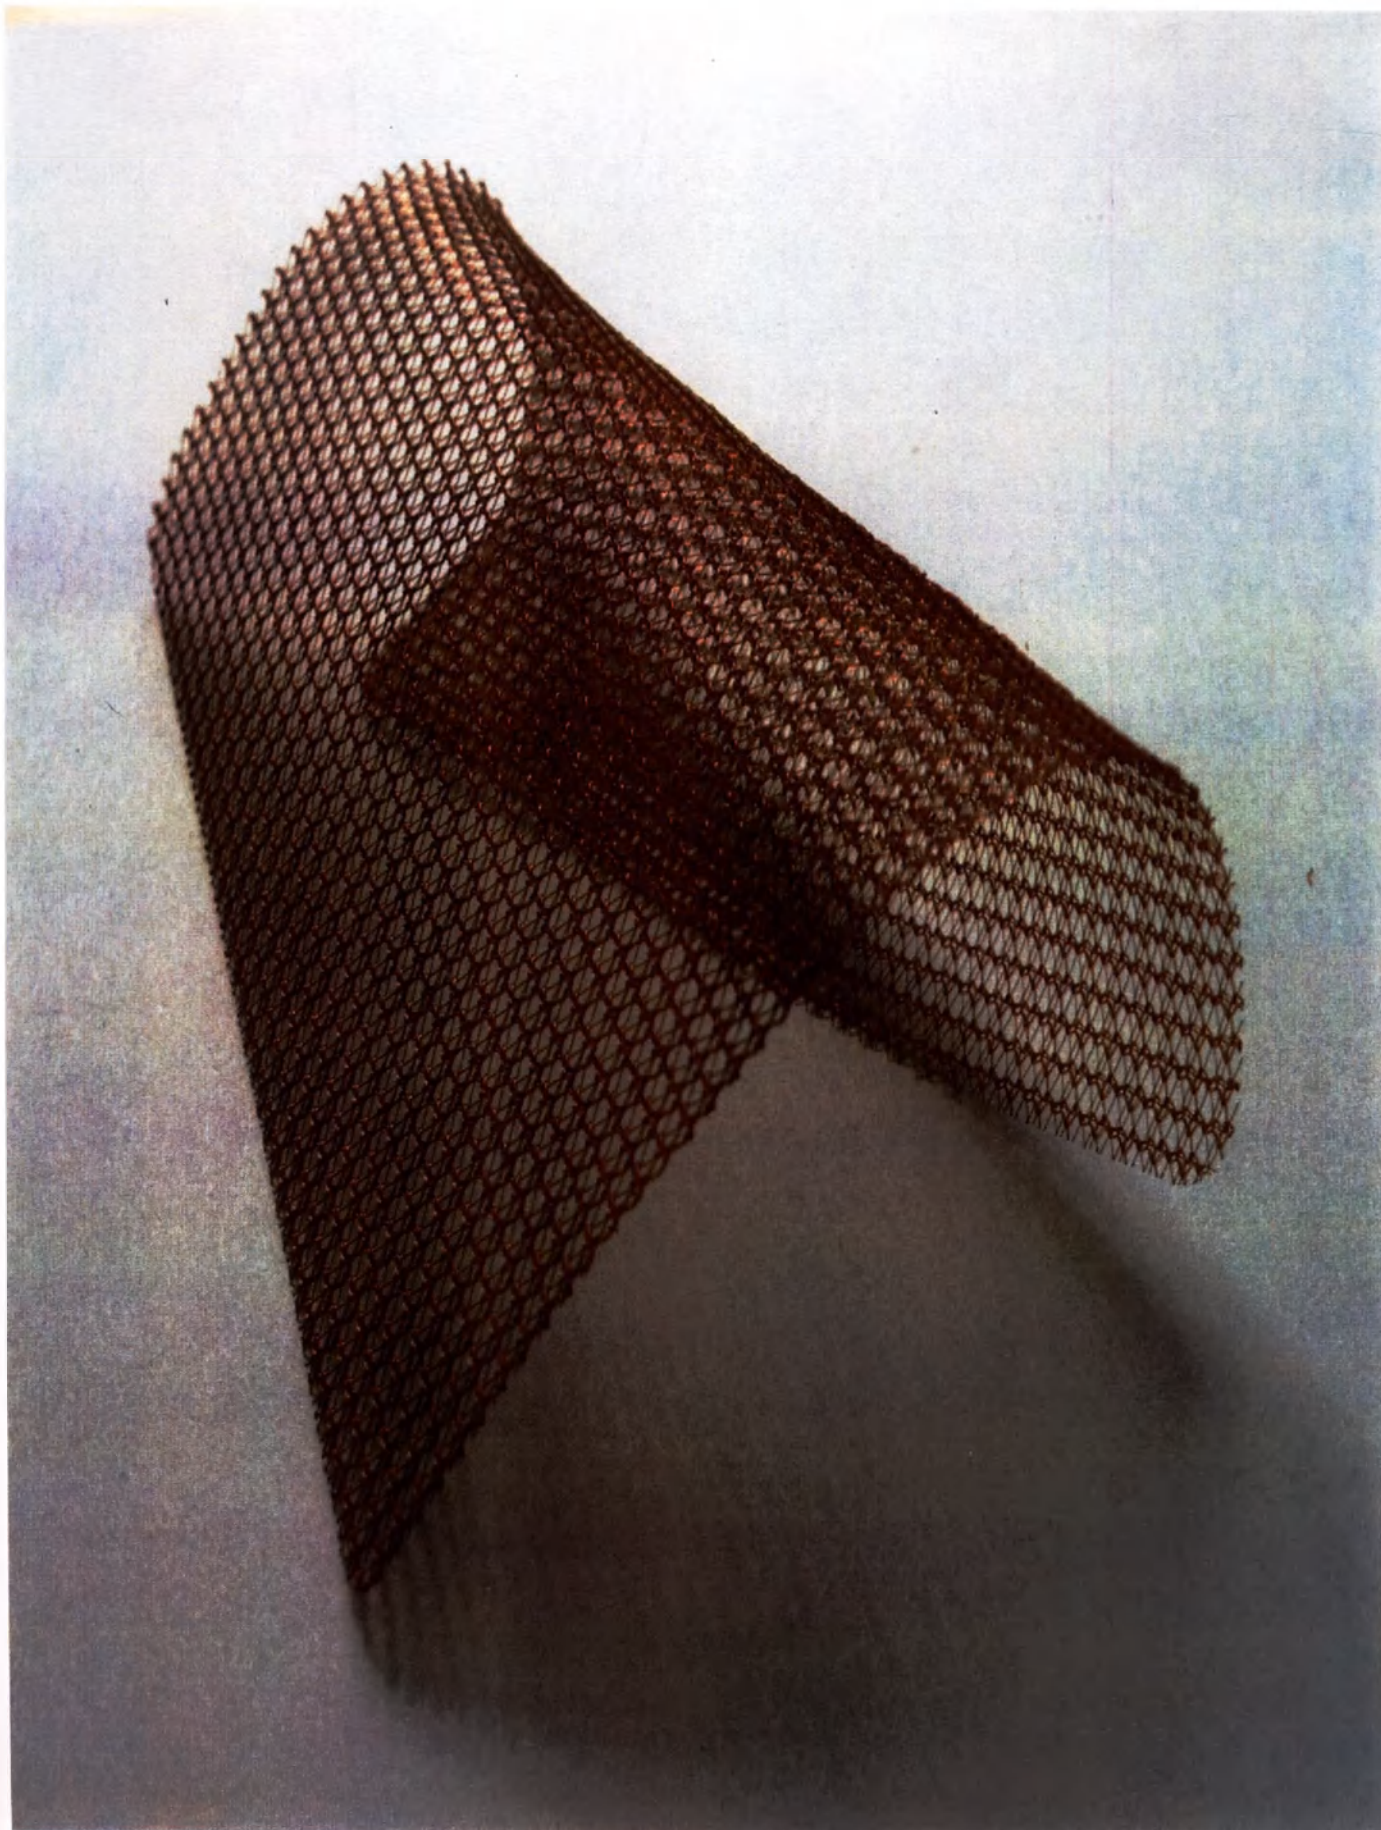


Эндопротез-сетка поливинилиденфторидный с карбиновым покрытием для  
восстановительной хирургии КАРБОФЛЕКС

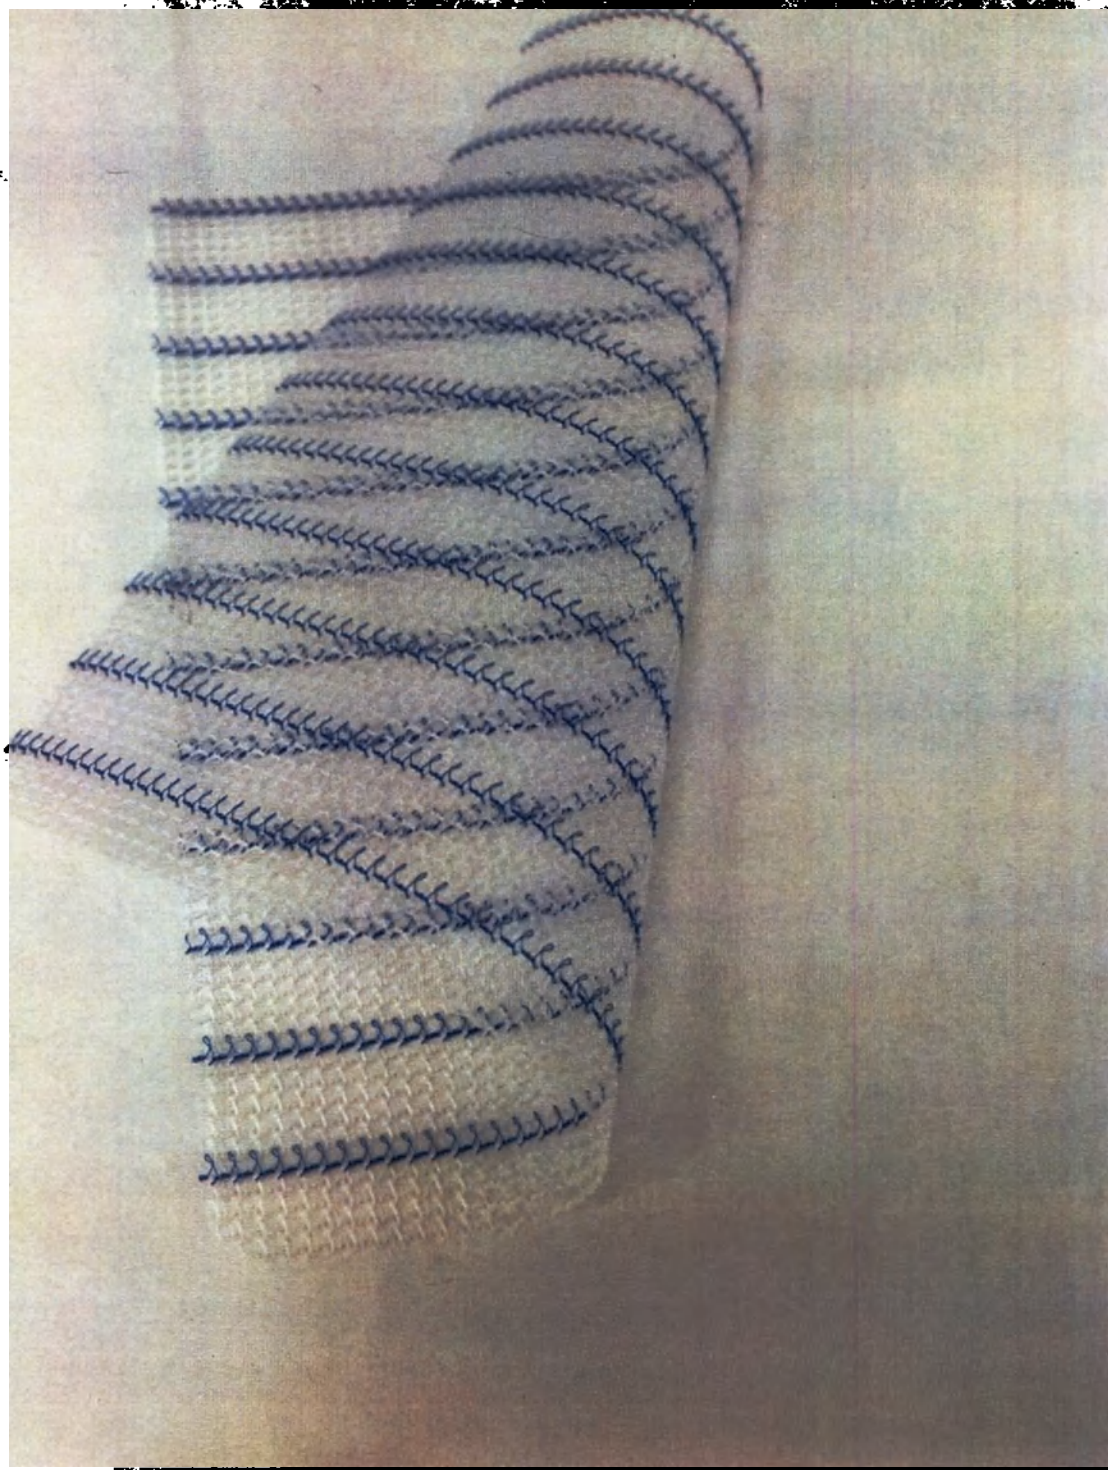


**Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии ФЛЕКСИЛЕН стандартный**

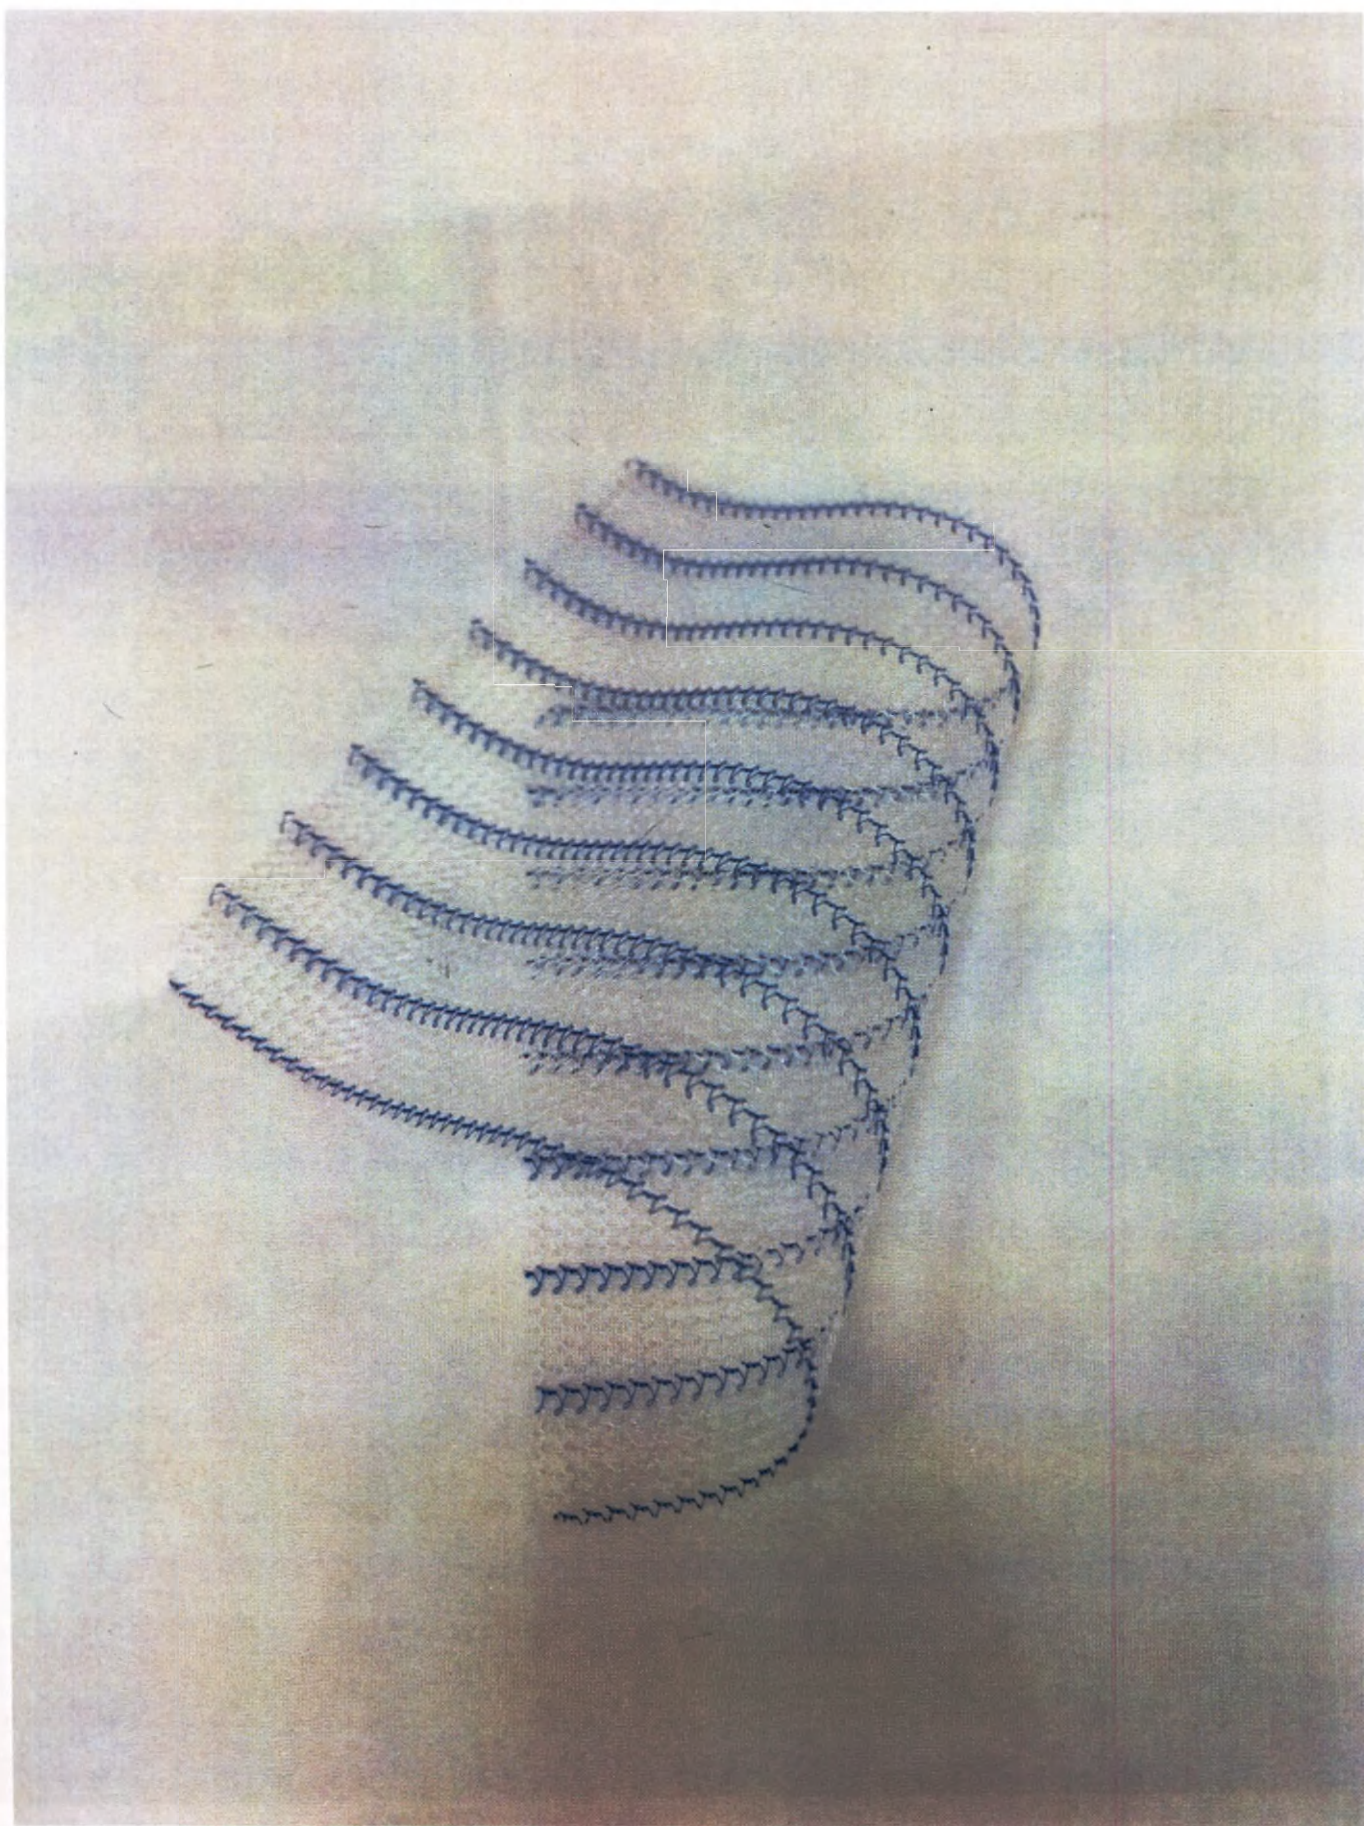


Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии ФЛЕКСИЛЕН легкий

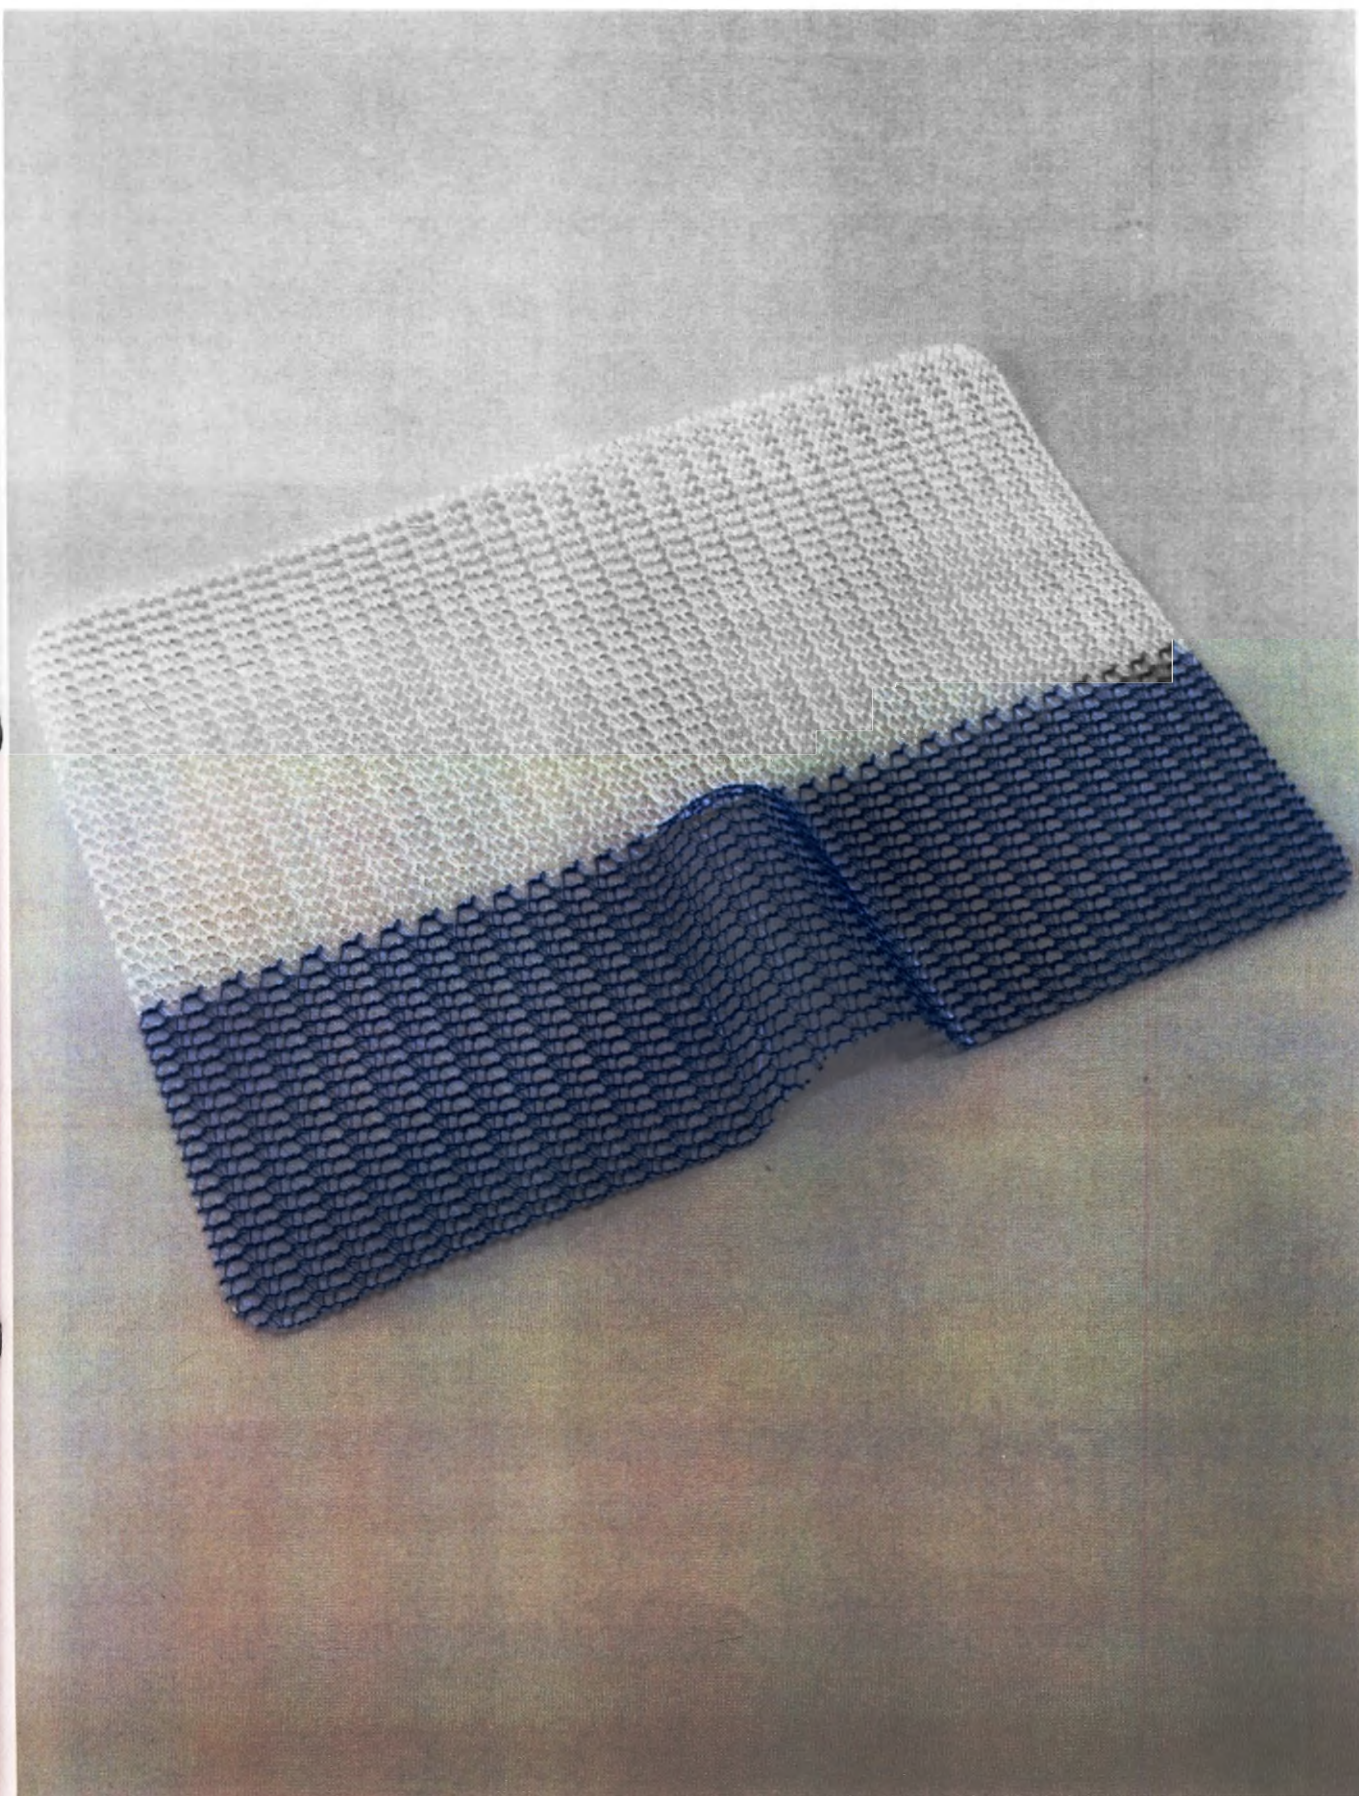


Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии ФЛЕКСИЛЕН объемный

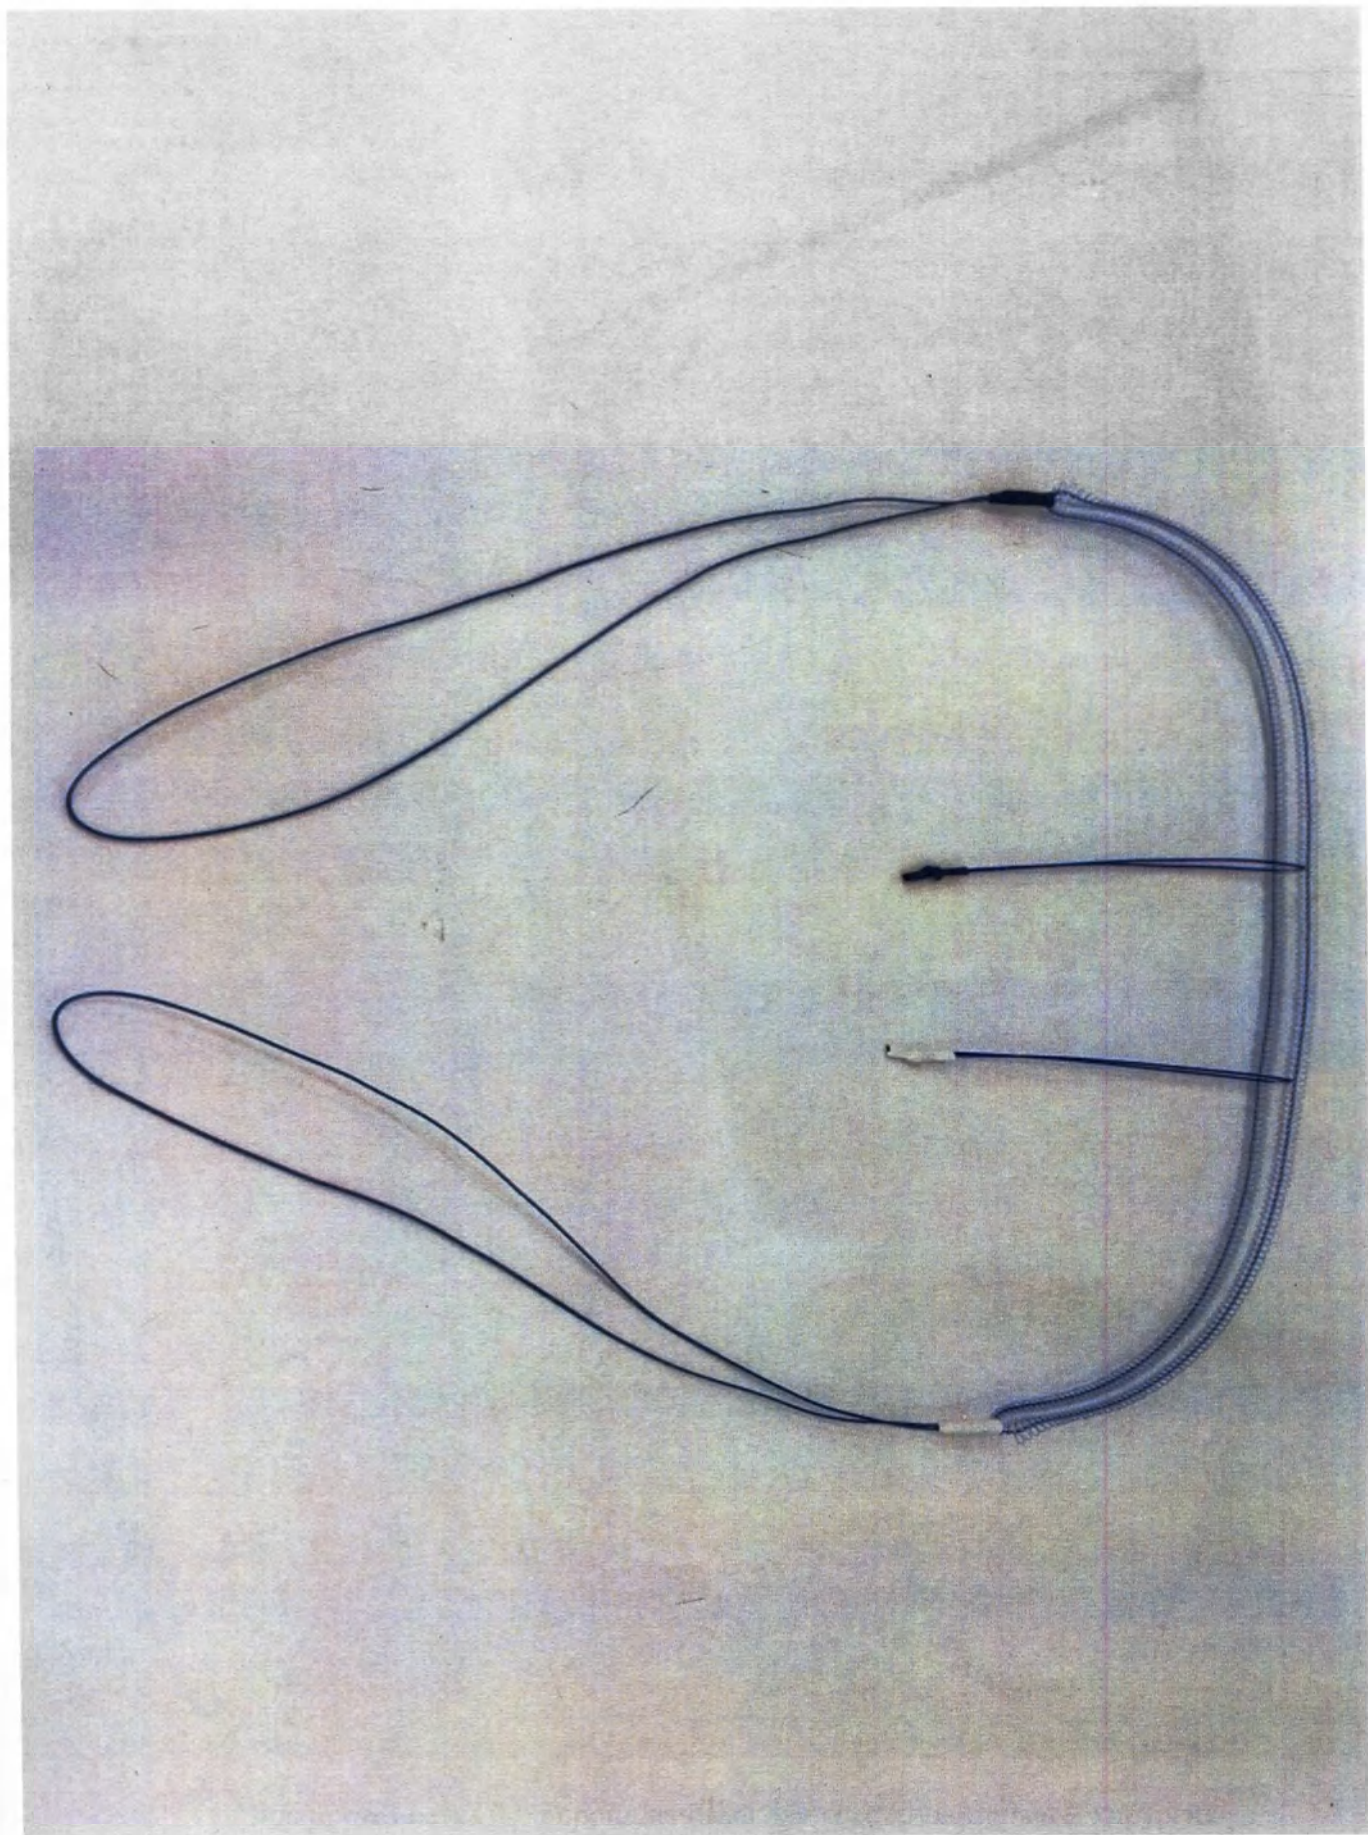


Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии  
УроСлинг®

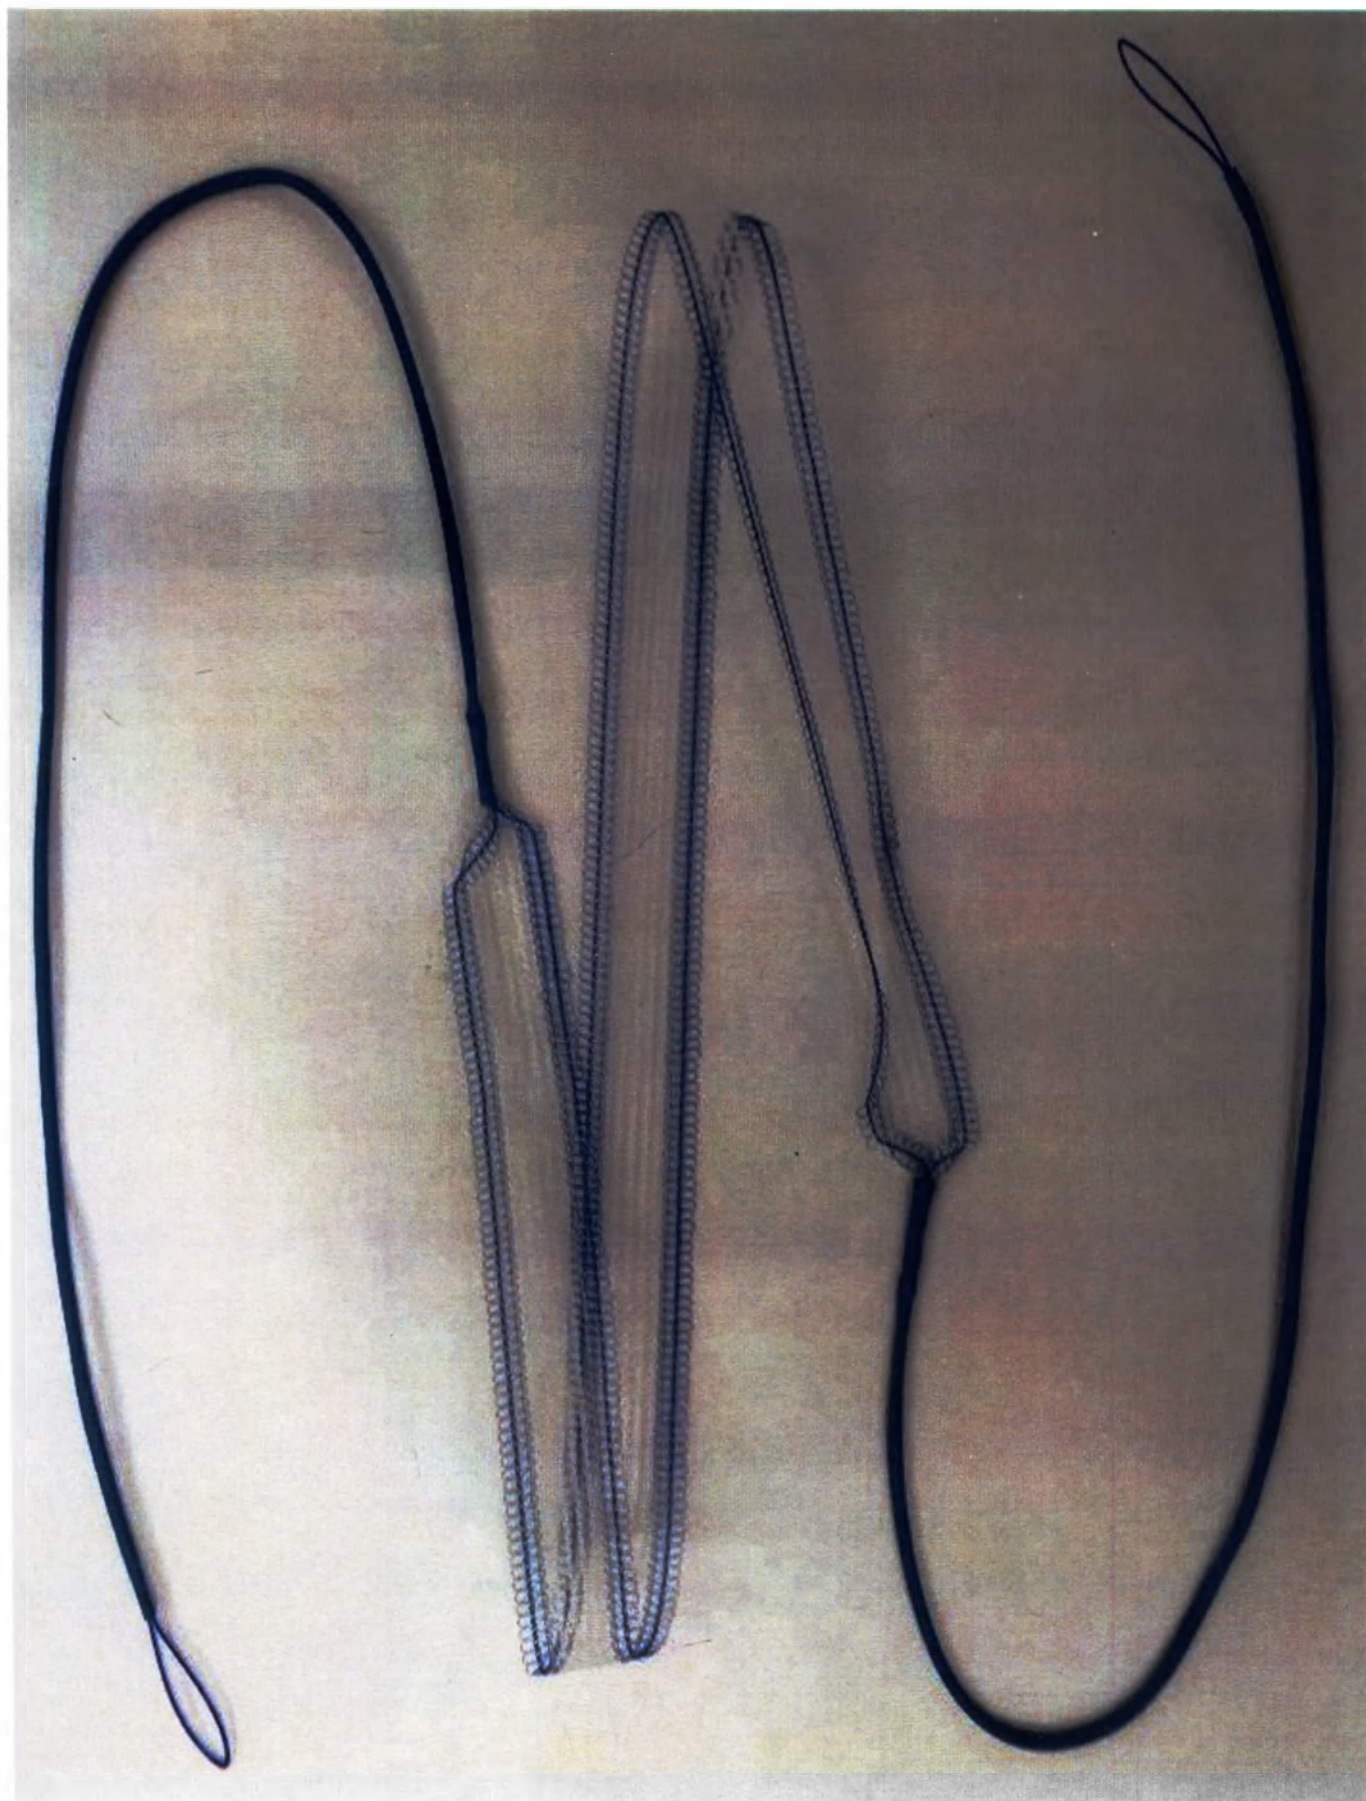


Эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии  
УроСлинг® 1

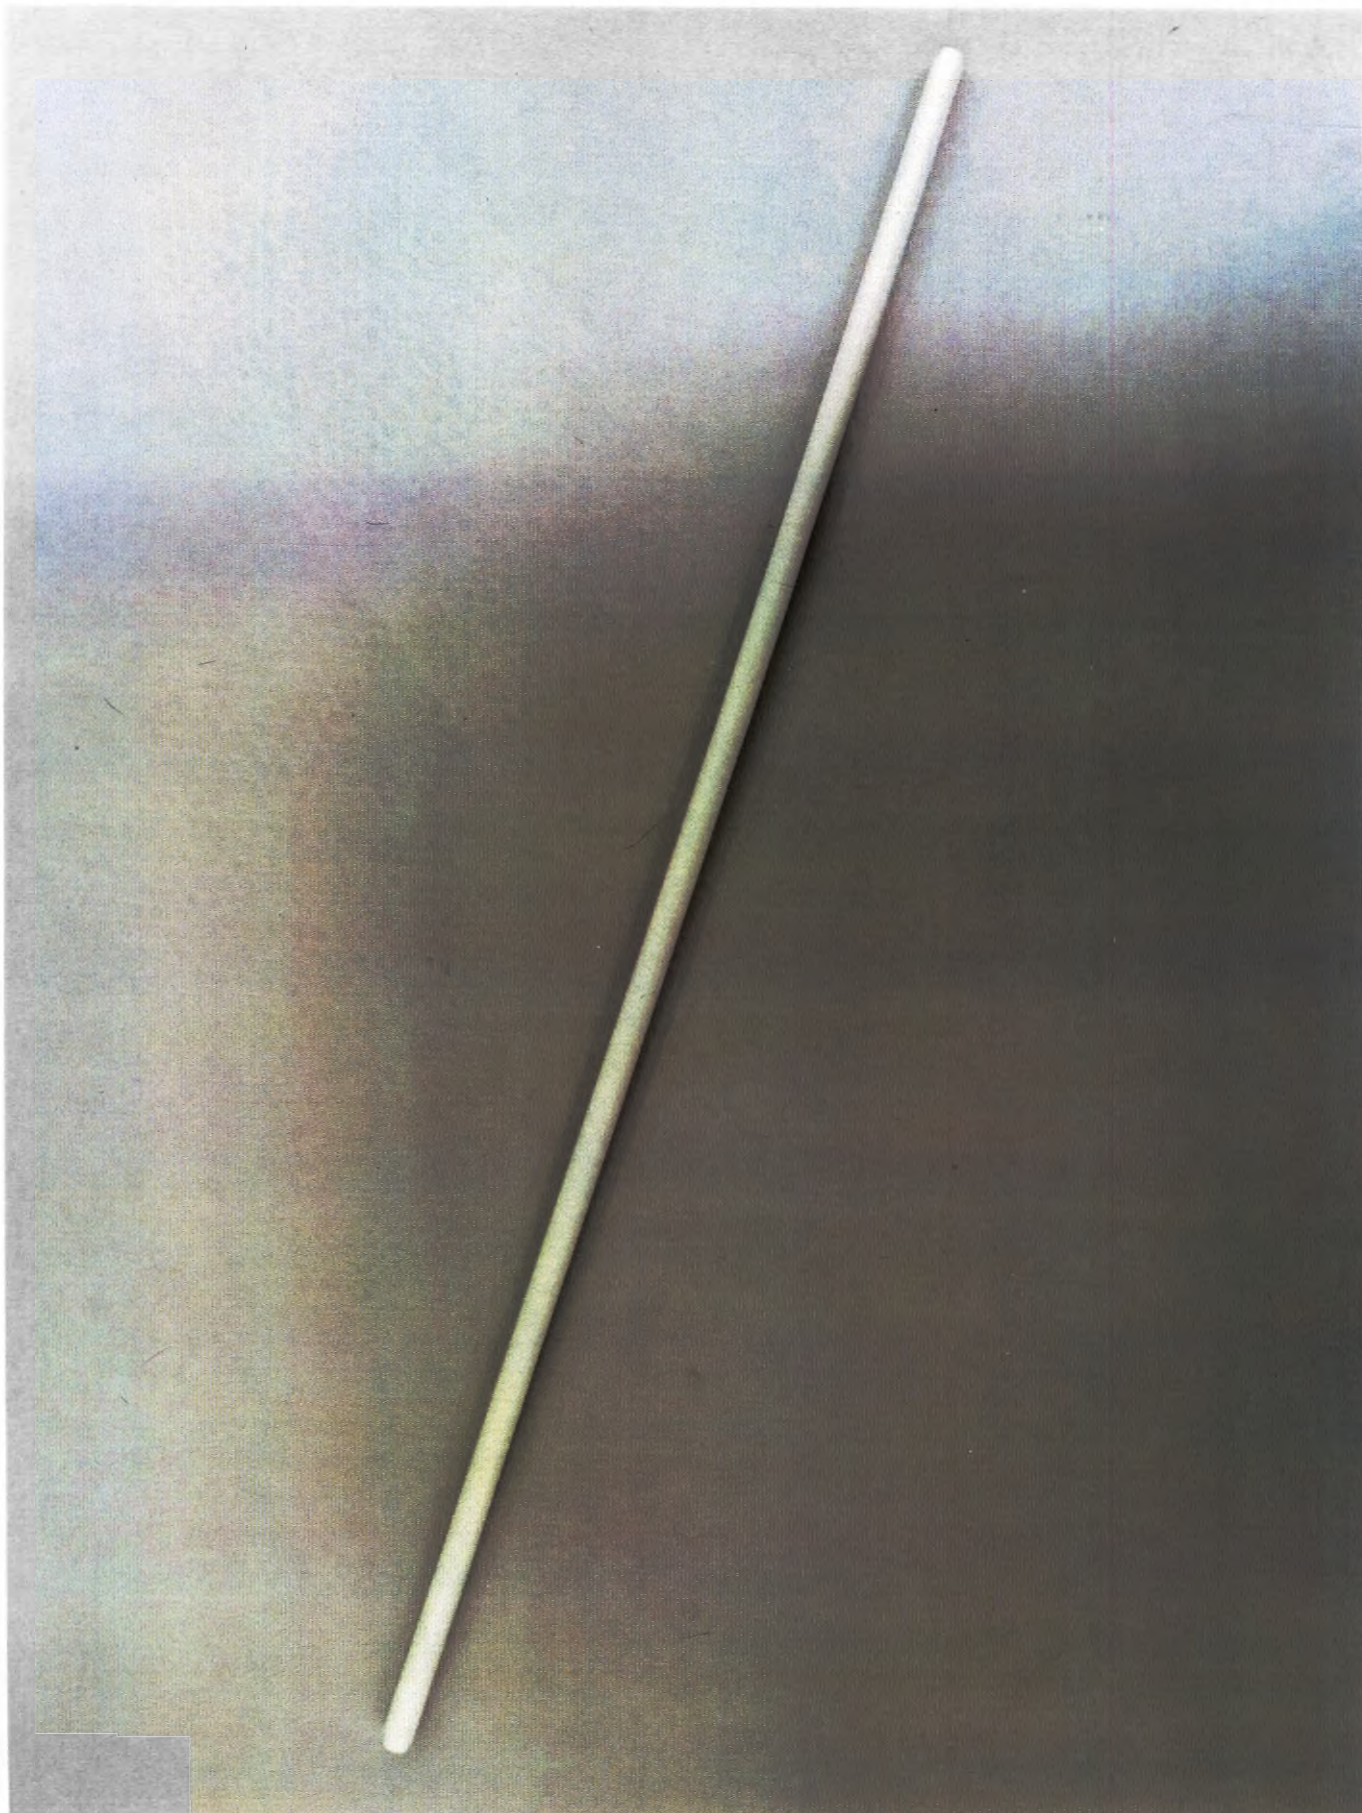


Туннелер

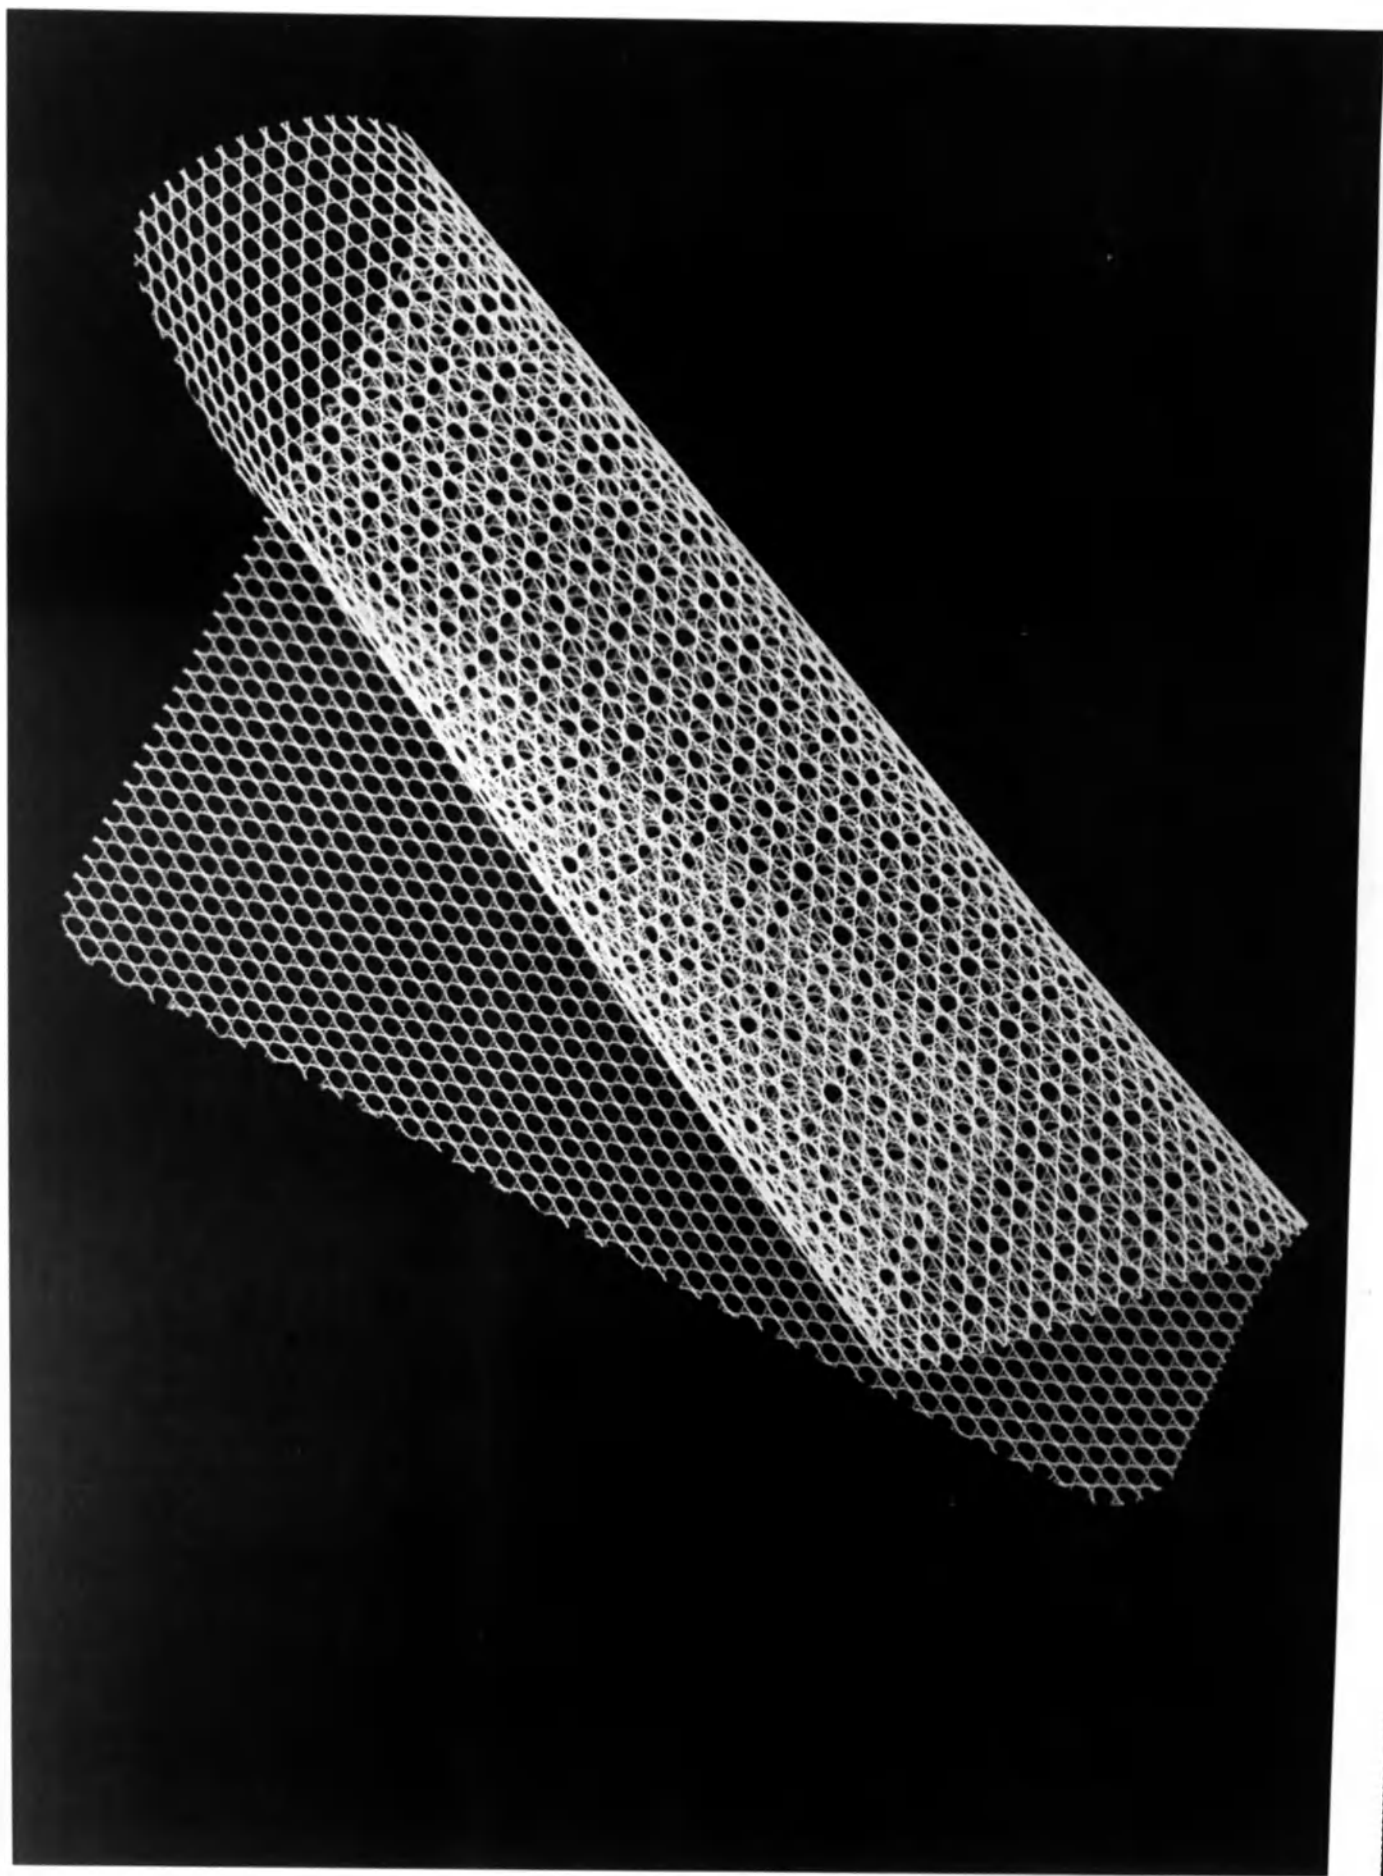


Эндопротез-сетка лавсановый для восстановительной хирургии  
ЭСЛАН стандартный

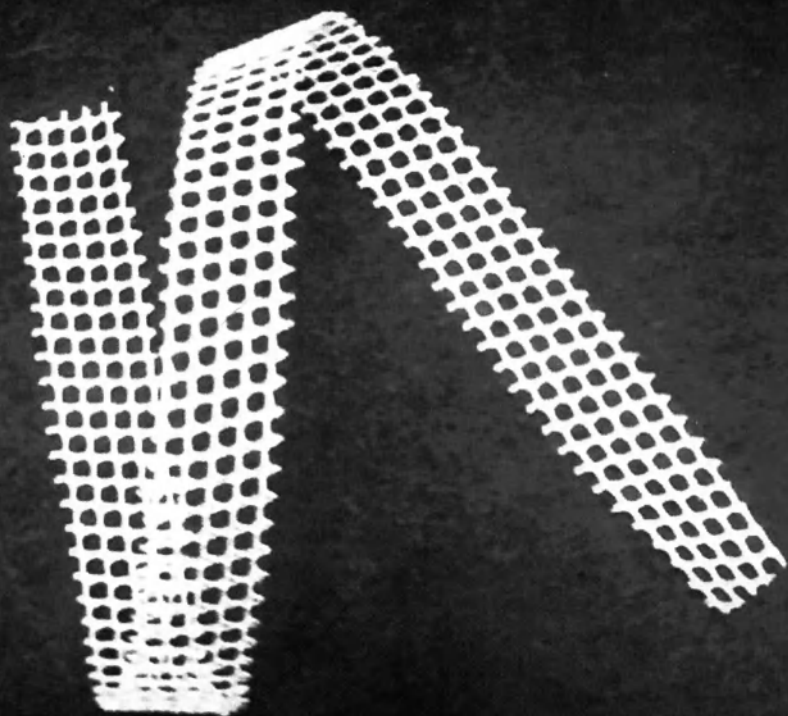

Эндопротез-сетка лавсановый для восстановительной хирургии  
ЭСЛАН легкий

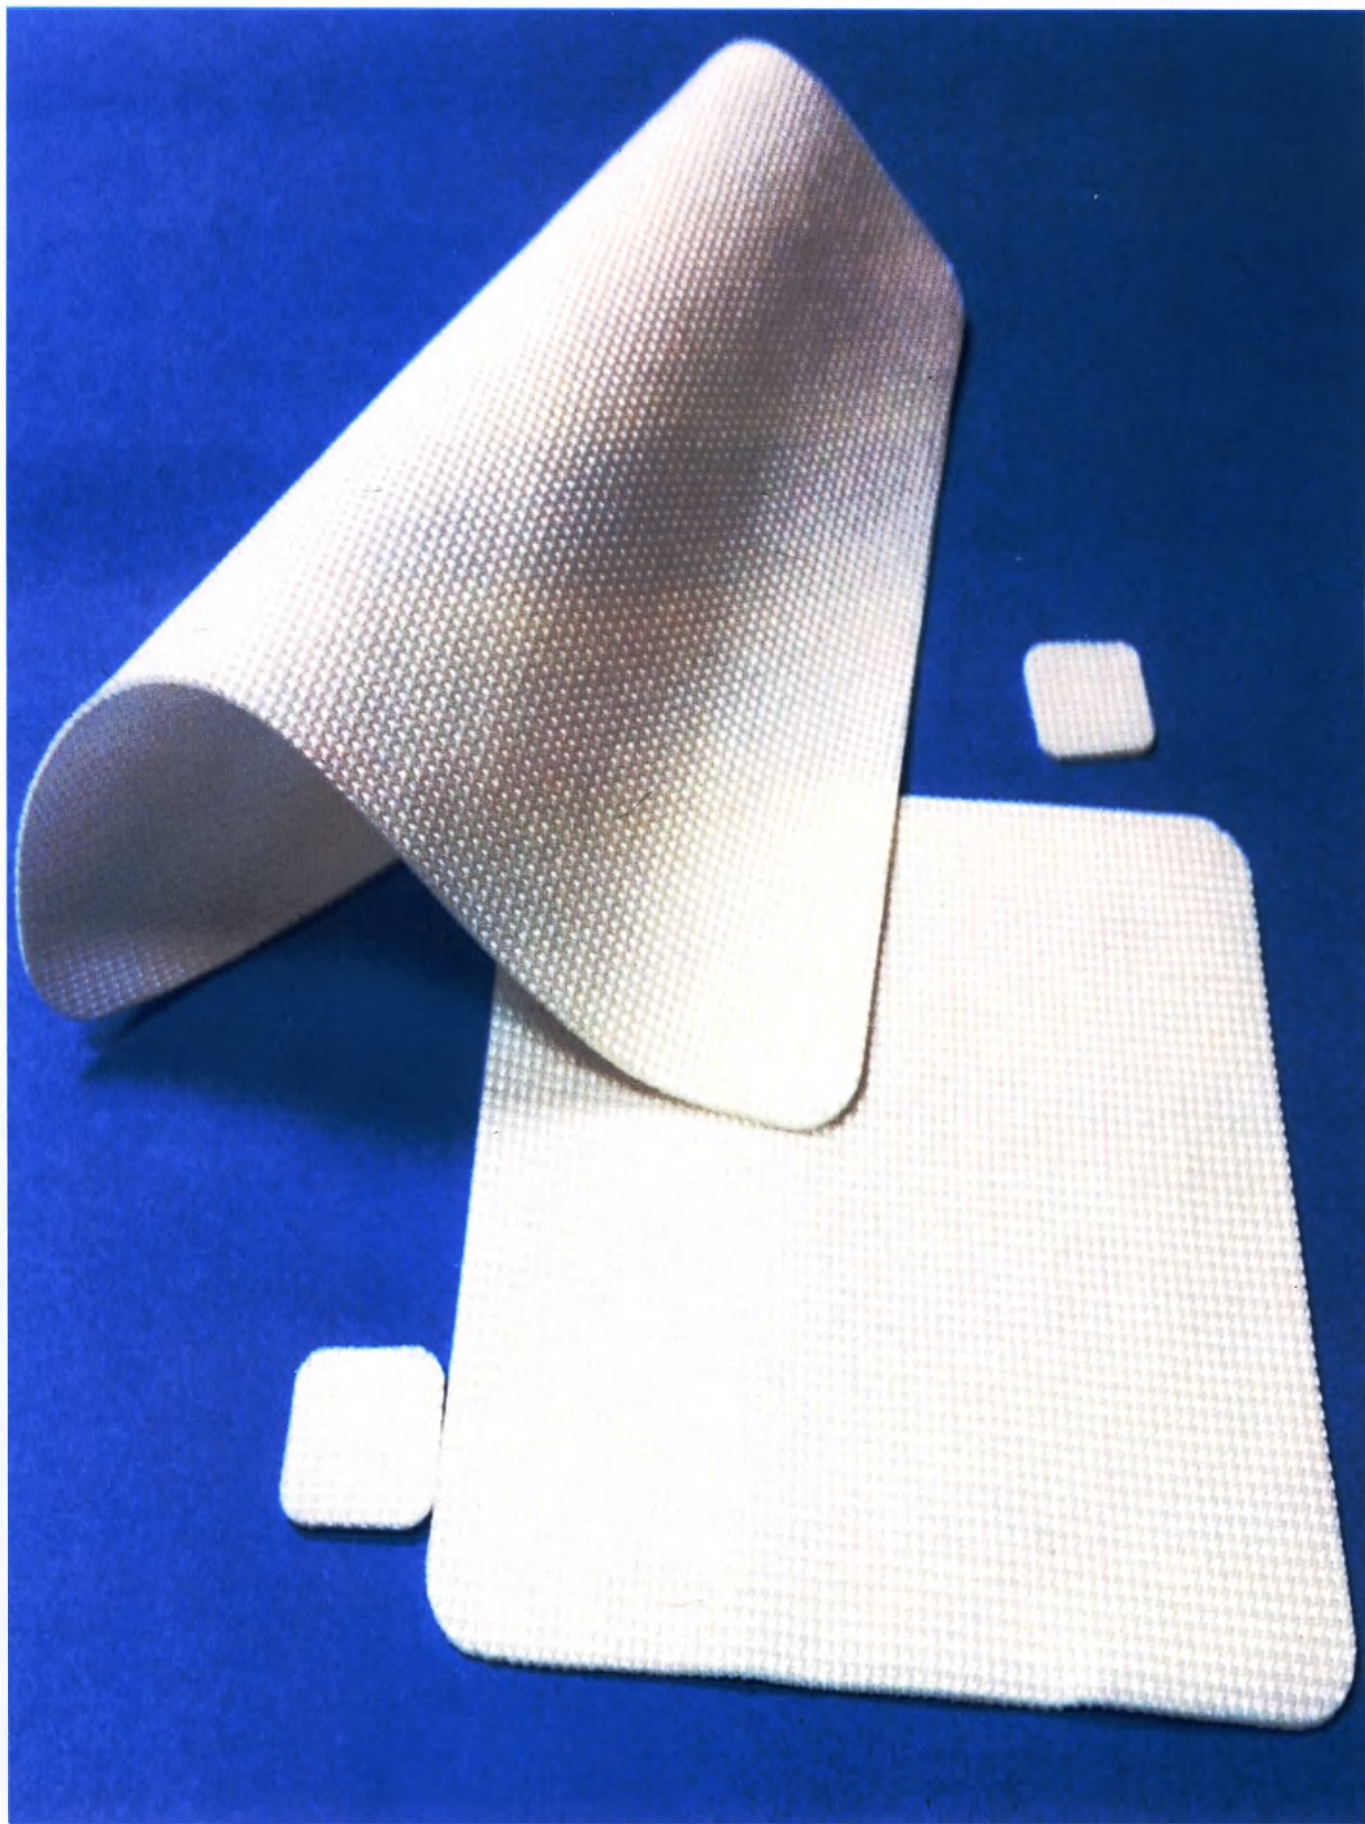


Эндопротез-сетка лавсановый для восстановительной хирургии  
ЭСЛАН тяжелый

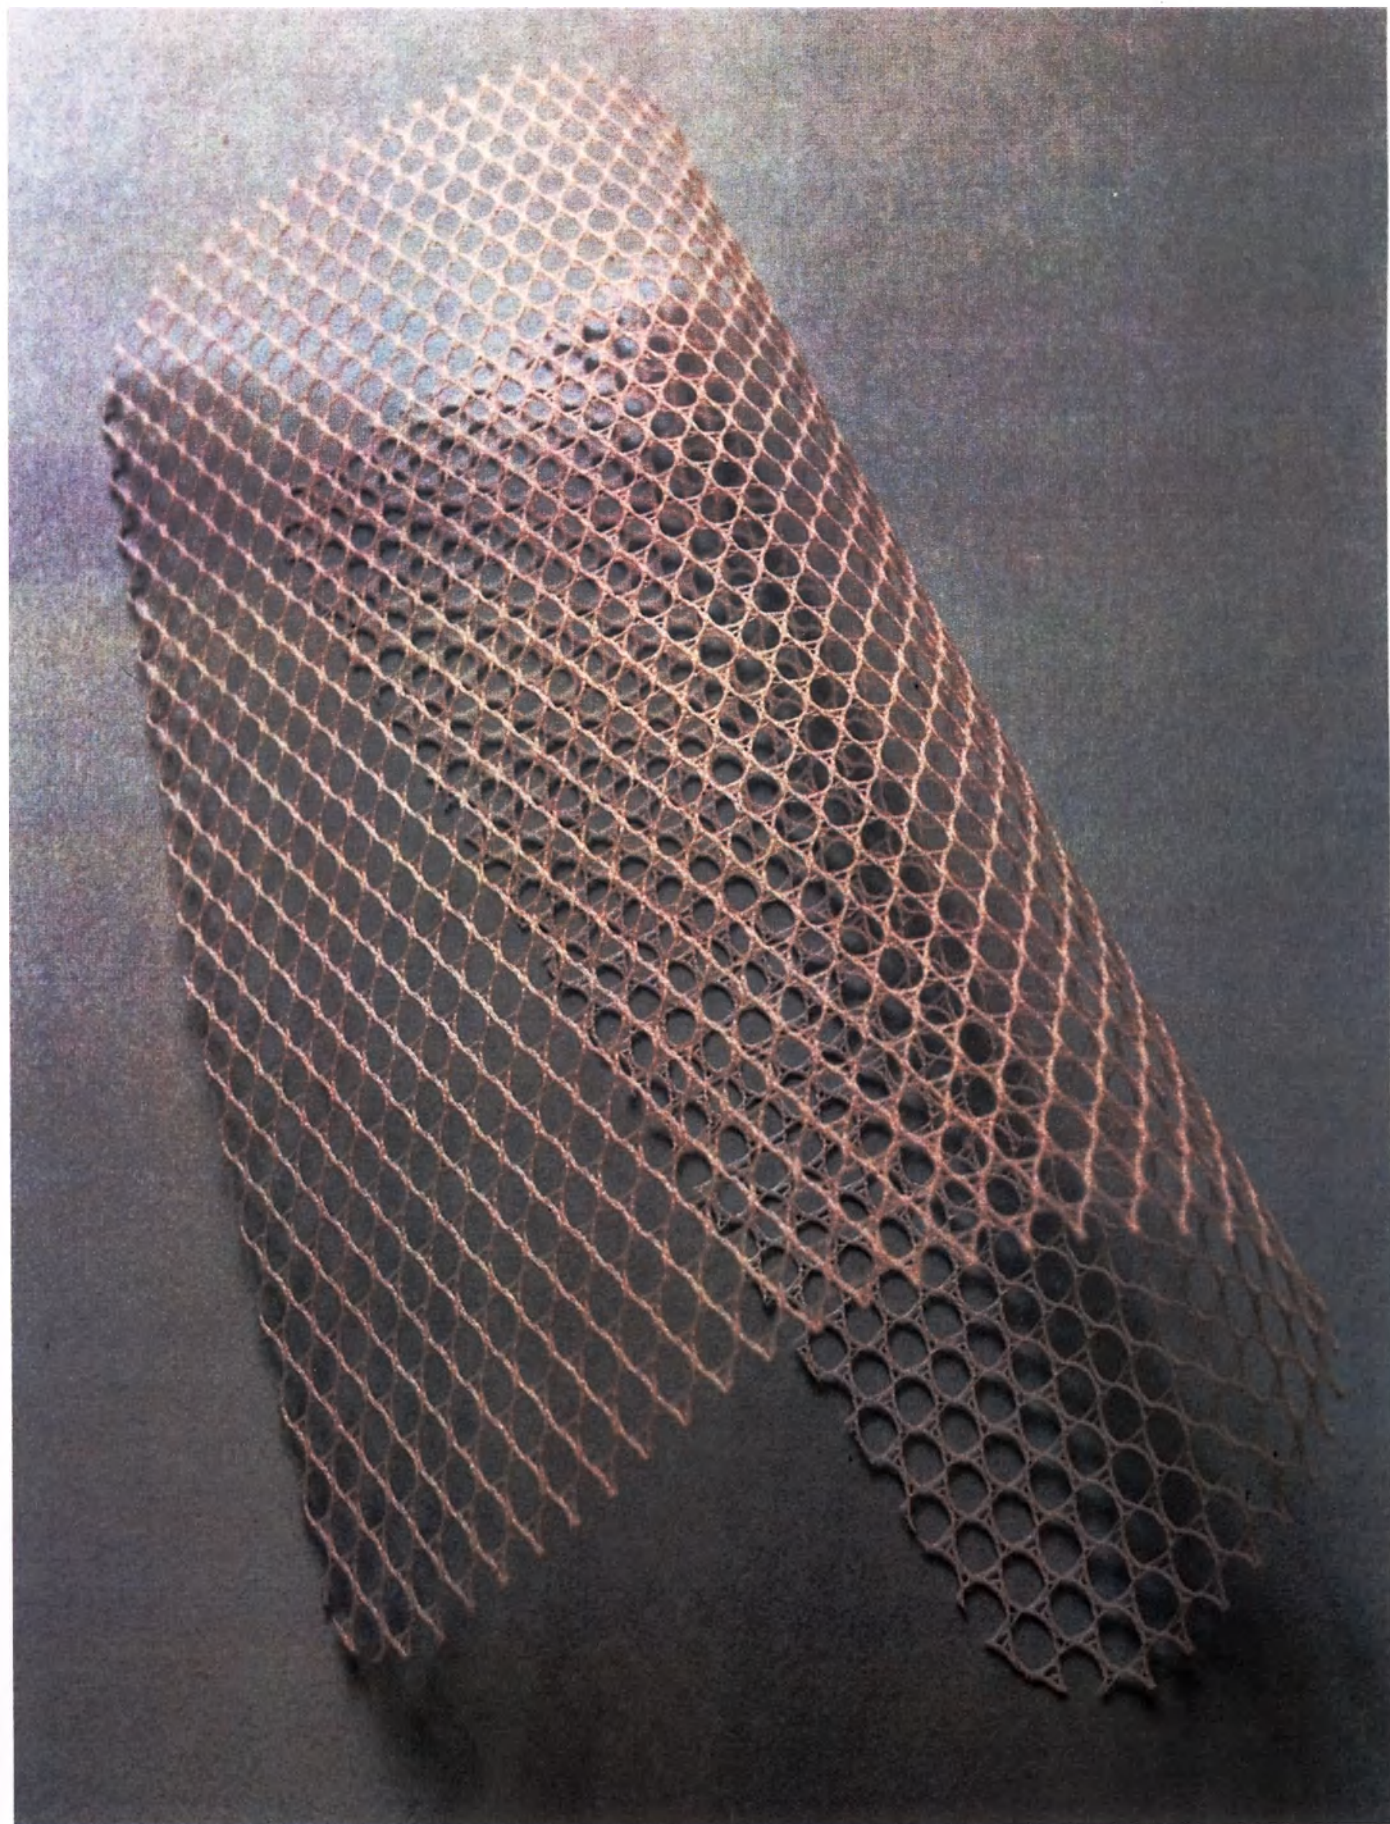



Эндопротез-сетка лавсановый с фторполимерным покрытием для восстановительной хирургии ФТОРЭКС®

## **2 БАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


ЭСФИЛ® стандартный, ЭСФИЛ® легкий, ЭСФИЛ® тяжелый, ЭСФИЛ® усиленный,  
ЭСФИЛ® усиленный, УНИФЛЕКС стандартный, УНИФЛЕКС тяжелый, КАРБОФЛЕКС,  
ФЛЕКСИЛЕН стандартный, ФЛЕКСИЛЕН легкий, ФЛЕКСИЛЕН объемный, УроСлинг®,  
УроСлинг® 1, ЭСЛАН стандартный, ЭСЛАН легкий, ЭСЛАН тяжелый, ФТОРЭКС®  
и Туннелера.

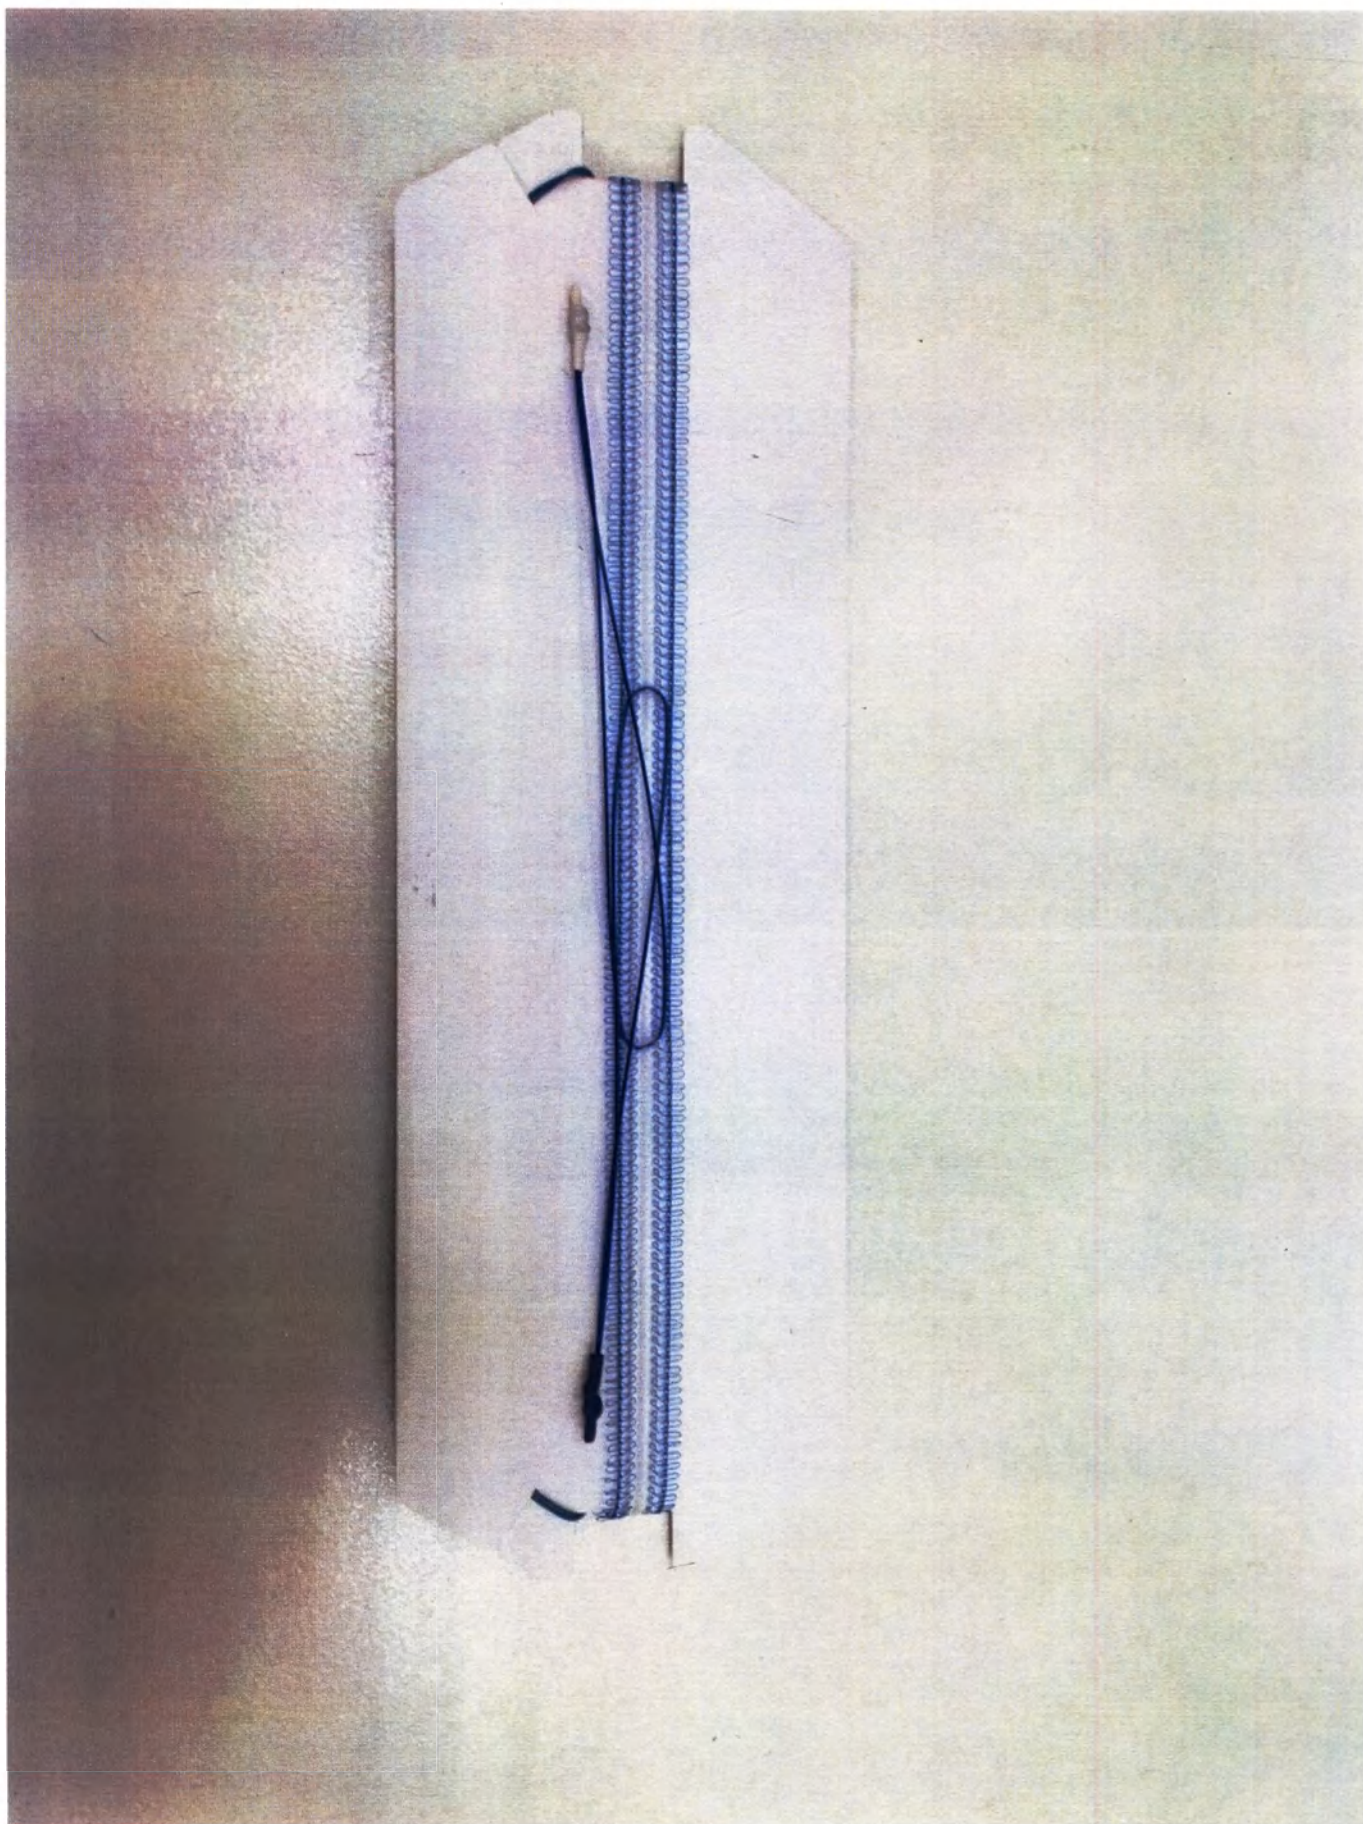


Бумажный носитель для исполнения УроСлинг®

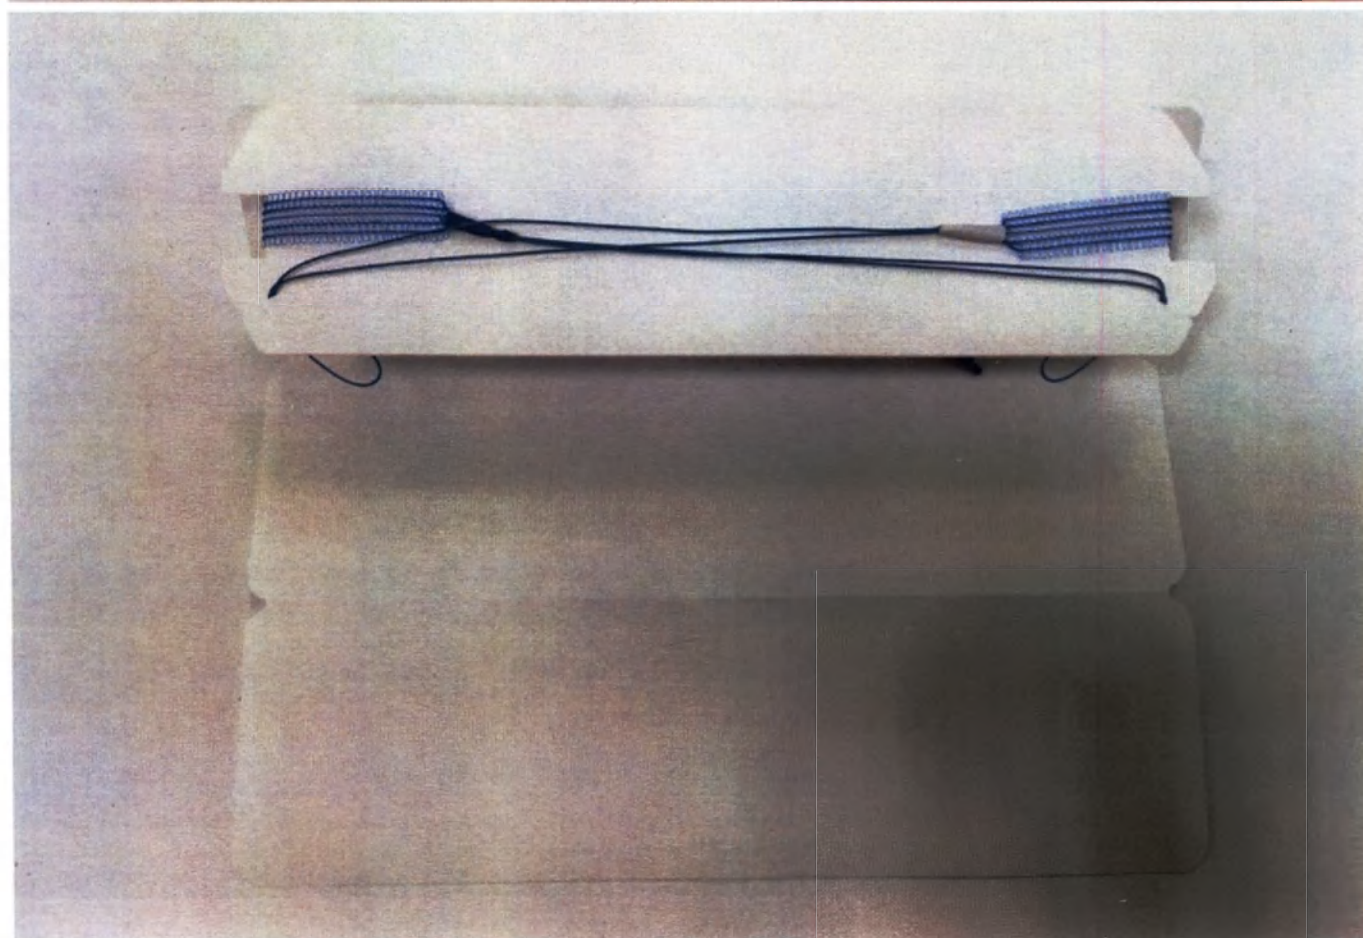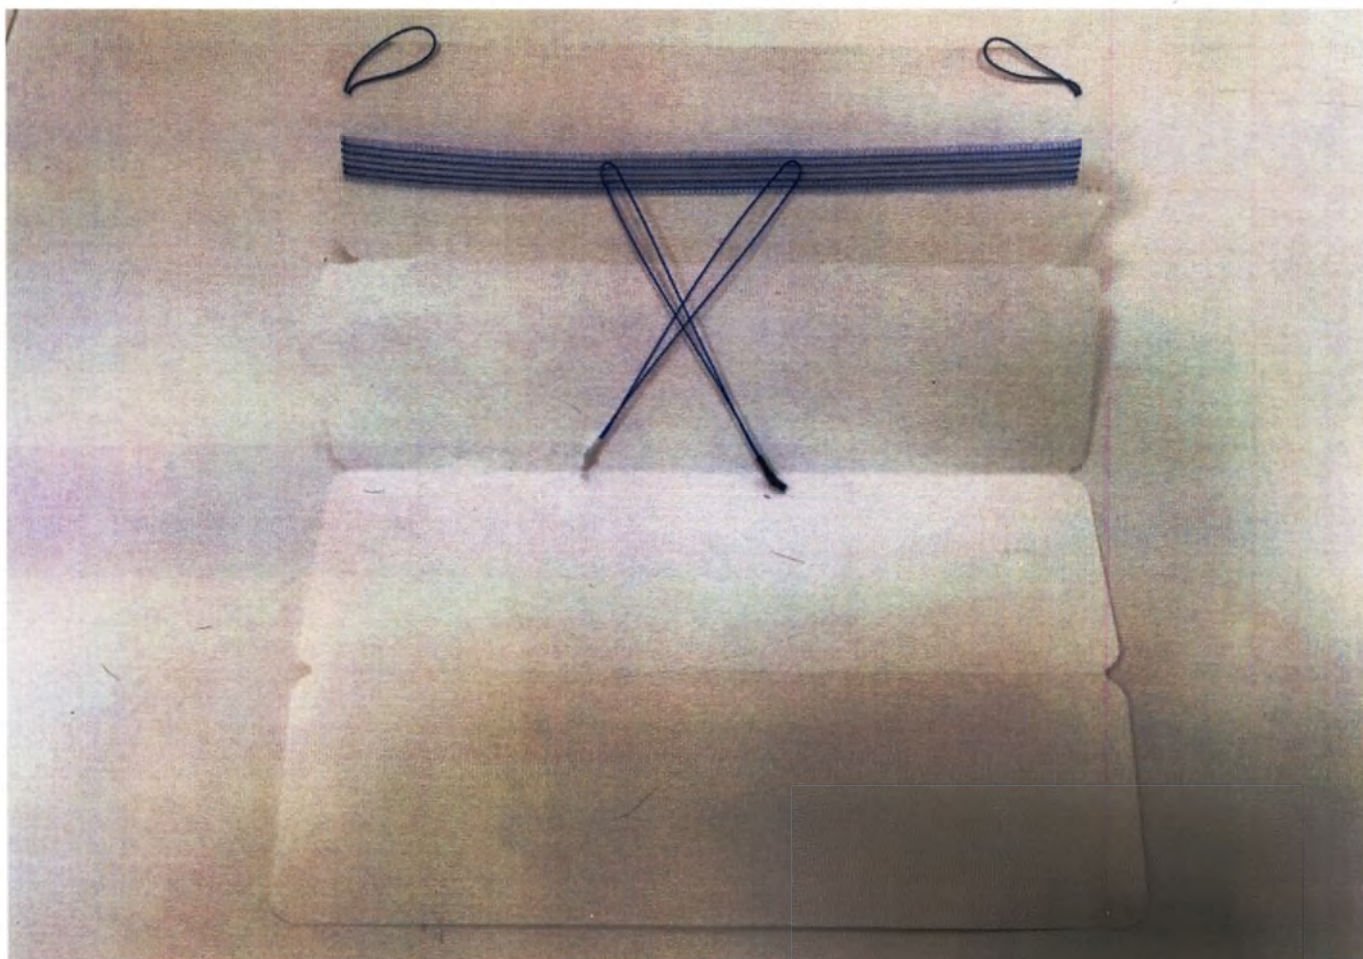



Бумажный носитель для исполнения УроСлинг®

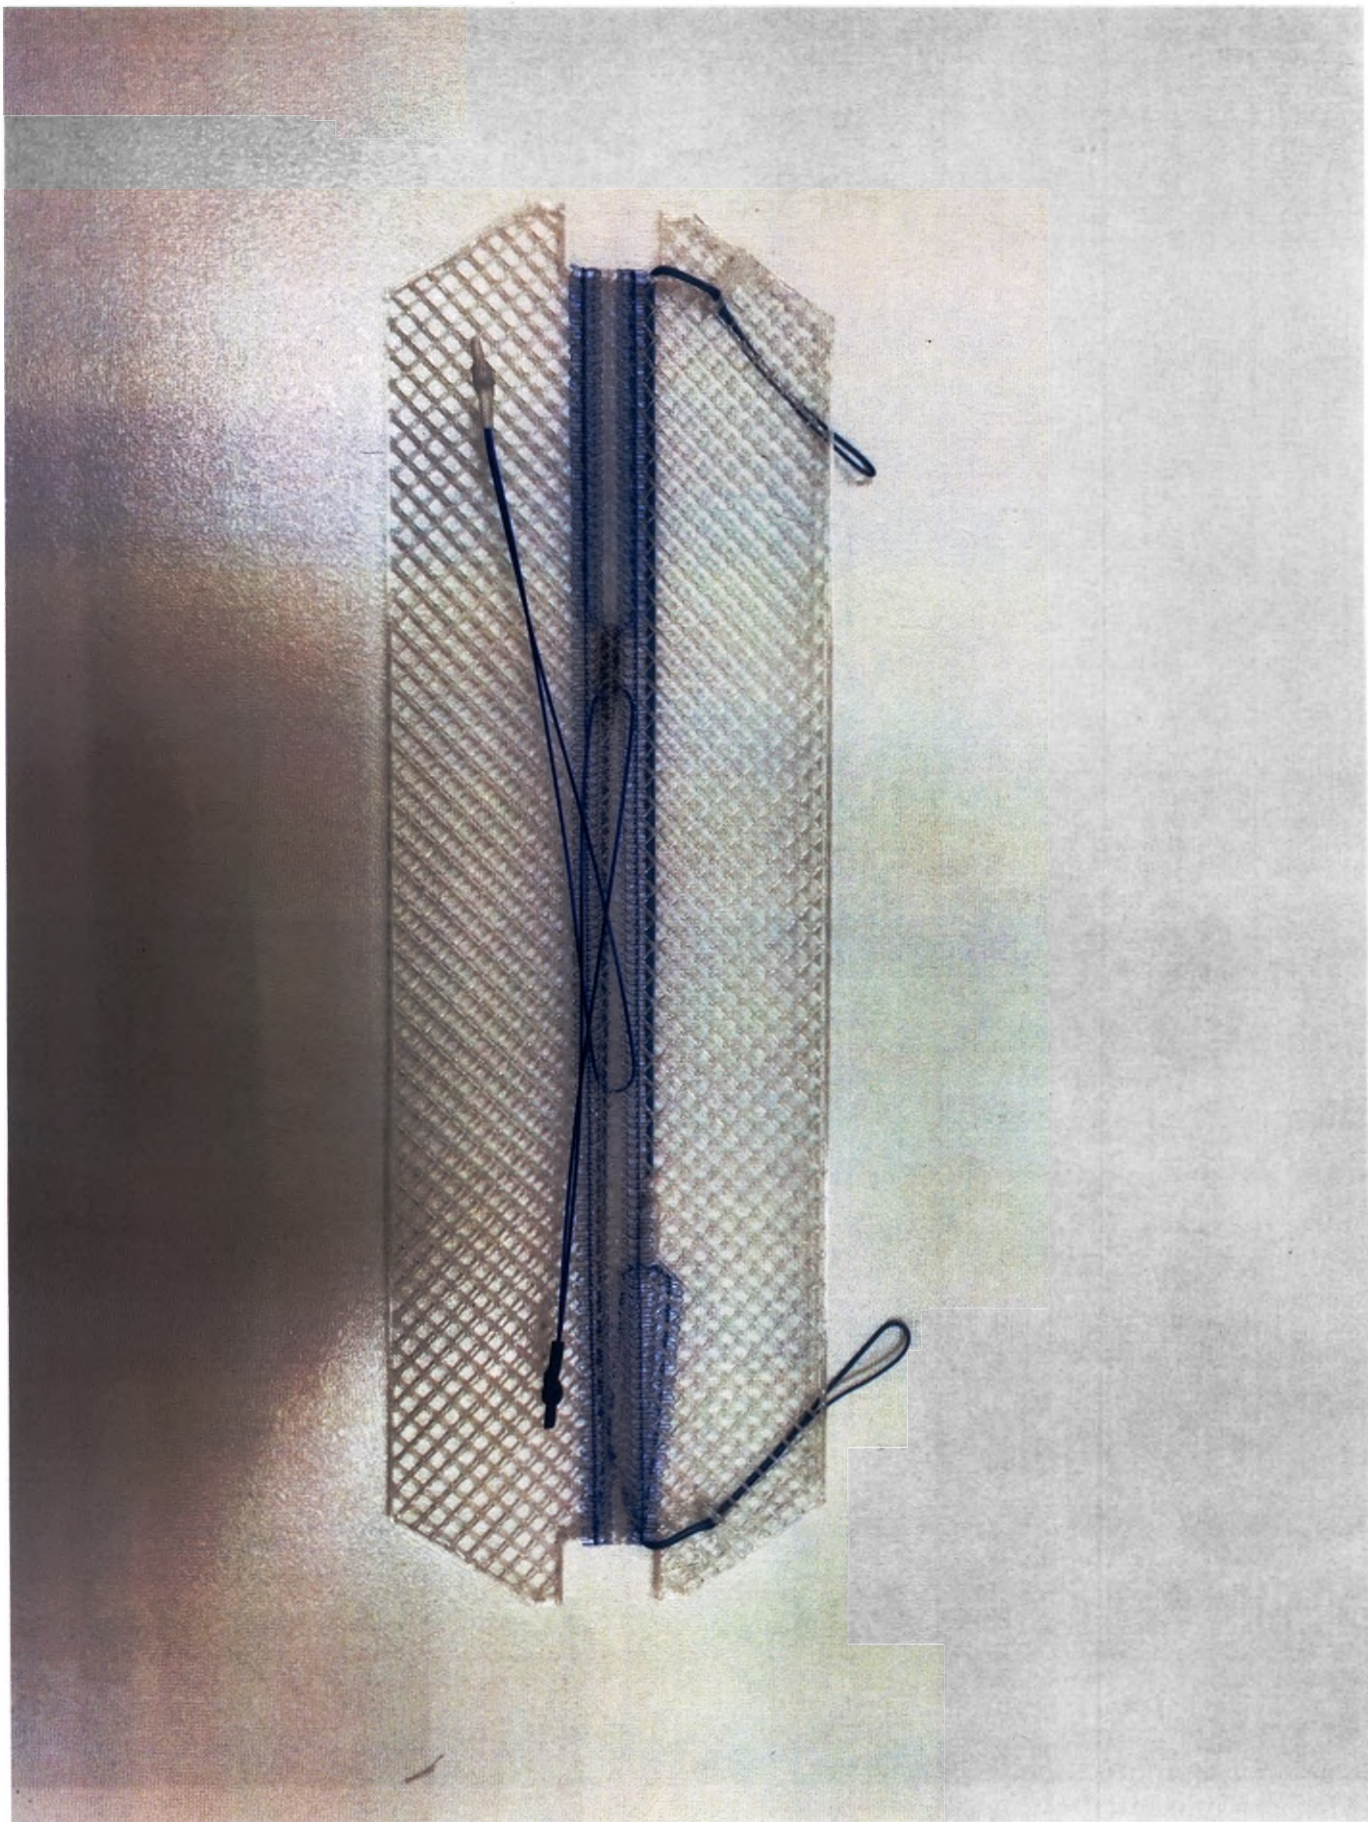


Полимерный носитель для исполнения УроСлинг®

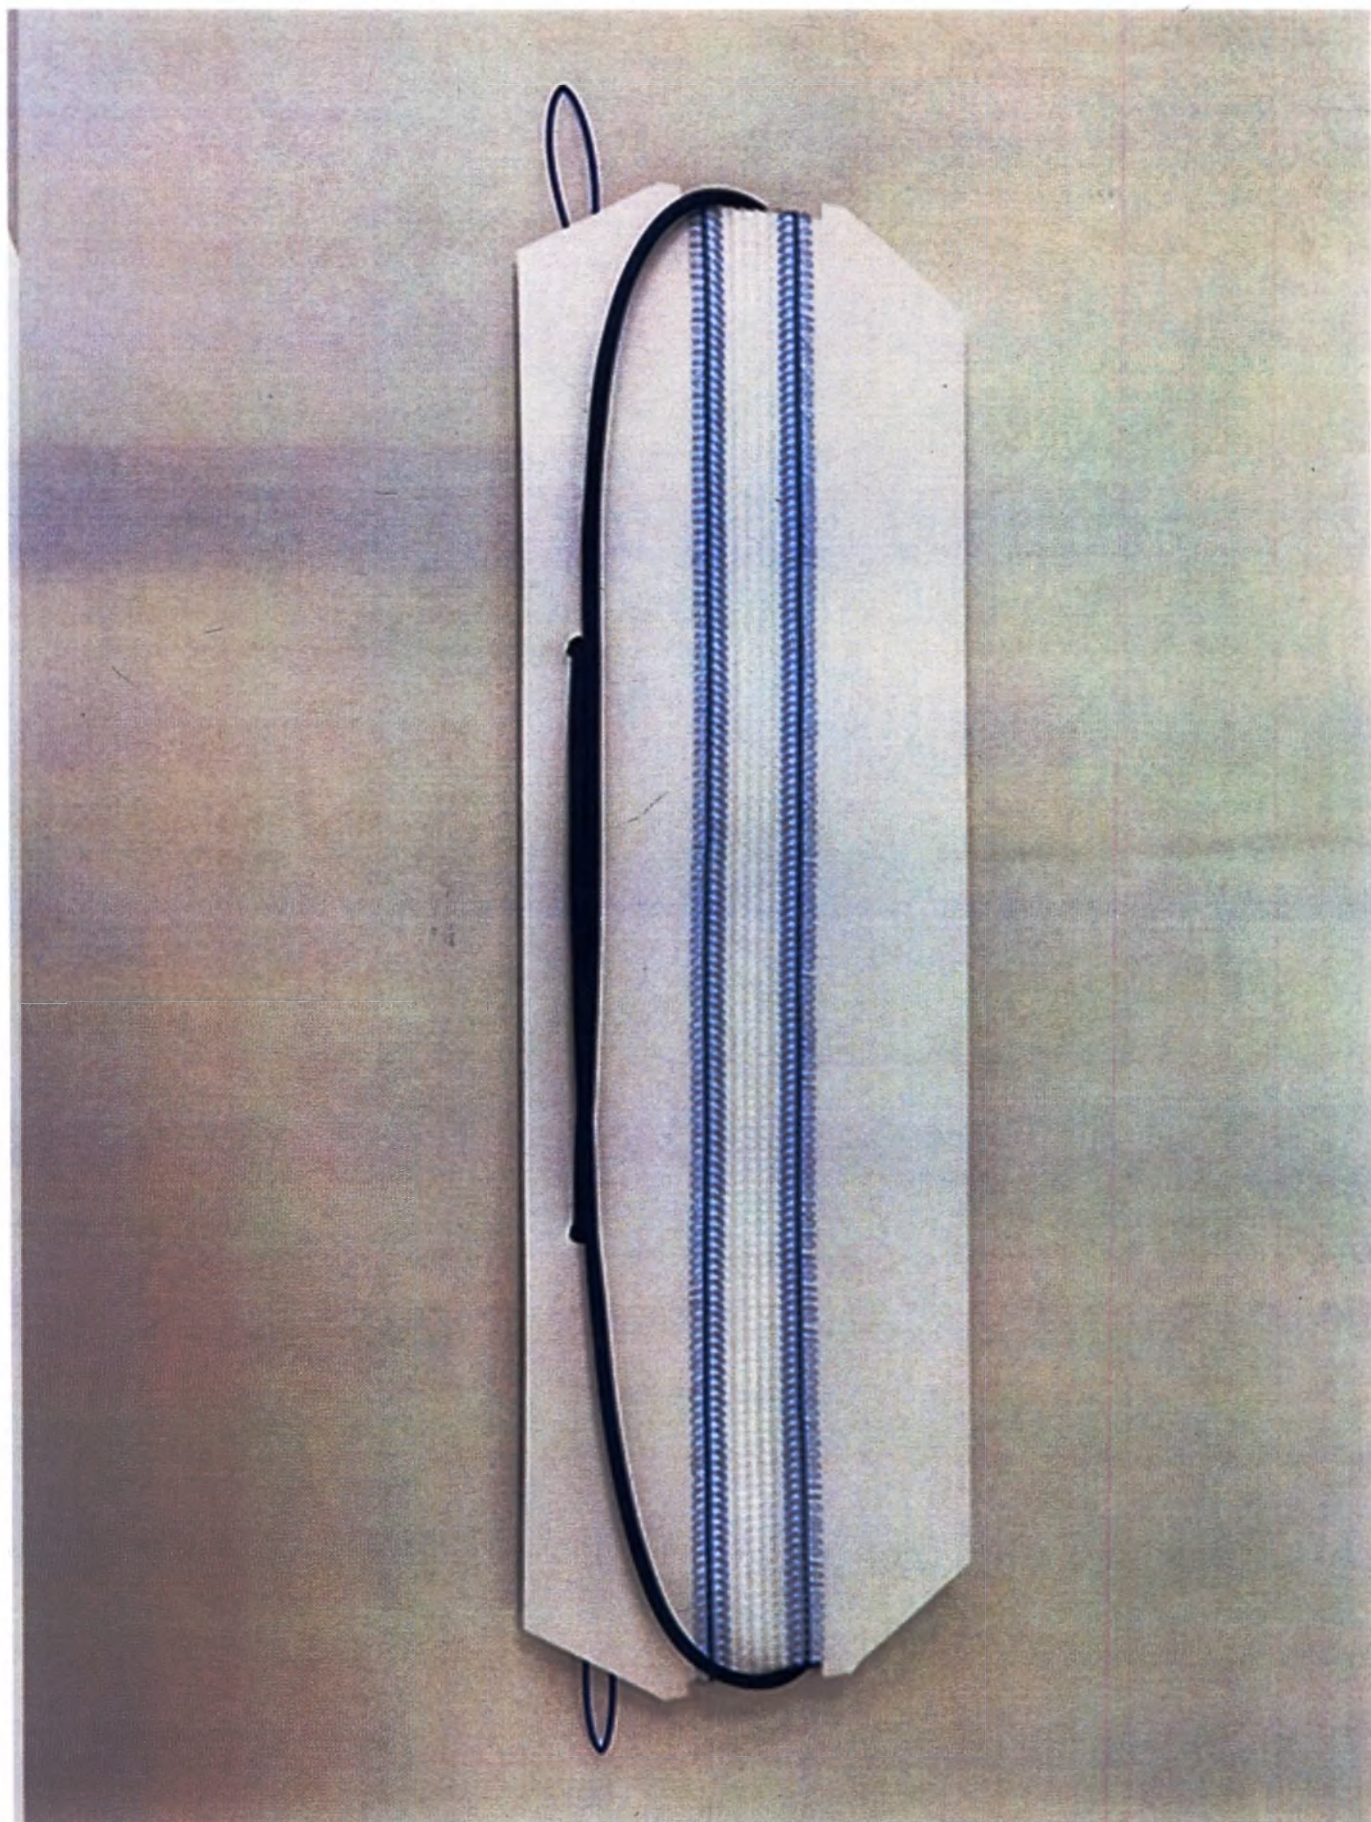


Бумажный носитель для исполнения УроСлинг® 1

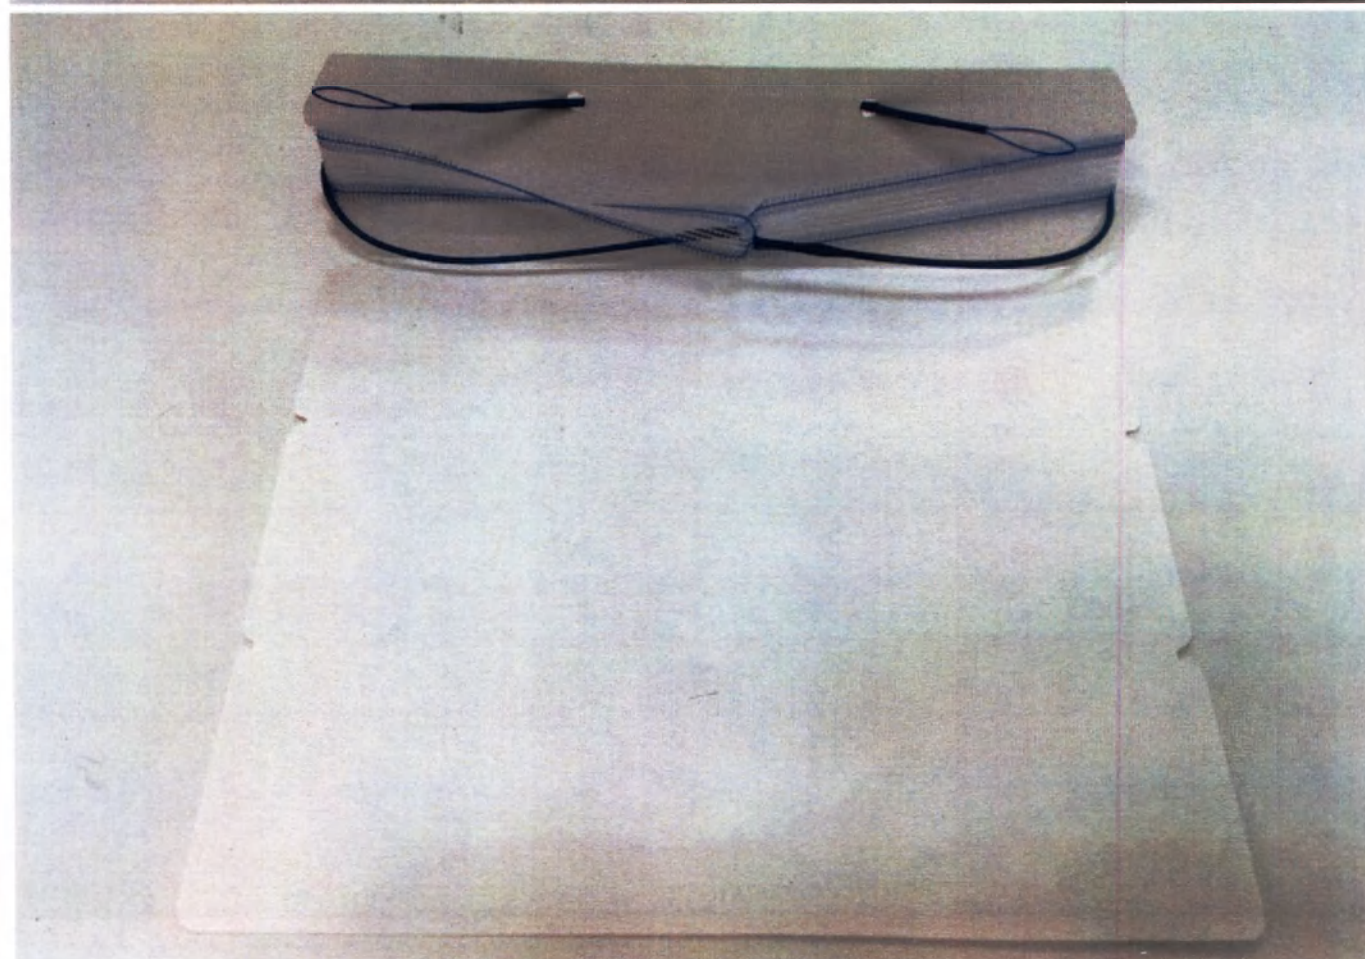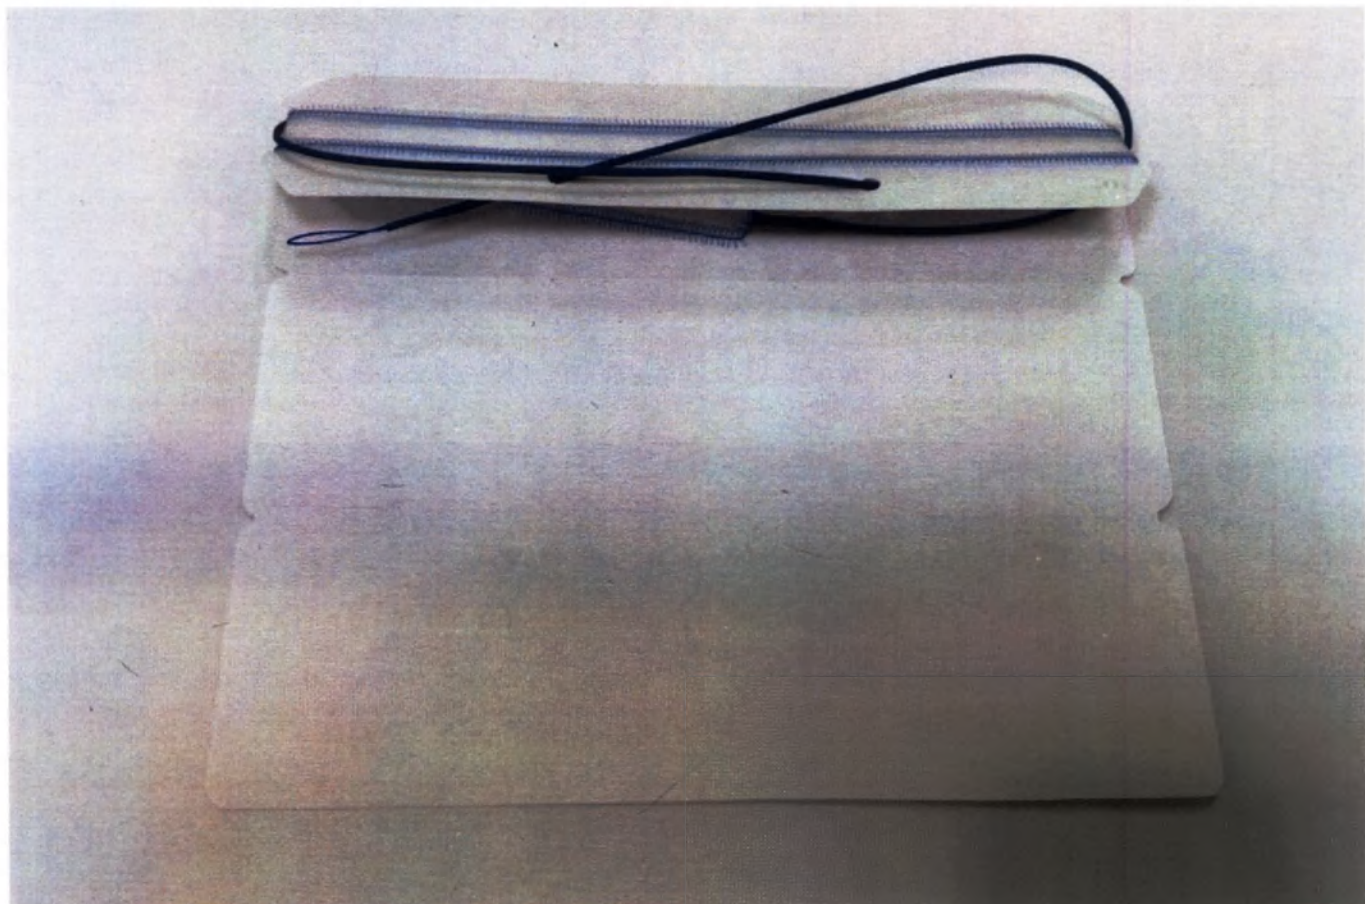


Бумажный носитель для исполнения УроСлинг® 1

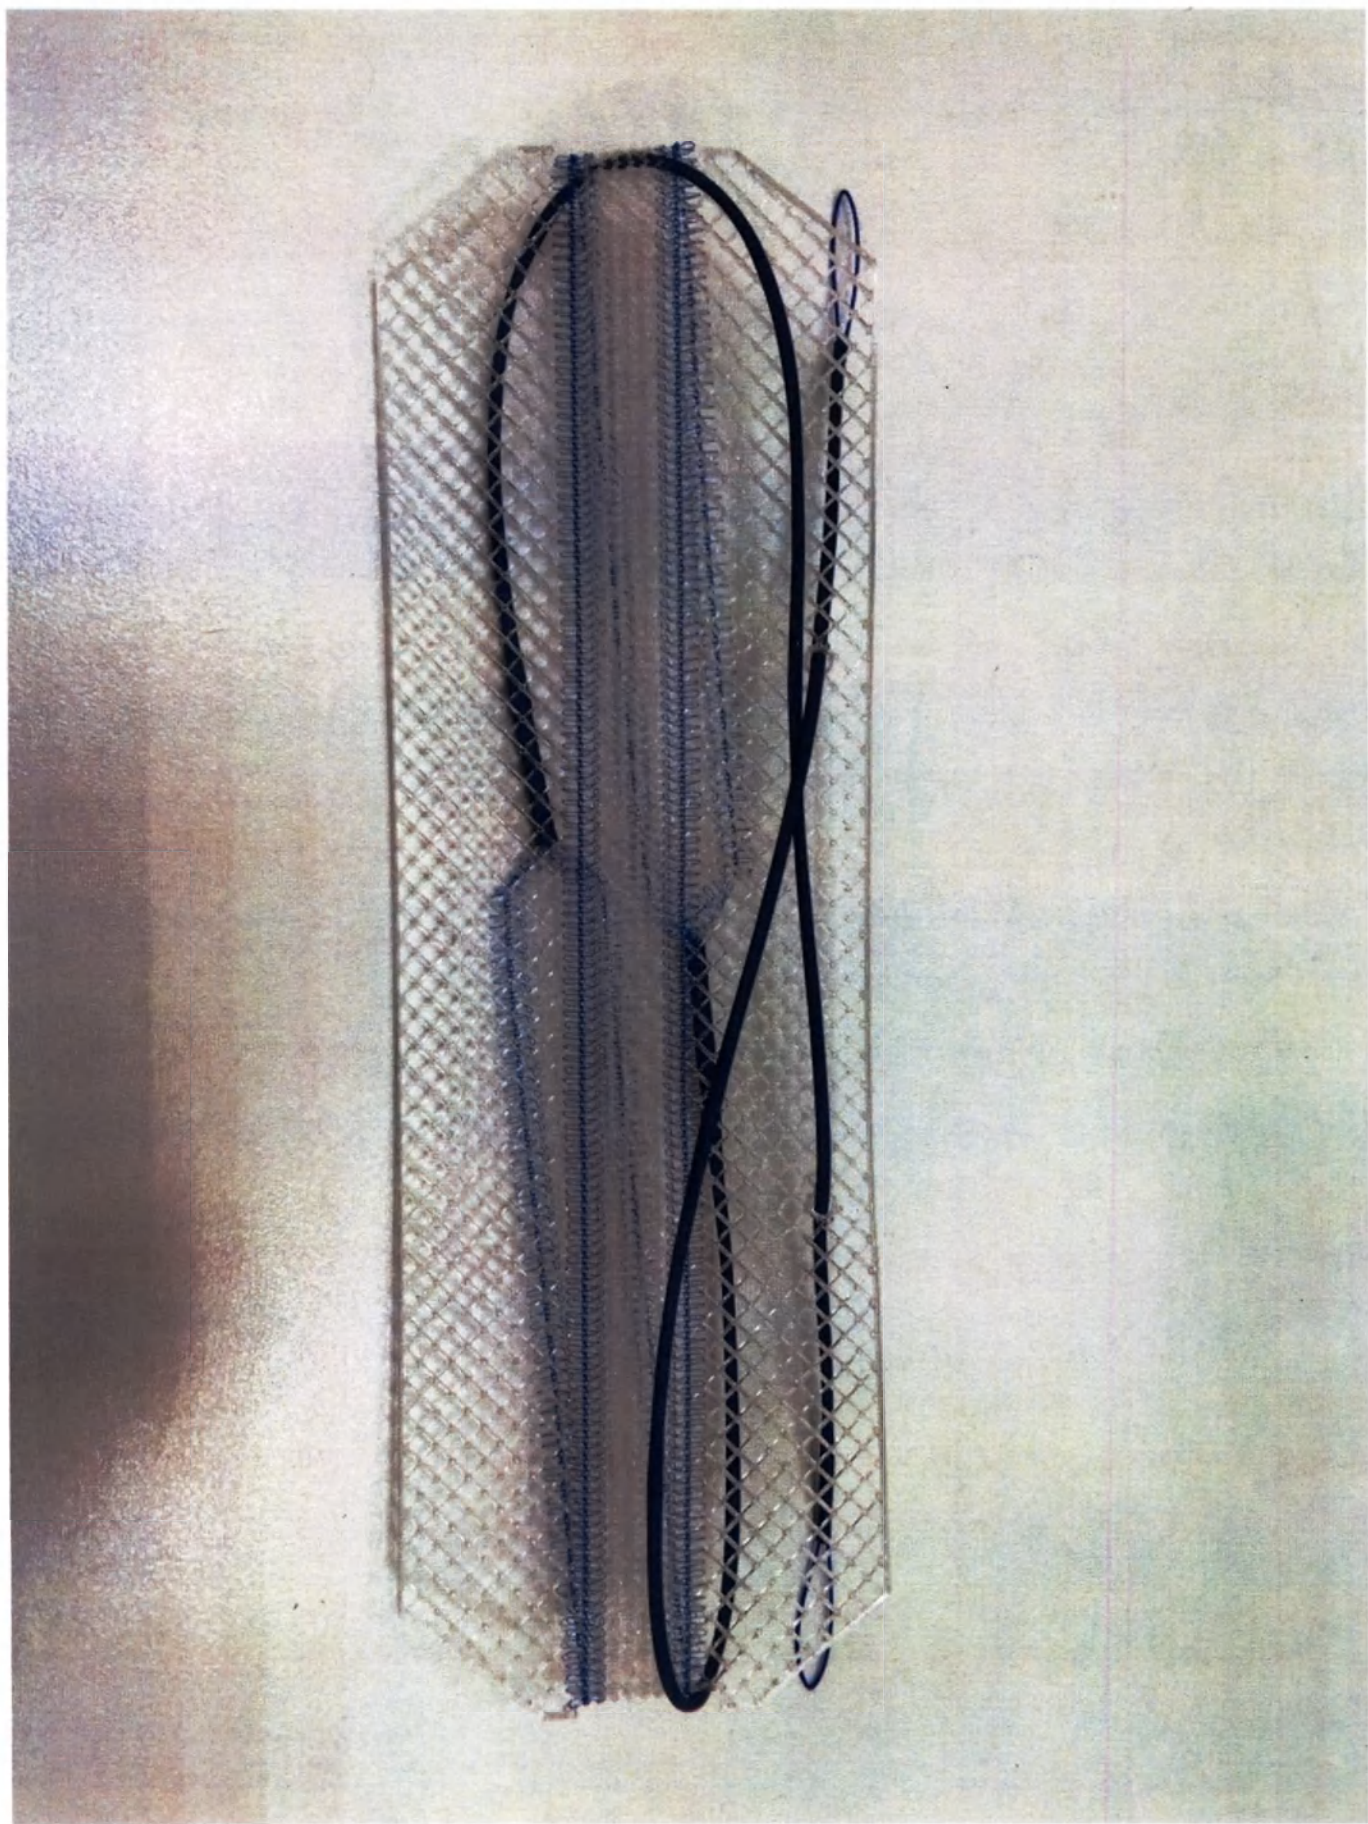

Полимерный носитель для исполнения УроСлинг® 1

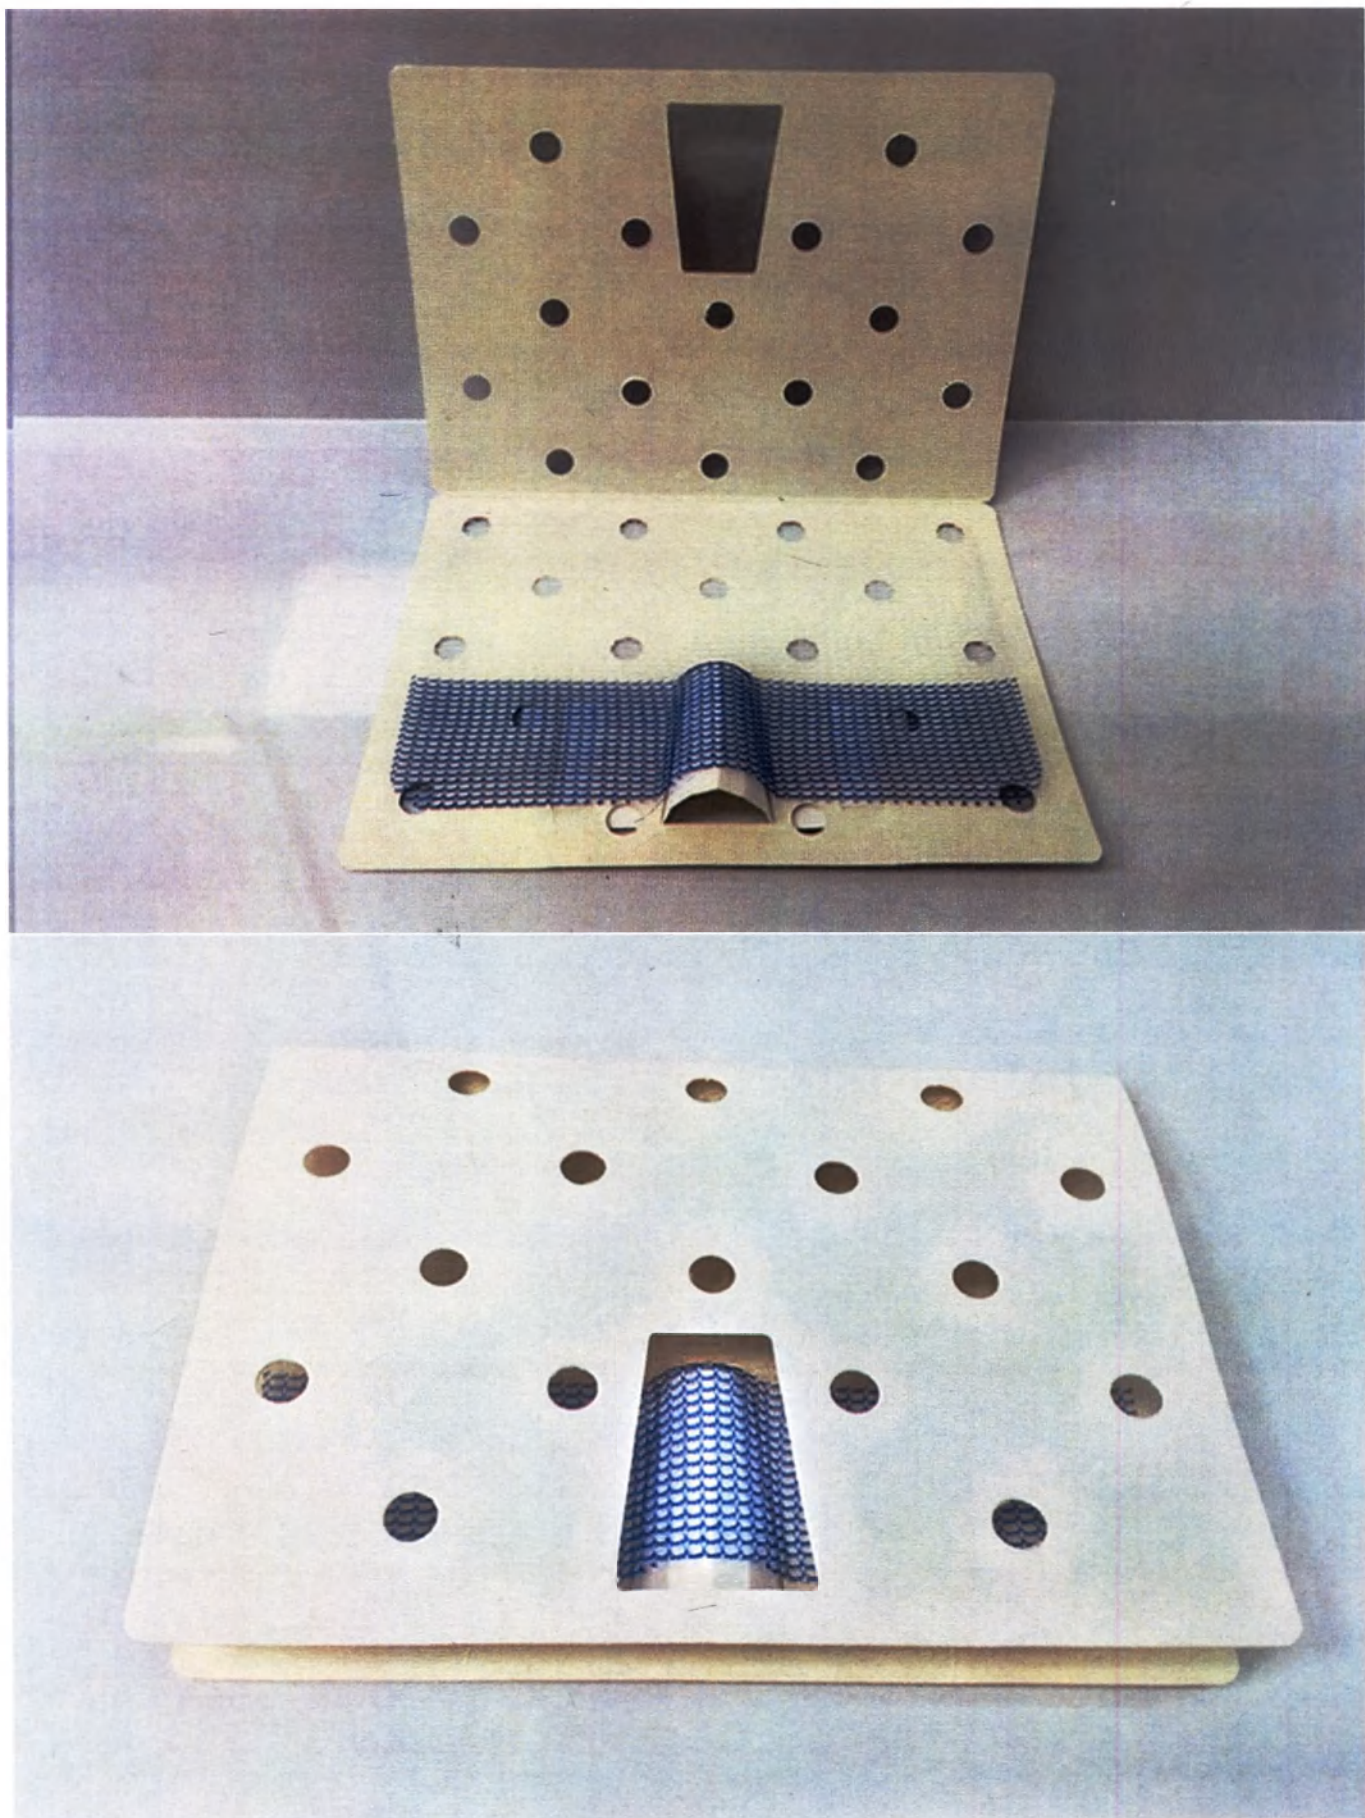

Бумажный носитель для исполнения ФЛЕКСИЛЕН объемный

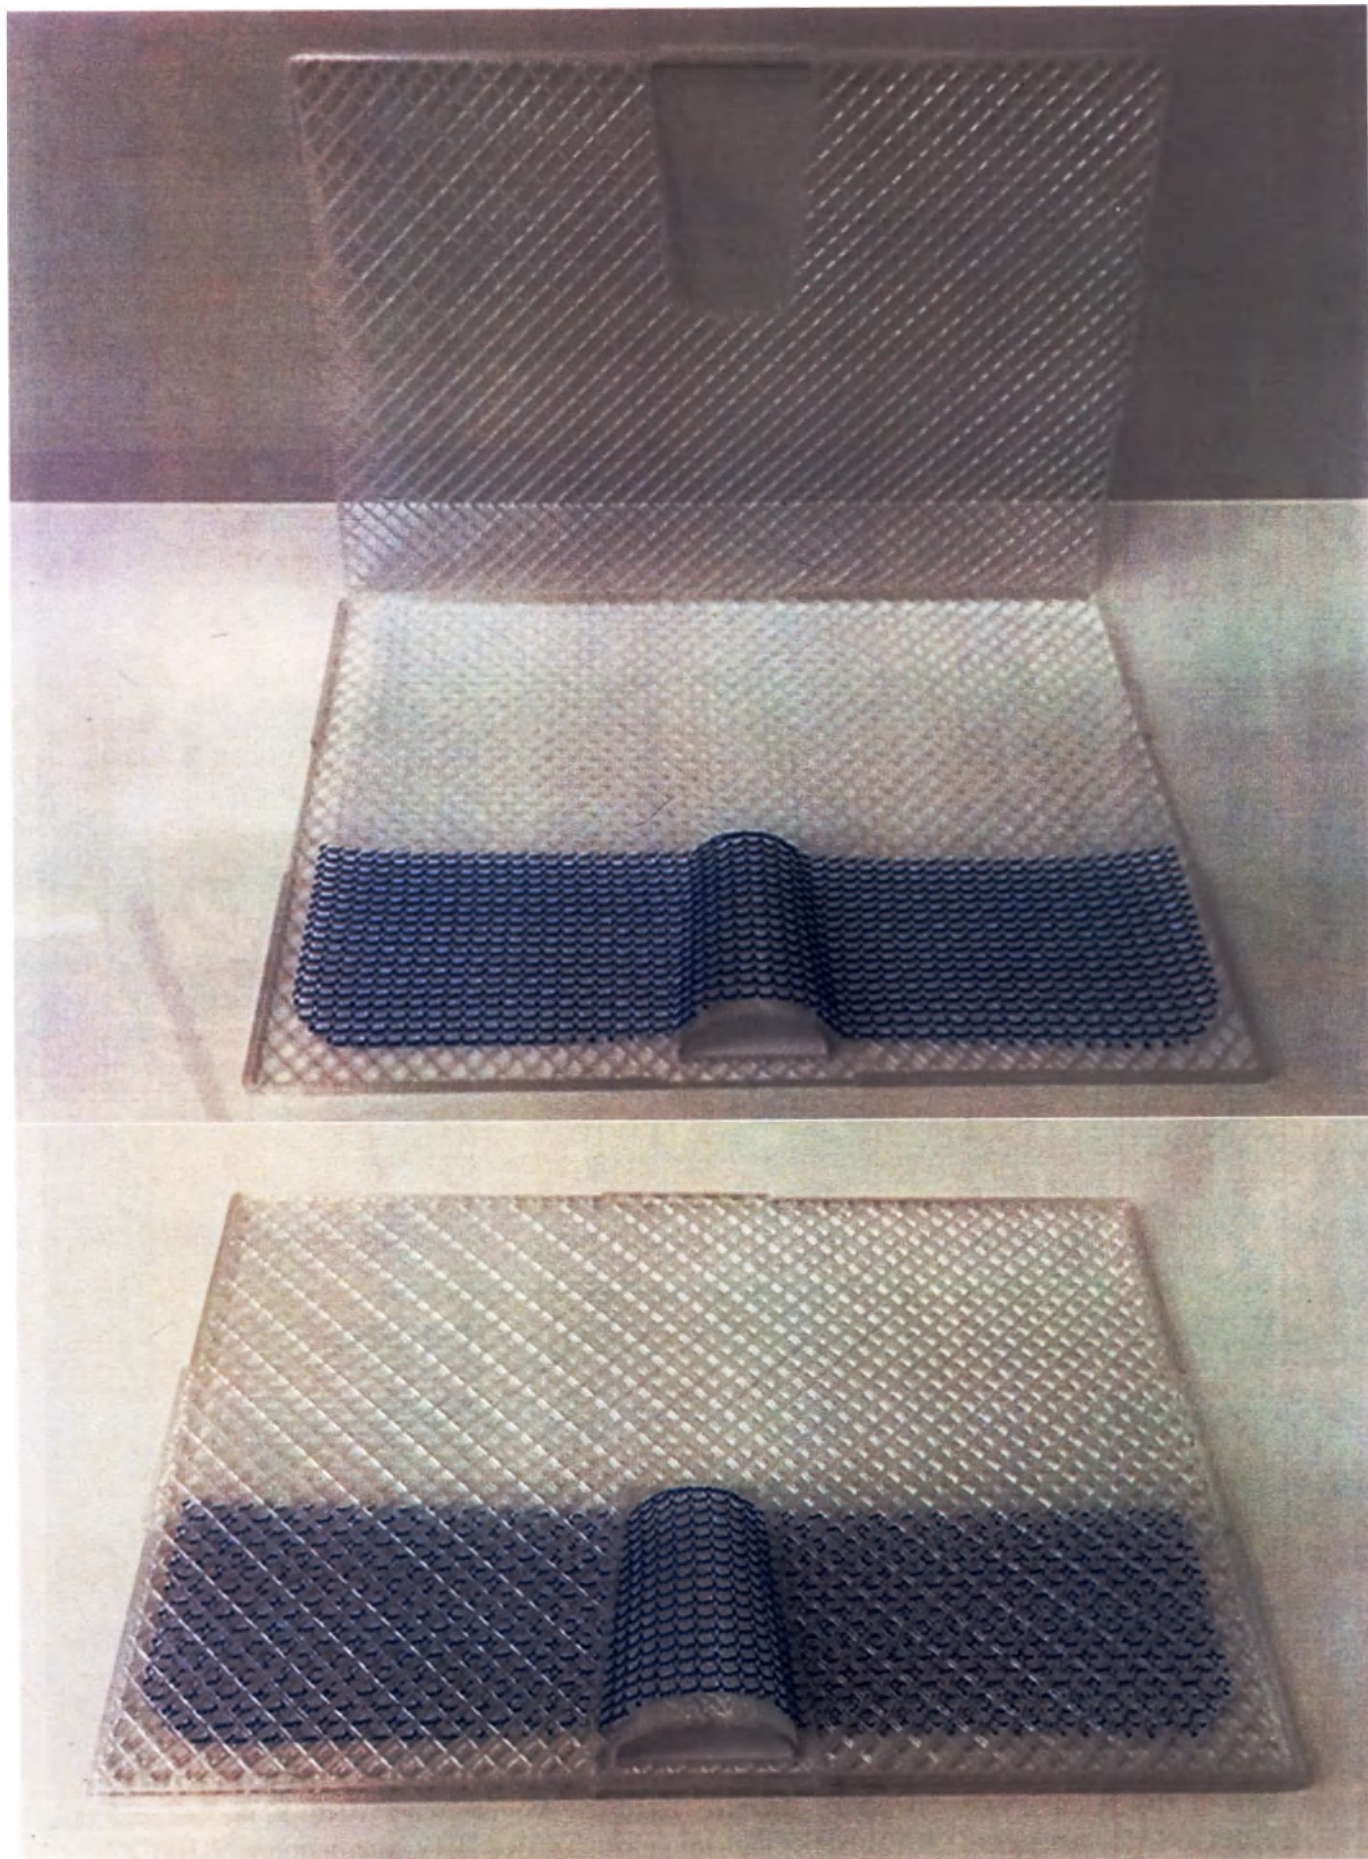


Полимерный носитель для исполнения ФЛЕКСИЛЕН объемный

## 2.2 Внутренний и внешний пакеты



Для исполнений ЭСФИЛ® стандартный, ЭСФИЛ® легкий, ЭСФИЛ® тяжелый, ЭСФИЛ® усиленный, ЭСФИЛ® усиленный, УНИФЛЕКС стандартный, УНИФЛЕКС тяжелый, КАРБОФЛЕКС, ФЛЕКСИЛЕН стандартный, ФЛЕКСИЛЕН легкий, ЭСЛАН стандартный, ЭСЛАН легкий, ЭСЛАН тяжелый, ФТОРЭКС® и Туннелера используют **внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты, без носителя**

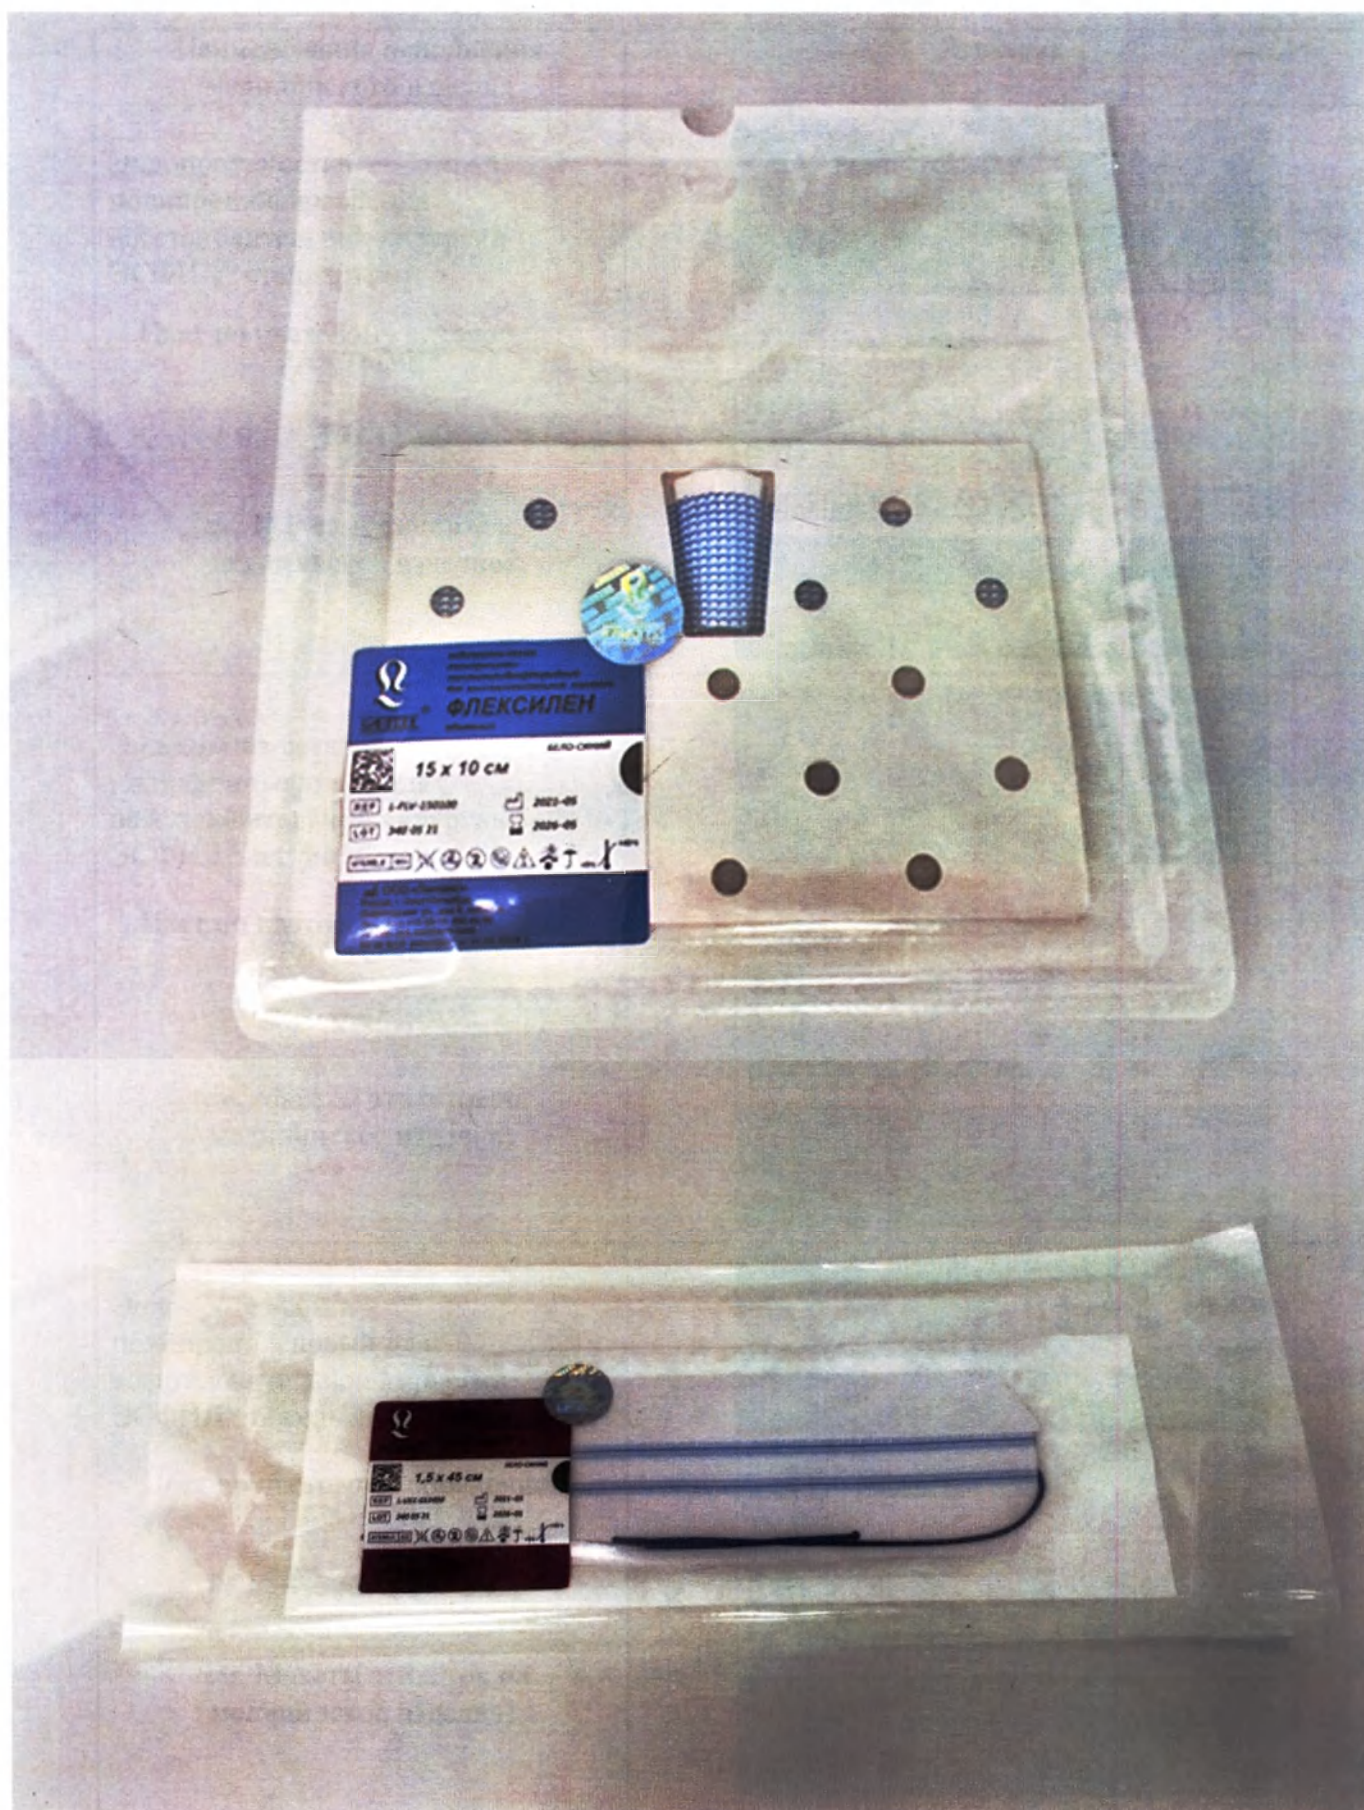

Для исполнений ФЛЕКСИЛЕН объемный, УроСлинг<sup>®</sup>, УроСлинг<sup>®</sup> 1 используют  
 внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты, бумажный или полимерный носитель


## 2.3 Макеты этикеток исполнений медицинского изделия

| Наименование исполнения<br>медицинского изделия                                                                                                                                                                                      | Этикетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропиленовый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСФИЛ® стандартный</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>299 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p> |  <p>Label for ЭСФИЛ® стандартный. The label is blue and white. It features the company logo (a stylized 'L' inside a circle) and the text 'эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии ЭСФИЛ® стандартный'. Below this, there is a section for 'РАЗМЕР' (Size) with a dashed box for 'Длинейный код (при наличии)' (Linear code (if available)). There are also fields for 'REF' and 'LOT'. A row of icons includes 'STERILE', 'EO', and various symbols for handling and storage. At the bottom, the company name 'ООО «Линтекс»' is listed along with its address in Saint-Petersburg, Russia, and contact information.</p> |
| <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропиленовый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСФИЛ® легкий</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>305C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>       |  <p>Label for ЭСФИЛ® легкий. The label is blue and white. It features the company logo and the text 'эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии ЭСФИЛ® легкий'. Below this, there is a section for 'РАЗМЕР' (Size) with a dashed box for 'Длинейный код (при наличии)' (Linear code (if available)). There are also fields for 'REF' and 'LOT'. A row of icons includes 'STERILE', 'EO', and various symbols for handling and storage. At the bottom, the company name 'ООО «Линтекс»' is listed along with its address in Saint-Petersburg, Russia, and contact information.</p>                                           |
| <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропиленовый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСФИЛ® тяжелый</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>3005 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>    |  <p>Label for ЭСФИЛ® тяжелый. The label is blue and white. It features the company logo and the text 'эндопротез-сетка полипропиленовый для восстановительной хирургии ЭСФИЛ® тяжелый'. Below this, there is a section for 'РАЗМЕР' (Size) with a dashed box for 'Длинейный код (при наличии)' (Linear code (if available)). There are also fields for 'REF' and 'LOT'. A row of icons includes 'STERILE', 'EO', and various symbols for handling and storage. At the bottom, the company name 'ООО «Линтекс»' is listed along with its address in Saint-Petersburg, Russia, and contact information.</p>                                        |

| Наименование исполнения<br>медицинского изделия                                                                                                                                                                                       | Этикетка                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропиленовый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСФИЛ® усиленный</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p>317 C</p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>           |    |
| <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропиленовый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСФИЛ® усиленный 1</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p>317 C</p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>         |   |
| <p>Эндопротез-сетка<br/>поливинилиденфторидный для<br/>восстановительной хирургии<br/>УНИФЛЕКС стандартный</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p>285 C</p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p> |  |

| Наименование исполнения<br>медицинского изделия                                                                                                                                                                                                                             | Этикетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эндопротез-сетка<br/>поливинилиденфторидный для<br/>восстановительной хирургии<br/><b>УНИФЛЕКС</b> тяжелый</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/><b>PANTONE®</b></p> <p><b>285 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>                      |  <p>эндопротез-сетка<br/>поливинилиденфторидный<br/>для восстановительной хирургии<br/><b>УНИФЛЕКС</b><br/>тяжелый</p> <p>РАЗМЕР</p> <p>ЦВЕТ</p> <p>СТЕРИЛЬНОСТЬ</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-68257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от</p>                          |
| <p>Эндопротез-сетка<br/>поливинилиденфторидный с<br/>карбиновым покрытием для<br/>восстановительной хирургии<br/><b>КАРБОФЛЕКС</b></p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/><b>PANTONE®</b></p> <p><b>471 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p> |  <p>эндопротез-сетка поливинилиден-<br/>фторидный с карбиновым покрытием<br/>для восстановительной хирургии<br/><b>КАРБОФЛЕКС</b></p> <p>РАЗМЕР</p> <p>ЦВЕТ</p> <p>СТЕРИЛЬНОСТЬ</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-68257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от</p>          |
| <p>Эндопротез-сетка полипропилен-<br/>поливинилиденфторидный для<br/>восстановительной хирургии<br/><b>ФЛЕКСИЛЕН</b> стандартный</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/><b>PANTONE®</b></p> <p><b>2635 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>  |  <p>эндопротез-сетка<br/>полипропилен-<br/>поливинилиденфторидный<br/>для восстановительной хирургии<br/><b>ФЛЕКСИЛЕН</b><br/>стандартный</p> <p>РАЗМЕР</p> <p>ЦВЕТ</p> <p>СТЕРИЛЬНОСТЬ</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-68257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от</p> |


| Наименование исполнения<br>медицинского изделия                                                                                                                                                                                                           | Этикетка                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии<br/><b>ФЛЕКСИЛЕН</b> легкий</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/><b>PANTONE®</b></p> <p><b>2635 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на медицинское изделие)</p>  |    |
| <p>Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии<br/><b>ФЛЕКСИЛЕН</b> объёмный</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/><b>PANTONE®</b></p> <p><b>272 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на медицинское изделие)</p> |   |
| <p>Эндопротез-сетка полипропилен-поливинилиденфторидный для восстановительной хирургии<br/><b>УроСлинг®</b></p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/><b>PANTONE®</b></p> <p><b>190 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на медицинское изделие)</p>          |  |
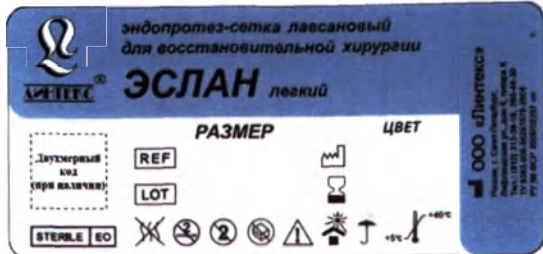
| Наименование исполнения<br>медицинского изделия                                                                                                                                                                               | Этикетка                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропиленовый для<br/>восстановительной хирургии<br/>УроСлинг® 1</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>193 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p> |    |
| <p>Эндопротез-сетка лавсановый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСЛАН стандартный</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>429 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>     |   |
| <p>Эндопротез-сетка лавсановый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСЛАН легкий</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>644 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>          |  |

| Наименование исполнения<br>медицинского изделия                                                                                                                                                                                                 | Этикетка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>Эндопротез-сетка лавсановый для<br/>восстановительной хирургии<br/>ЭСЛАН тяжёлый</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>429 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>                           |          |
| <p>Эндопротез-сетка лавсановый с<br/>фторкаучуковым покрытием для<br/>восстановительной хирургии<br/>ФТОРЭКС®</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p><b>382 C</b></p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p> |          |
| <p>Туннелер</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p>-</p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>                                                                                                              |          |
| <p>Идентификационная этикетка</p> <p>Цвет по цветовому справочнику<br/>PANTONE®</p> <p>-</p> <p>(см. Макеты этикеток на<br/>медицинское изделие)</p>                                                                                            |          |

### **3 ЗАЩИТНАЯ УПАКОВКА (КАРТОННЫЙ КОНВЕРТ) ИСПОЛНЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ЭСФИЛ® стандартный, ЭСФИЛ® легкий, ЭСФИЛ® тяжелый, ЭСФИЛ® усиленный,  
ЭСФИЛ® усиленный, УНИФЛЕКС стандартный, УНИФЛЕКС тяжелый, КАРБОФЛЕКС,  
ФЛЕКСИЛЕН стандартный, ФЛЕКСИЛЕН легкий,  
ФЛЕКСИЛЕН объемный, УроСлинг®, УроСлинг® 1, ЭСЛАН стандартный,  
ЭСЛАН легкий, ЭСЛАН тяжелый, ФТОРЭКС®**

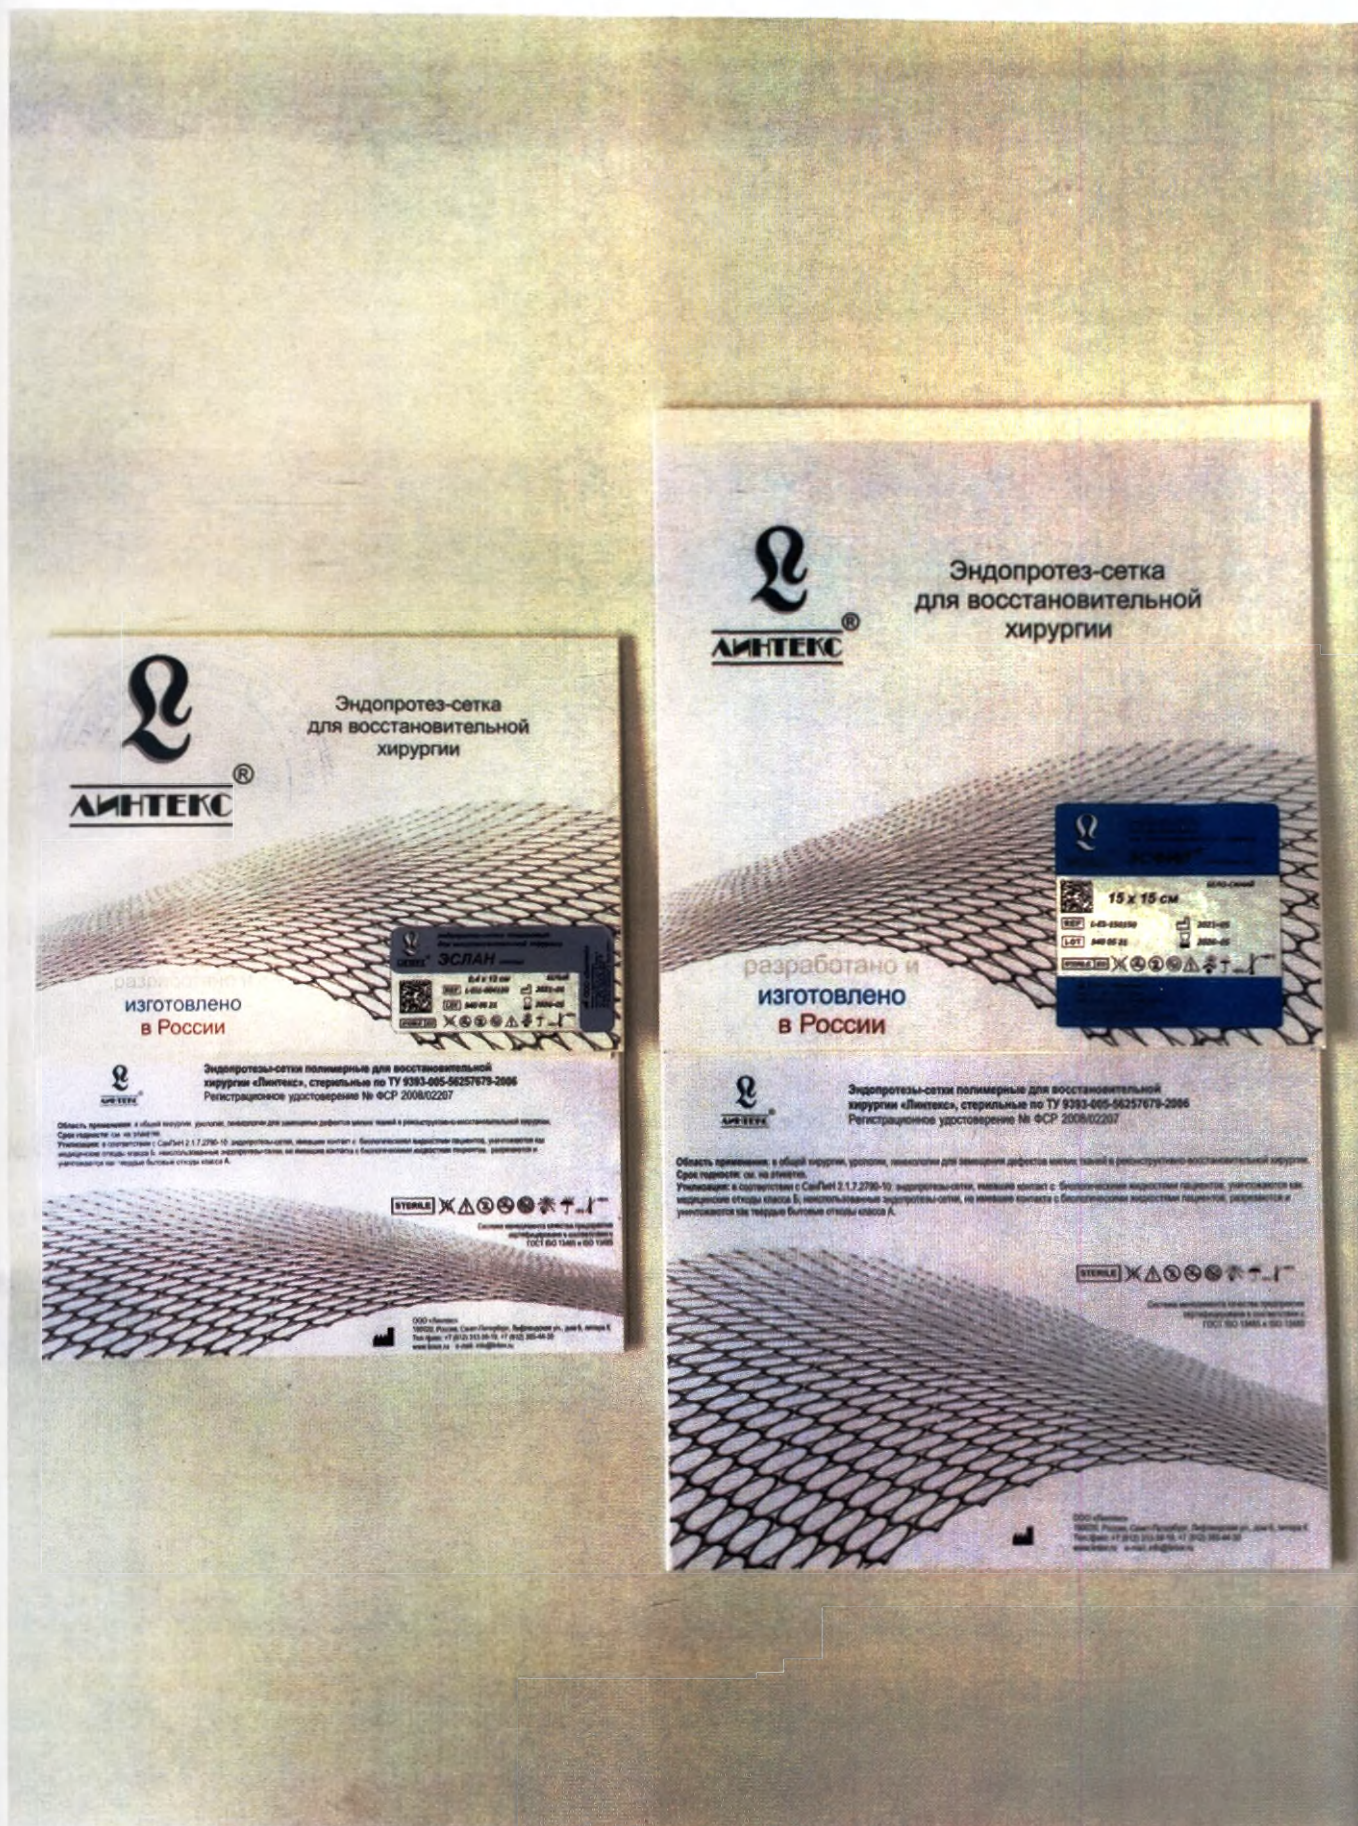

Защитная упаковка (картонный конверт) исполнений медицинского изделия



Сброшюровано 40 листов

Генеральный директор

ООО «Линтекс»

И.И. Жуковская  
И.И. Жуковская  
(подпись)



Общество с ограниченной ответственностью «Линтекс»  
(ООО «Линтекс»)

Лифляндская ул., дом 6, литера К, Санкт-Петербург, 190020

Тел. (812) 313-39-19; Тел./факс (812) 385-44-30

e-mail: [info@lintex.ru](mailto:info@lintex.ru); <http://www.lintex.ru>

ОКПО 56257679; ОГРН 1037851036167; ИНН 7826083684; КПП 783901001

## МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК

медицинское изделие

**«Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии  
«Линтекс», стерильные»**

по ТУ 9393-005-56257679-2006

Генеральный директор  
ООО «Линтекс»

И. И. Жуковская



19.05.2021 г.

Товарный знак предприятия-производителя

Двухмерный код (при наличии)

Символ «Номер по каталогу» (при наличии)

Символ «Код партии» (номер партии)

Символ «Стерильно» с указанием метода стерилизации (оксид этилена)

Символ «Изготовитель» (производитель) наименование предприятия-производителя, адрес места производства, контактная информация, номер технических условий, номер и дата регистрационного удостоверения



Цвет по цветовому справочнику Pantone®

Полное наименование исполнения Изделия

Цвет исполнения Изделия

Размеры исполнения Изделия

Символ «Дата изготовления» – дата стерилизации (год, месяц)

Символ «Использовать до» – дата окончания срока годности (год, месяц)

Символы:

- «Апирогенно»;
- «Не стерилизовать повторно»;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Не использовать при повреждении упаковки»;
- «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Беречь от влаги»;
- «Предел температуры» с указанием диапазона температуры хранения исполнения Изделия


Знак соответствия (при наличии)

Знак обращения на территории государств-членов ЕАЭС (в случае регистрации в системе ЕАЭС)




| Полное<br>наименование<br>исполнения Изделия | Размеры<br>исполнения<br>Изделия | Цвет<br>исполнения<br>Изделия |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|



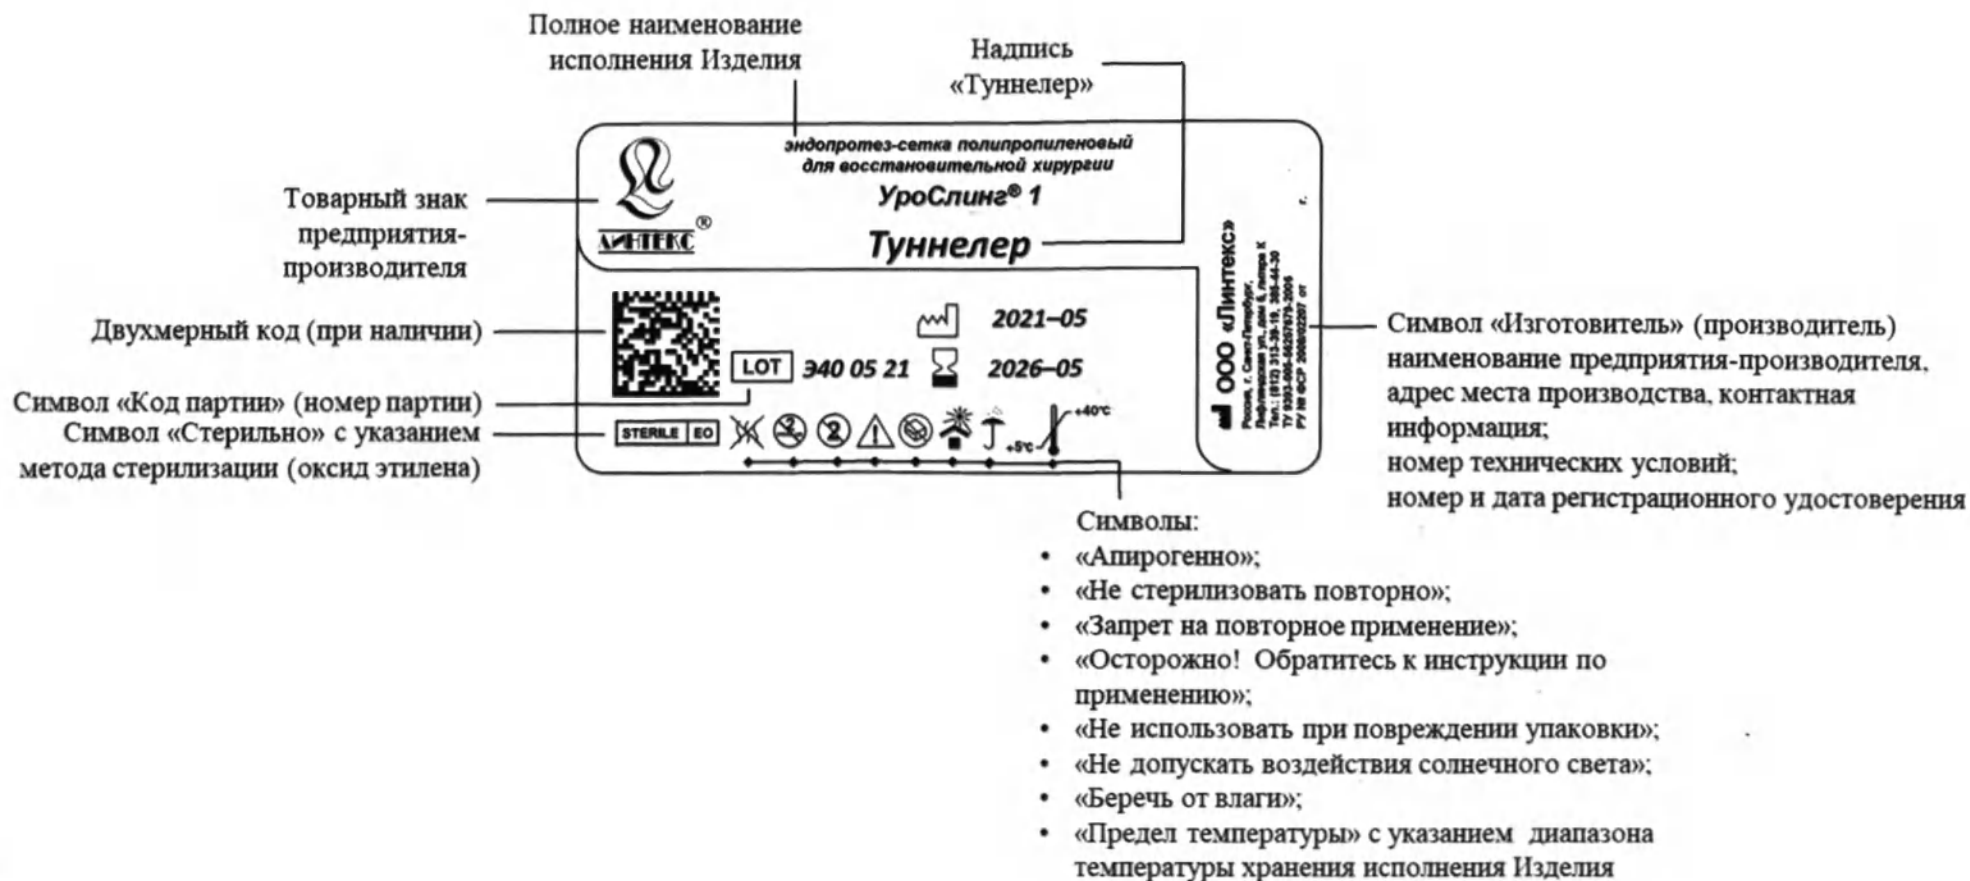


**Цвета, используемые при изготовлении этикеток по цветовому справочнику  
PANTONE® FORMULA GUIDE Solid Coated**



| Наименование<br>исполнения<br>медицинского<br>изделия                                                 | Этикетка                                                                            | Цвет по<br>цветовому<br>справочнику<br>PANTONE® | Образец цвета из<br>цветового<br>справочника<br>PANTONE®                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротез-сетка<br>полипропиленовый<br>для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСФИЛ®<br>стандартный |    | 299 C                                           | <br>PANTONE®<br>299 C    |
| Эндопротез-сетка<br>полипропиленовый<br>для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСФИЛ® легкий         |   | 305C                                            | <br>PANTONE®<br>305 C  |
| Эндопротез-сетка<br>полипропиленовый<br>для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСФИЛ® тяжелый        |  | 3005 C                                          | <br>PANTONE®<br>3005 C |

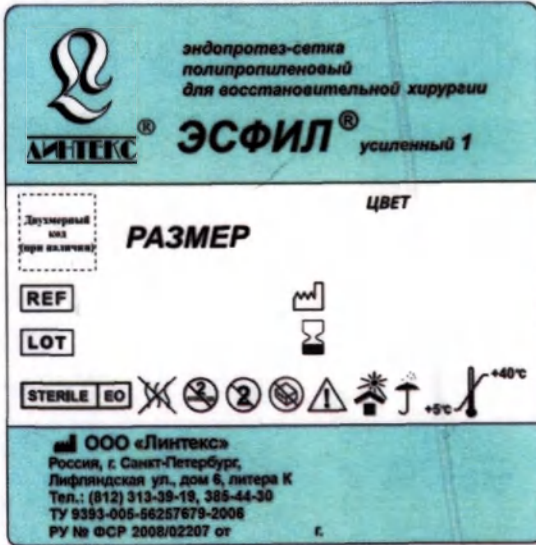
| Наименование<br>исполнения<br>медицинского<br>изделия                                                           | Этикетка                                                                            | Цвет по<br>цветовому<br>справочнику<br>PANTONE® | Образец цвета из<br>цветового<br>справочника<br>PANTONE®                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротез-сетка<br>полипропиленовый<br>для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСФИЛ®<br>усиленный             |    | 317 C                                           |    |
| Эндопротез-сетка<br>полипропиленовый<br>для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСФИЛ®<br>усиленный 1           |   | 317 C                                           |   |
| Эндопротез-сетка<br>поливинилиден-<br>фторидный для<br>восстановительной<br>хирургии<br>УНИФЛЕКС<br>стандартный |  | 285 C                                           |  |

| Наименование<br>исполнения<br>медицинского<br>изделия                                                                             | Этикетка                                                                            | Цвет по<br>цветовому<br>справочнику<br>PANTONE® | Образец цвета из<br>цветового<br>справочника<br>PANTONE®                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротез-сетка<br>поливинилиден-<br>фторидный для<br>восстановительной<br>хирургии<br>УНИФЛЕКС<br>тяжелый                       |    | 285 C                                           | <br>PANTONE®<br>285 C    |
| Эндопротез-сетка<br>поливинилиден-<br>фторидный с<br>карбиновым<br>покрытием для<br>восстановительной<br>хирургии<br>КАРБОФЛЕКС   |   | 471 C                                           | <br>PANTONE®<br>471 C   |
| Эндопротез-сетка<br>полипропилен-<br>поливинилиден-<br>фторидный для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ФЛЕКСИЛЕН<br>стандартный |  | 2635 C                                          | <br>PANTONE®<br>2635 C |

| Наименование<br>исполнения<br>медицинского<br>изделия                                                                          | Этикетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цвет по<br>цветовому<br>справочнику<br>PANTONE® | Образец цвета из<br>цветового<br>справочника<br>PANTONE®                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротез-сетка<br>полипропилен-<br>поливинилиден-<br>фторидный для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ФЛЕКСИЛЕН<br>легкий   |  <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропилен-<br/>поливинилиденфторидный<br/>для восстановительной хирургии<br/><b>ФЛЕКСИЛЕН</b><br/>легкий</p> <p>Датумский код<br/>или<br/>серия изготовления</p> <p><b>РАЗМЕР</b></p> <p>REF</p> <p>LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ЦВЕТ</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от</p>    | 2635 C                                          |  <p>PANTONE®<br/>2635 C</p>  |
| Эндопротез-сетка<br>полипропилен-<br>поливинилиден-<br>фторидный для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ФЛЕКСИЛЕН<br>объёмный |  <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропилен-<br/>поливинилиденфторидный<br/>для восстановительной хирургии<br/><b>ФЛЕКСИЛЕН</b><br/>объёмный</p> <p>Датумский код<br/>или<br/>серия изготовления</p> <p><b>РАЗМЕР</b></p> <p>REF</p> <p>LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ЦВЕТ</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от</p> | 272 C                                           |  <p>PANTONE®<br/>272 C</p>  |
| Эндопротез-сетка<br>полипропилен-<br>поливинилиден-<br>фторидный для<br>восстановительной<br>хирургии<br>УроСлинг®             |  <p>Эндопротез-сетка<br/>полипропилен-<br/>поливинилиденфторидный<br/>для восстановительной хирургии<br/><b>УроСлинг®</b></p> <p>Датумский код<br/>или<br/>серия изготовления</p> <p><b>РАЗМЕР</b></p> <p>REF</p> <p>LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ЦВЕТ</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от</p>             | 190 C                                           |  <p>PANTONE®<br/>190 C</p> |
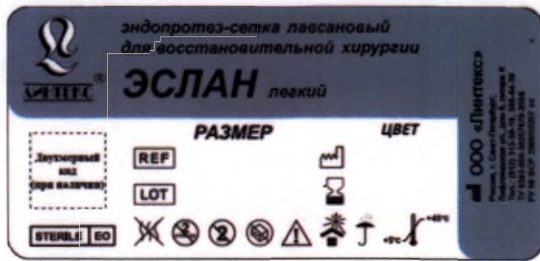
| Наименование<br>исполнения<br>медицинского<br>изделия                                       | Этикетка                                                                            | Цвет по<br>цветовому<br>справочнику<br>PANTONE® | Образец цвета из<br>цветового<br>справочника<br>PANTONE®                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротез-сетка<br>полипропиленовый<br>для<br>восстановительной<br>хирургии<br>УроСлинг® 1 |    | 193 C                                           |    |
| Эндопротез-сетка<br>лавсановый для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСЛАН<br>стандартный |   | 429 C                                           |   |
| Эндопротез-сетка<br>лавсановый для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСЛАН легкий         |  | 644 C                                           |  |
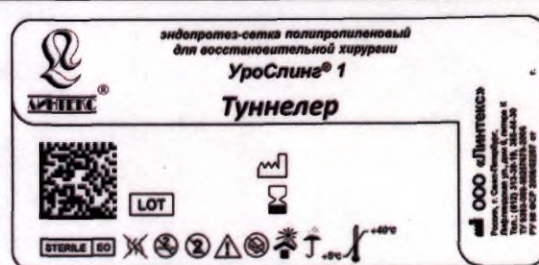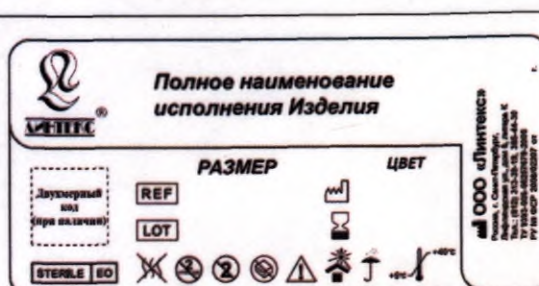
| Наименование<br>исполнения<br>медицинского<br>изделия                                                            | Этикетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цвет по<br>цветовому<br>справочнику<br>PANTONE® | Образец цвета из<br>цветового<br>справочника<br>PANTONE®                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротез-сетка<br>лавсановый для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ЭСЛАН тяжёлый                             |  <p>эндопротез-сетка<br/>лавсановый<br/>для восстановительной хирургии</p> <p><b>ЭСЛАН</b><br/>тяжёлый</p> <p>РАЗМЕР ЦВЕТ</p> <p>REF LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от г.</p>                    | 429 C                                           |  <p>PANTONE®<br/>429 C</p>  |
| Эндопротез-сетка<br>лавсановый с<br>фторкаучуковым<br>покрытием для<br>восстановительной<br>хирургии<br>ФТОРЭКС® |  <p>эндопротез-сетка лавсановый<br/>с фторполимерным покрытием<br/>для восстановительной хирургии</p> <p><b>ФТОРЭКС®</b></p> <p>РАЗМЕР ЦВЕТ</p> <p>REF LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от г.</p> | 382 C                                           |  <p>PANTONE®<br/>382 C</p> |
| Туннелер                                                                                                         |  <p>эндопротез-сетка полипропиленовый<br/>для восстановительной хирургии</p> <p><b>УроСлинг® 1</b><br/>Туннелер</p> <p>LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от г.</p>                                | -                                               |                                                                                                                |
| Идентификационная<br>этикетка                                                                                    |  <p>Полное наименование<br/>исполнения Изделия</p> <p>РАЗМЕР ЦВЕТ</p> <p>REF LOT</p> <p>STERILE EO</p> <p>ООО «Линтекс»<br/>Россия, г. Санкт-Петербург,<br/>Лифляндская ул., дом 6, литера К<br/>Тел.: (812) 313-39-19, 385-44-30<br/>ТУ 9393-005-56257679-2006<br/>РУ № ФСР 2008/02207 от г.</p>                                                                          | -                                               |                                                                                                                |

Сброшюровано 11 листов  
**Линтекс**  
Генеральный директор  
ООО «Линтекс»  
 И.И. Жуковская  
(подпись)