

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Миндрей Медикал Рус»



Сюн Вэй

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 24.05.22Г

СЫСОВА Н.В.  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  
РЕГИСТРАЦИИ

«23» сентября 2022 г.



## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**«Прибор автоматический для подготовки и окраски мазков SC-120,  
с принадлежностями, в составе»**

Производитель Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.  
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), Китай

2022 год




Маркировка основного блока

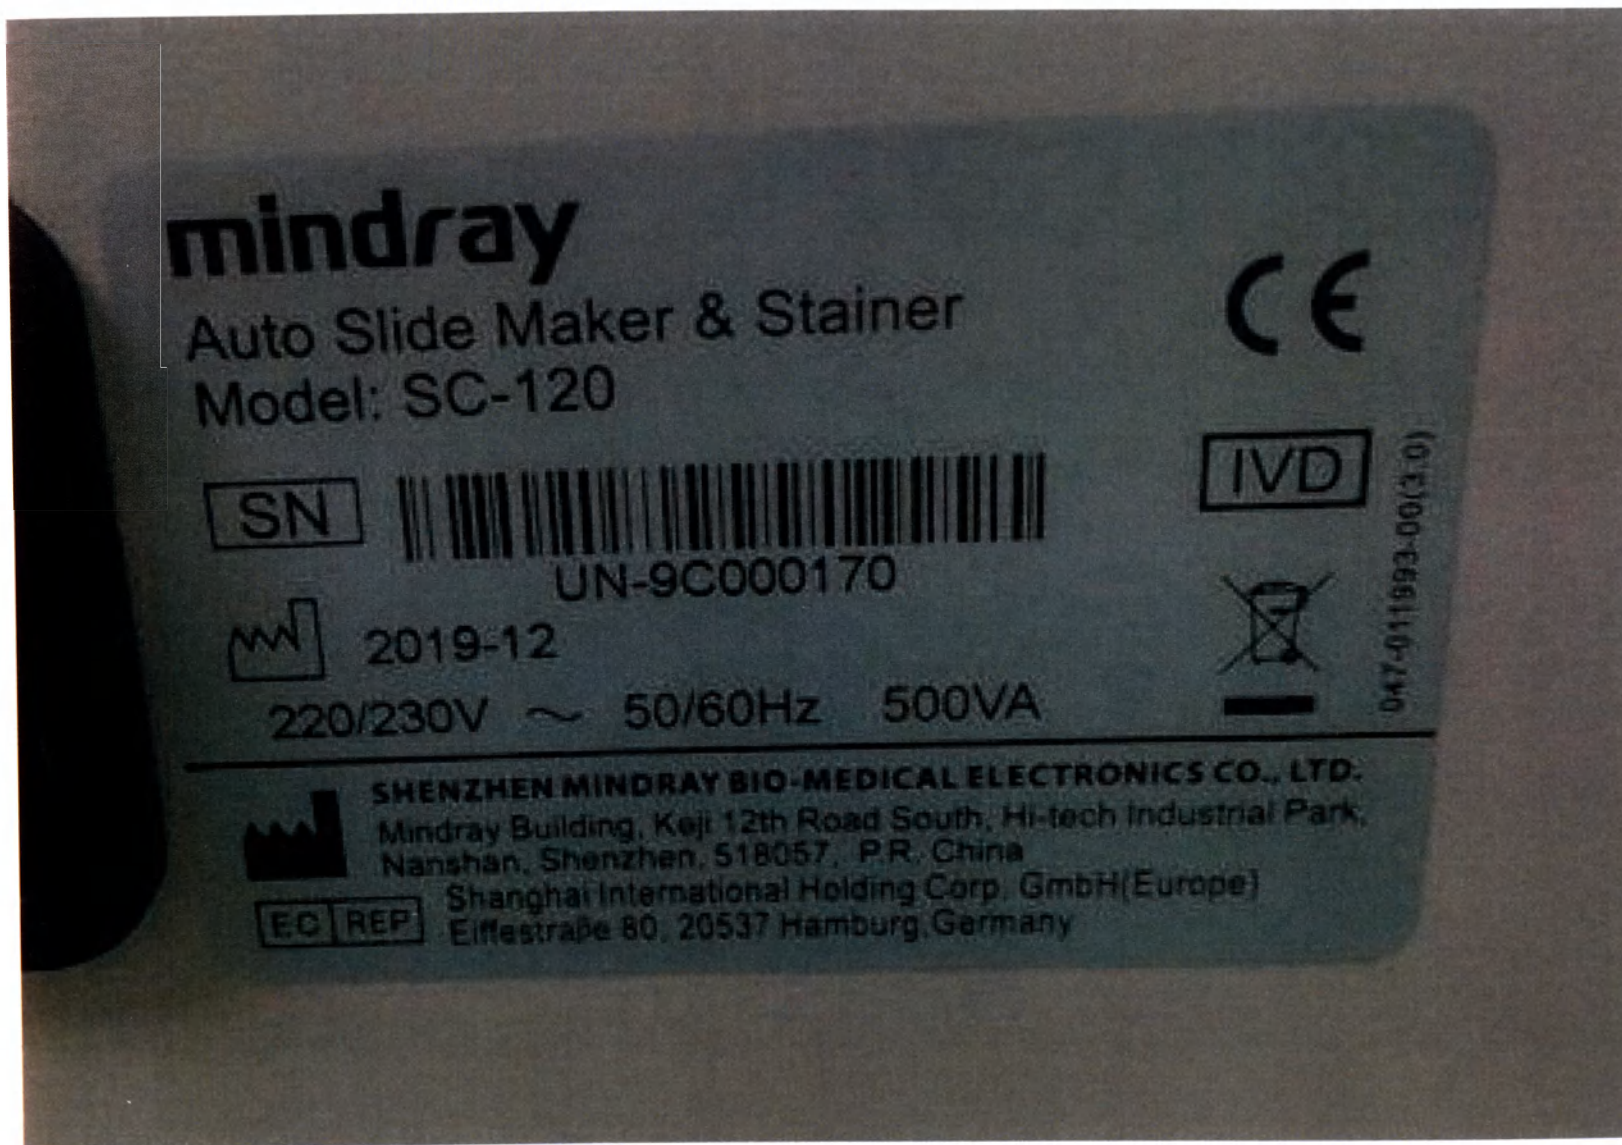

Кабель питания для основного блока




Кассета для предметного стекла

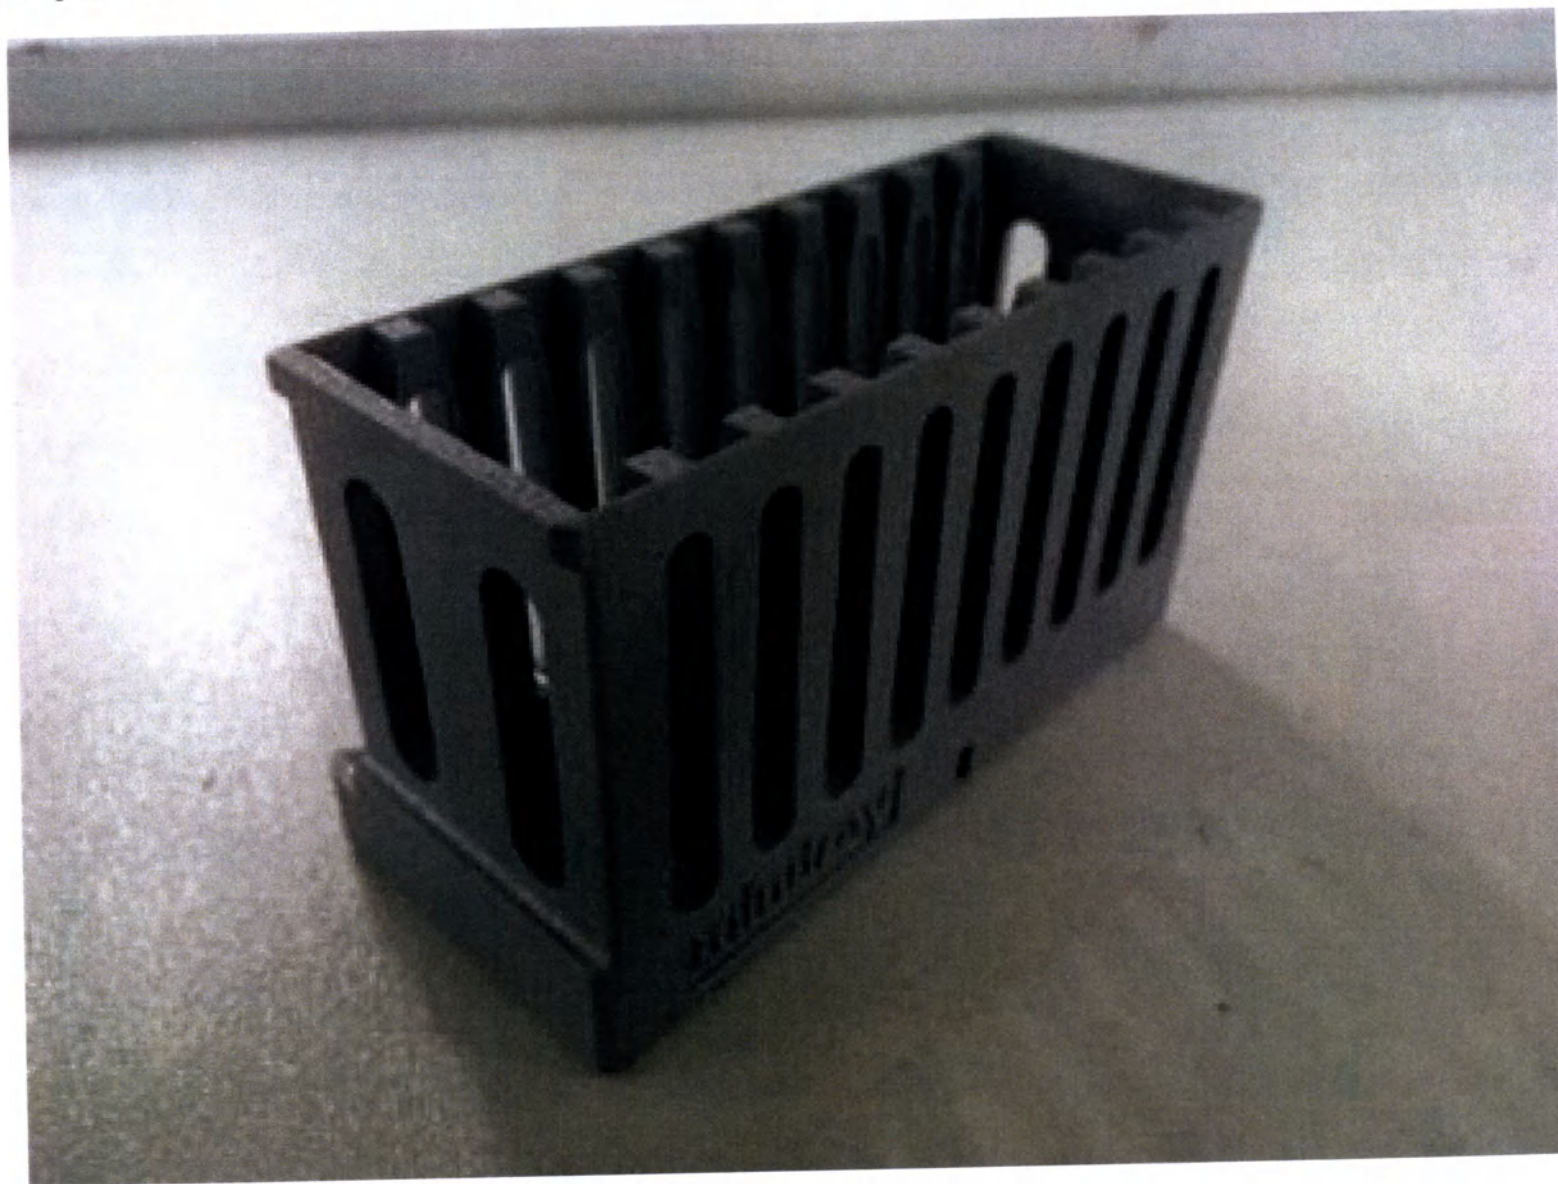


## Контейнер для стекол



## Контейнер для окраски

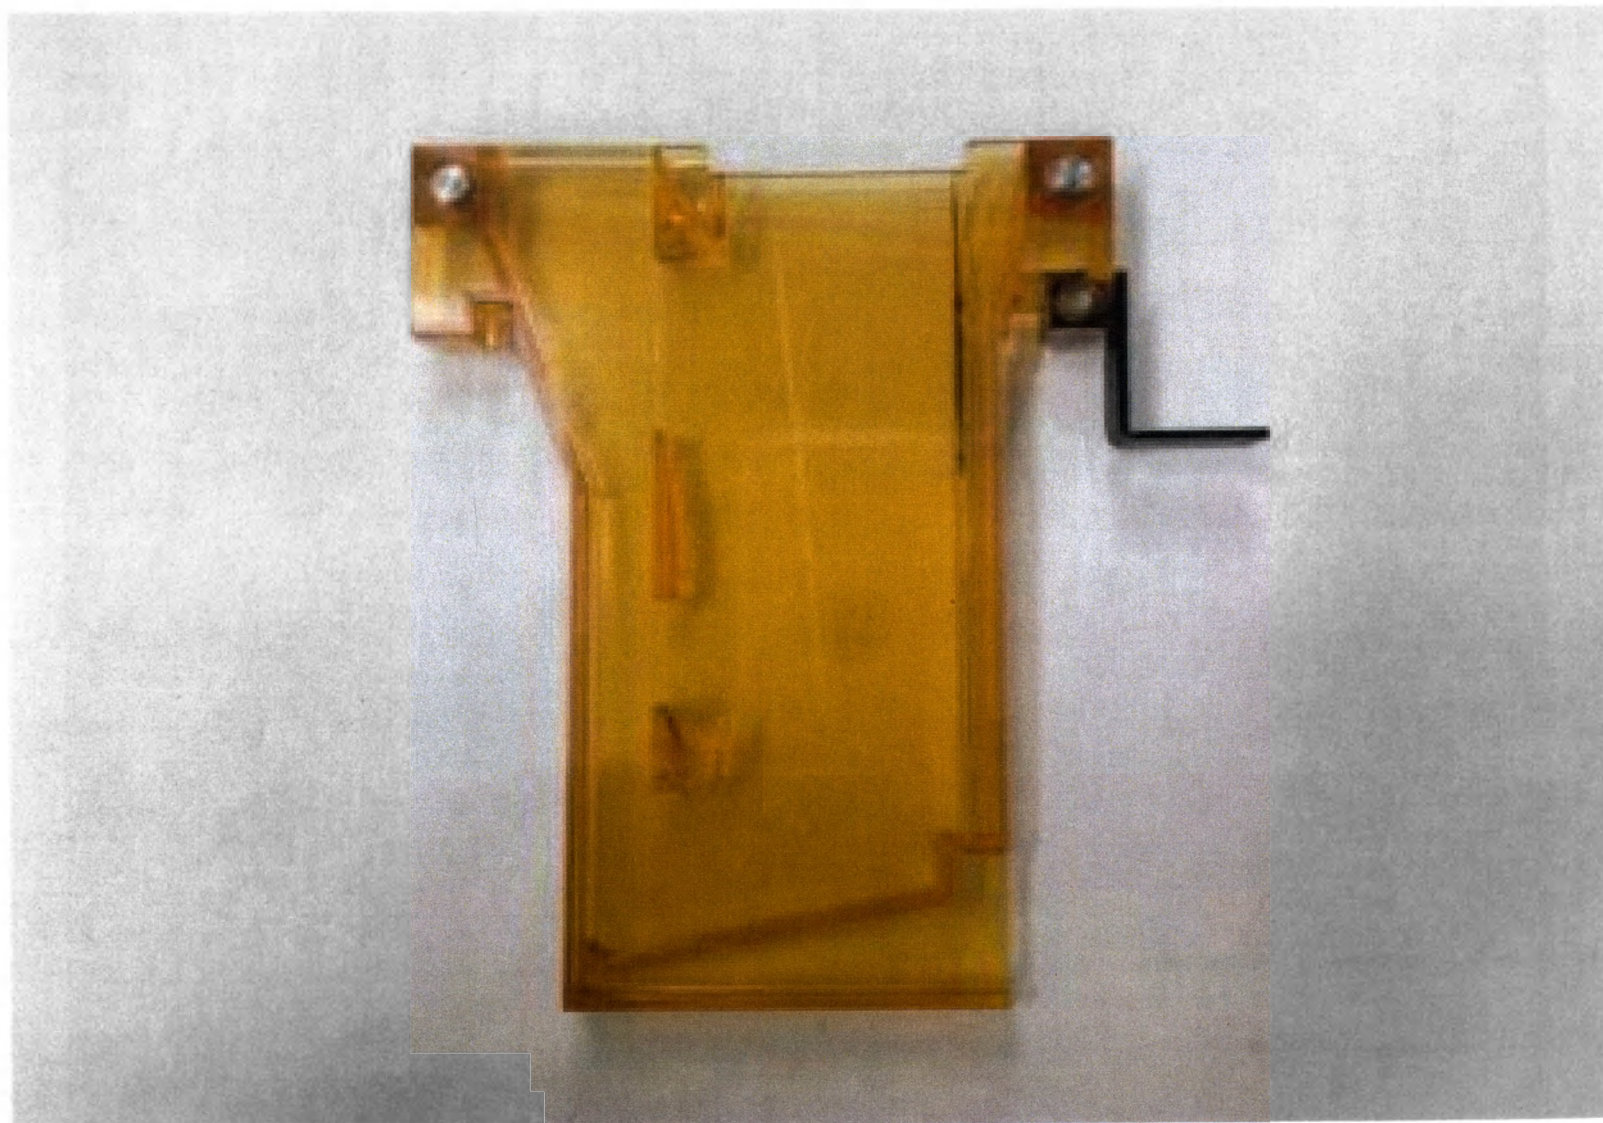


Контейнер для реагентов (2 л)

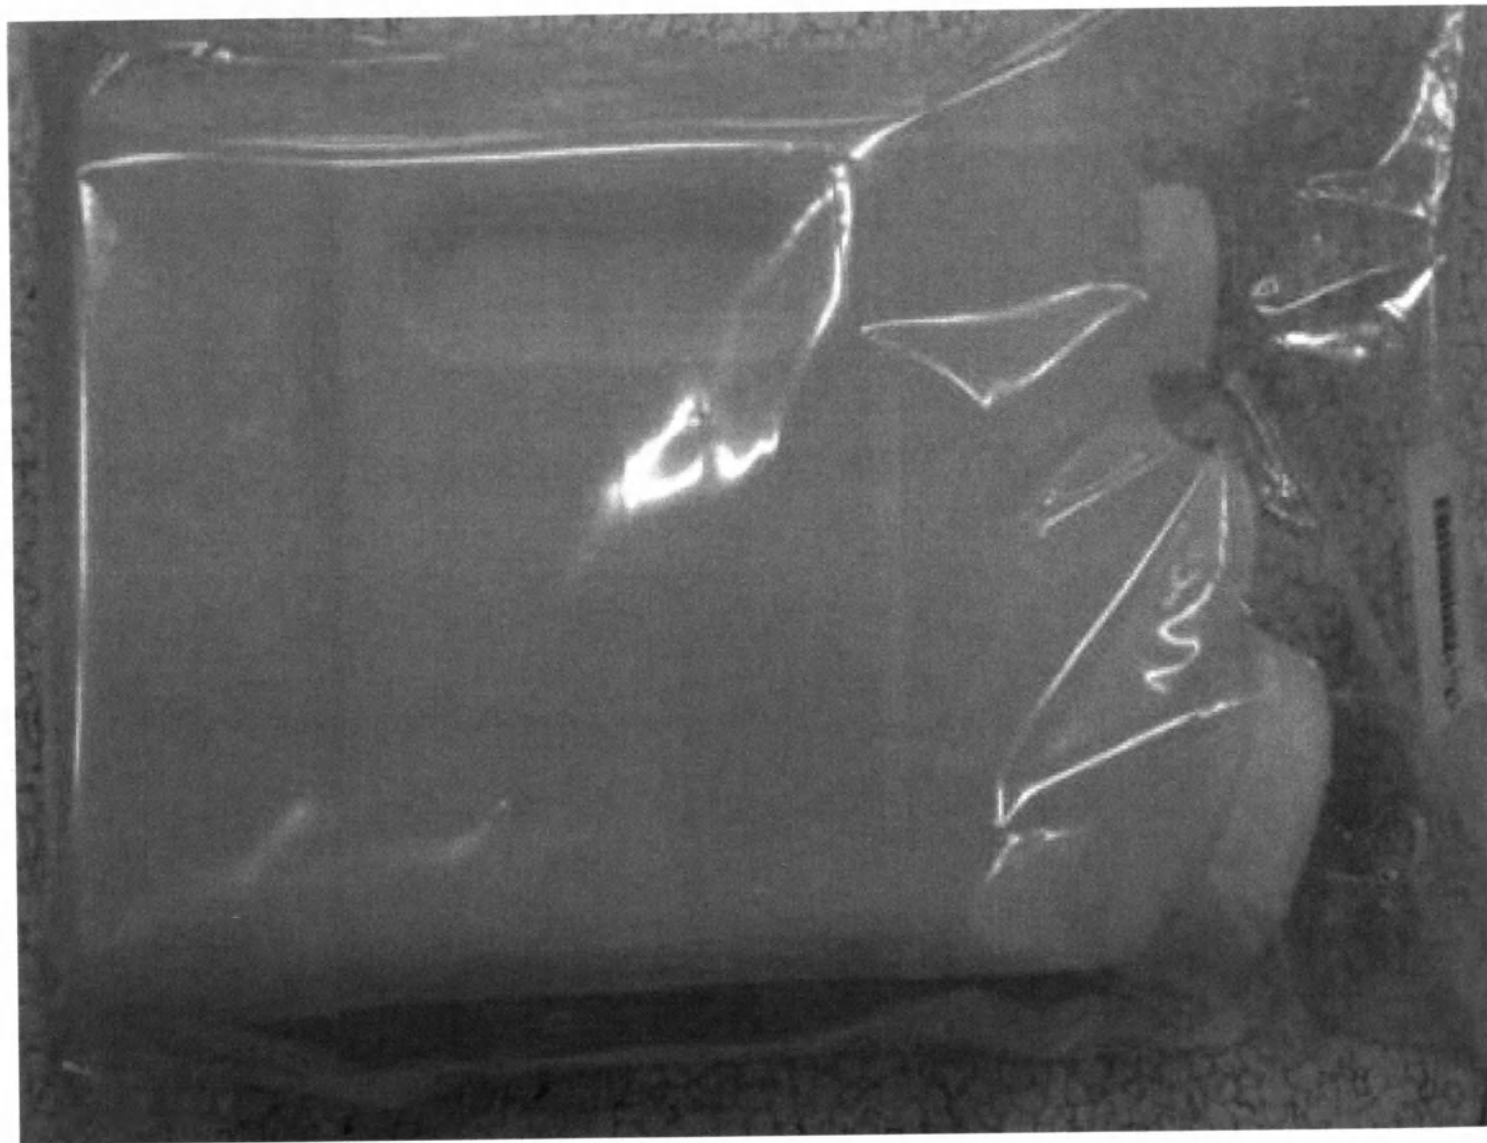

Контейнер для реагентов (5 л)



Контейнер для реагентов (20 л)

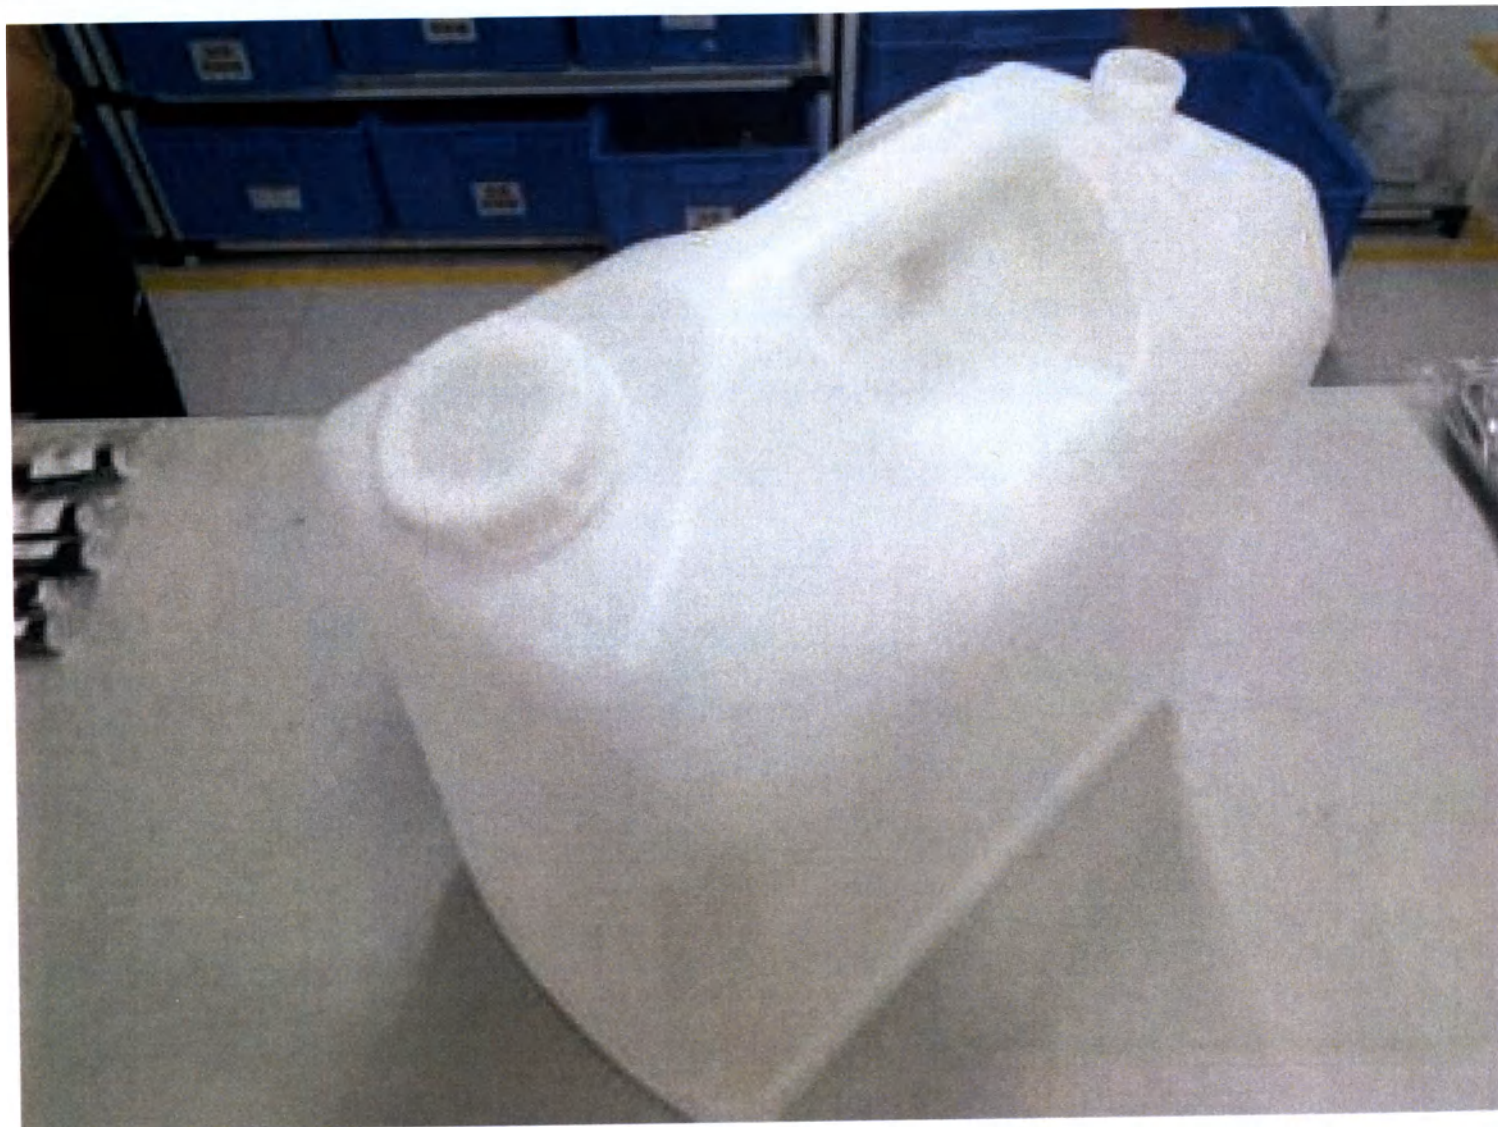

Крышка в сборе для контейнера с буфером



## Крышка в сборе для контейнера отходов (WC\_B)



Крышка в сборе для контейнера отходов (WC\_S)





# Крышка в сборе для контейнера реагентов LC-A1



## Крышка в сборе для контейнера реагентов LC-A2




Крышка в сборе для контейнера метанола




Крышка в сборе для контейнера воды DL Water




minerals

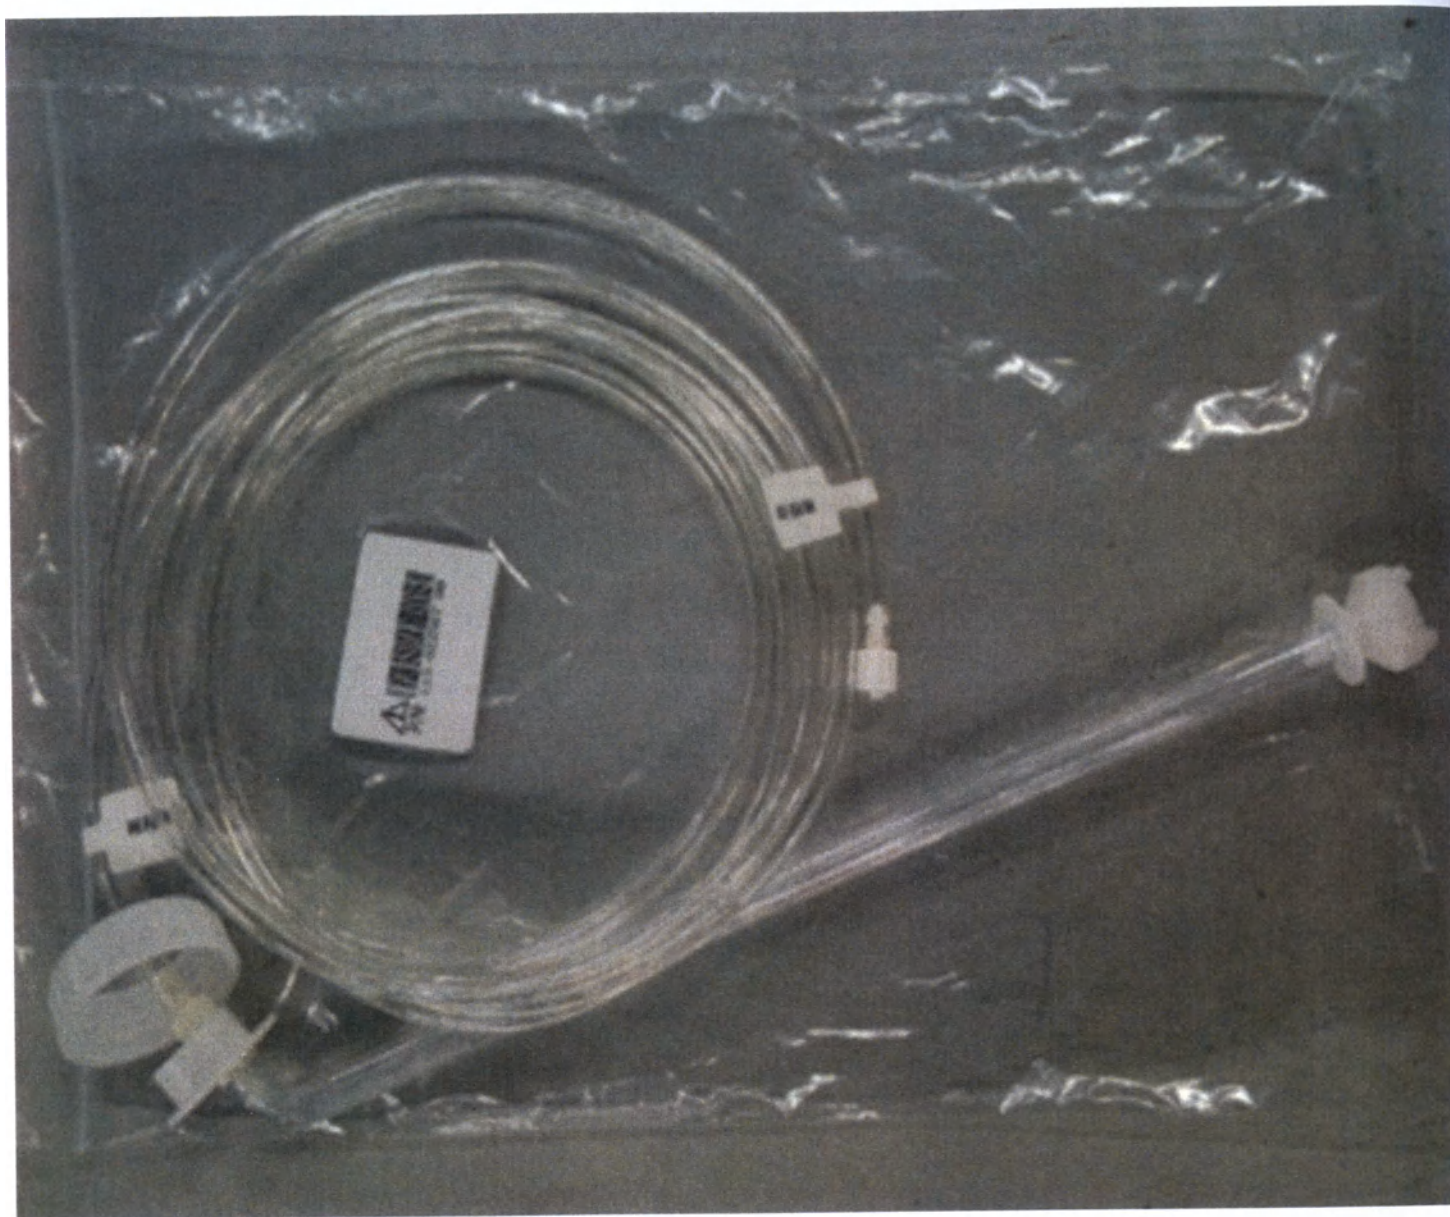

Опорная планка для контейнера

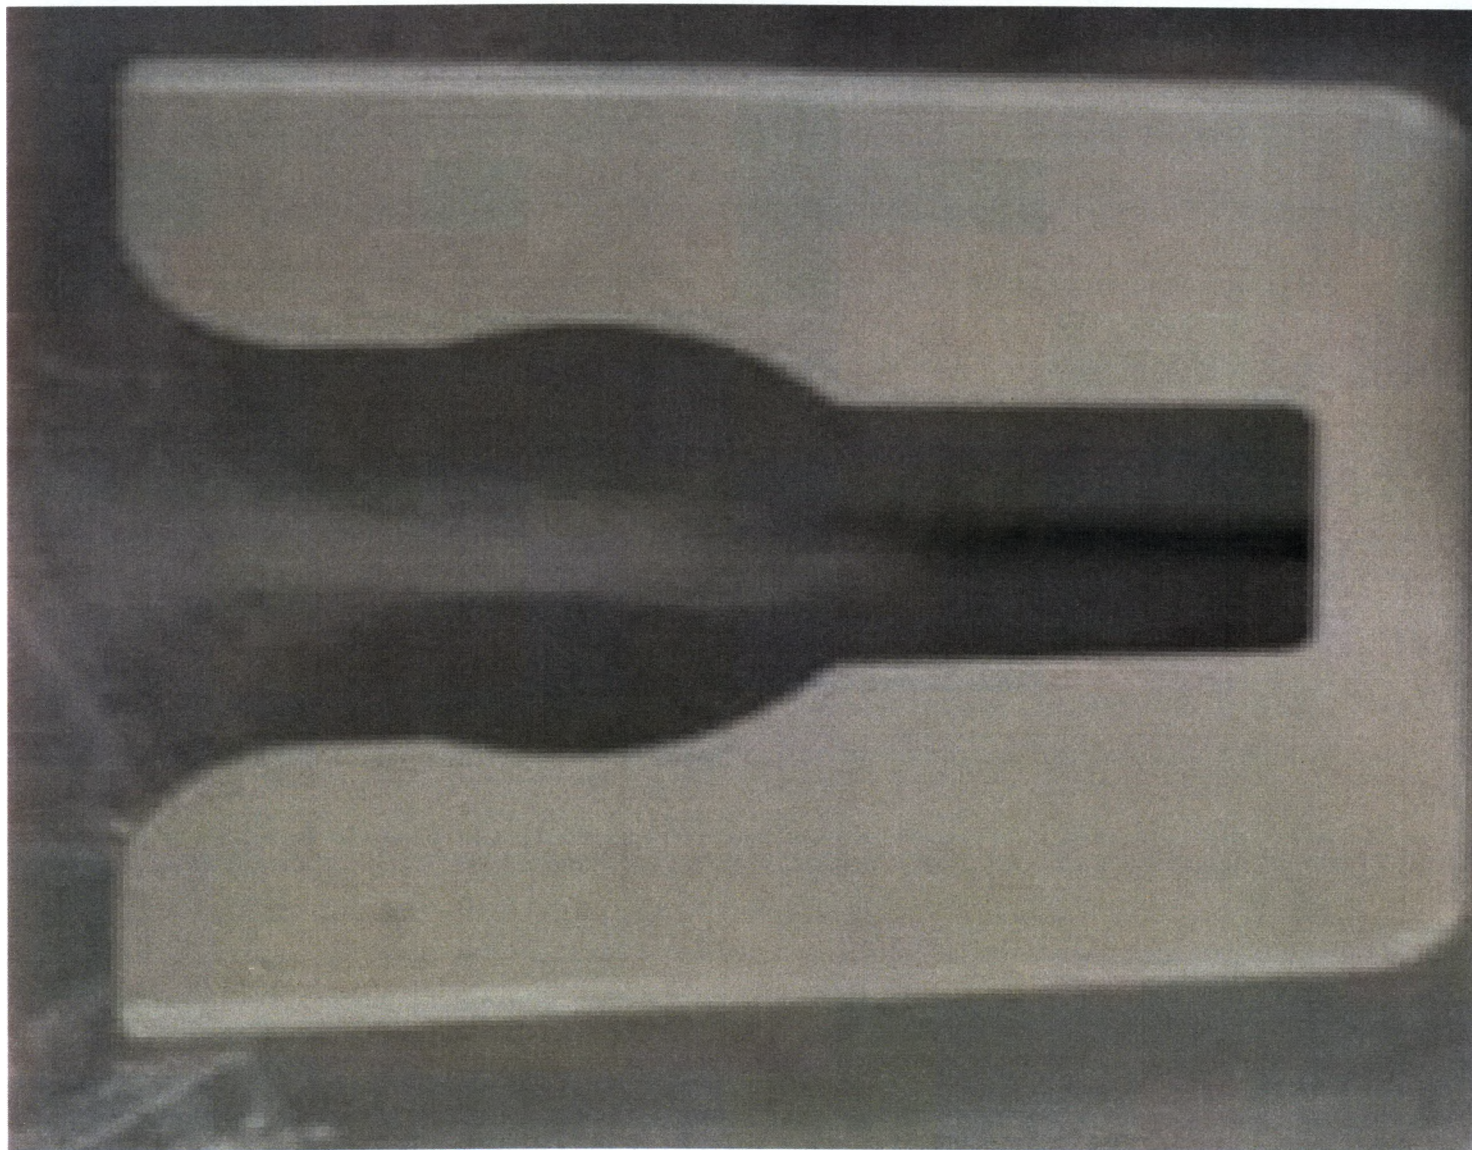

Трубка для отходов в сборе (без датчика)

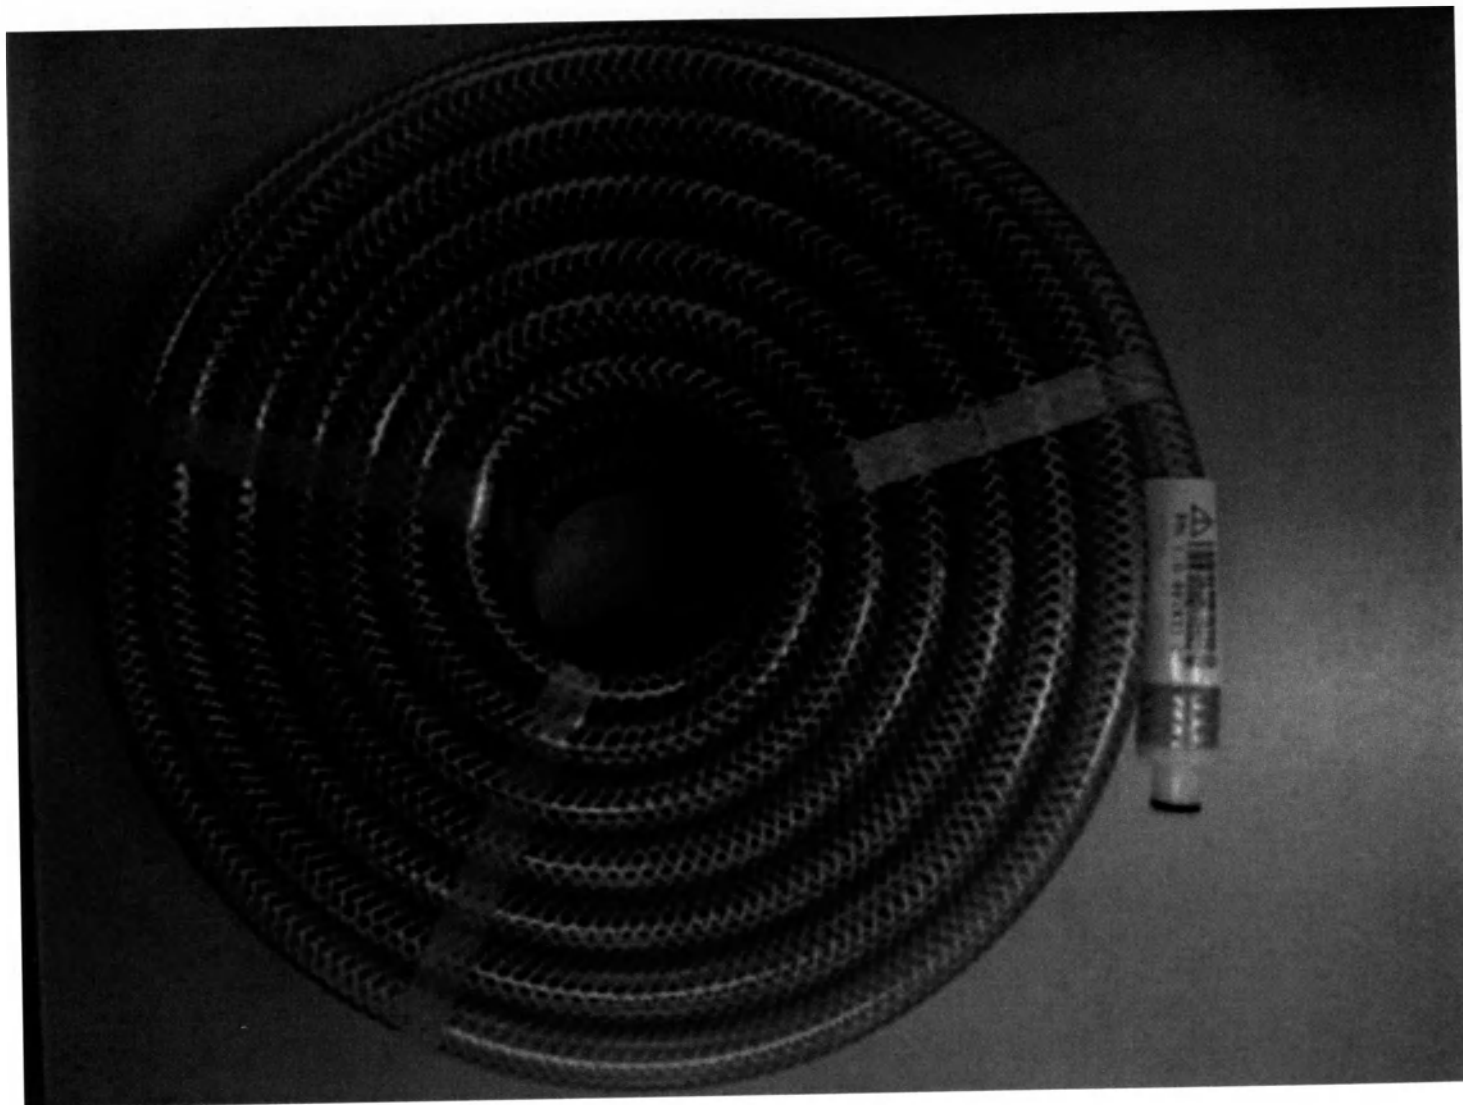

Комбинированный винт М3х8 мм




## Комбинированный винт М4Х8 (GB/T9074.4)



Ручка для транспортировки




### Осушитель пневматической линии

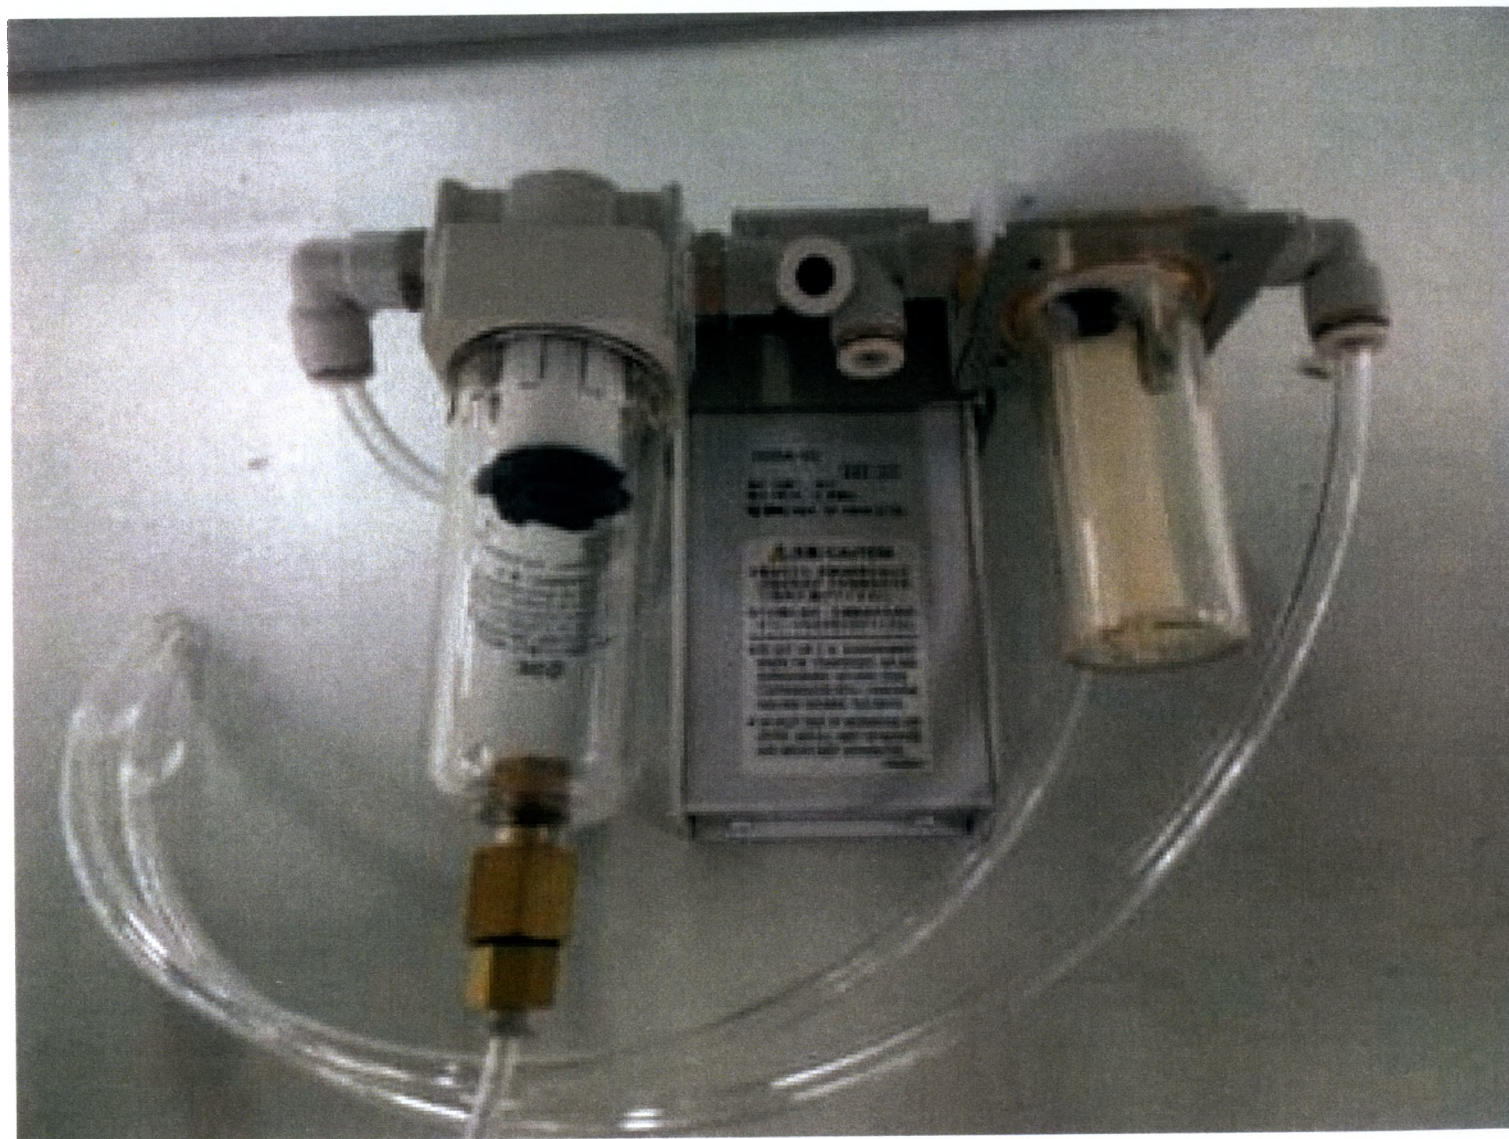

**Пневматический блок, в составе:**

- Пневматический модуль

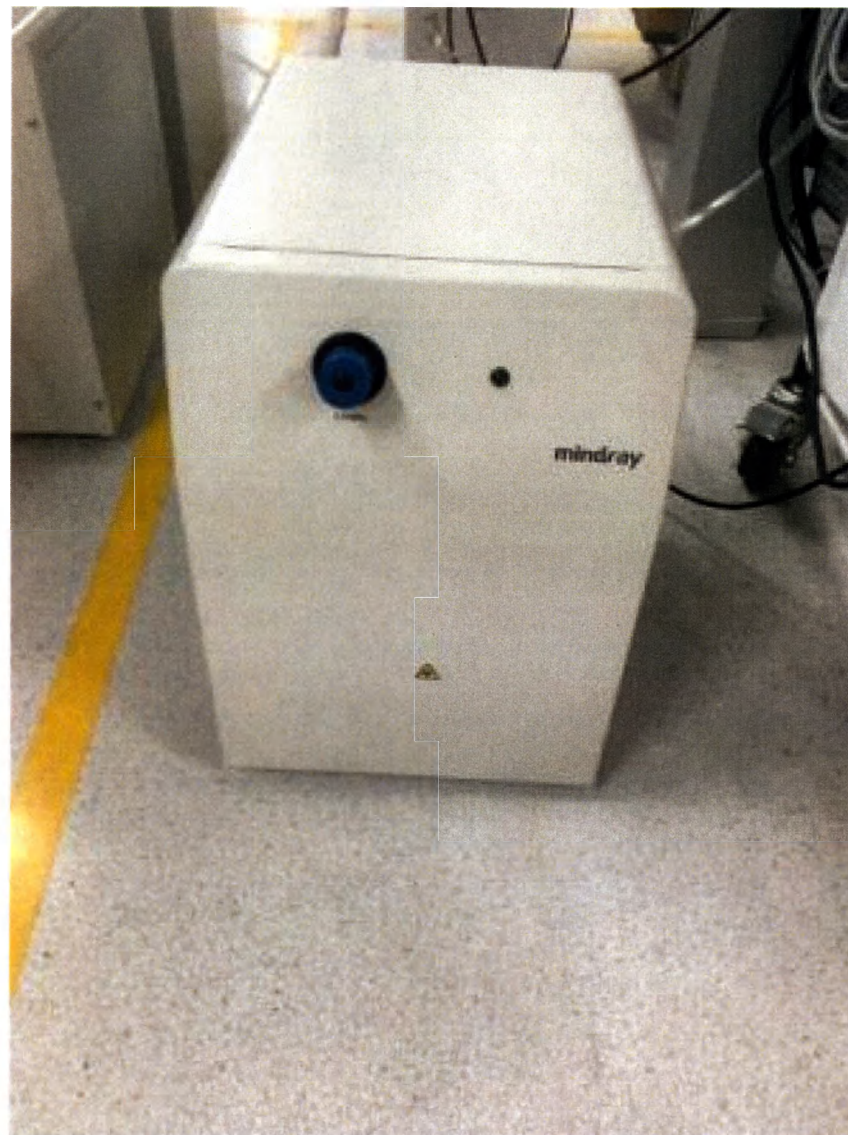

- Маркировка пневматического модуля

CAUTION For use on Mindray Auto Hematology Analyzer only

**mindray**

PNEUMATIC UNIT


CE

SN



IVD

SHA87404860



2018-07

220/230V ~ 50/60Hz 450VA/50HZ 300VA/60HZ



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Elbestr. 80, 20537 Hamburg, Germany


- Контрольный провод пневматической системы



**- ПУ трубка 6х4 мм прозрачная для вакуума**

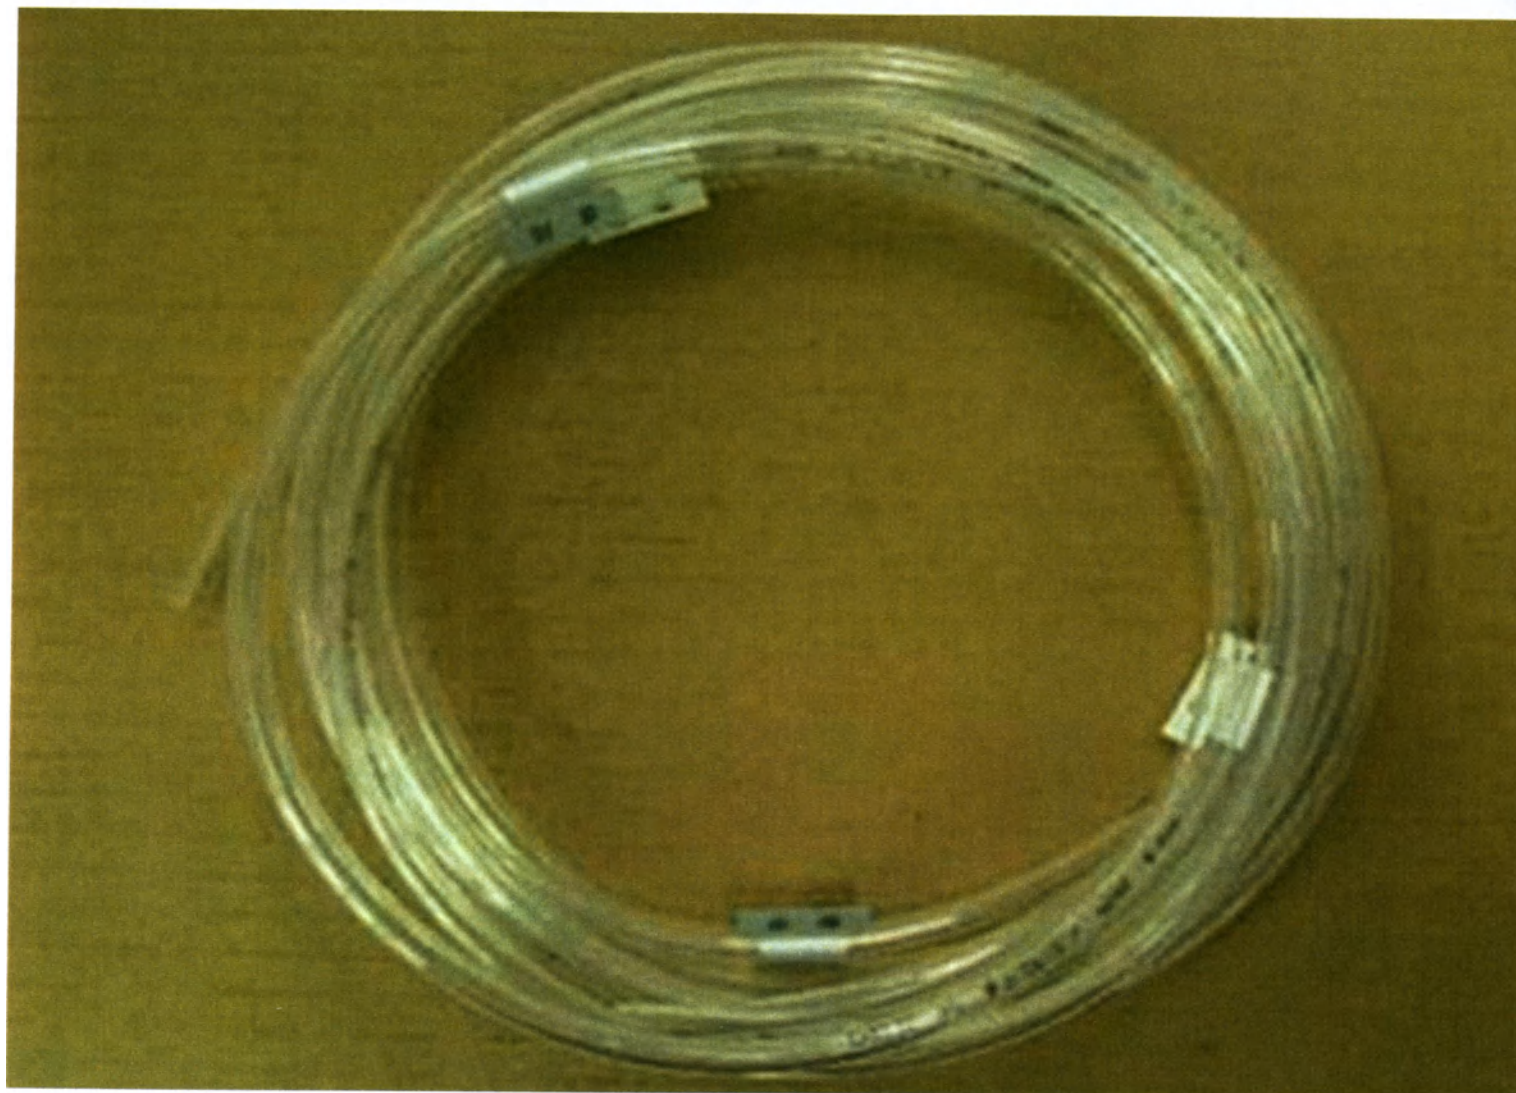


- ПУ трубка 6х4 мм прозрачная для воздуха

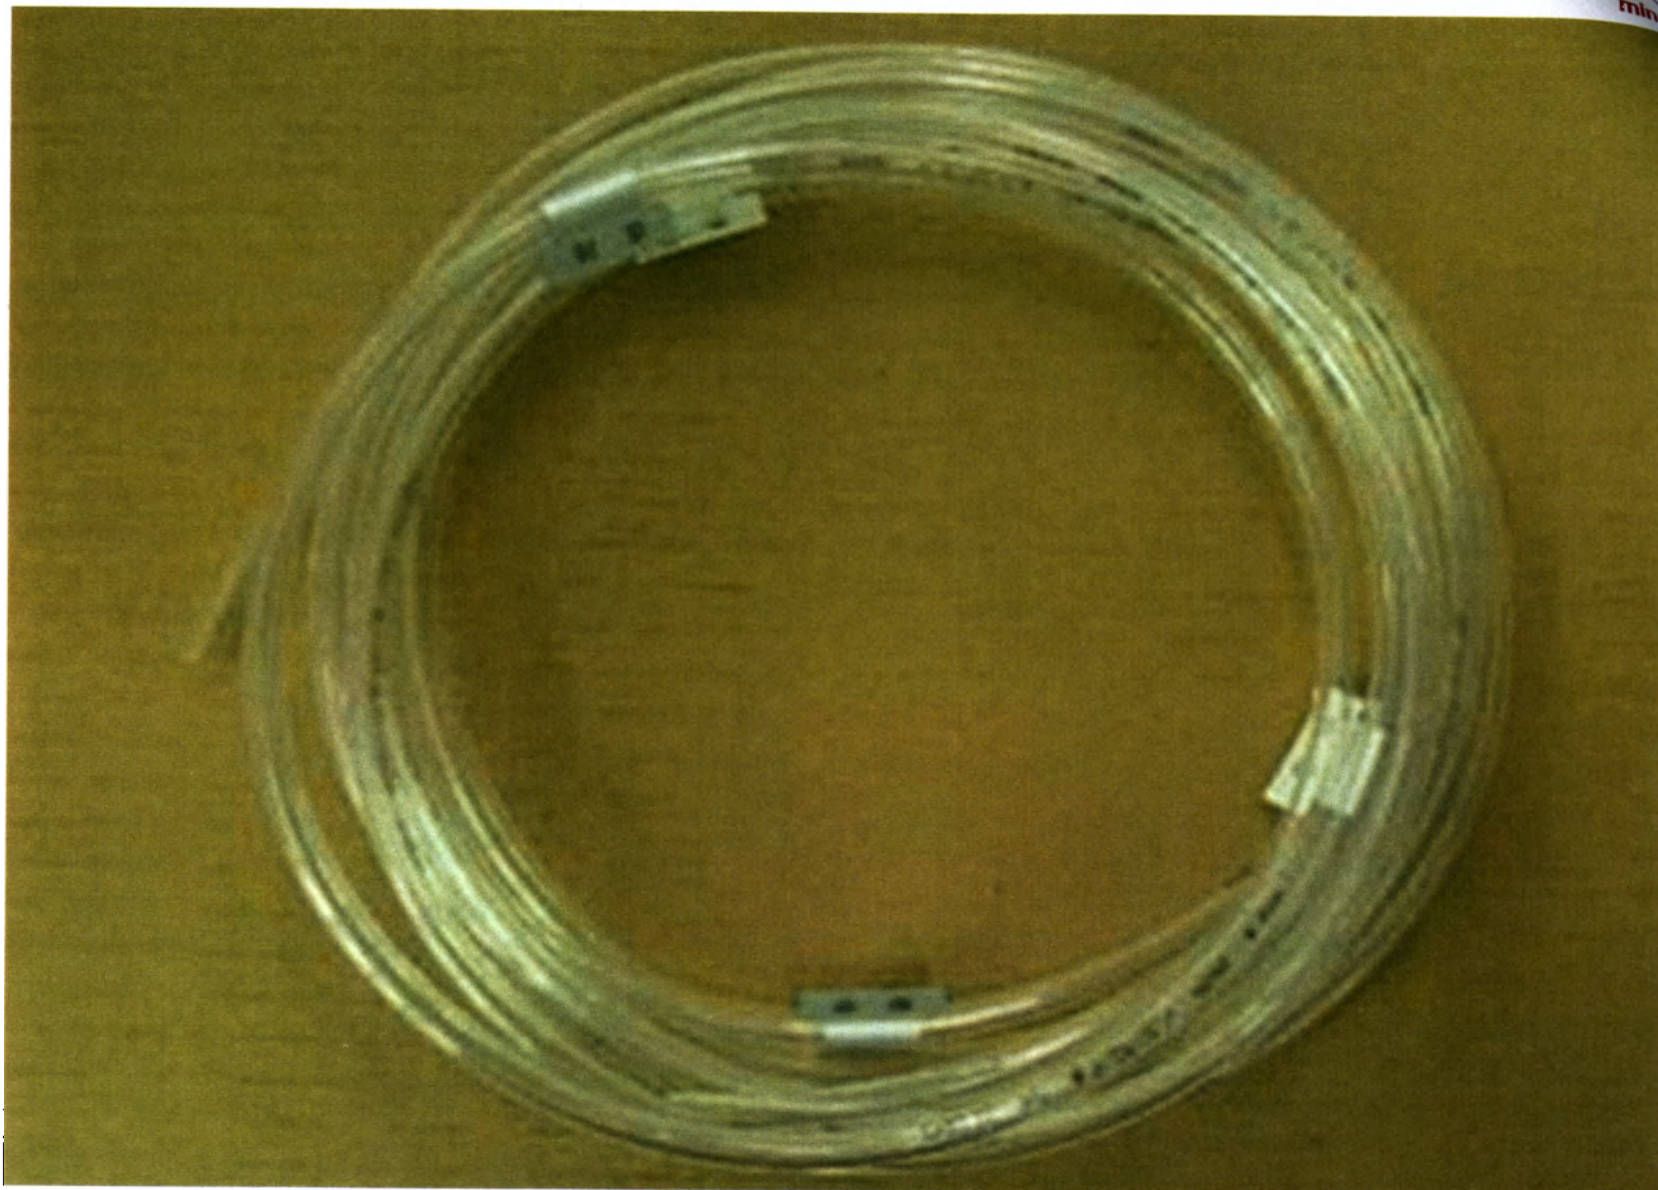

**- Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания 250V 3.15AD5X20**



Автозагрузчик в составе:  
- Основной модуль автозагрузчика

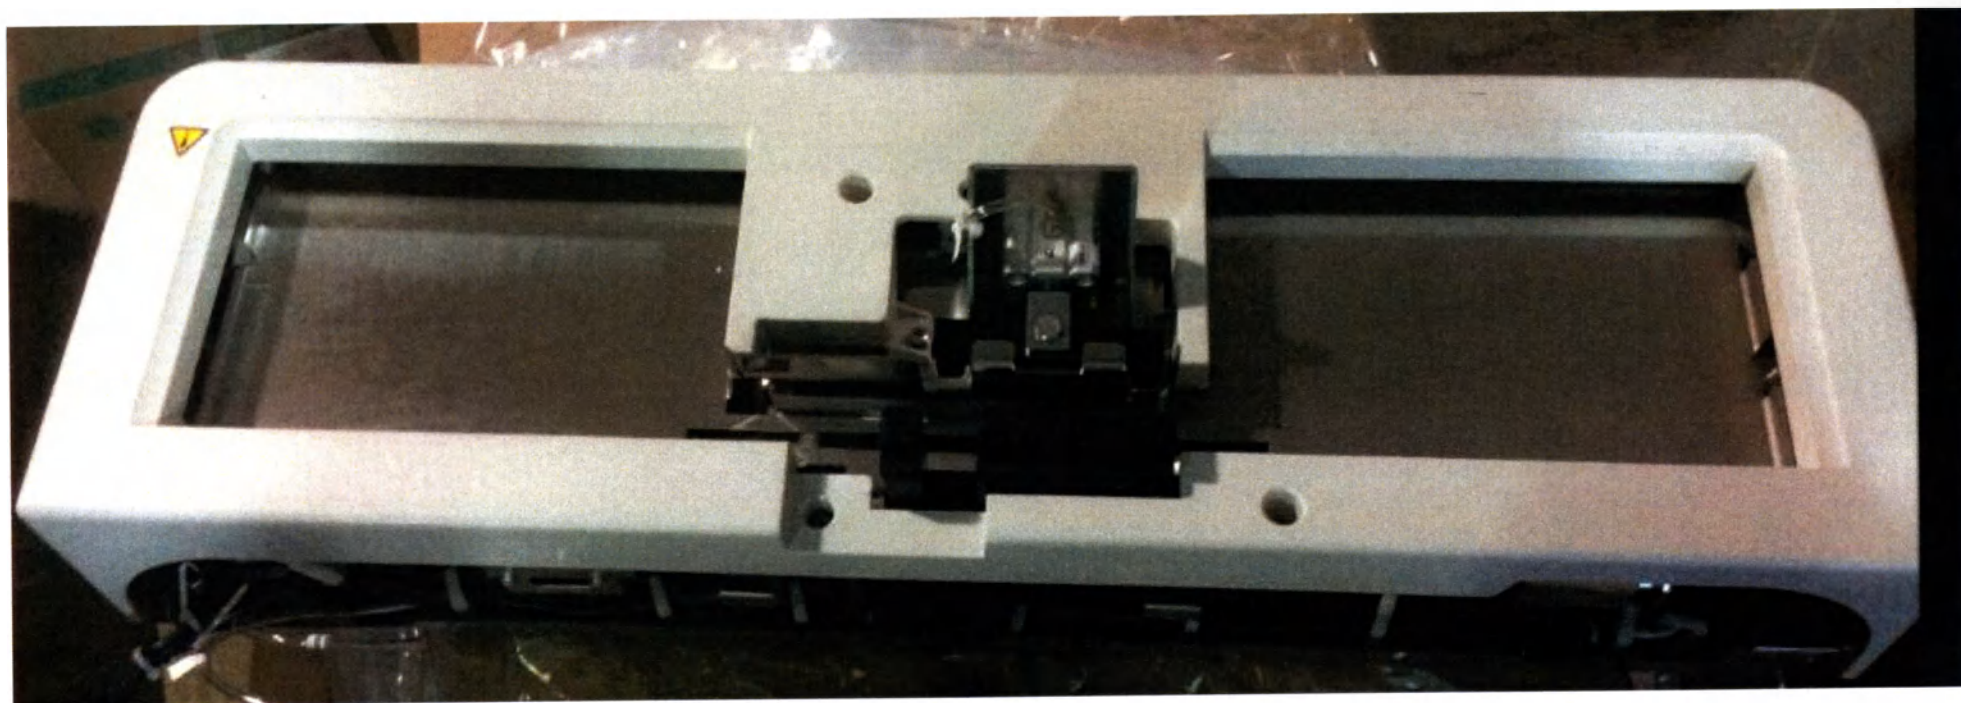

- Комбинированный винт M4X8 (GB/T9074.8)



Общество с ограниченной ответственностью «Цирми»  
123110, г. Москва, м. м.п. в муниципальном округе Цирми, г.п.п. Островского, д. 16, стр. 3, этаж 4/1, пом. 7, 7/1а  
ИНН 770815086 ОГРН 770801001


- Балка автозагрузчика




- Штатив для пробирок



Крышка с отверстием

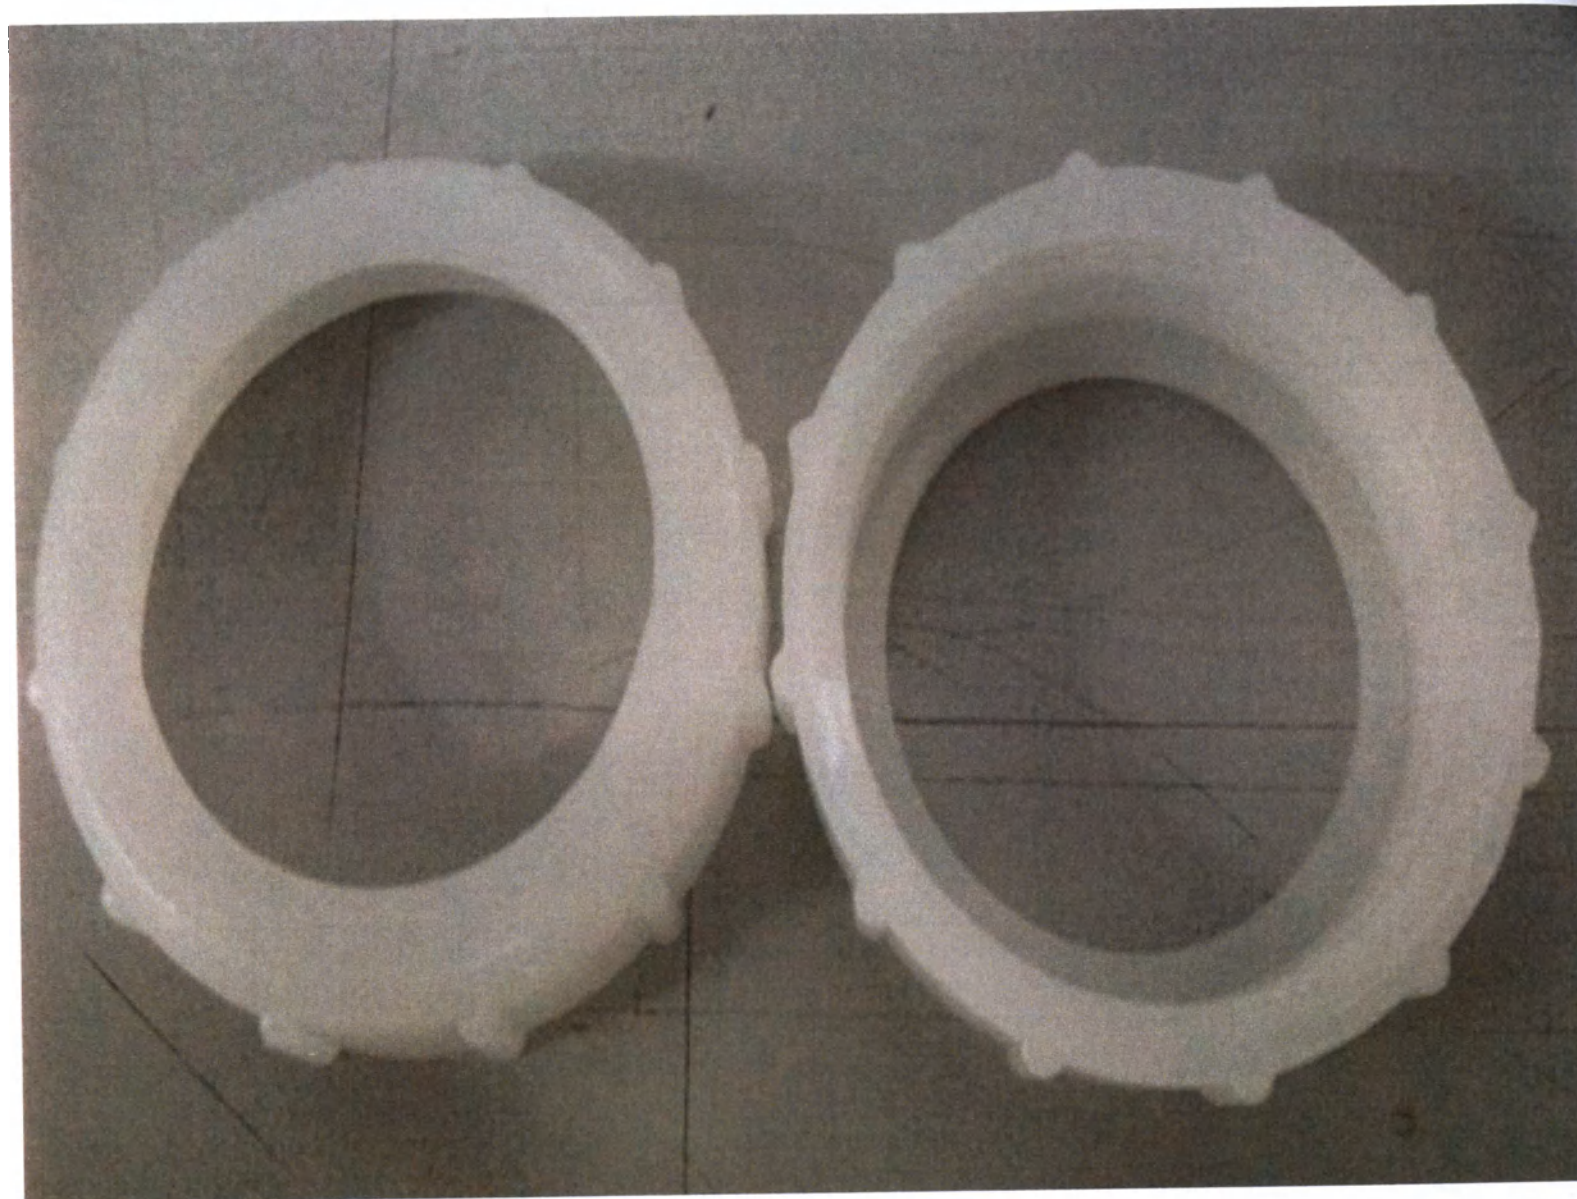

**Защитная крышка**

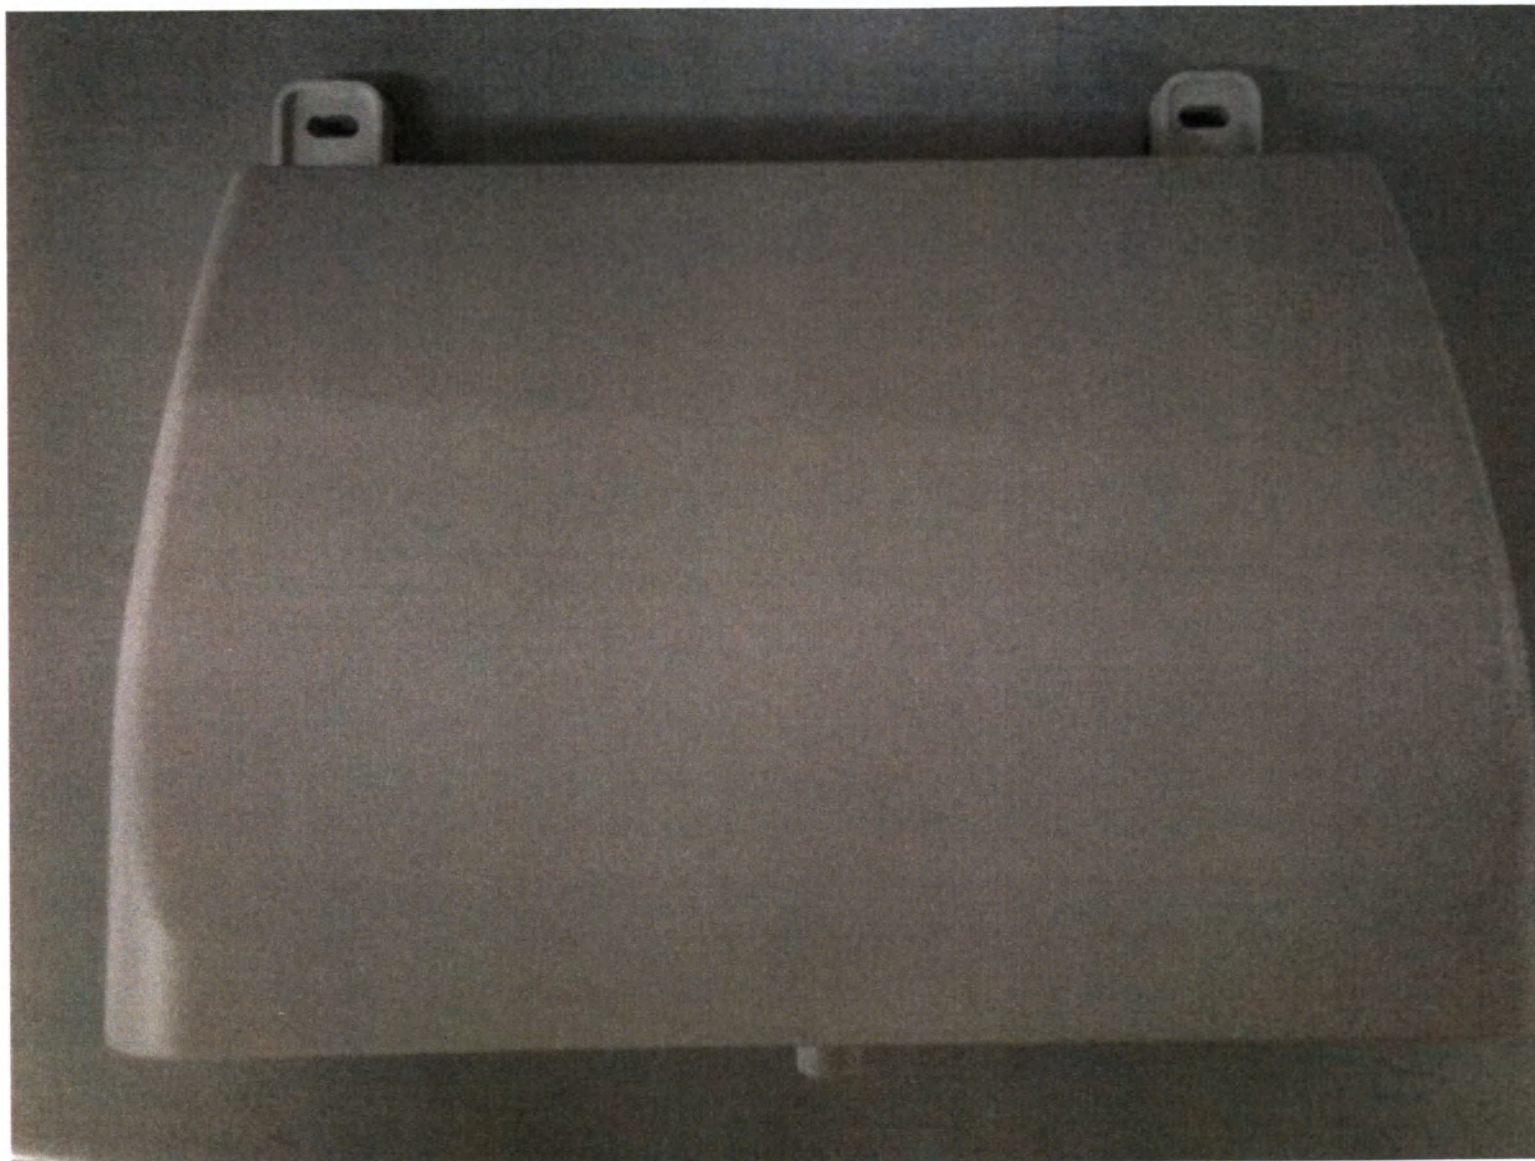

Комплект стартовый для установки прибора, в составе:  
- Предметные стекла, длина 75–76 мм






- Термокрасящая лента для принтера, ширина 40 мм



- Дилуэнт М-68DS DILUENT

mindray

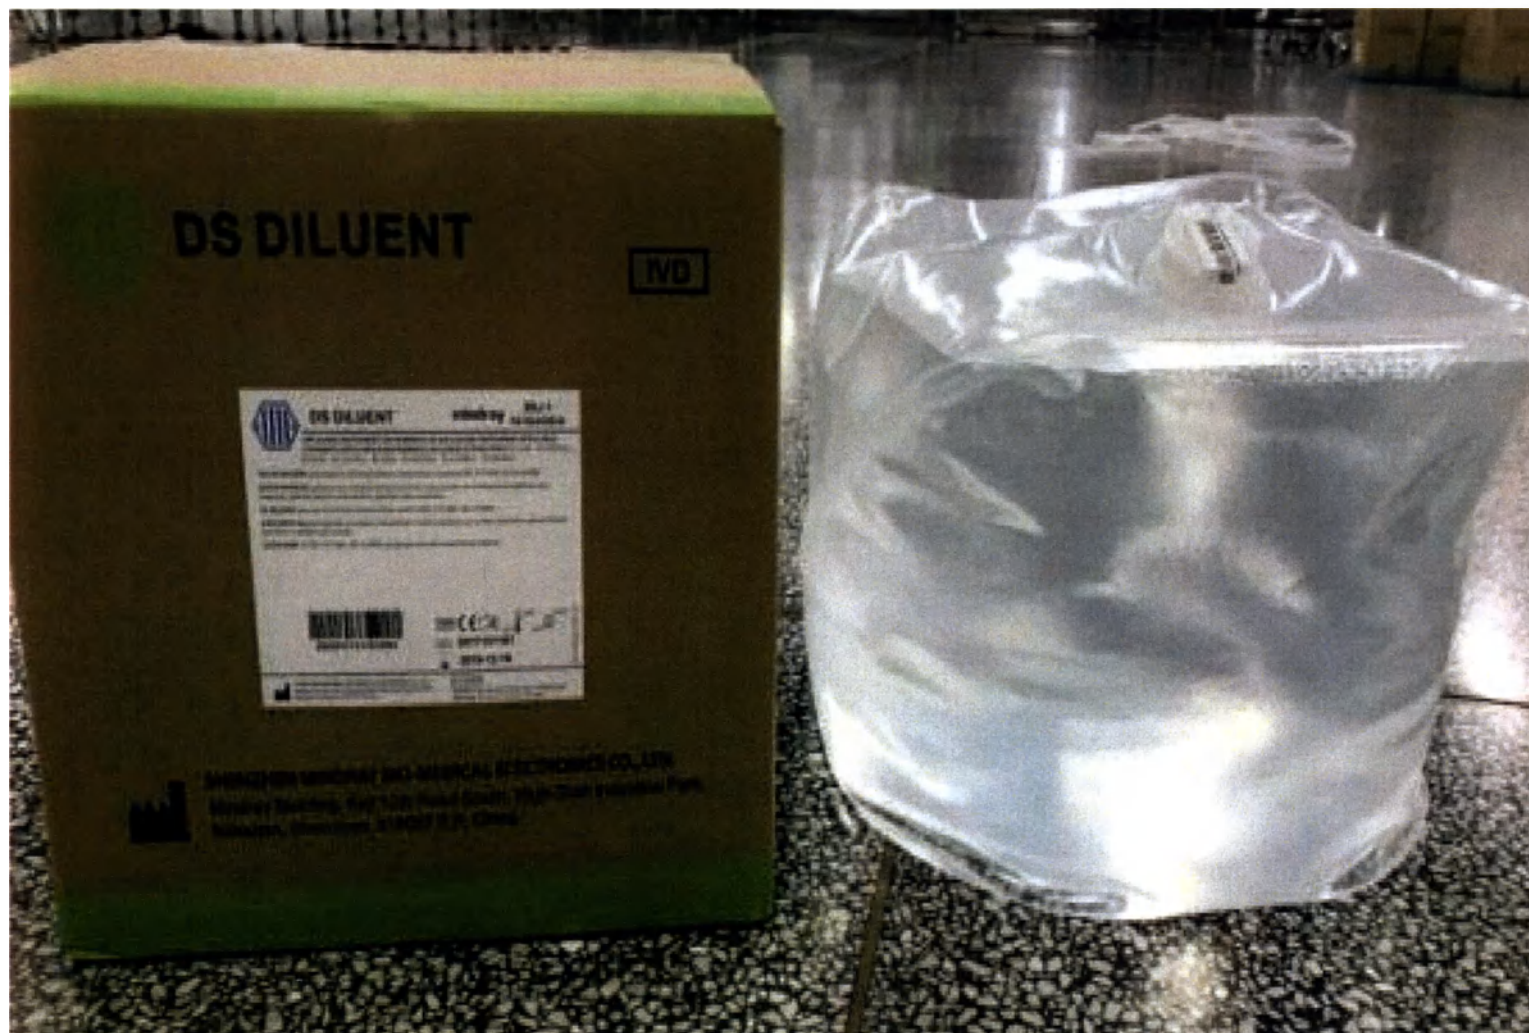



## M-68DS DILUENT

20 L

P/N:105-001974-00

**INTENDED USE:** The M-68DS DILUENT applies to Mindray BC-6800/BC-6600 Auto Hematology Analyzer. It participates in the measurement of parameters related to RBC, PLT, WBC, RET and NRBC. M-68DS DILUENT also applies to SC-120 Auto Slide Maker & Stainer and CRP-M100 Specific Protein Analyzer manufactured by Mindray. It participates in the cleaning of related components of the Auto Slide Maker & Stainer and Specific Protein Analyzer.

**VERWENDUNGSZWECK:** M-68DS DILUENT wurde für den Mindray BC-6800/BC-6600 Autom. Hämatologie-Analysator entwickelt. Das Produkt ist an der Messung von Parametern in Bezug auf RBC, PLT, WBC, RET und NRBC beteiligt.

**USO PREVISTO:** El DILUYENTE M-68DS se usa con el Analizador automático para hematología Mindray BC-6800/BC-6600. Se utiliza para la medición de parámetros relacionados con RBC, PLT, WBC, RET y NRBC.



**USAGE PREVU:** Le DILUANT M-68DS s'applique à l'automate d'hématologie Mindray BC-6800/BC-6600. Il participe à la mesure des paramètres RBC, PLT, WBC, RET et NRBC.

**USO PREVISTO:** M-68DS DILUENT è applicabile all'analizzatore ematologico automatico Mindray BC-6800/BC-6600. Partecipa alla misurazione dei parametri relativi a RBC, PLT, WBC, RET e NRBC.

**USO PRETENDIDO:** O DILUENTE M-68DS se aplica ao Analisador Automático de Hematologia Mindray BC-6800/BC-6600. Ele participa da medição dos parâmetros relacionados a GV, PLT, GB, RET e NRBC.



27720180507030853




2019 120703



2021-12-06



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.  
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

047-004987-00(4.0)

## Ручной сканер штрих-кода



Ручной сканер штрих-кода: маркировка на верхней части




Ручной сканер штрих-кода: маркировка на внутренней стороне




## Соединительный кабель для сканера штрих-кода



Защитная крышка (дополнительная)

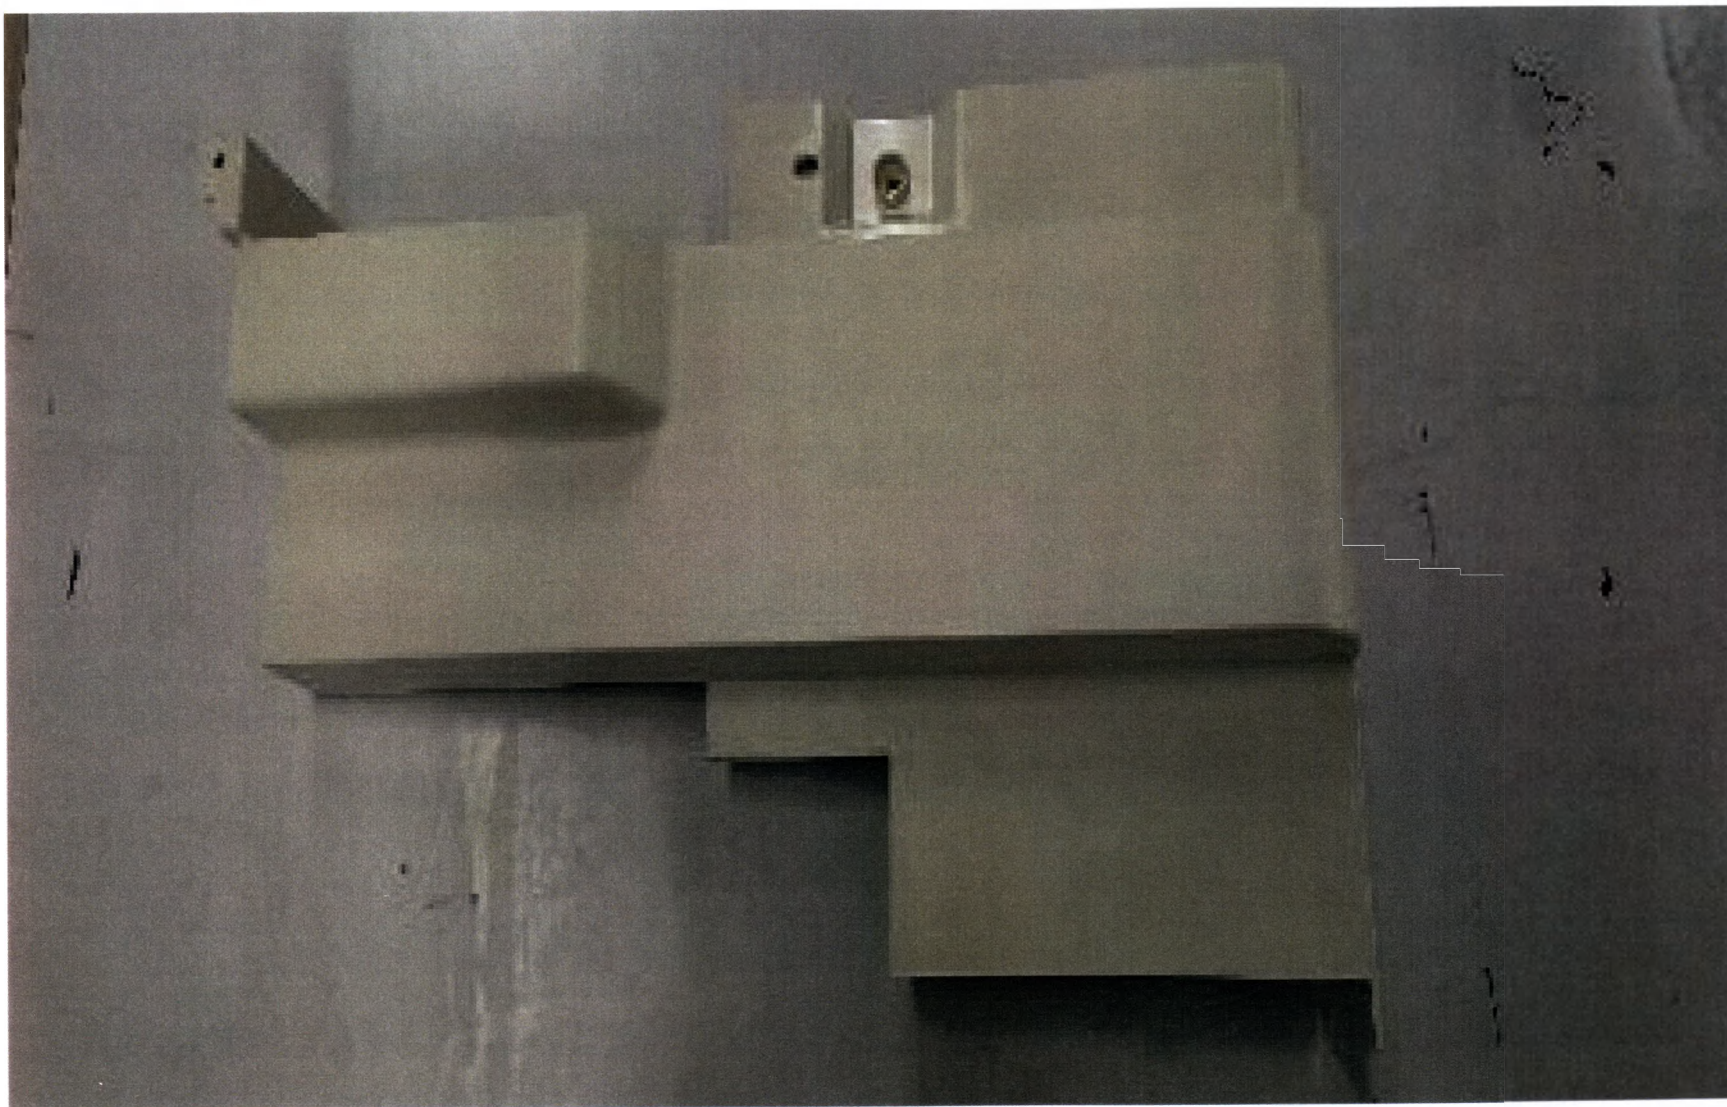

Ножка в сборе

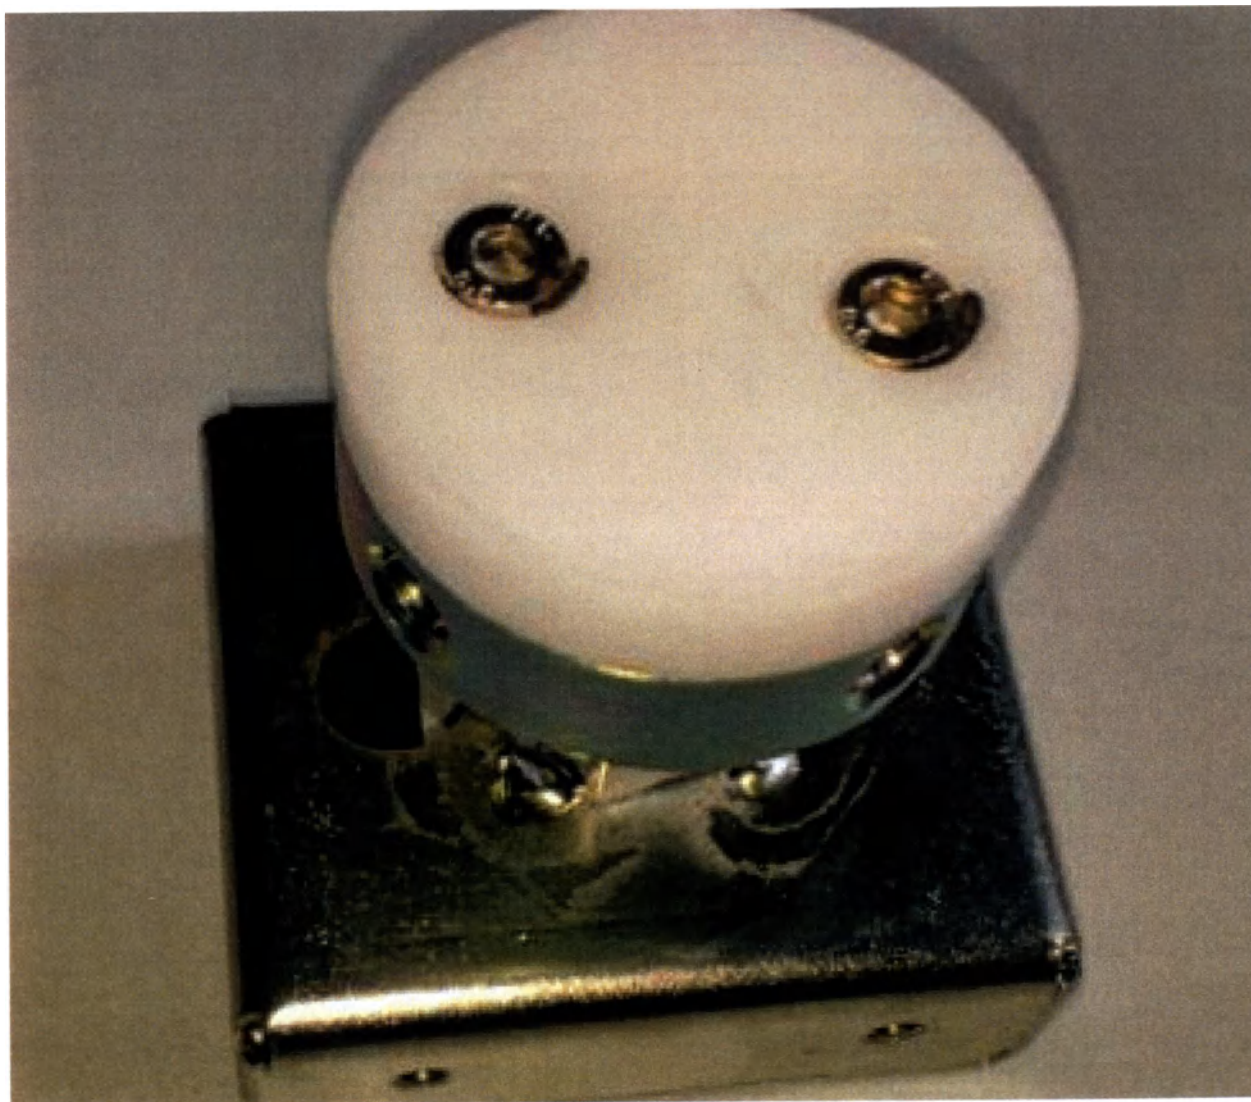

## Адаптер для пробирки без крышки



## Адаптер для центрифужной пробирки 1,5 мл




# Адаптер для пробирки с антикоагулянтом



# Адаптер для центрифужной пробирки 0,5 мл



## Соединитель Y-образный

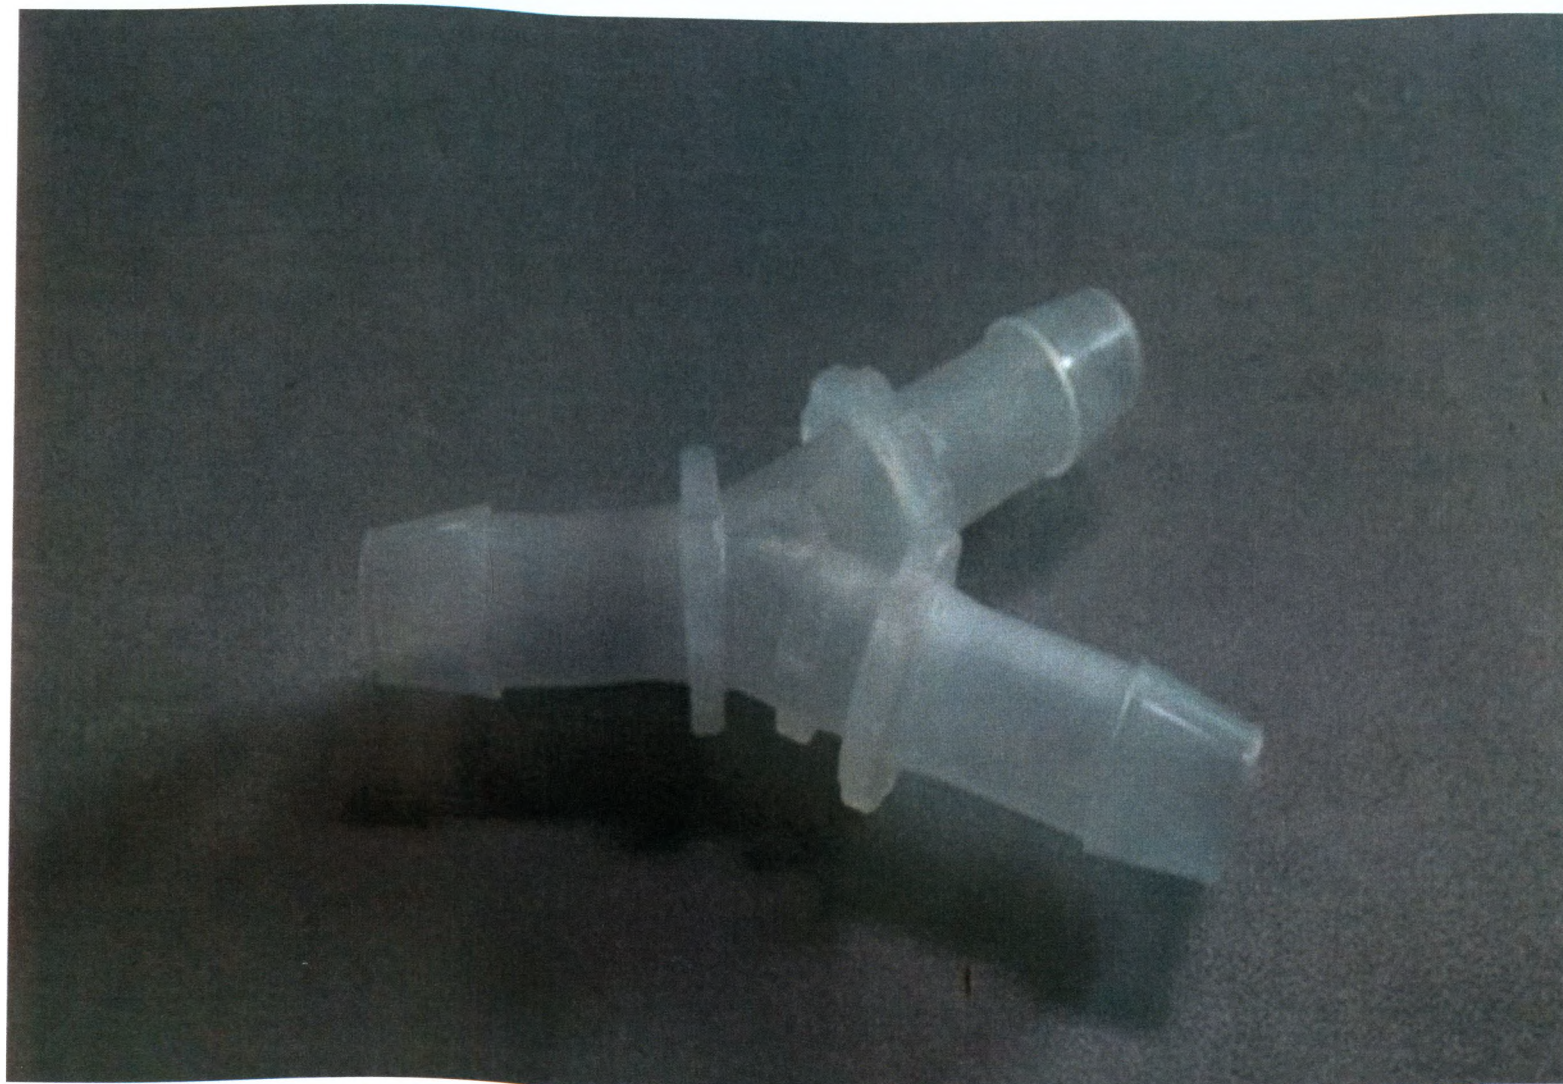

Макет стикера с русскоязычной маркировкой прибора

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>«Прибор автоматический для подготовки и окраски мазков SC-120, с принадлежностями»</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Производитель:</b>                                                                     | Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.<br>Здание “Миндрей”, Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк<br>высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская<br>Народная Республика |
| <b>Страна<br/>происхождения:</b>                                                          | Китай                                                                                                            |
| <b>Уполномоченный<br/>представитель в РФ:</b>                                             | ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн. тер.<br>г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,<br>стр. 5, ан./пом. 4/І, ком. 7, 11а<br>Тел. +7 (499) 553-60-36       |
| <b>Регистрационное<br/>удостоверение</b>                                                  | № _____ от _____                                                                                                                                                                                    |

Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинского изделия. Общий вид




**Auto Slide Maker & Stainer**




**mindray**

Model : SC-120 Qty : 1

Size : 1040 mm × 1040 mm × 1170 mm

 **SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**  
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China  
TEL: +86 755 81888998 FAX: +86 755 26582680

 **Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)**  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

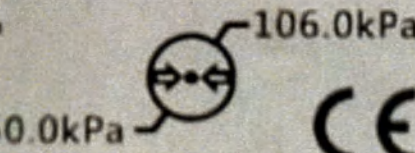DATE: 2019-12

SN:

 UN-9C000170

P/N:

 3204B-CTO-S01

W#:

 93126060

Ordering NO

 21318441.10

(1 OF 4)

047-011995-01 (1.0)

применяется  
и скреплено  
печатью 57

*Сысоева*

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 24.05.22Г  
СЫСОЕВА Н.В.  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  
РЕГИСТРАЦИИ

