

ВЕКТОР

БЕСТ - БАЛТИКА

АО "Вектор-Бест-Балтика"

Юридический адрес:

196240, г. Санкт-Петербург,

вн. тер. г. муниципальный округ

Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д. 4,

литера А, ком. 201

тел./факс: (812) 495-55-99 (многокан.)

e-mail: vbbalt@vbest.ru

ОКПО: 46922822

ИНН: 7810118490 КПП: 781001001

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор

АО «Вектор-Бест-Балтика»




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Раствор промывающий для Анализатора автоматического
клеточного состава мочи Usscanner (E) в вариантах исполнения**

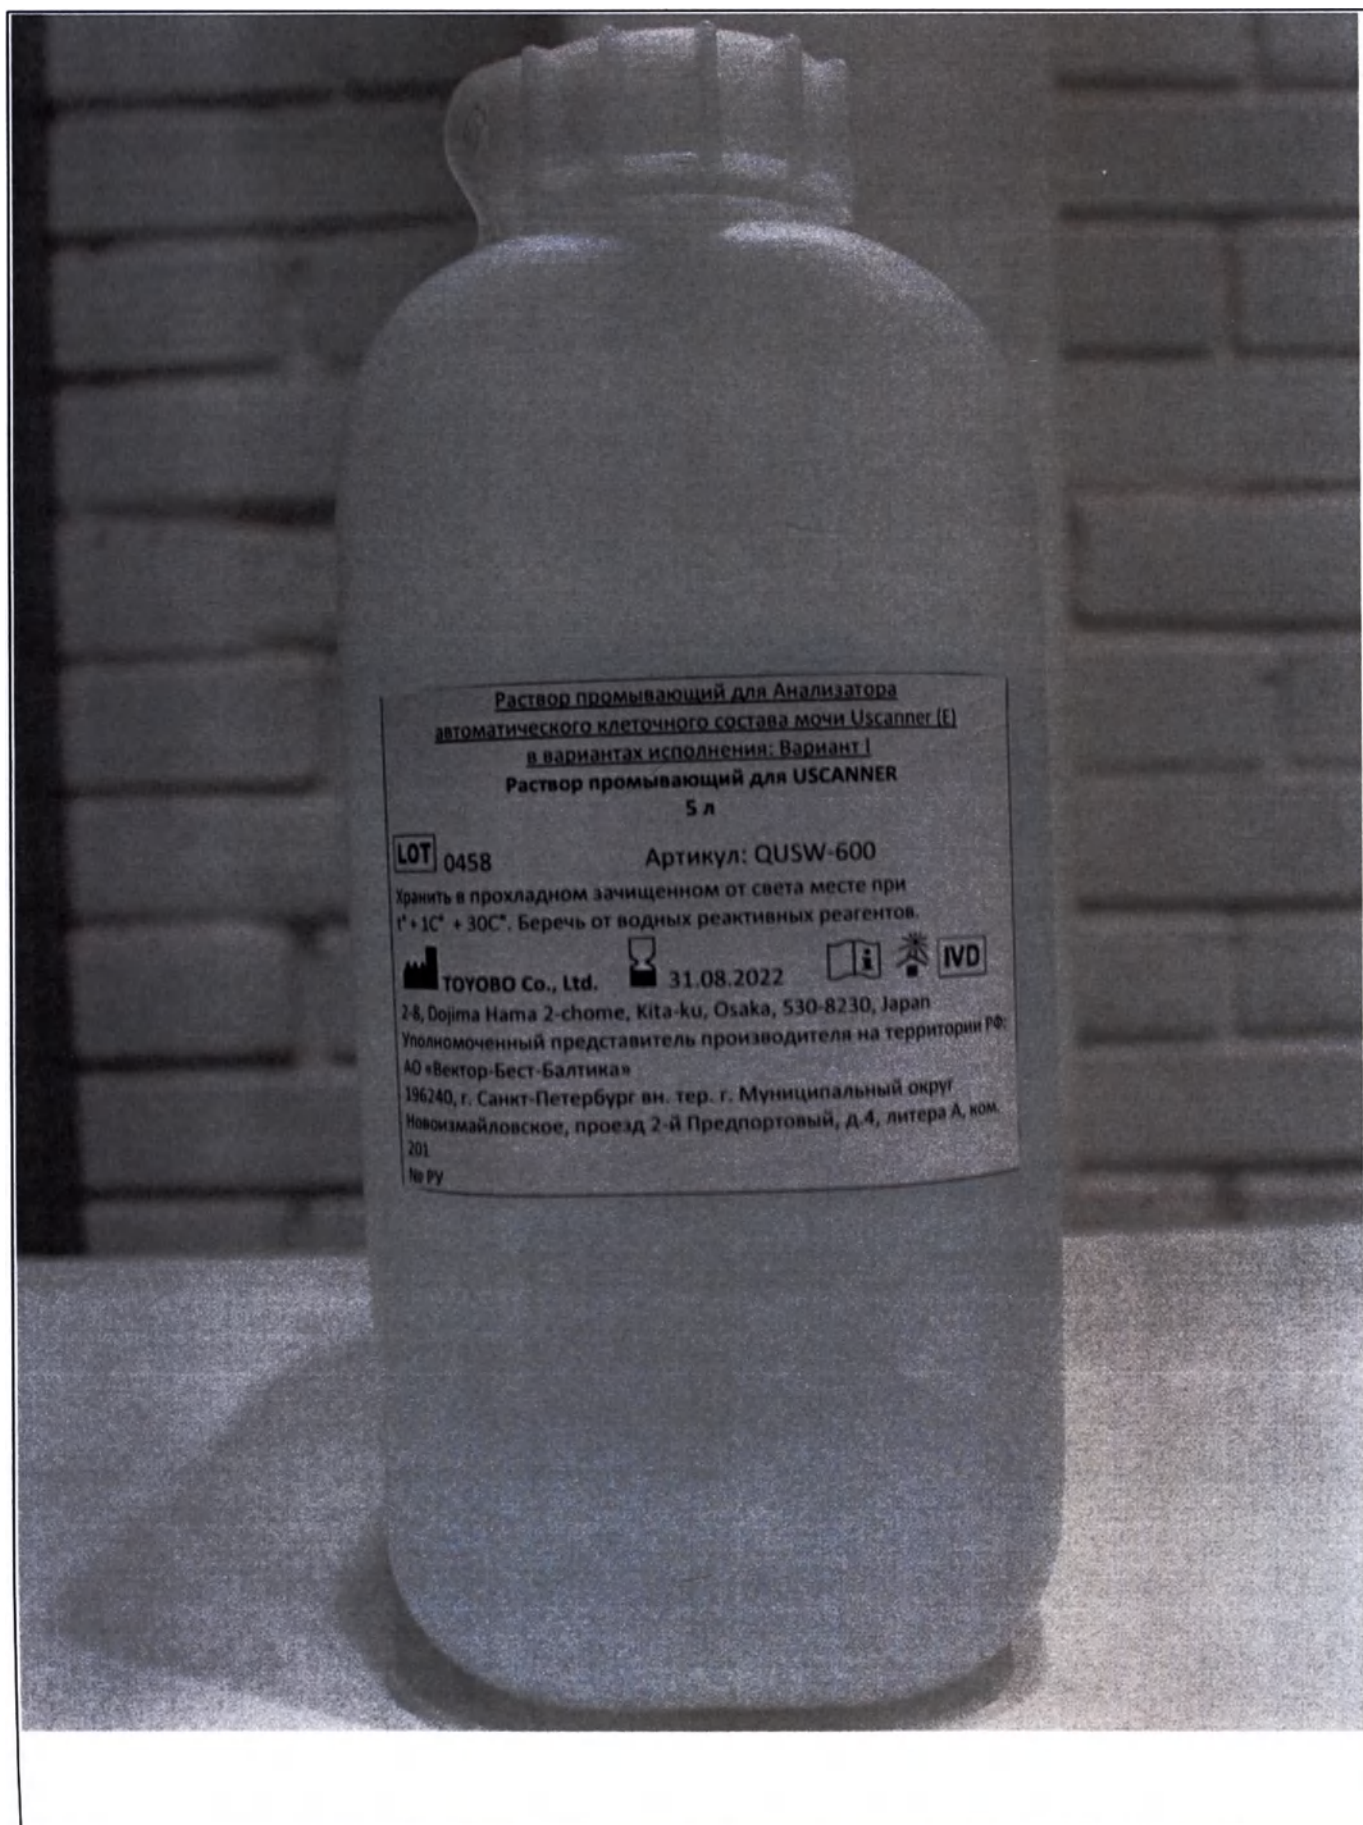

Маркировка на канистре 5 л. Вариант I. Раствор промывающий для USCANNER

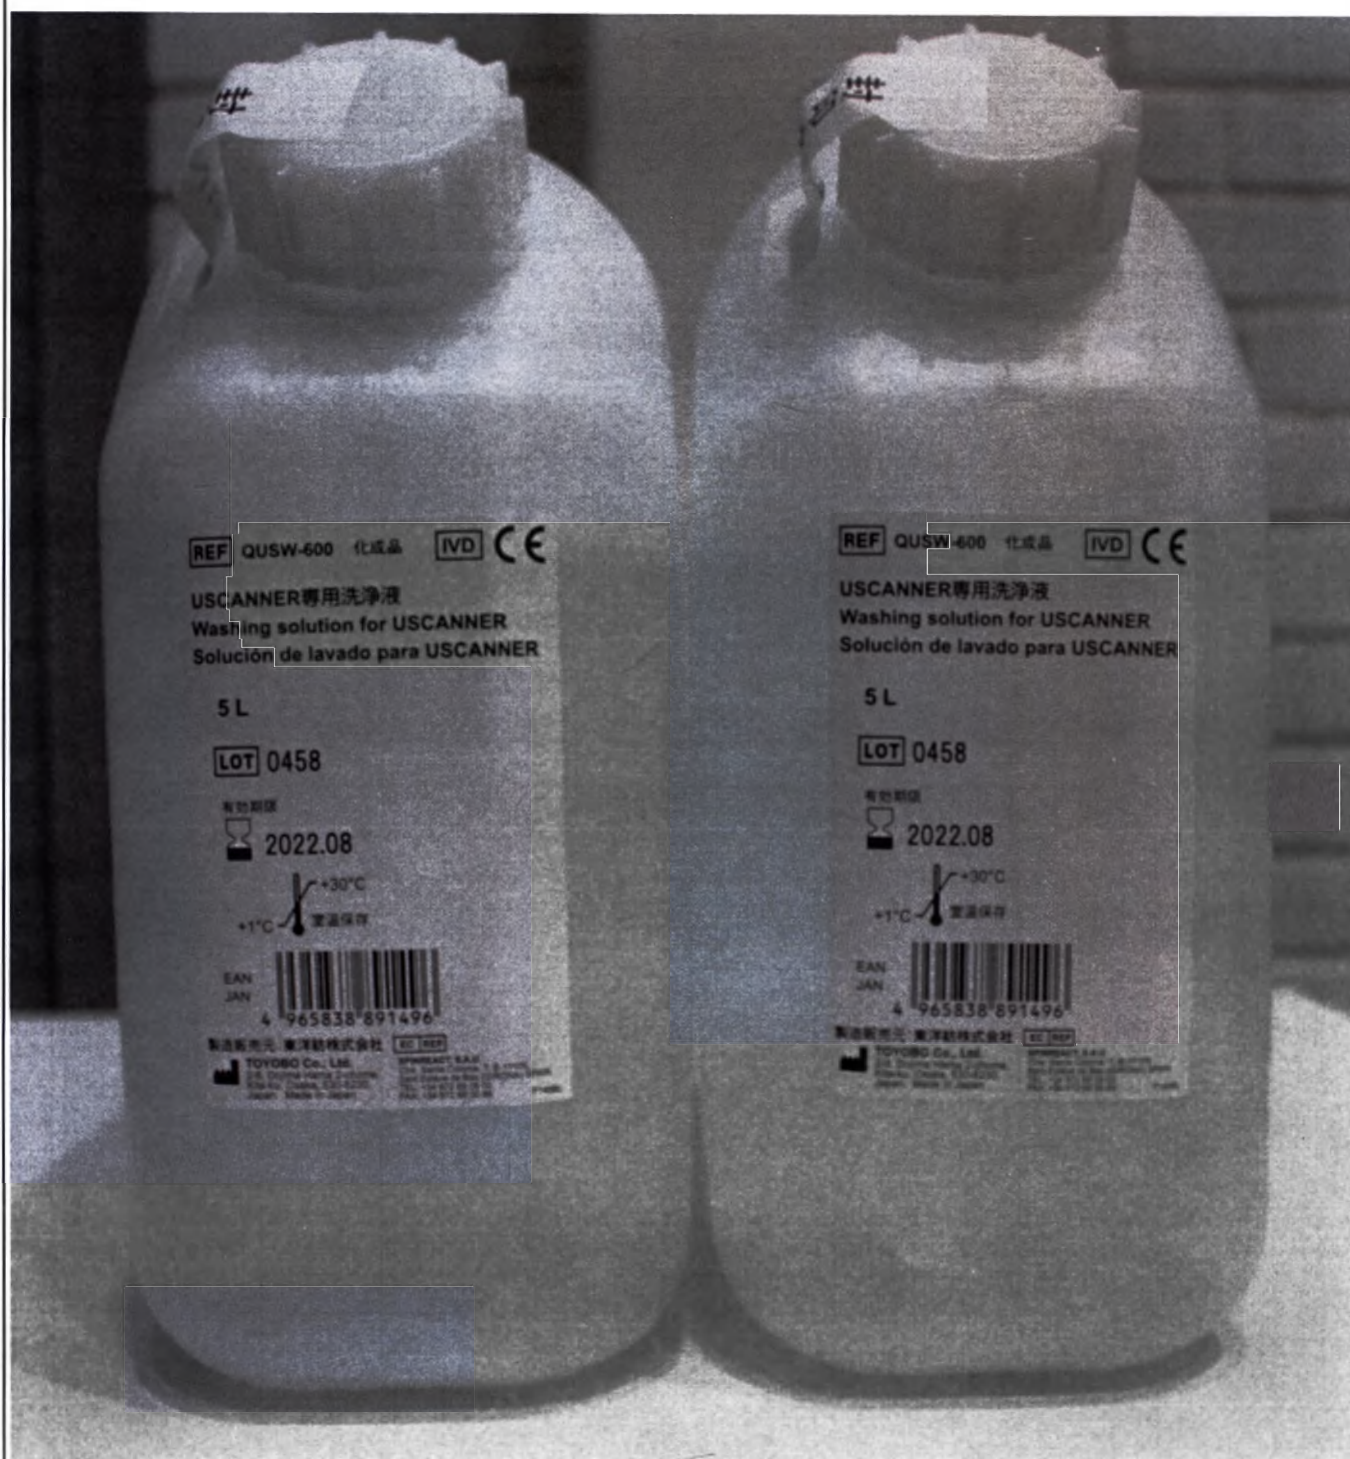

2 канистры 5 л. Вариант I. Раствор промывающий для USCANNER

REF QUSW-600 化成品 CE IVD

USCANNER専用洗浄液
Washing solution for USCANNER
Solución de lavado para USCANNER
10L (5L x 2)

LOT 0458

有効期限 2022. 08

製造販売元 東洋薬機株式会社
TOYOBO Co., Ltd.
2-8, Dojima Numa 2-chome,
Kita-ku,
Osaka, 530-8230, Japan
Made in Japan

SPINREACT S.A.U.
C/ta Santa Coloma, 7, E-17170
Sant Cugat del Val (Barcelona) Spain
TEL: +34 937 89 00 00
FAX: +34 937 89 00 00

EAN JAN [001-128] 2022. 08

4 965838 891496 (01)04885838891496(17)220800(10)0458

Раствор промывающий для Анализатора
автоматического клеточного состава мочи Usccanner [E]
в вариантах исполнения: Вариант I
- Раствор промывающий для USCANNER
10 л (5 л x 2 канистры)
- Инструкция по применению

LOT 0458 Артикул: QUSW-600

Хранить в прохладном защищенном от света месте при
 $t^{\circ} + 1^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}$. Беречь от водных реактивных реагентов.

TOYOBO Co., Ltd. 31.08.2022 IVD

2-8, Dojima Numa 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, Japan
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
АО «Вектор-Бест-Балтика»
196240, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. Муниципальный округ
Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д.4, литера А, ком.
201
№ РУ

Упаковка 2-х канистр 5 л. Вариант I. Раствор промывающий для USCANNER

REF QUSW-600 化成品



IVD



製造販売元: 東洋紡株式会社

TOYOBO Co., Ltd.
2-8, Dojima Hama 2-chome,
Kita-ku,
Osaka, 530-8230, Japan
Made In Japan

USCANNER専用洗浄液

Washing solution for USCANNER

Solución de lavado para USCANNER

LOT 0458

10L (5L x 2)

EC REP

SPINREACT, S.A.U.
Ctra. Santa Coloma, 7, E-17176
Sant Esteve de Bas (GIRONA) SPAIN
TEL: +34 972 69 08 00
FAX: +34 972 69 00 99

EAN JAN

[GS1-128]



有効期限

2022. 08



4 965838 891496

F1447L



(01) 04965838891496 (17) 220800 (10) 0458

Раствор промывающий для Анализатора
автоматического клеточного состава мочи Uscanner (E)

в вариантах исполнения: Вариант I

- Раствор промывающий для USCANNER

10 л (5 л x 2 канистры)

- Инструкция по применению

LOT 0458

Артикул: QUSW-600

Хранить в прохладном защищенном от света месте при
 $t^{\circ} + 1^{\circ}C^{\circ} + 30^{\circ}C^{\circ}$. Беречь от водных реактивных реагентов.



TOYOBO Co., Ltd.



31.08.2022



IVD

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «Вектор-Бест-Балтика»


196240, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. Муниципальный округ

Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д.4, литера А, ком.

201

№ РУ

Маркировка на упаковке 2-х канистр 5 л. Вариант I. Раствор промывающий для
USCANNER

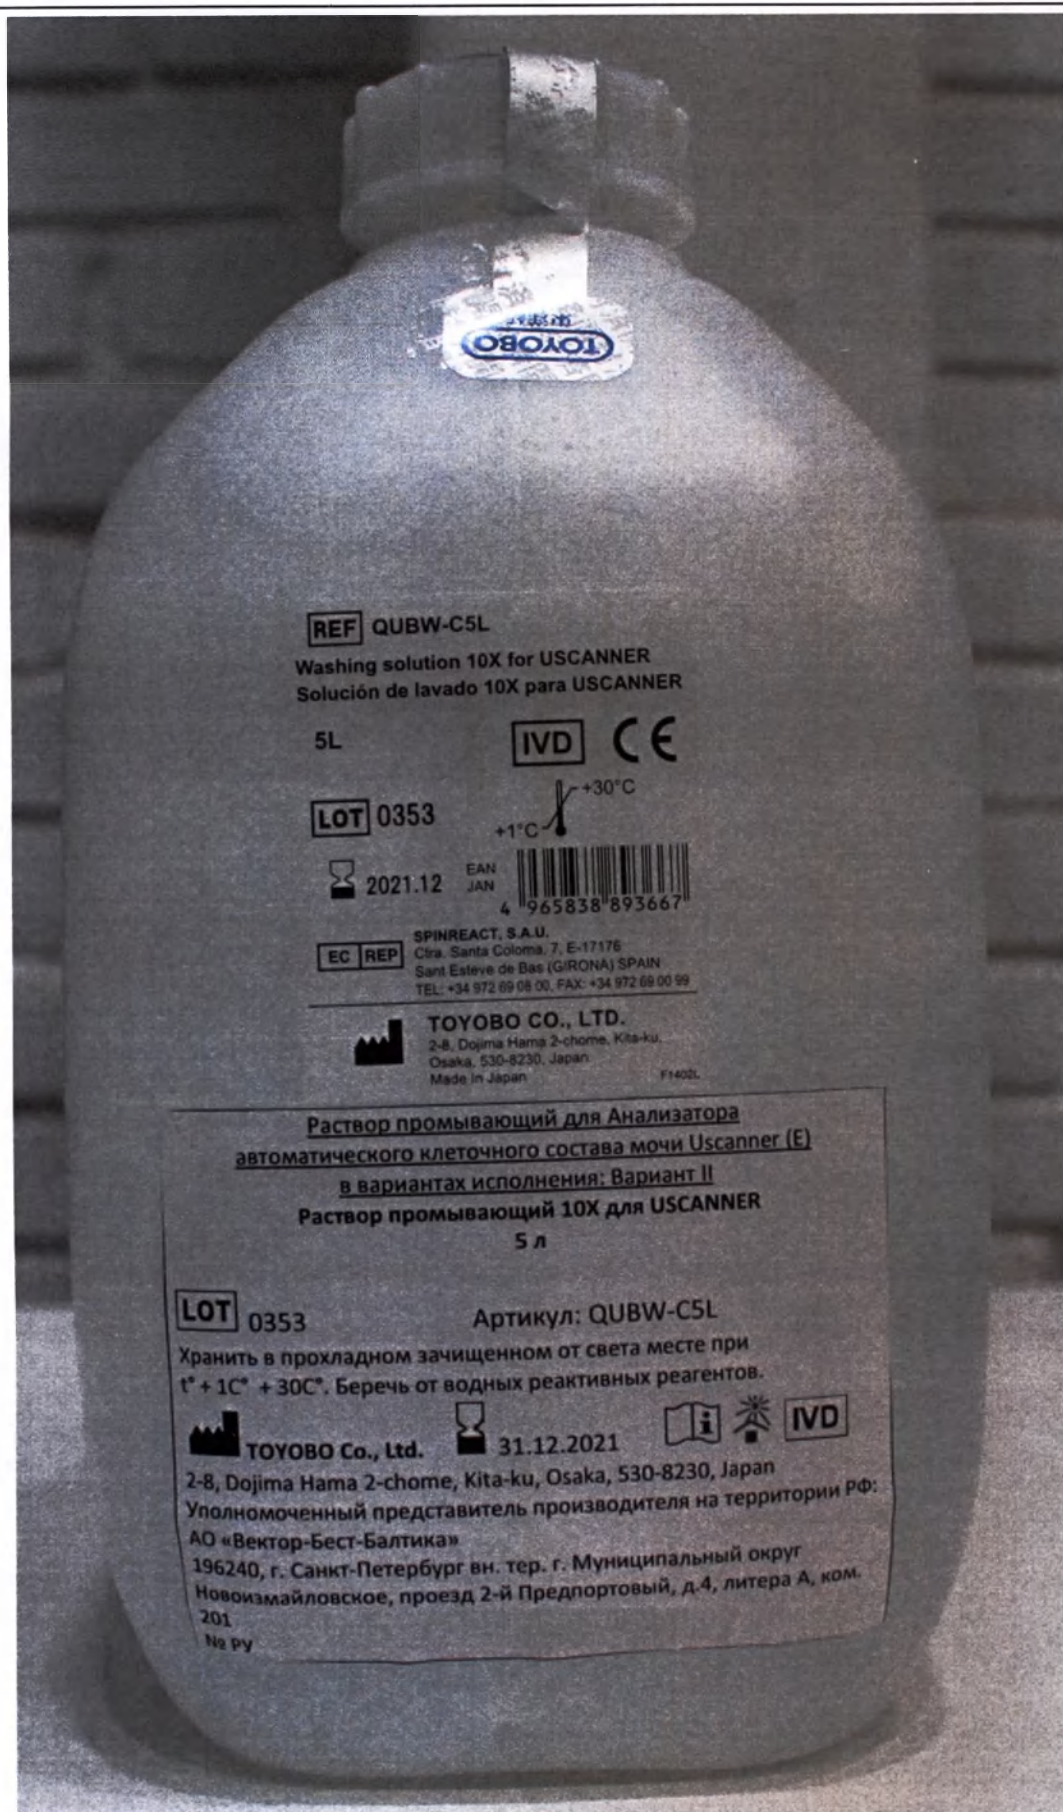

Канистра 5 л. Вариант II. Раствор промывающий 10X для USCANNER

REF QUBW-C5L

Washing solution 10X for USCANNER

Solución de lavado 10X para USCANNER

5L

IVD



LOT 0353

+1°C +30°C



2021.12

EAN
JAN



4 965838 893667

EC REP

SPINREACT, S.A.U.

Ctra. Santa Coloma, 7, E-17176

Sant Esteve de Bas (GIRONA) SPAIN

TEL: +34 972 69 08 00. FAX: +34 972 69 00 99



TOYOBO CO., LTD.

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku,

Osaka, 530-8230, Japan

Made In Japan

F1402L

Раствор промывающий для Анализатора
автоматического клеточного состава мочи Uscanner (E)

в вариантах исполнения: Вариант II

Раствор промывающий 10X для USCANNER

5 л

LOT 0353

Артикул: QUBW-C5L

Хранить в прохладном защищенном от света месте при
 $t^{\circ} + 1^{\circ} + 30^{\circ}C$. Беречь от водных реактивных реагентов.



TOYOBO Co., Ltd.



31.12.2021



IVD

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «Вектор-Бест-Балтика»

196240, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. Муниципальный округ

Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д.4, литера А, ком.

201

№ ру

Маркировка на канистре 5 л. Вариант II. Раствор промывающий 10X для USCANNER

Раствор промывающий для Анализатора
автоматического клеточного состава мочи UsScanner (E)
в вариантах исполнения: Вариант II
- Раствор промывающий 10X для USCANNER
(5 л x 1 канистры)
- Инструкция по применению

LOT 0353

Артикул: QUBW-CSL

Хранить в прохладном защищенном от света месте при
 $t^{\circ} + 10^{\circ} + 30^{\circ}C$. Беречь от водных реактивных реагентов.



TOYOBO Co., Ltd.



31.12.2021



2-8, Dojima Naha 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
АО «Вектор-Бест-Балтика»

196240, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. Муниципальный округ
Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д.4, литера А, ком.
201

№ PY

REF QUBW-CSL

Washing solution 10X for USCANNER
Solución de lavado 10X para USCANNER

5L



LOT 0353

$+10^{\circ}C$ $+30^{\circ}C$



2021.12

EAN

JAN



4 965838 893667



SPINREACT, S.A.U.

C/ra. Santa Coloma, 7, E-17170

Sant Esteve de Bas (GIRONA) SPAIN

TEL: +34 972 69 06 00, FAX: +34 972 69 00 99



TOYOBO CO., LTD.

2-8, Dojima Naha 2-chome, Kita-ku,

Osaka, 530-8230, Japan


Made in Japan

F1402L


Маркировка на упаковке канистры 5 л. Вариант II. Раствор промывающий 10X для
USCANNER



Ideas & Chemistry



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Раствор промывающий для Анализатора автоматического
клеточного состава мочи Uscanner (E) в вариантах исполнения

"APPROVE"

Group Manager

(position)

Syojiro Masuoka

(name)

Syojiro Masuoka

(signature)

2022. 11. 22

(date)

Stamp



Инструкция по применению.

Примечание: в каждую упаковку будет вложена Инструкция по применению,
содержание которой соответствует документу в регистрационном досье.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

9

