

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "А-КЛИНИК ЛАЙН"

Чипко В.Н.

2021 г.





**Фотографические изображения
«Программатор SmartTouch для имплантируемых электрокардиостимуляторов и дефибрилляторов»**


**Производства
«МайкроПорт СиАрЭм С.р.л.», Италия / MicroPort CRM S.r.l., Via Crescentino s.n. 13040 Saluggia (VC), Italy**

2021

Программатор SmartTouch для имплантируемых электрокардиостимуляторов и дефибрилляторов, в составе:
1. Интерфейсный модуль программатора SmartTouch – 1 шт. Вид сверху

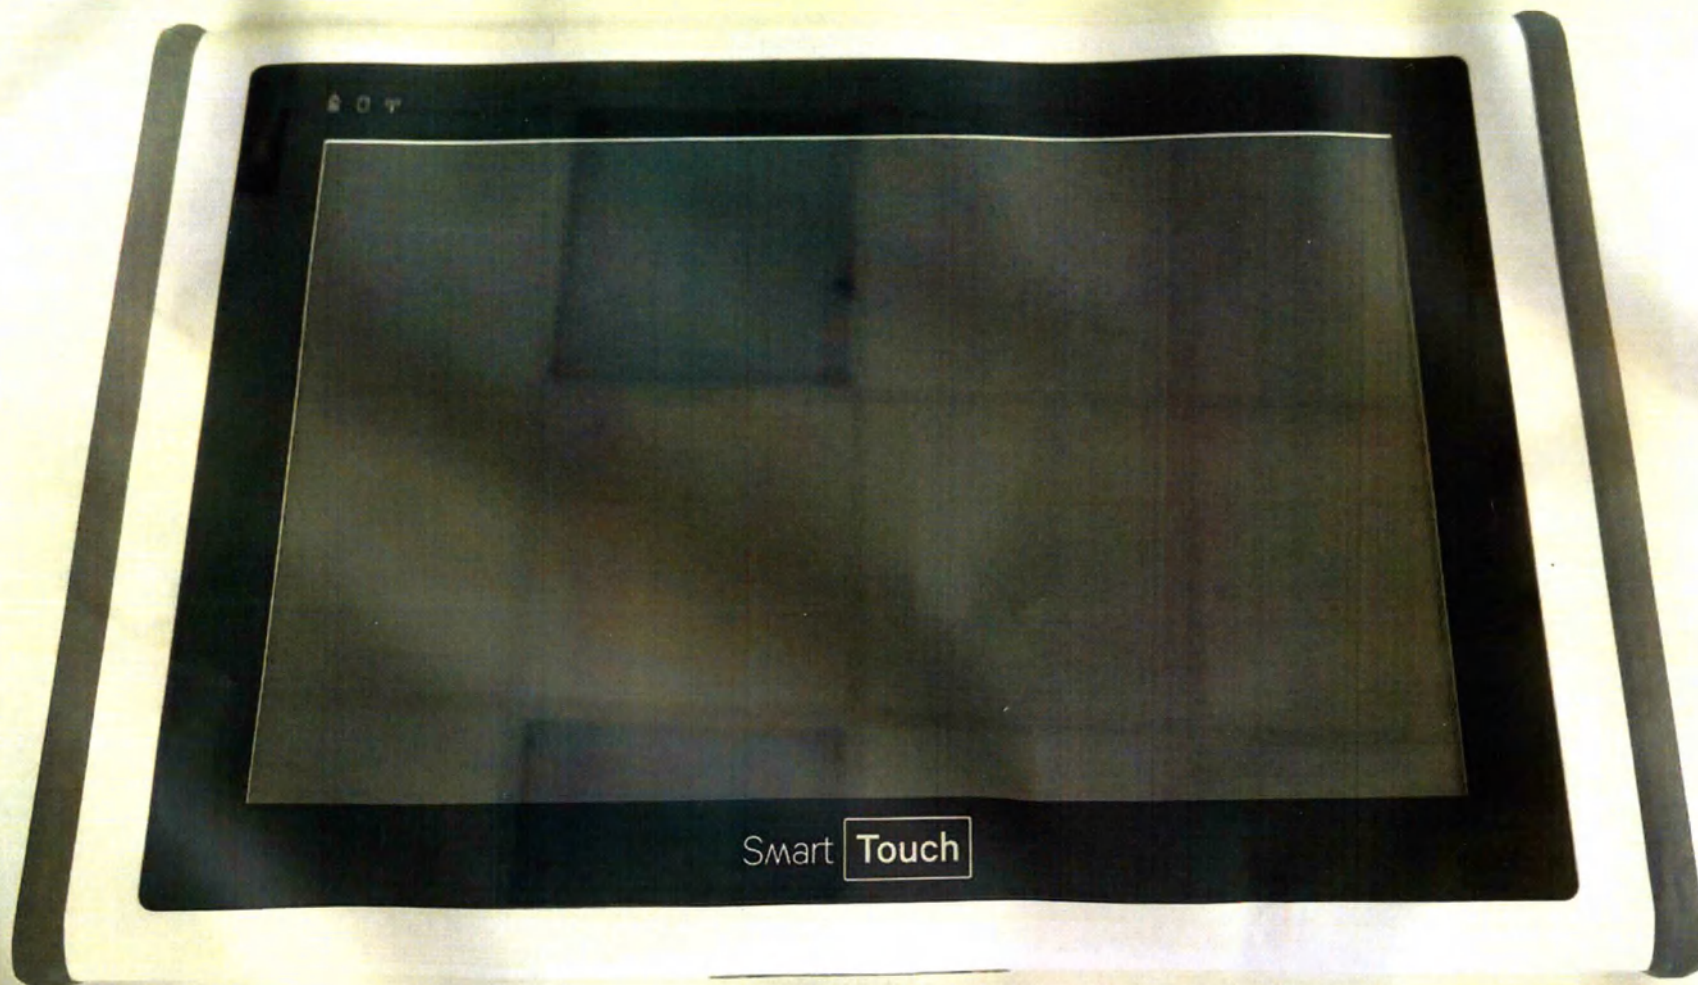

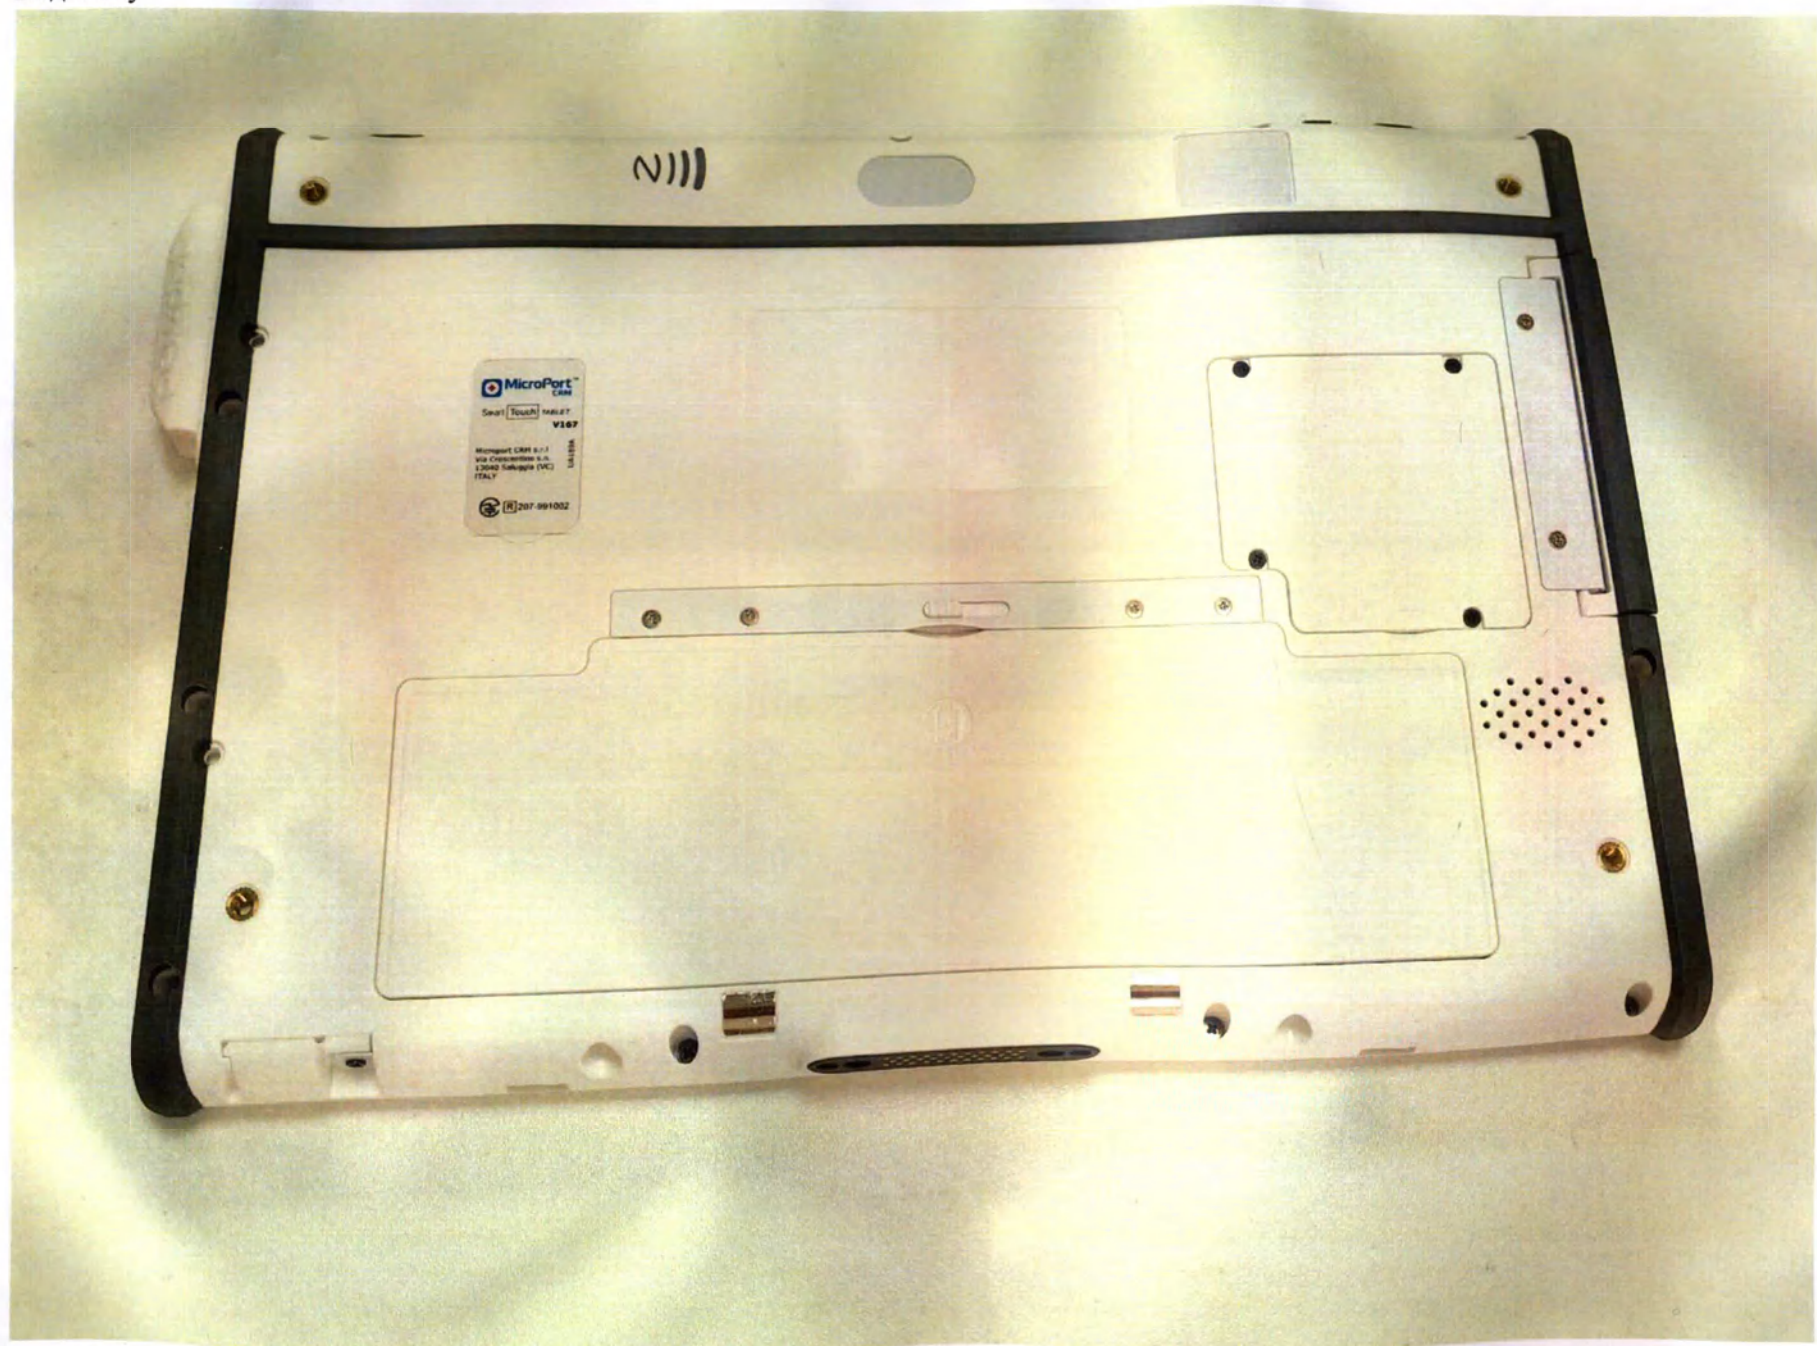

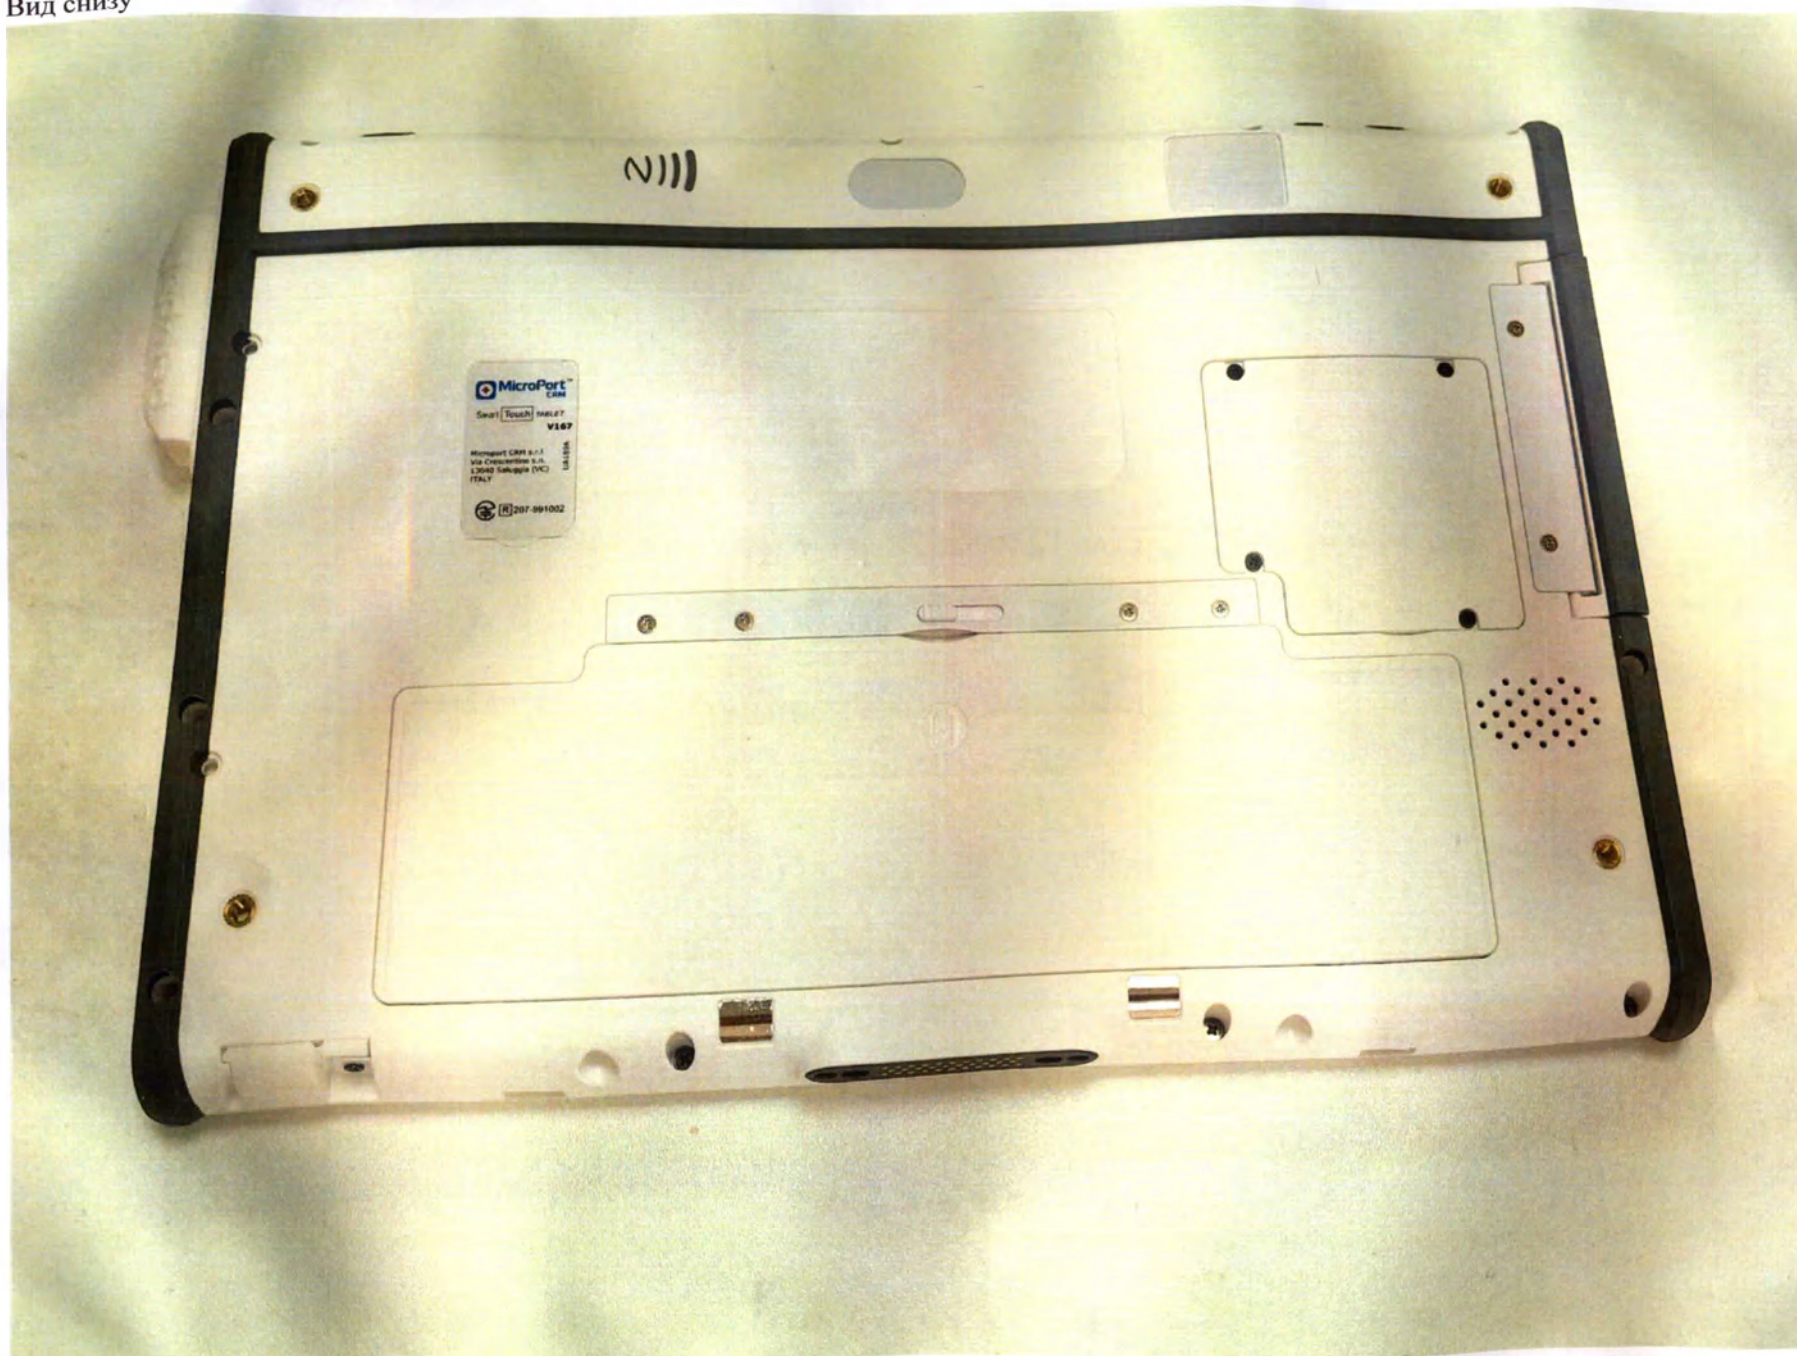


Вид сбоку



2. Установочный модуль программатора SmartTouch – 1 шт. Вид сверху





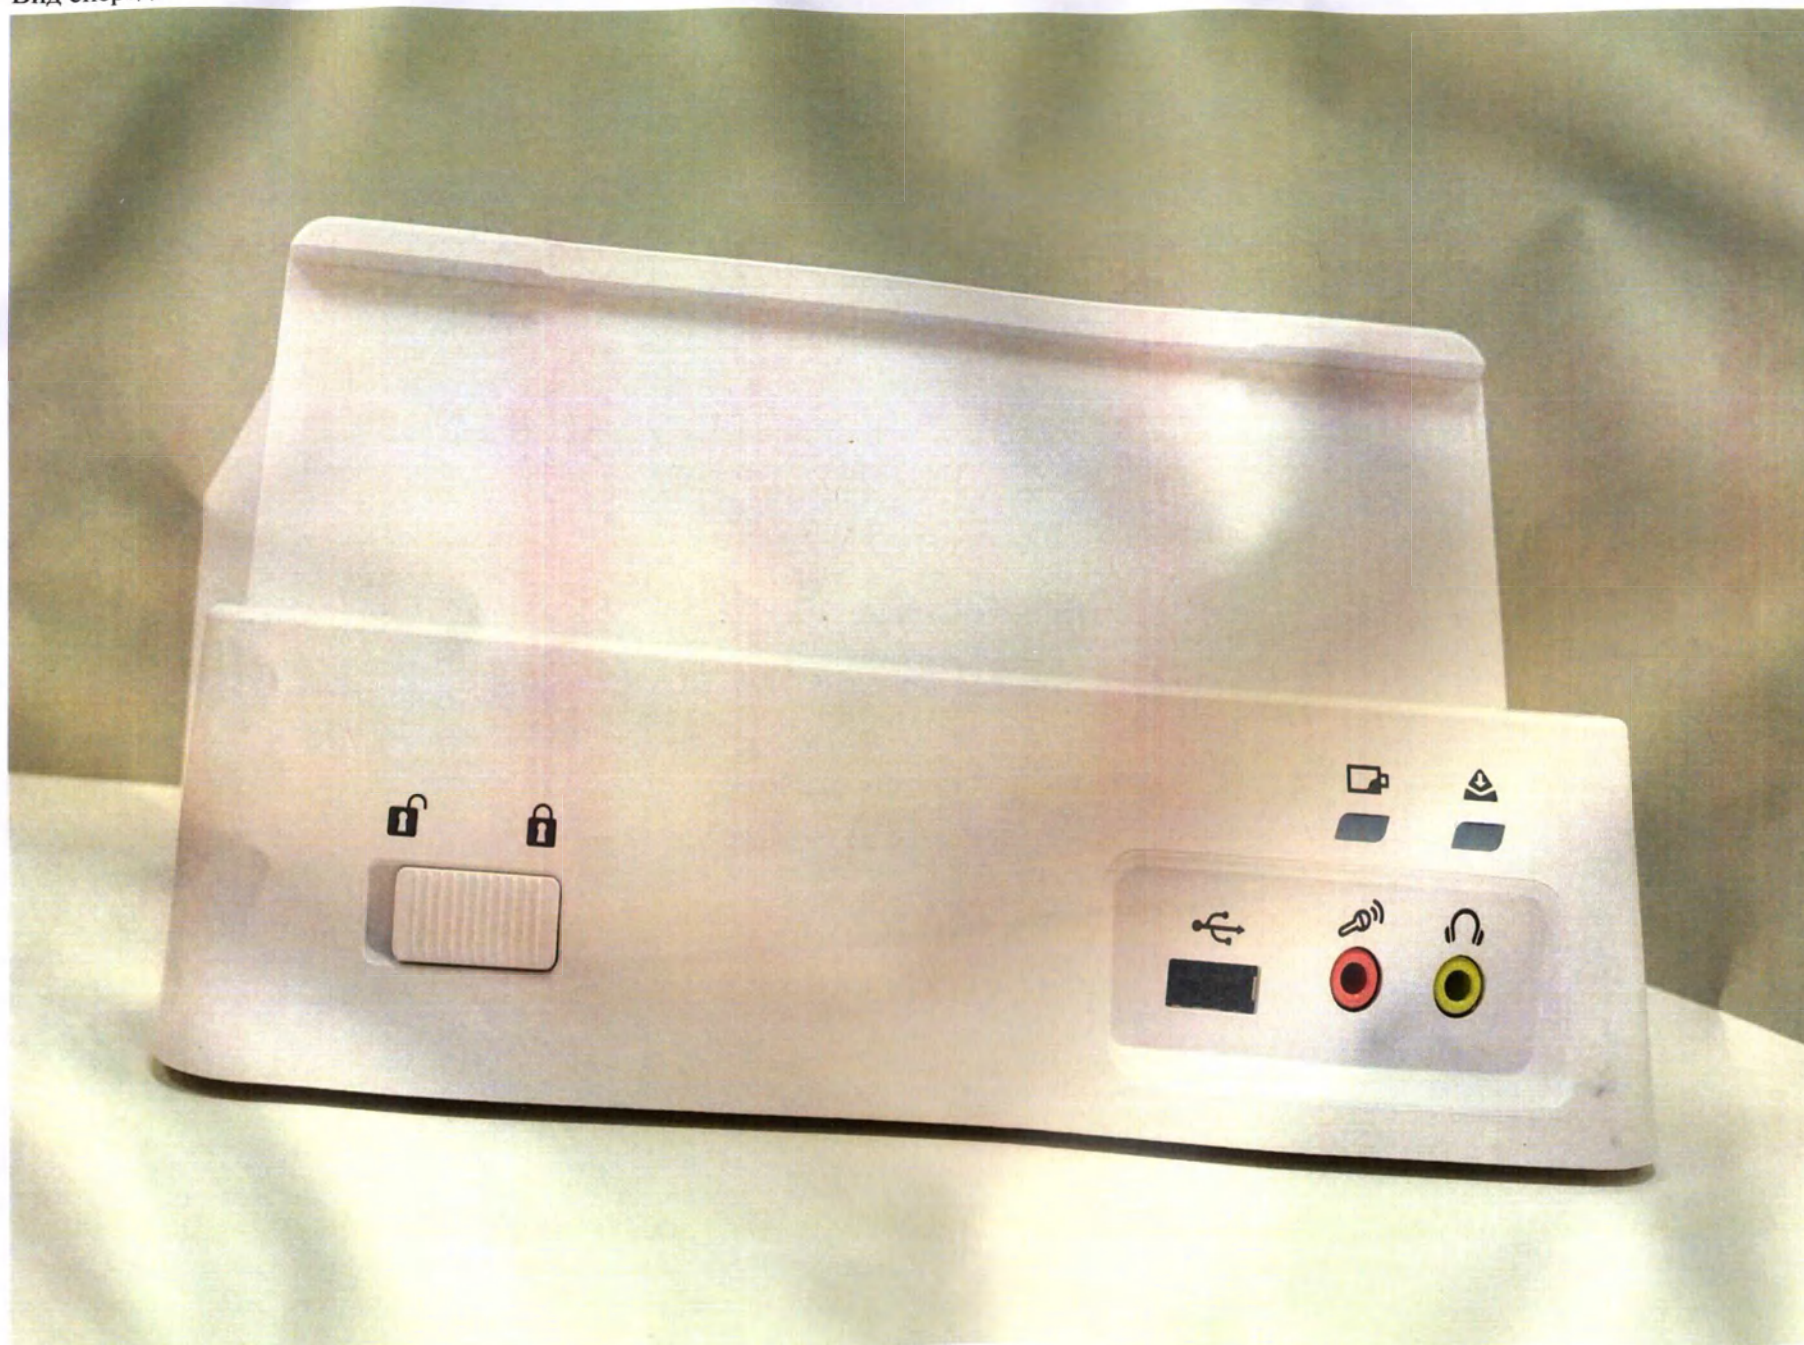

Вид сзади



3. Кабель питания 220 В – 1шт.



4. Блок питания программатора Smart Touch – 1 шт. Вид снизу



MIT-W101

Single unit power adpt
of MIT-W101 for LivaNoa

C/N:

P/N: MIT-W101-ACCAD01E

MO: PAJ5034ZA Rev: A0



249

TPAB988546




MADE IN TAIWAN

5. Программирующая головка CPR3H – 1 шт. Вид сверху







Вид сверху отдельной коробки

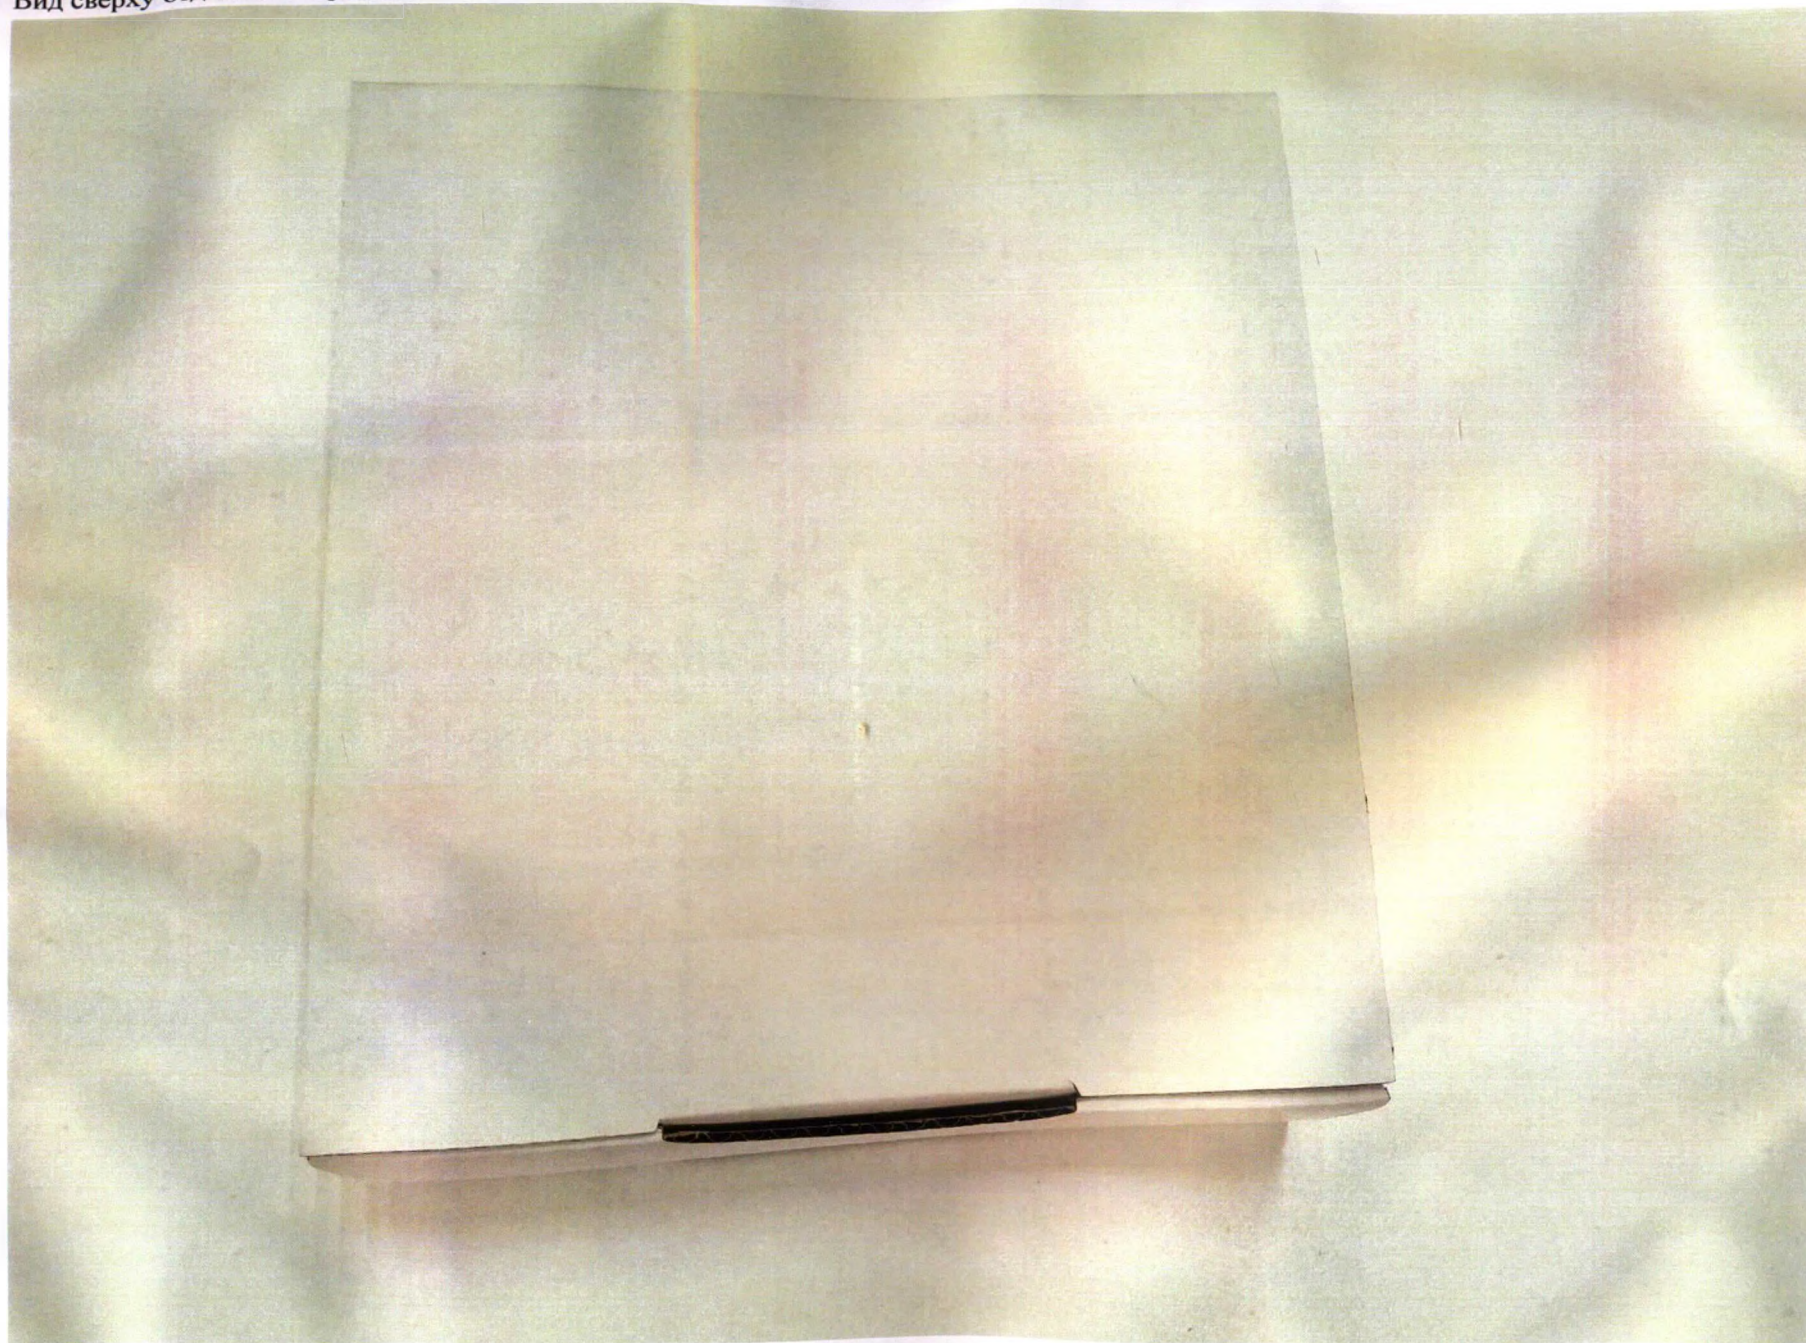

6. USB адаптер для программирующей головки CPR3 – 1 шт. Вид снизу

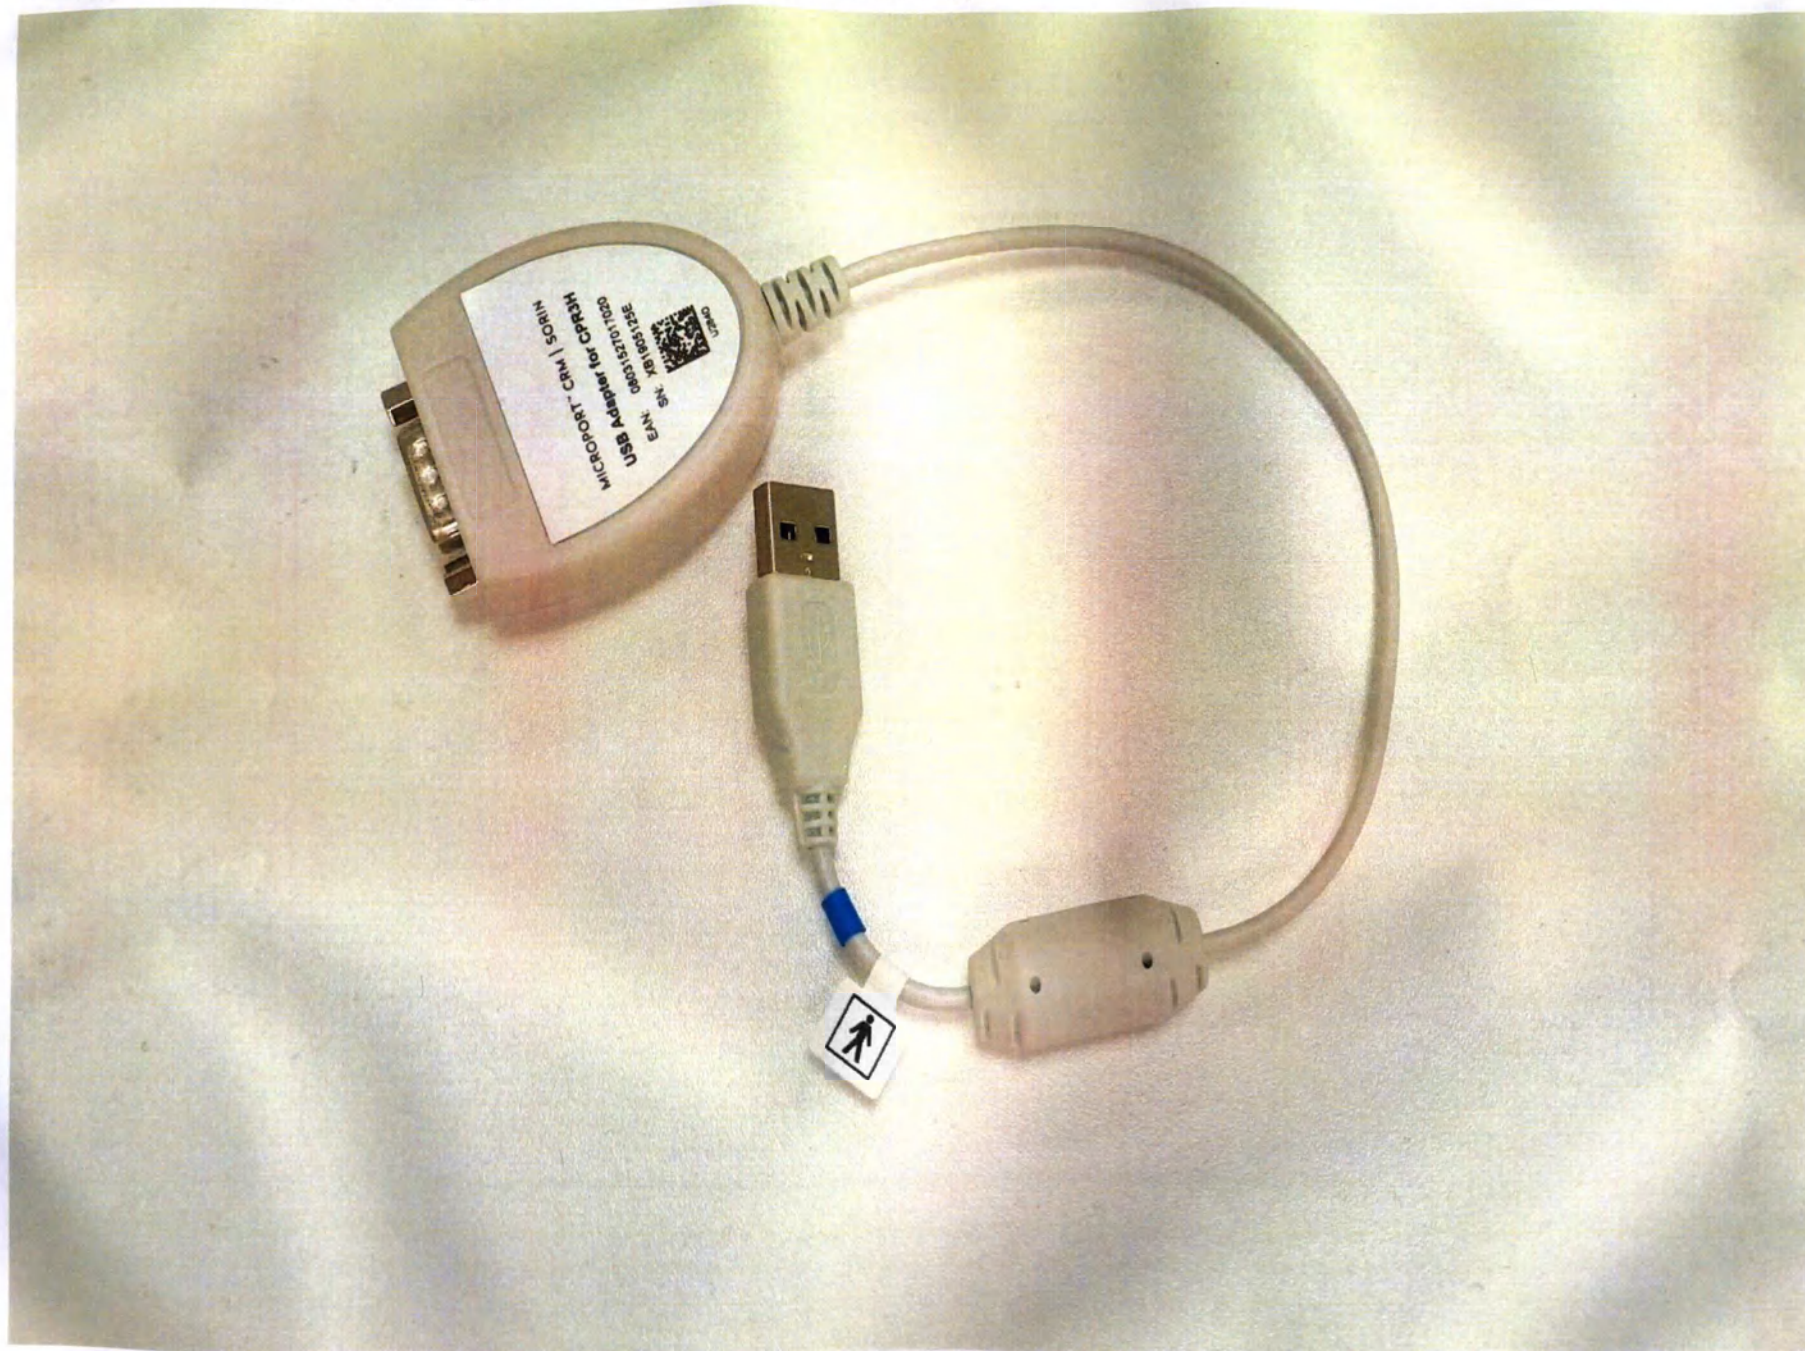



SORIN

Manufactured in France for
MicroPort CRM S.r.l.
Via Crescentino s.n.
13040 Saluggia (VC) - ITALY

USB adapter for CPR3H




REF G999

SN XB1905125E

UDI:



(01)08031527017020(21)XB1905125E



microportmanuals.com

U290E

MicroPort™ | SORIN
CRM



ENGLISH

The user manual for your device is available in PDF on www.microportmanuals.com. Do not use this device if you have not been trained.

Please read the manual thoroughly before using the device and keep it handy for ready reference. To obtain a printed manual (free of charge), please contact your MicroPort representative. The paper-based manual should be forwarded to you at the latest within 7 calendar days of receiving your request.

MicroPort system requirements: Microsoft® Windows® 7 SP1 or higher, Internet Explorer® 8 or higher, Internet connection.

FRANÇAIS

Le manuel de l'utilisateur est disponible au format PDF sur www.microportmanuals.com. Vous ne devez pas utiliser cet appareil si vous n'avez pas été formé.

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser cet appareil.

Pour obtenir un exemplaire papier (gratuit) du manuel, contactez votre représentant MicroPort. Le manuel papier devrait vous être envoyé dans les 7 jours calendaires suivant la réception de votre demande.

Configuration système requise: Microsoft® Windows® 7 SP1 ou version ultérieure, Internet Explorer® 8 ou version ultérieure, connexion Internet.

DEUTSCH

Das Anwenderhandbuch für Ihr Gerät steht als PDF auf www.microportmanuals.com zur Verfügung. Das Produkt darf nur nach der Teilnahme an einer entsprechenden Schulung verwendet werden.

Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Wenn Sie sich an Ihren MicroPort Vertreter um das Handbuch in Papierform (kostenlos) zu erhalten, Das Handbuch in Papierform sollte innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang Ihrer Anfrage bei Ihnen eintreffen.

Mindest-Systemanforderungen: Microsoft® Windows® 7 SP1 oder höher, Internet Explorer® 8 oder höher, Internet-Verbindung.

ITALIANO

Il manuale utente del dispositivo è disponibile in formato PDF sul sito www.microportmanuals.com. Non utilizzare il dispositivo senza aver ricevuto la formazione.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale e tenerlo a portata di mano per la consultazione.

Per ricevere gratuitamente una copia cartacea del manuale, indirizzare al rappresentante MicroPort. Il manuale cartaceo dovrebbe essere recapitato al massimo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Requisiti minimi di sistema: Microsoft® Windows® 7 SP1 o versione superiore, Internet Explorer® 8 o versione superiore, connessione Internet.

ESPAÑOL

El manual del usuario para su dispositivo está disponible en PDF en www.microportmanuals.com. No utilice este dispositivo si no ha recibido la formación.

Lea atentamente el manual antes de usar el dispositivo y téngalo a mano para poder consultarlo.

Si desea obtener una copia impresa del manual (gratuita), póngase en contacto con su representante de MicroPort. La copia impresa del manual debería llegar en un máximo de 7 días naturales tras recibir su solicitud.

Requisitos mínimos del sistema: Microsoft® Windows® 7 SP1 o posterior, Internet Explorer® 8 o posterior, conexión a Internet.

NEDERLANDS

U kunt de gebruikershandleiding voor uw apparaat in PDF-indeling vinden op www.microportmanuals.com. Gebruik dit apparaat niet als u niet met het toestel opgeleid bent.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze bij de hand om snel te kunnen raadplegen.

Als u (gratis) een papieren versie van de handleiding wilt ontvangen, neem dan contact op met een MicroPort-vertegenwoordiger. De papieren handleiding wordt in de regel binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek aan u verzonden.

Minimale systeemvereisten: Microsoft® Windows® 7 SP1 of hoger, Internet Explorer® 8 of hoger, internetverbinding.



2018-11
* U A 1 8 1 A *

www.crm.microport.com

MicroPort CRM S.r.l.
Via Crescentino s.n.
13040 Saluggia (VC)
Italy
Tel: +39 0161 487095

MicroPort™
CRM | SORIN

8. Элемент питания интерфейсного модуля программатора SmartTouch – 1 шт. Вид сверху в индивидуальной упаковке










9. Модуль коммутации Orchestra Plus Link – 1 шт. Вид сверху




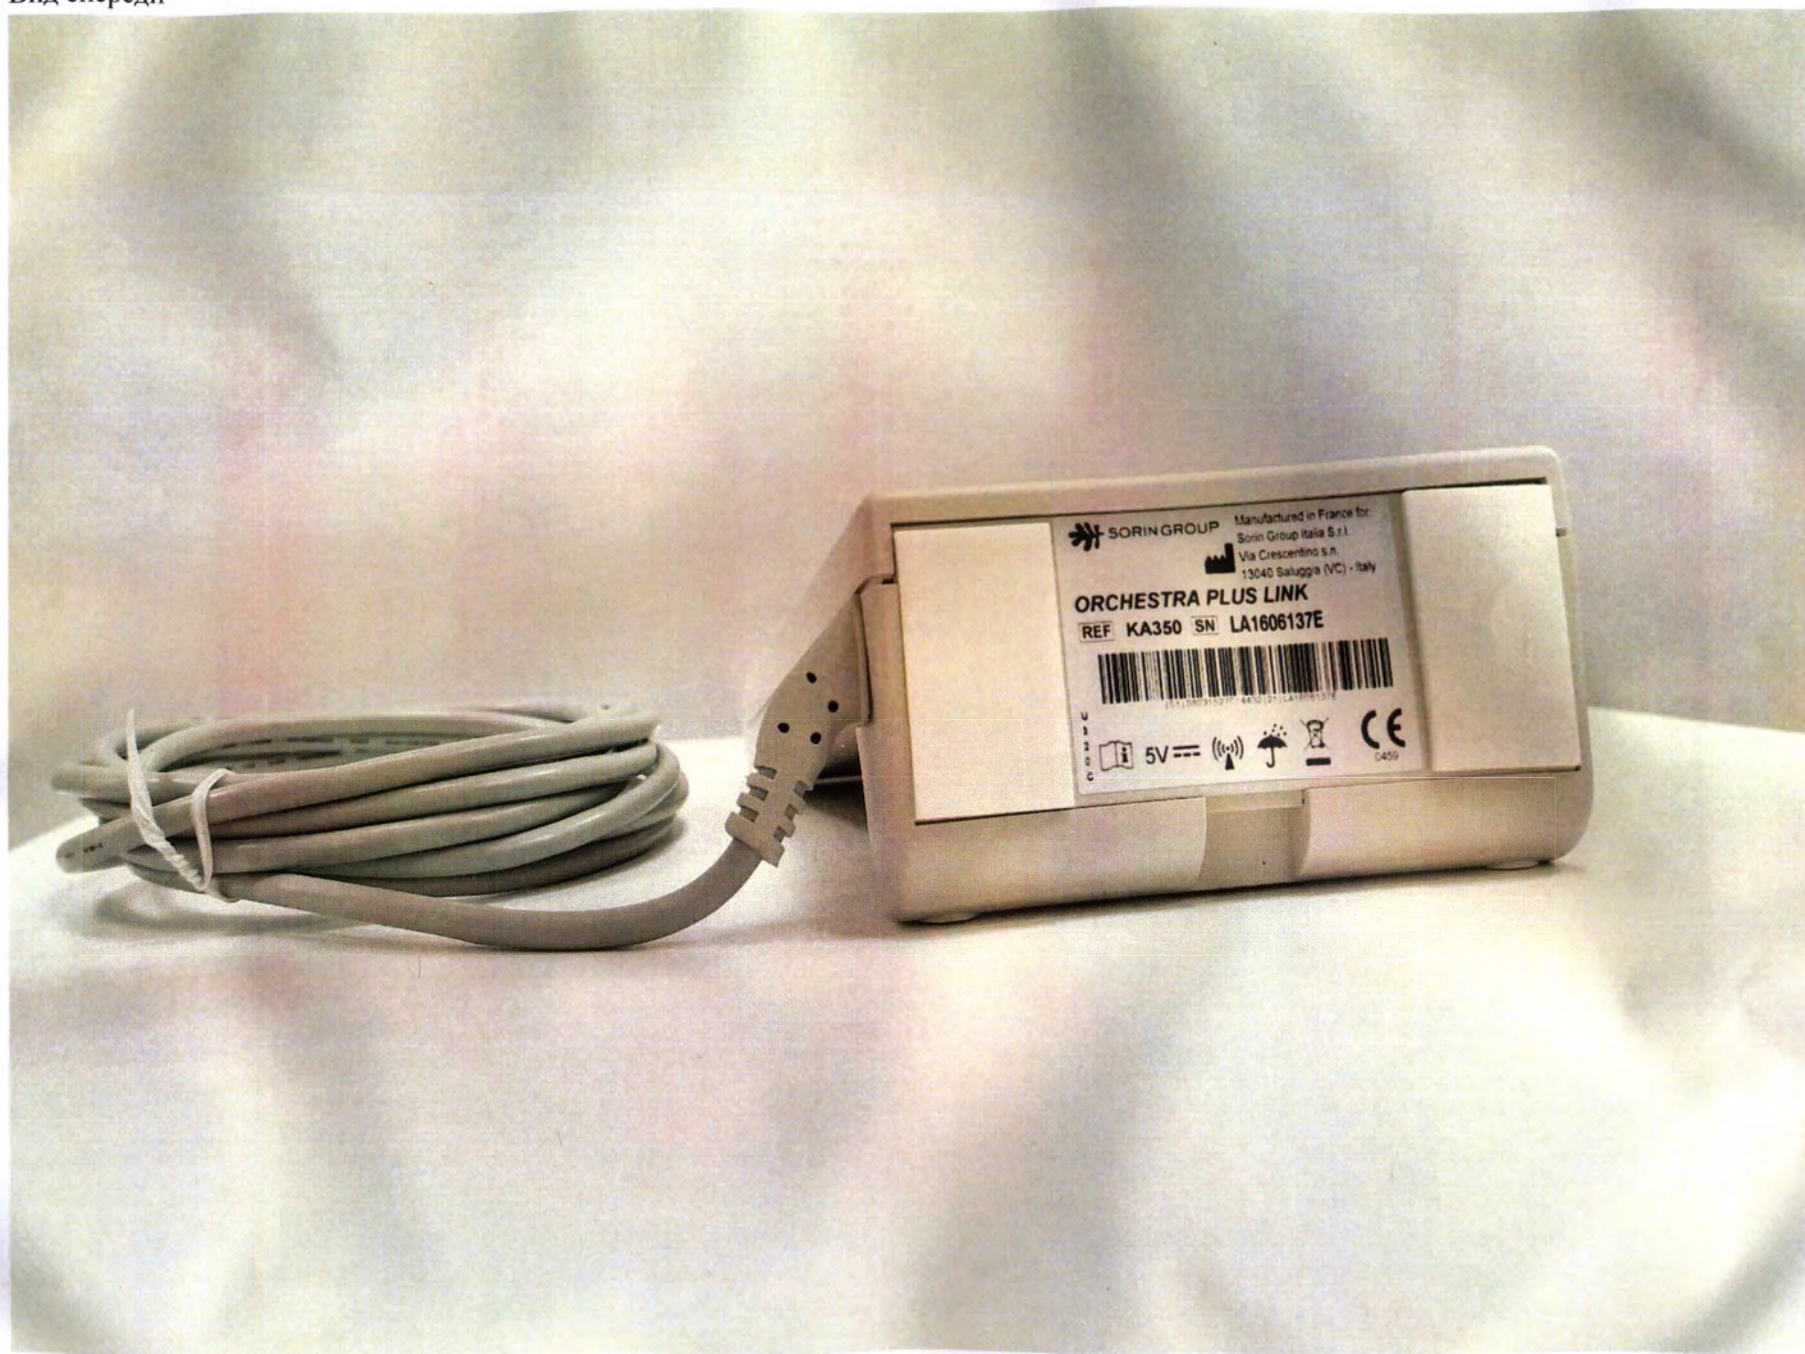







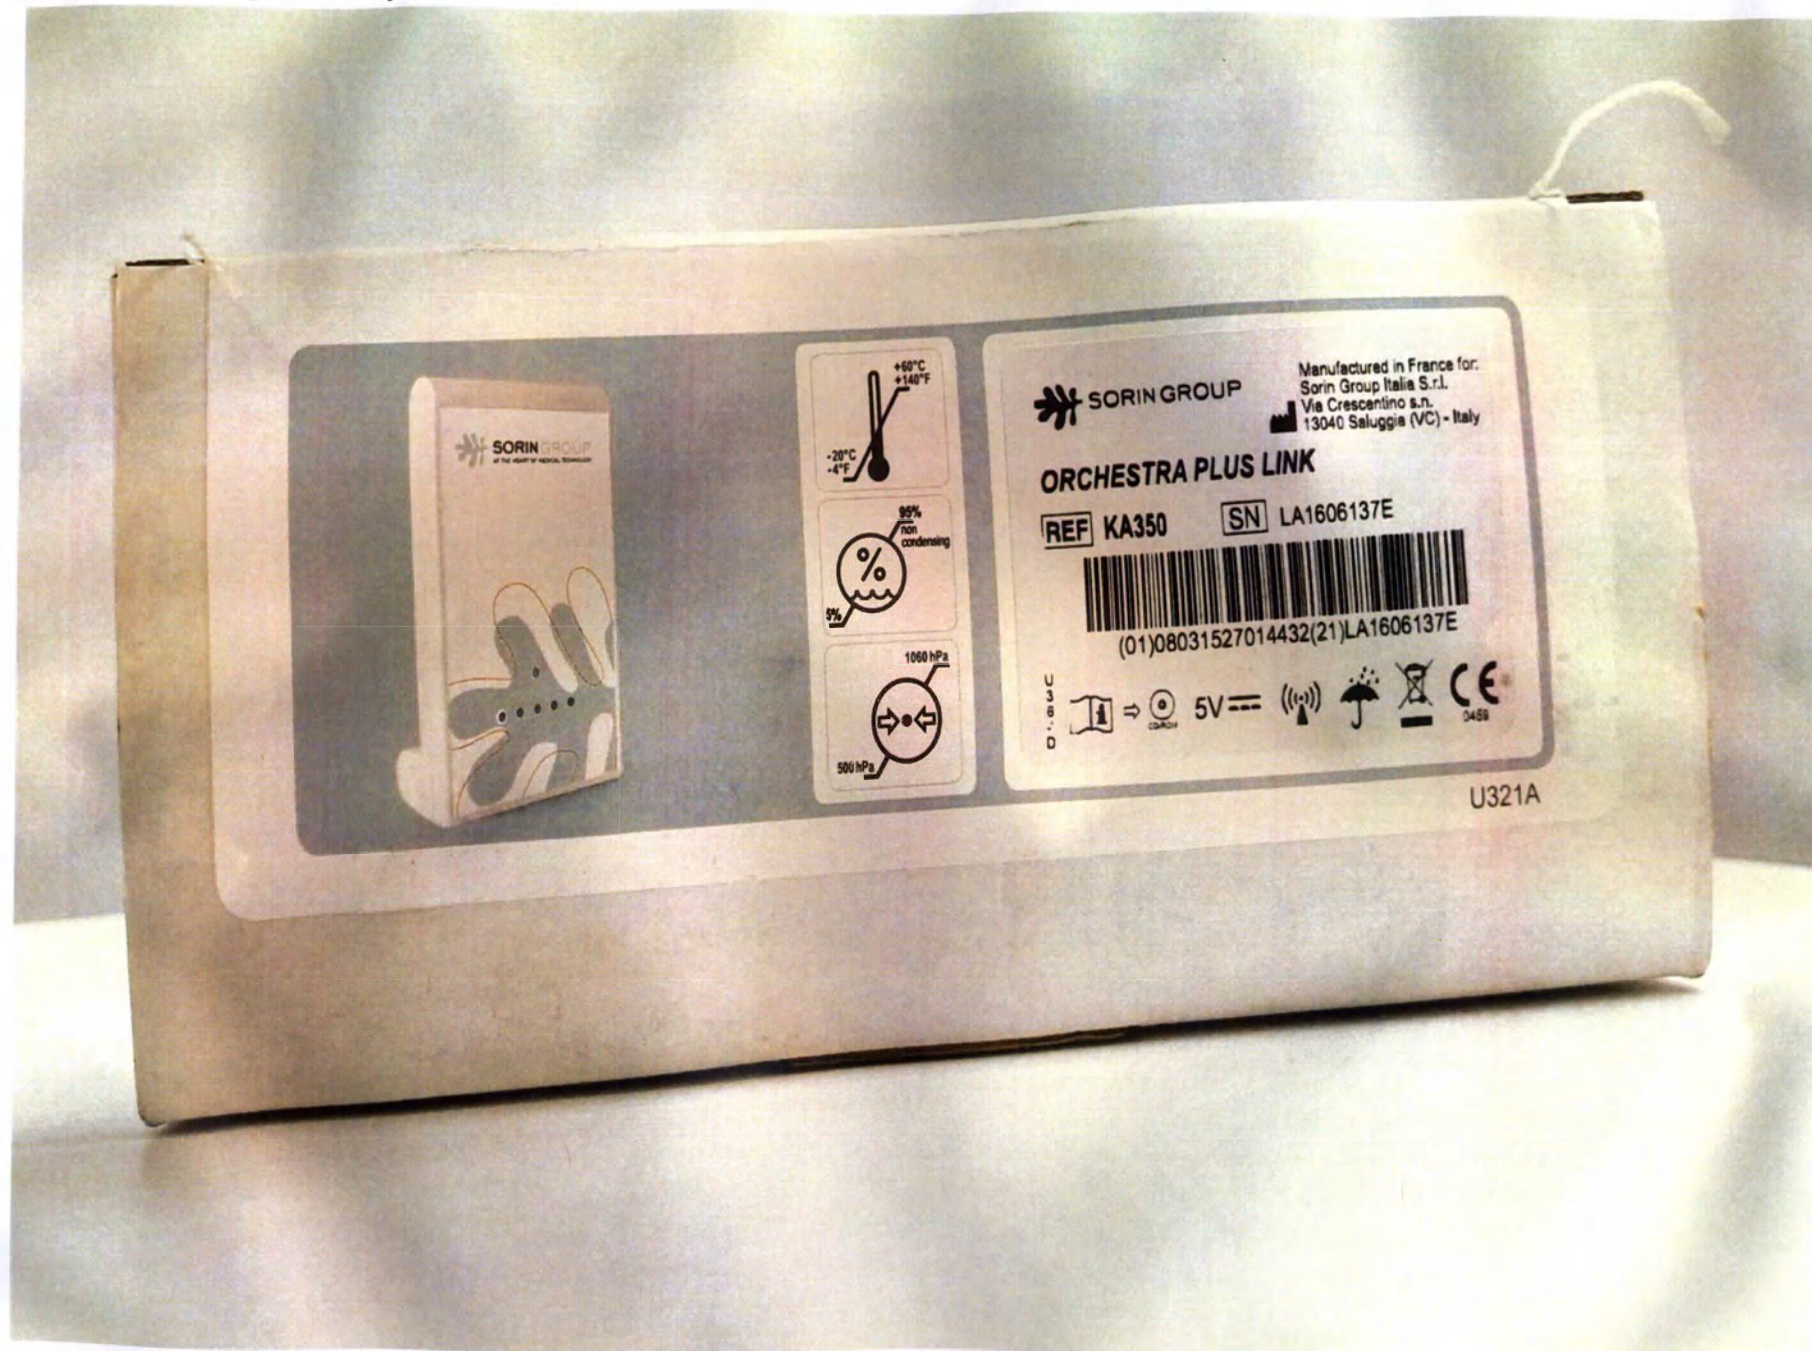


10. Термопринтер для программатора – 1 шт. Вид сверху






WOOSIM SYSTEMS
Model (모델): WSP-1450
Rated Voltage (입력): $\pm 8.4V, 0.8A$
FCC ID: QDDWSP-1450R
Serial No. (序列号): DAQDGB19K02629
Date of MFG (製造年月日): 2011.09.11
MFG (製造): WOOSIM SYSTEMS Inc.
* 제조업자는 품질을 보증합니다 * MADE IN KOREA (한국제조)



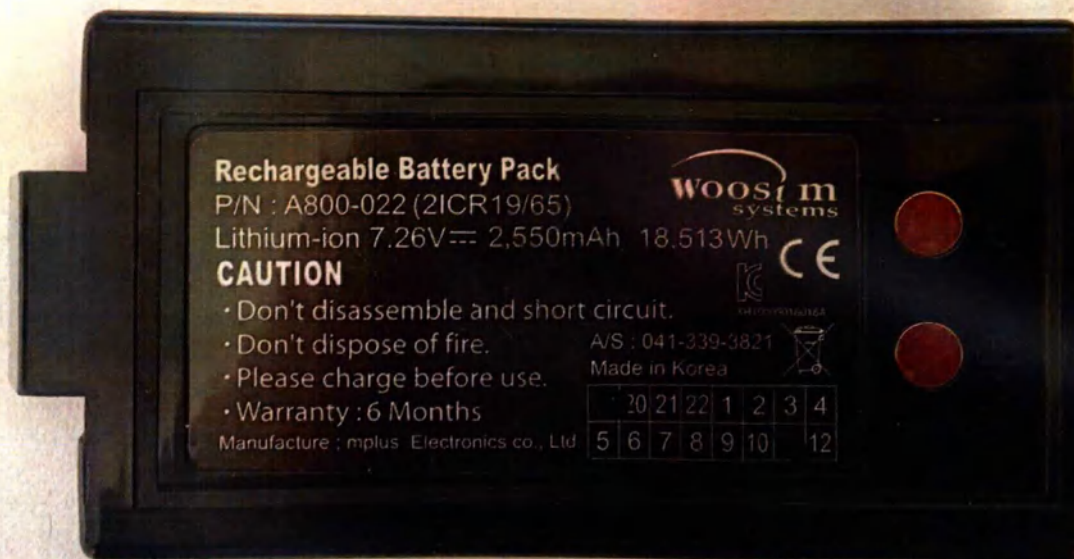


Термобумага для принтера – 1 шт.

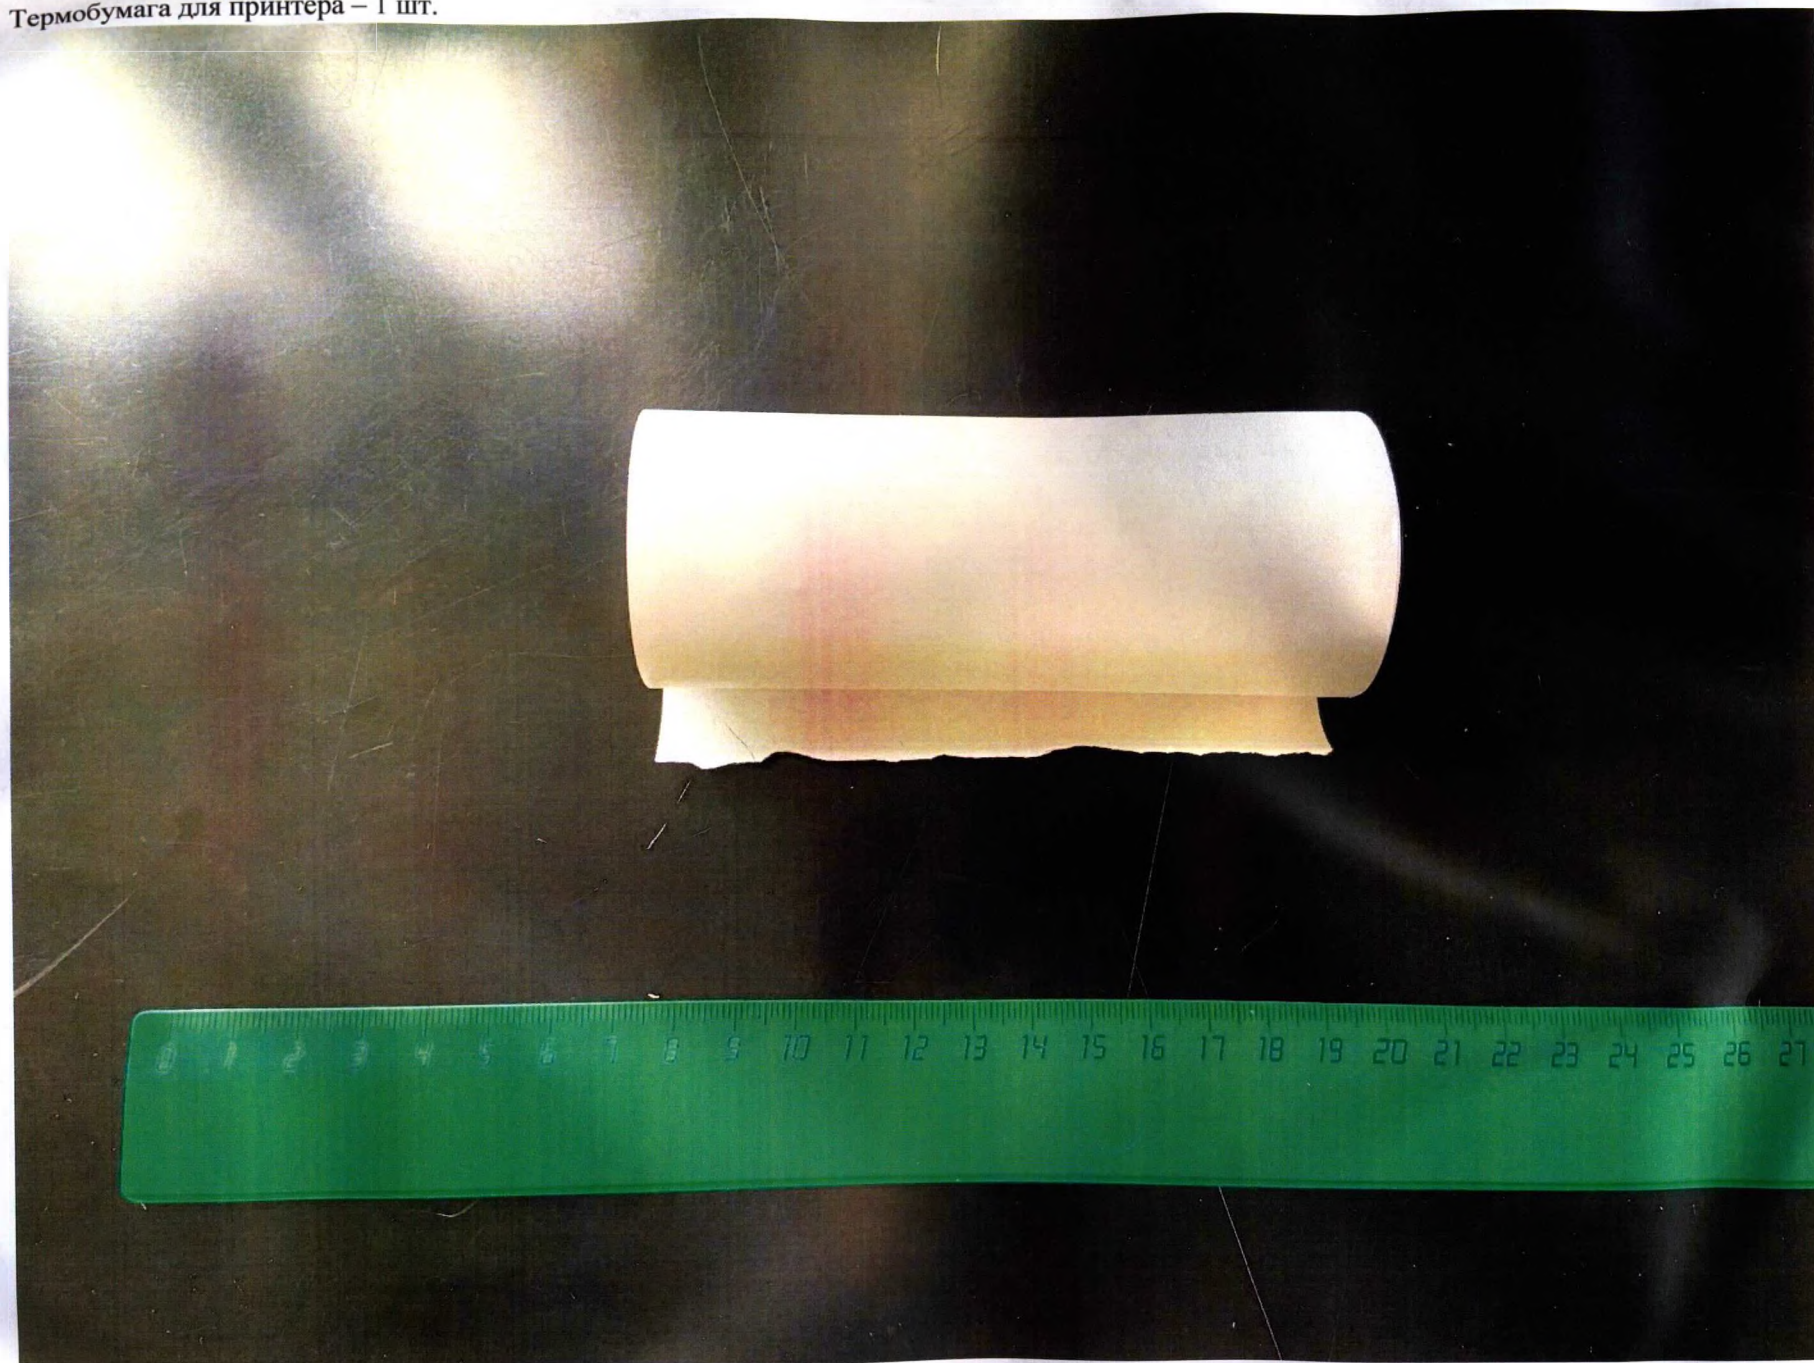






Кабель питания – 1 шт.

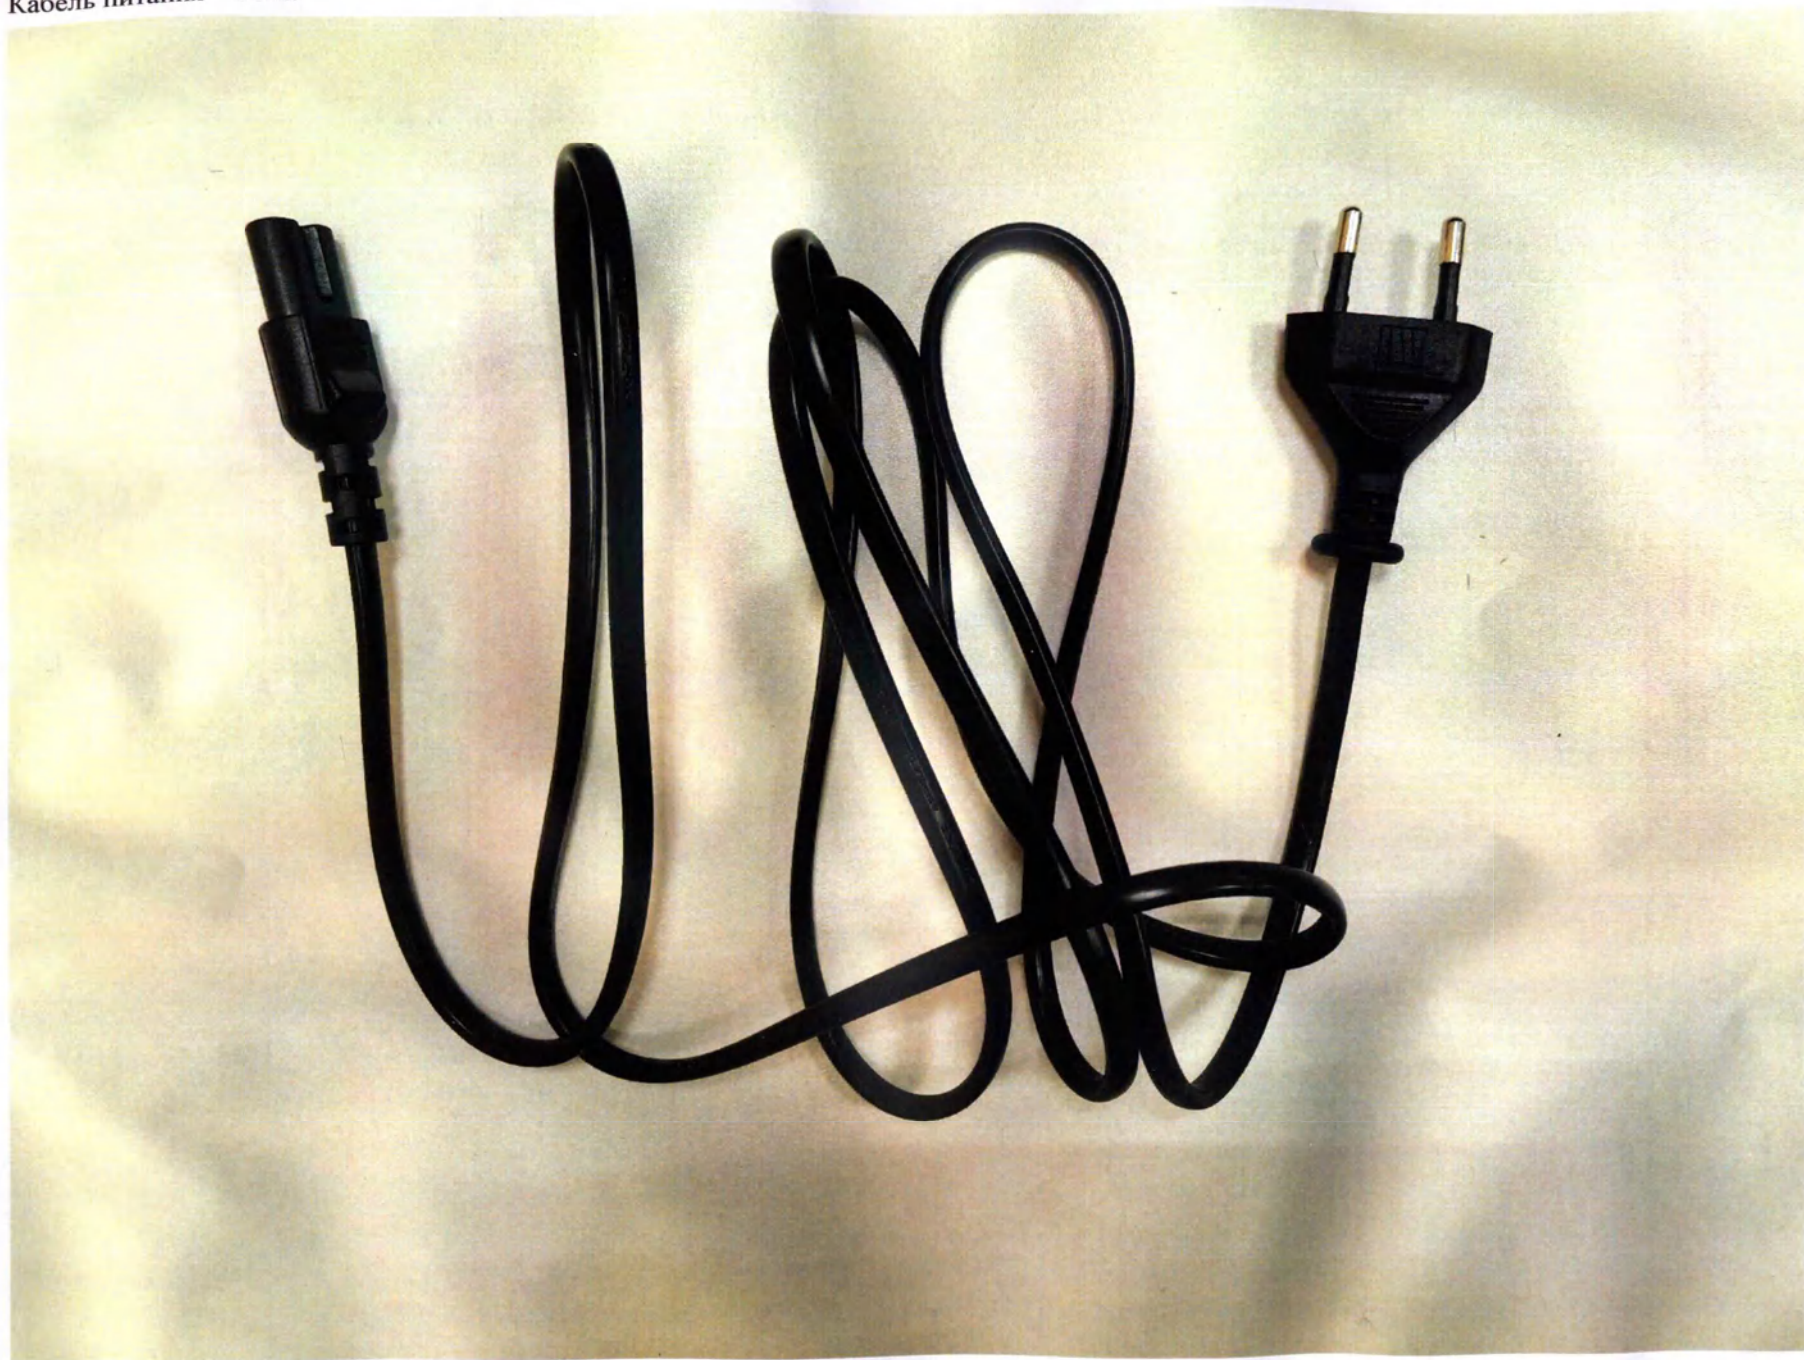




Вид сверху общей коробки

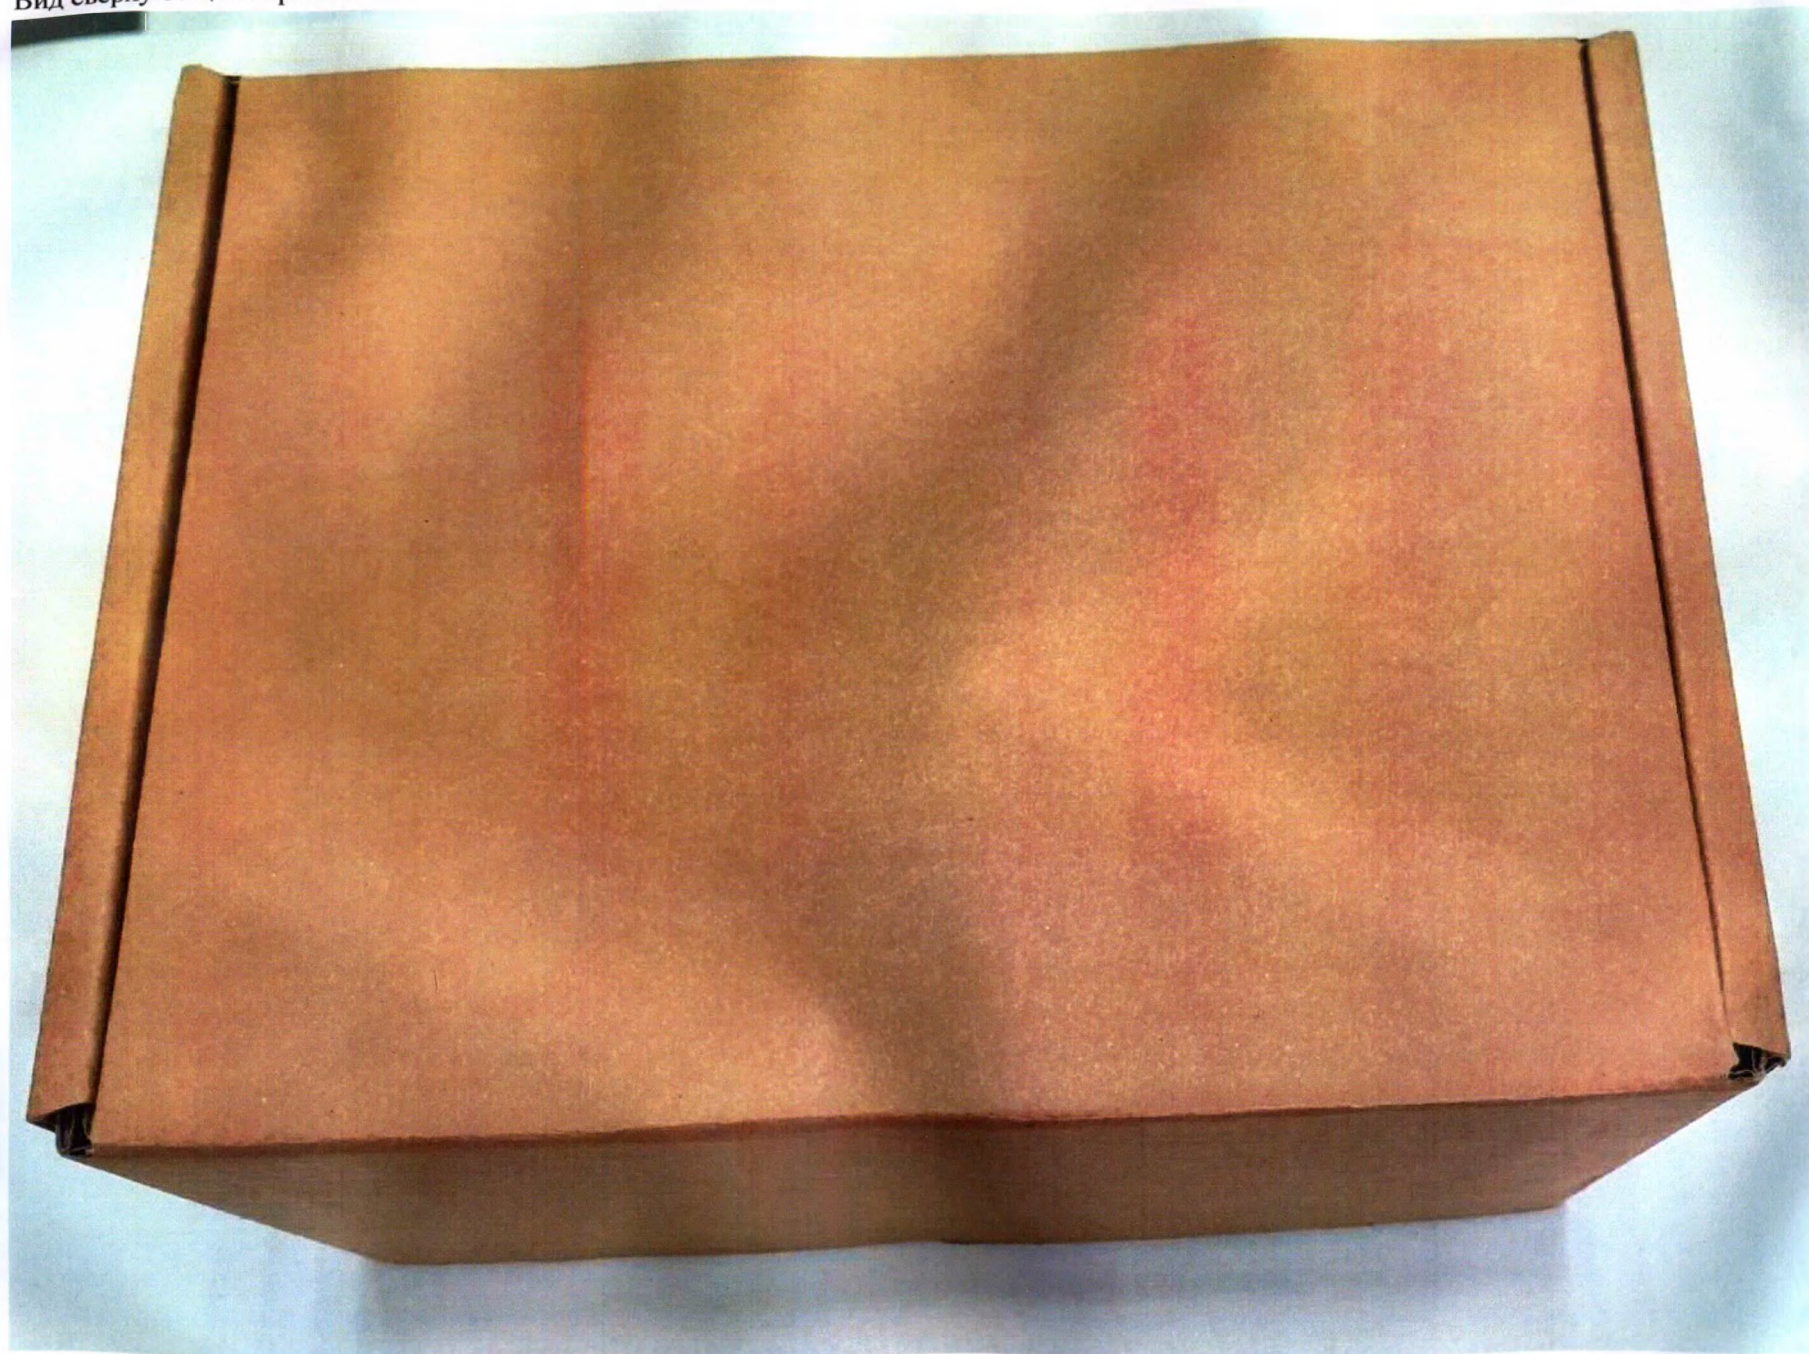




Отдельная коробка адаптера, кабеля питания и кабеля связи в общей коробке

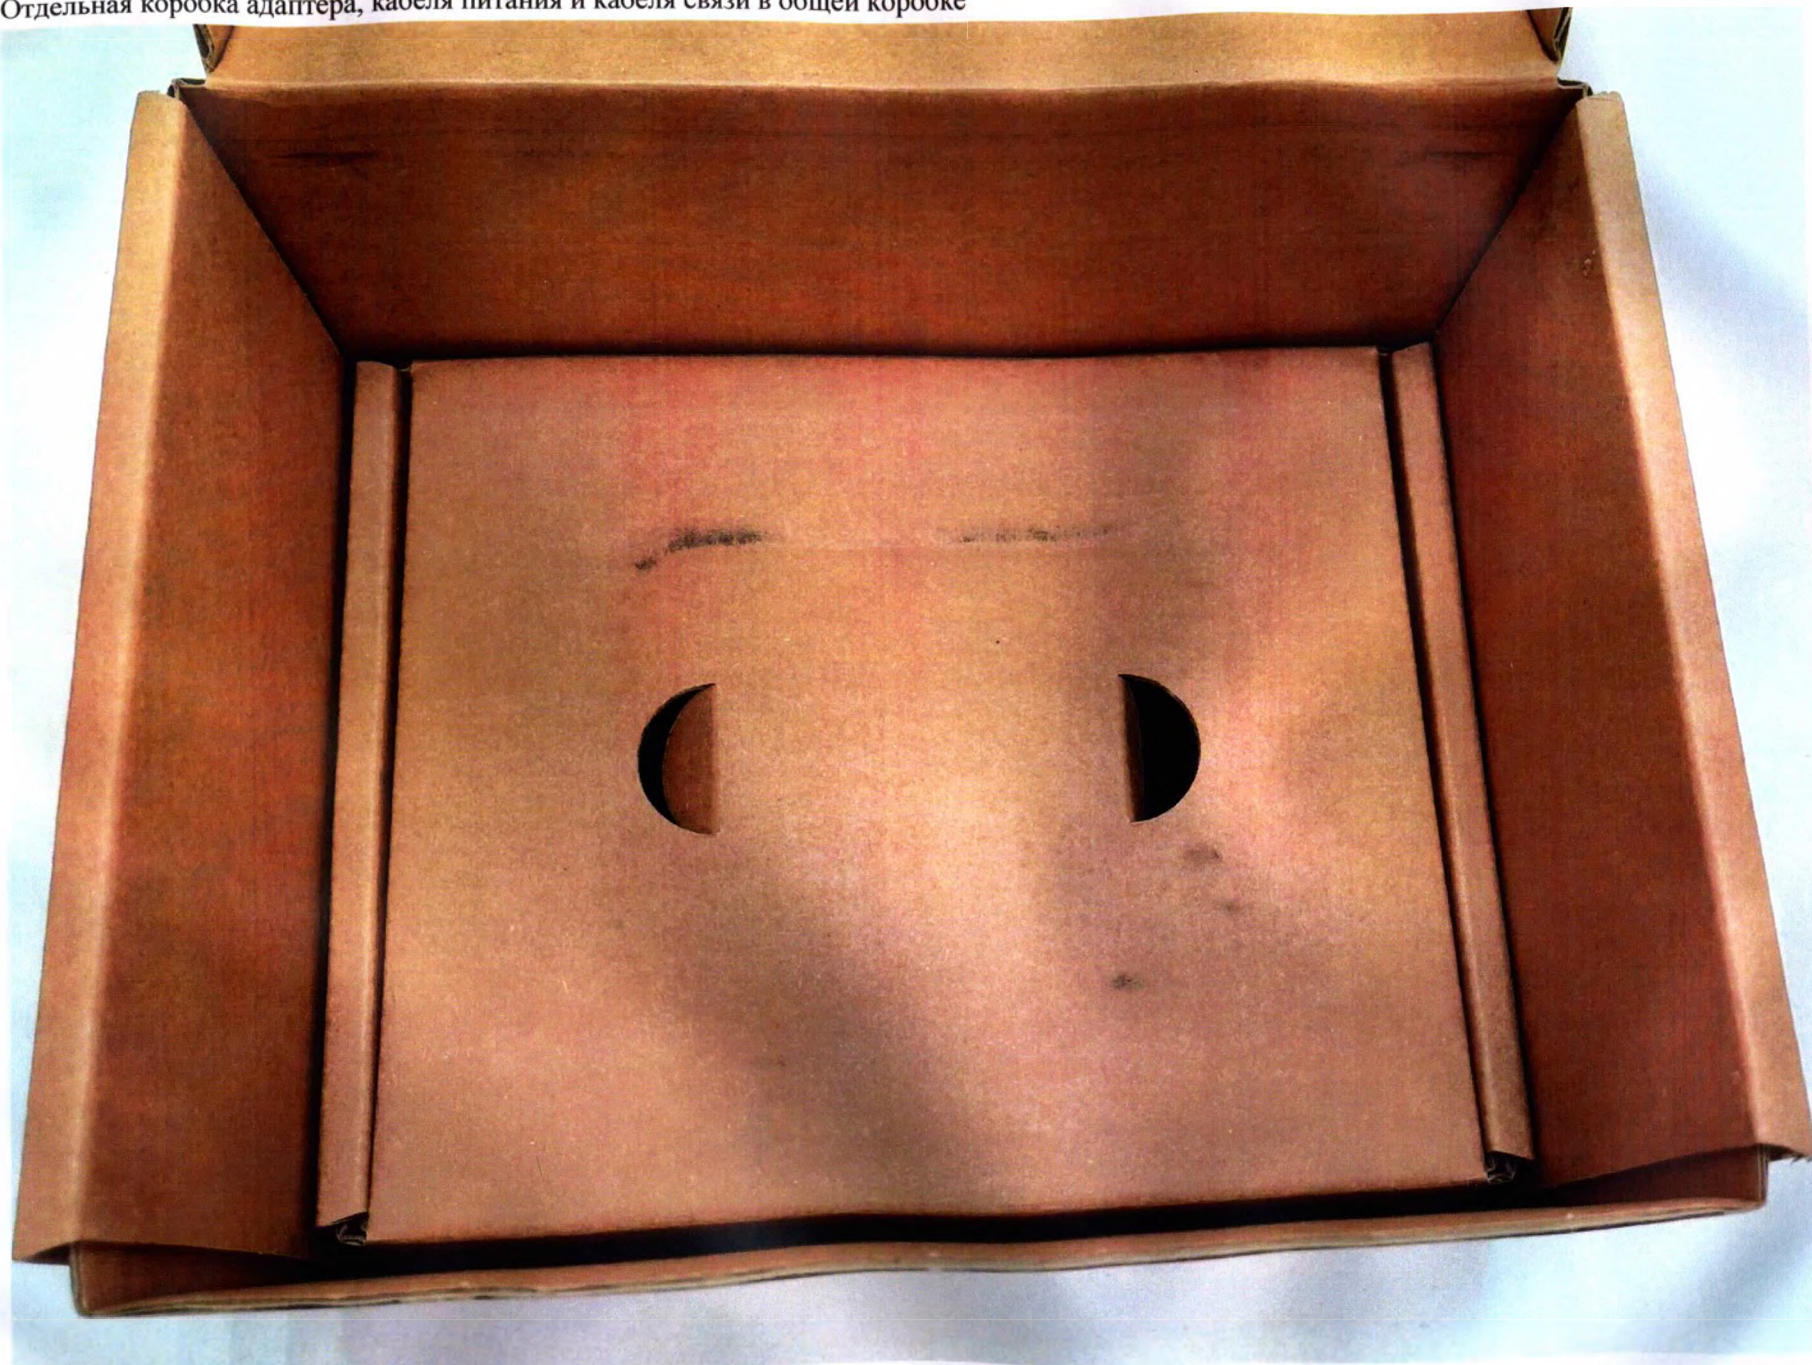

Отдельная коробка адаптера, кабеля питания и кабеля связи (вид сверху)

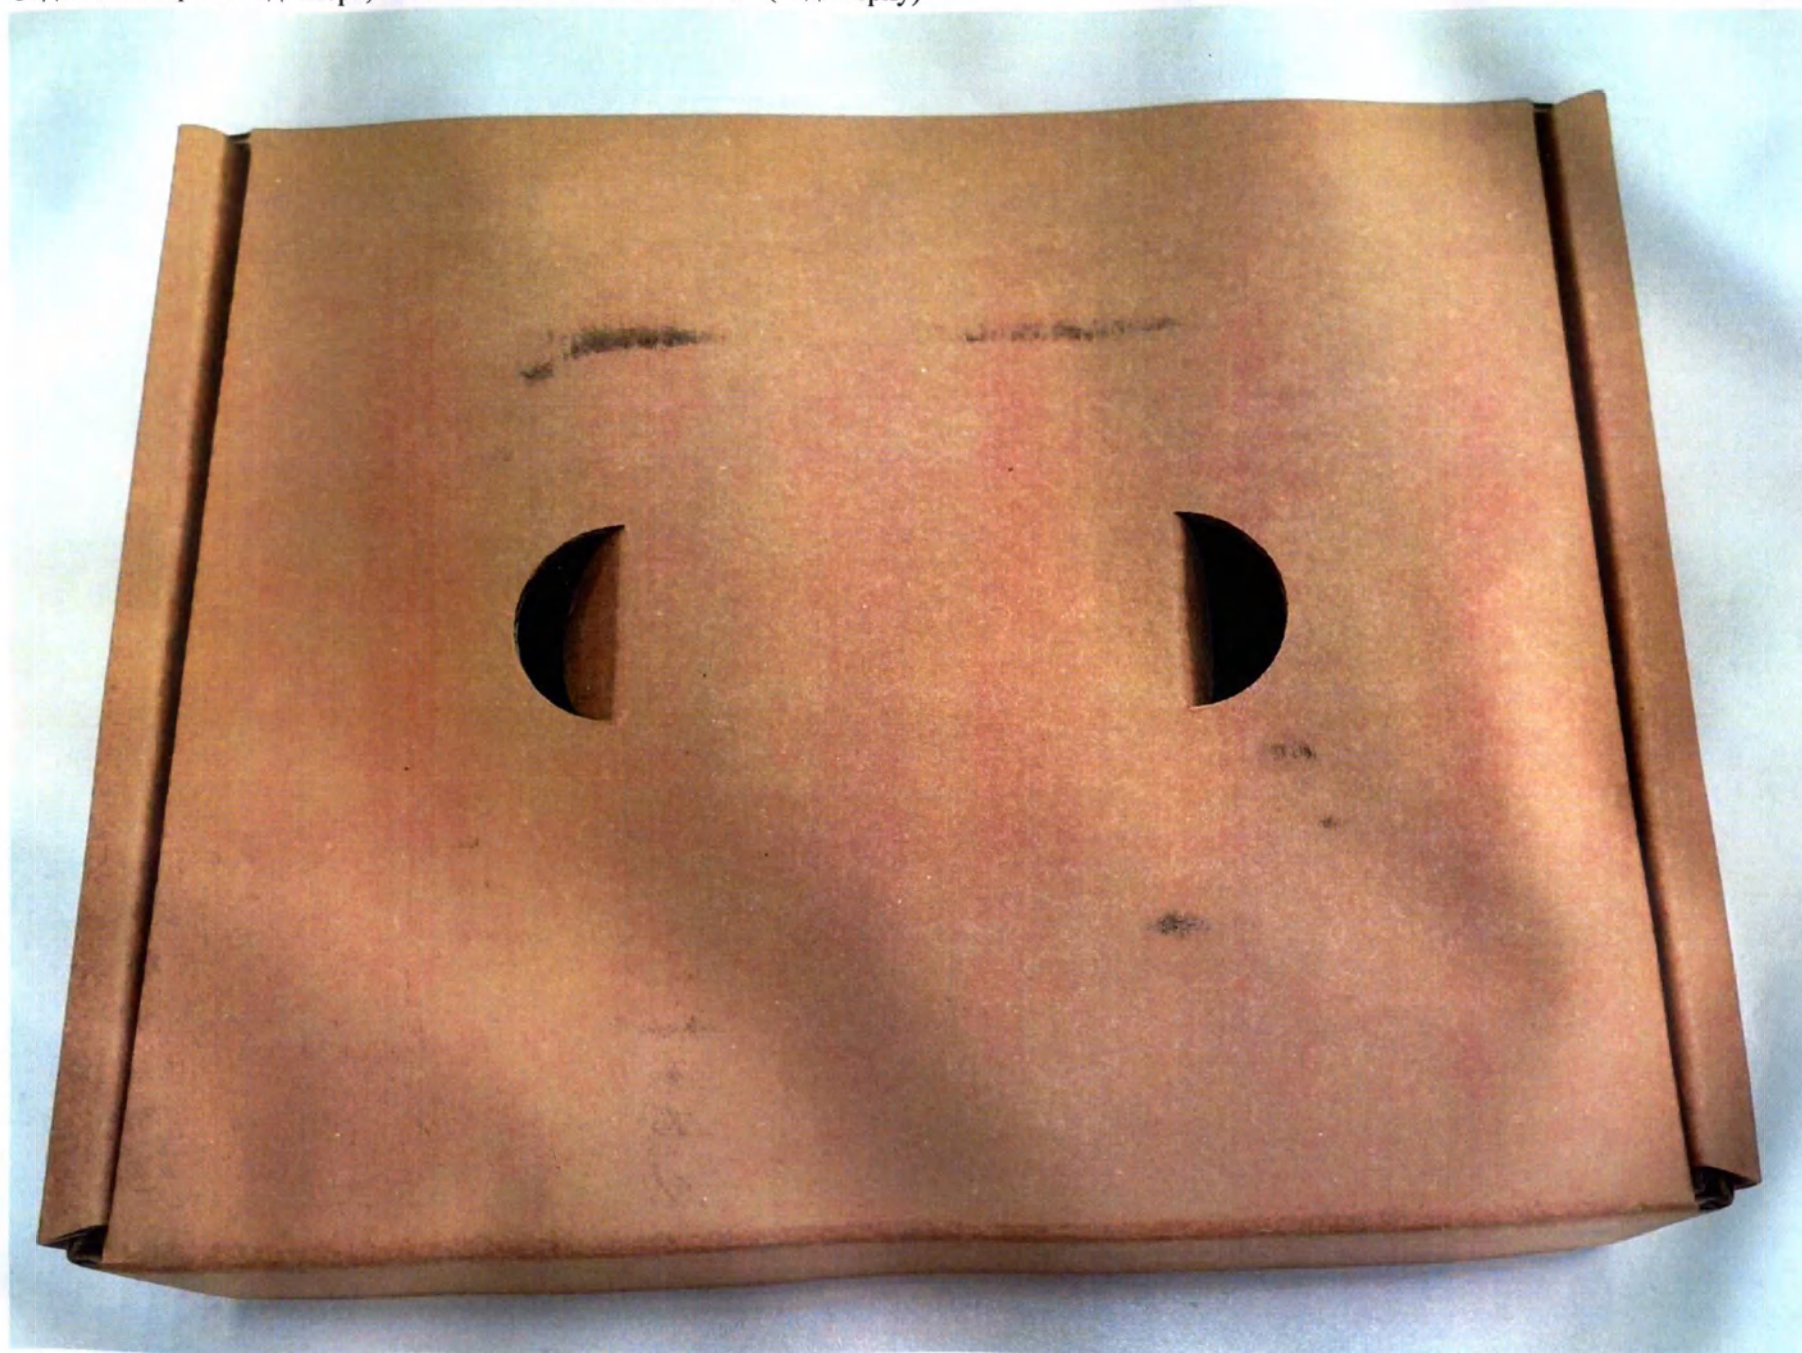


11. Модуль ЭКГ Smart ECG – 1 шт. Модуль ЭКГ Smart ECG – вид сверху (вместе с индивидуальной упаковкой)



ЭКГ кабель. Вид сверху (вместе с индивидуальной упаковкой)



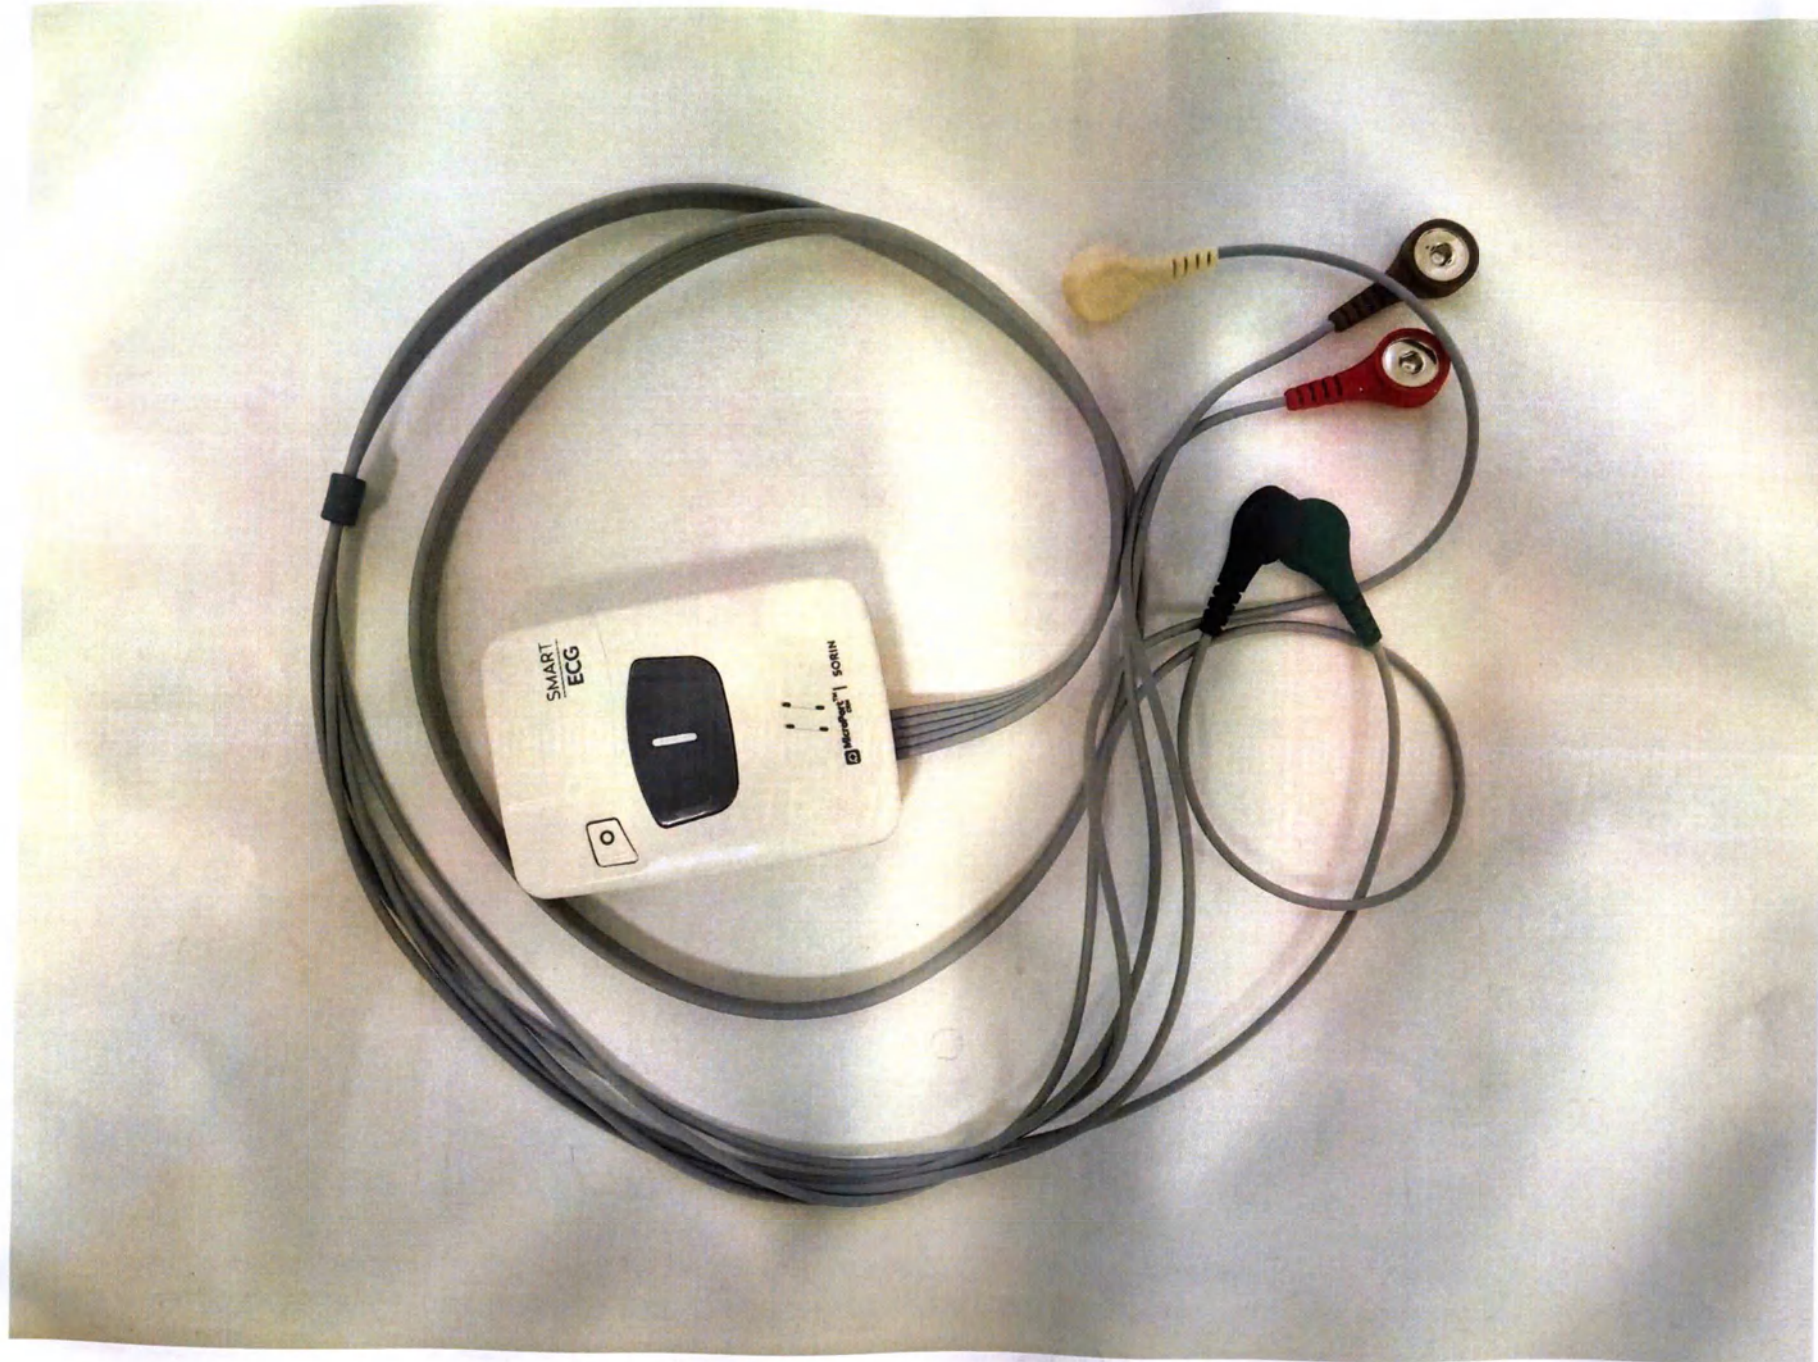

Батарея – 1 шт.








RG 01,
NECK & BELT HOLSTER
SPIDERSAS - SPIDERFLASH


UDI: ✓




(01)08031527016344(10)201910

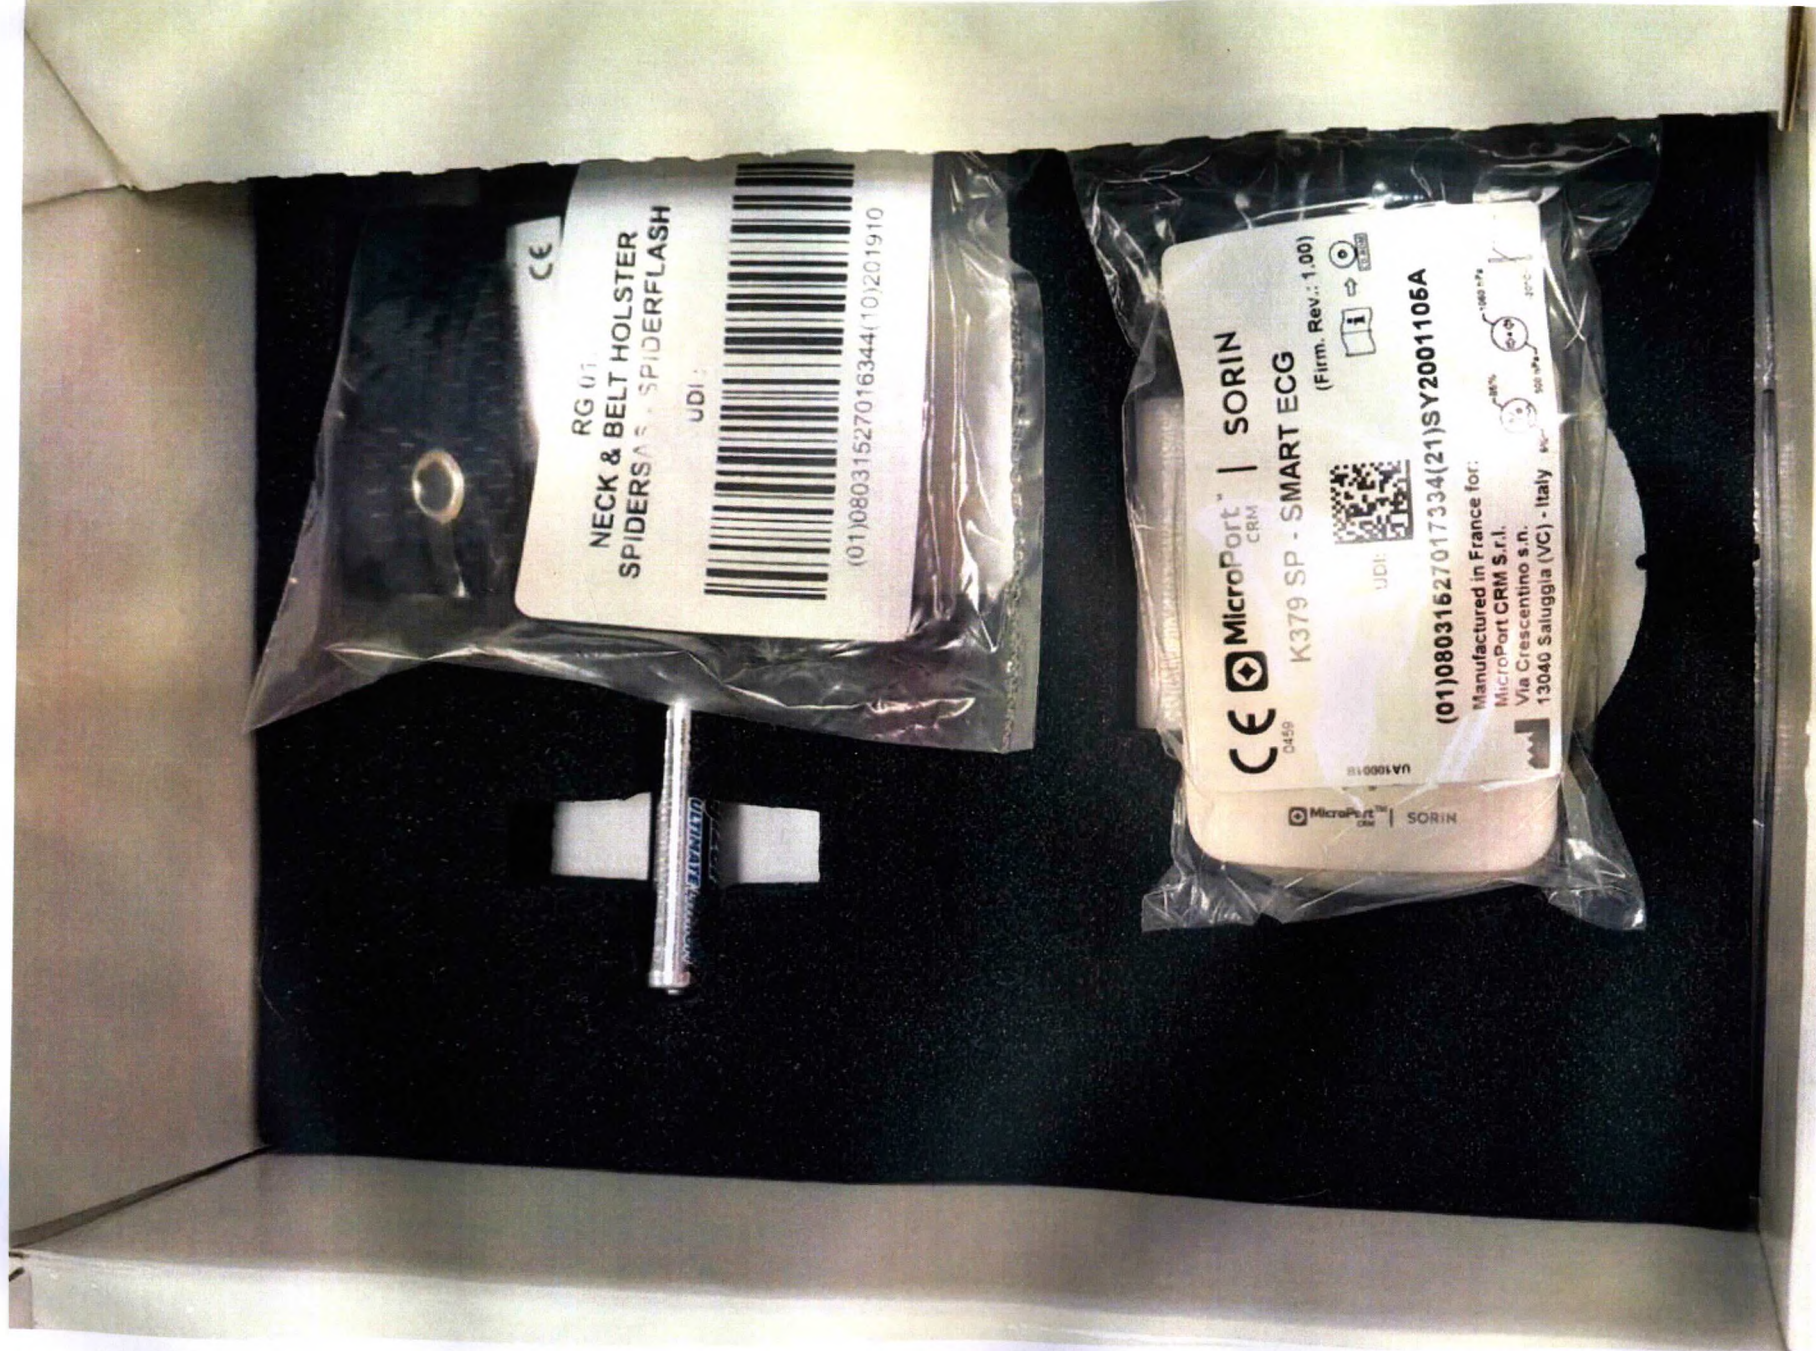



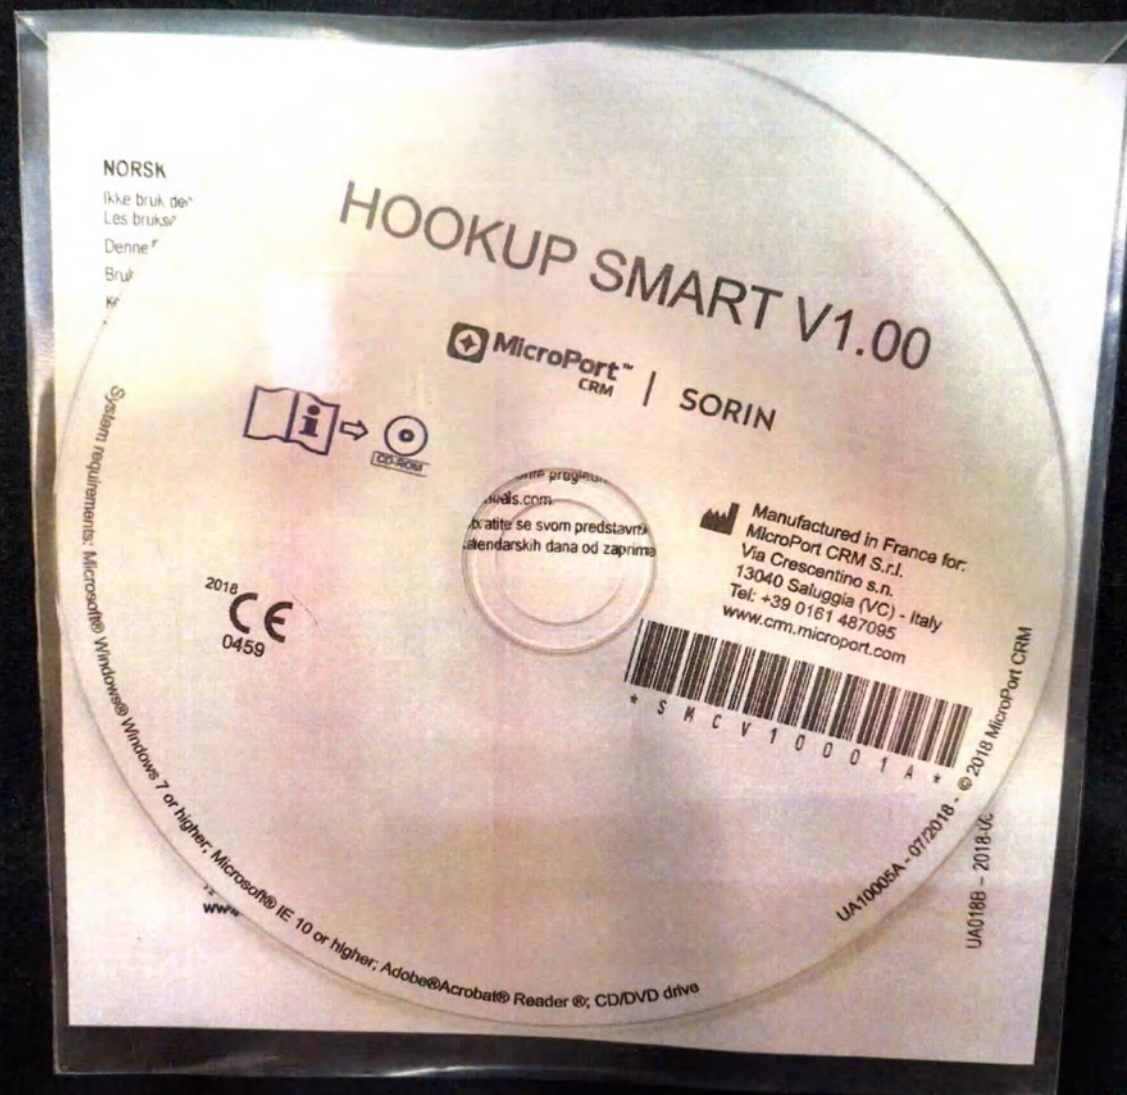

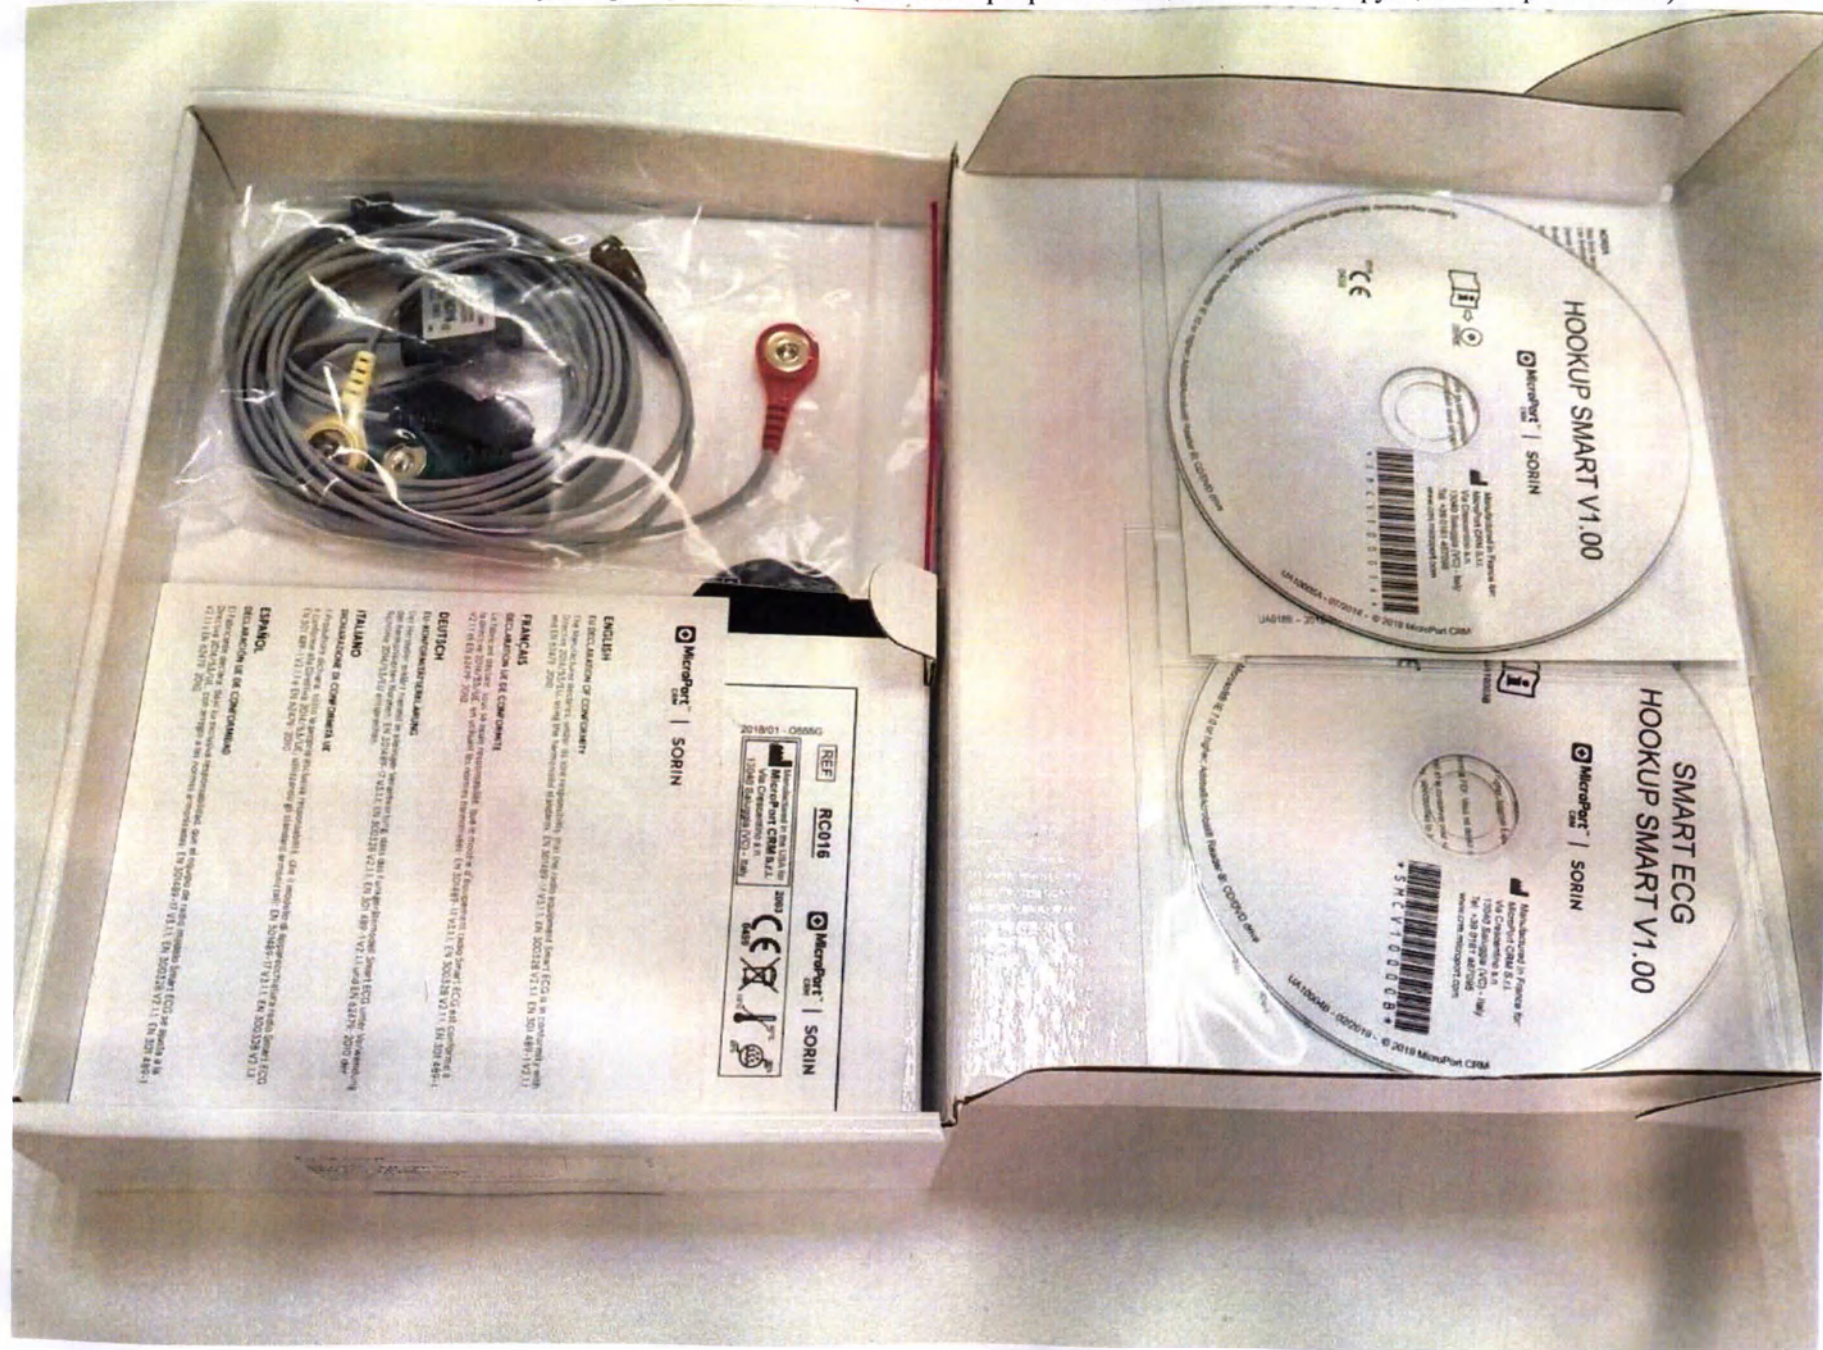



 **MicroPort™**
CRM | **SORIN**

K379 - SMART ECG

UA10014C


UDI:



(01)08031527017334(21)SY2001105A

Manufactured in France for:
MicroPort CRM S.r.l.

Via Crescentino s.n.
13040 Saluggia (VC) - Italy



For US market

Manufactured in France

Distributed by

MicroPort CRM USA Inc,

5640 Airline Road

Arlington, TN.38002 - USA


Telephone: 877-663-7674

Facsimile 763-383-4713 or 877-443-3134

www.crm.microport.com

CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE
ORDER OF A PHYSICIAN (OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER)

O
0
0
3
F

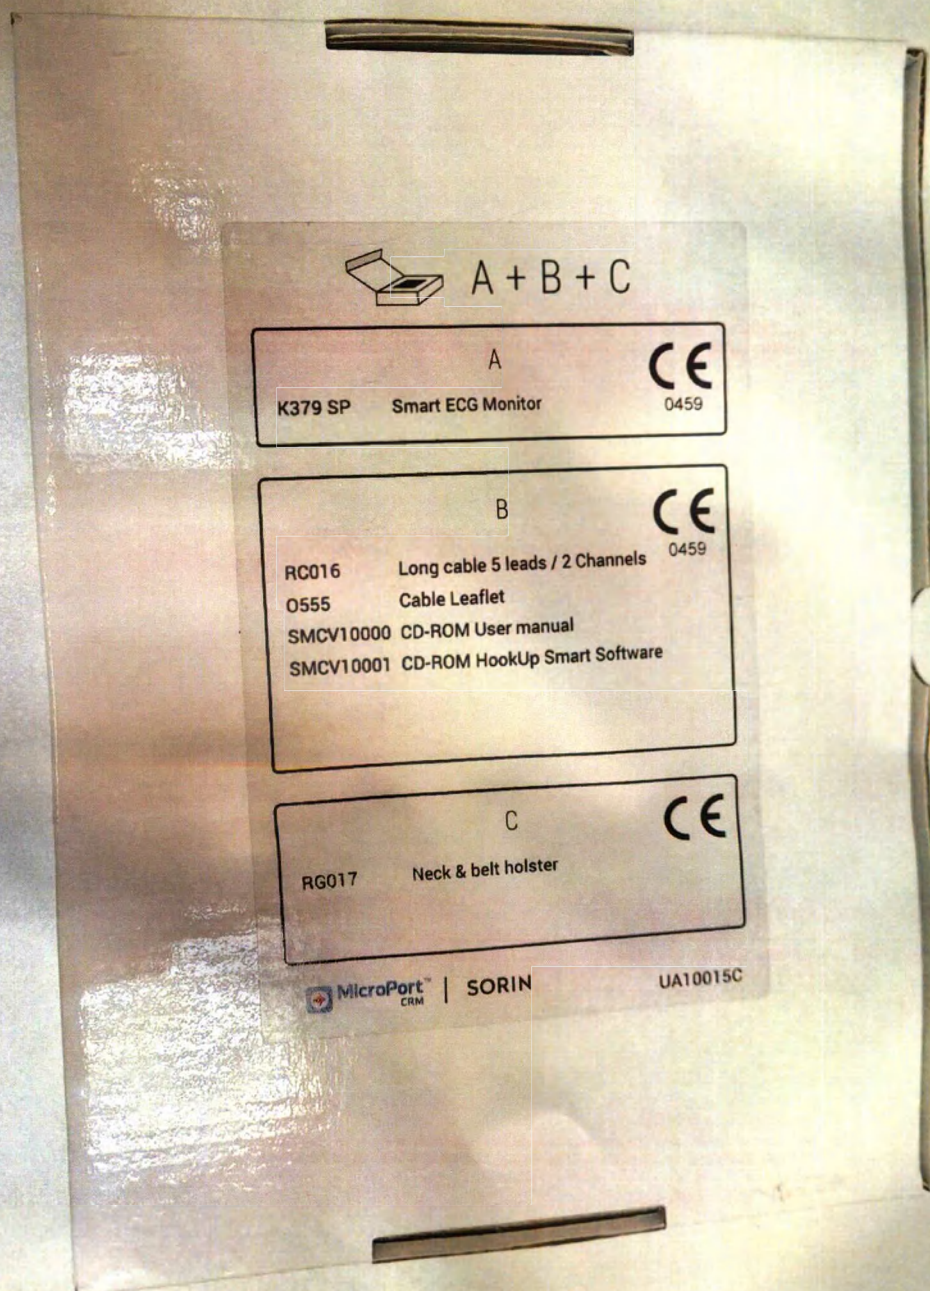

A + B + C

A



K379 SP Smart ECG Monitor

0459

B



RC016 Long cable 5 leads / 2 Channels
O555 Cable Leaflet
SMCV10000 CD-ROM User manual
SMCV10001 CD-ROM HookUp Smart Software

0459

C



RG017 Neck & belt holster




MicroPort
CRM

SORIN

UA10015C

12. Ручка-стилус интерфейсного модуля – 3 шт.

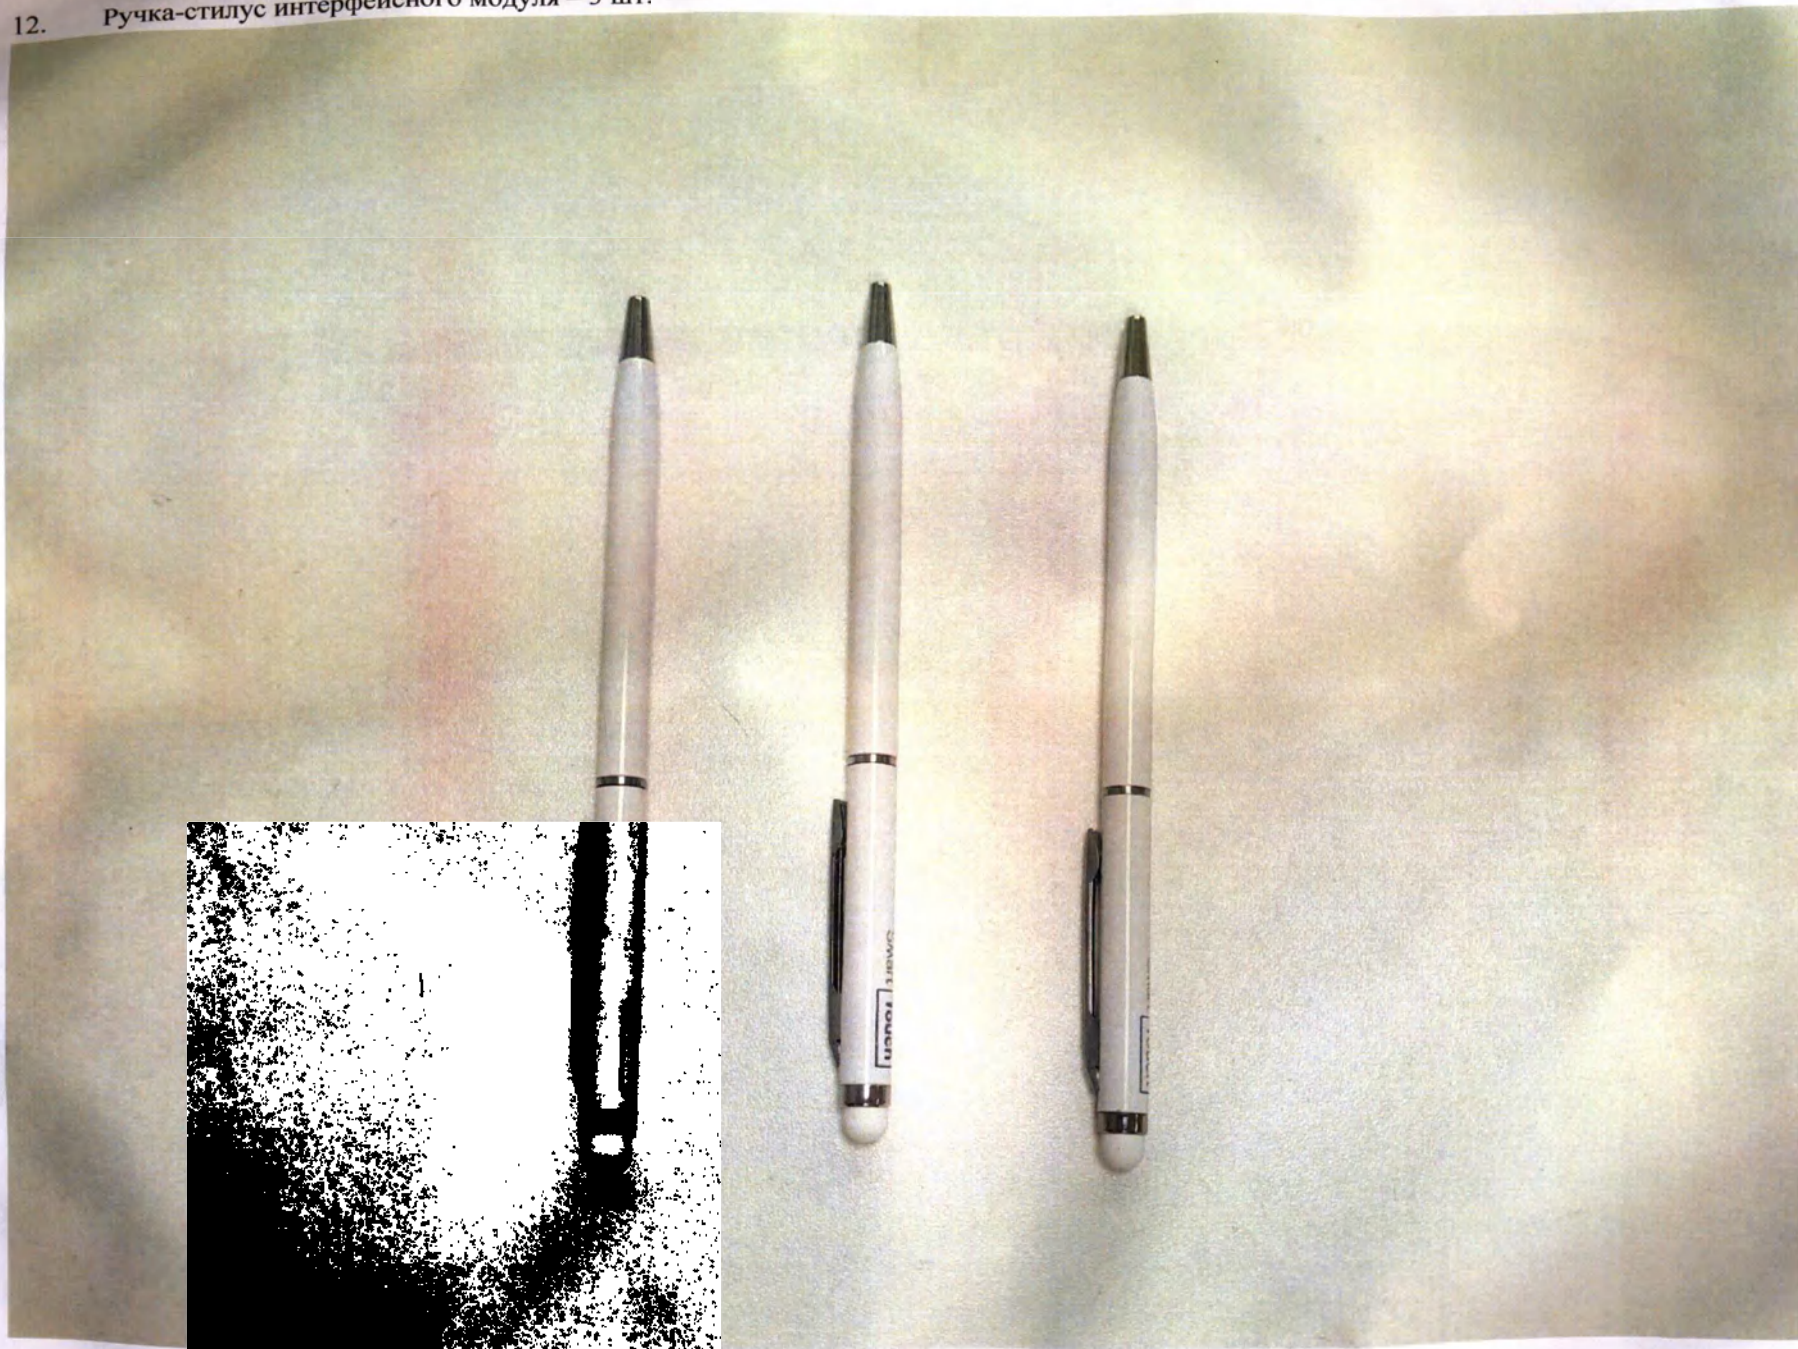

13. Держатель ручки-стилуса интерфейсного модуля – 1 шт.




14. Кофр транспортировочный – 1 шт. Вид спереди







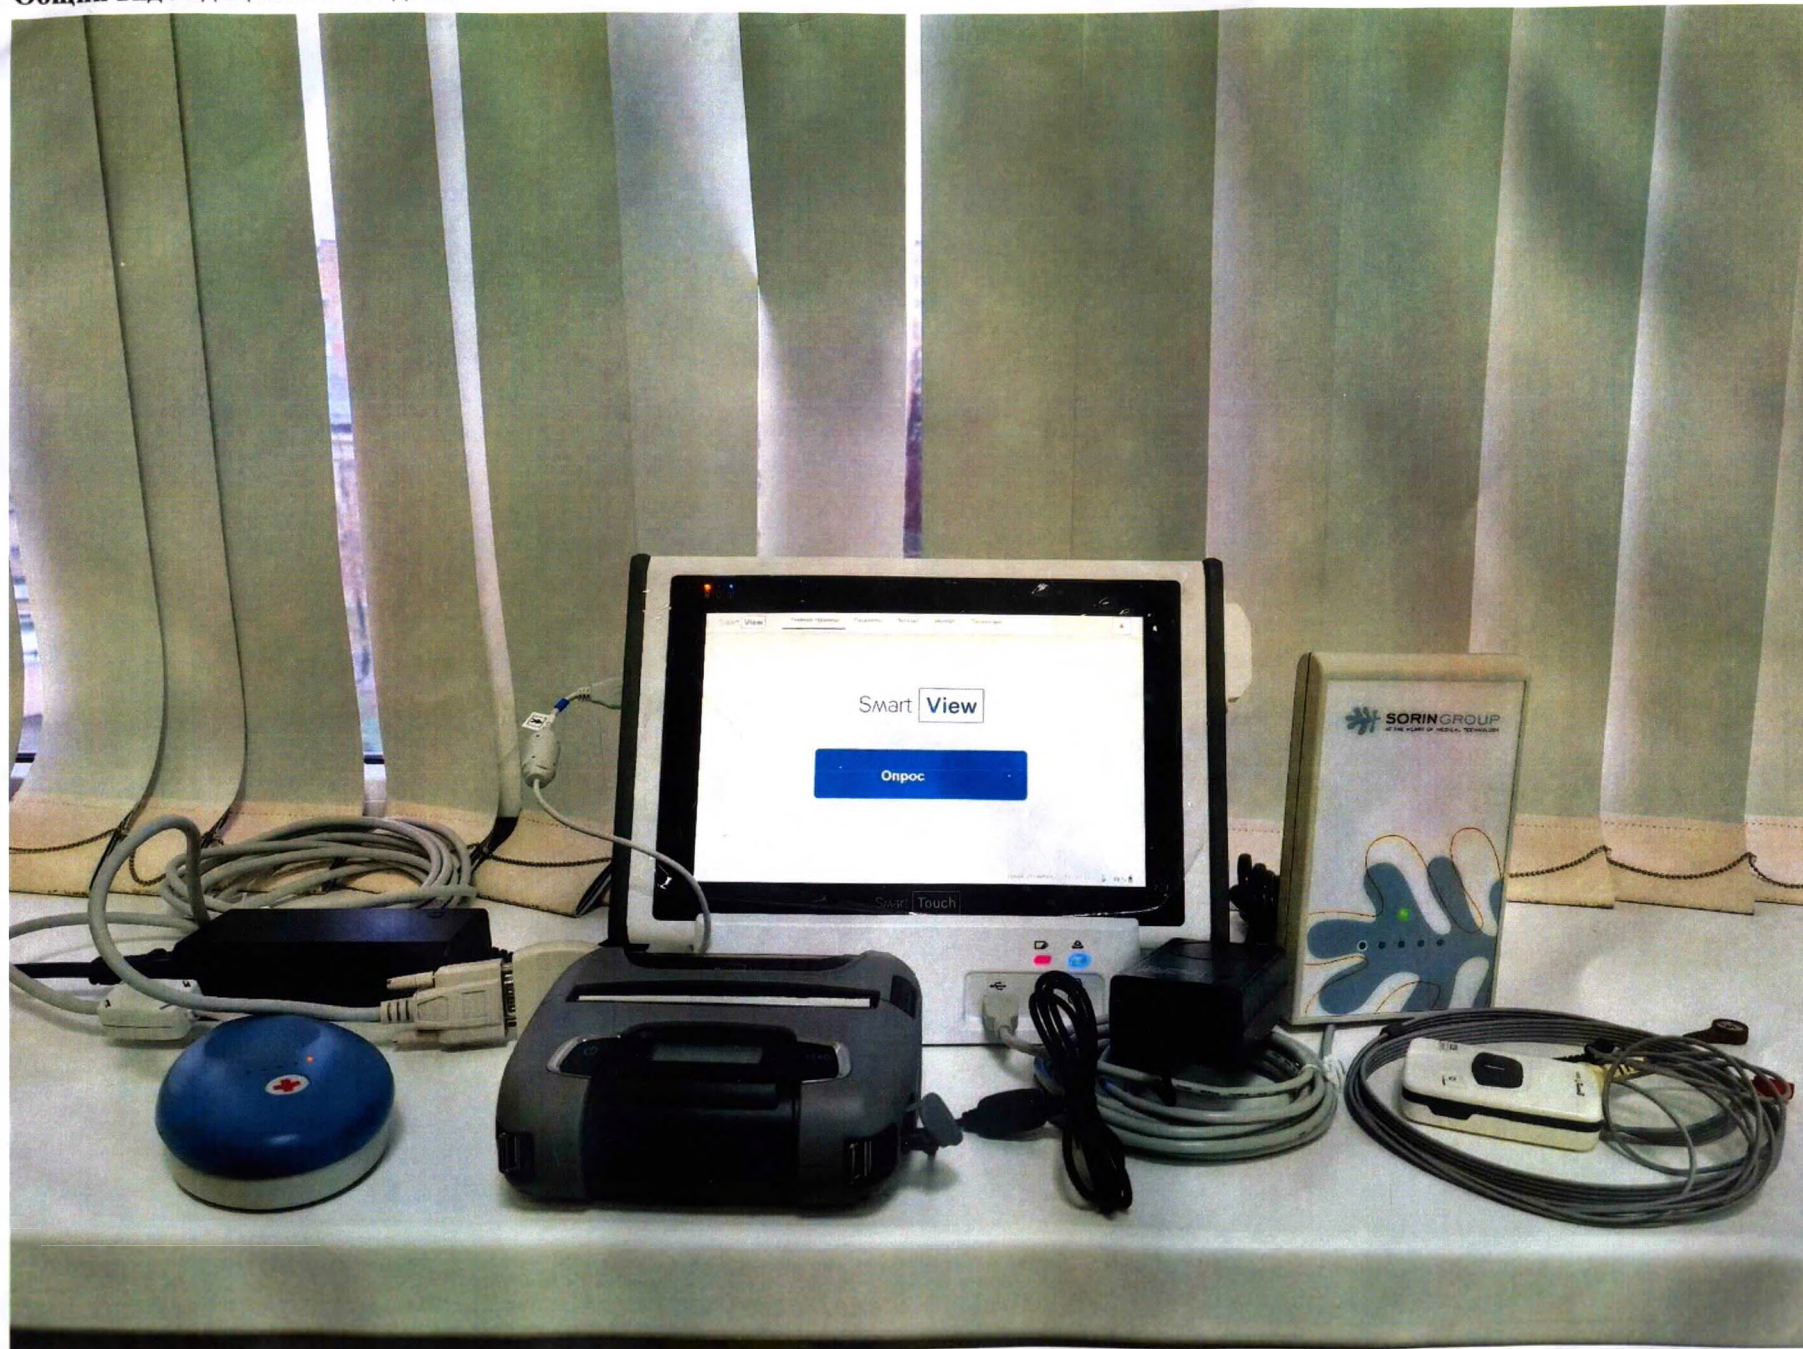

Транспортная упаковка программатора с принадлежностями

Способ упаковки кофра транспортировочного с программатором и принадлежностей в транспортировочную упаковку









Handwritten signature

Yunus B. A.

65

