



121357, Москва г, Верейская ул., дом 17, Верейская Плаза-2, офис 216, ИНН/КПП 7703819090/ 773101001,
т. +7 (499) 682-67-87

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭДАН МЕДИКАЛ»

Цзян Шуай

«23» декабря 2021 г.



Фотографические изображения

медицинского изделия


Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями
Edan Instruments, Inc. («Эдан Инструментс, Инк.»), Китай



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой AcclariX LX3 (вид сзади)

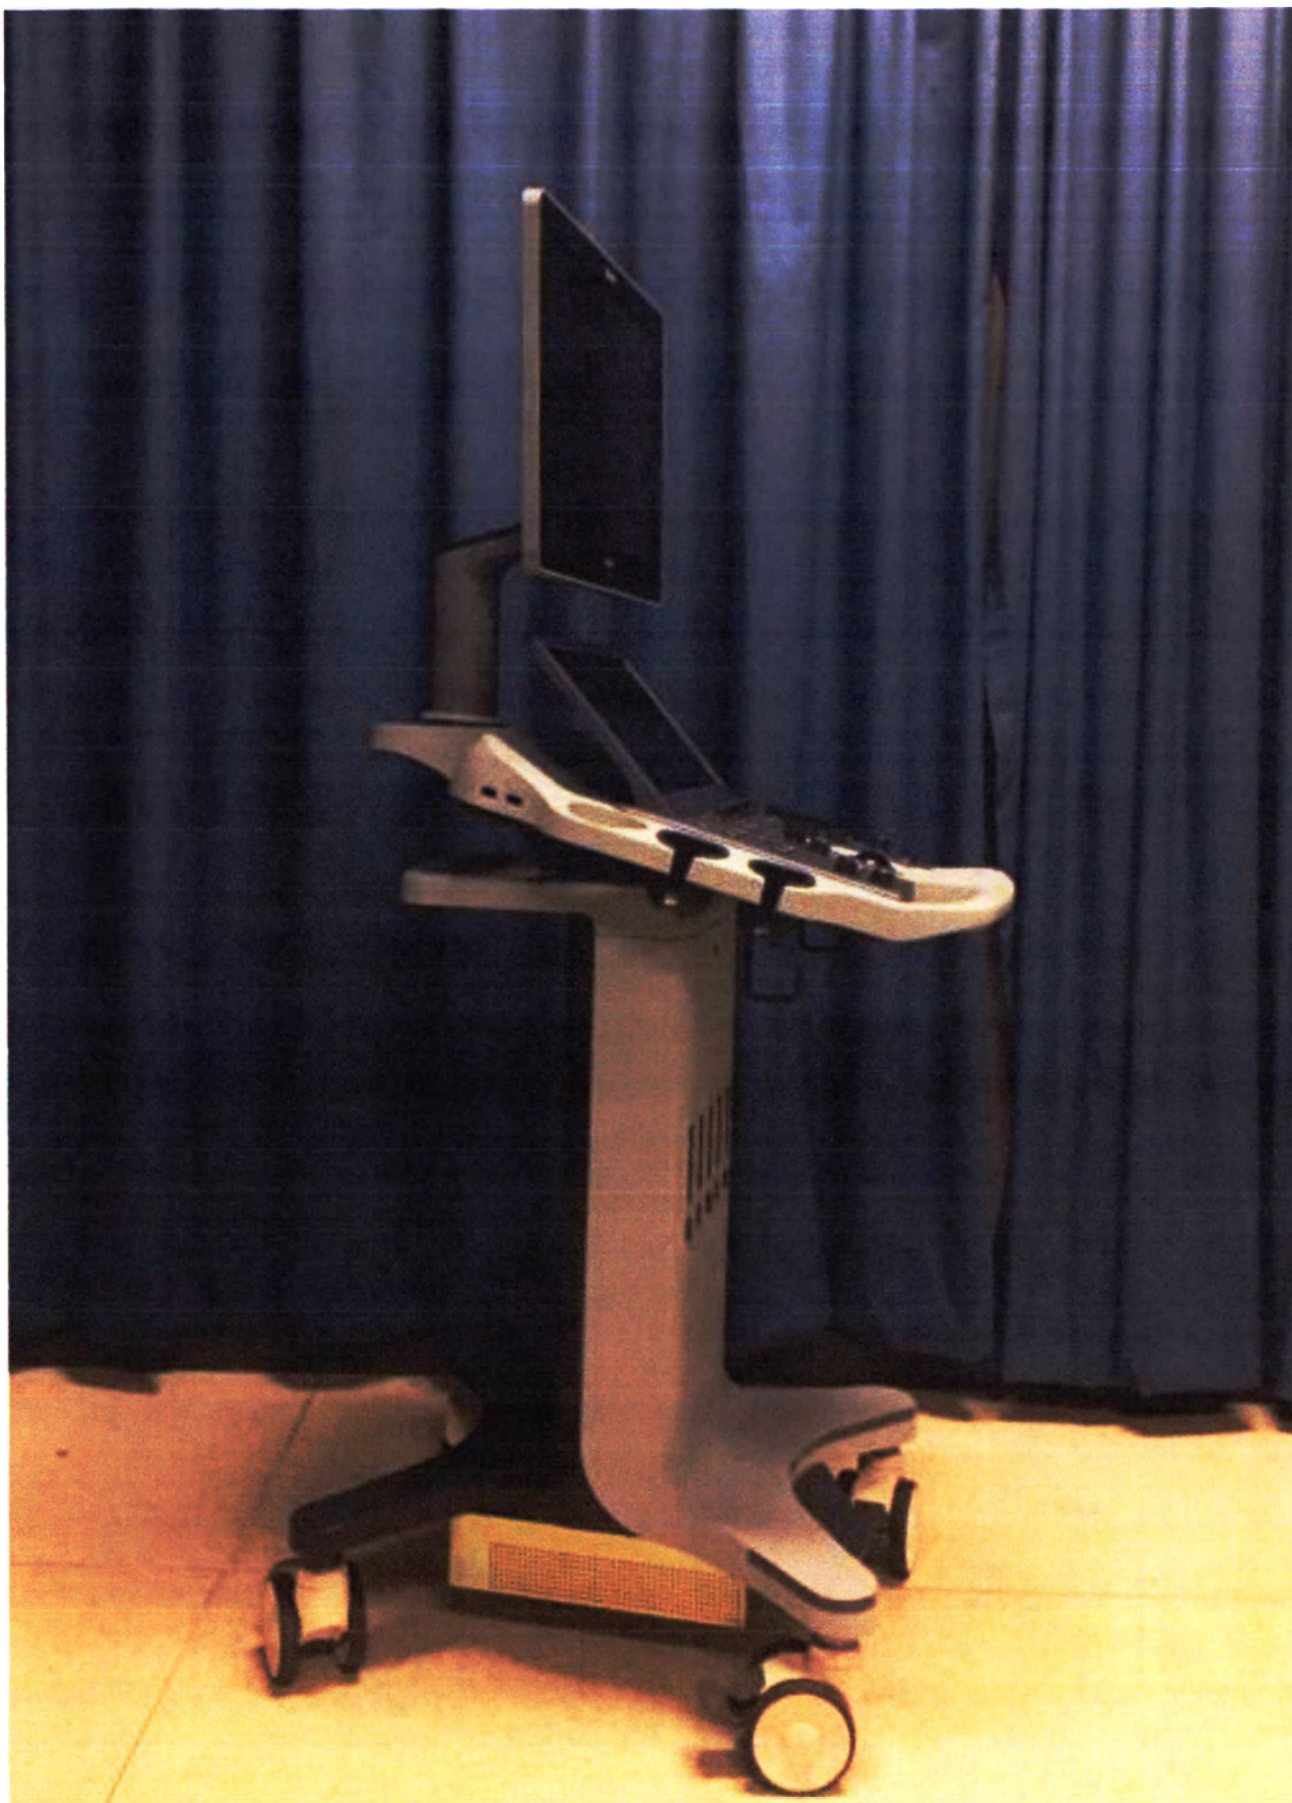

Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 (вид слева)




Внешний вид системы ультразвуковой Acclagix LX3 (вид справа)




Внешний вид системы ультразвуковой Acclagix LX3 Super (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 Super (вид сзади с подключенным датчиком УЗ)

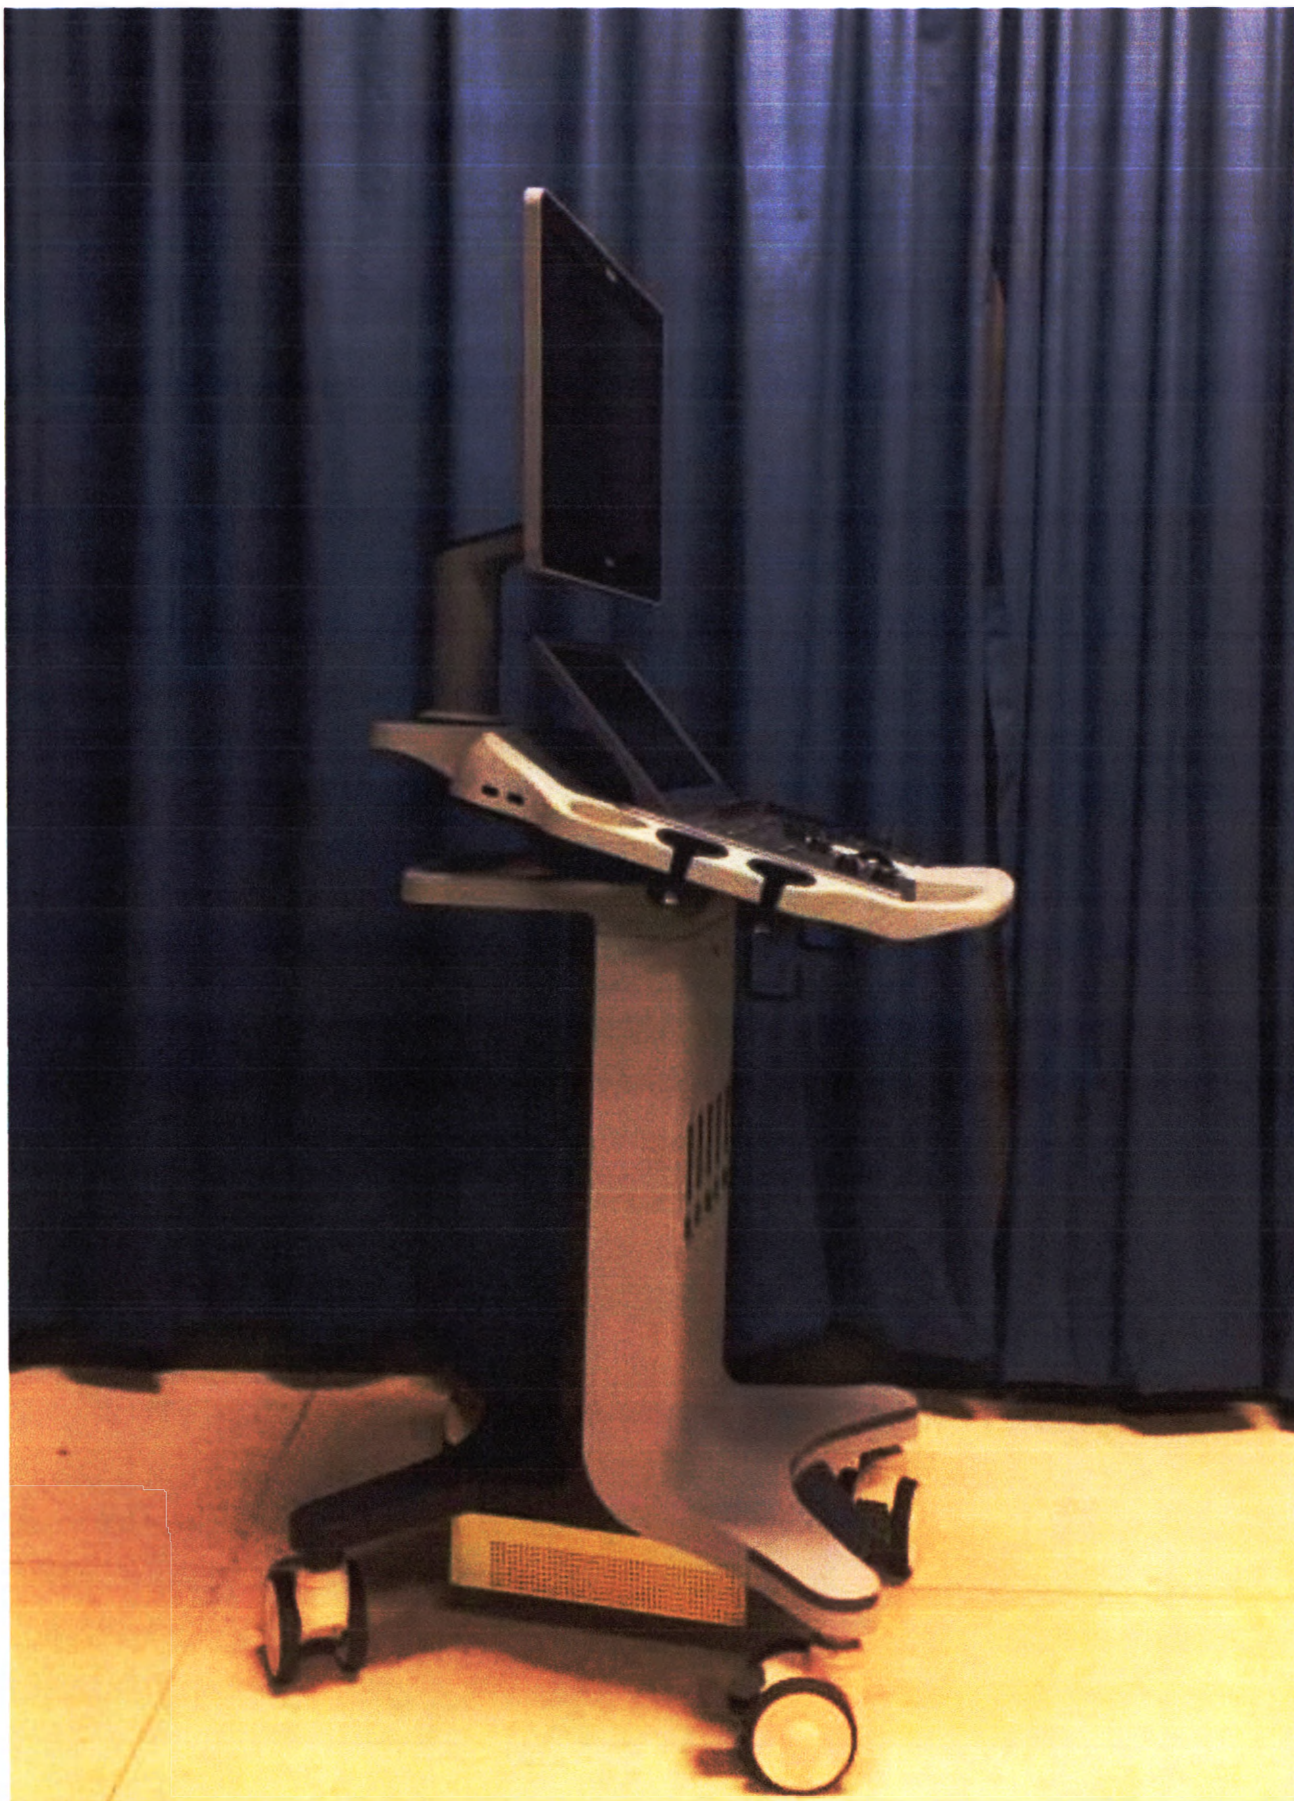

Внешний вид системы ультразвуковой Acclagix LX3 Super (вид слева)

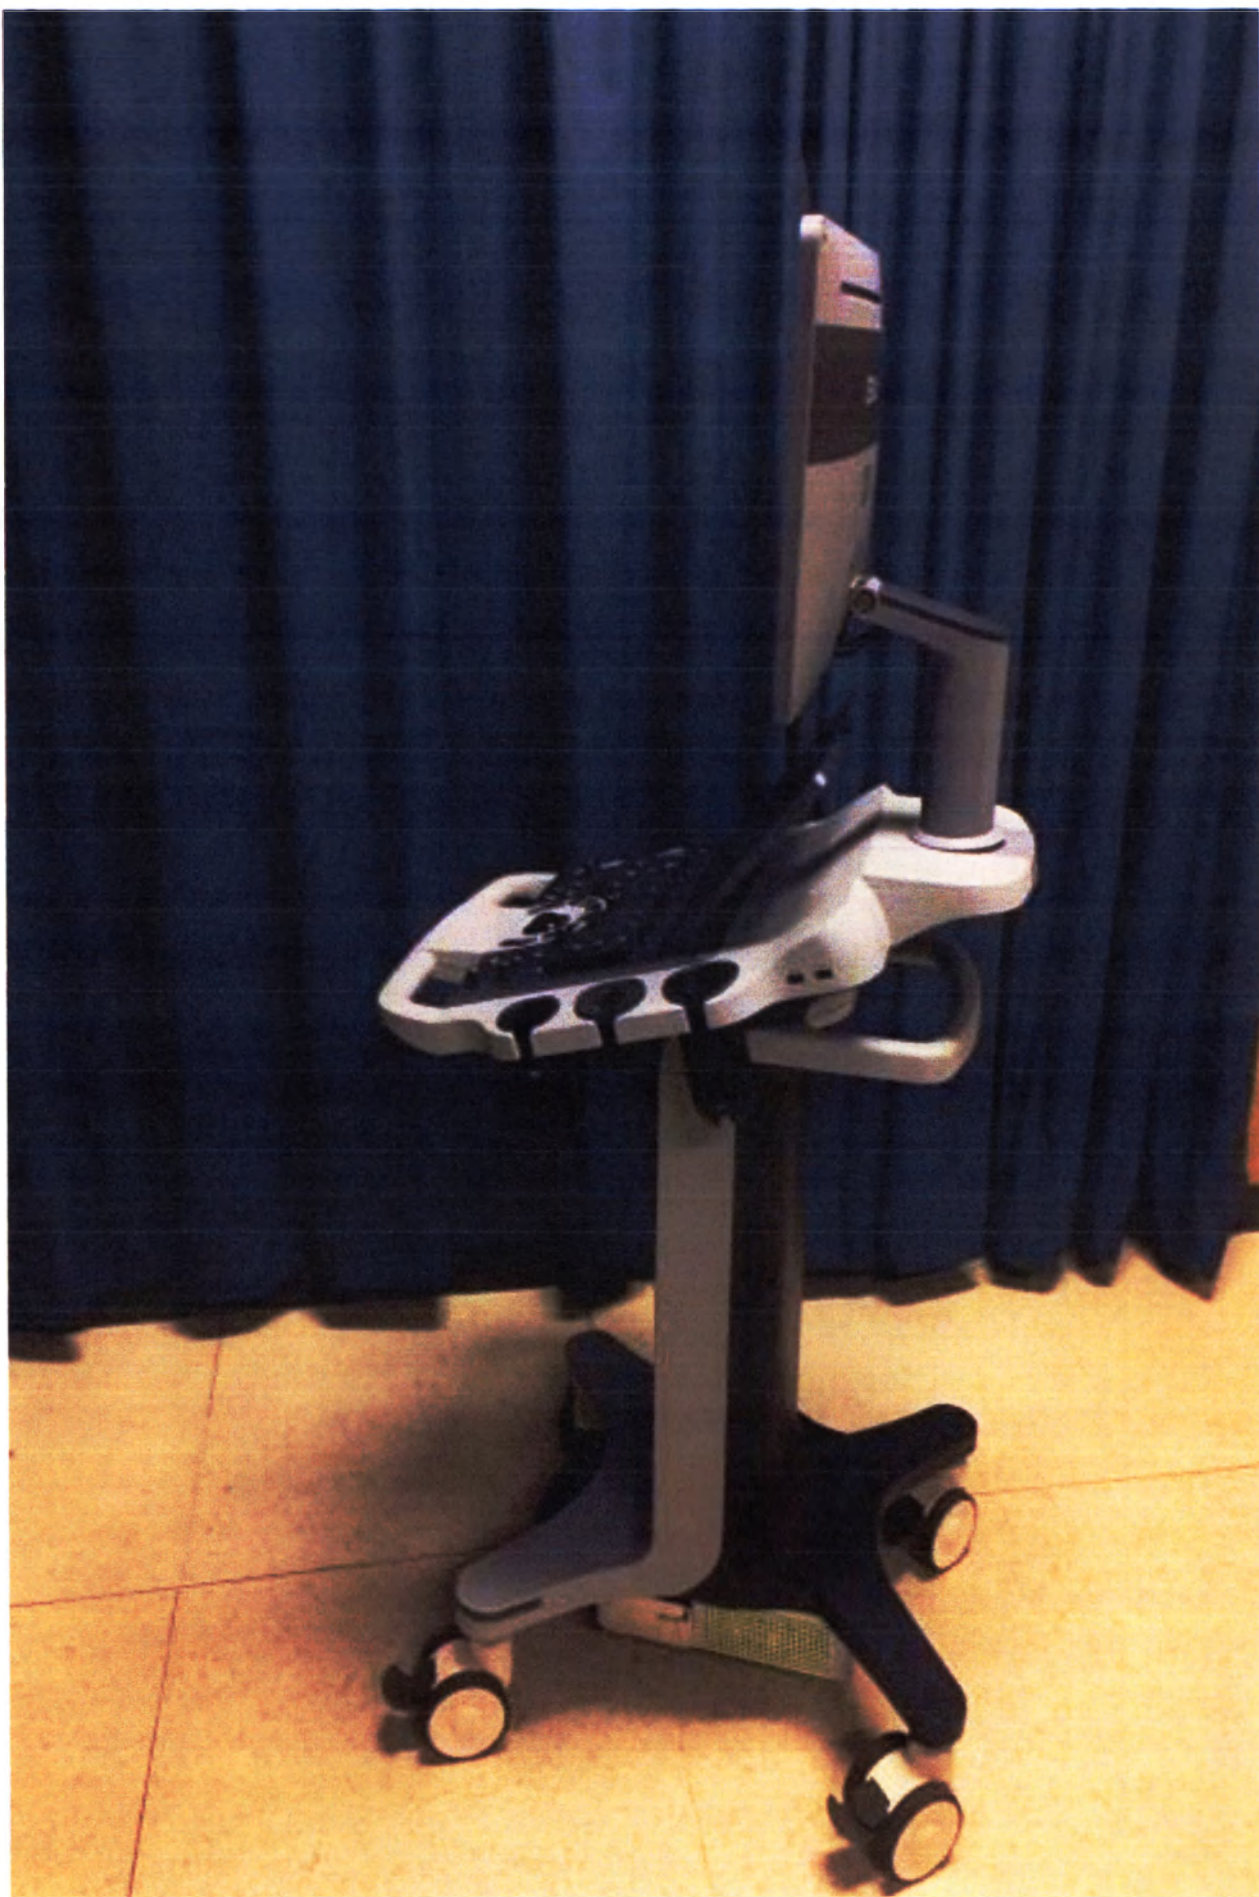

Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 Super (вид справа)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 Exp (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 Exp (вид сзади)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 Exp (вид слева)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX3 Exp (вид справа)




Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX25 (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX25 (вид сзади)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX25 (вид слева)

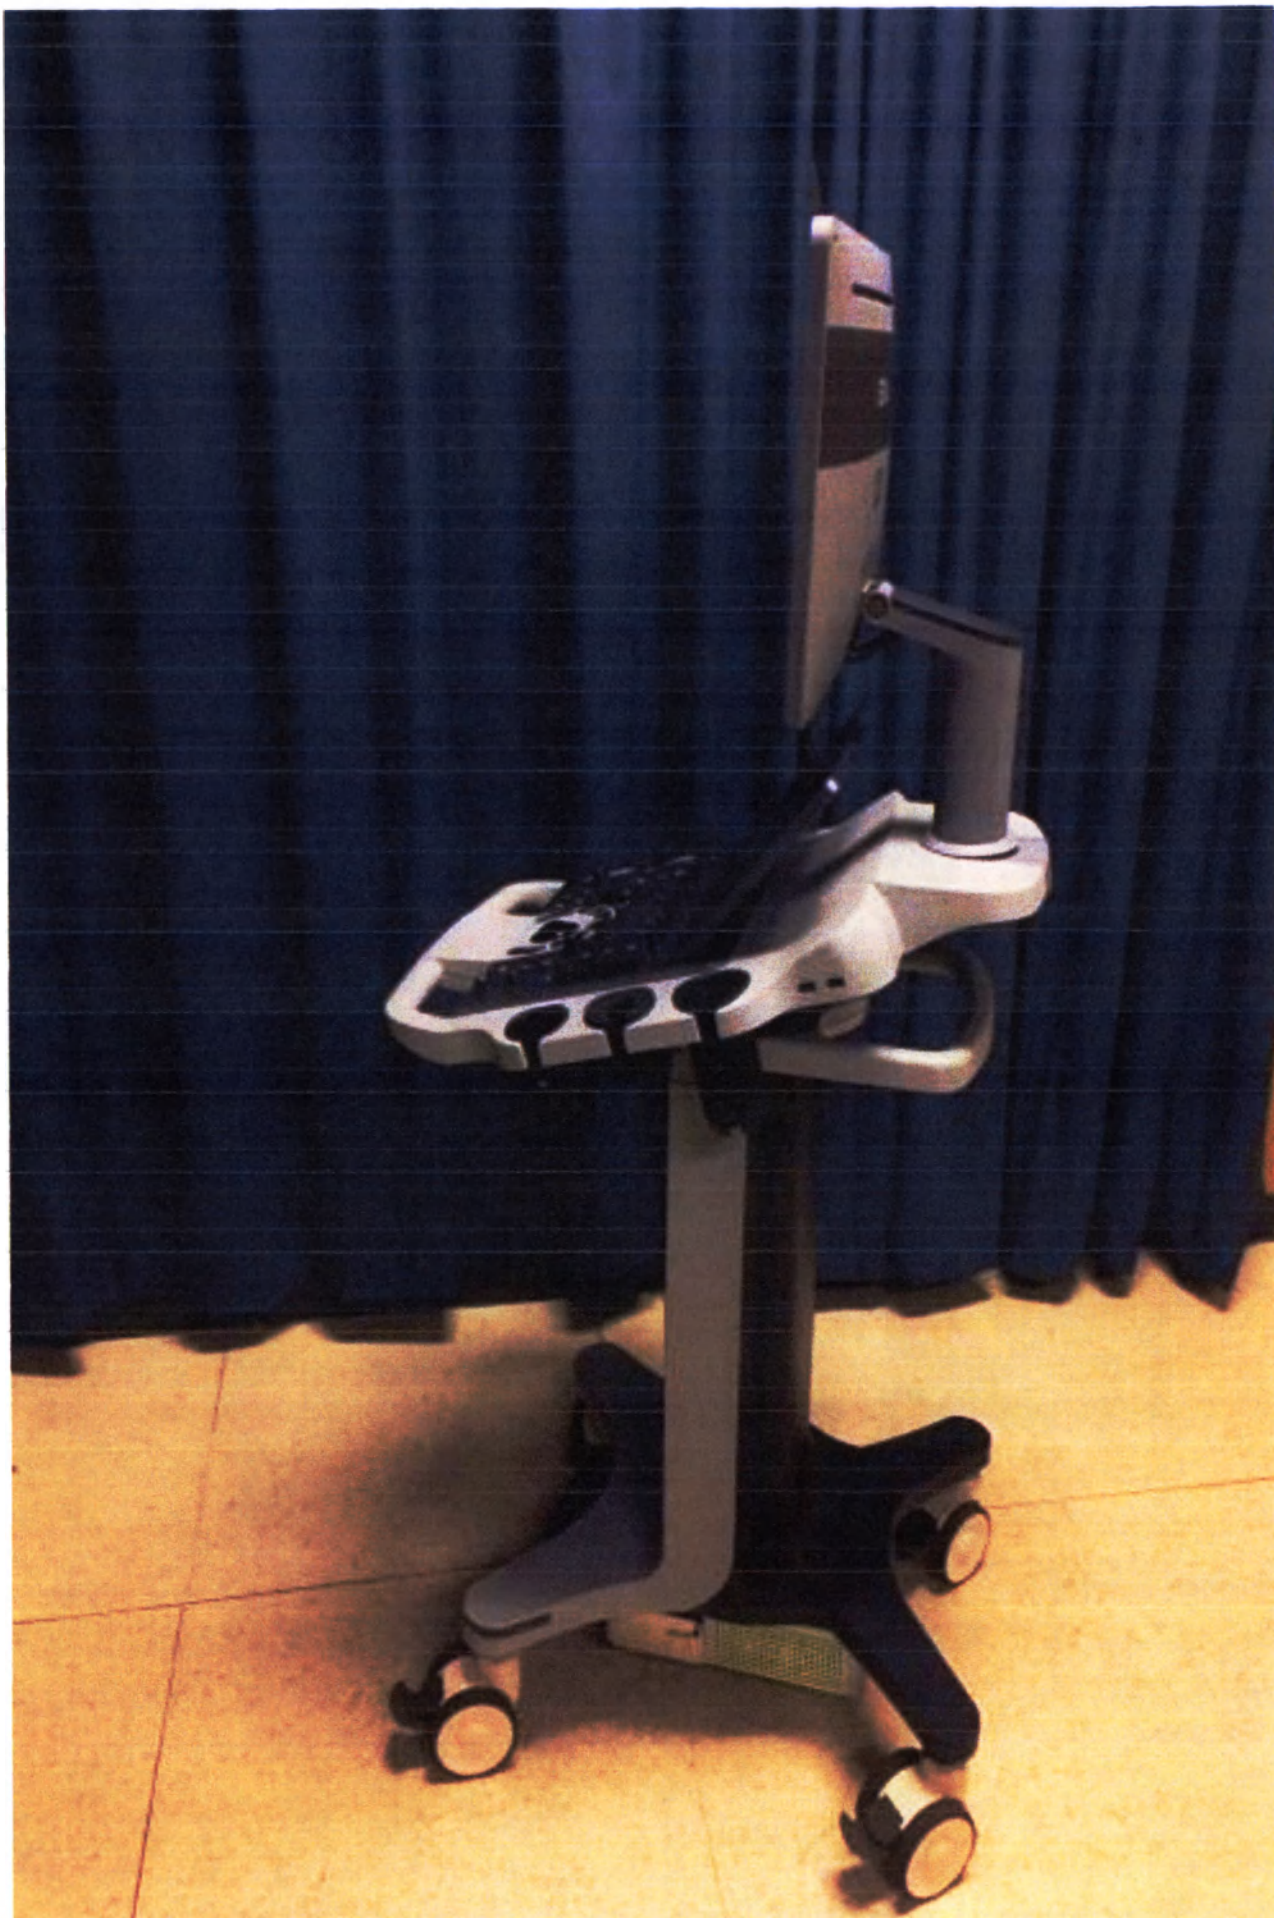

Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX25 (вид справа)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX28 (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX28 (вид сзади)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX28 (вид слева)




Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX28 (вид справа)




Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 (вид сзади)

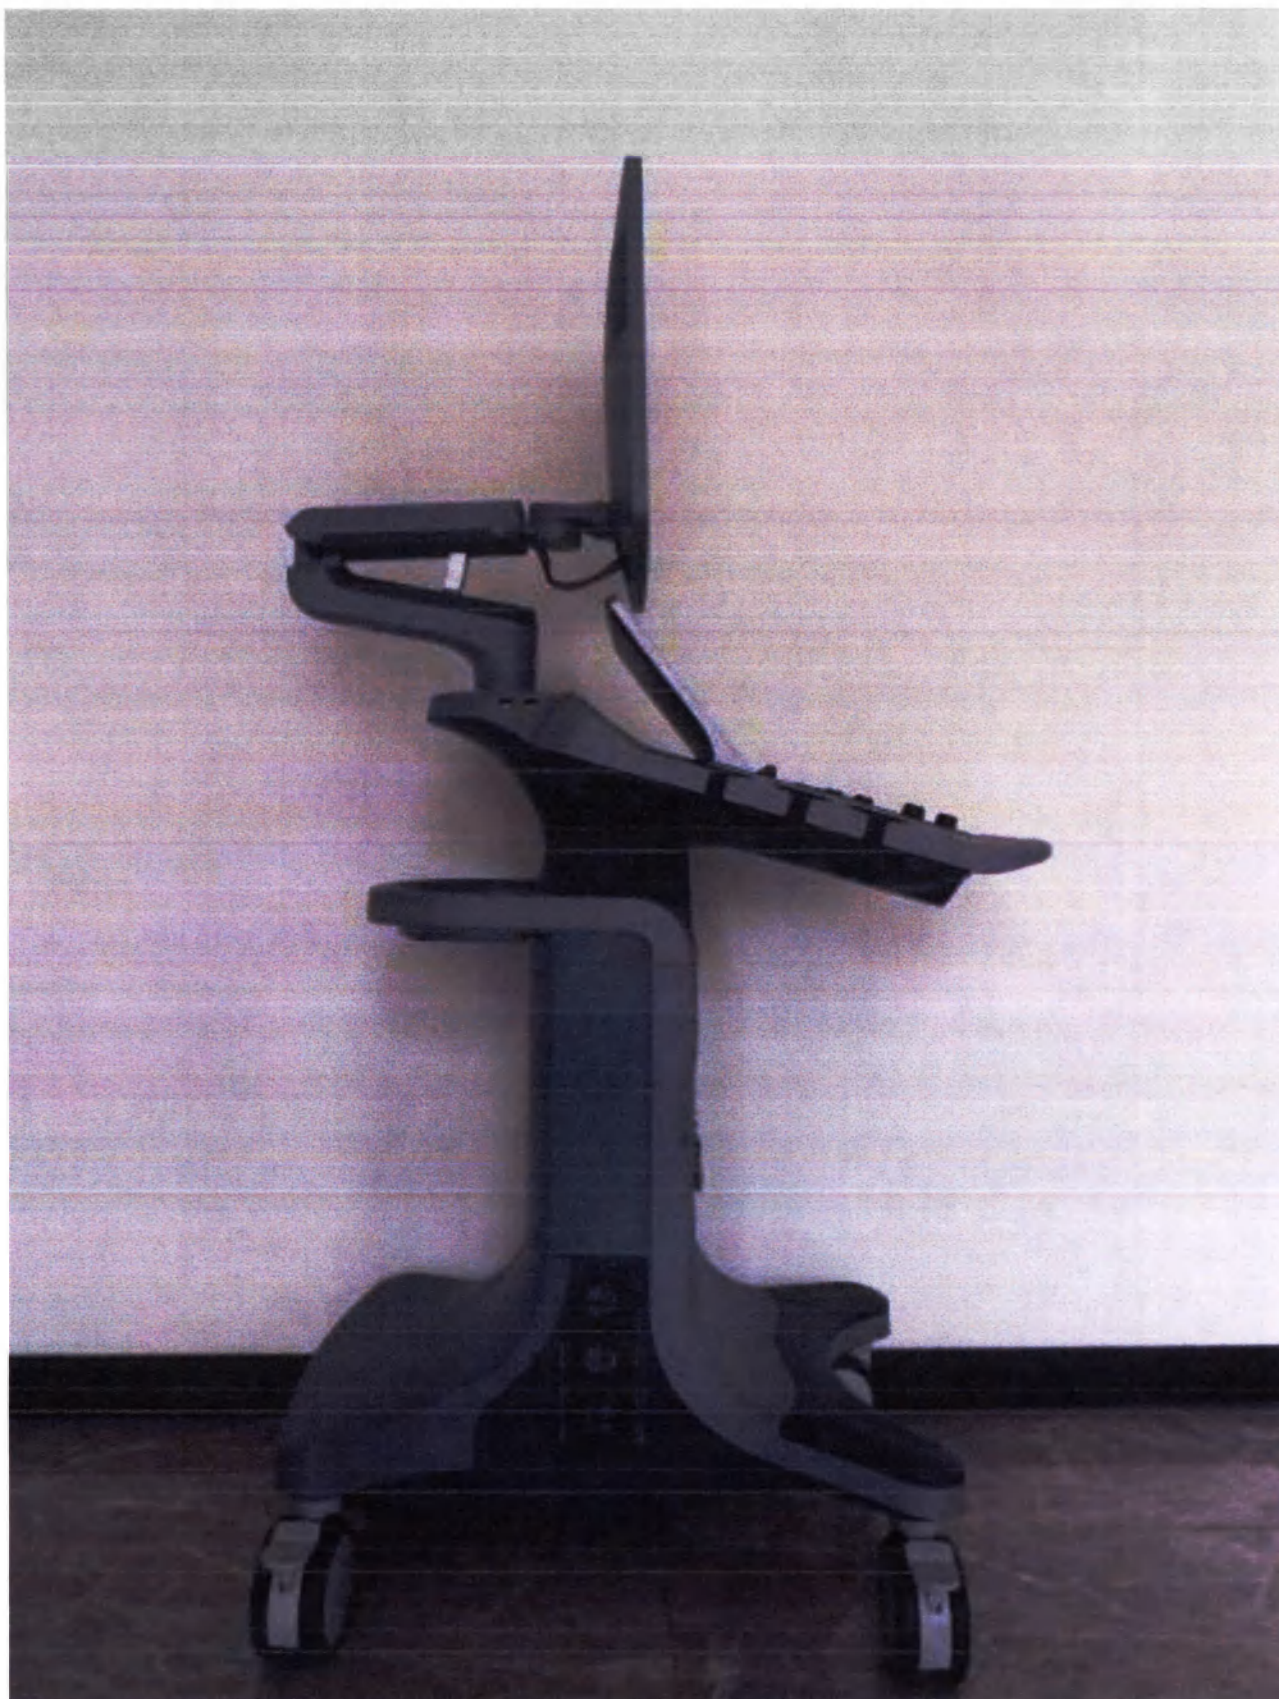

Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 (вид слева)

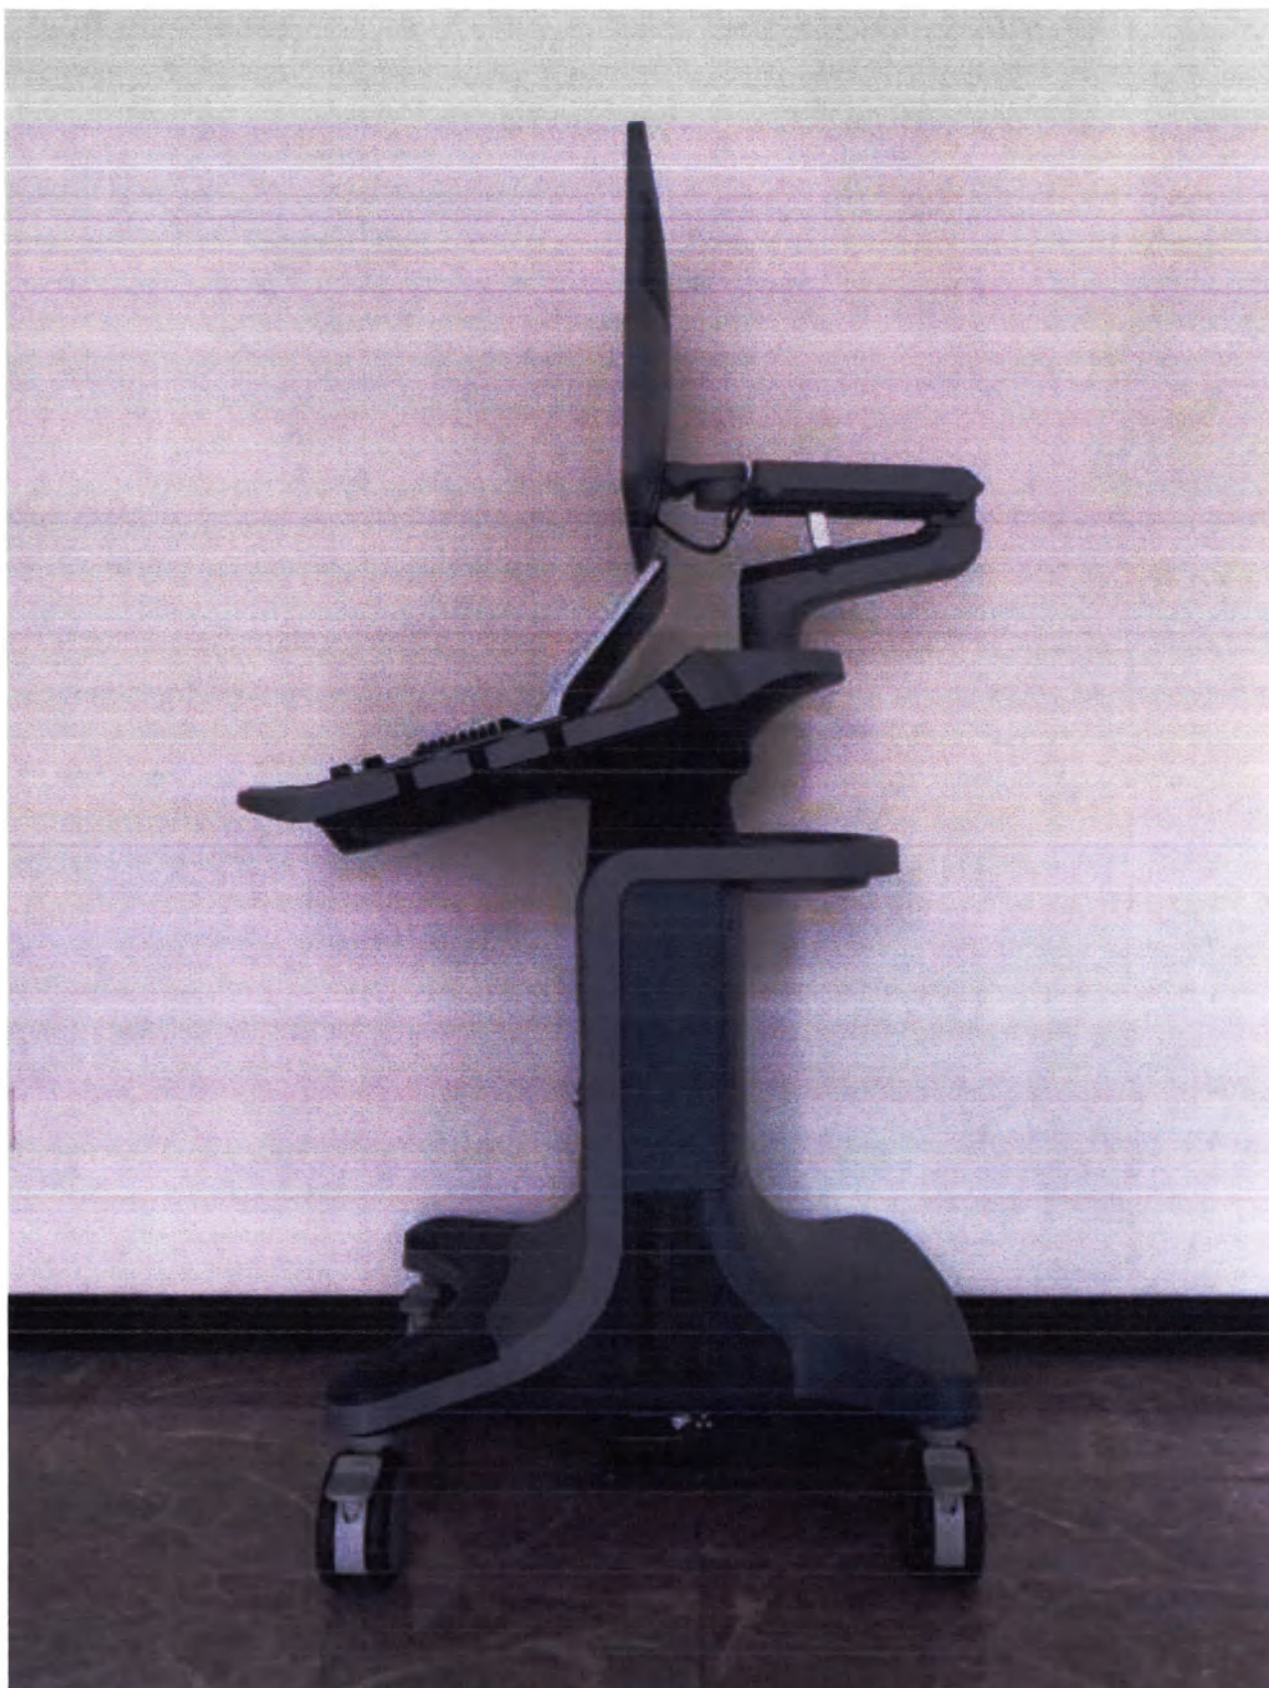

Внешний вид системы ультразвуковой Acclagix LX9 (вид справа)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Super (вид спереди) с подключённым внешним ЭКГ модулем и датчиком ультразвуковым



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Super (вид сзади) с подключённым внешним ЭКГ модулем и датчиком ультразвуковым



Внешний вид системы ультразвуковой AcclariX LX9 Super (вид слева) с подключённым внешним ЭКГ модулем и датчиком ультразвуковым



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Super (вид справа) с подключённым внешним ЭКГ модулем и датчиком ультразвуковым




Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Exp (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Exp (вид сзади)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Exp (вид слева)

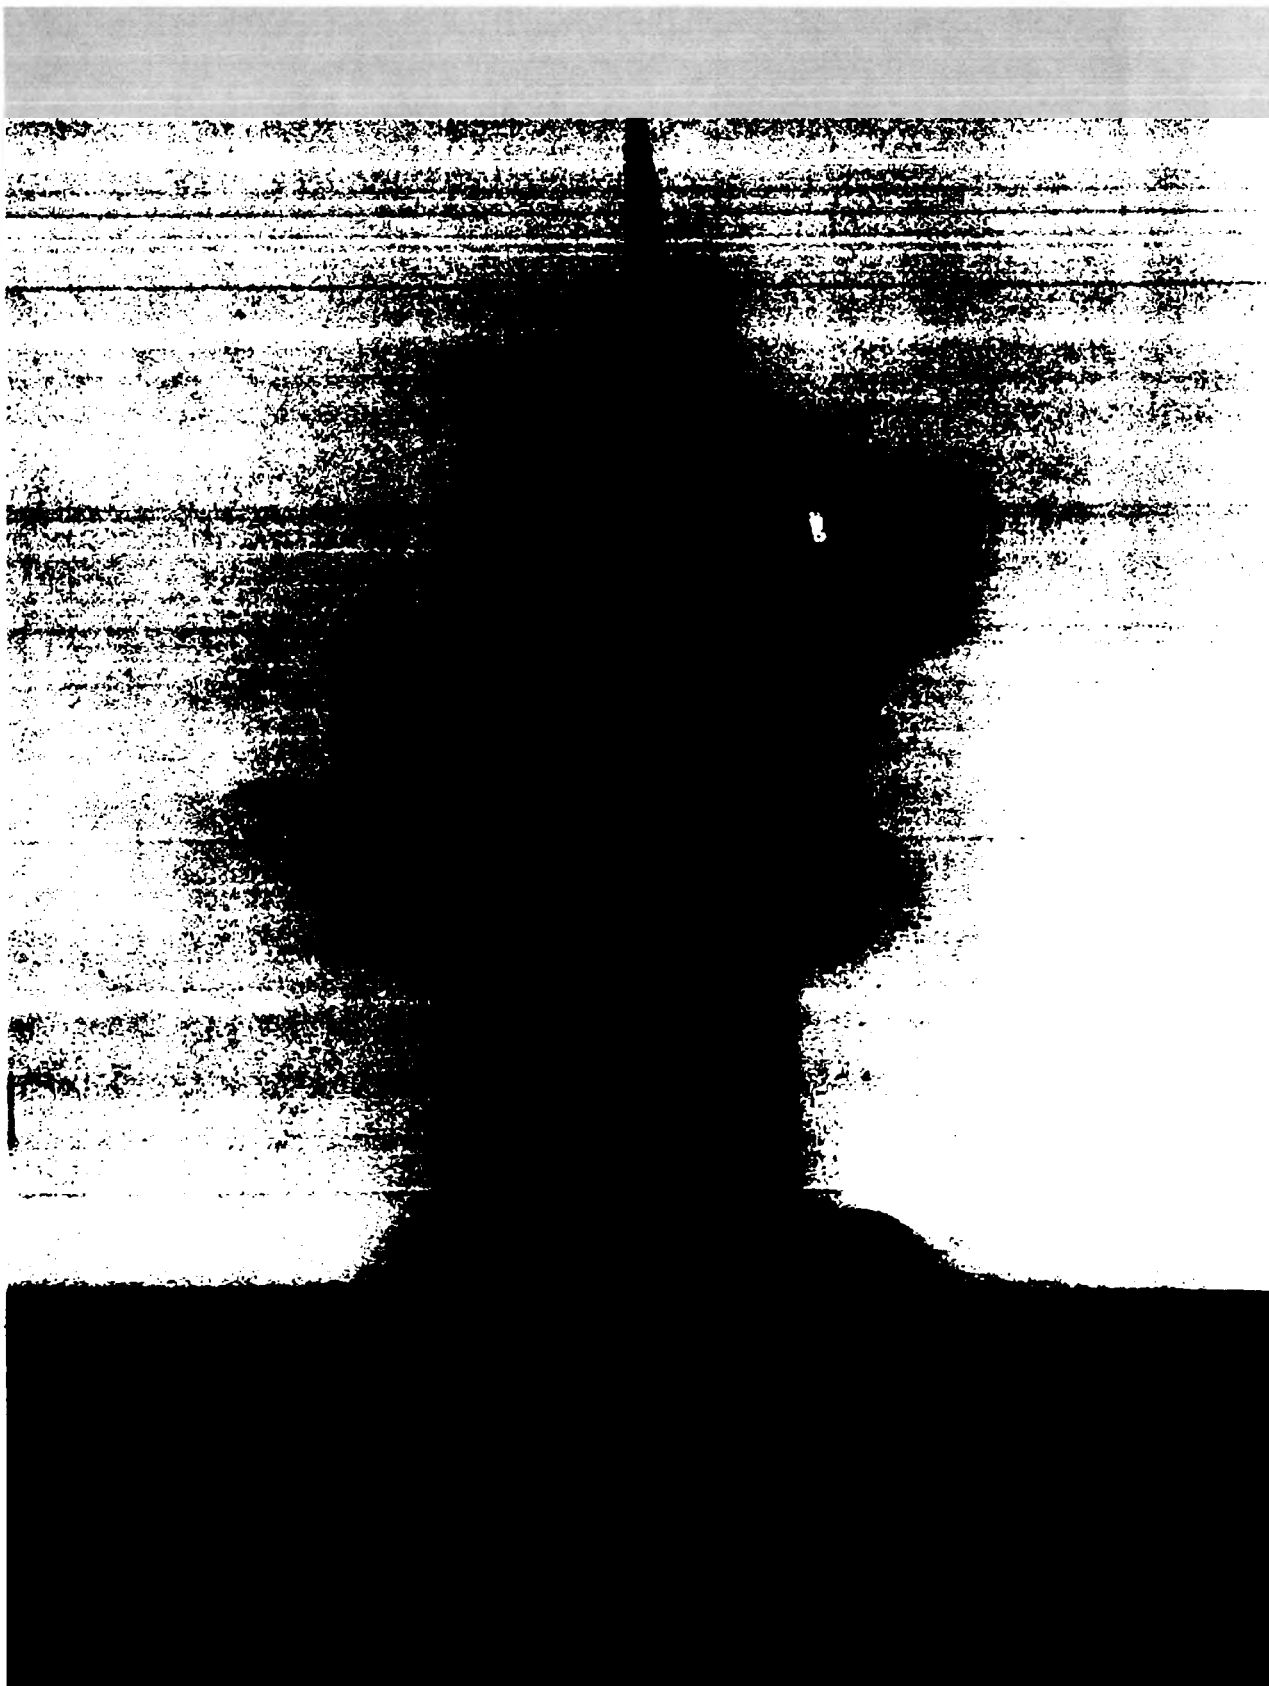

Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX9 Exp (вид справа)




Внешний вид системы ультразвуковой Acclagix LX85 (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX85 (вид сзади)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX85 (вид слева)

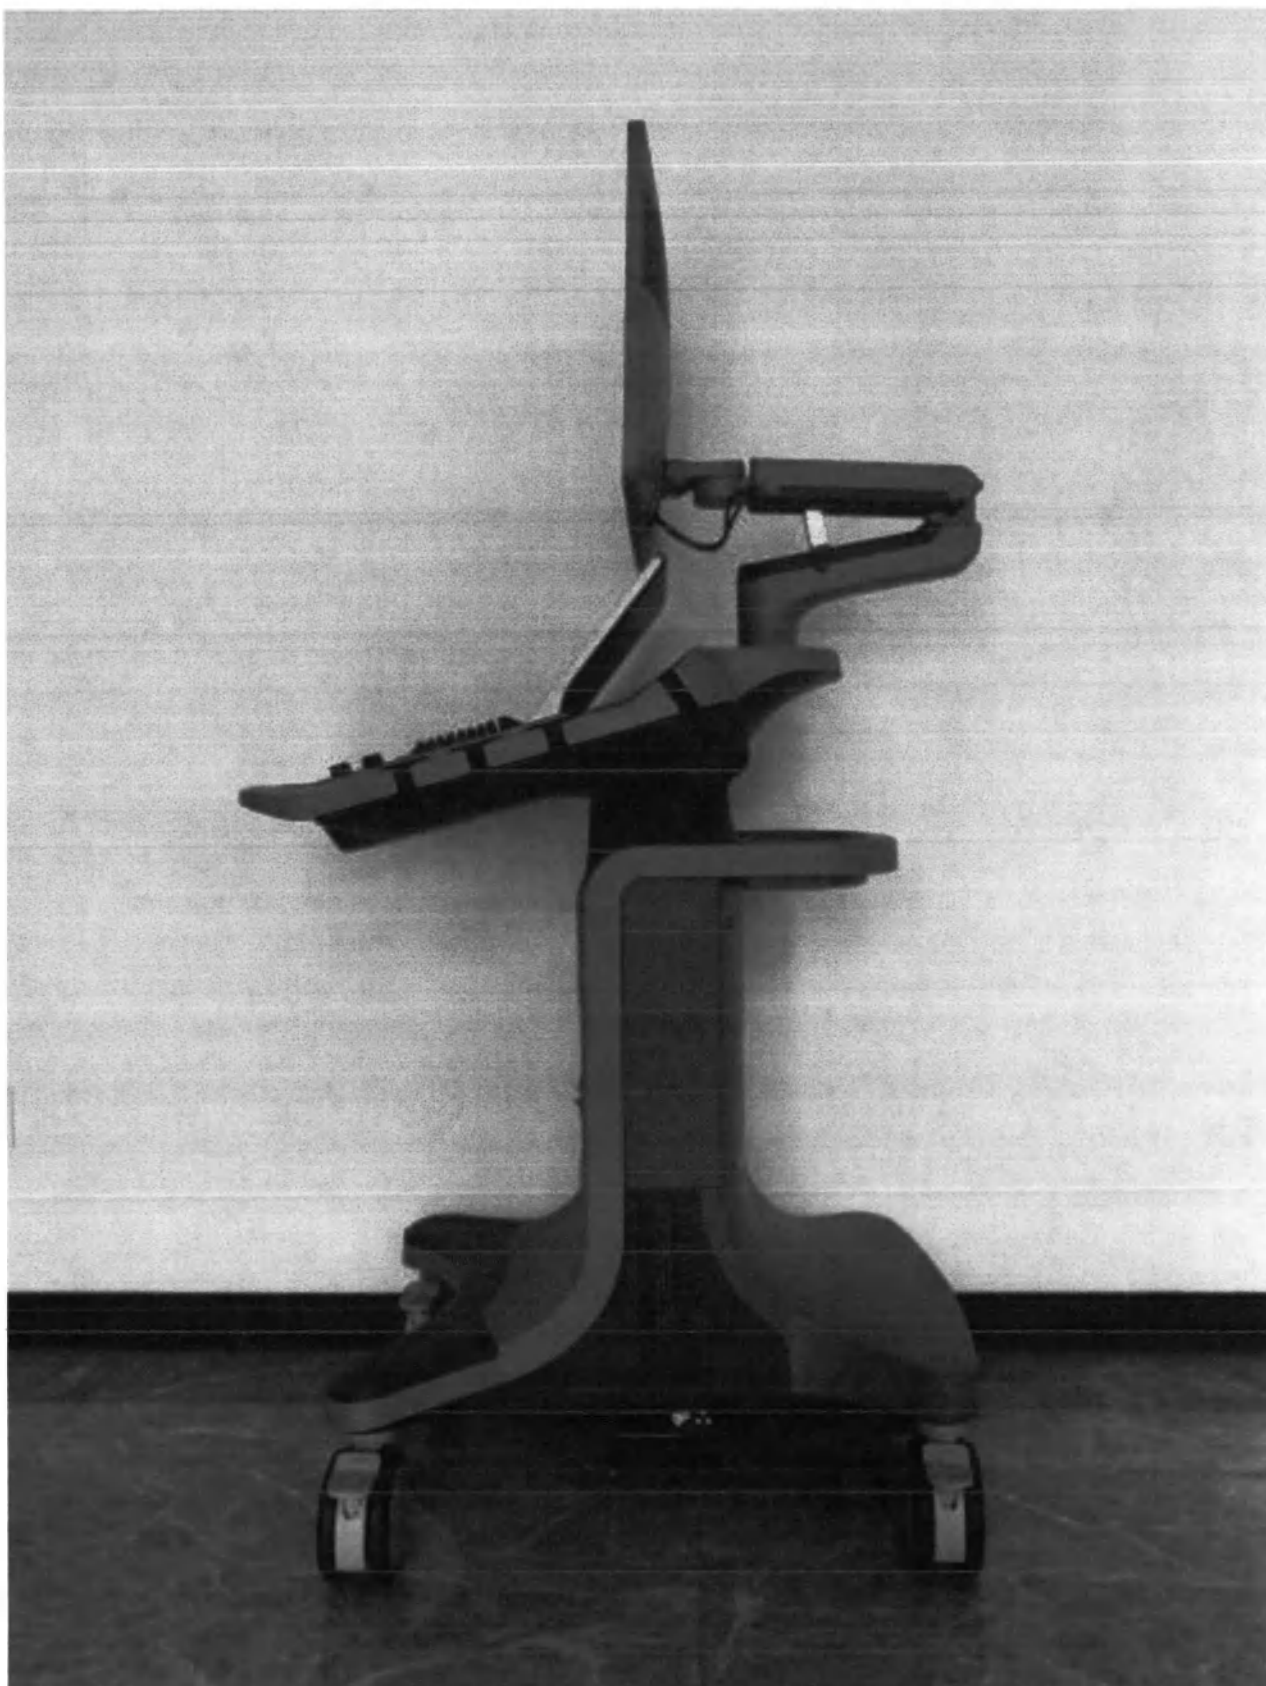


Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX85 (вид справа)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX88 (вид спереди)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX88 (вид сзади)

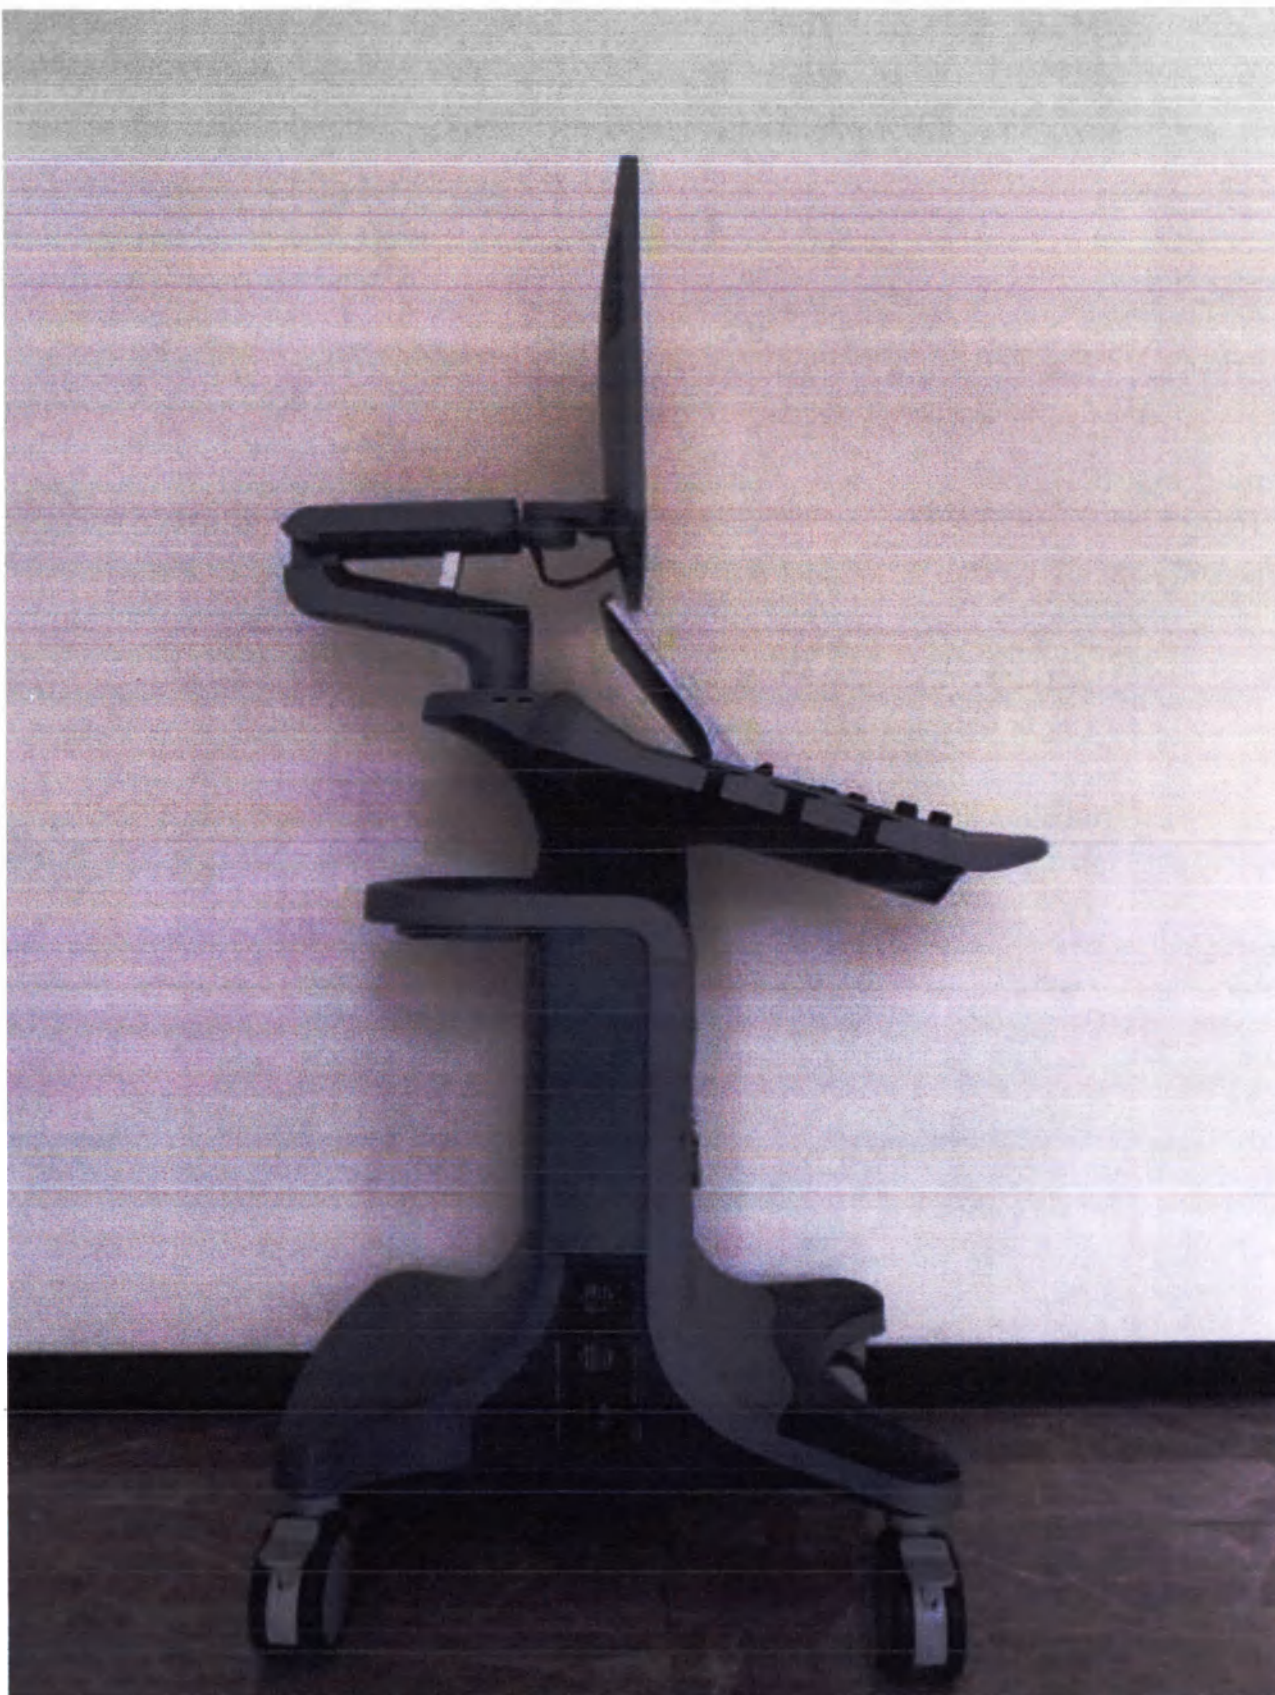

Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX88 (вид слева)



Внешний вид системы ультразвуковой Acclarix LX88 (вид справа)



Кабель питания



可充电锂离子电池
Rechargeable Li-ion Battery

型号 Model: TWSLB-003 41XR19/65-2

P/N 01.21.064143

SN 003-EBA01273

制造日期 2020-11-13

电压 Voltage: 14.8V
额定容量 Rated Capacity: 5000mAh/74Wh
充电限制电压 Limited Charge Voltage: 16.8V

警告 Caution:

- 充电时使用指定的充电器
Charge only with specified charger
- 不要对电池加热或投入火中
Don't heat or dispose of in fire
- 不要拆开电池
Don't disassemble the battery
- 不要将正负极短路
Don't short circuit "+-"
- 电池浸水后禁止使用
Don't use again after flooding

中国制造 MADE IN CHINA


制造商 广州明美新能源有限公司

TWS TECHNOLOGY (GUANGZHOU) LIMITED


01.21.064143012




Литий-ионная батарея

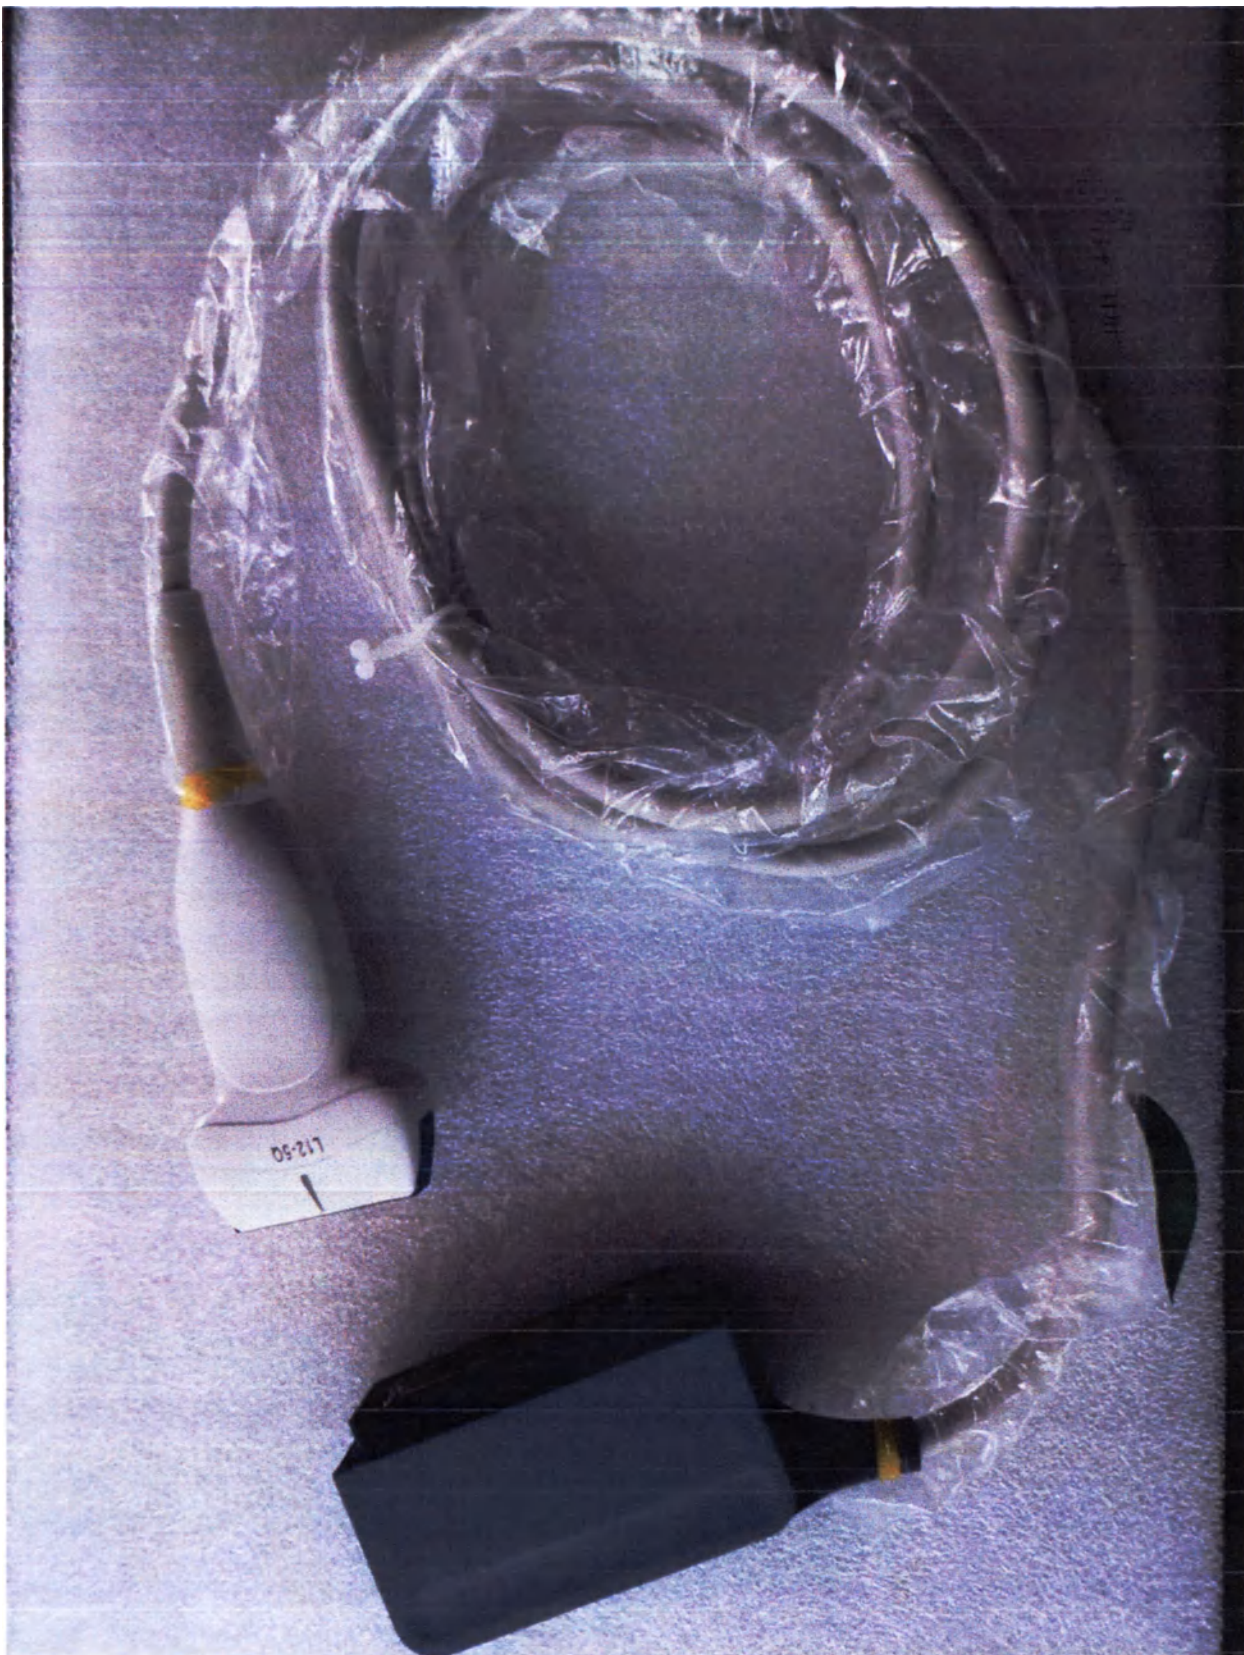

Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q

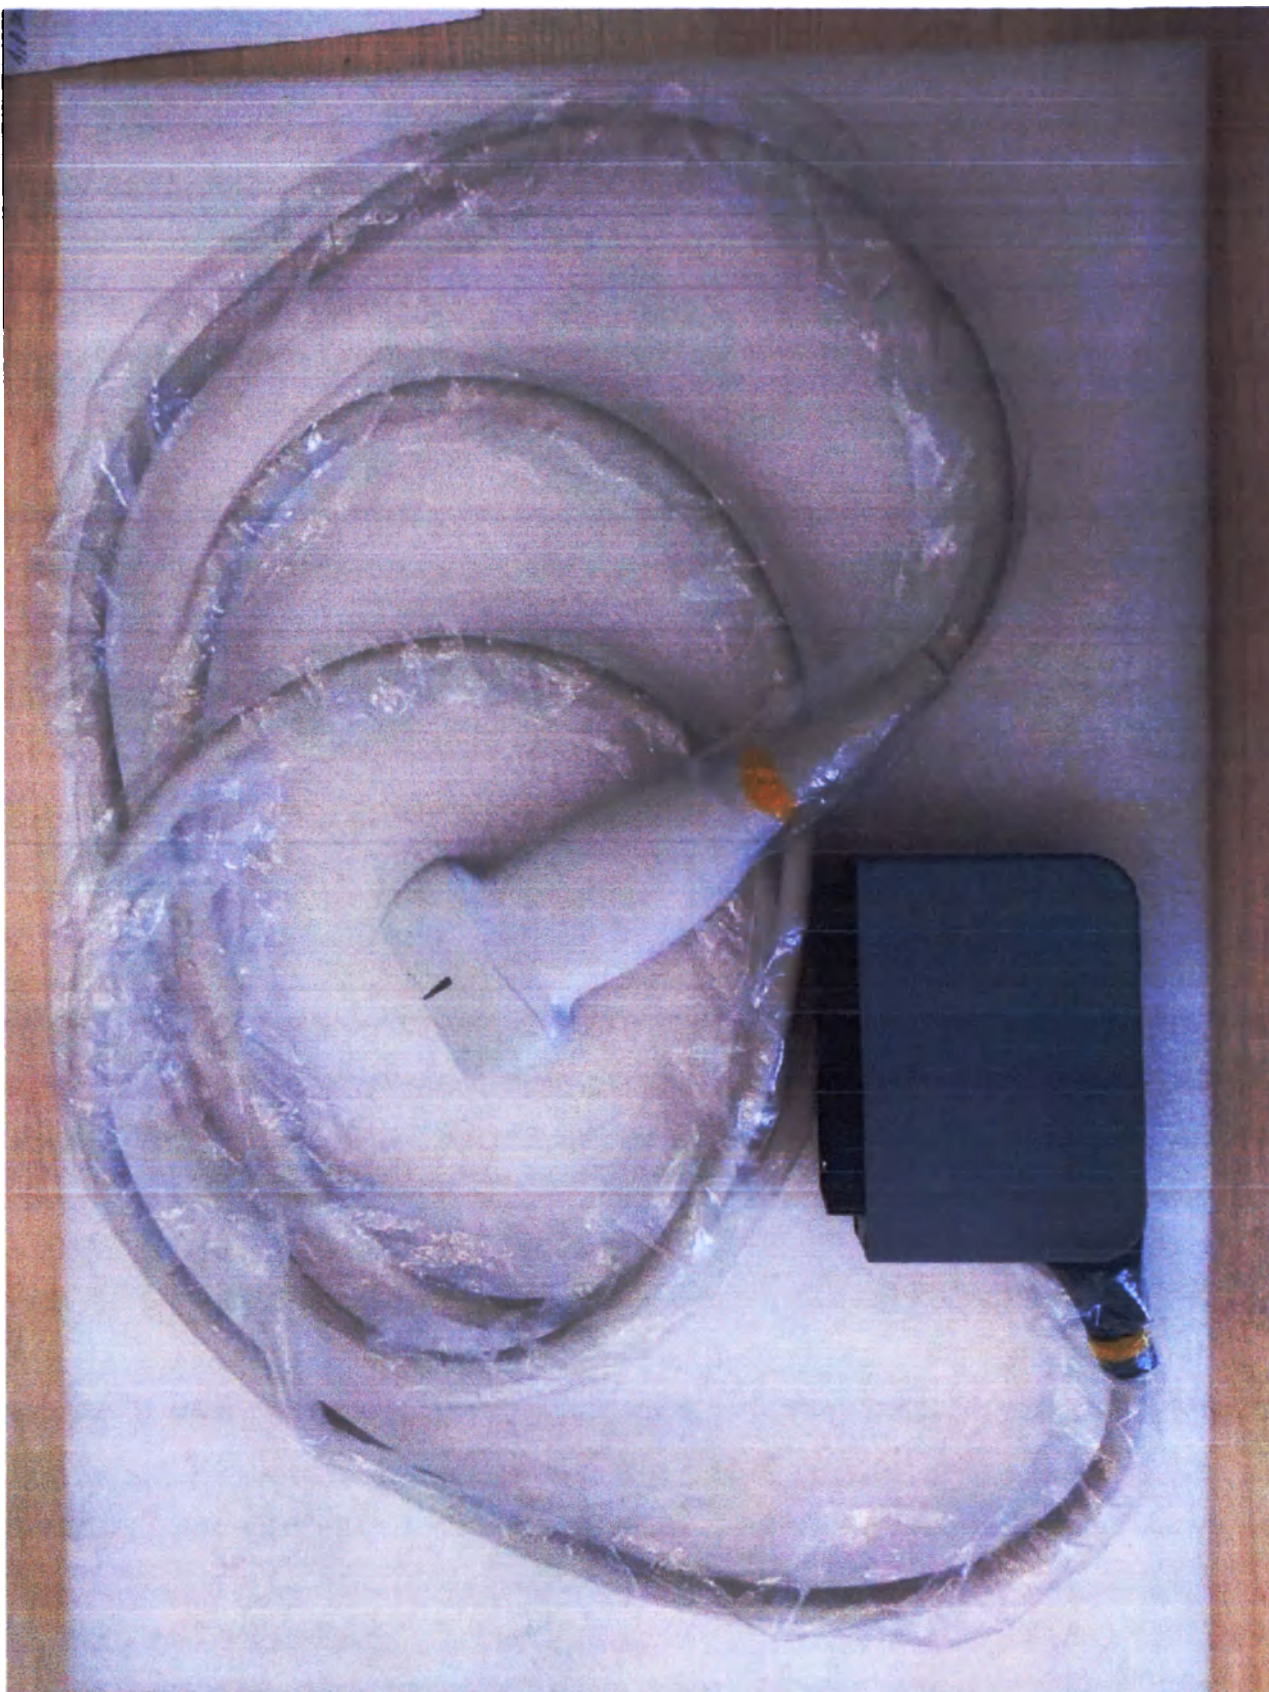

Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ

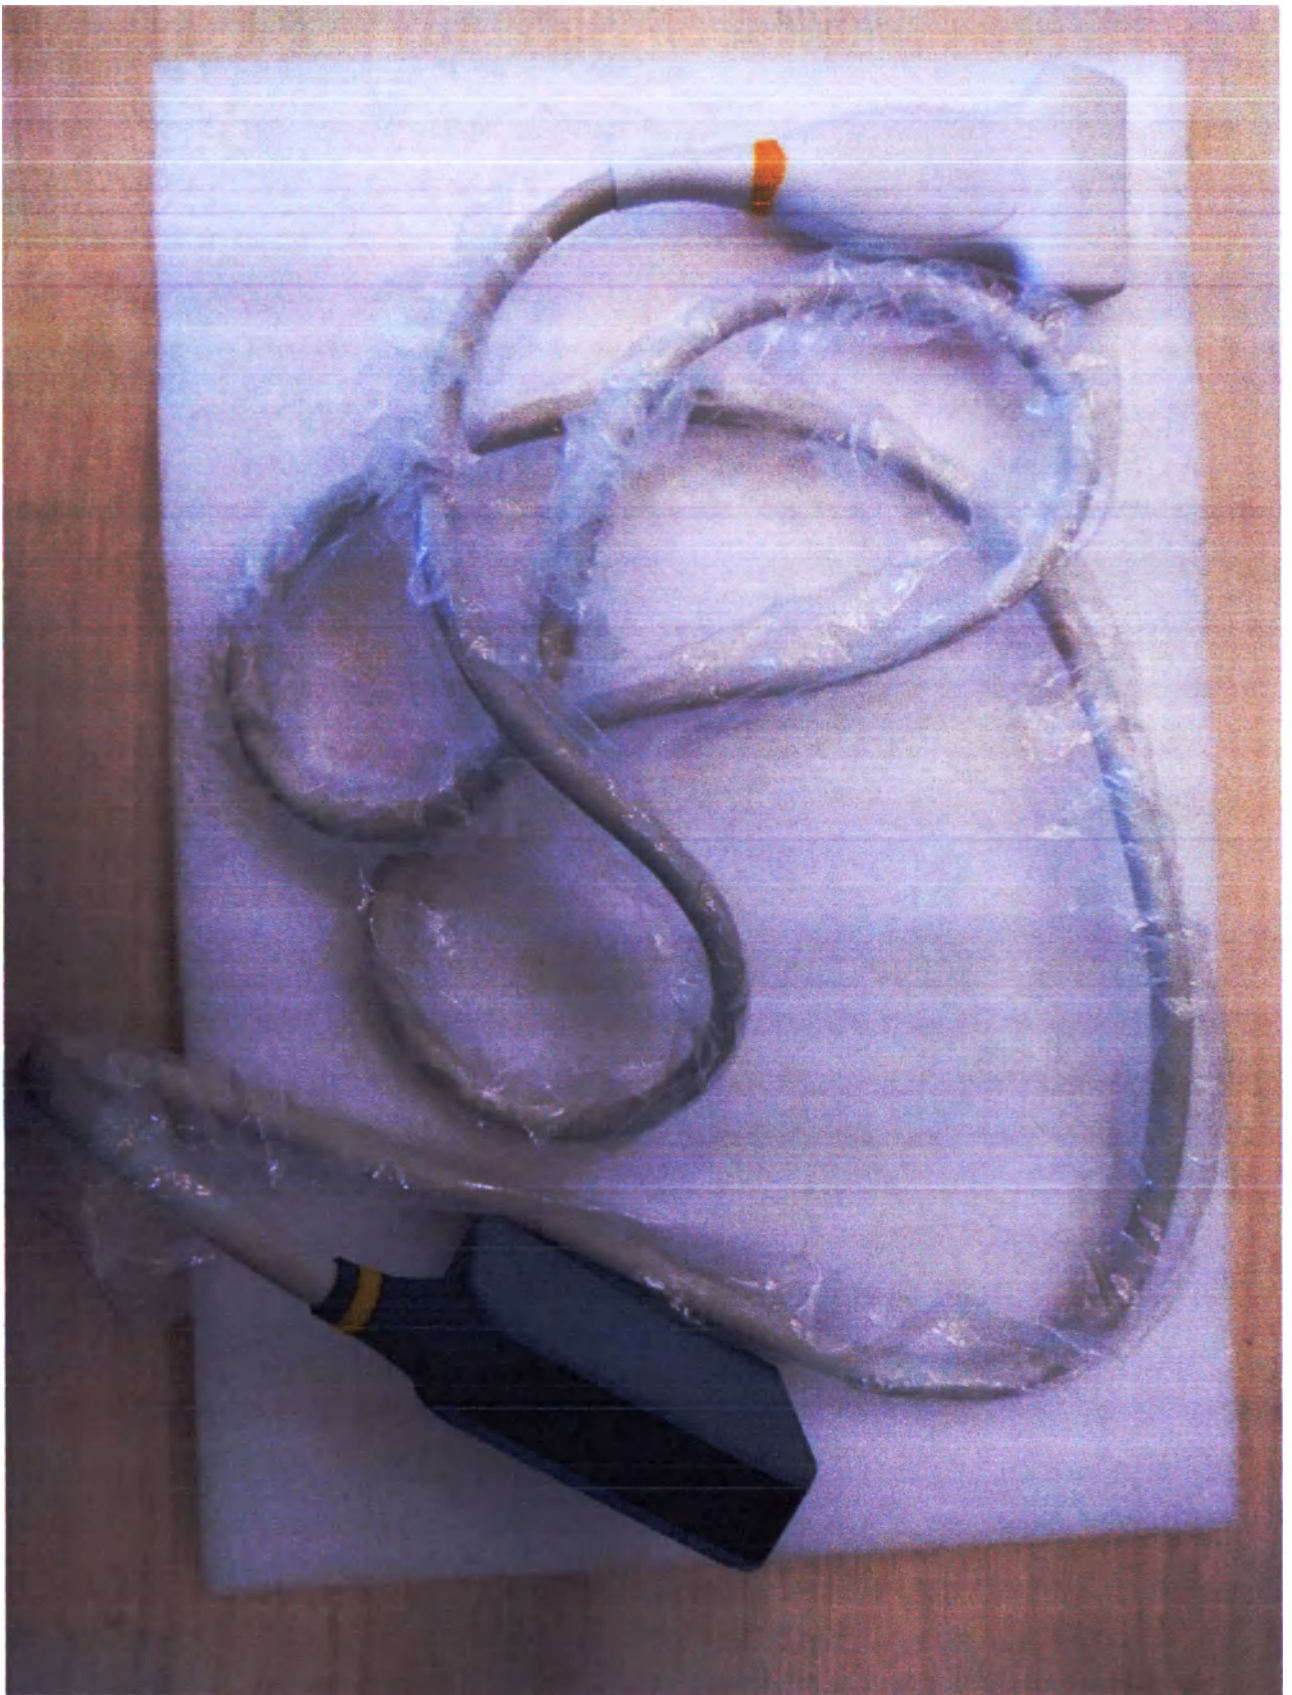

Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ



Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ




Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ



Датчик внутриполостной ультразвуковой Е8-4Q




Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ

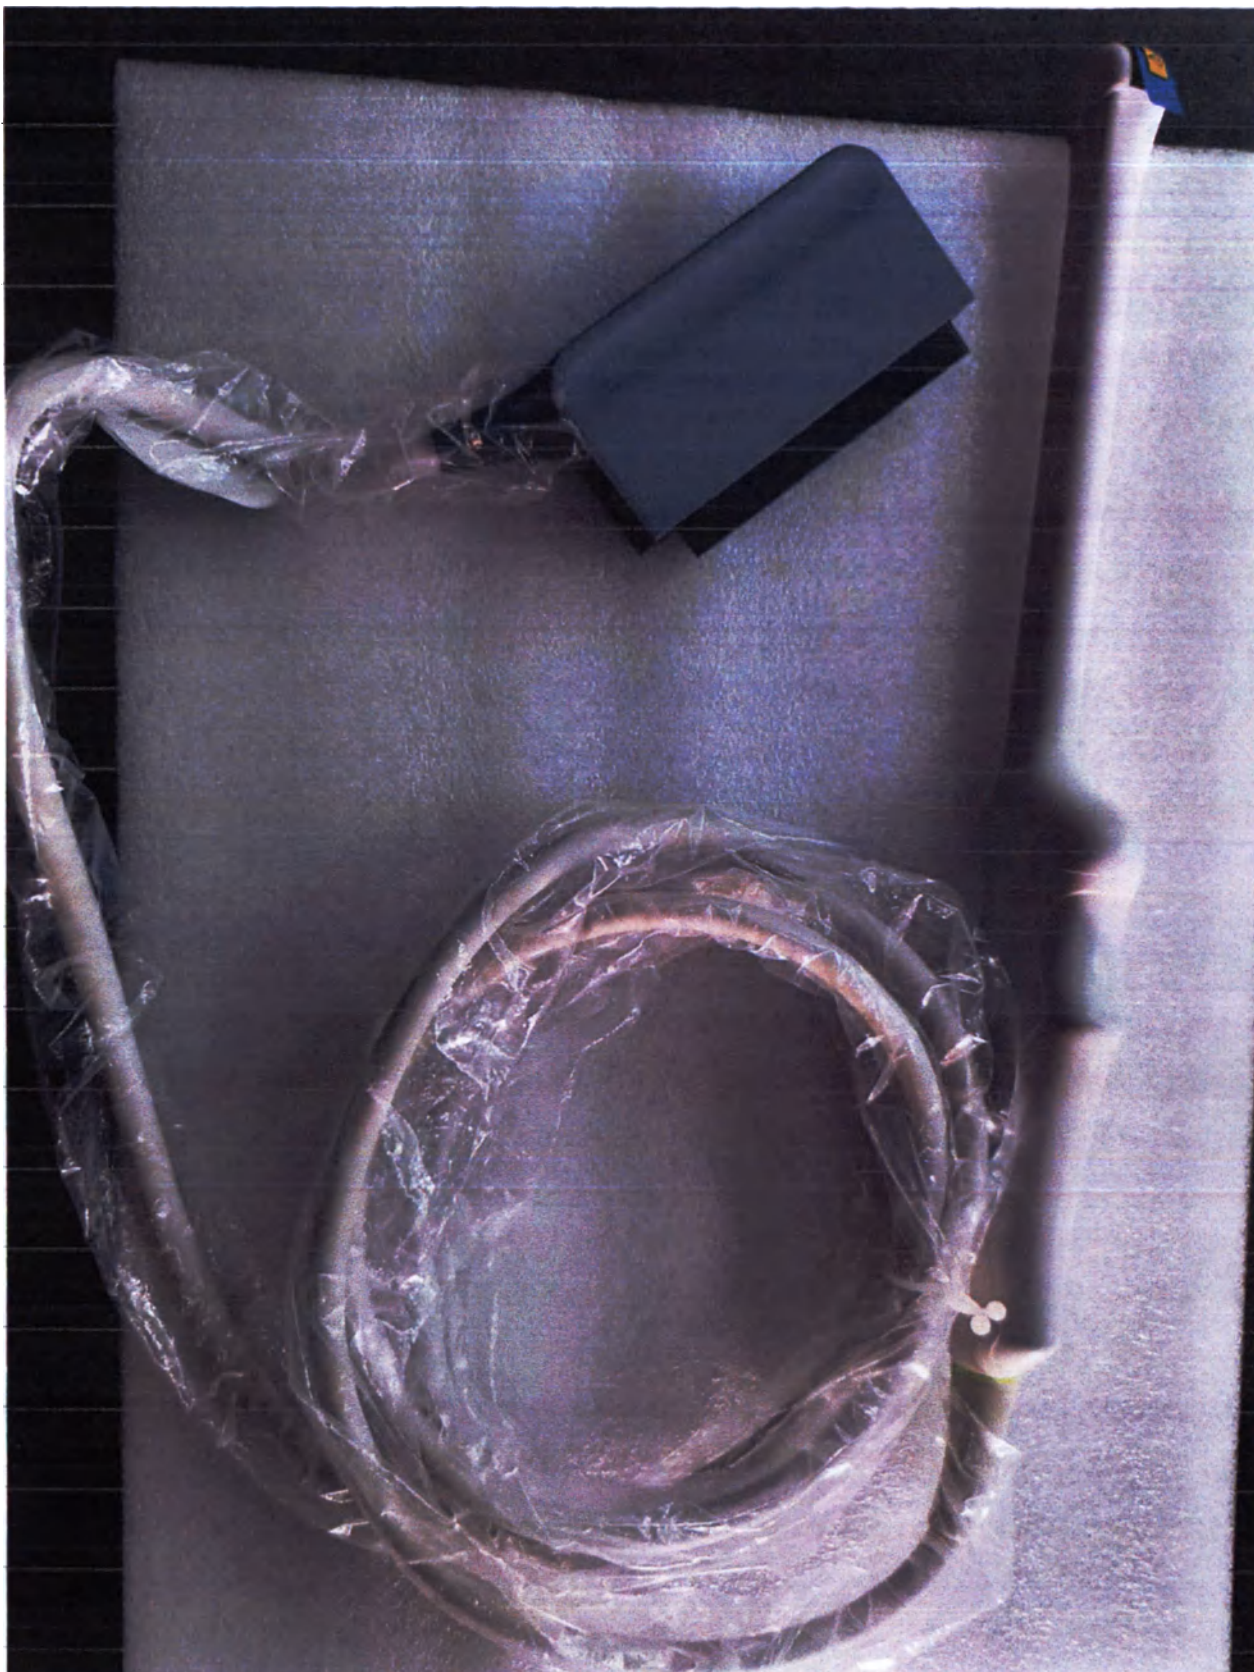

Датчик внутриспостной ультразвуковой E10-3HQ



Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q

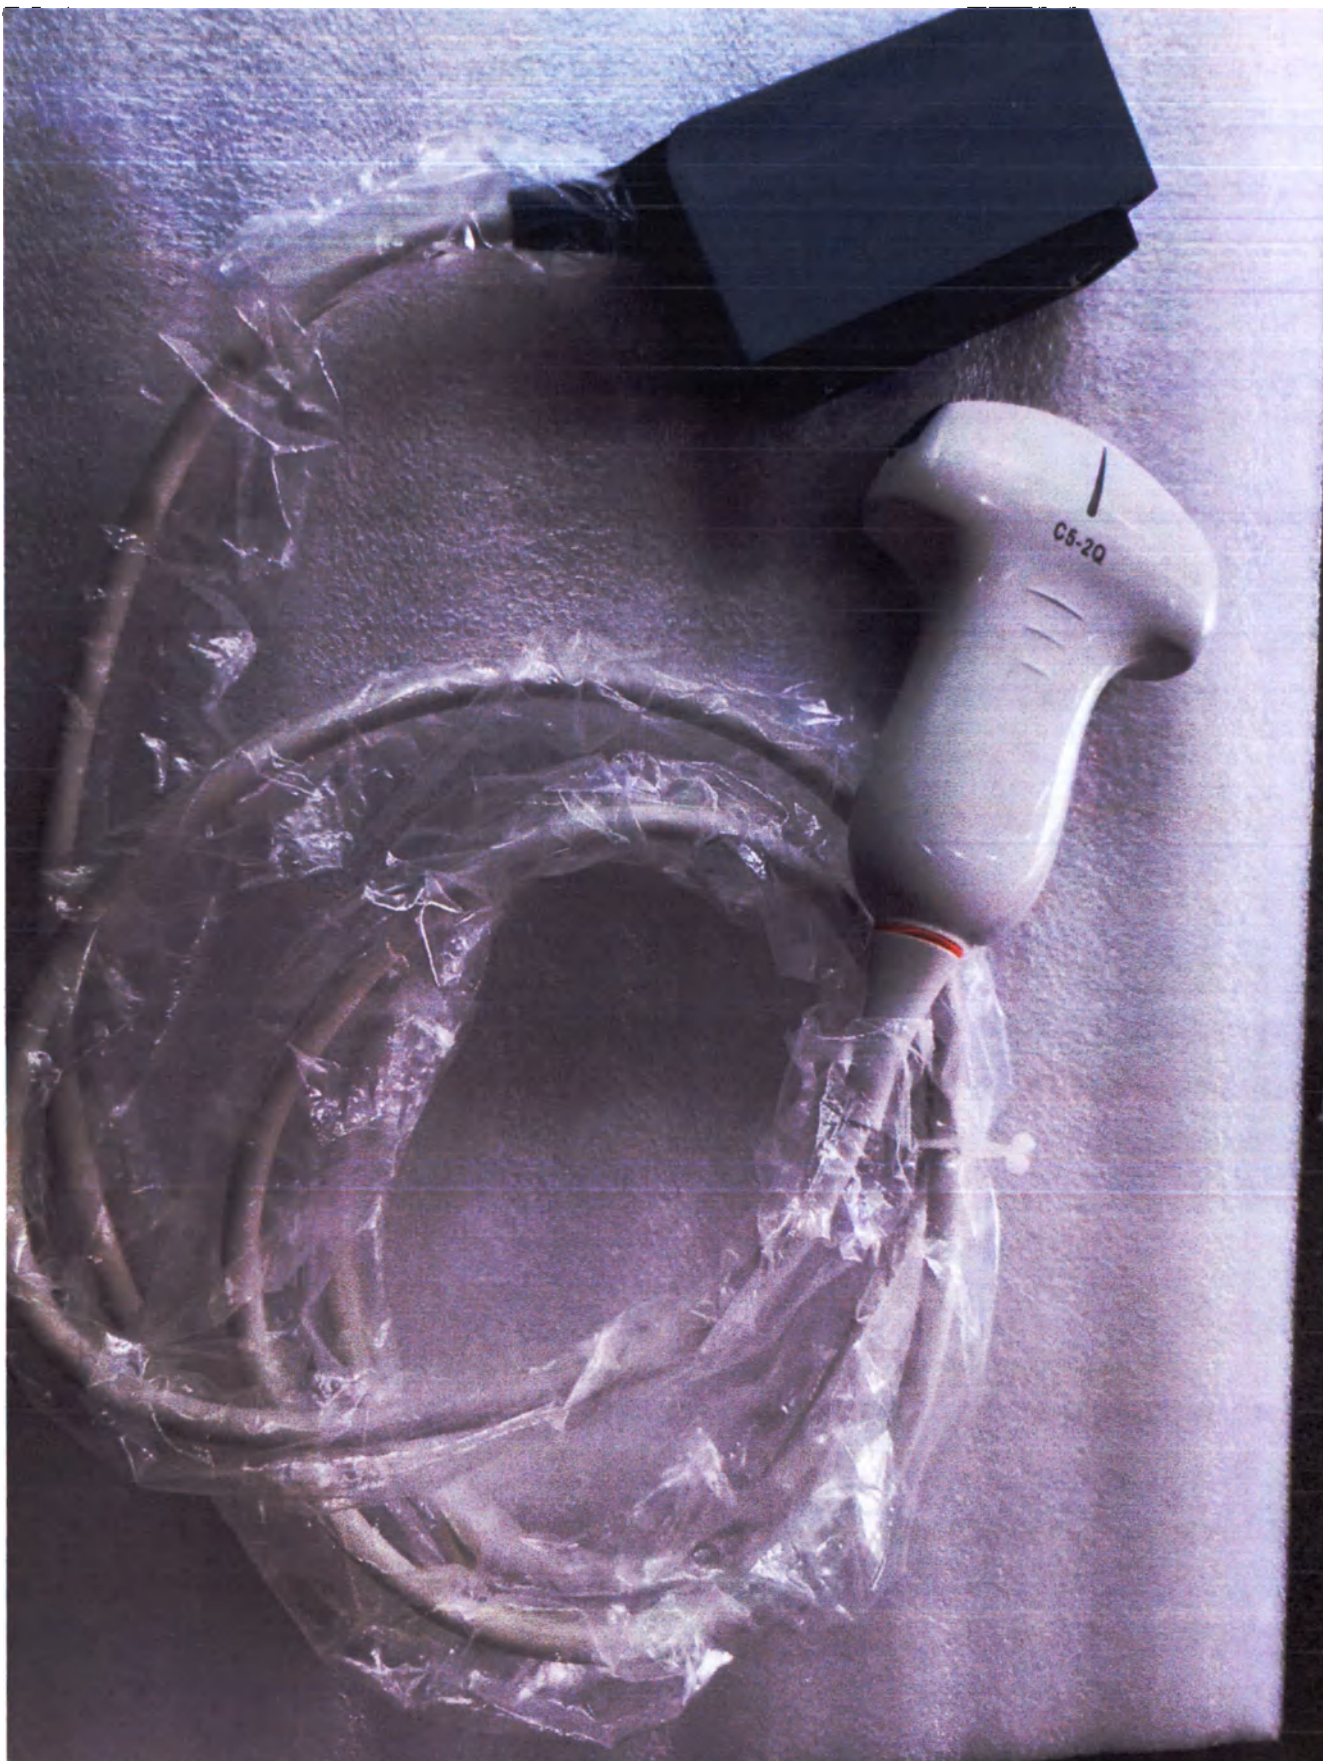


Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q



Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ




Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q

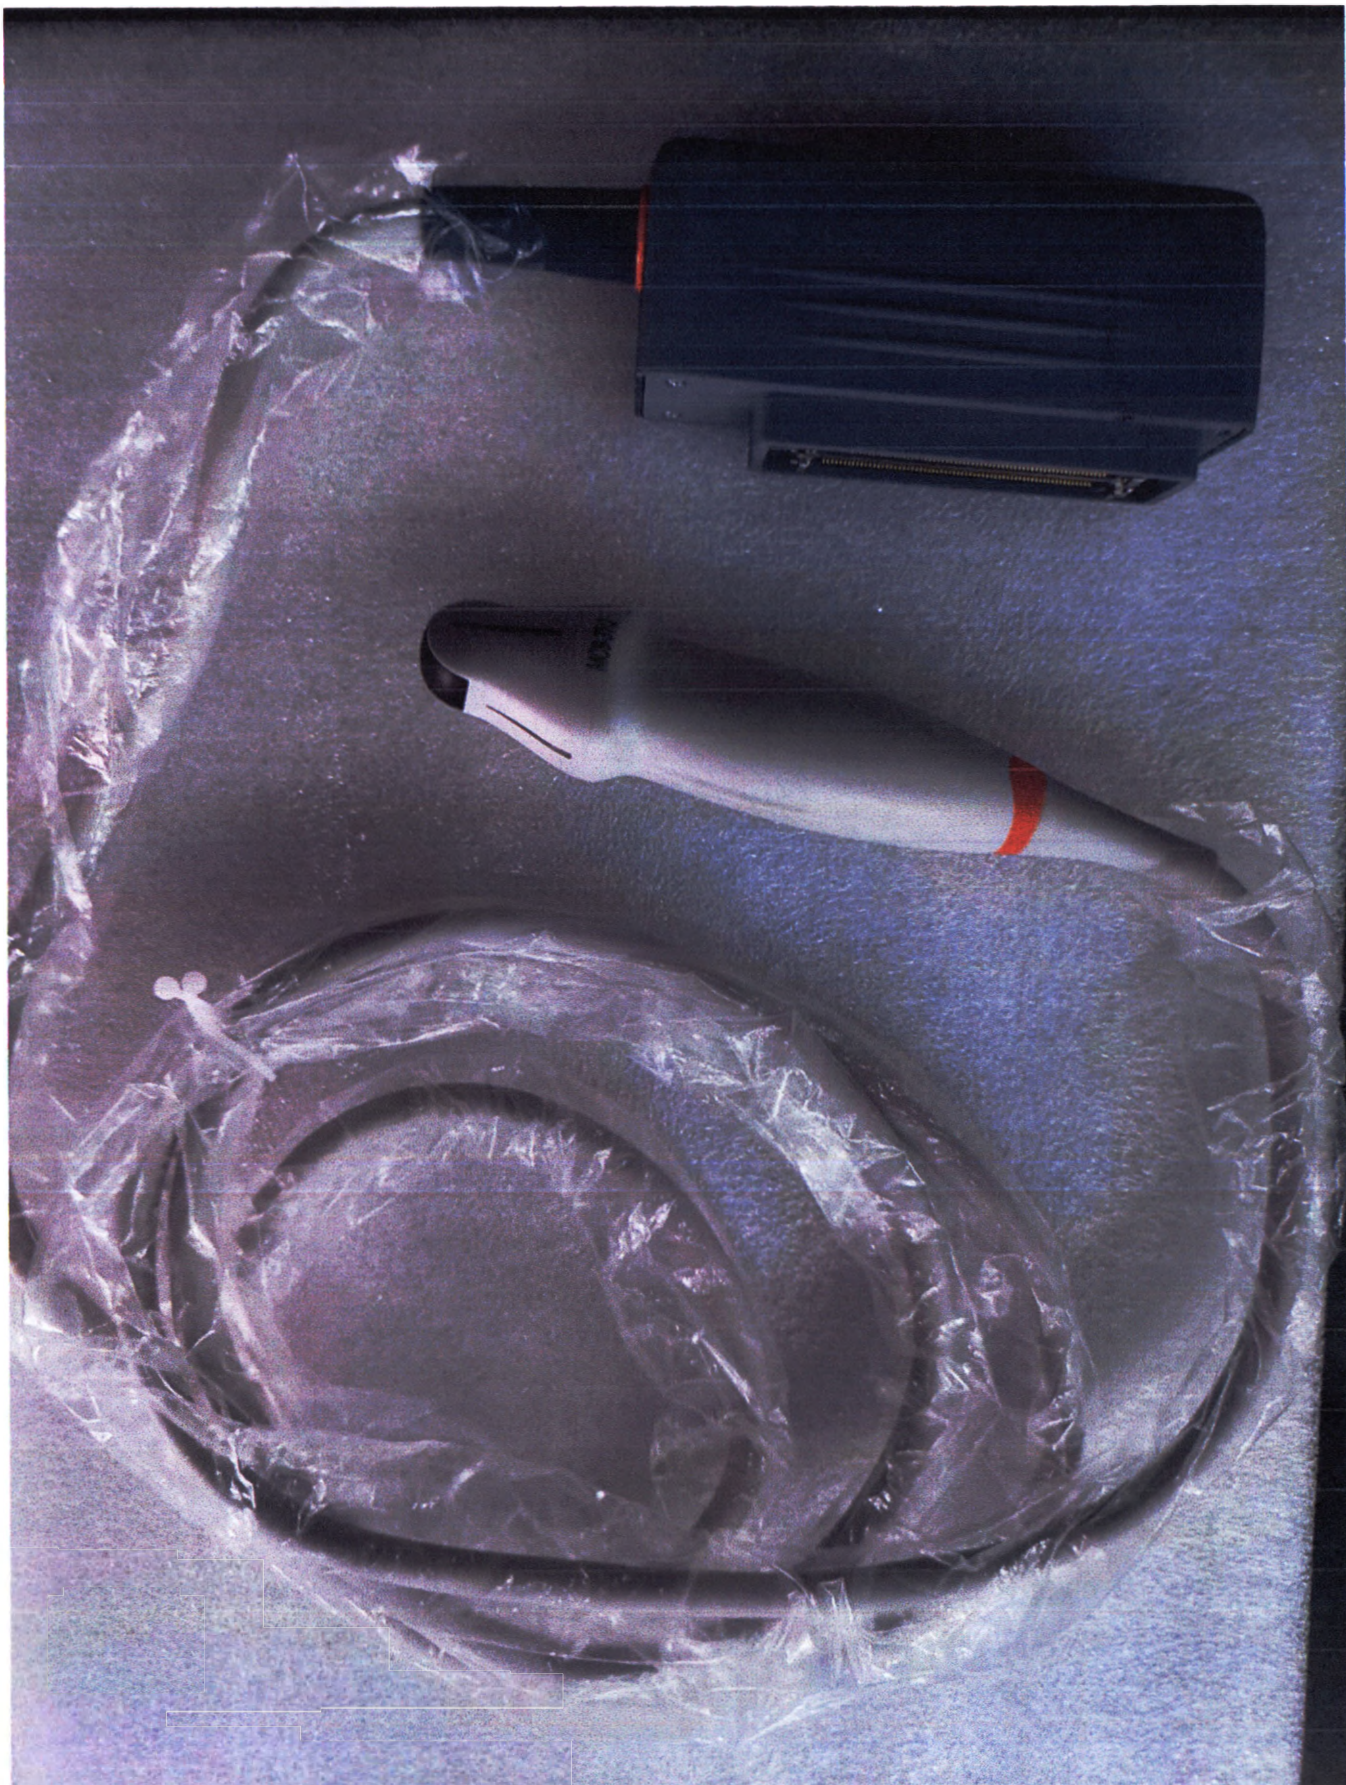


Датчик микро-конвексный ультразвуковой МС9-3ТQ



Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q

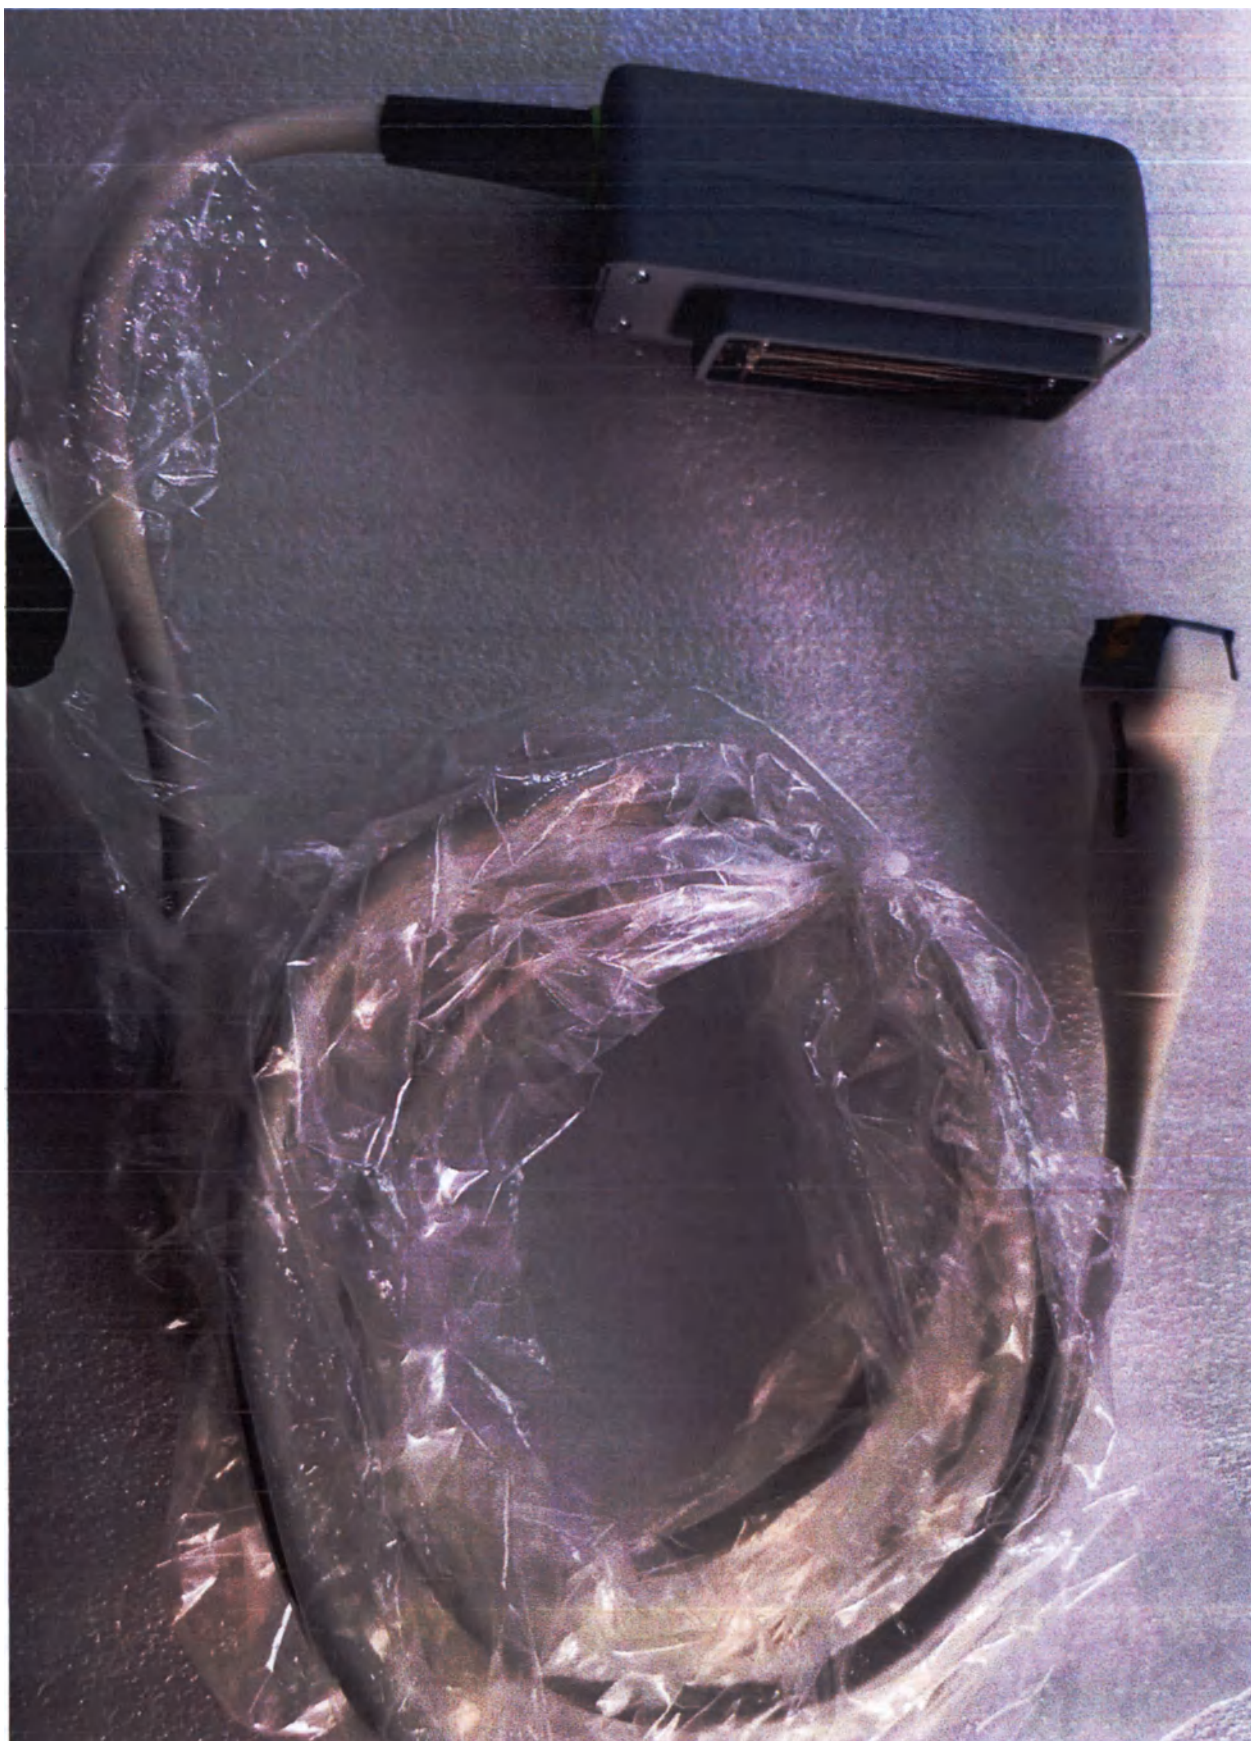

Датчик фазированный ультразвуковой Р7-3Q

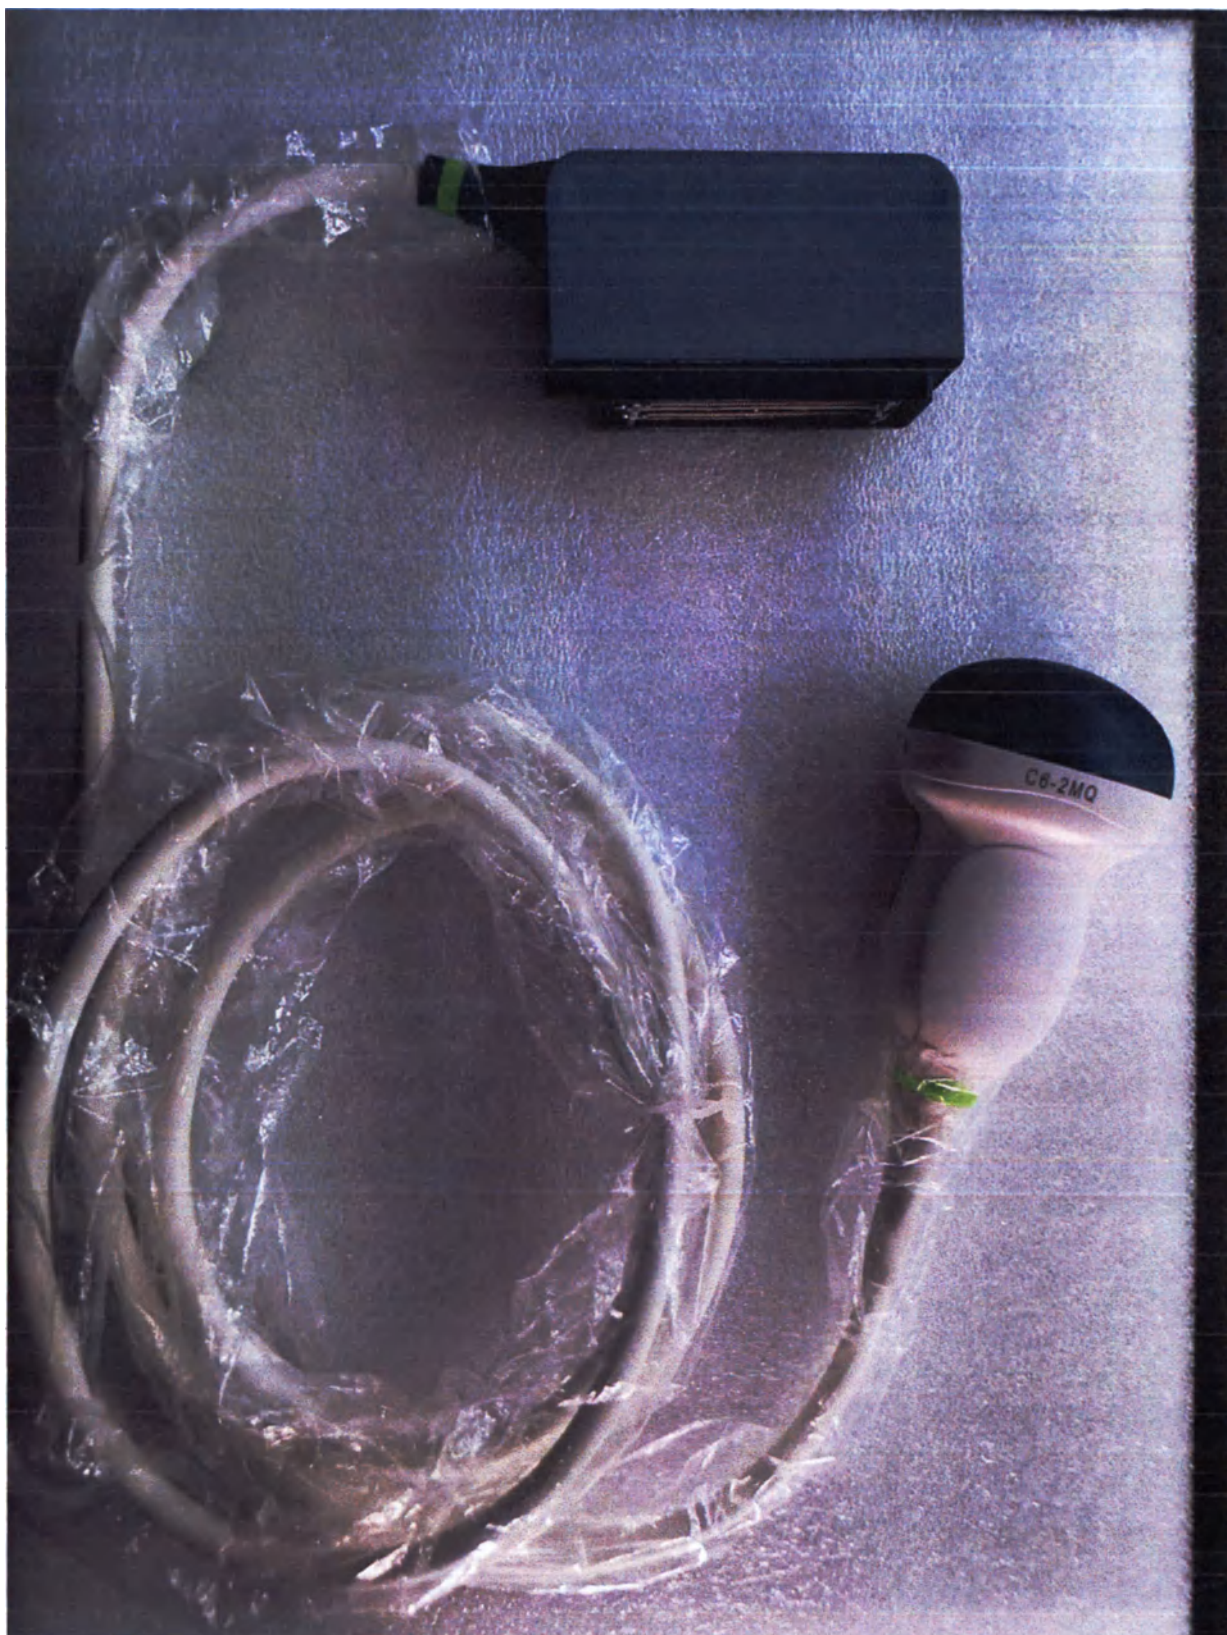

Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ




Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q



Насадка биопсийная BGK-C5-2



Насадка биопсийная BGK-CR10UA

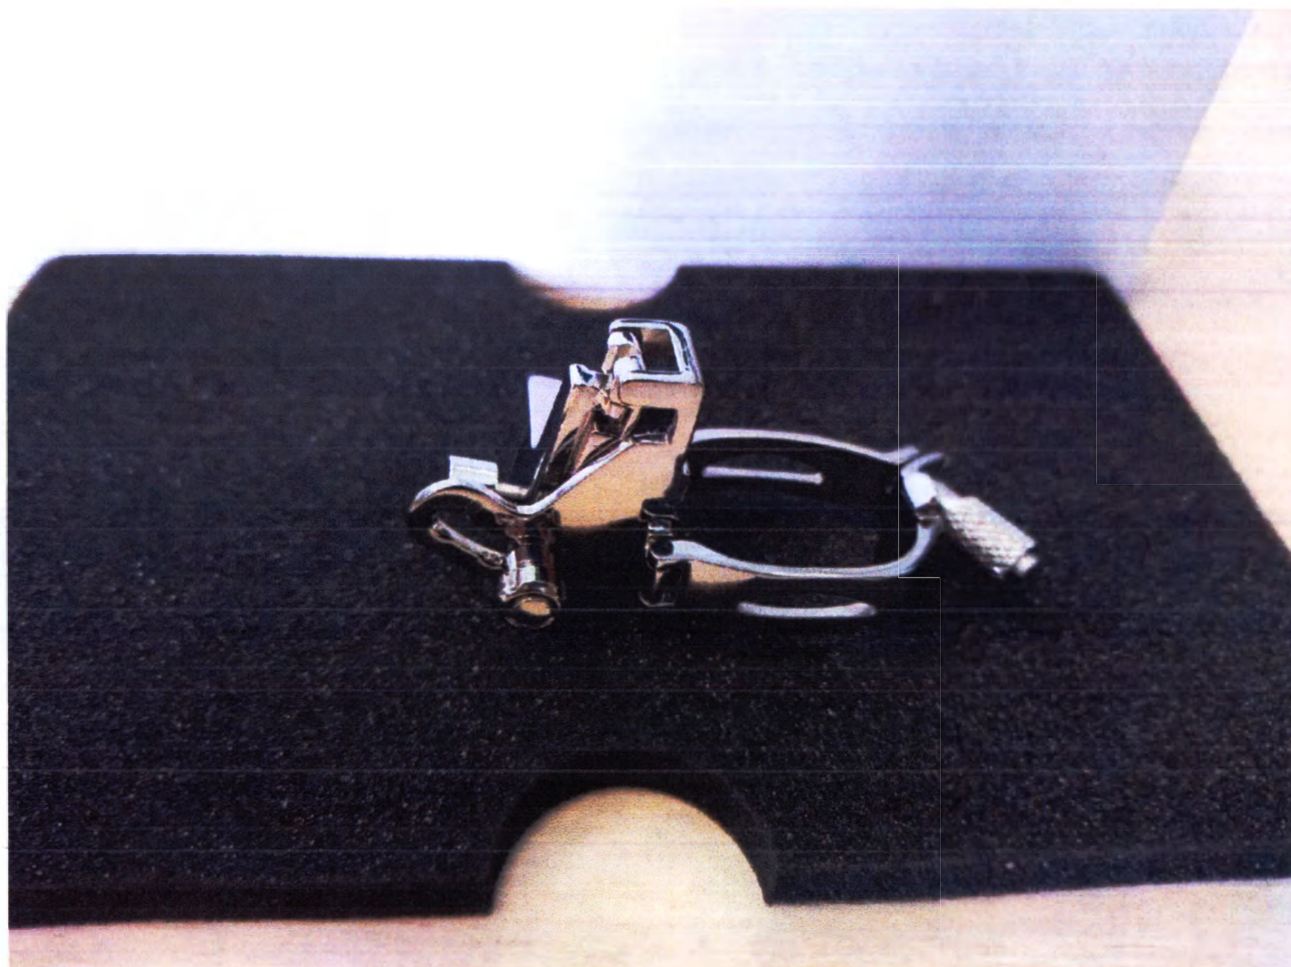


Насадка биопсийная BGK-R15UB




Насадка биопсийная BGK-002




Насадка биопсийная BGK-003

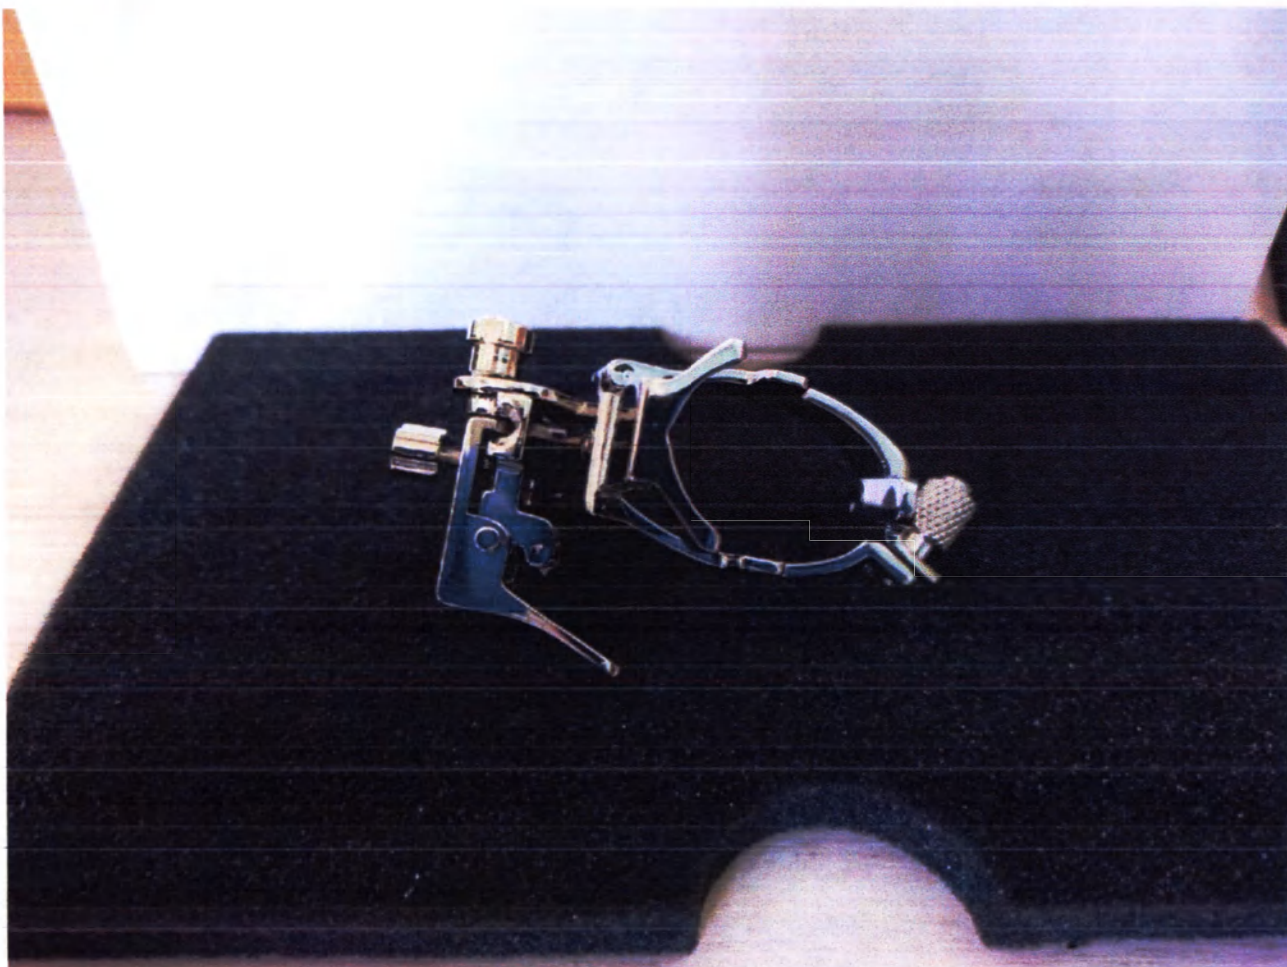


Насадка биопсийная BGK-004

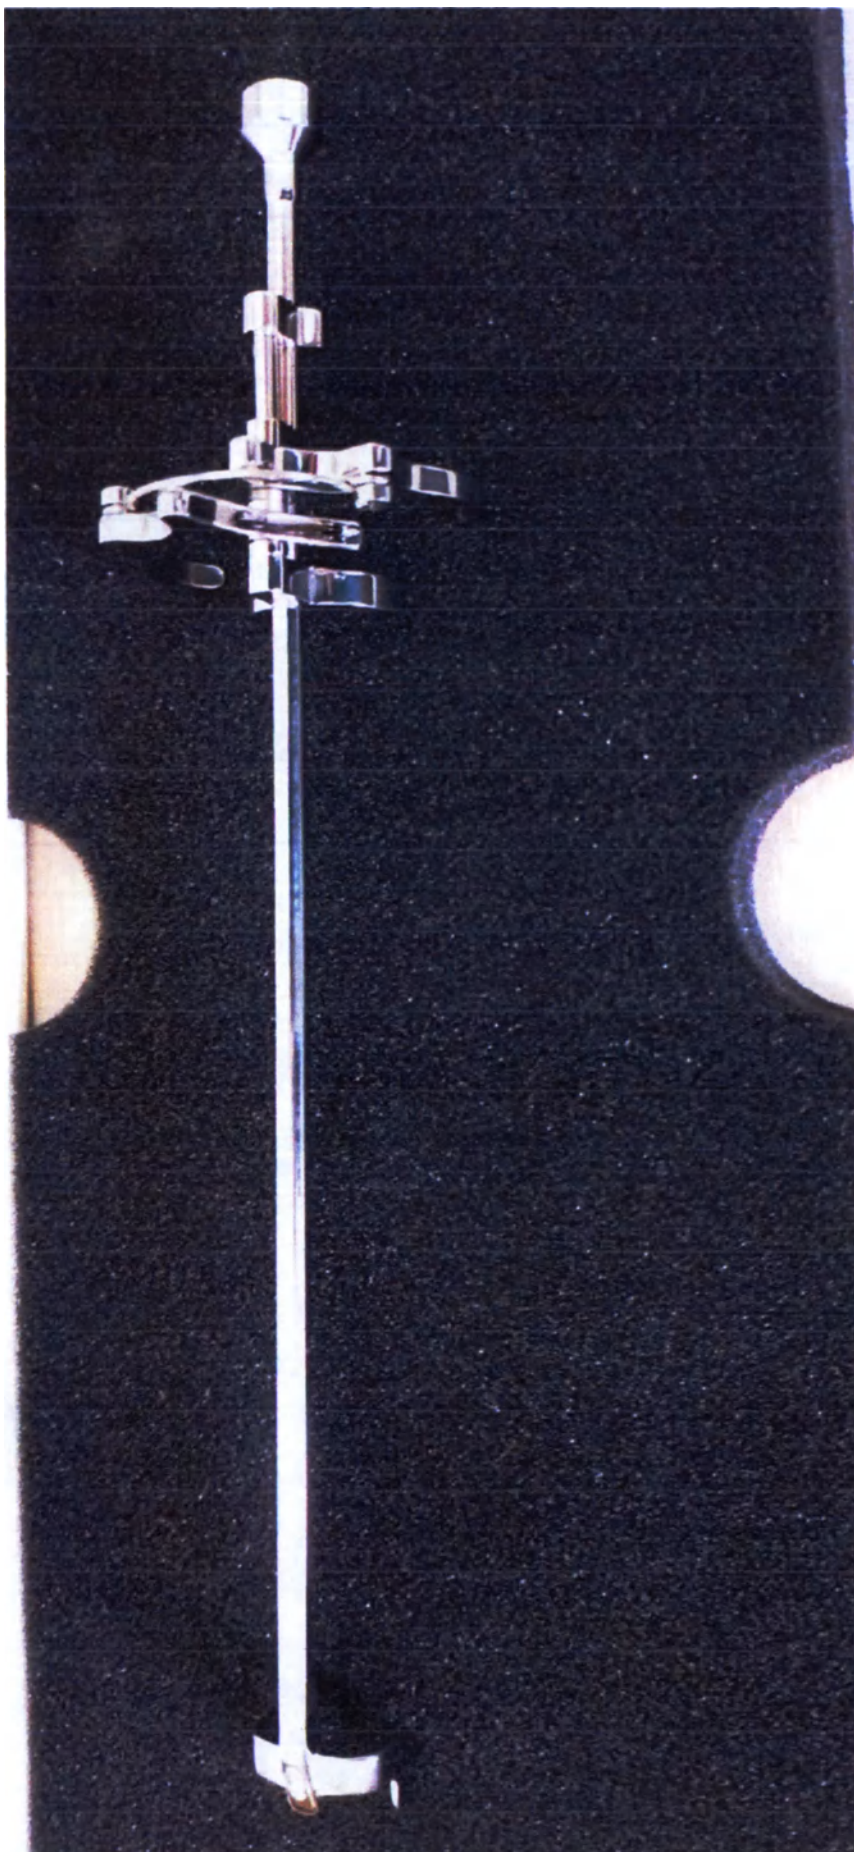


Насадка биопсийная BGK-005

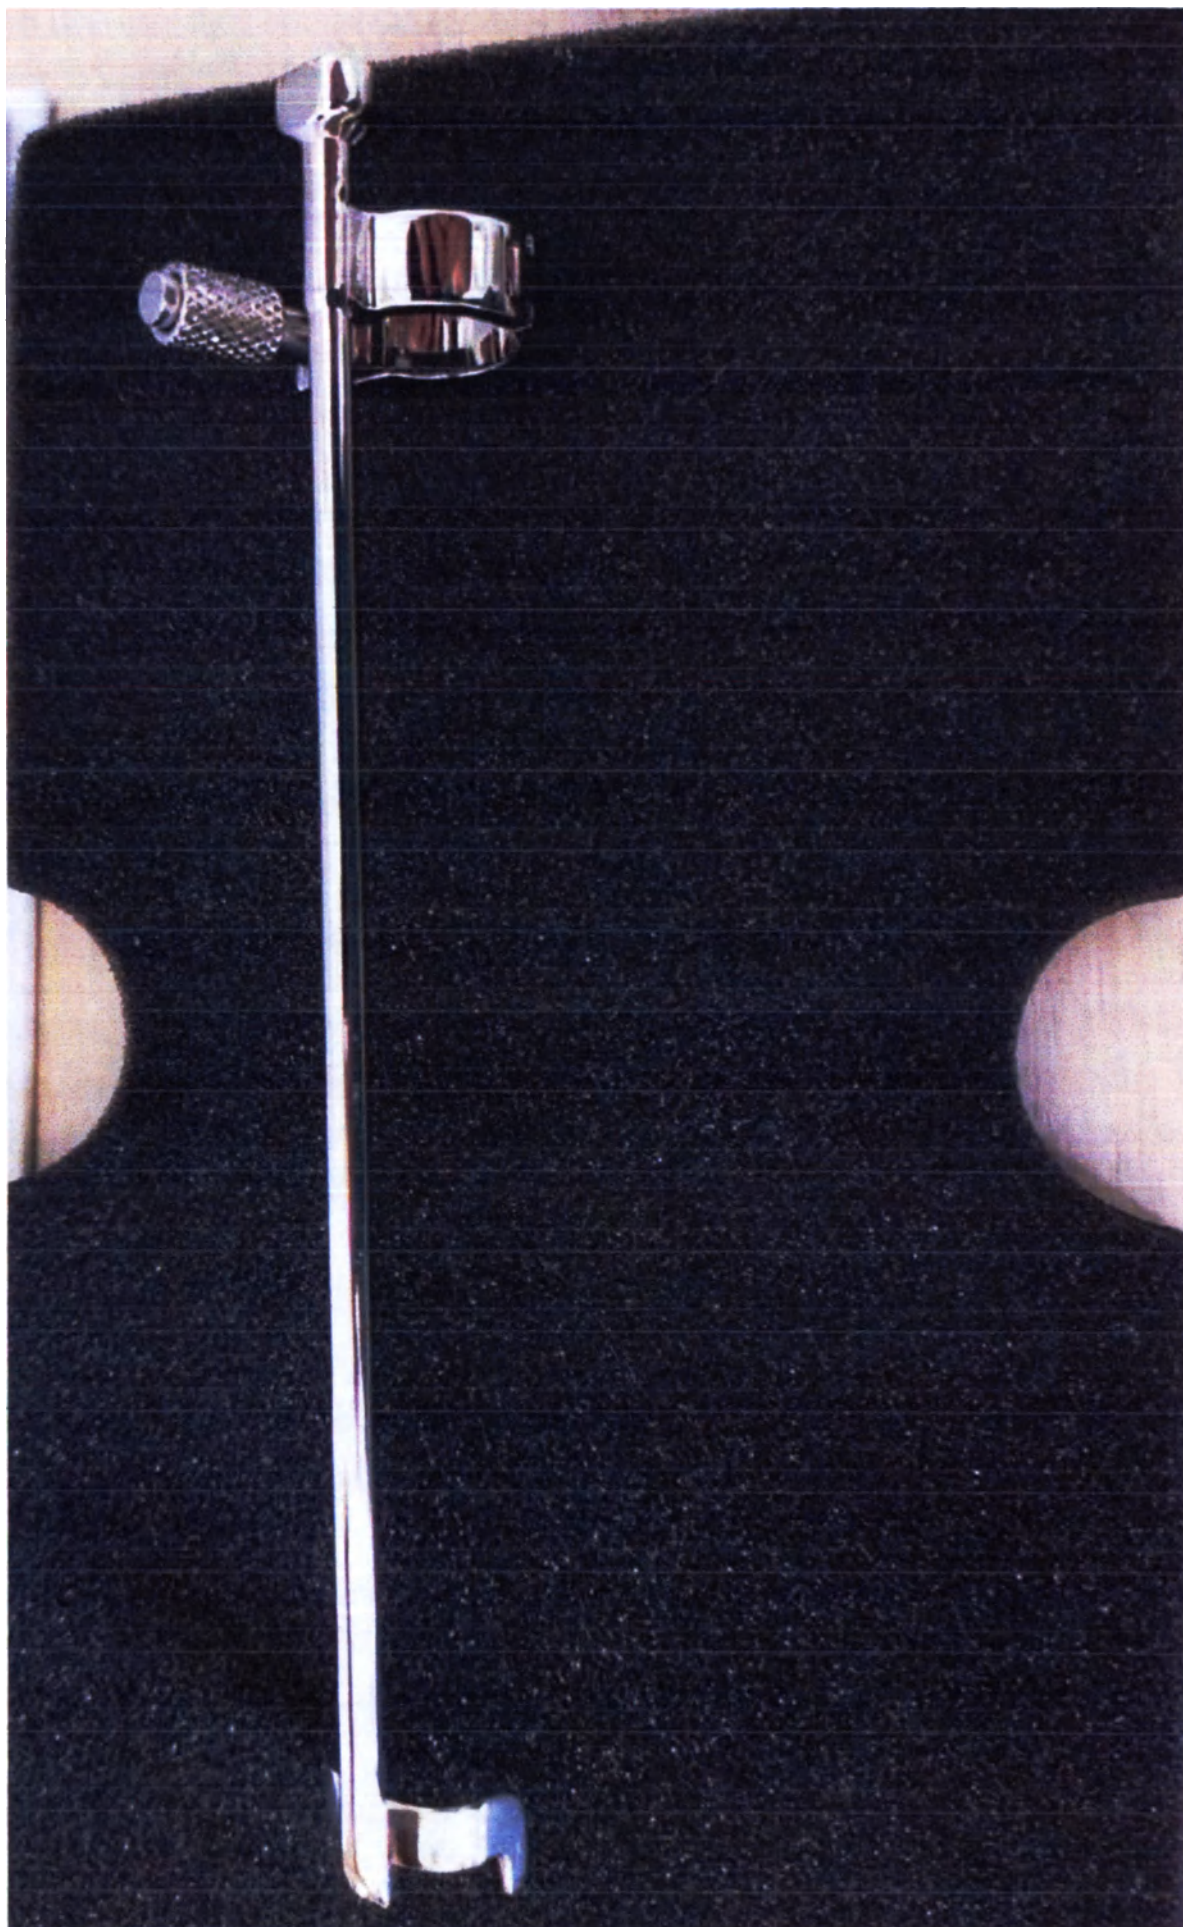

Насадка биопсийная BGK-006

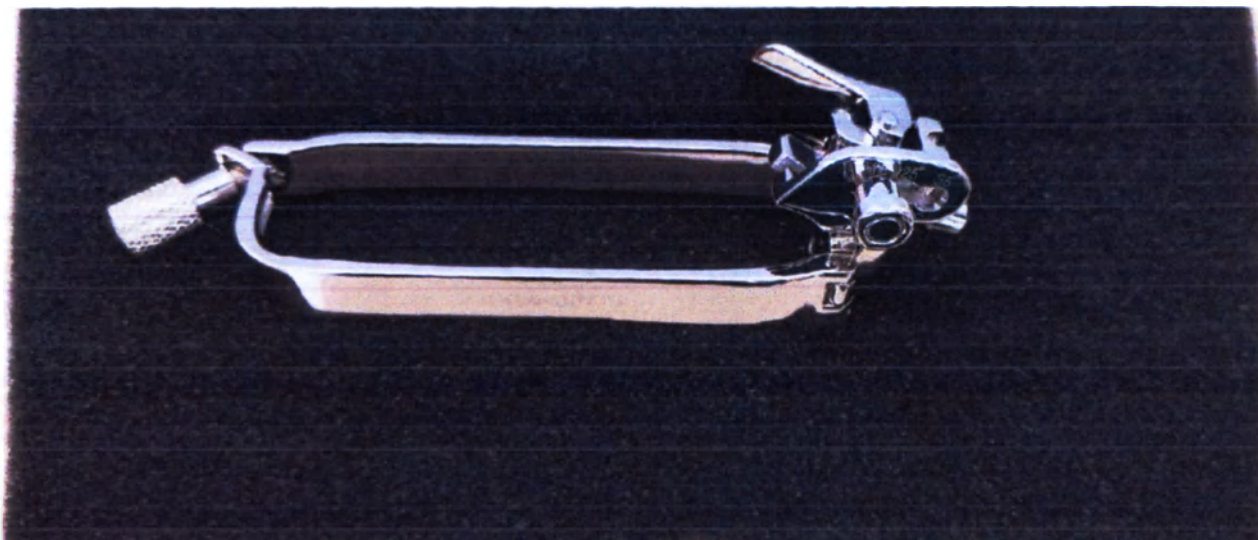


Насадка биопсийная BGK-007

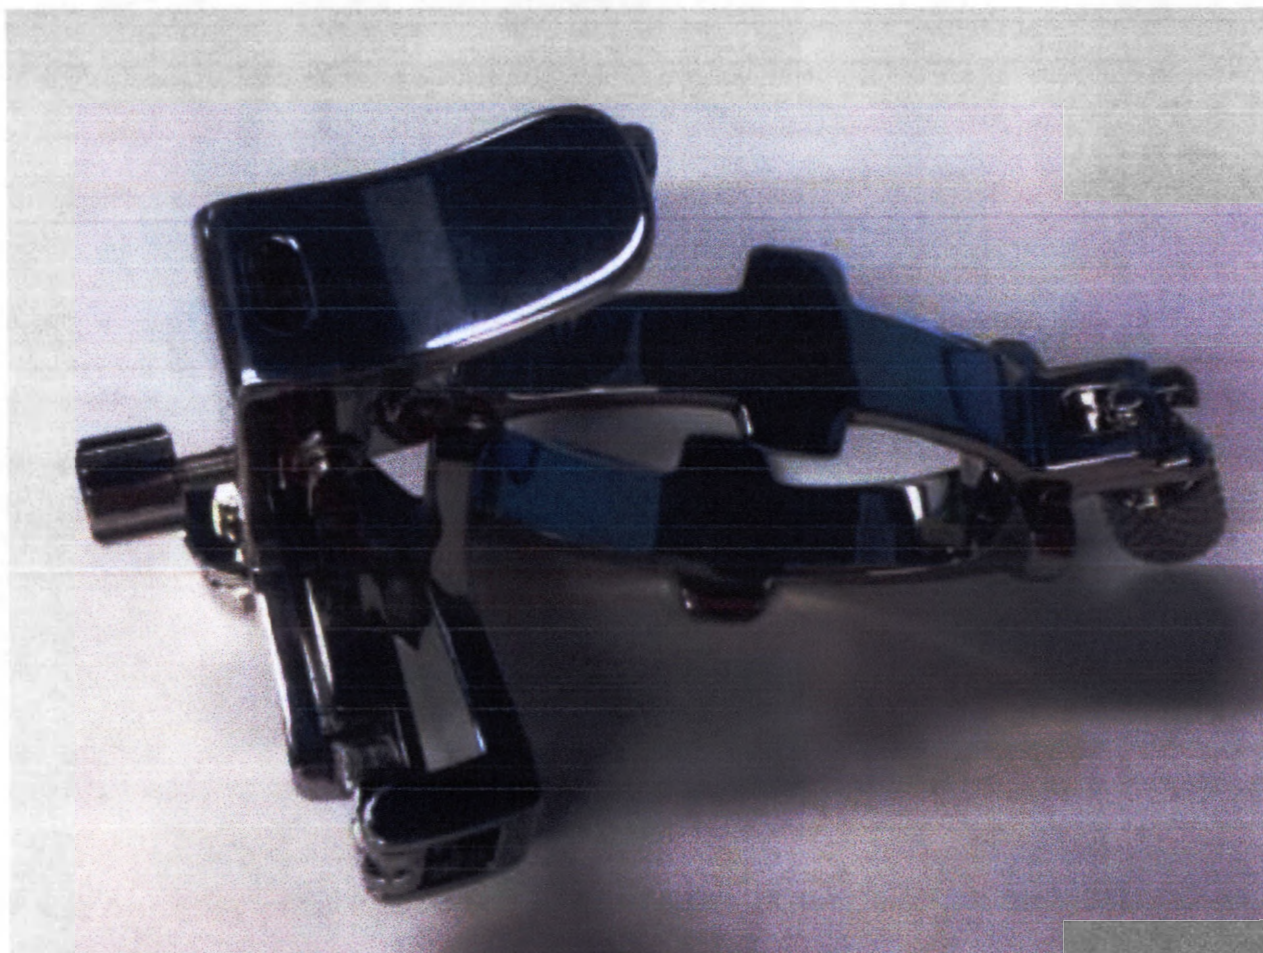


Насадка биопсийная BGK-008




Насадка биопсийная BGK-009

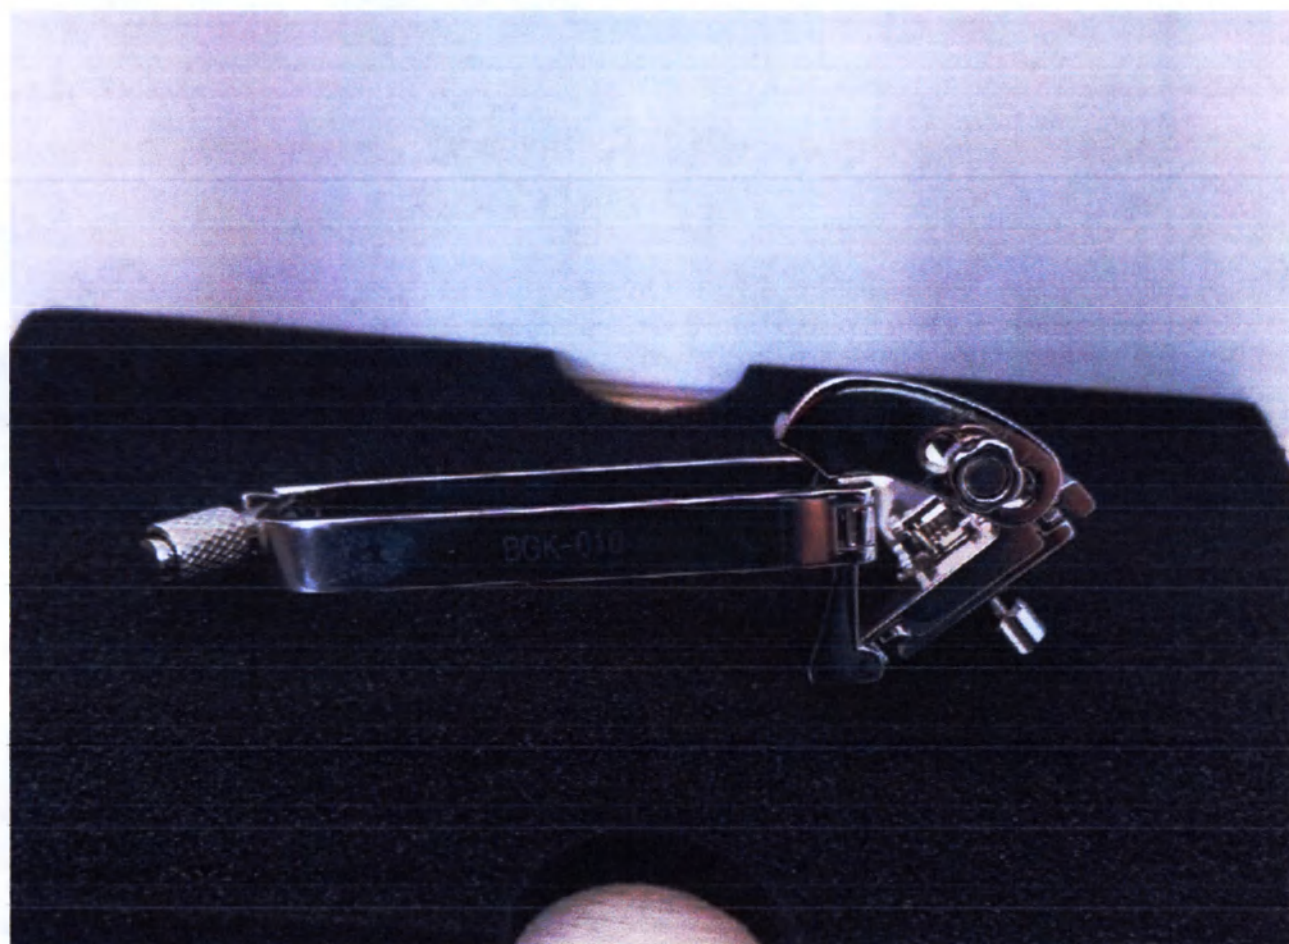

Насадка биопсийная BGK-010

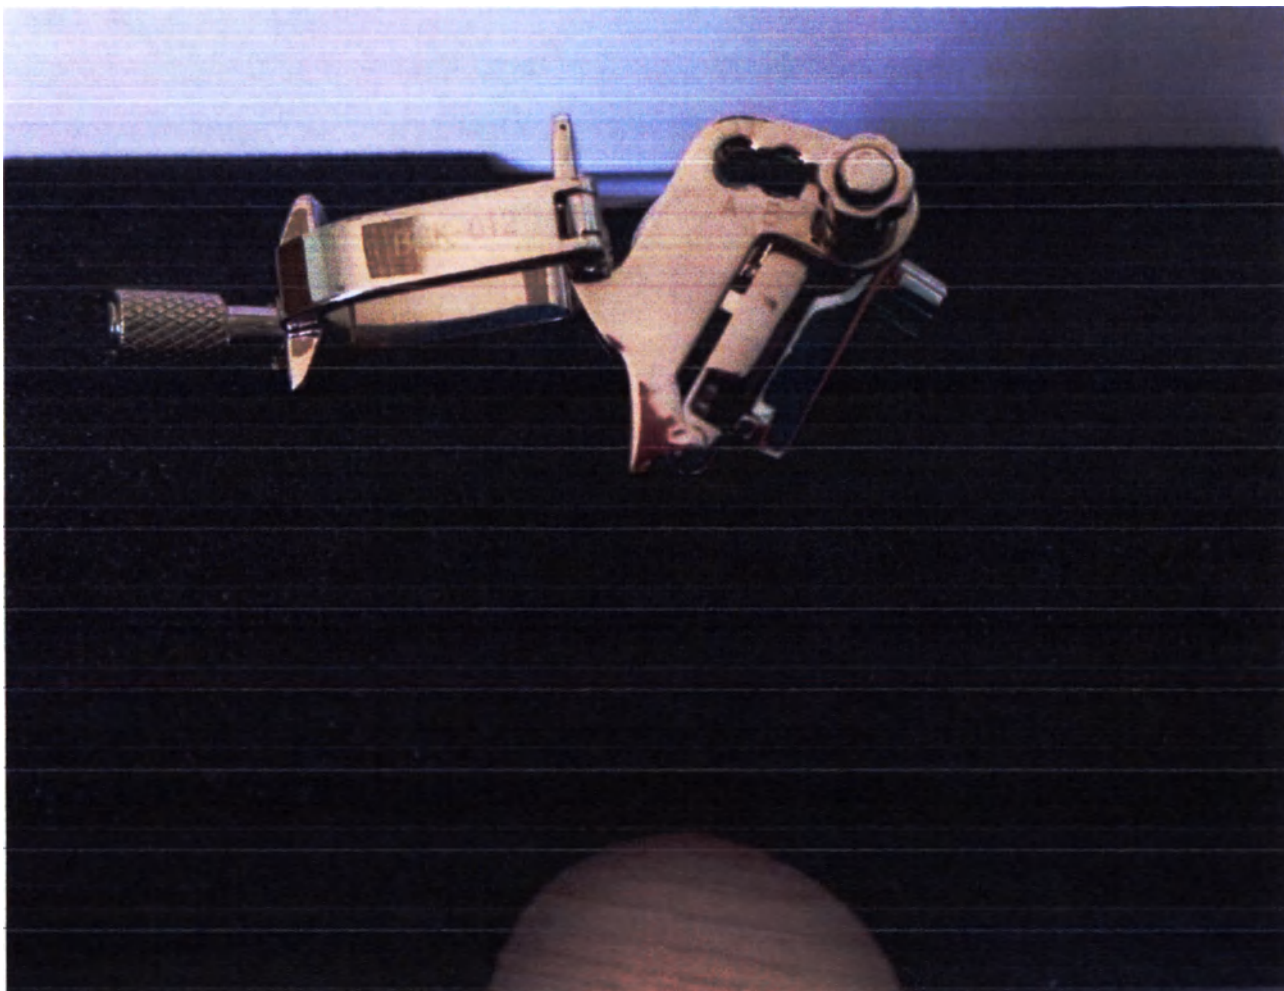

Насадка биопсийная BGK-012

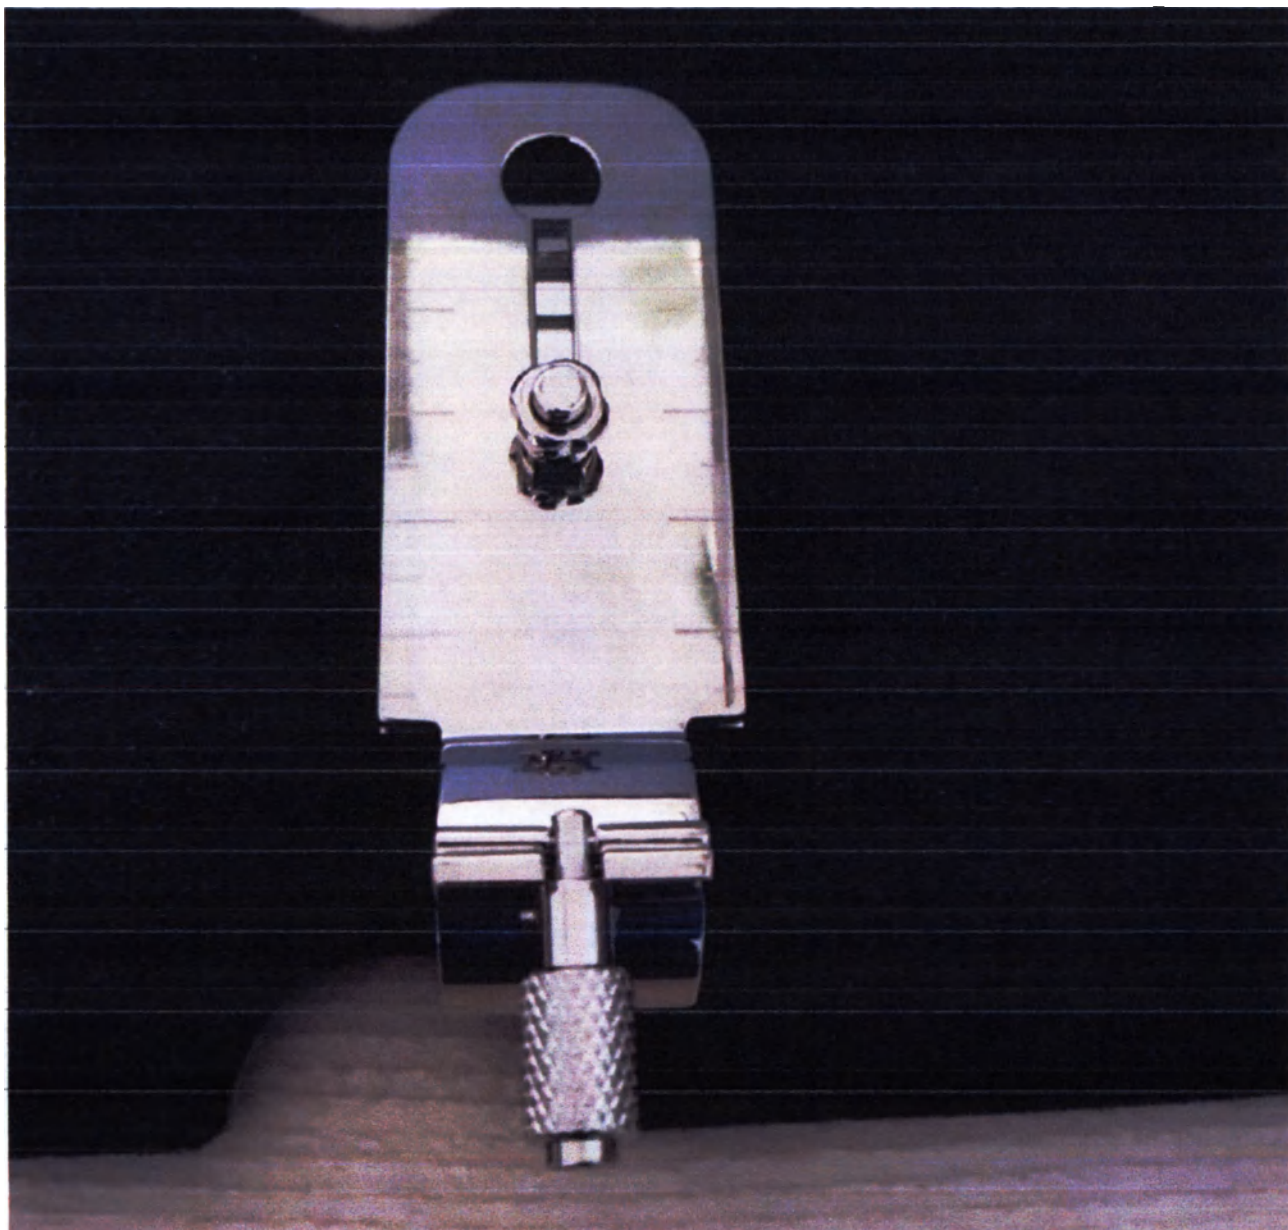


Насадка биопсийная BGK-013 (вид спереди)




Насадка биопсийная BGK-013 (вид сбоку)



ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем

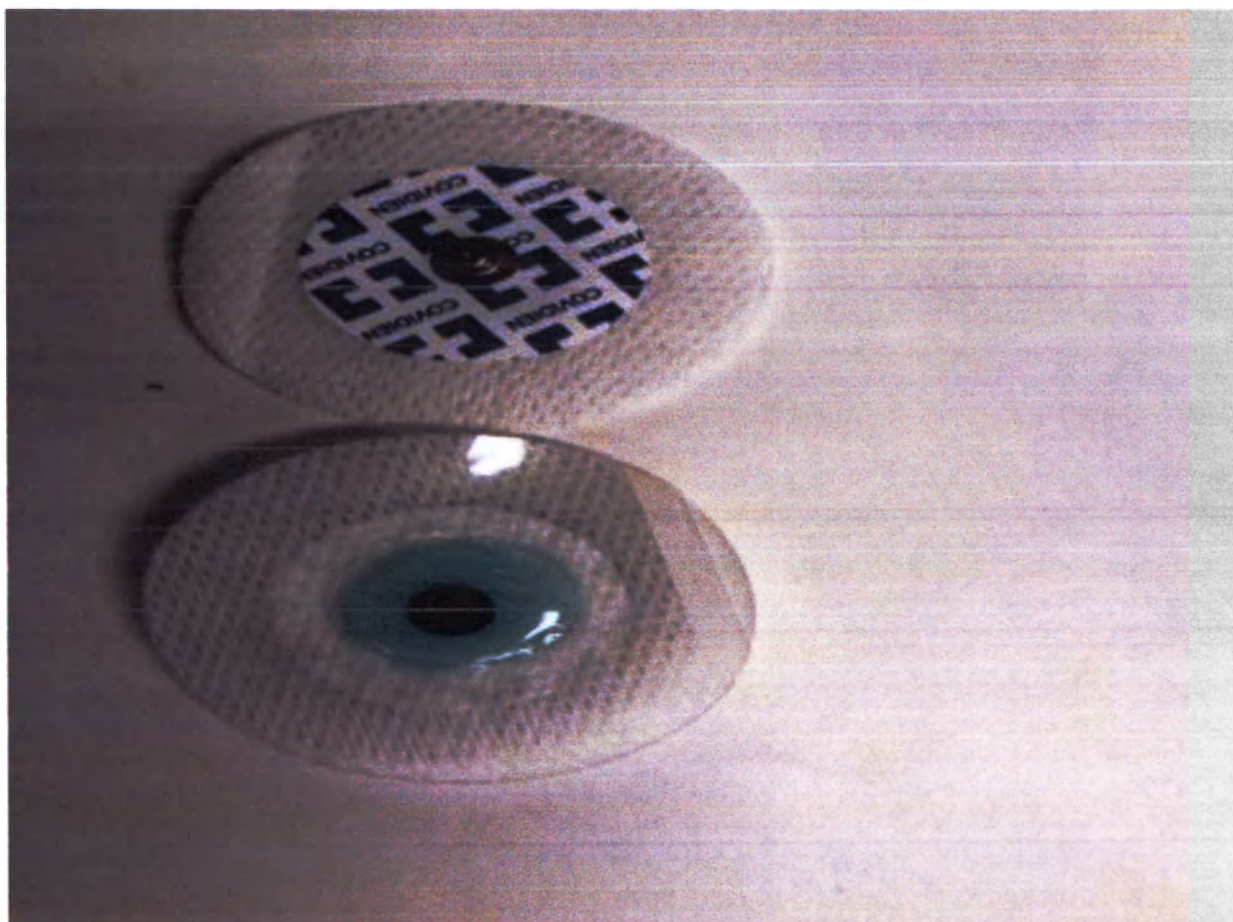


ЭКГ электроды, одноразовые

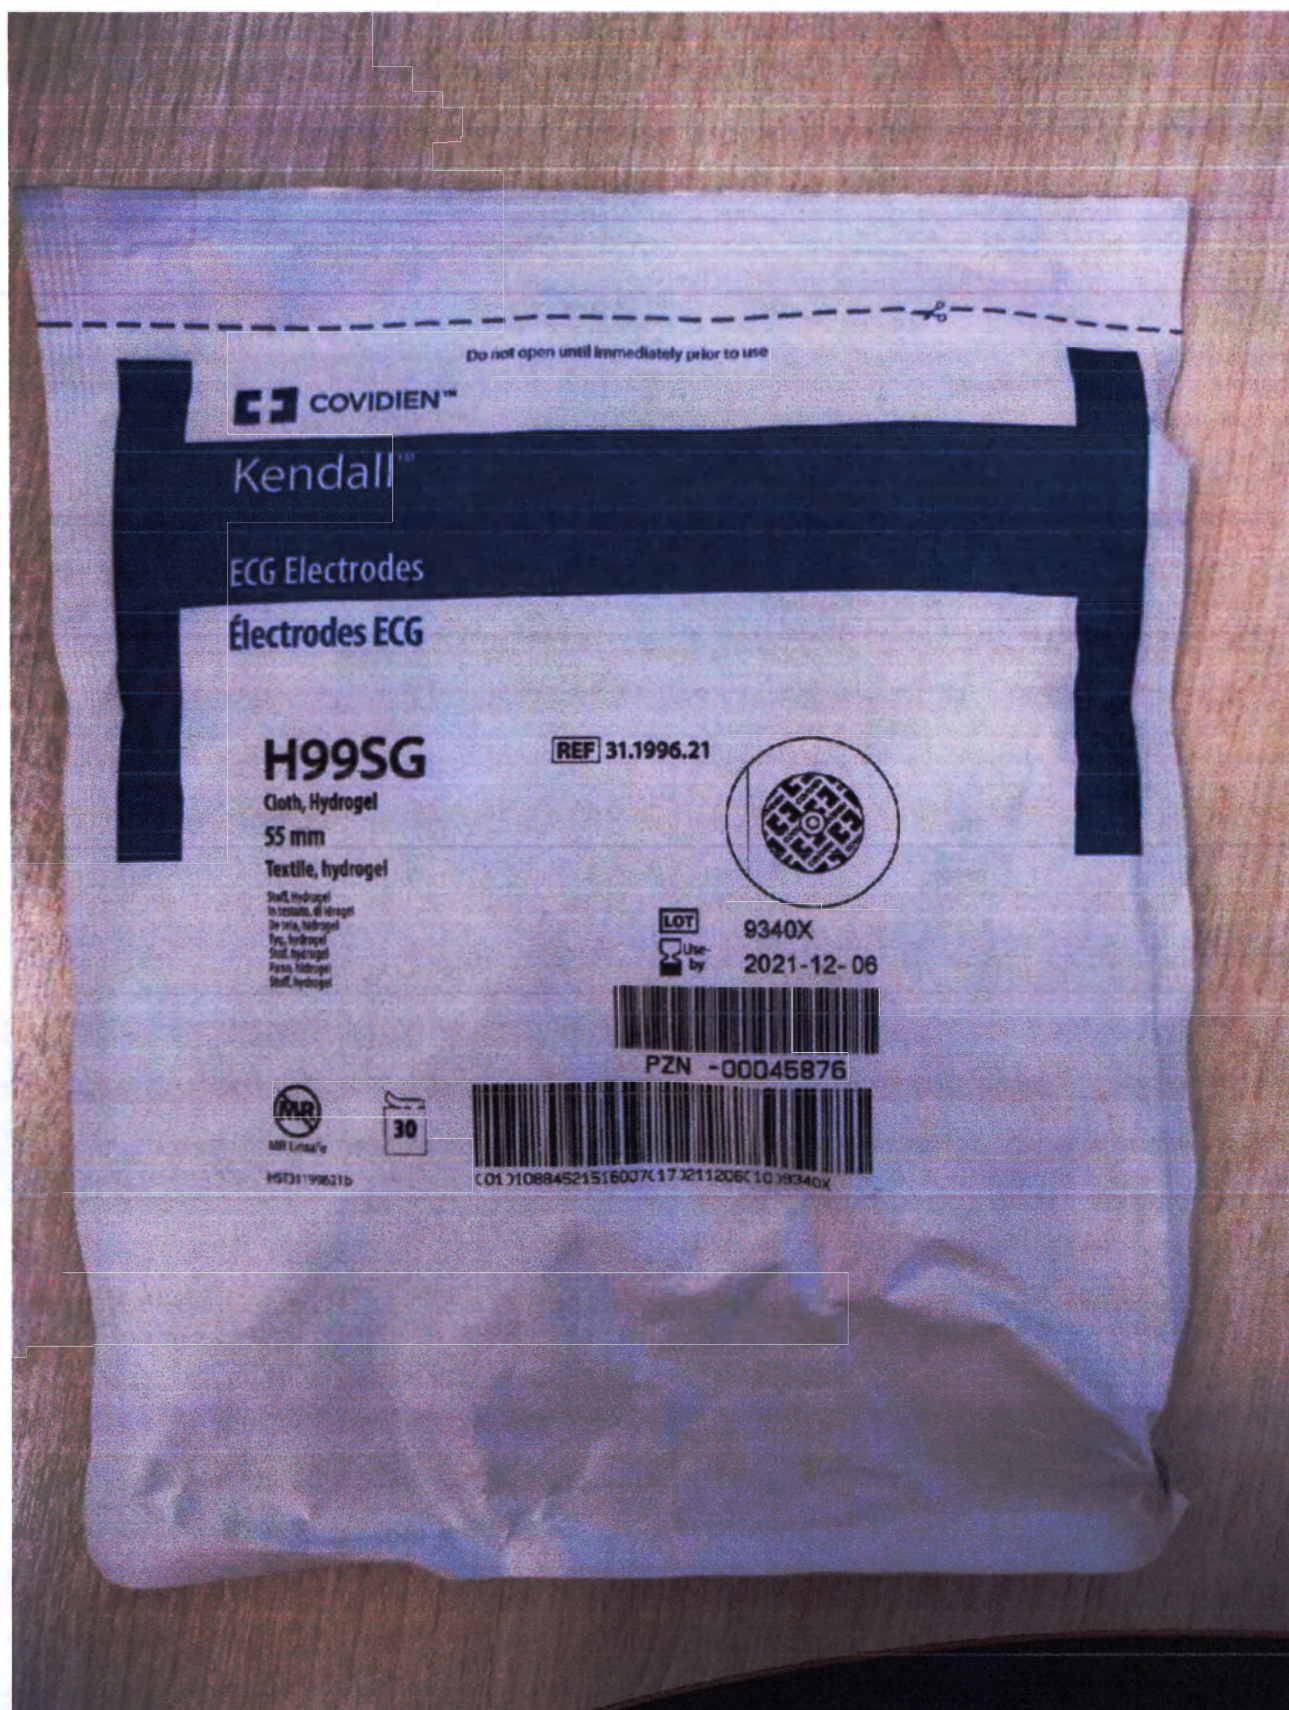

Упаковка ЭКГ электродов одноразовых




Внешний ЭКГ модуль (вид сзади)

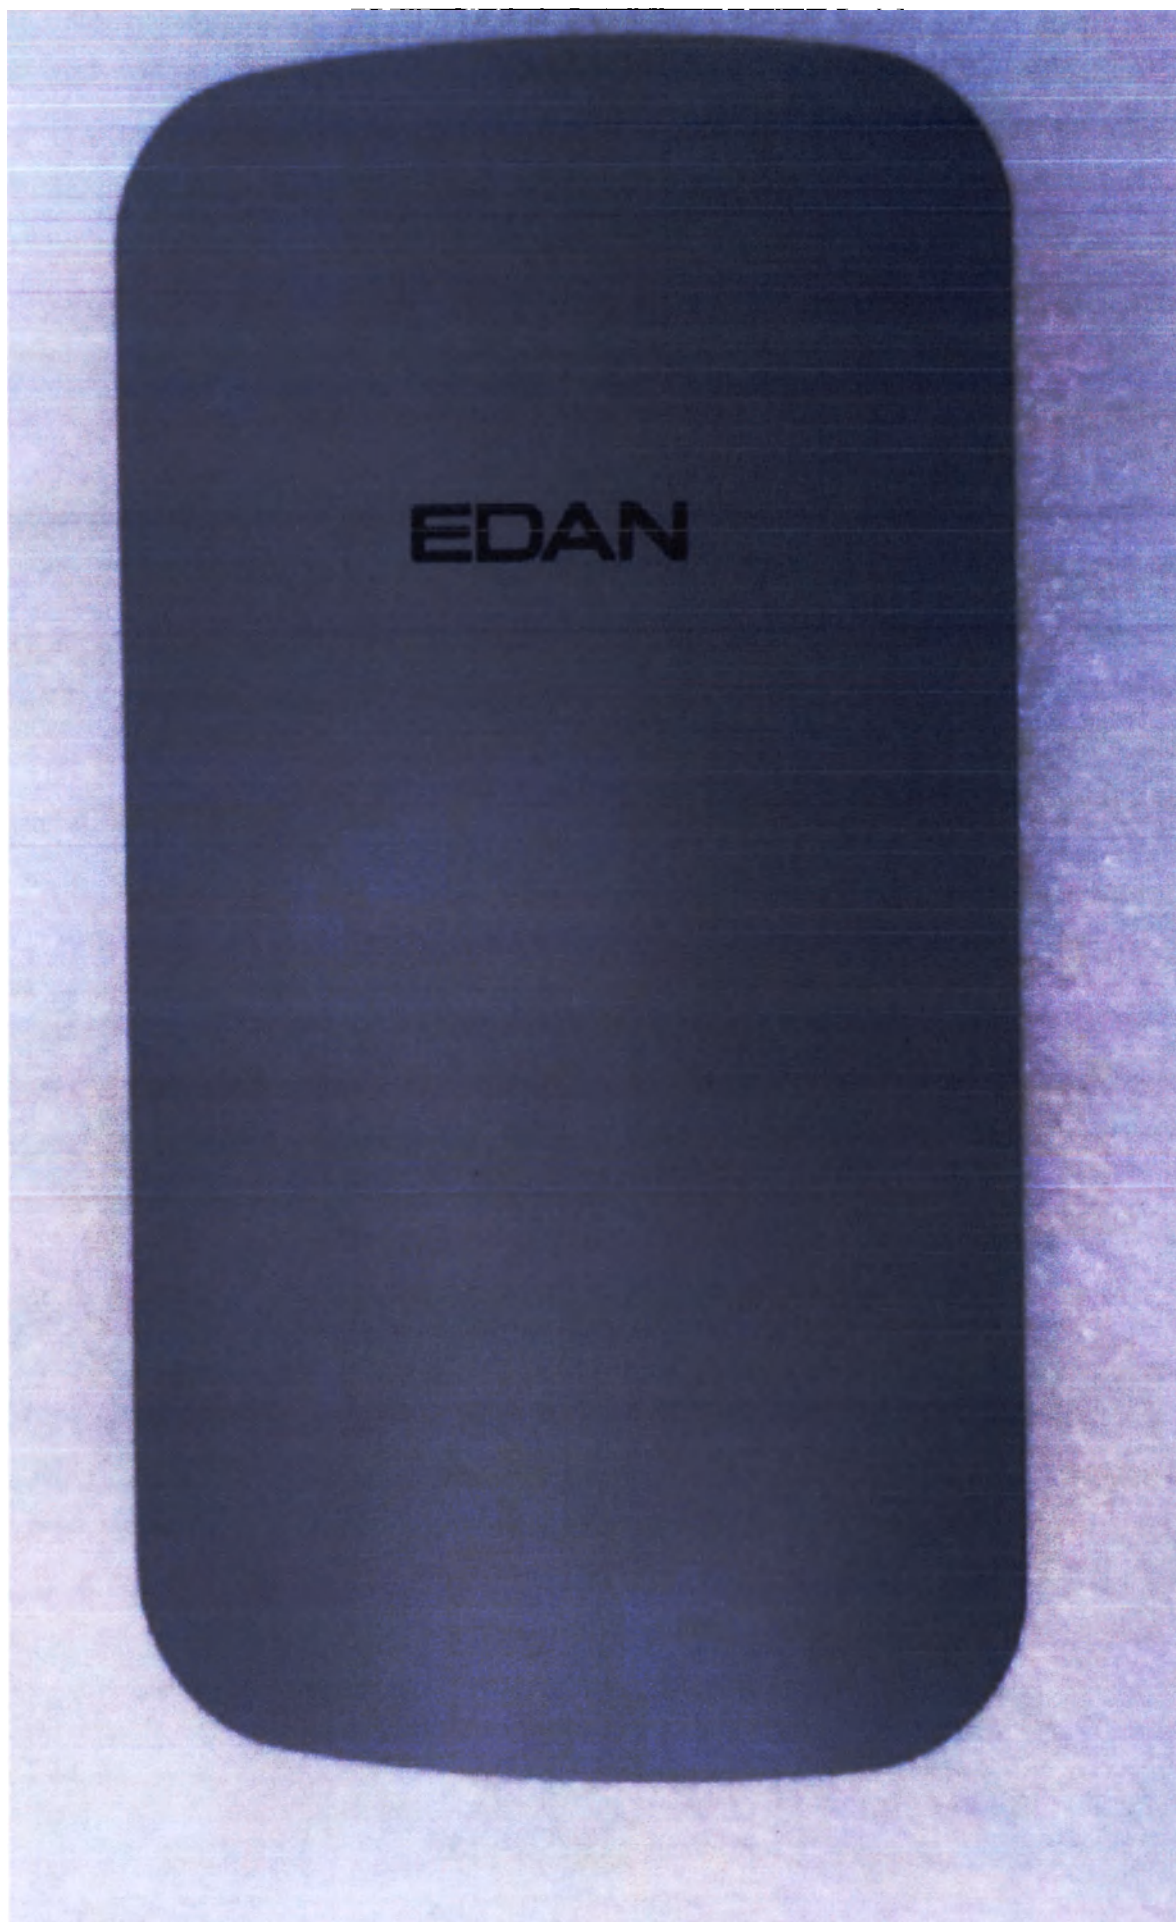


Внешний ЭКГ модуль (вид спереди)




Чехол для внешнего ЭКГ модуля

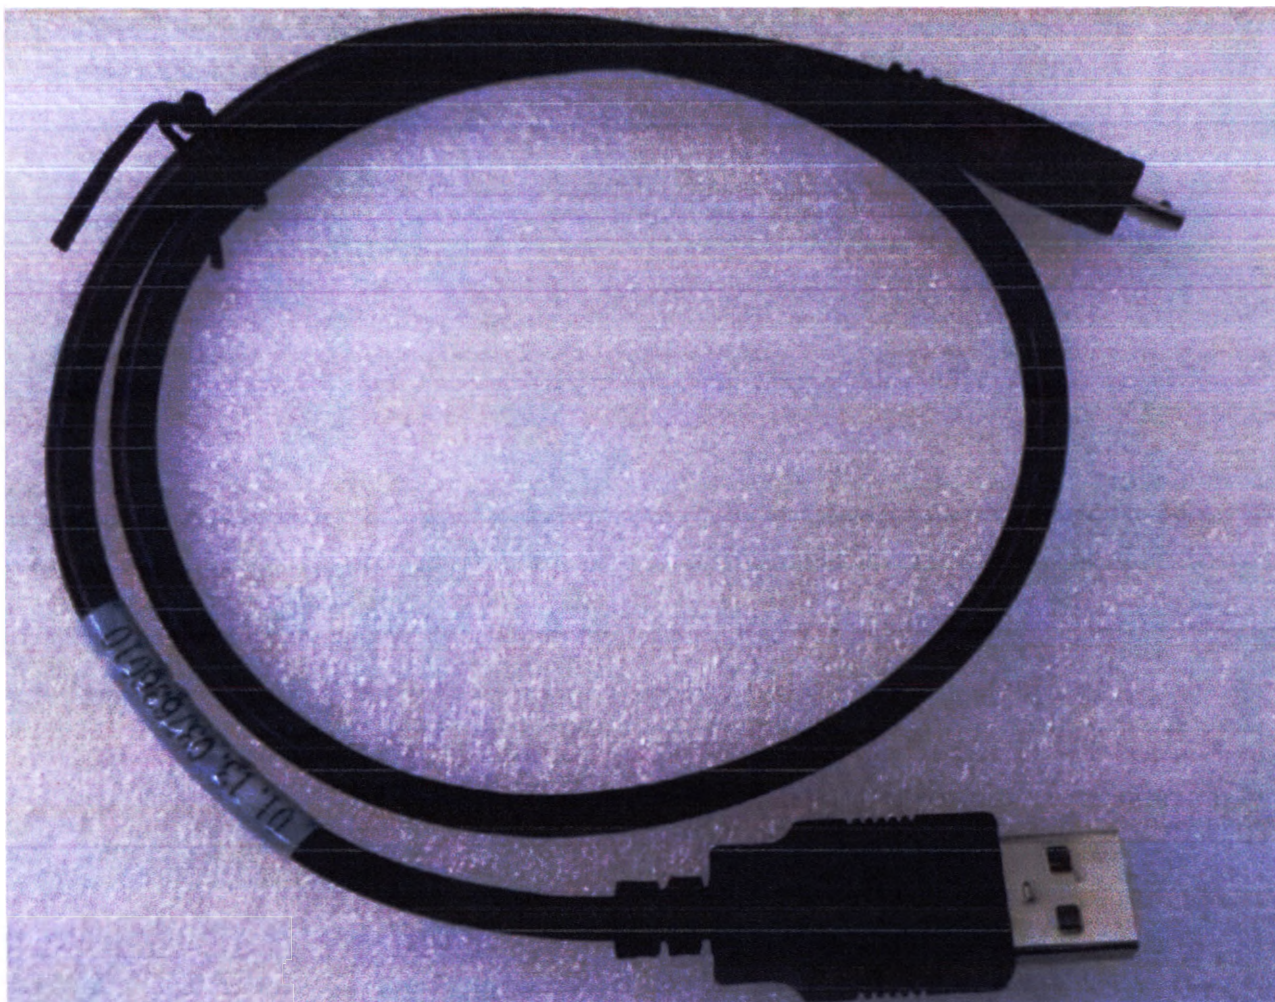

Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой

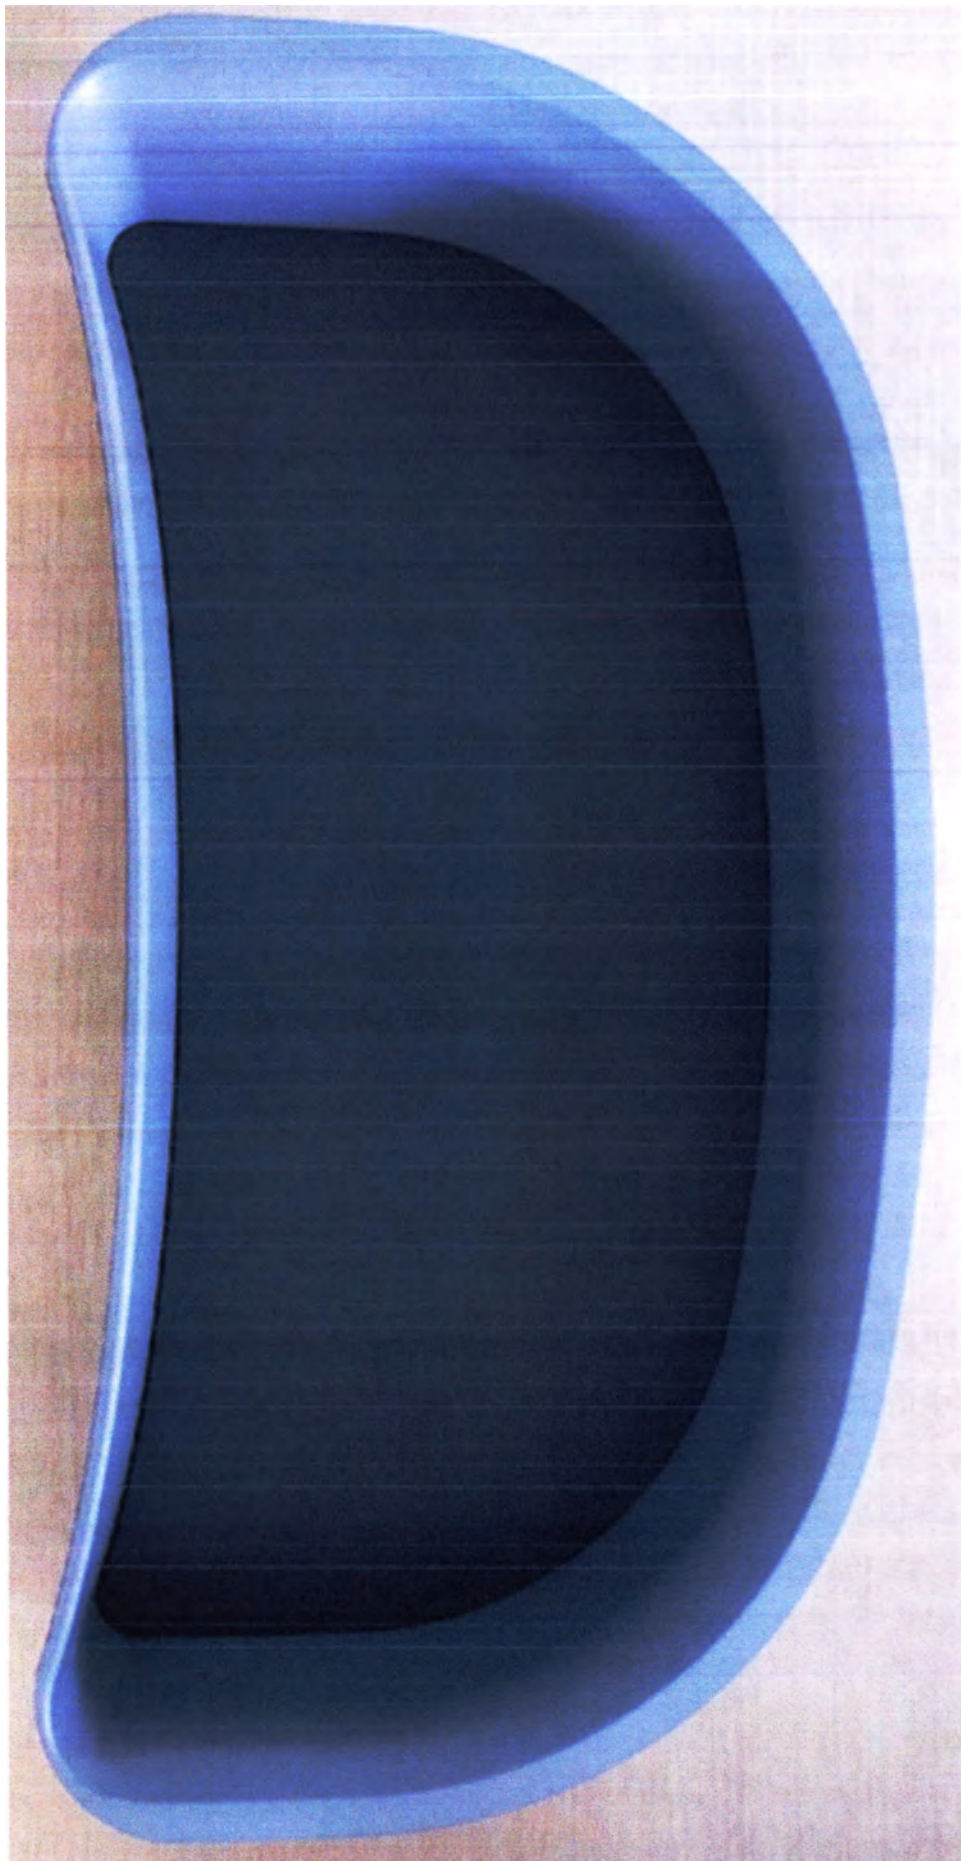

Лоток для принадлежностей

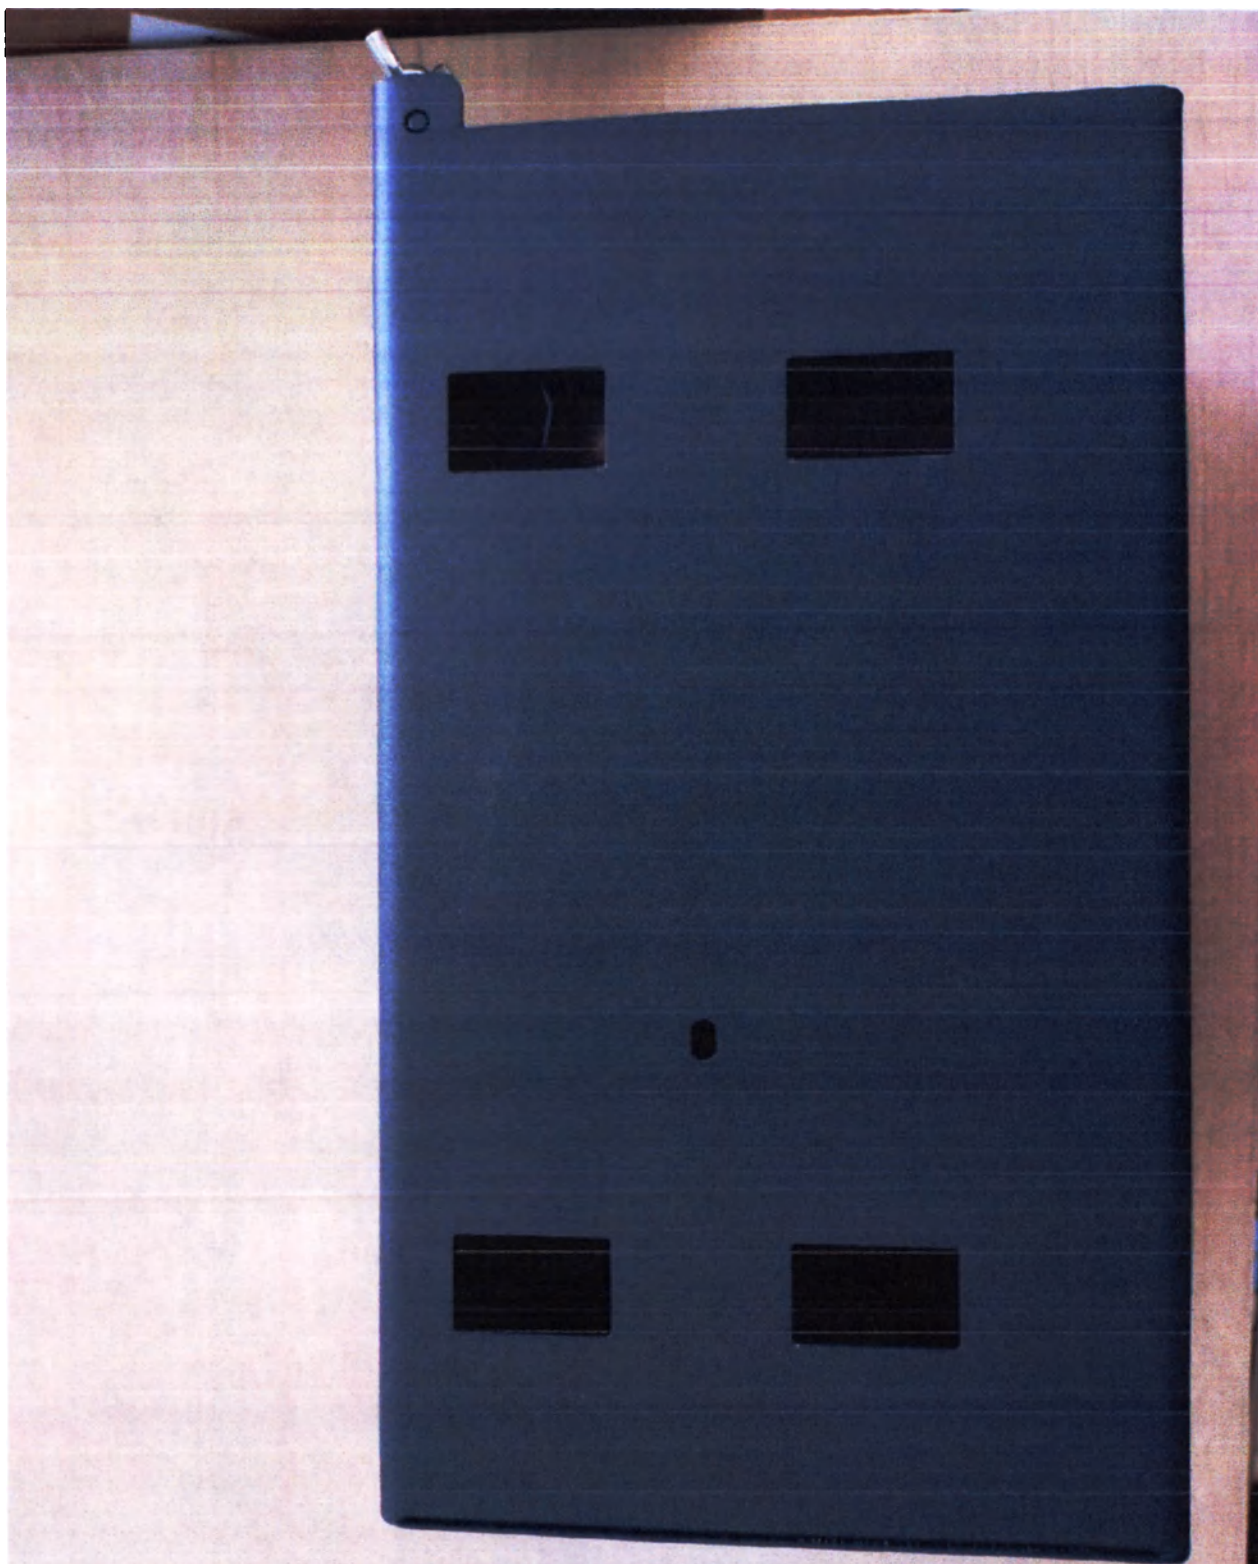

Полка для принтера (вид снизу)

EDAN Diagnostic Ultrasound System

Model: Acclarix LX9 Super



2020-12-12



SN



560500-M20C06680001



Anti-electro-shock Type: Class I
100V-240V~ 50Hz/60Hz 2.5A-1.2A

Max. Mass: 83kg



Shanghai International Holding Corp. GmbH.
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 E-mail: shholding@hotmail.com

Rx Only




Edan Instruments, Inc.
#15 Jinhui Road, Jinsha Community,
Kengzi Sub-District, Pingshan District,
518122 Shenzhen, P.R.China
Tel: +86-755-26898326
Fax: +86-755-26898330
[http:// www.edan.com.cn](http://www.edan.com.cn)



(01)06944413811393
(21)560500-M20C06680001
(11)201212


Полка для принтера (вид сбоку)

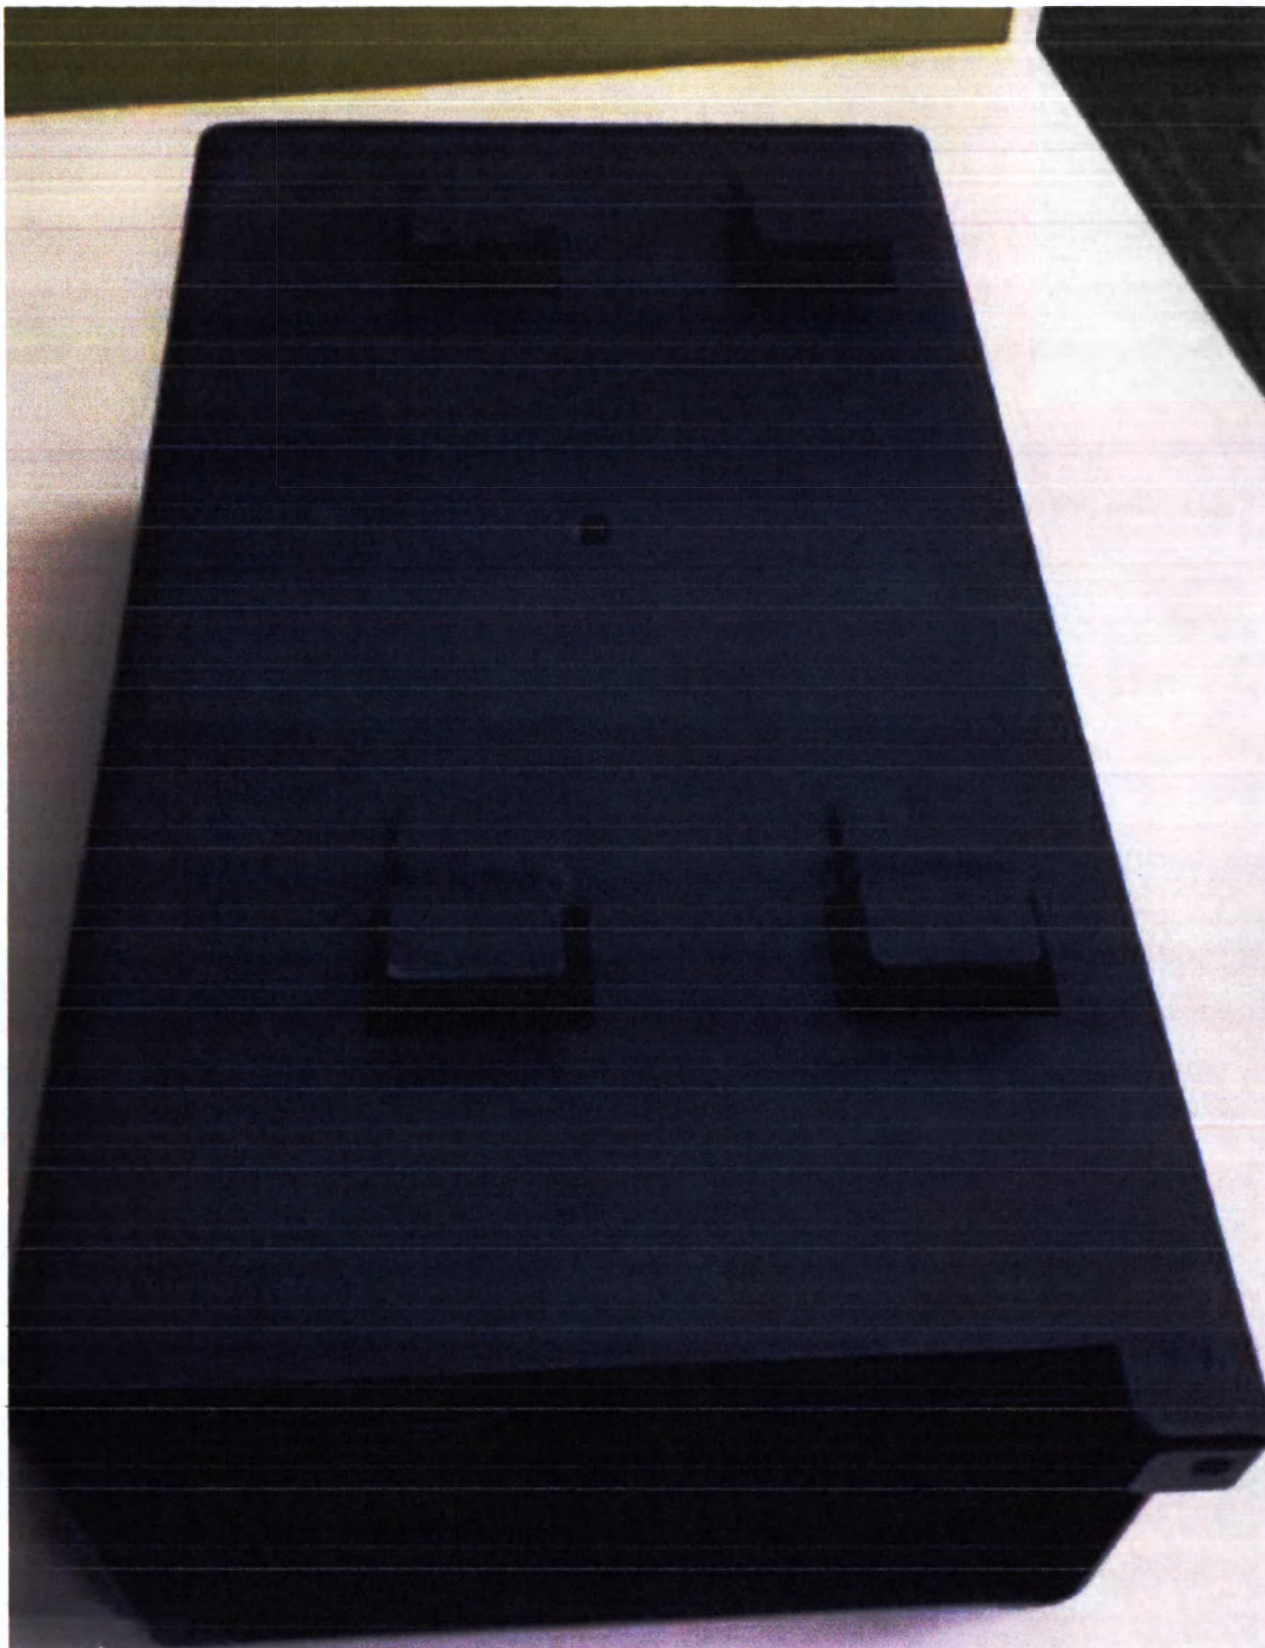

Полка для принтера



Ножной переключатель (одна педаль)

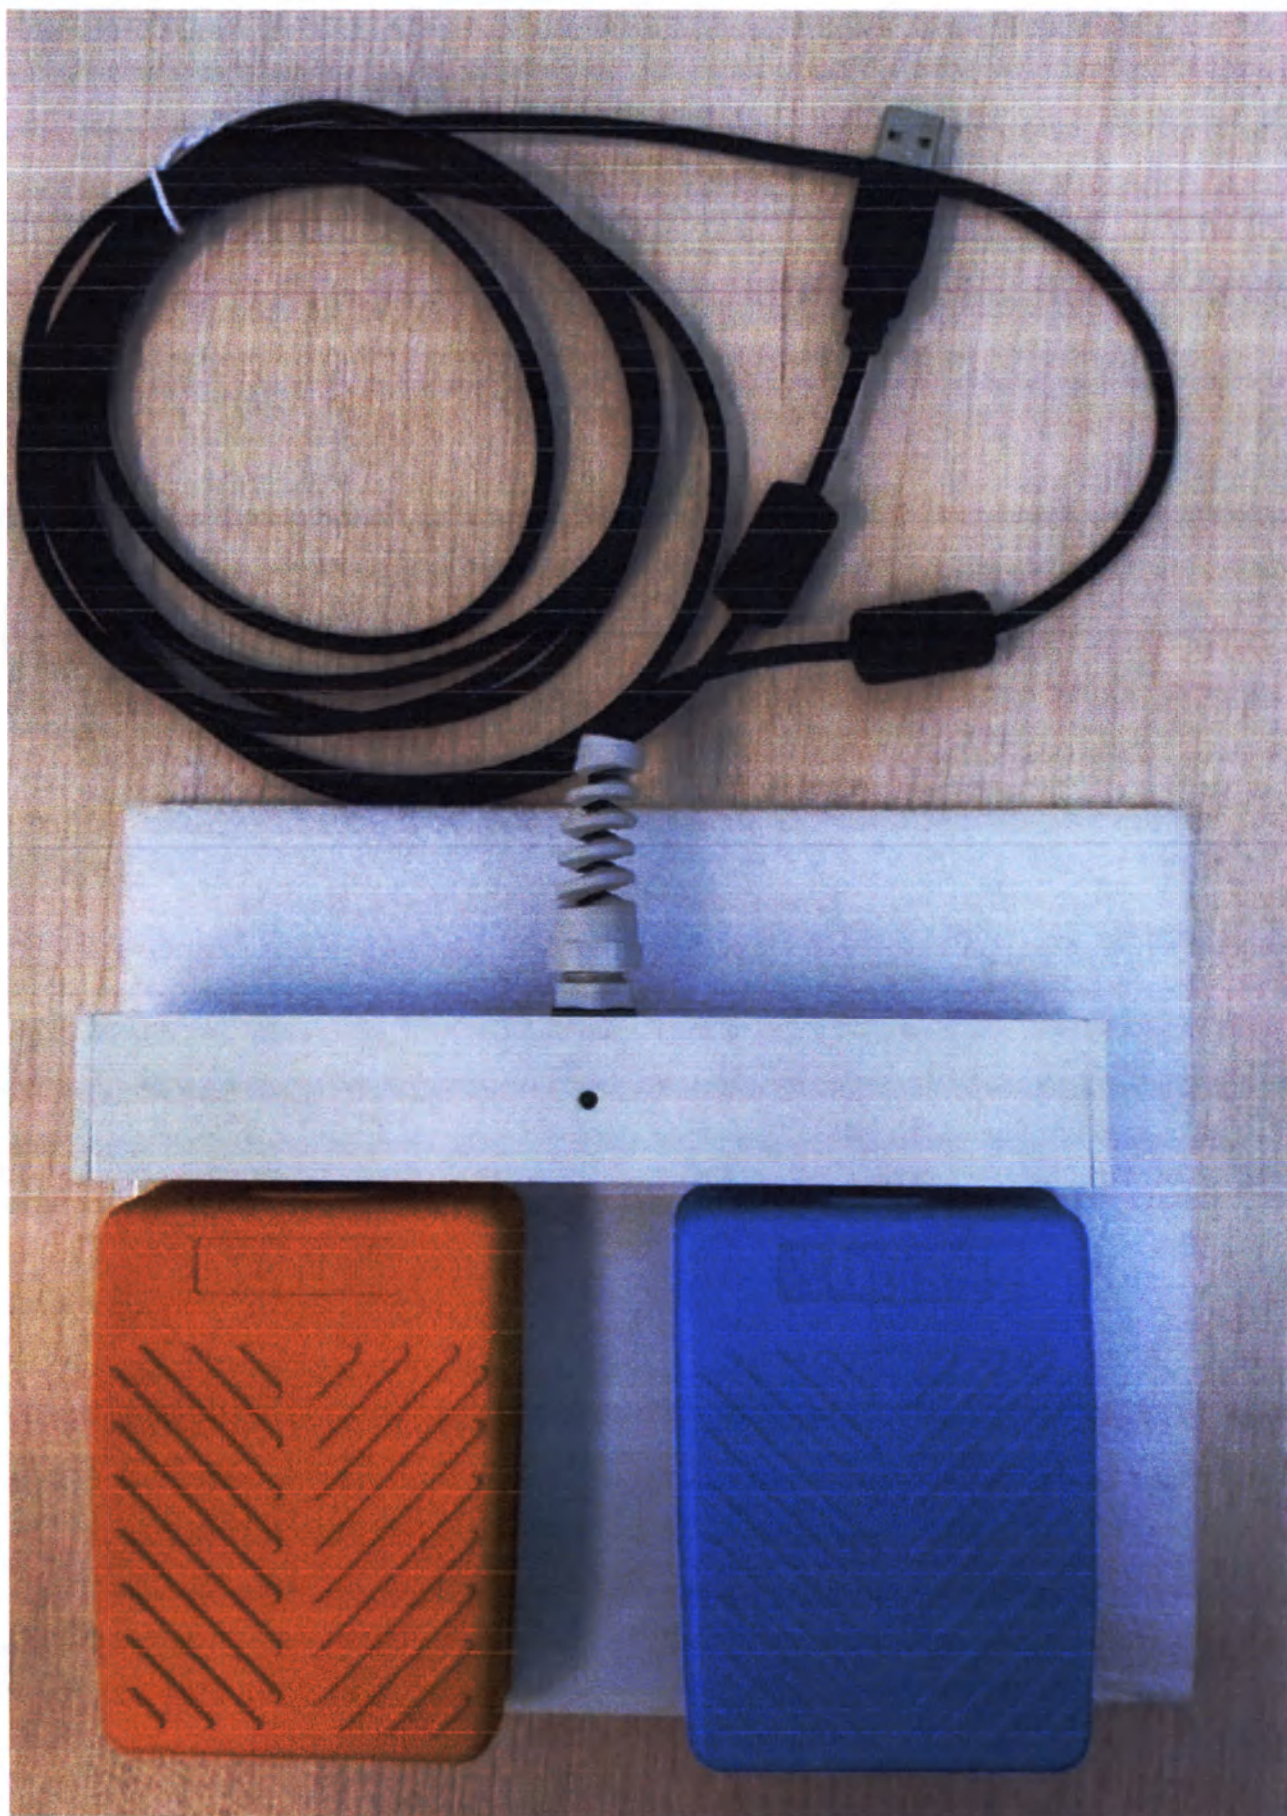


Ножной переключатель (две педали)




Кабель заземления




Предохранитель

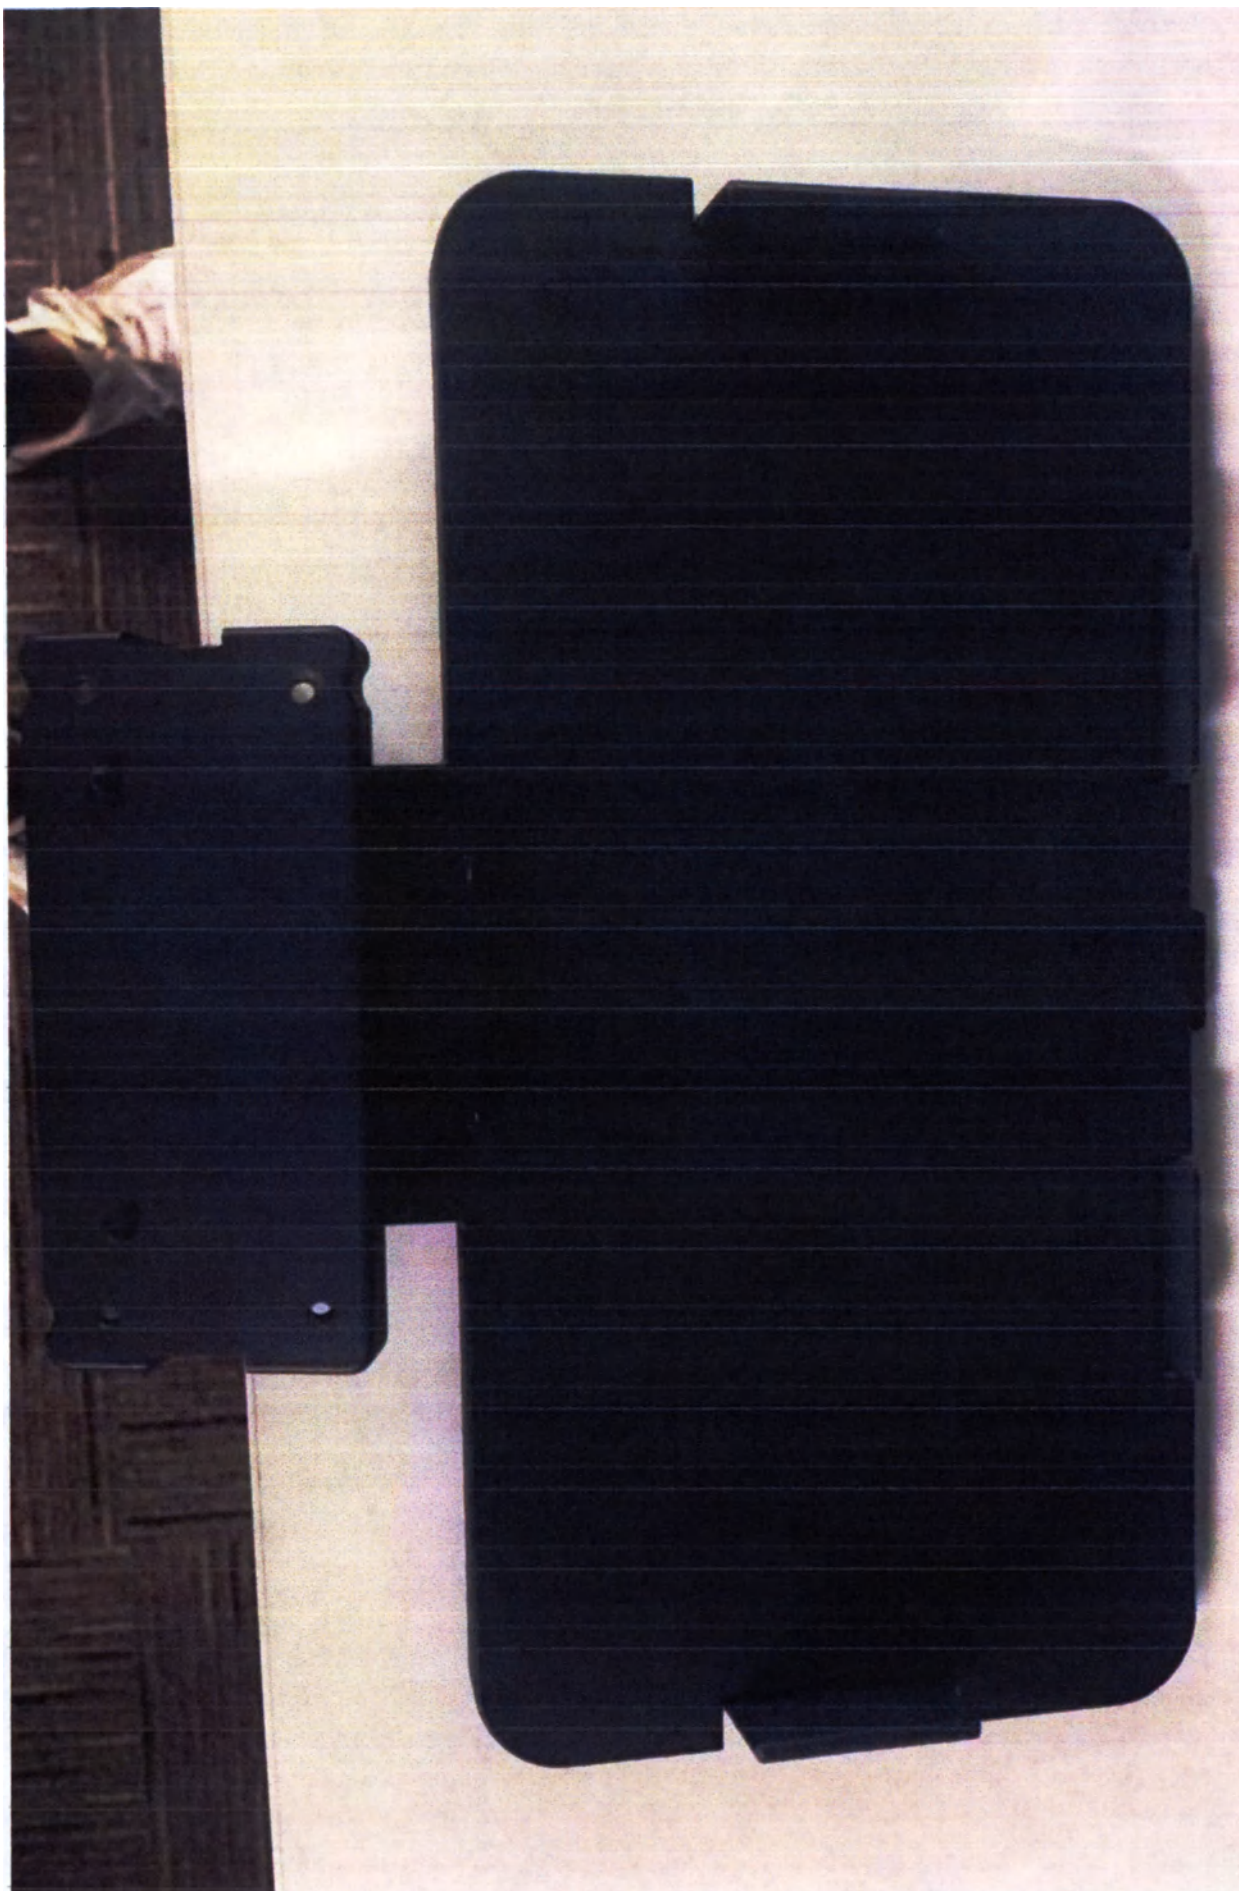

Держатель клавиатуры

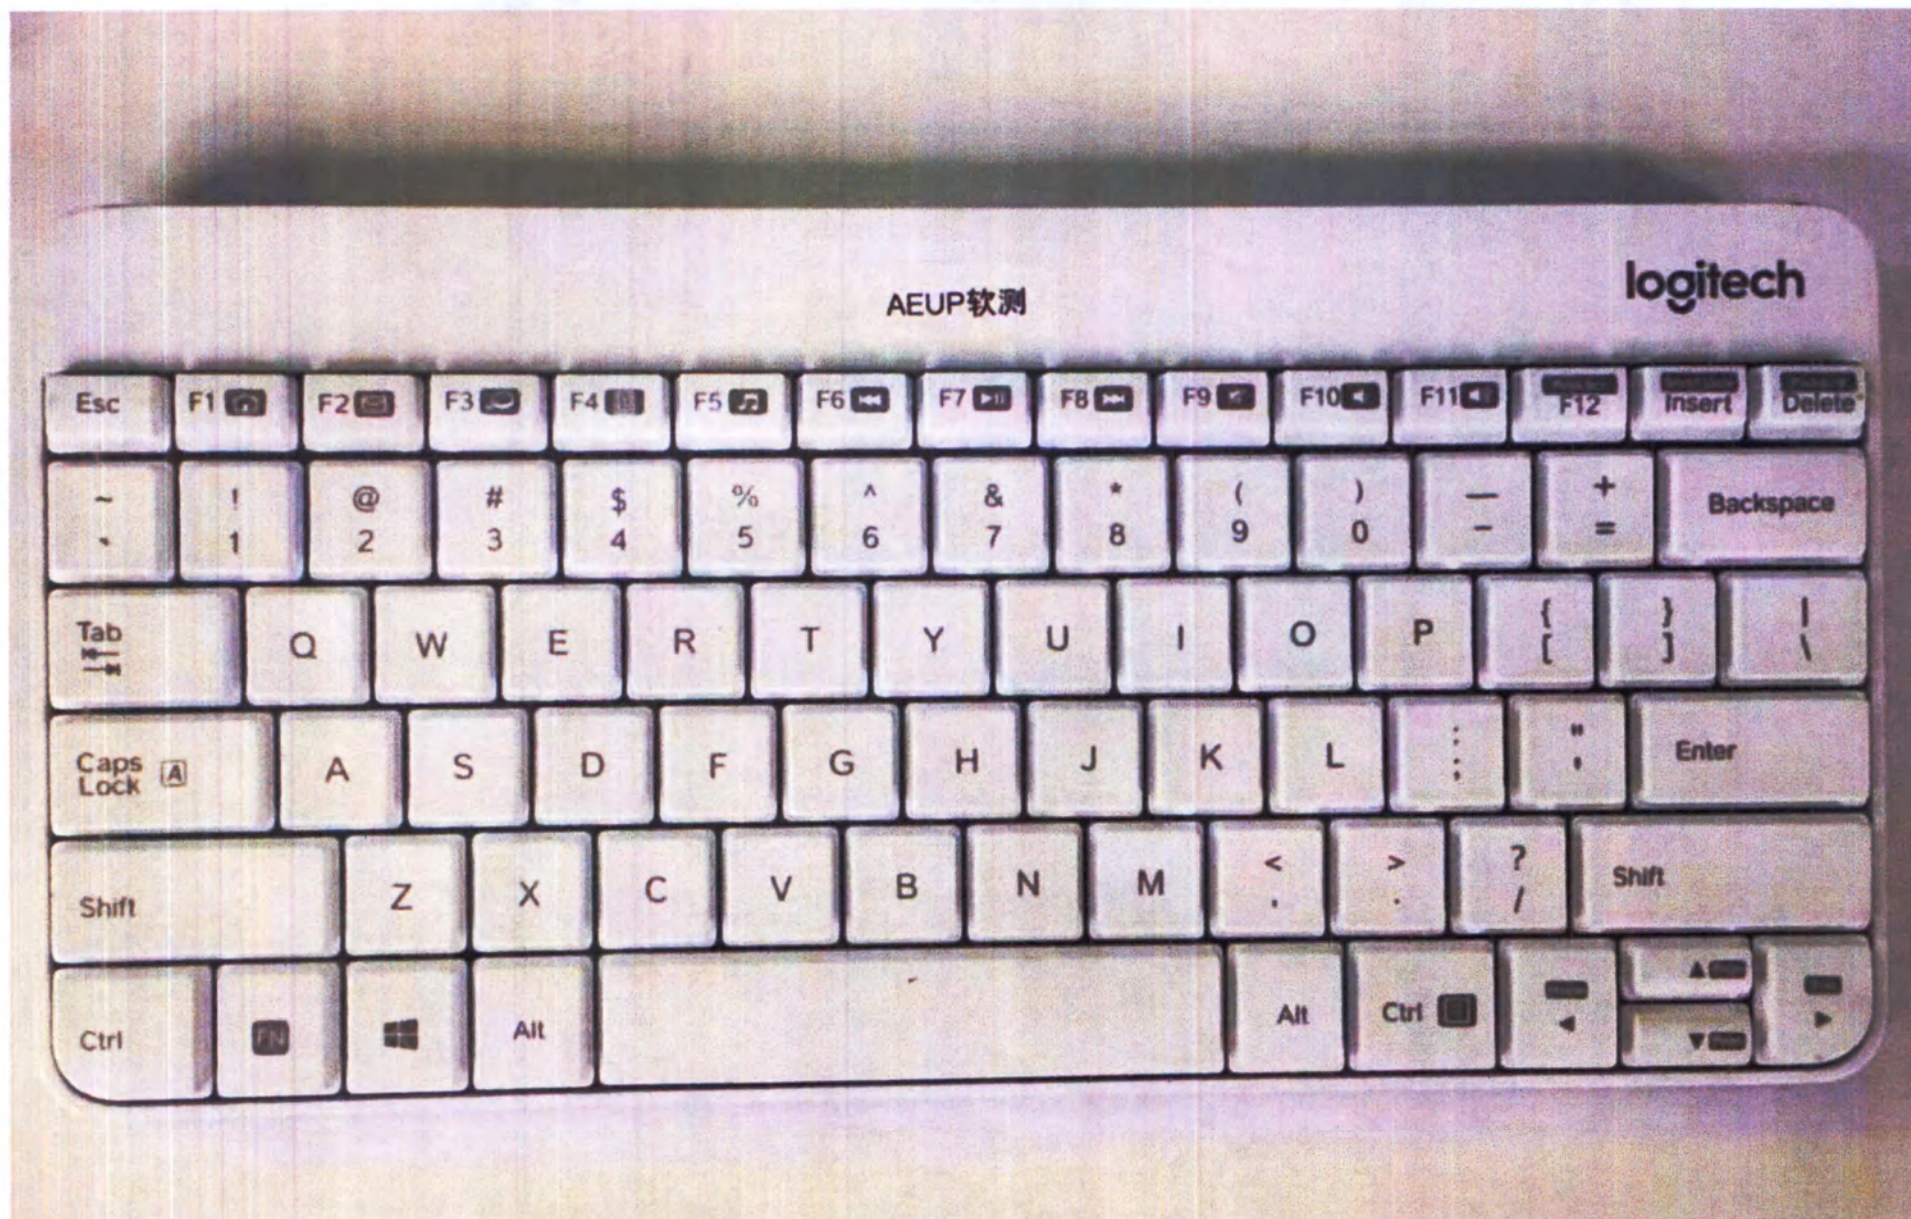

Клавиатура

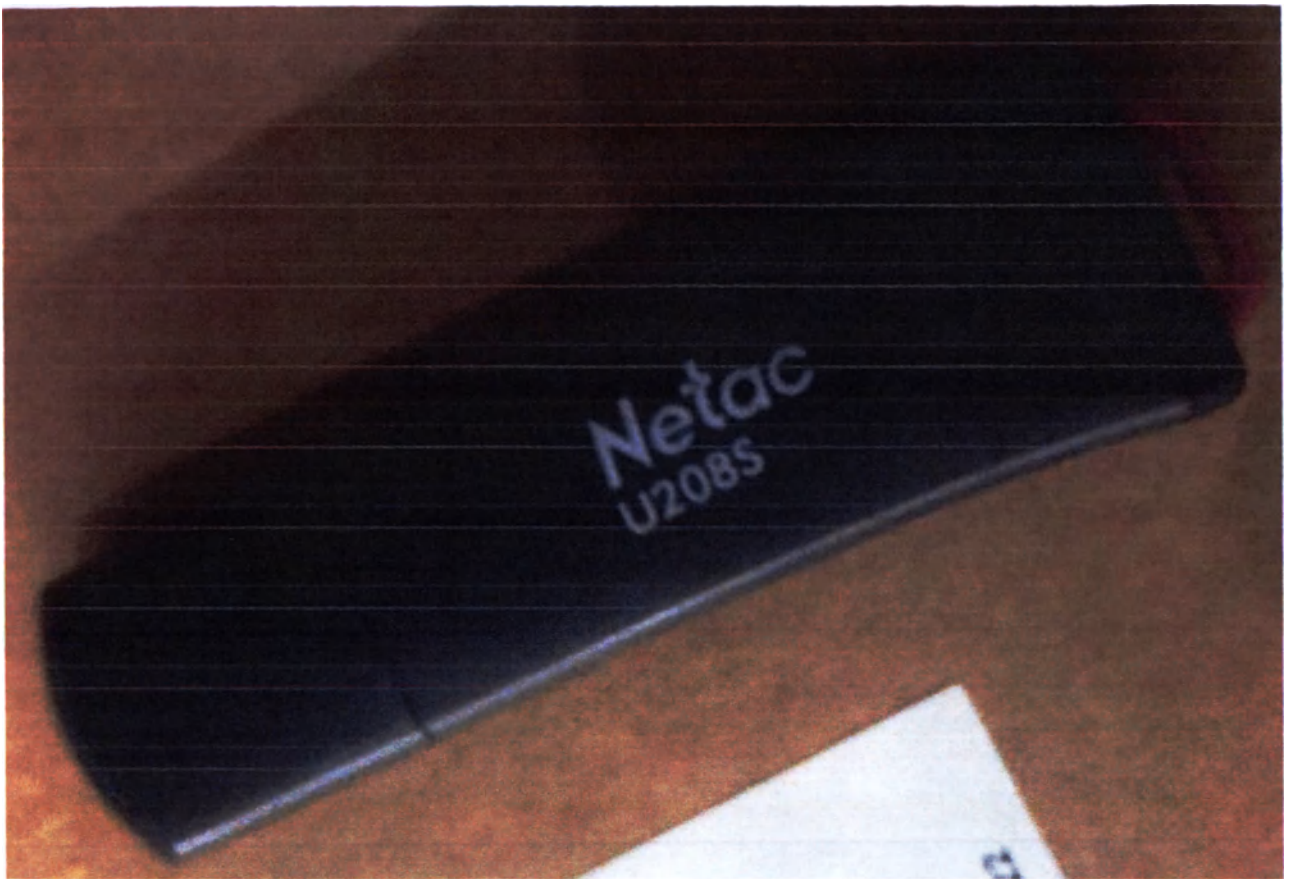

USB диск



Flash-диск

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 88 листа (-ов)

Генеральный директор Татьяна Швай
М.П.

