


Фотографические изображения общего вида

Набор калибраторов «Alinity m HIV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m.

В состав наборов входят следующие компоненты:

Набор пробирок с калибратором А (Калиб. А)

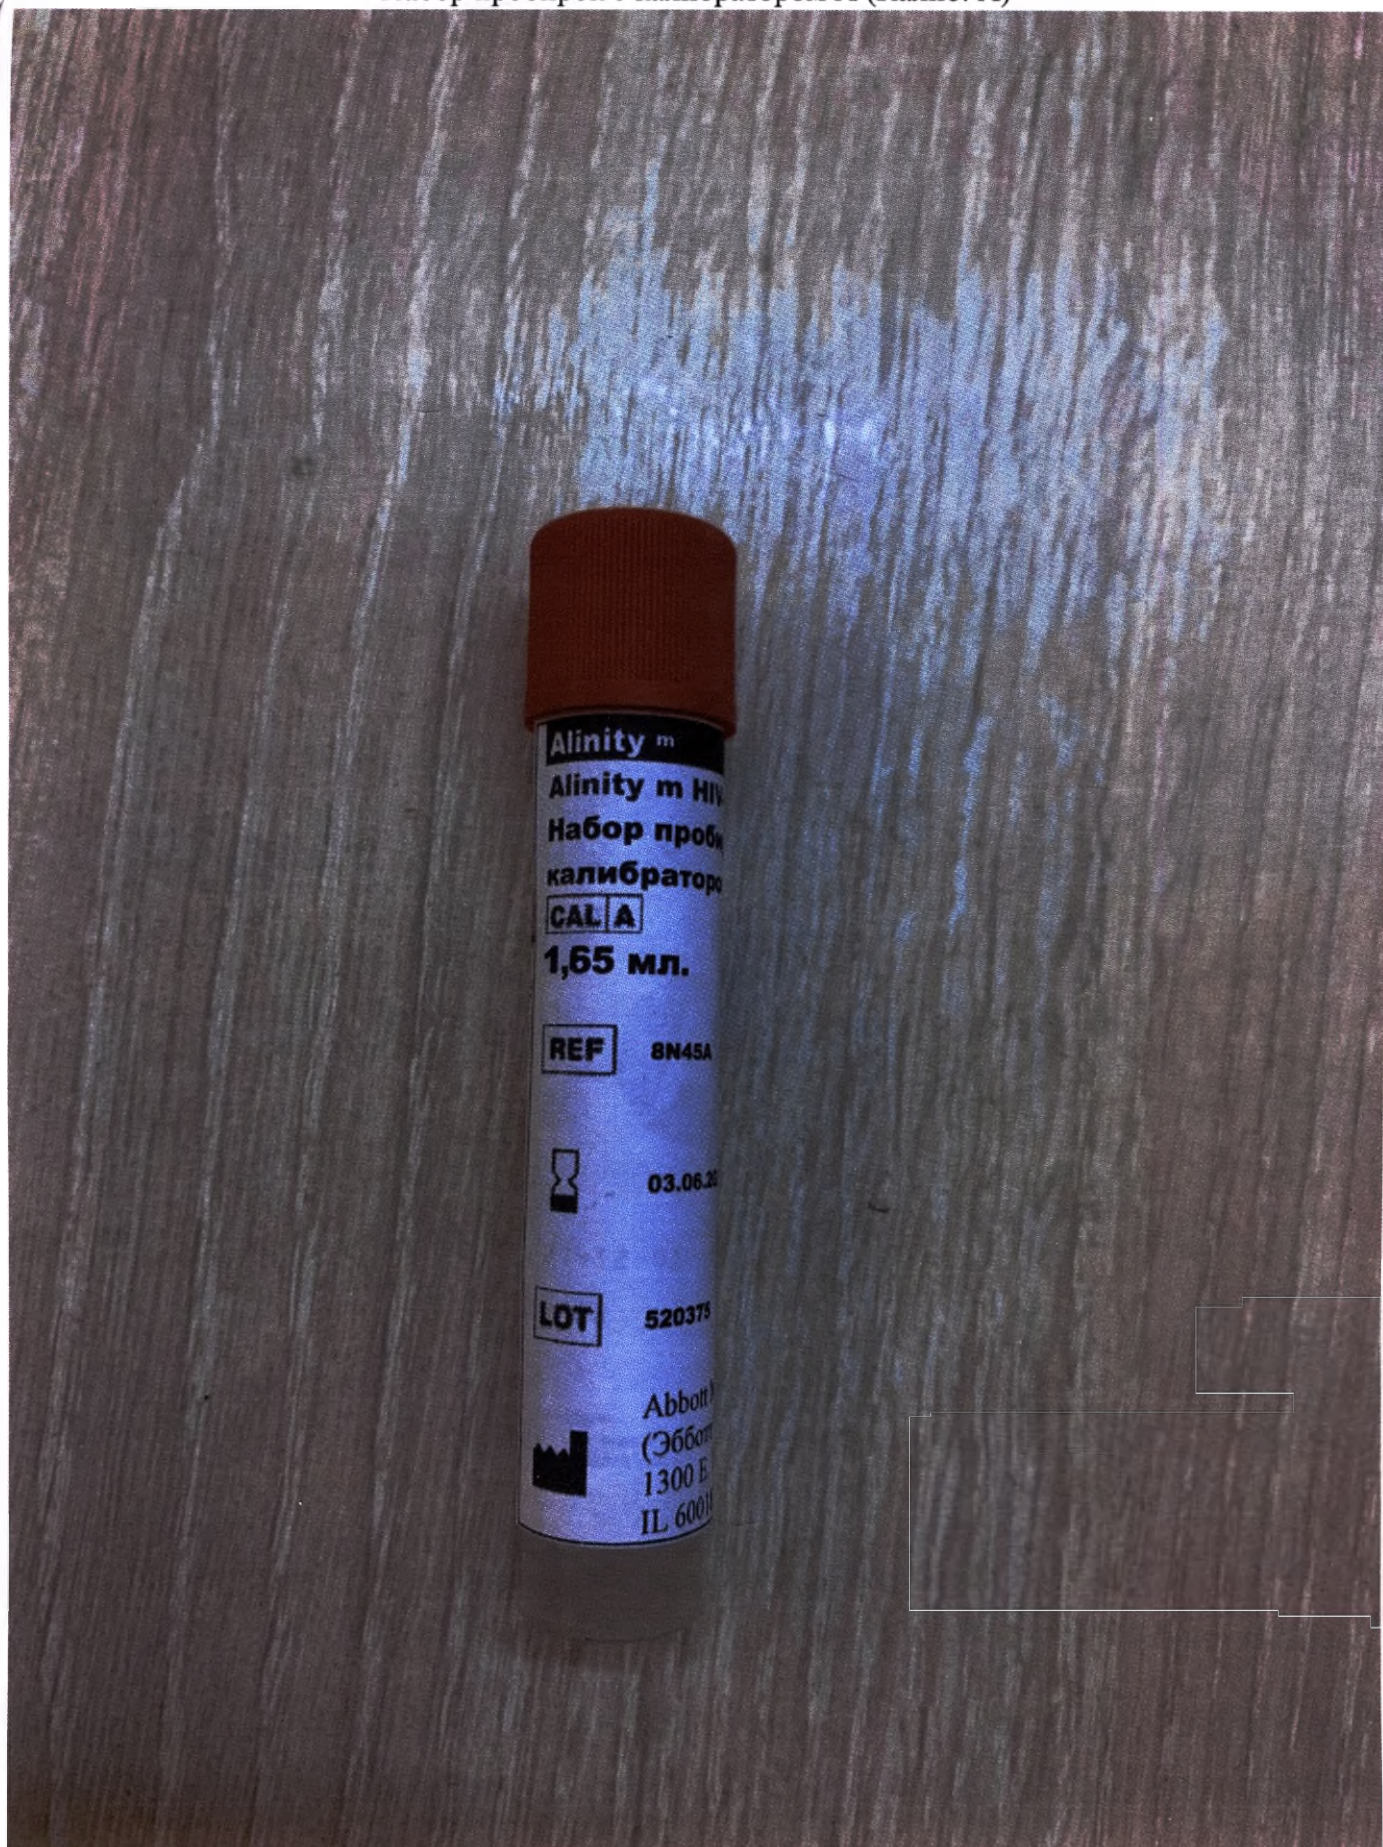

Набор пробирок с калибратором В (Калиб. В)



Набор калибраторов «Alinity m HIV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m с компонентами



Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»

Е.Р. Коничева

Списито и заверено печатью 4
лист 1
Руководитель подразделения молекулярной диагностики
по России ООО Эбботт Лэбораториз
Конишева Е.Р.

Фотографические изображения общего вида

Набор калибраторов «Alinity m HIV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m.

В состав наборов входят следующие компоненты:

Набор пробирок с калибратором А (Калиб. А)





Набор калибраторов «Alinity m HIV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m с компонентами




Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»

Е.Р. Коничева

Сшито и заверено печатью 4

() лист

Руководитель подразделения молекулярной диагностики
по России ООО Эбботт Лэбораториз
Коничева Е.Р.



**Макет маркировки упаковки «Набор калибраторов «Alinity m HIV Cal Kit»
для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека
методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека
на анализаторе Alinity m»**

Alinity^m		HIV-1 CAL Kit	
Набор калибраторов «Alinity m HIV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m		REF 08N47-091	
CAL A 4 x 1.65 мл. CAL B 4 x 1.65 мл.		H317, P261, P280, P272, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P501	
 XX.XX.XXXX LOT XXXXXX		PRODUCT OF USA In Vitro Test IVD EC REP www.molecular.abbott/portal Уполномоченный представитель изготовителя в РФ: ООО «Эбботт Лабораториз», Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 Abbott- russia@abbott.com	
		Abbott Molecular Inc. (Эбботт Молекуляр Инк.) 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, USA	

Alinity^m

Alinity m HIV-1 Cal Kit
Набор пробирок с
калибратором A

CAL A

1,65 мл.

REF

8N45A

XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXX

53-602023/R1

Abbott Molecular Inc.
 (Эбботт Молекуляр Инк.)
 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines,
 IL 60018, USA

Alinity^m

Alinity m HIV-1 Cal Kit
Набор пробирок с
калибратором B

CAL B

1,65 мл.

REF

8N45B

XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXX

53-602024/R1

Abbott Molecular Inc.
 (Эбботт Молекуляр Инк.)
 1300 E. Touhy Avenue,
 Des Plaines, IL 60018, USA

Макет маркировки упаковки «Набор контролей «Alinity m HIV-1 CTRL Kit» для количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ОТ-ПЦР в плазме и сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m.»

Alinity^m		HIV-1 CTRL Kit	
Набор контролей «Alinity m HIV-1 CTRL Kit» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) методом ОТ-ПЦР в плазме и сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m		REF 08N45-080 	
CTRL - 12 x 1.15 мл. CTRL + 12 x 1.15 мл. CTRL ++ 12 x 1.15 мл.	H317, P261, P280, P272, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P501  PRODUCT OF USA In Vitro Test IVD CE REP www.molecular.abbott/portal Уполномоченный представитель изготовителя в РФ: ООО «З660тт Лабораториз», Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 Abbott- russia@abbott.com	Abbott Molecular Inc. (З660тт Молекуляр Инк.) 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, USA	
CE  XX.XX.XXXX LOT XXXXXX			

Alinity^m
Alinity m HIV-1 CTRL Kit
Набор пробирок с
положительным
контролем с низкой
концентрацией

CTRL +
1,15 мл.

REF 8N45W

LOT XXXXXX 53-602027/R1

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, IL 60018, USA

Alinity^m
Alinity m HIV-1 CTRL Kit
Набор пробирок с
положительным
контролем с высокой
концентрацией

CTRL ++
1,15 мл.

REF 8N45W

LOT XXXXXX 53-602036/R1

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, IL 60018, USA

Alinity^m
Alinity m HIV-1 CTRL Kit
Набор пробирок с
отрицательным
контролем

CTRL -
1,15 мл.

REF 8N45W

LOT XXXXXX 53-602026/R1

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, IL 60018, USA

Alinity^m
Alinity m HIV-1 CTRL Kit
Набор пробирок с
положительным
контролем с низкой
концентрацией

CTRL +
1,15 мл.

REF 8N45W

LOT XXXXXX 53-602027/R1

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, IL 60018, USA

Alinity^m
Alinity m HIV-1 CTRL Kit
Набор пробирок с
положительным
контролем с высокой
концентрацией

CTRL ++
1,15 мл.

REF 8N45W

LOT XXXXXX 53-602036/R1

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, IL 60018, USA

Alinity^m
Alinity m HIV-1 CTRL Kit
Набор пробирок с
отрицательным
контролем

CTRL -
1,15 мл.

REF 8N45W

LOT XXXXXX 53-602026/R1

Abbott Molecular Inc.
(Эбботт Молекуляр Инк.)
1300 E. Touhy Avenue,
Des Plaines, IL 60018, USA