



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 марта 2023 года № РЗН 2023/19694

На медицинское изделие

**Трубки трахеальные Shiley с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник"

(ООО "Медтроник"), Россия,

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 9, пом. III, ком. 41

Производитель

"Ковидиен Ллс", США,

Covidien Llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-49444/97834 от 18.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 28 листах

приказом Росздравнадзора от 02 марта 2023 года № 1136  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0070751

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 1

На медицинское изделие

**Трубки трахеальные Shiley с принадлежностями, в вариантах исполнения:**

1) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1 Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

**0118532**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 2

- 5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- II) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, в  
**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0118533

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 3

вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0118534

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 4

диаметр:7,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:7,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:8,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:8,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:9,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

10) 10.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:9,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр:9,5 мм - не более 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118535

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 5

- инструкция по применению - 1 шт.

10.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

11) 11.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

11.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

III) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0118536

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 6

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.;  
- 10 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 10 Fr - не более 10 шт.;  
- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 10 Fr - не более 10 шт.;  
- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 10 Fr - не более 10 шт.;  
- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118537

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 7

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

10) 10.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с

глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

10.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости),  
размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

11) 11.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с  
глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

11.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости),  
размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

12) 12.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с  
глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

12.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости),  
размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

13) 13.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118538

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 8

глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

13.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

14) 14.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

14.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

15) 15.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

15.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

IV) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118539

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 9

Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком

Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118540

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года № РЗН 2023/19694

Лист 10

- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

10) 10.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

10.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:


- 14 Fr - не более 10 шт.

11) 11.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

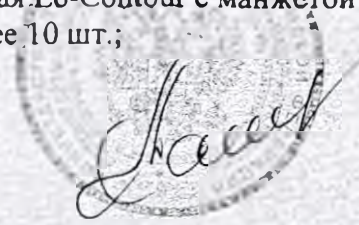

А.В. Самойлова

0118541

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 11

11.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

12) 12.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

12.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

13) 13.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

13.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

14) 14.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

14.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

V) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118542

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 12

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.;  
- 10 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 10 Fr - не более 10 шт.;  
- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 10 Fr - не более 10 шт.;  
- 14 Fr - не более 10 шт.

VI) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, в вариантах исполнения:

1) Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 2,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 2,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 2,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 2,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не  
**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0118543

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 13

содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 3,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 3,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 3,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 3,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 4,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 4,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:


- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

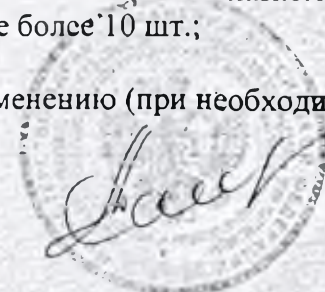  
А.В. Самойлова

0118544

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 14

- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

10) 10.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

10.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

11) 11.1. Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:


- трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

11.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

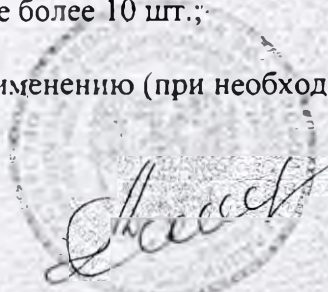  
А.В. Самойлова

0118545

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 15

VII) Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0118546

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 16

- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

VIII) Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
А.В. Самойлова

0118547

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 17

внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самоилова**

0118548

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 18

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

IX) Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 6 Fr - не более 10 шт.;

- 10 Fr - не более 10 шт.

X) Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.


1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

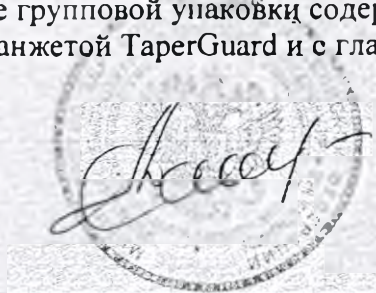

**А.В. Самойлова**

0118549

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 19

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.


6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи,

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

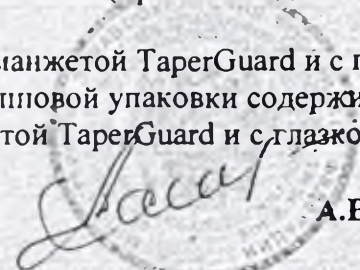  
**А.В. Самойлова**

0118550

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 20

внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

XI) Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0118551

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 21

- 3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- 7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:  
- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;  
- инструкция по применению - 1 шт.
- 7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.
- XII) Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, в  
Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118552

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 22

вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;
- 10 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,5 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.


4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 6 Fr - не более 10 шт.;
- 10 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

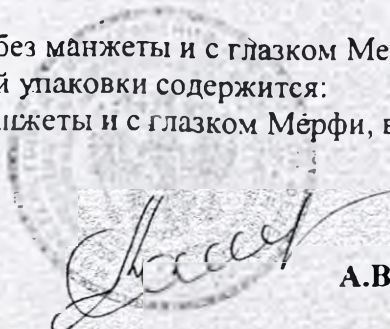

А.В. Самойлова

0118553

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 23

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;


- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

XIII) Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

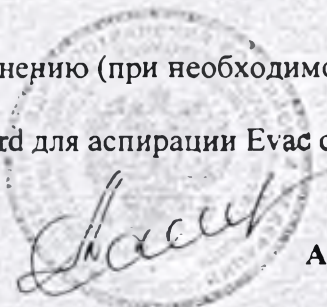

А.В. Самойлова

0118554

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 24

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 10 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 10 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;
- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118555

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 25

4.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Evac с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

XIV) Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм - не более 10 шт.;
- стилет для интубации, размер: 10 Fr - не более 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0118556

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 26

1.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,5 мм, не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 10 F - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

3) 3.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,0 мм - не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 10 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

4) 4.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм - не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 10 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Стилет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 10 Fr - не более 10 шт.;

- 14 Fr - не более 10 шт.

5) 5.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0118557

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 27

5.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

6) 6.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр:  
7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм - не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

6.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

7) 7.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр:  
8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

7.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

8) 8.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр:  
8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм - не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

8.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

9) 9.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр:  
9,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 9,0 мм - не более 10 шт.;


- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

9.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:  
- 14 Fr - не более 10 шт.

10) 10.1. Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр:  
10,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

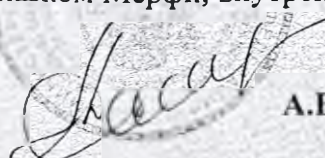

**А.В. Самойлова**

**0118558**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19694

Лист 28

- трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 10,0 мм - не более 10 шт.;

- стилет для интубации, размер: 14 Fr - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

10.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

XV) Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, в вариантах исполнения:

1) 1.1. Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

2) 2.1. Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм - не более 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры:

- 14 Fr - не более 10 шт.

Принадлежности (для всех вариантов исполнения):

1) Коннектор поворотный с вращением в двух плоскостях - не более 10 шт.

Место производства:

1. Mallinckrodt Medical, Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone, Ireland.

2. Covidien, Avenue Henequen No. 1181, Park Industrial Salvarcar, 32573, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.

3. Covidien Lls, 117 Moo 2, Petchkasem Road, Sampran, Nakorn-Pathom 73110, Thailand.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0118559