



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения белка в моче или спинномозговой жидкости человека турбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с "Белок в моче/СМЖ Калибраторы (Alinity с Urine/CSF Protein Calibrator Kit)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



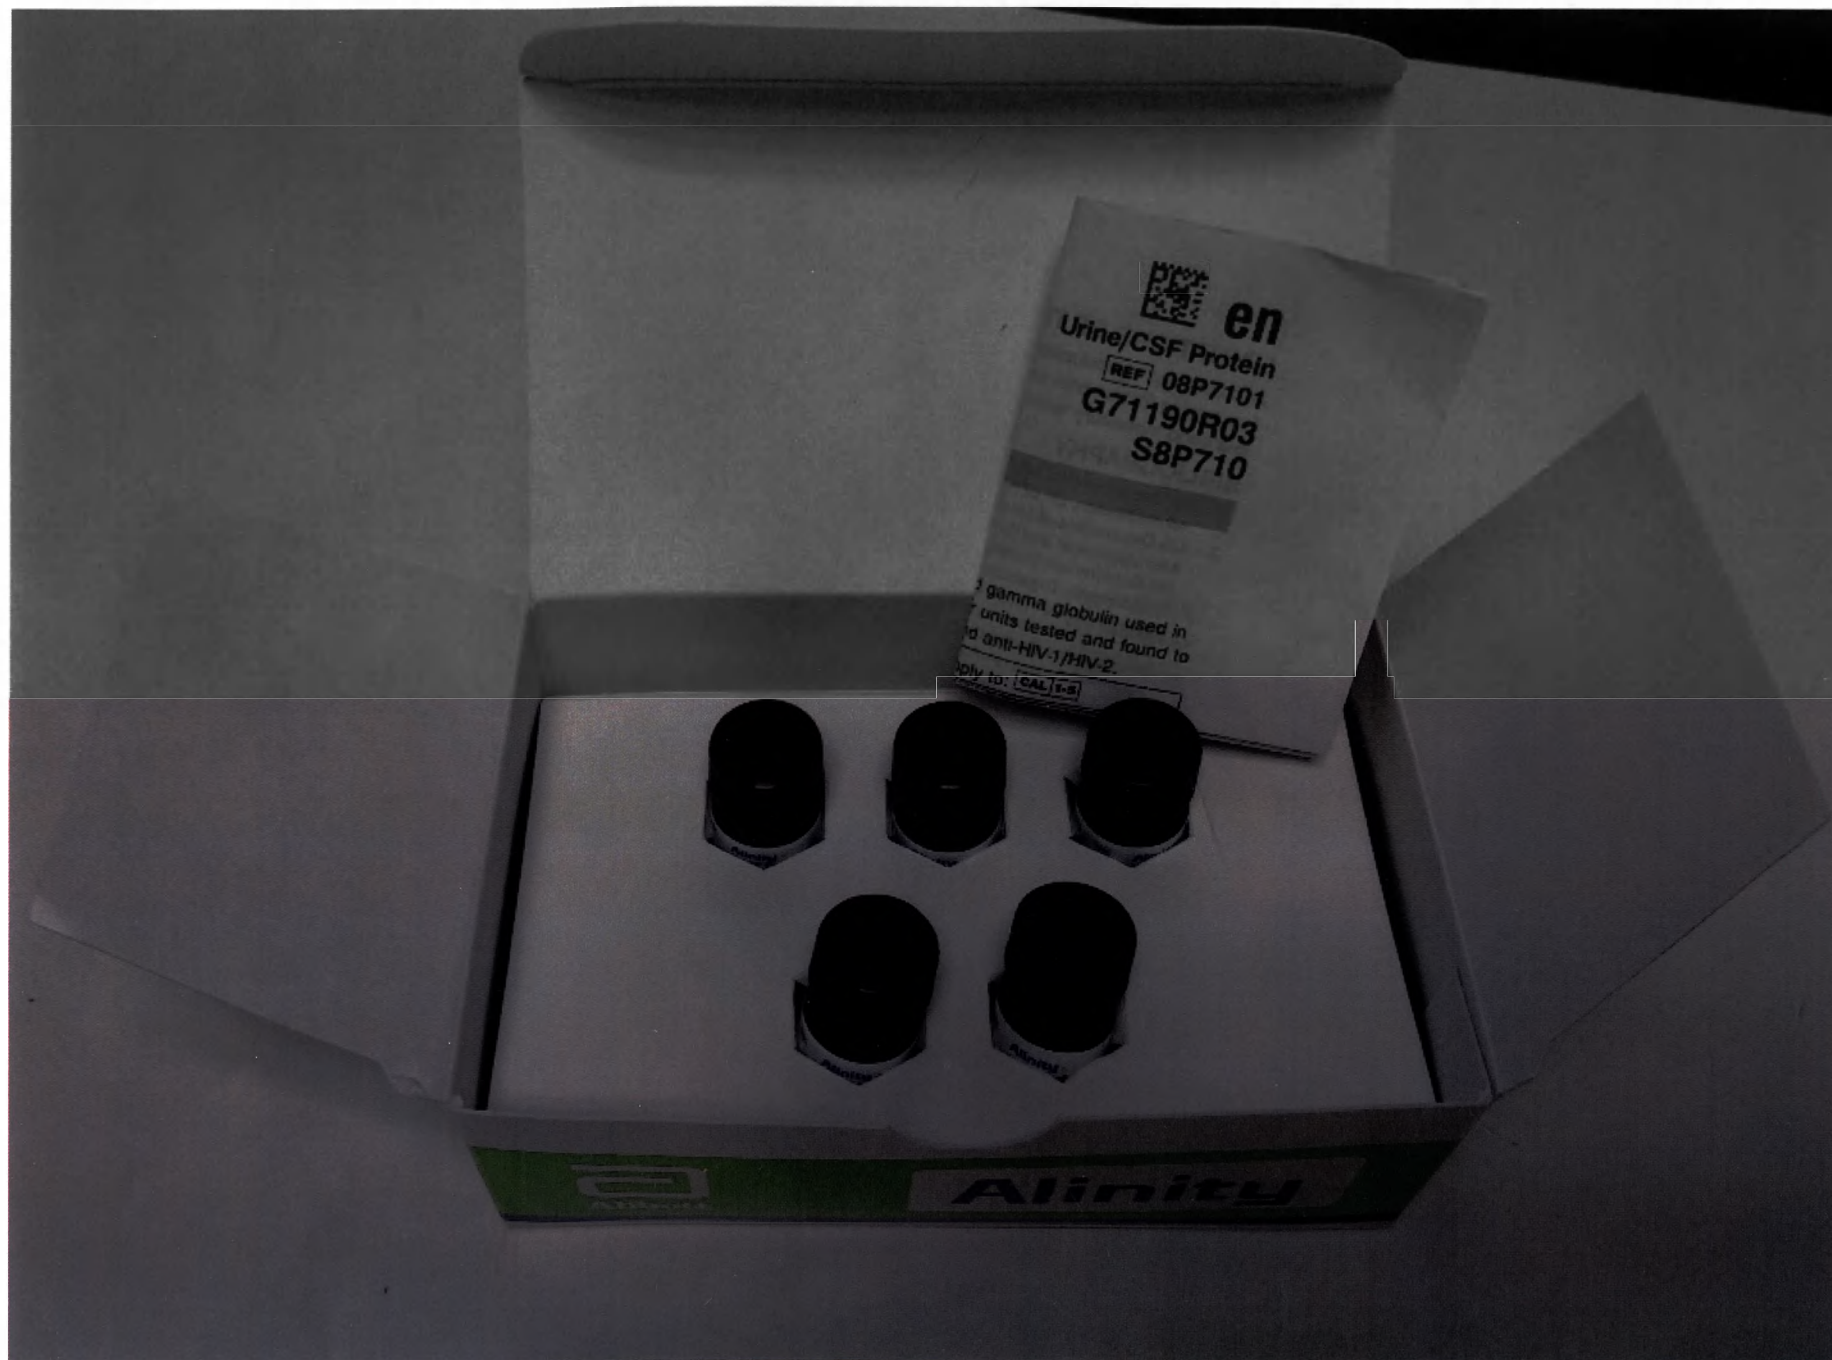


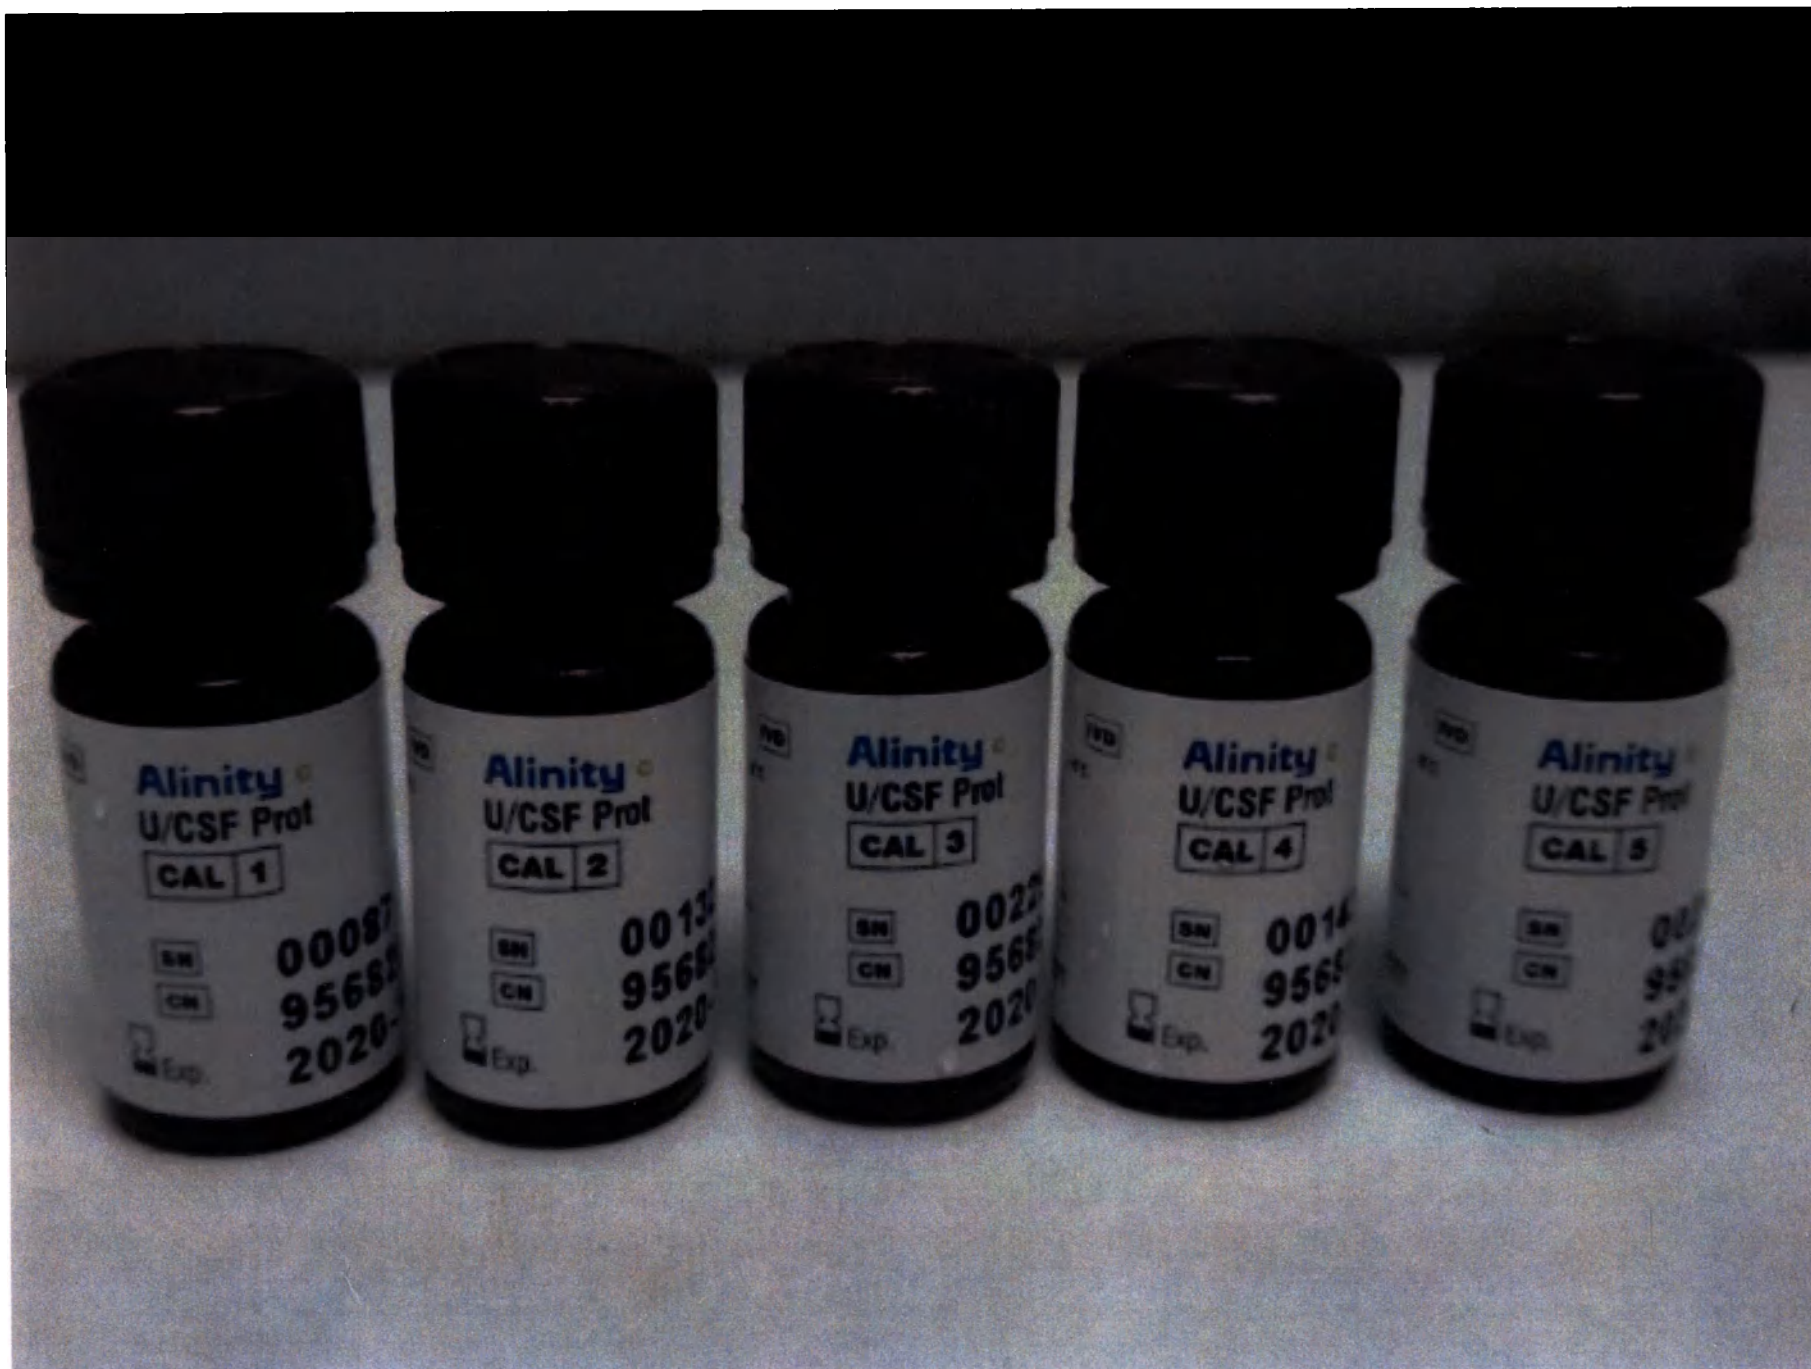

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

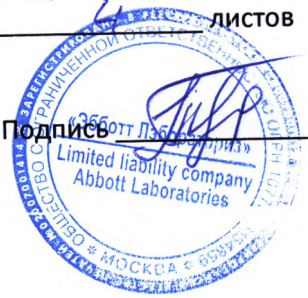

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного
определения белка в моче или спинномозговой жидкости человека
турбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с
"Белок в моче/СМЖ Калибраторы (Alinity с Urine/CSF Protein Calibrator
Kit)"**



REF

08P7101

IVD



Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения белка в моче или спинномозговой жидкости человека турбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с "Белок в моче/СМЖ Калибраторы (Alinity с Urine/CSF Protein Calibrator Kit)"

В составе:

- Калибратор 1 (Alinity с U/CSF Prot Cal 1) – 1 x 3,0 мл;
- Калибратор 2 (Alinity с U/CSF Prot Cal 2) – 1 x 3,0 мл;
- Калибратор 3 (Alinity с U/CSF Prot Cal 3) – 1 x 3,0 мл;
- Калибратор 4 (Alinity с U/CSF Prot Cal 4) – 1 x 3,0 мл;
- Калибратор 5 (Alinity с U/CSF Prot Cal 5) – 1 x 3,0 мл;

инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт ГмбХ и Ко. КГ» (Abbott GmbH & Co. KG), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)

Место производства: Fisher Diagnostics, A Division of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown, Virginia, 22645, USA

Страна происхождения: США

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

G70267R02

www.abbottdiagnostics.com/RU
08P7101



CAL 5	1 X 3.0 mL
CAL 4	1 X 3.0 mL
CAL 3	1 X 3.0 mL
CAL 2	1 X 3.0 mL
CAL 1	1 X 3.0 mL

U/CSF Prot Cals



Alinity c Urine/CSF Protein Calibrator Kit Abbott

Alinity c Urine/CSF Protein Calibrator Kit

Abbott

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**
For use in the calibration of the Alinity c Urine/CSF Protein assay on the Alinity c analyzer.
• **CAL 1-5** are human protein-based solutions. Preservatives are also present.
Infection Risk
Distributed in the USA by
Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike Middletown VA 22645 USA



PRODUCT OF USA

U/CSF Prot Cals



Макет маркировки компонентов медицинского изделия Белок в моче/СМЖ Калибраторы (Alinity c
Urine/CSF Protein Calibrator Kit), Кат. № 08P7101

Alinity^c
U/CSF Prot
CAL 1

08P71
3.0 mL
10 mg/dL
G70268R01

ABBOTT  Exp.

Alinity^c
U/CSF Prot
CAL 2

08P71
3.0 mL
20 mg/dL
G70269R01

ABBOTT  Exp.

Alinity^c
U/CSF Prot
CAL 3

08P71
3.0 mL
40 mg/dL
G70270R01

ABBOTT  Exp.

Alinity^c
U/CSF Prot
CAL 4

08P71
3.0 mL
80 mg/dL
G70271R01

ABBOTT  Exp.

Alinity^c
U/CSF Prot
CAL 5

08P71
3.0 mL
200 mg/dL
G70272R01

ABBOTT  Exp.

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

Подпись

