

УТВЕРЖДАЮ

Специалист отдела регистрации

Медицинского департамента АО «Р-Фарм»



В.А. Королевская


Фотографические изображения медицинского изделия

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Производитель: FUJIFILM Corporation


26-30 Nishiazabu 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, 106-8620, Япония



**Слайды FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического
автоматического FUJI DRI-CHEM**

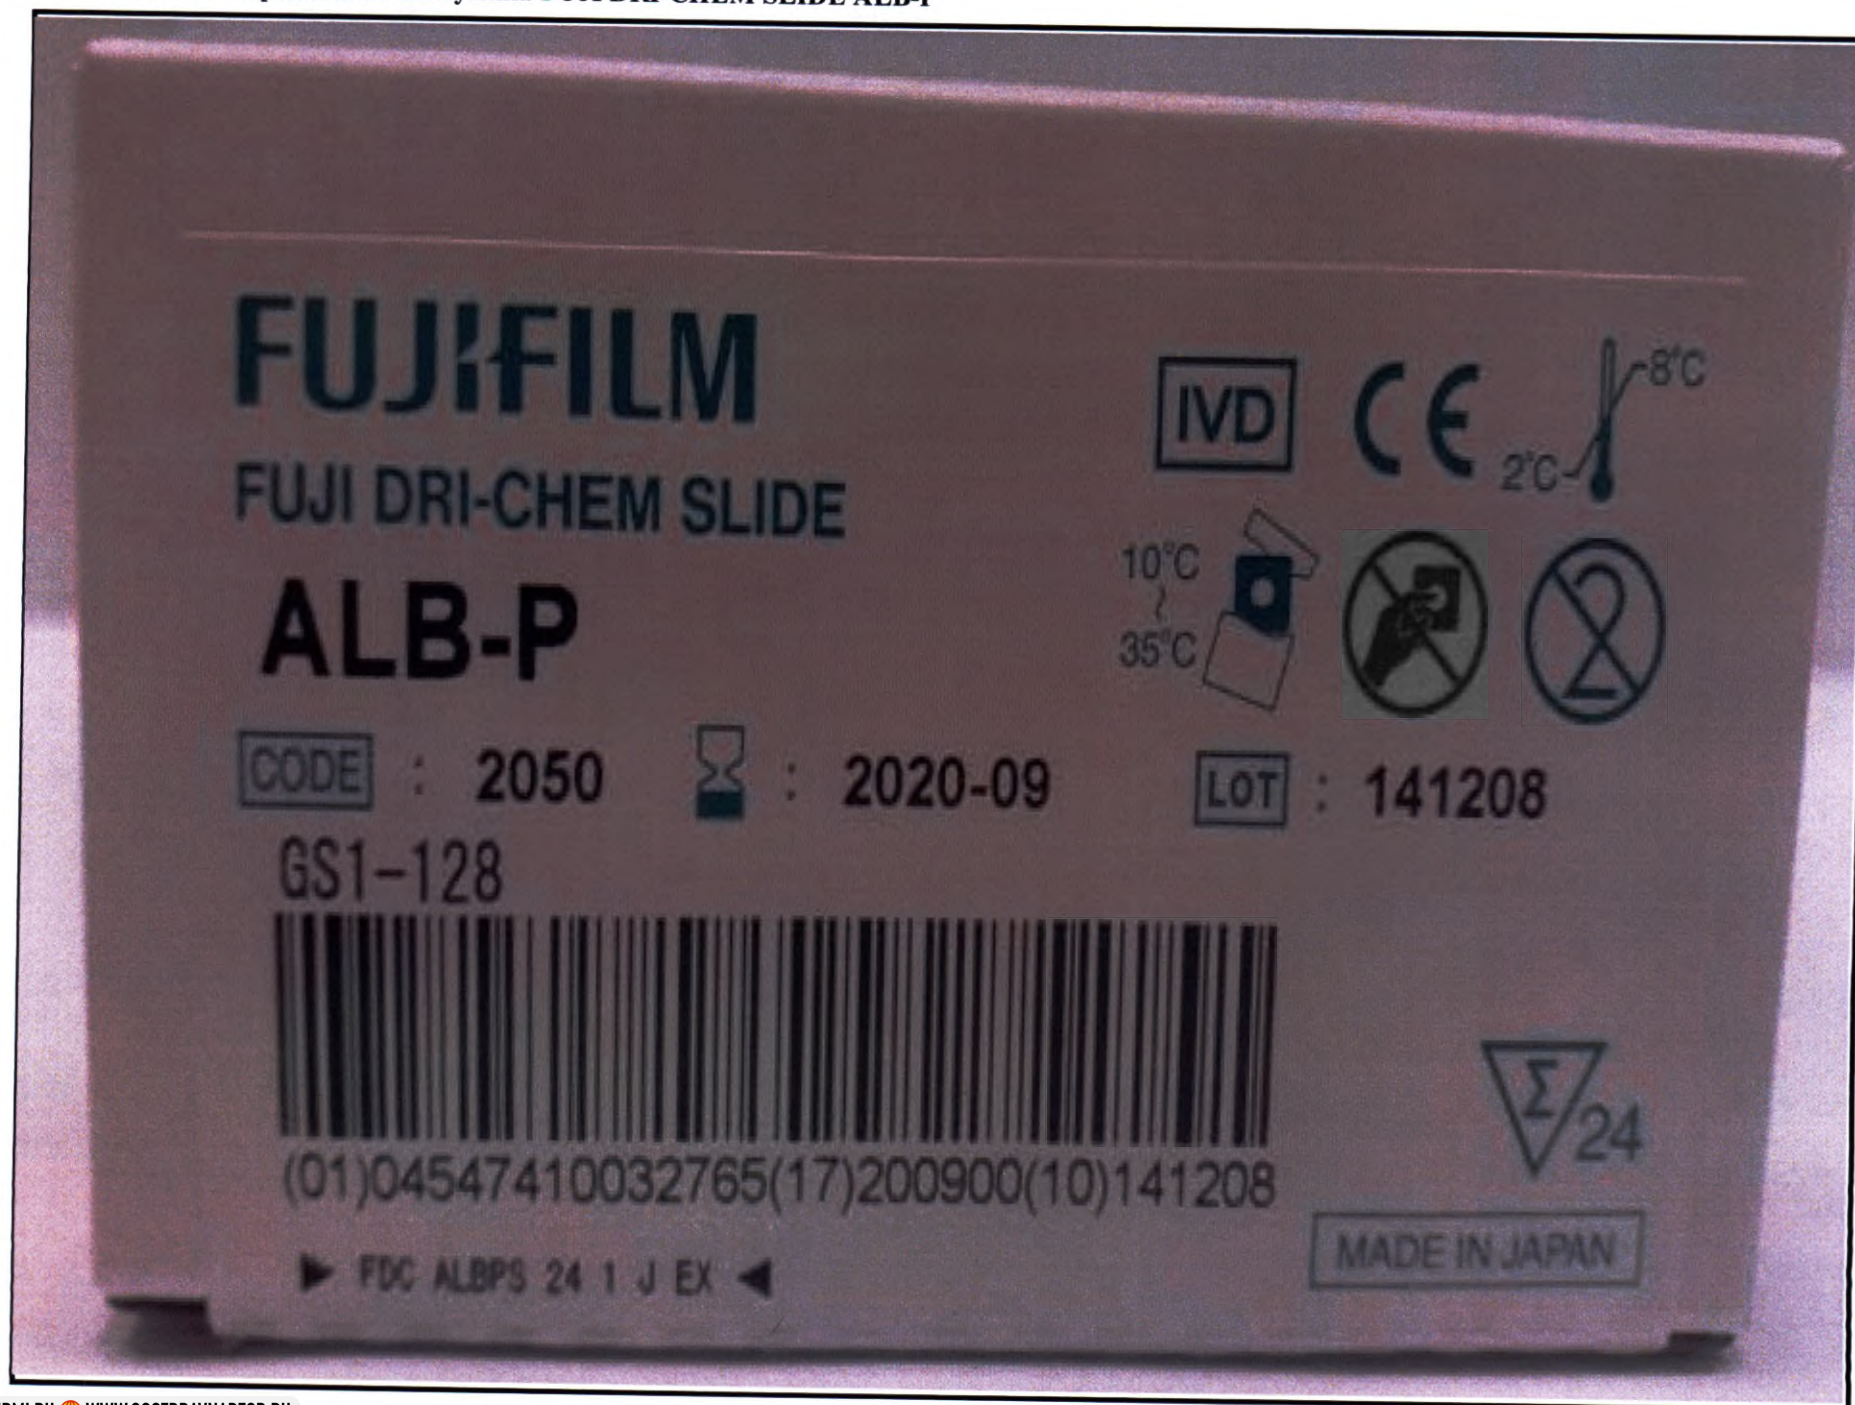

1. Слайды для определения альбумина FUJI DRI-CHEM SLIDE ALB-P

4

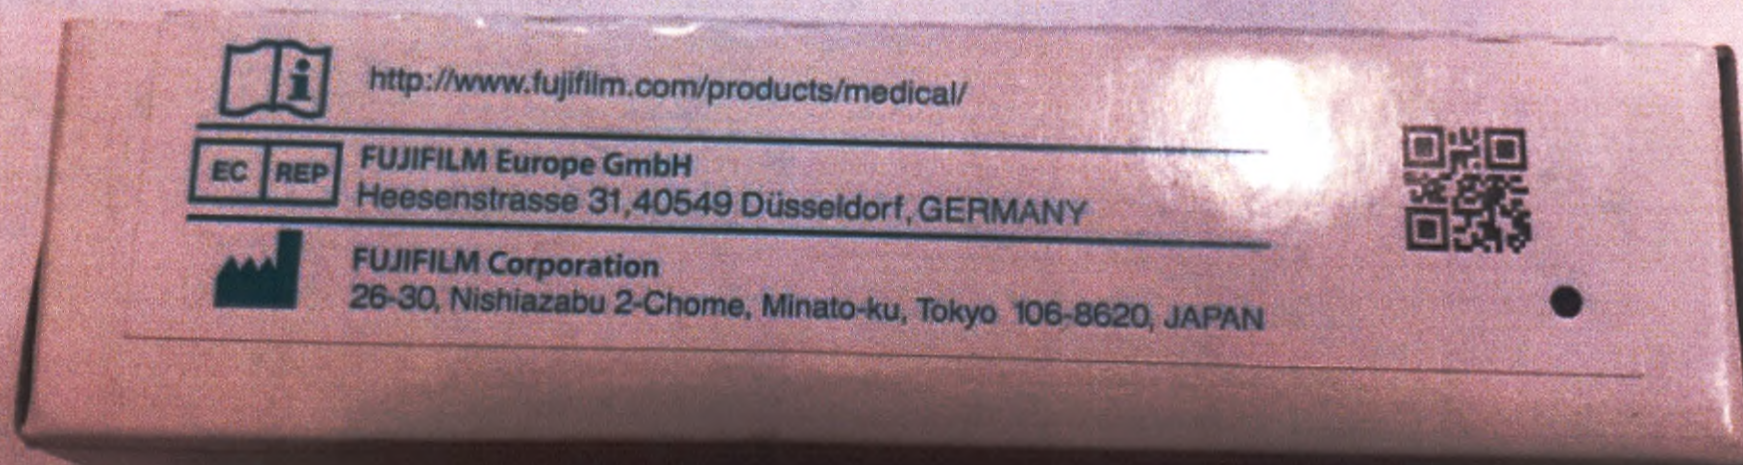

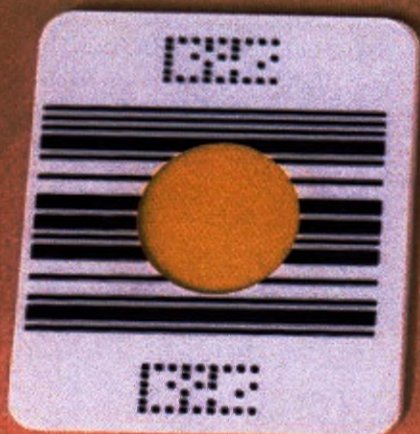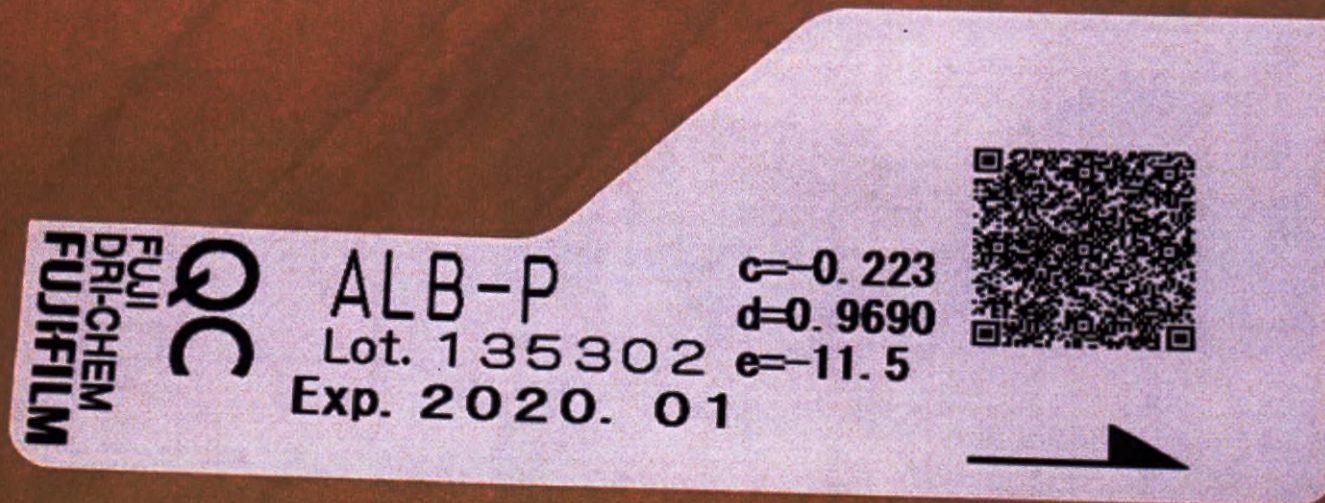

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для
анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-
CHEM

Слайды для определения альбумина FUJI DRI-CHEM
SLIDE ALB-P - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809396

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на
упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-
ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:


АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19
корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

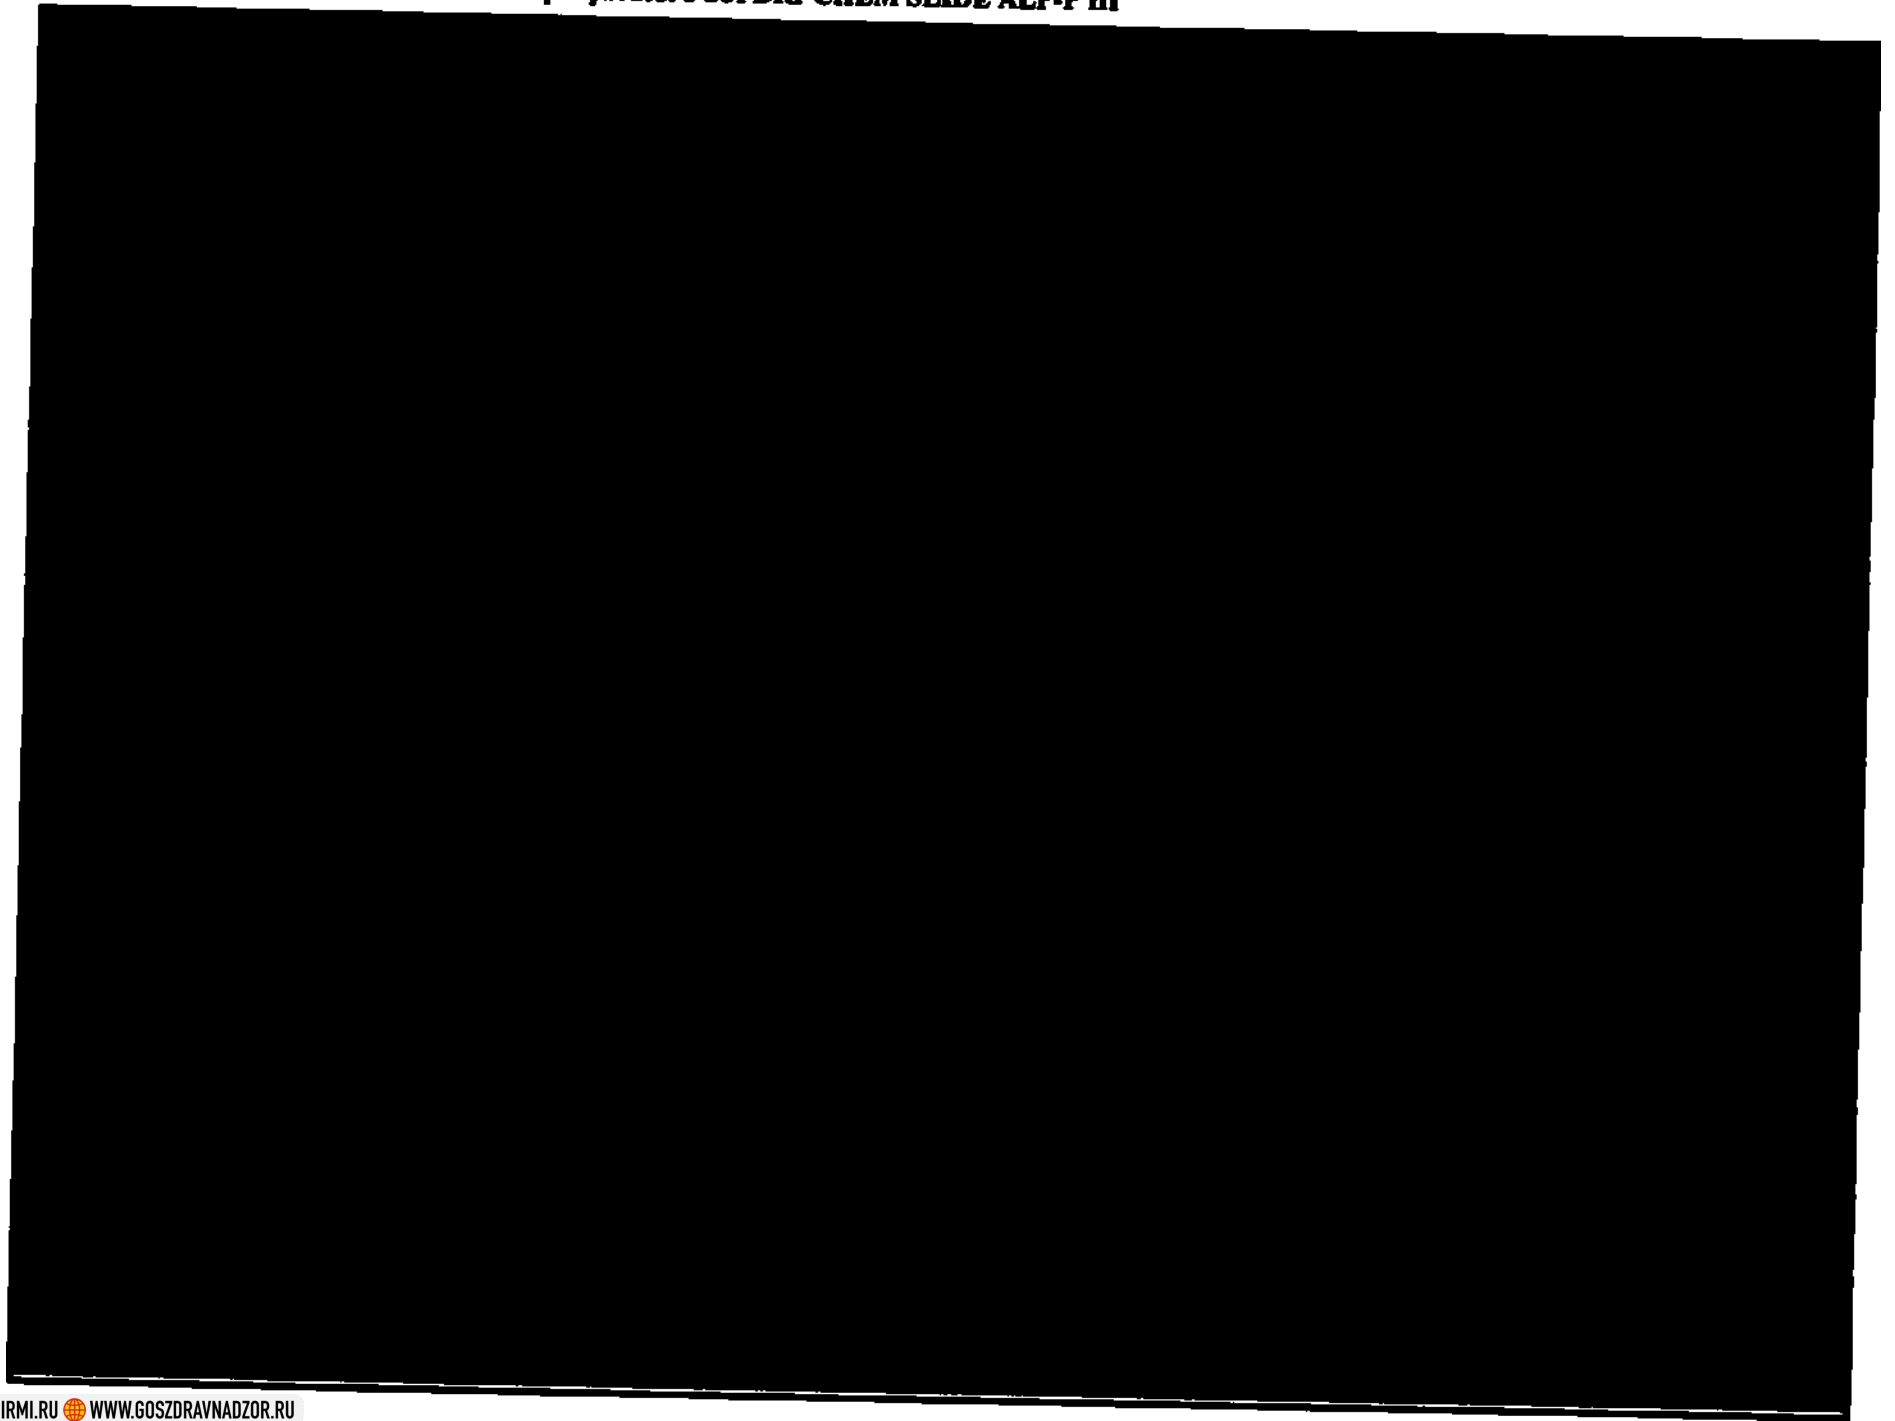

2. Слайды для определения щелочной фосфатазы FUJI DRI-CHEM SLIDE ALP-P III

8

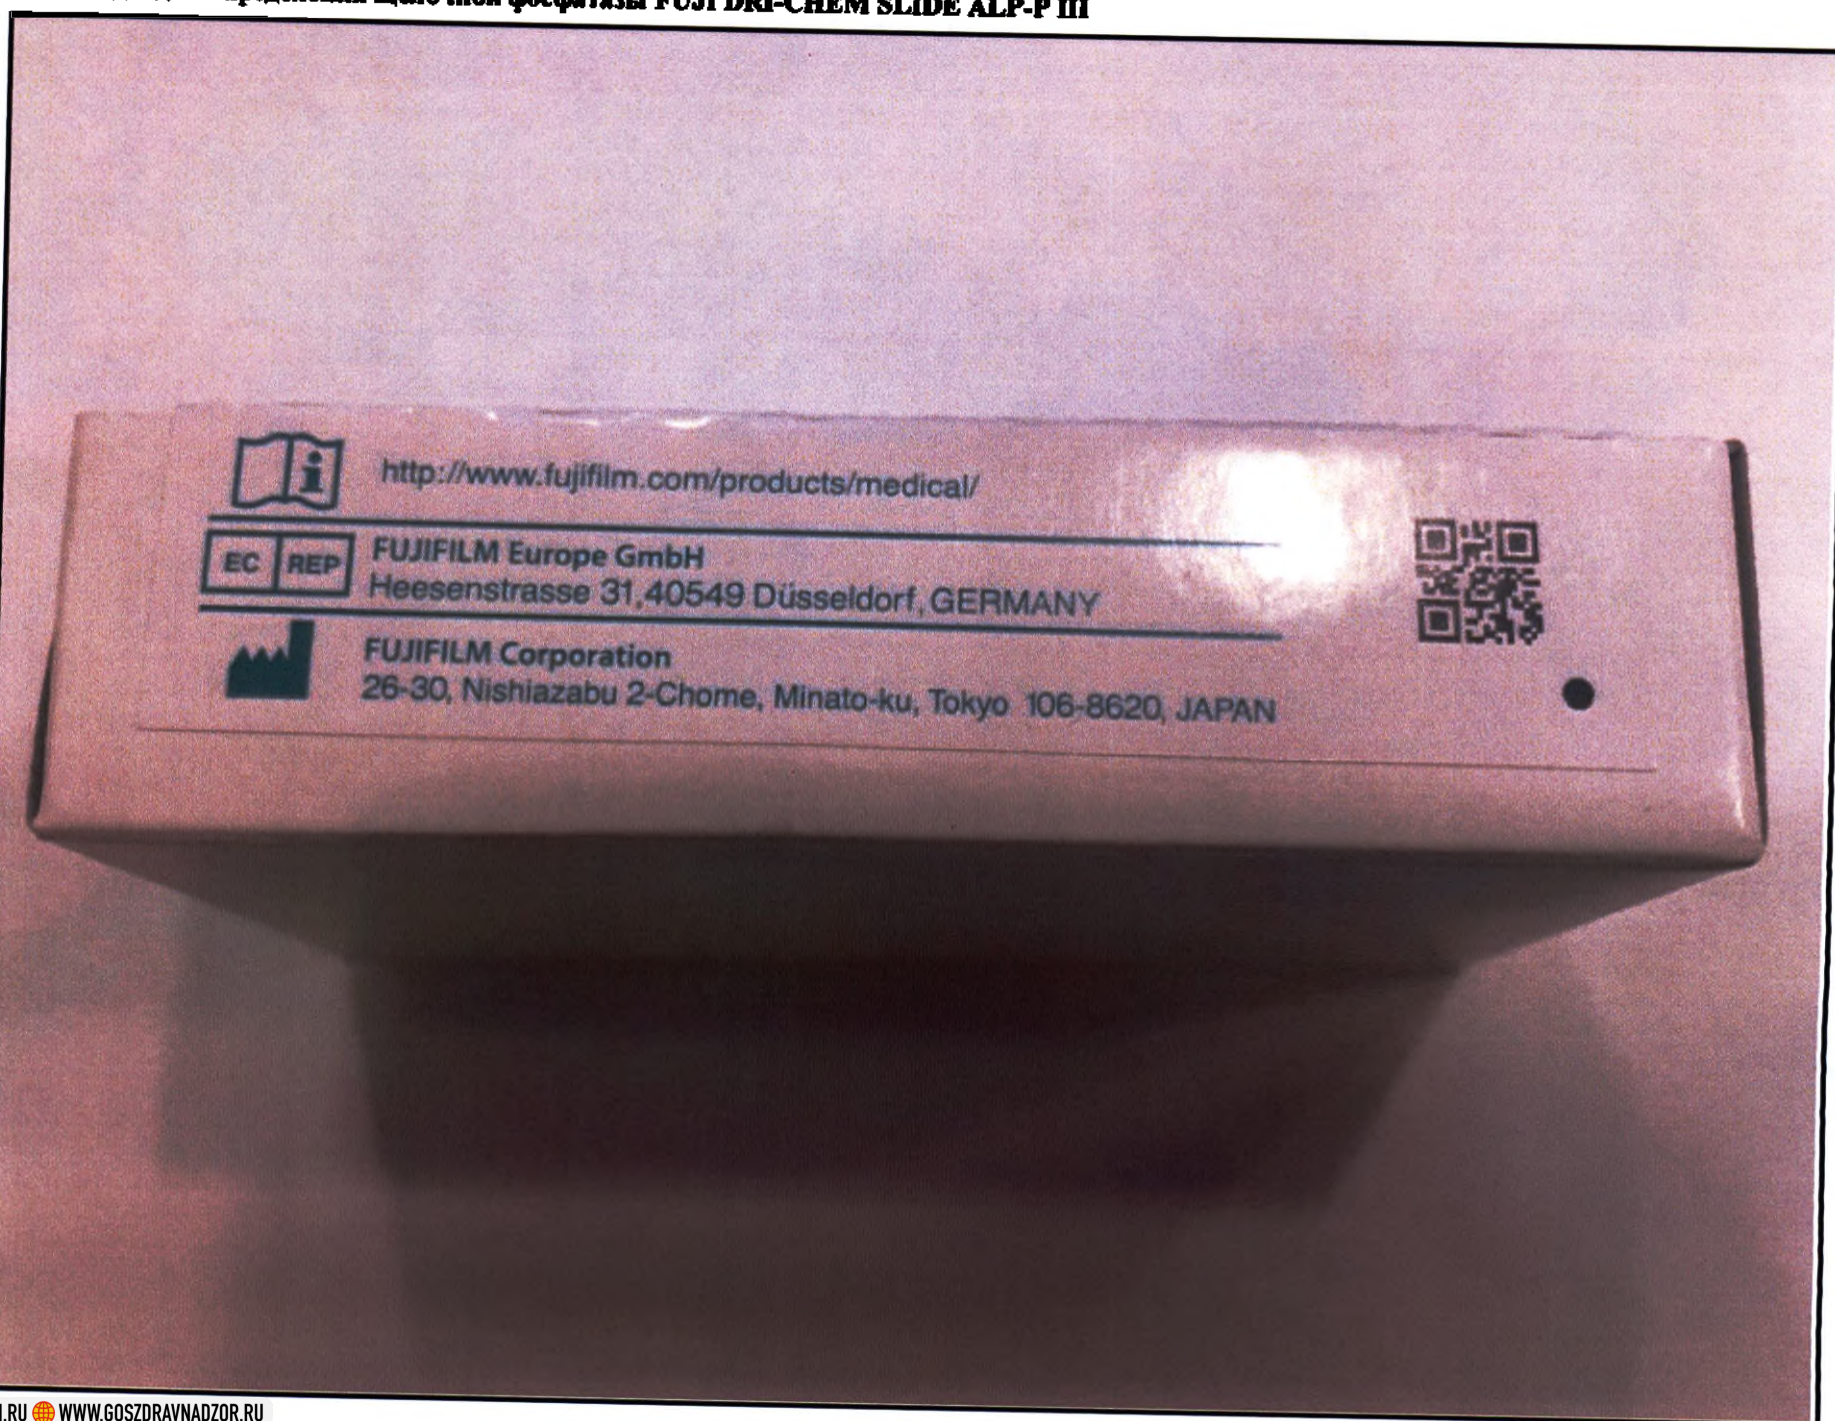



Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для
анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-
CHEM

Слайды для определения щелочной фосфатазы FUJI DRI-
CHEM SLIDE ALP-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809401

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на
упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-
ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:


АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19
корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

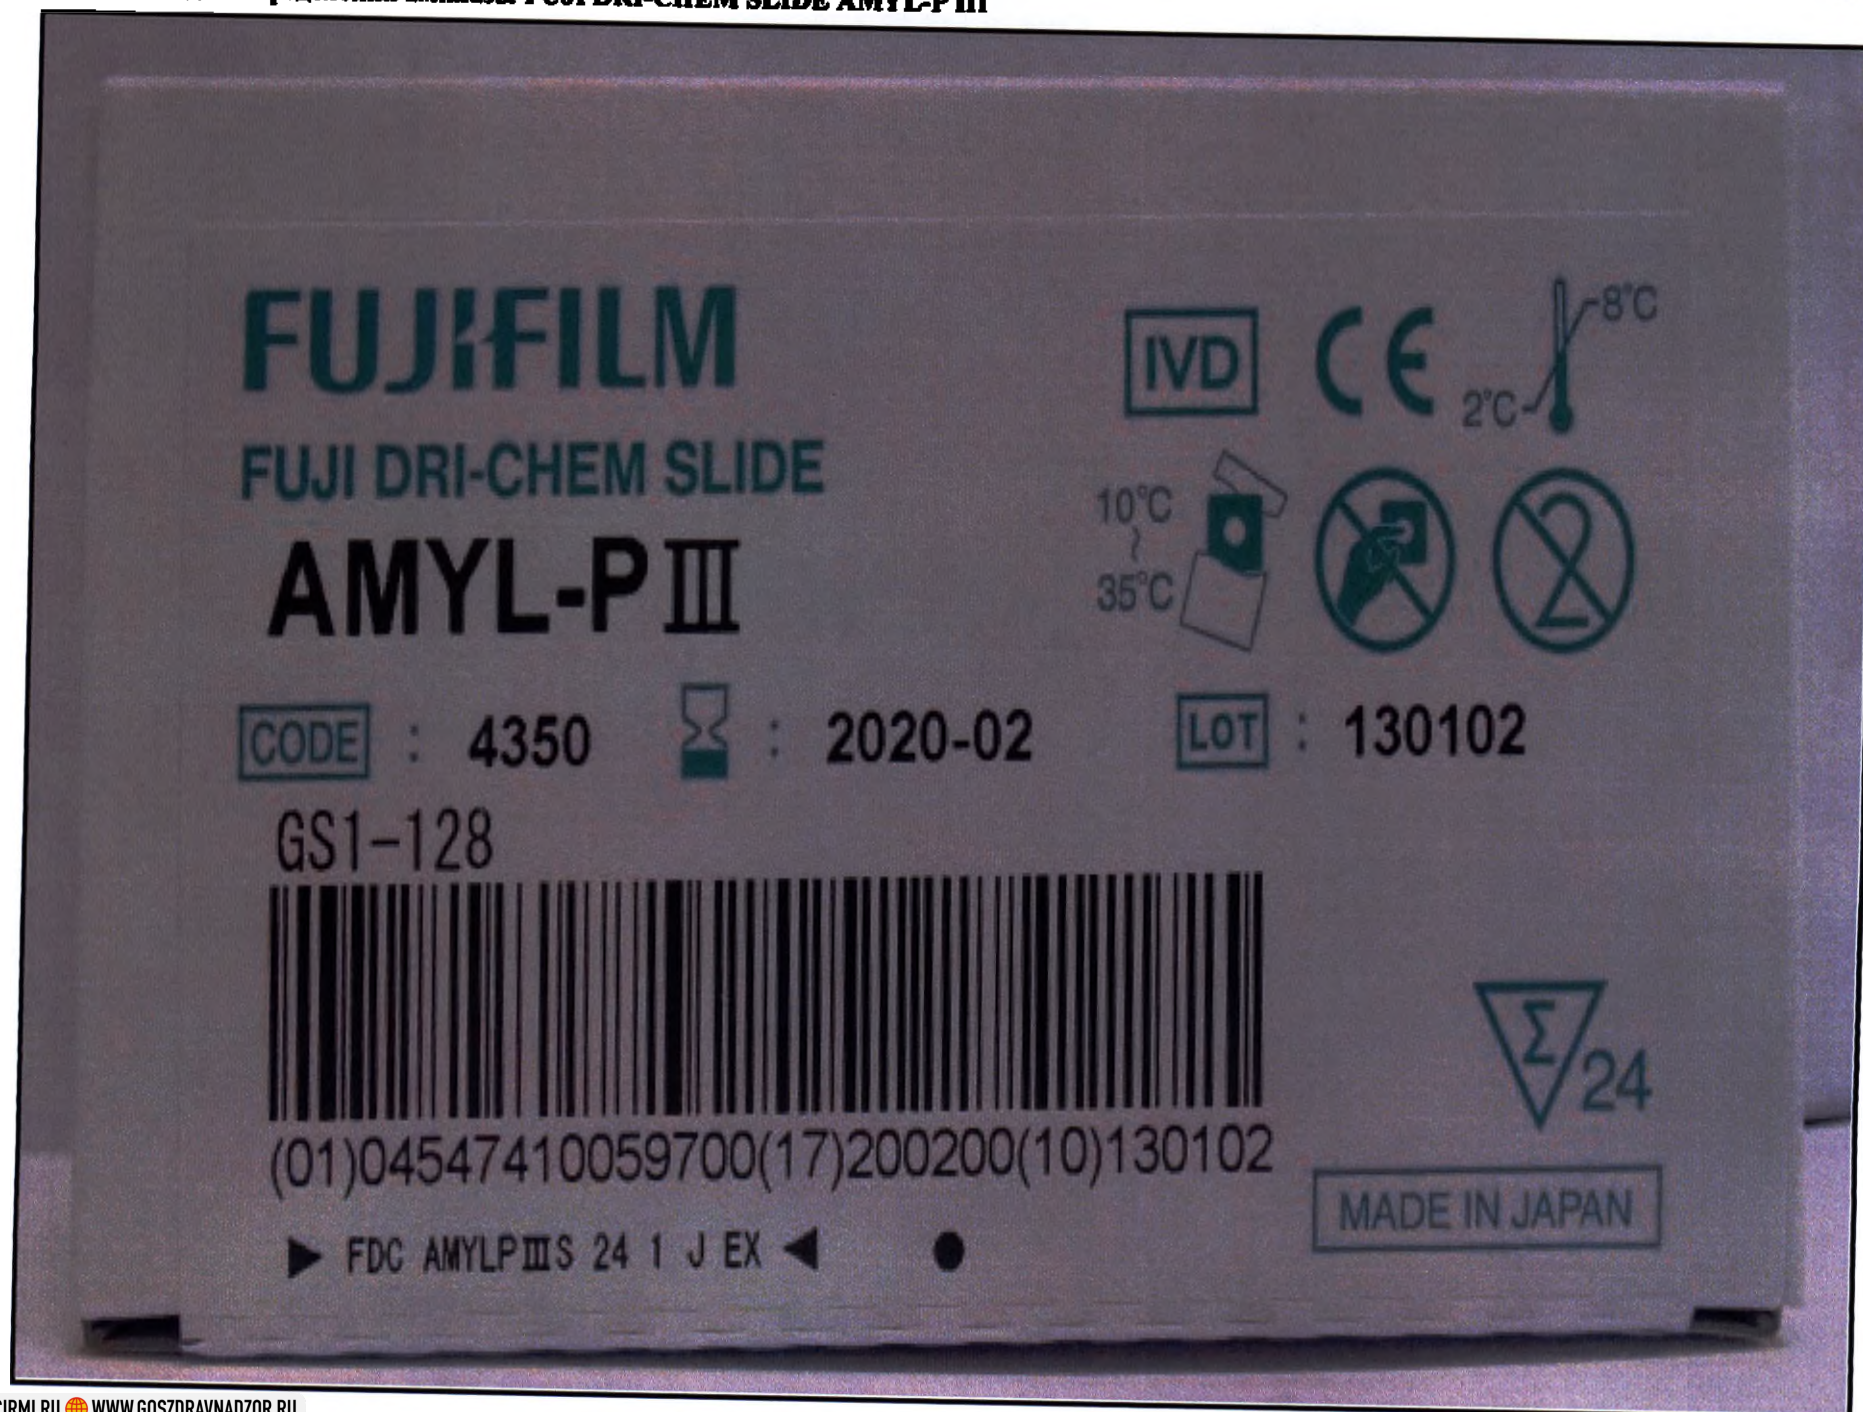

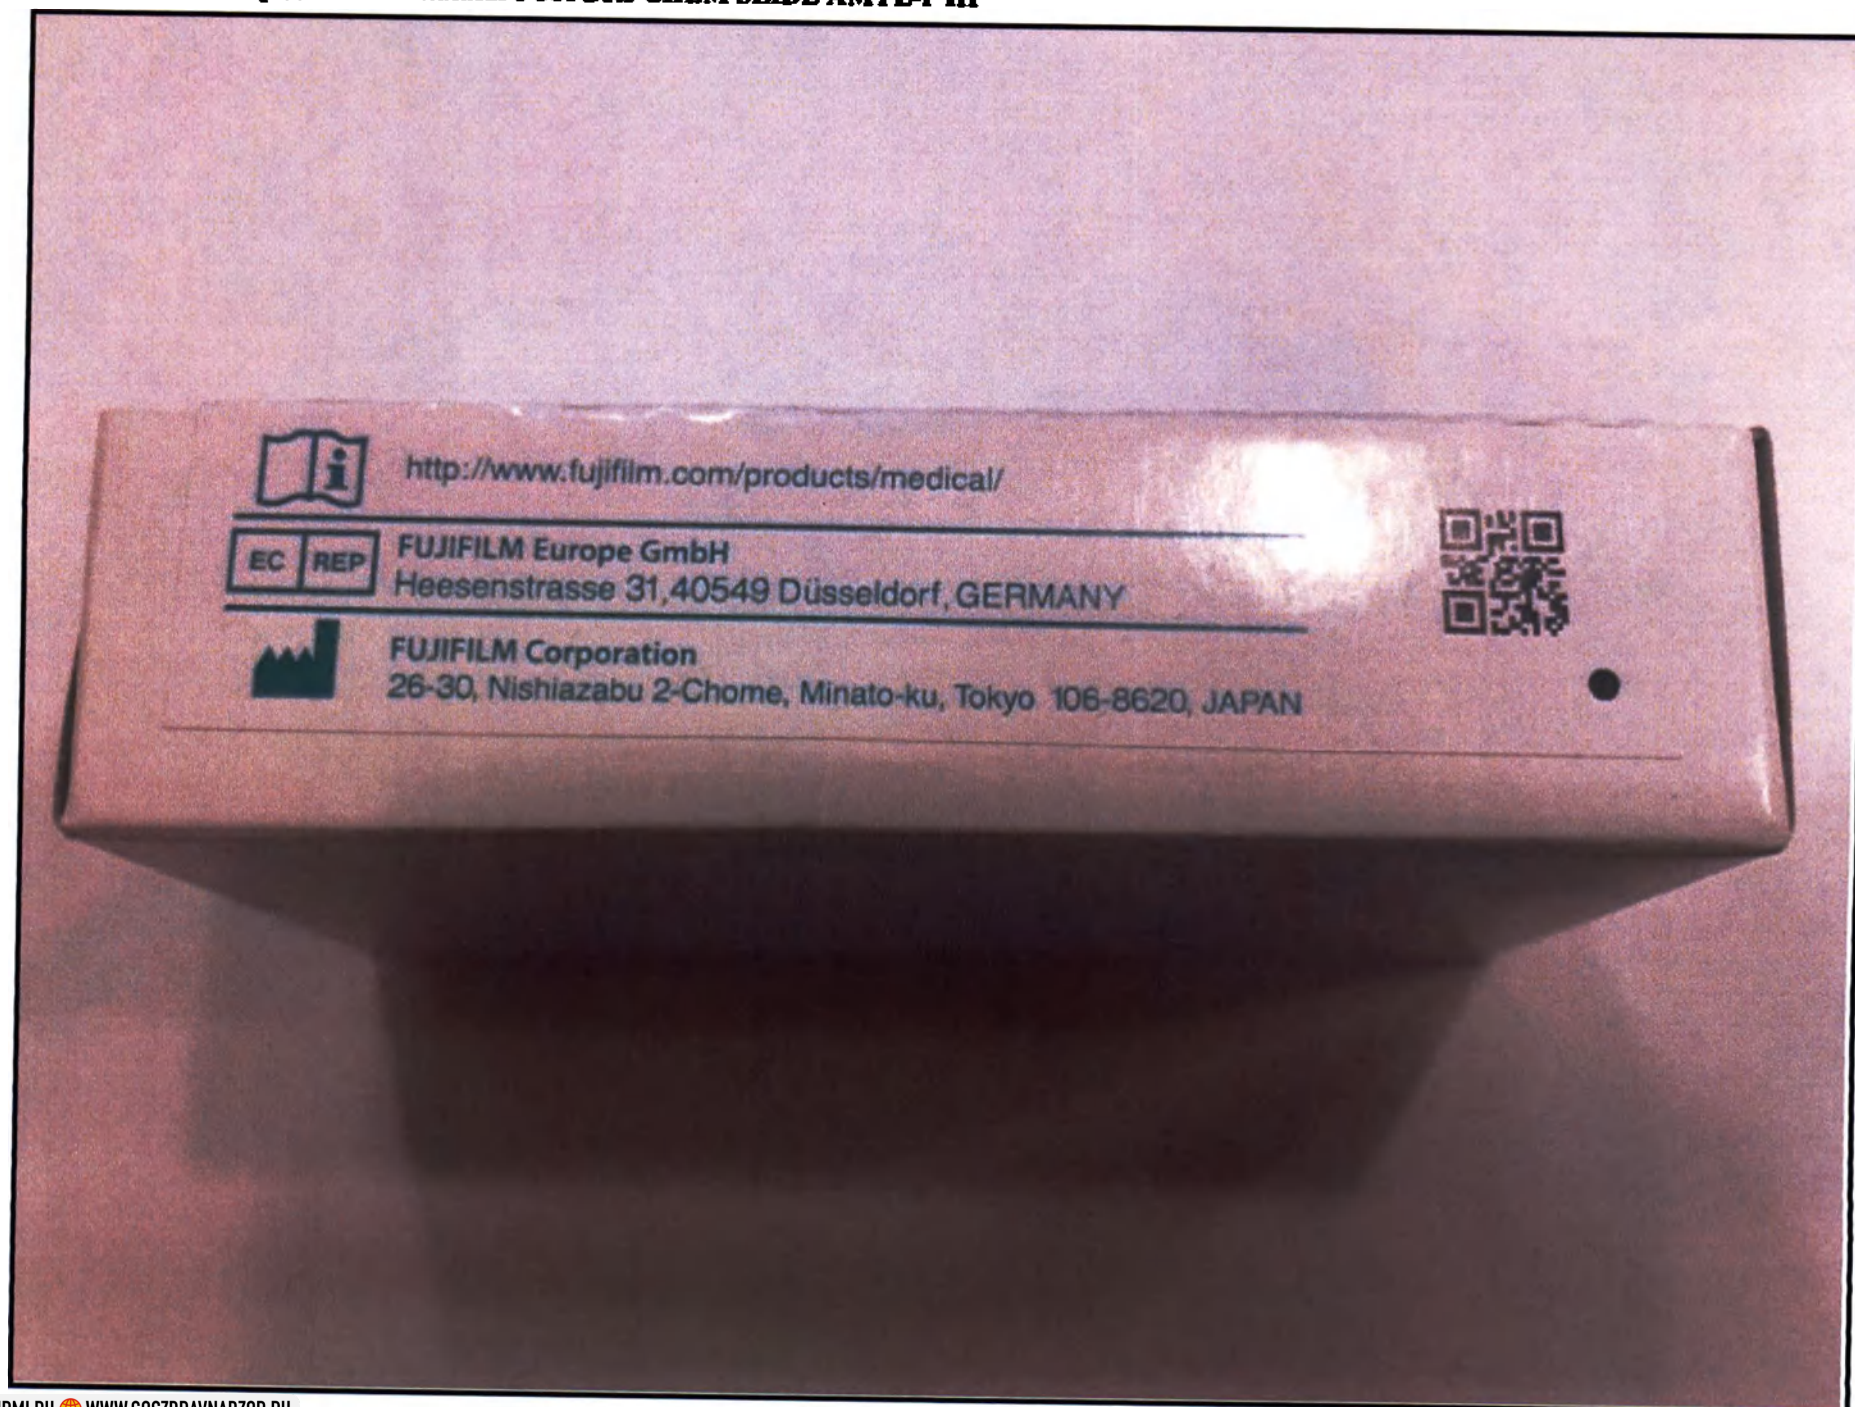



Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения амилазы FUJI DRI-CHEM SLIDE AMYL-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15827934

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19
корп. 1.

Телефон: (495) 9567937



info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

4. Слайды для определения азота мочевины крови FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-P III





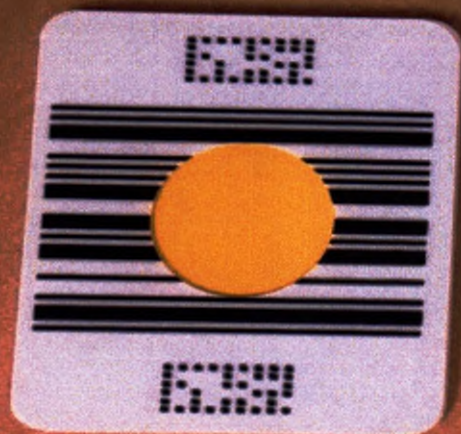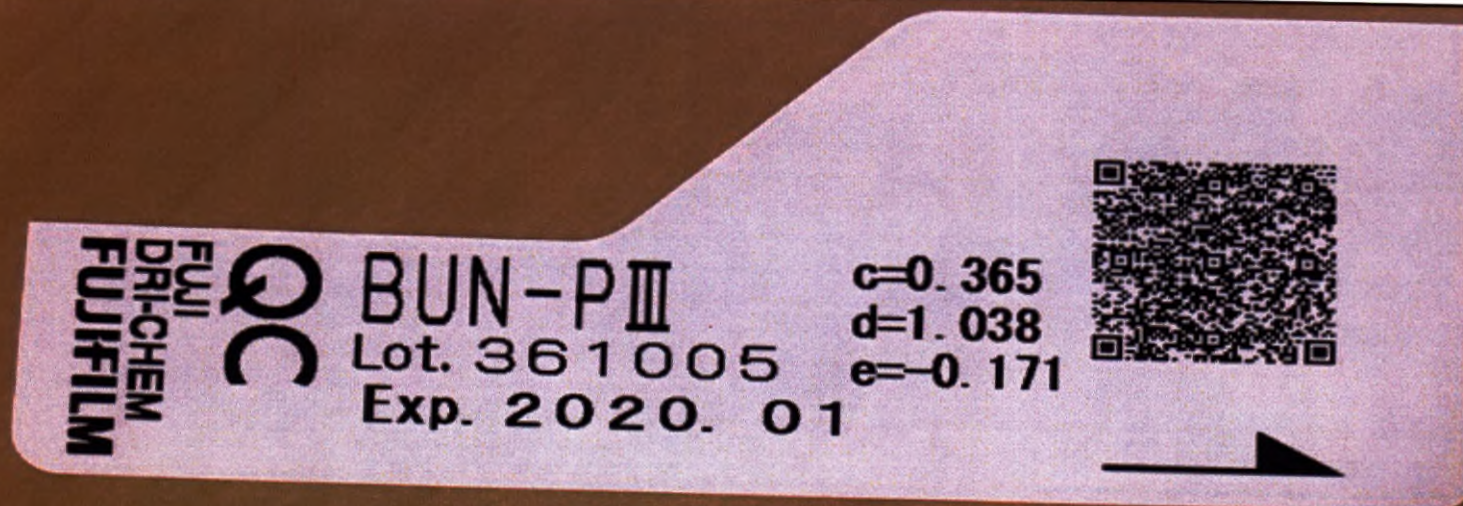

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения азота мочевины крови FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809425

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:


АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

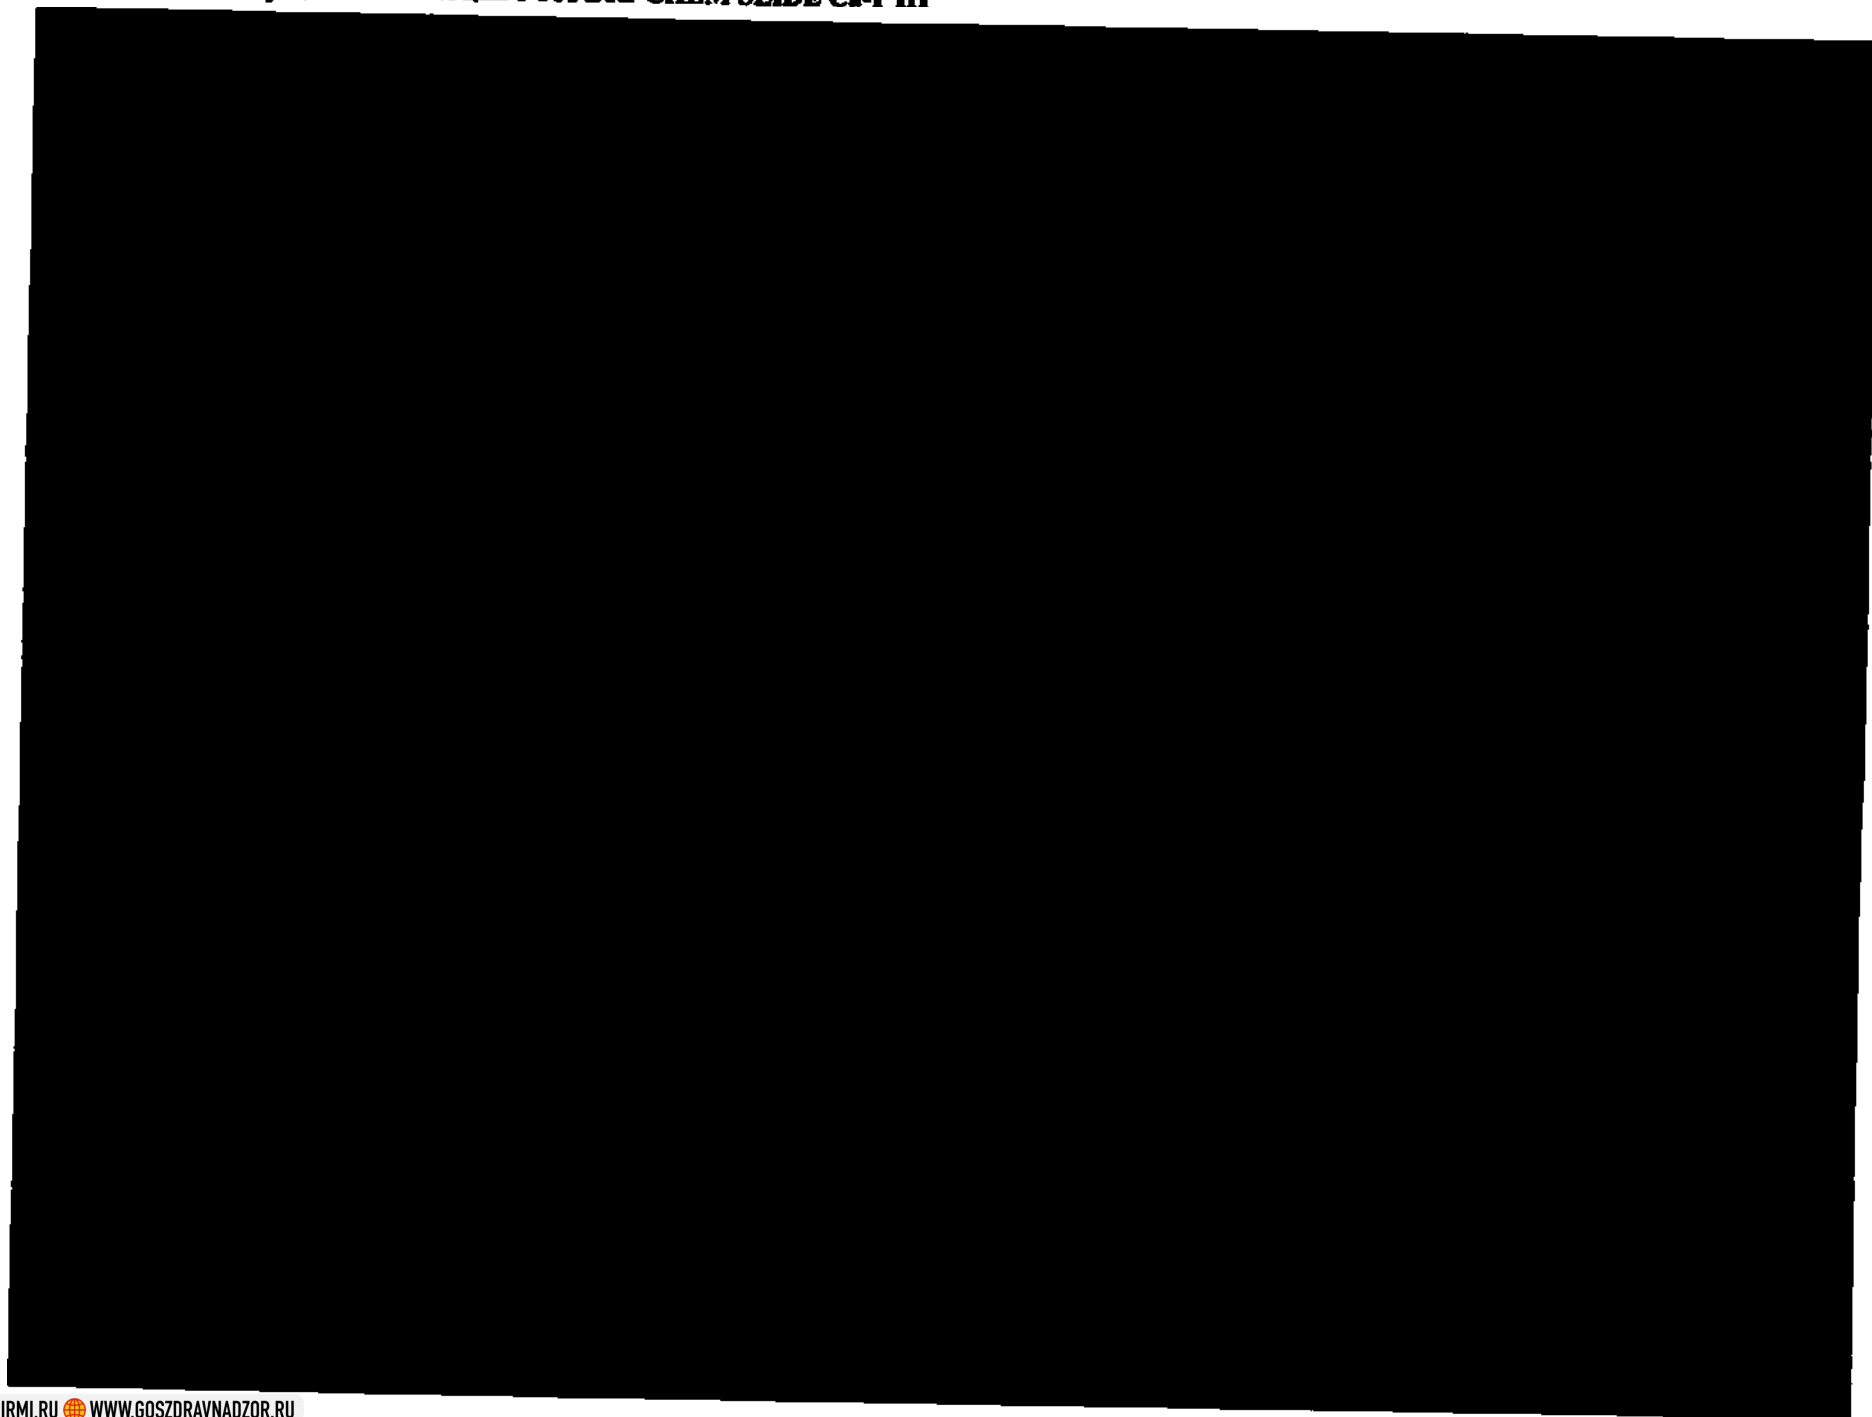

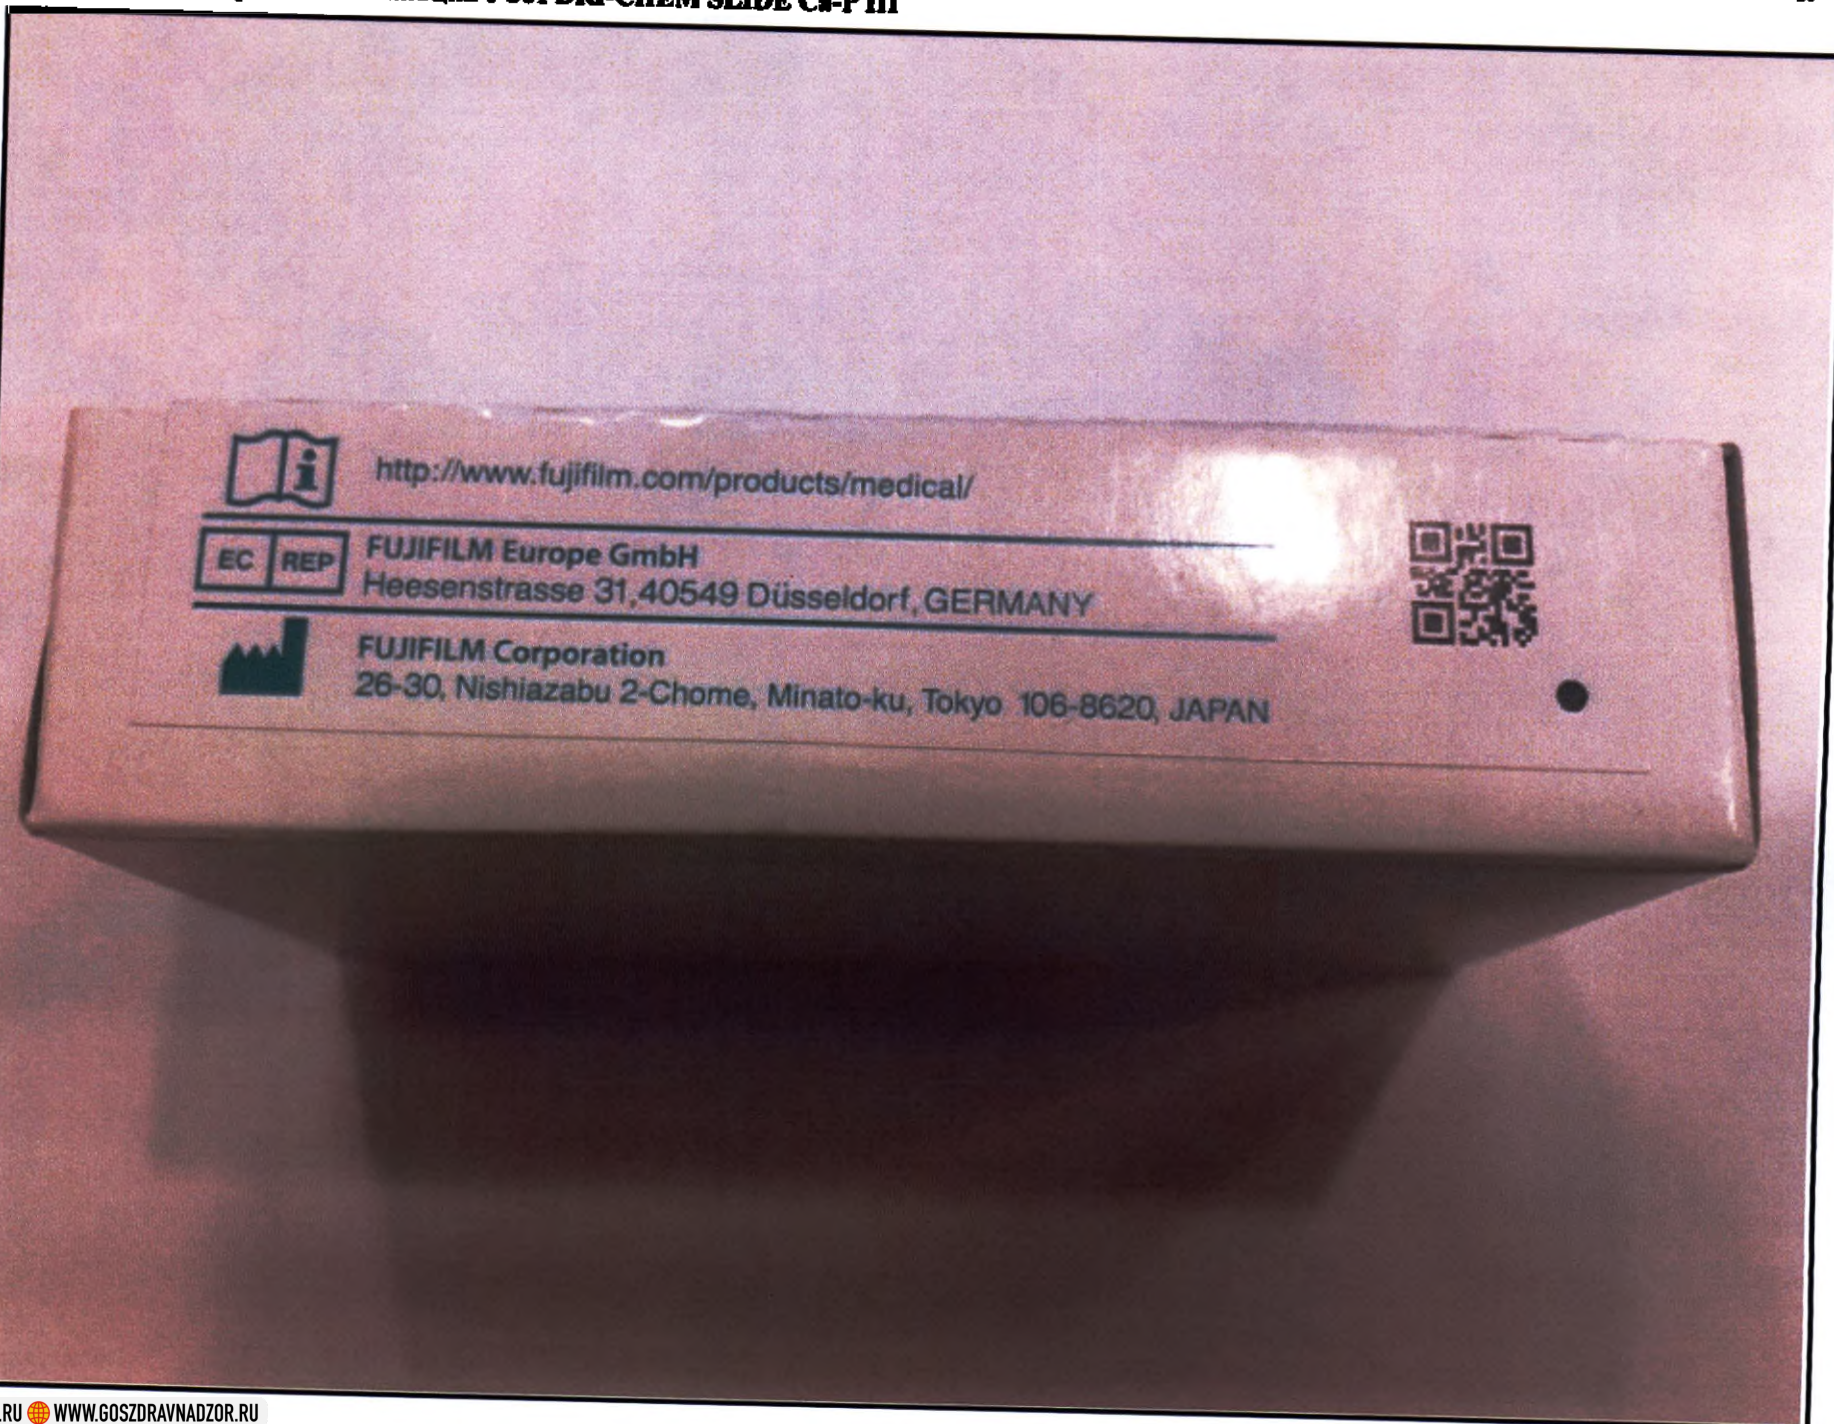



Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для
анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-
CHEM

Слайды для определения кальция FUJI DRI-CHEM SLIDE
Ca-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809437

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на
упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-
ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:


АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19
корп. 1.


Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

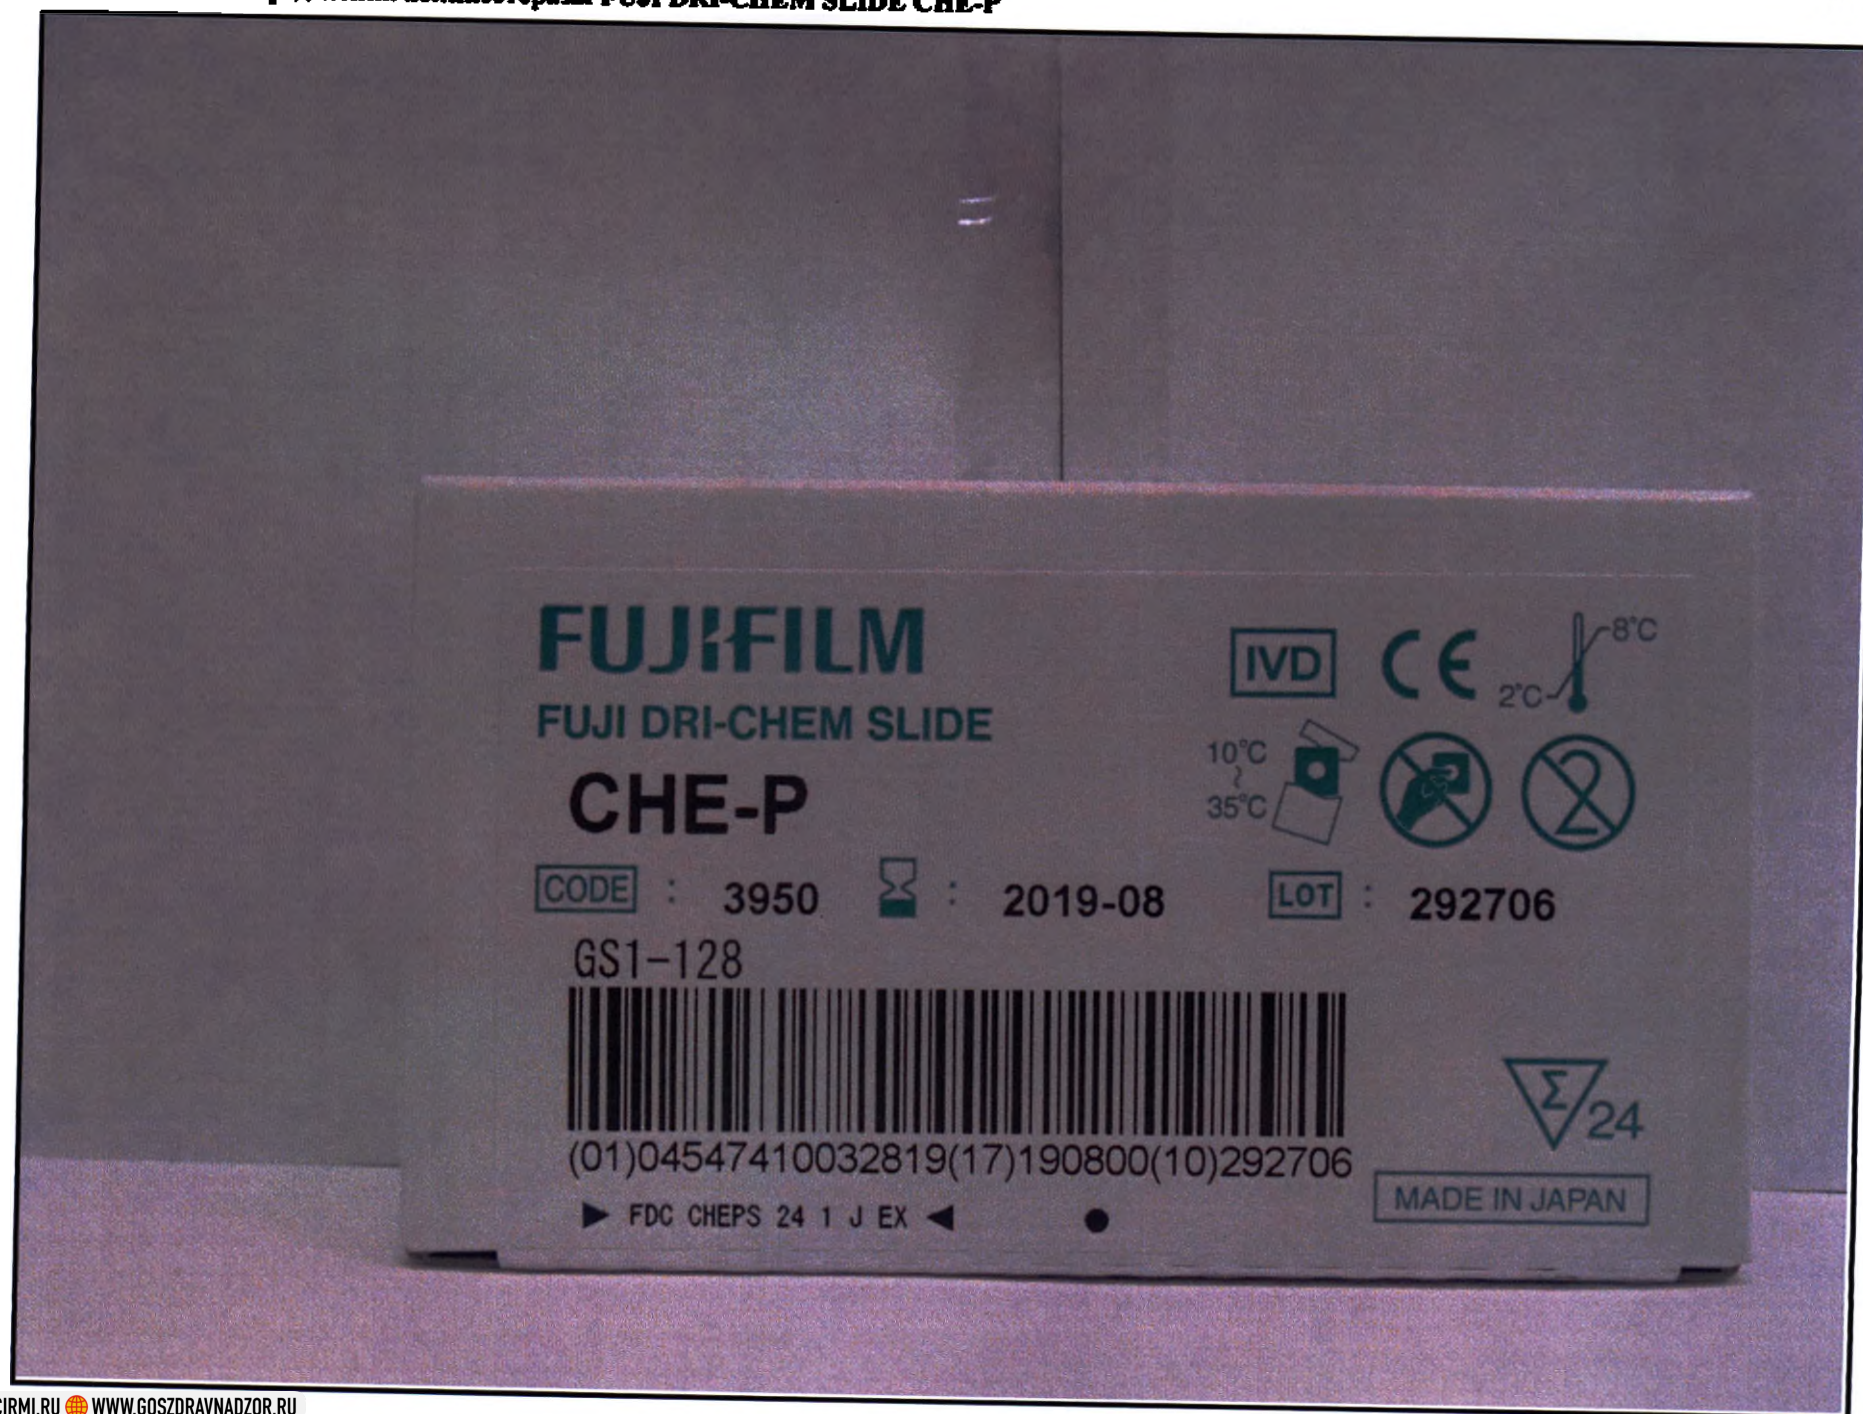



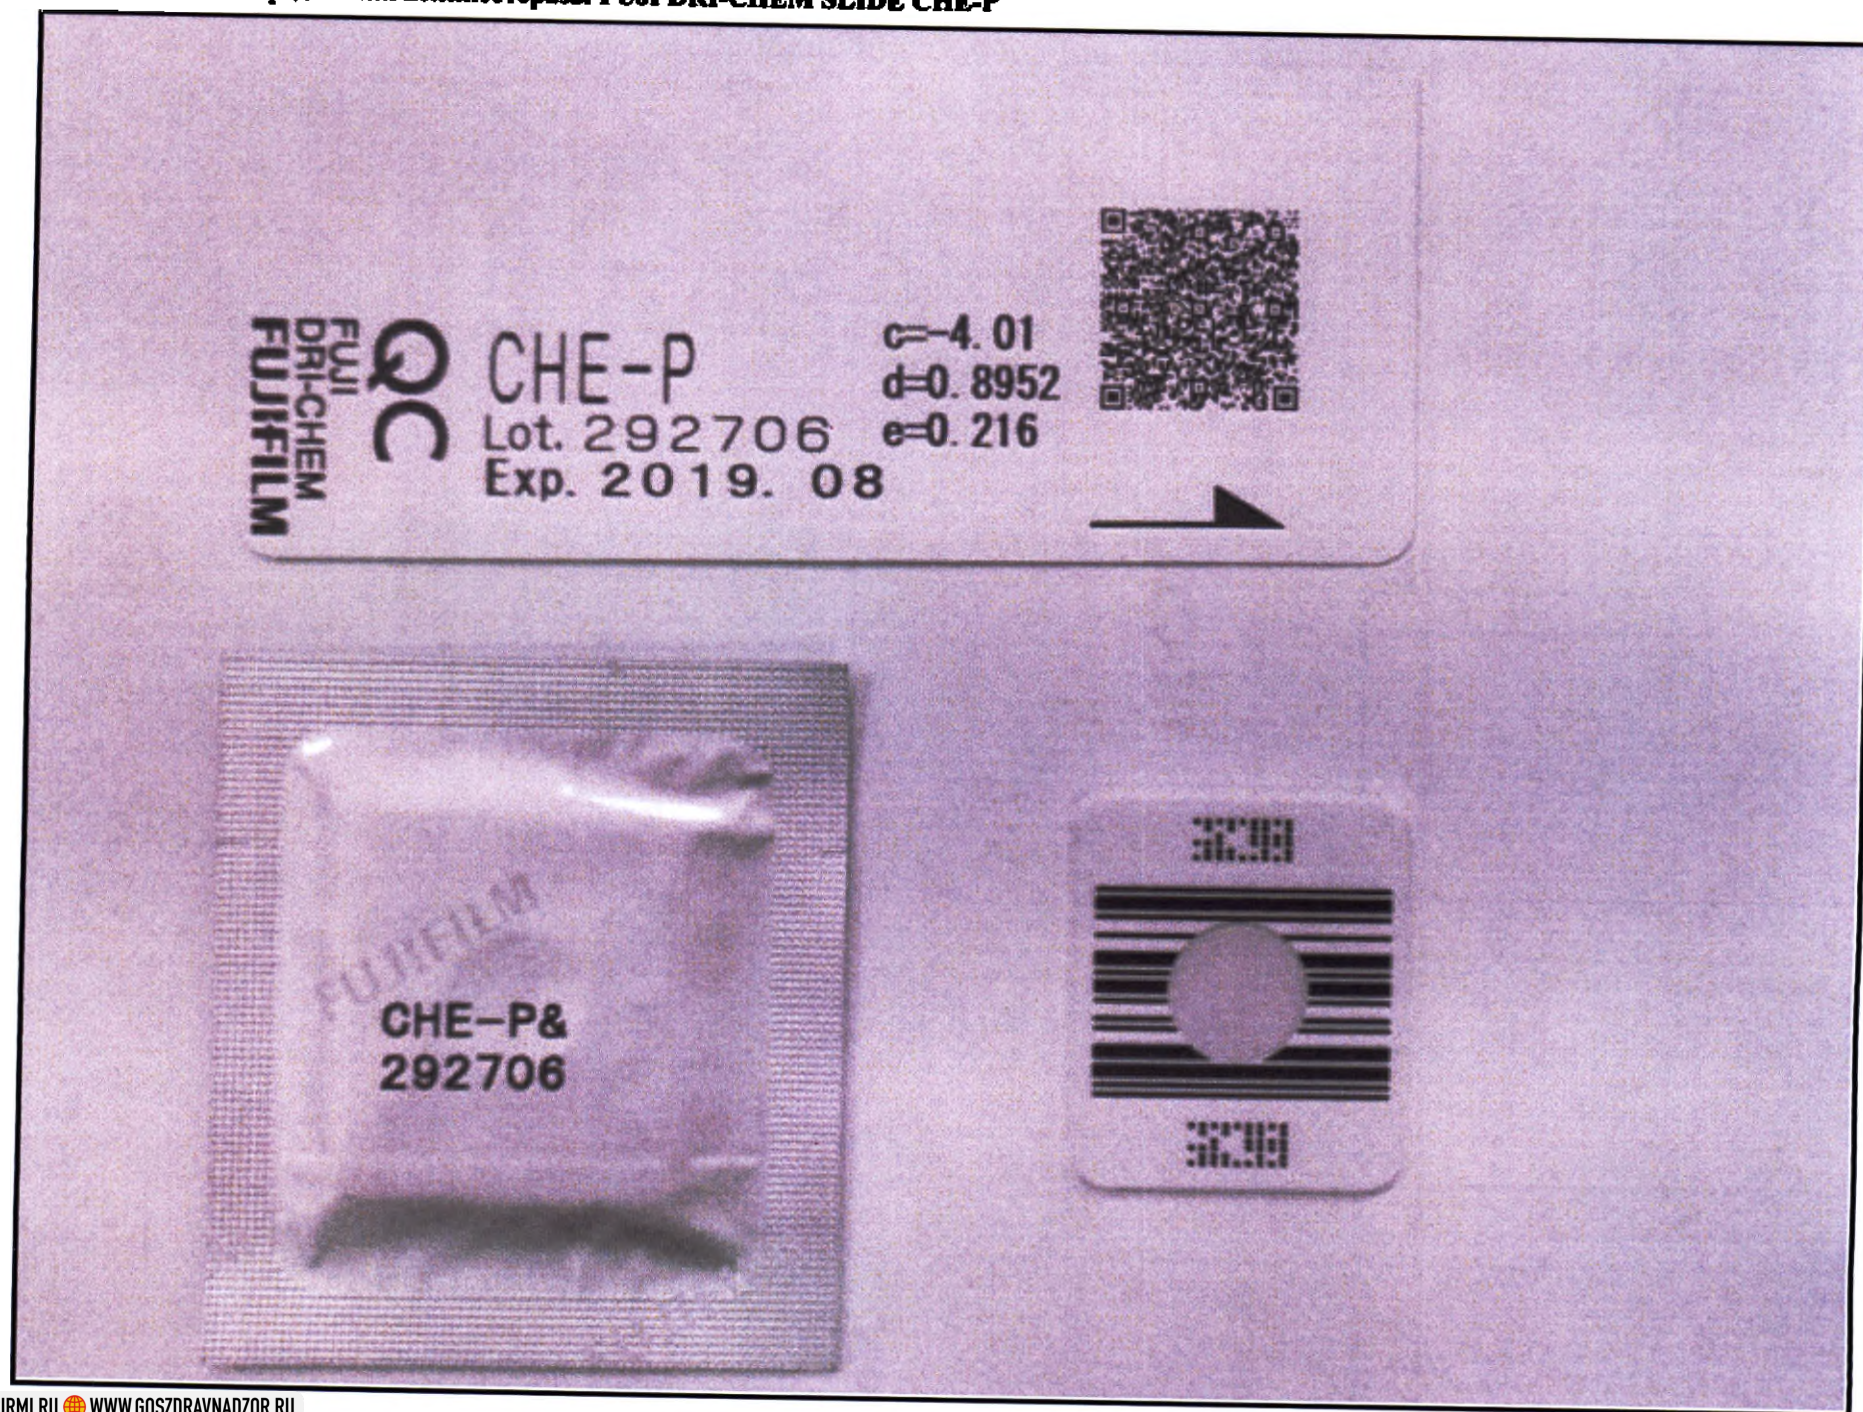

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения холинэстеразы FUJI DRI-CHEM SLIDE CHE-P - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809449

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:


АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.


Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

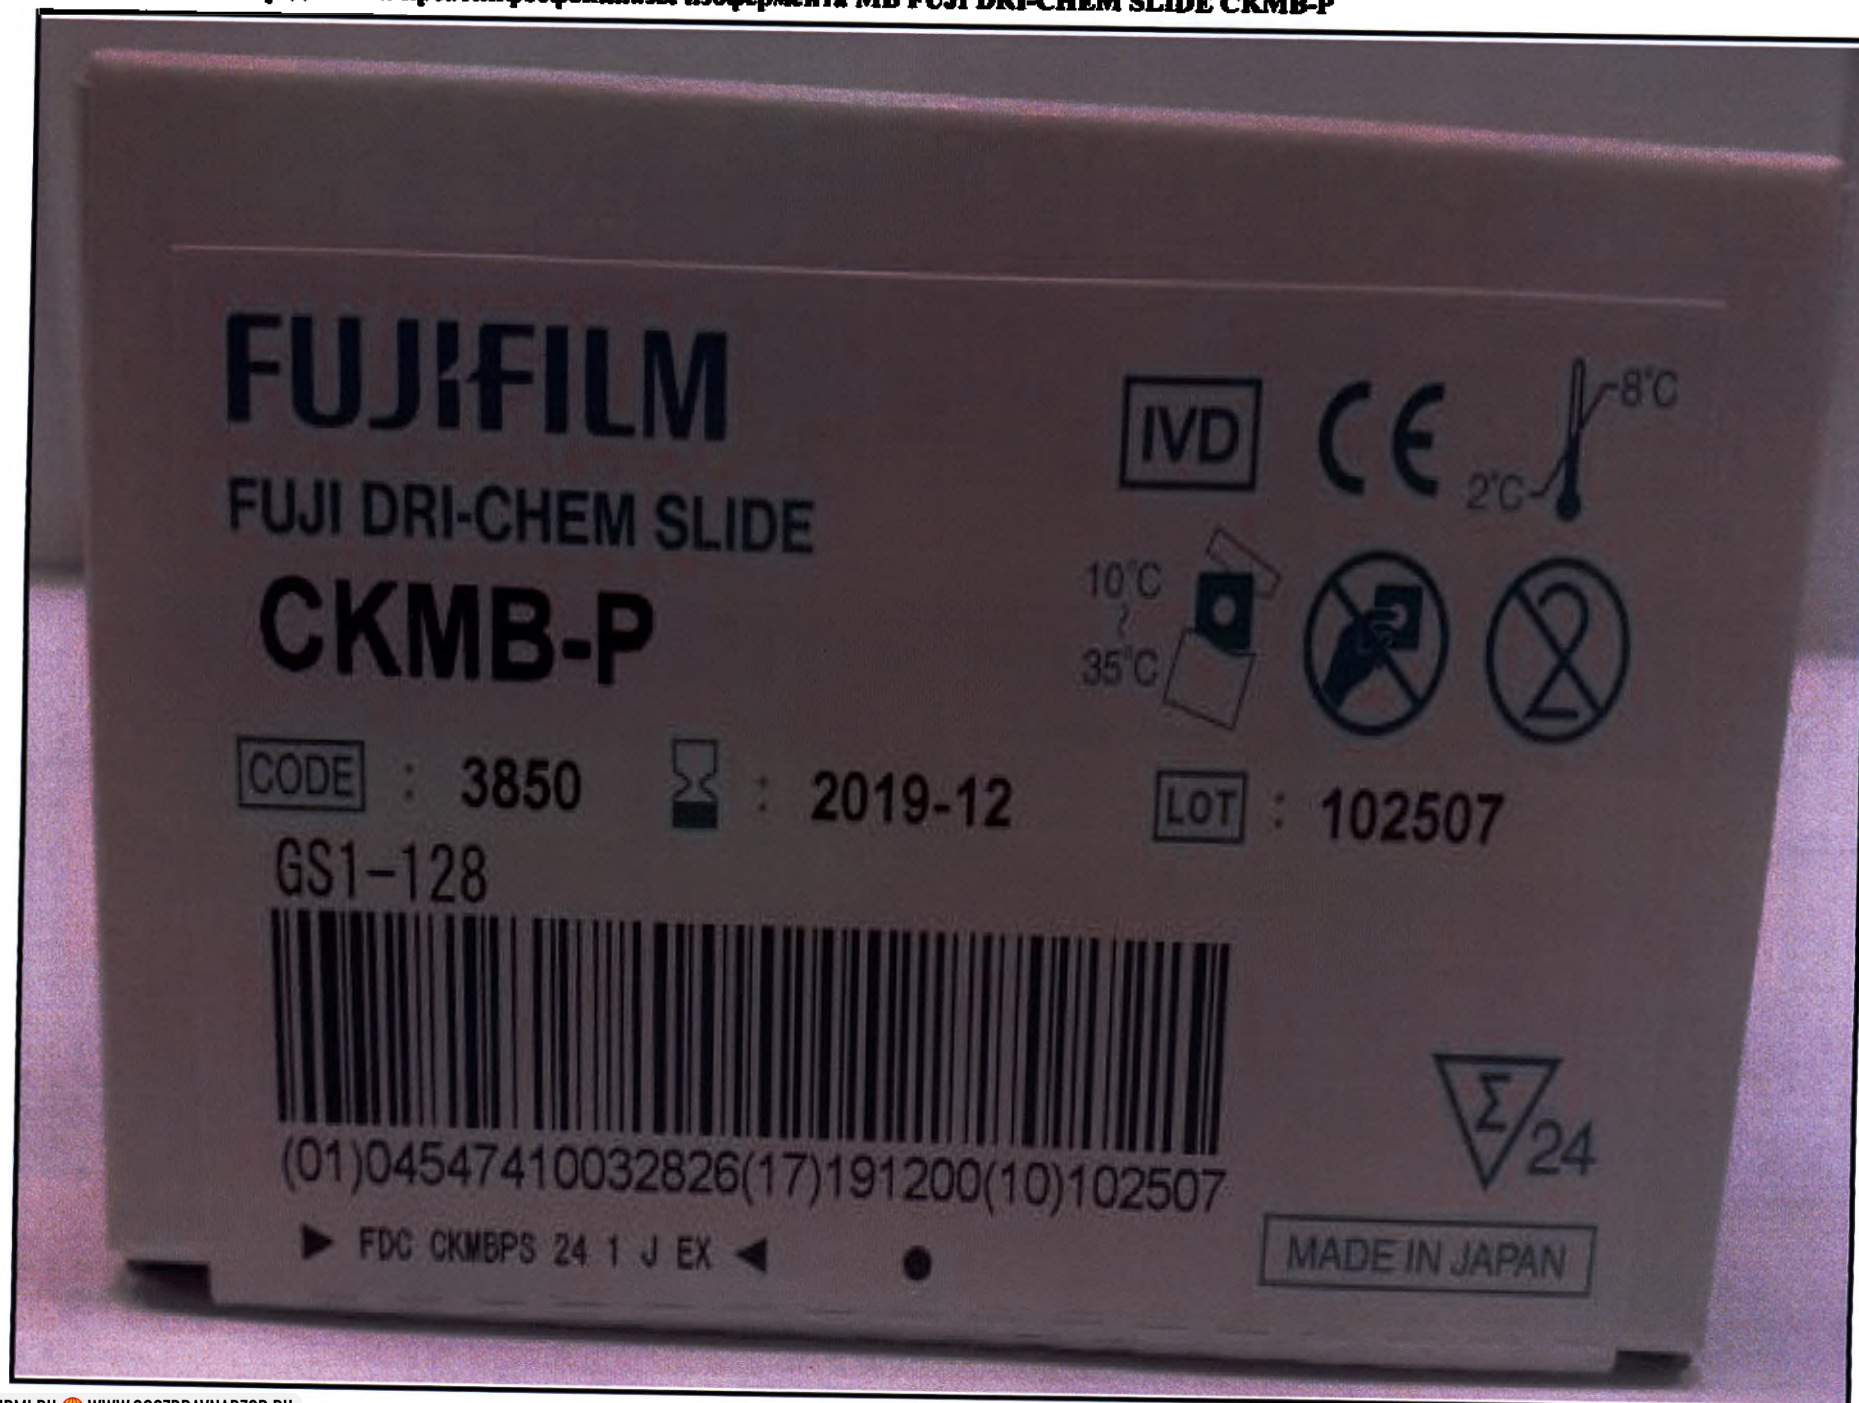

7. Слайды для определения креатинфосфокиназы изофермента MB FUJI DRI-CHEM SLIDE CKMB-P

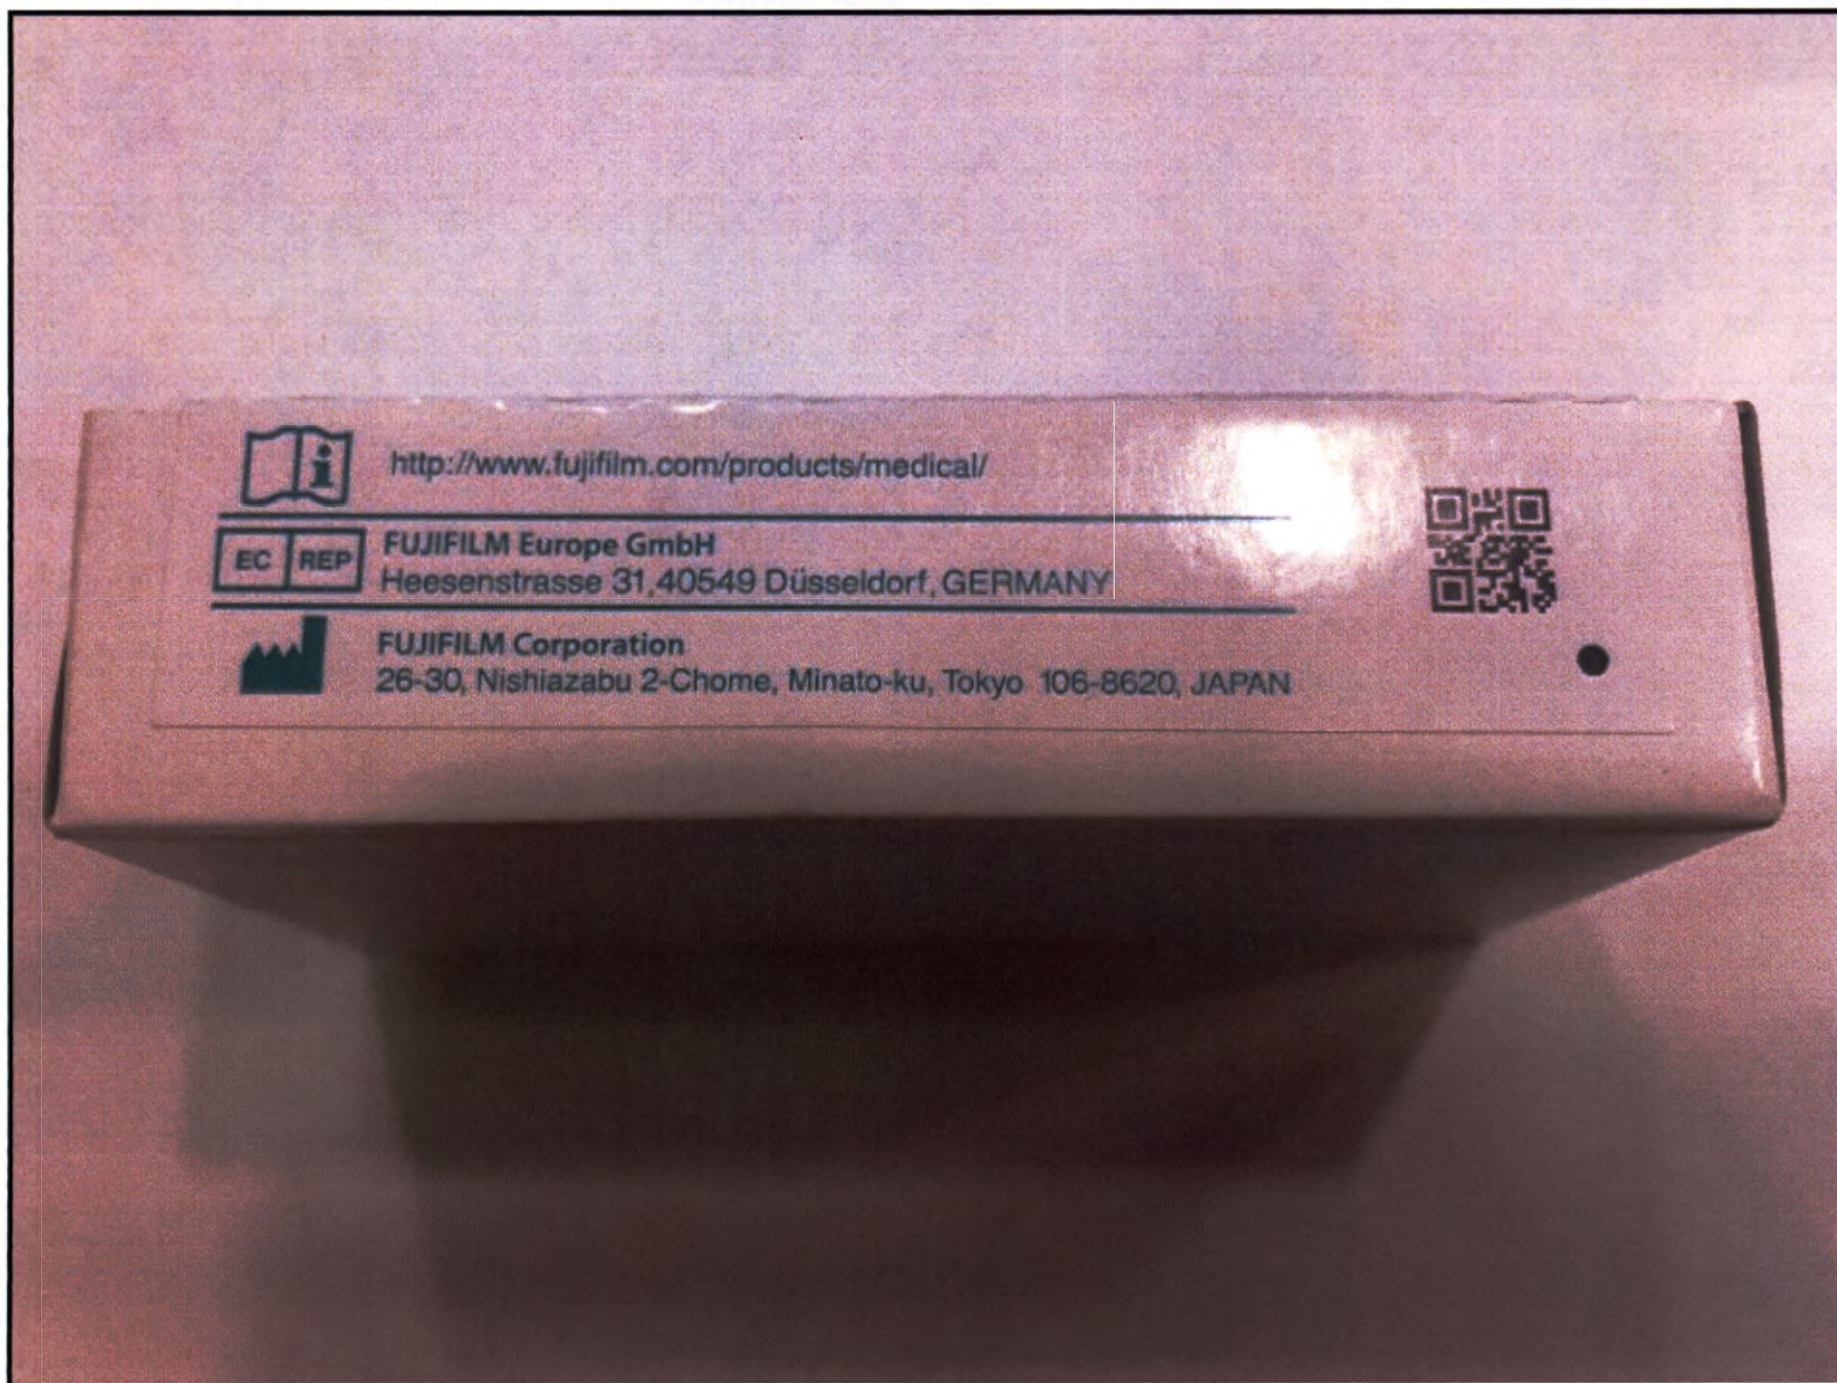

7. Слайды для определения креатинфосфокиназы изофермента MB FUJI DRI-CHEM SLIDE CKMB-P



7. Слайды для определения креатинфосфокиназы изофермента MB FUJI DRI-CHEM SLIDE CKMB-P — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения креатинфосфокиназы изофермента MB FUJI DRI-CHEM SLIDE CKMB-P-24 шт./1 уп.

Кат. № 15809451

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

8. Слайды для определения креатинфосфокиназы FUJI DRI-CHEM SLIDE CPK-P III



8. Слайды для определения креатинфосфокиназы FUJI DRI-CHEM SLIDE CPK-P III



8. Слайды для определения креатинфосфокиназы FUJI DRI-CHEM SLIDE CPK-P III



8. Слайды для определения креатинфосфокиназы FUJI DRI-CHEM SLIDE CPK-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения креатинфосфокиназы FUJI DRI-CHEM SLIDE CPK-P III - 24 шт./1уп.

Кат. № 15809463

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 26.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


**Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19
корп. 1.**

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

9. Слайды для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-P III

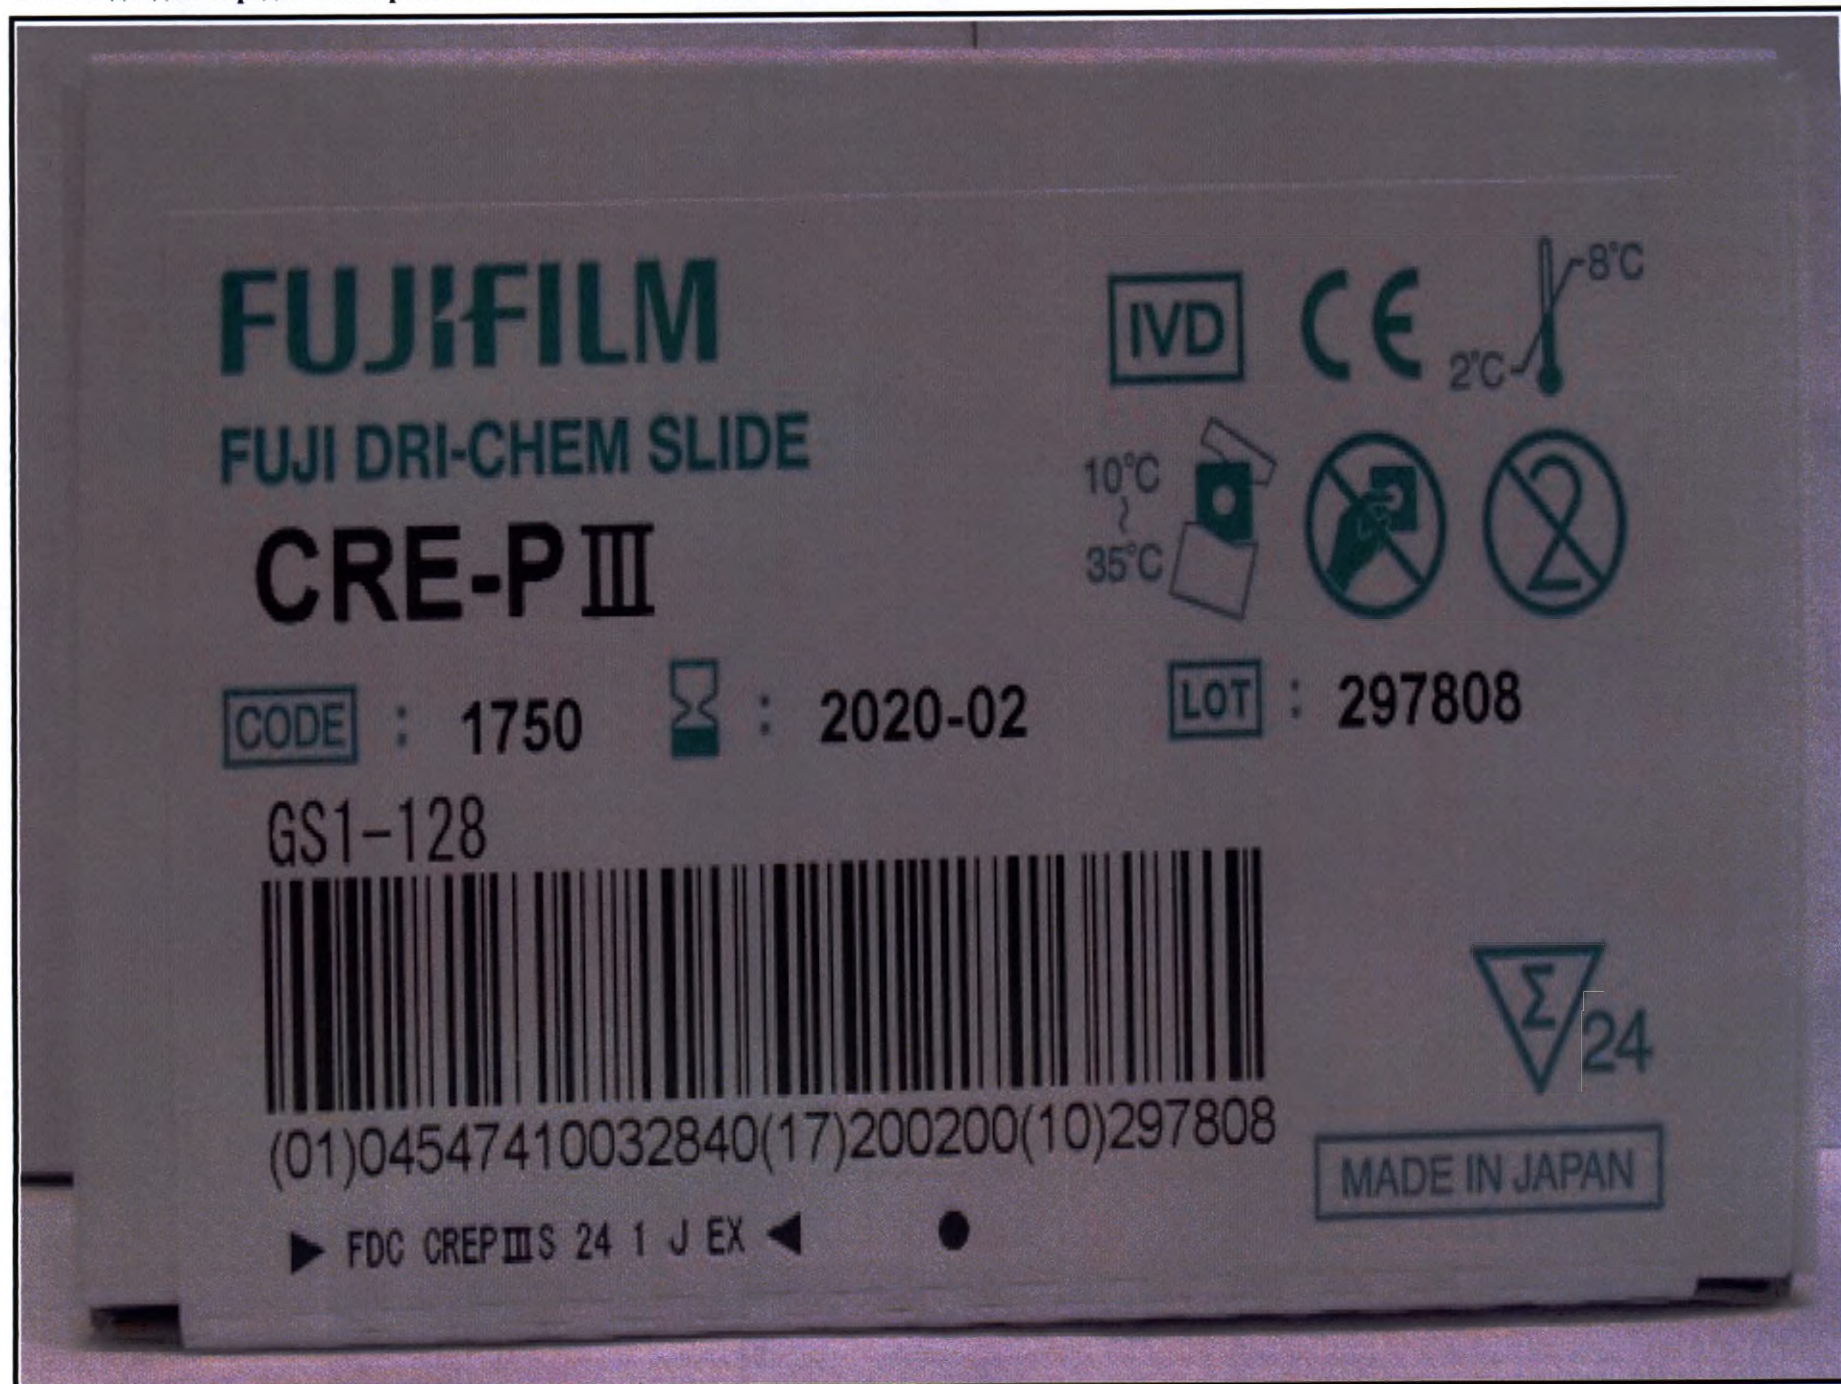

9. Слайды для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-P III

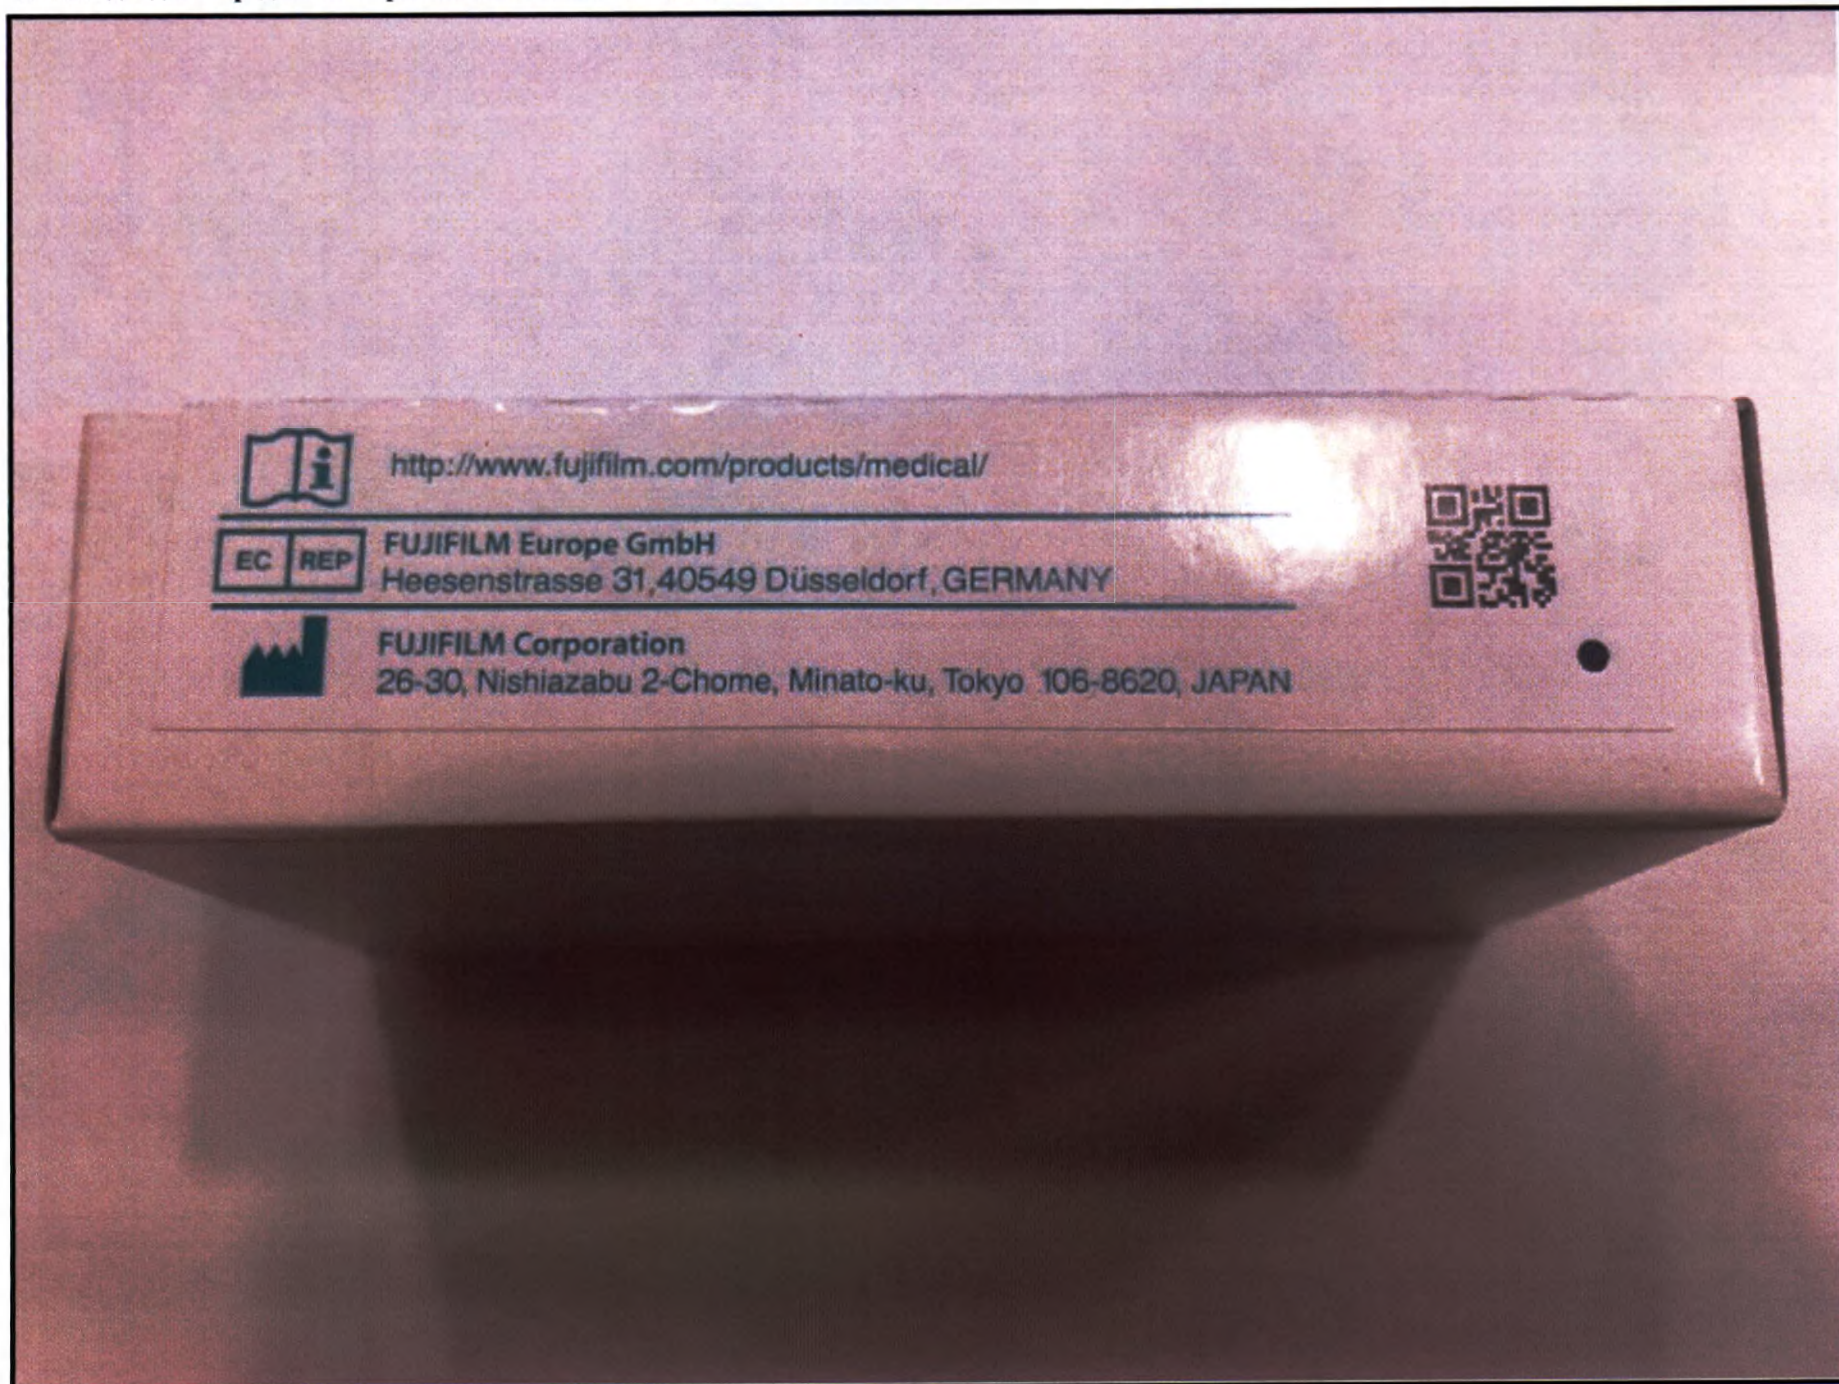

9. Слайды для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-P III



9. Слайды для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809475

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19
корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


10. Слайды для определения С-реактивного белка FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-S III



10. Слайды для определения С-реактивного белка FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-S III

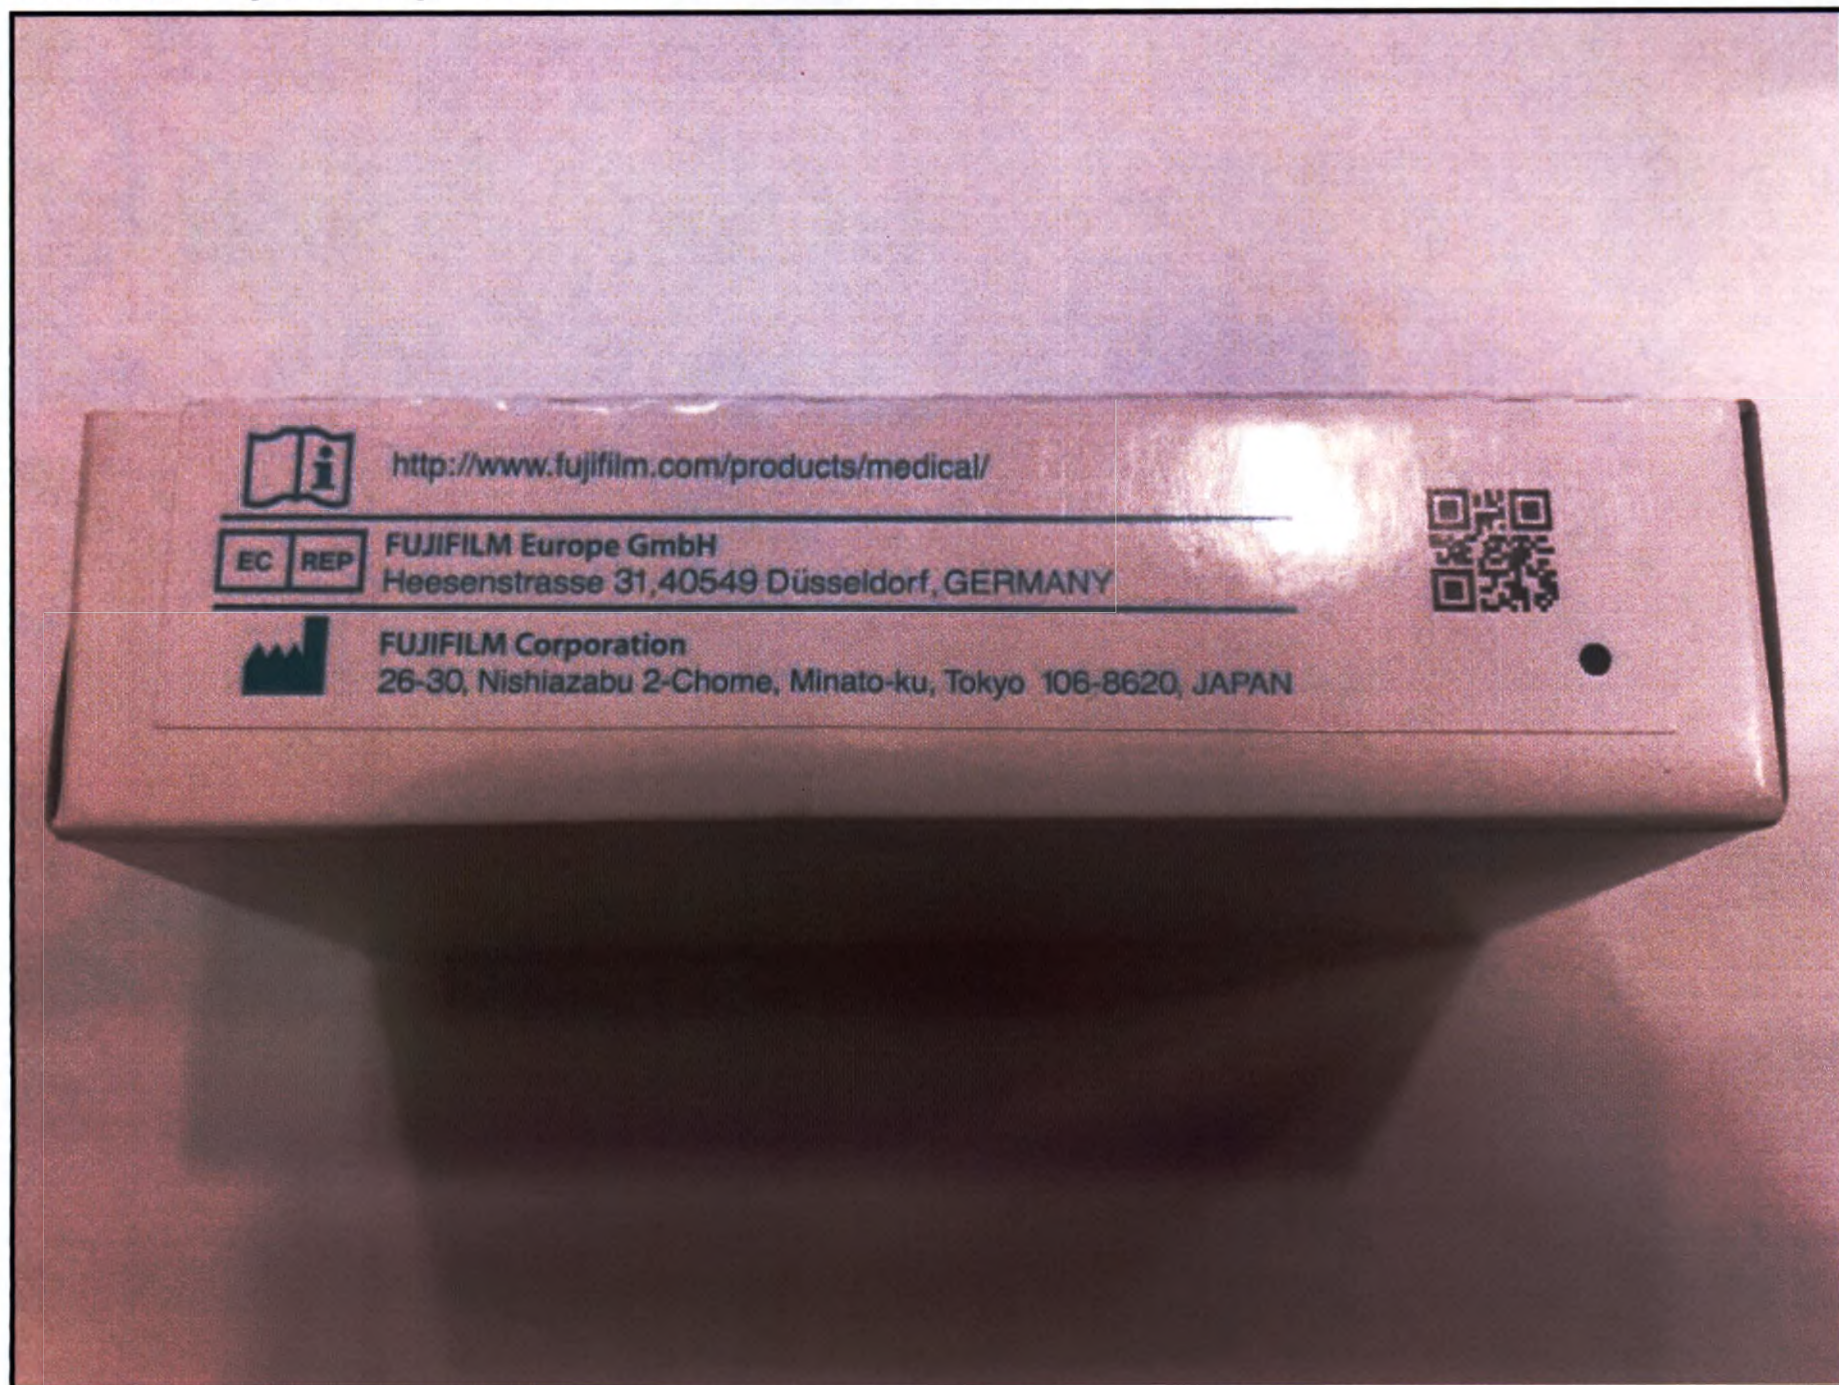

10. Слайды для определения С-реактивного белка FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-S III

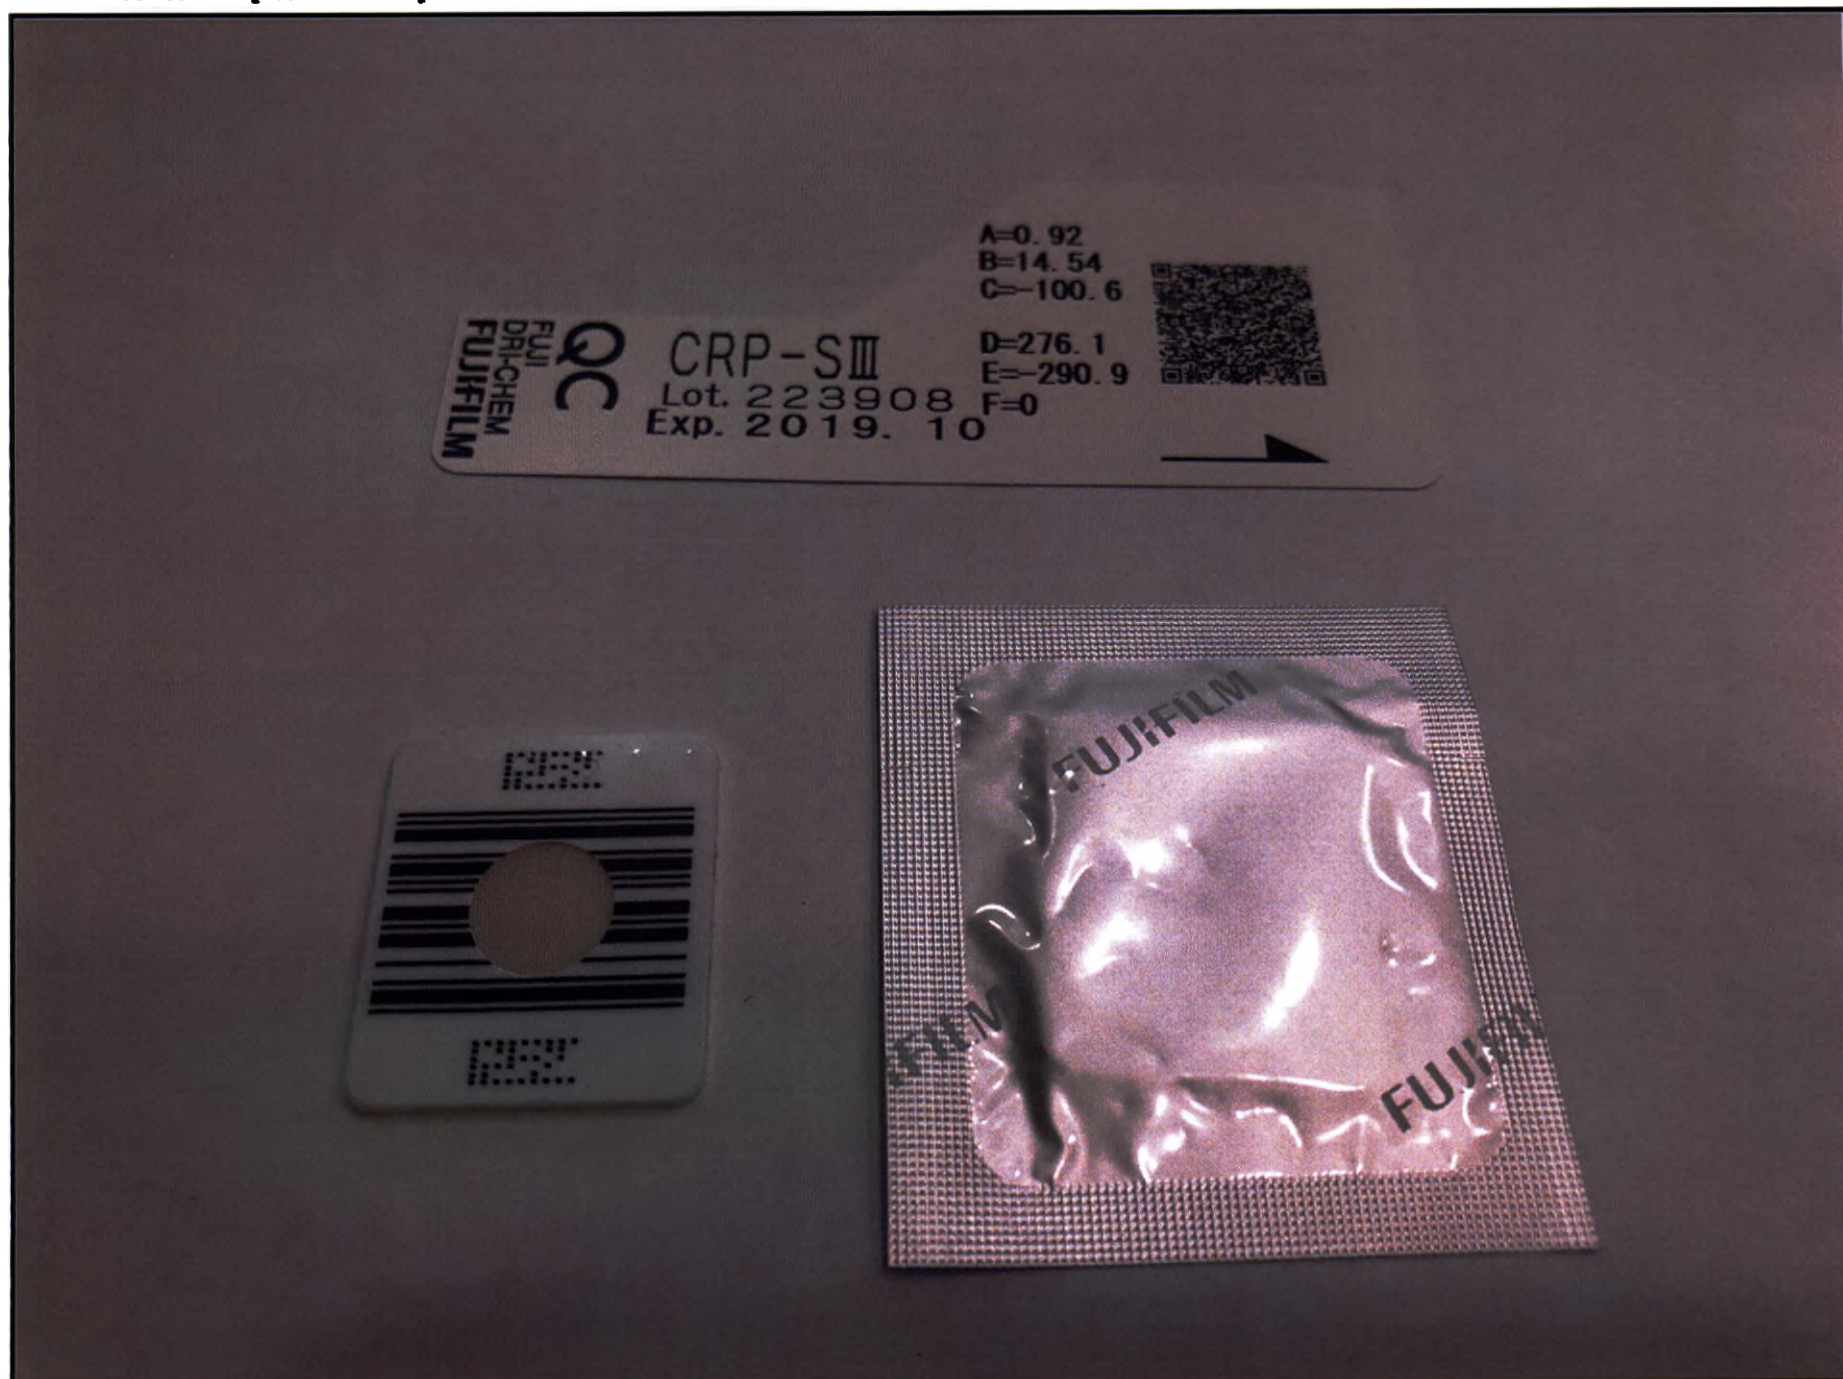

10. Слайды для определения С-реактивного белка FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-S III — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения С-реактивного белка FUJI DRI-CHEM SLIDE CRP-S III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809499

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

11. Слайды для определения прямого билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II

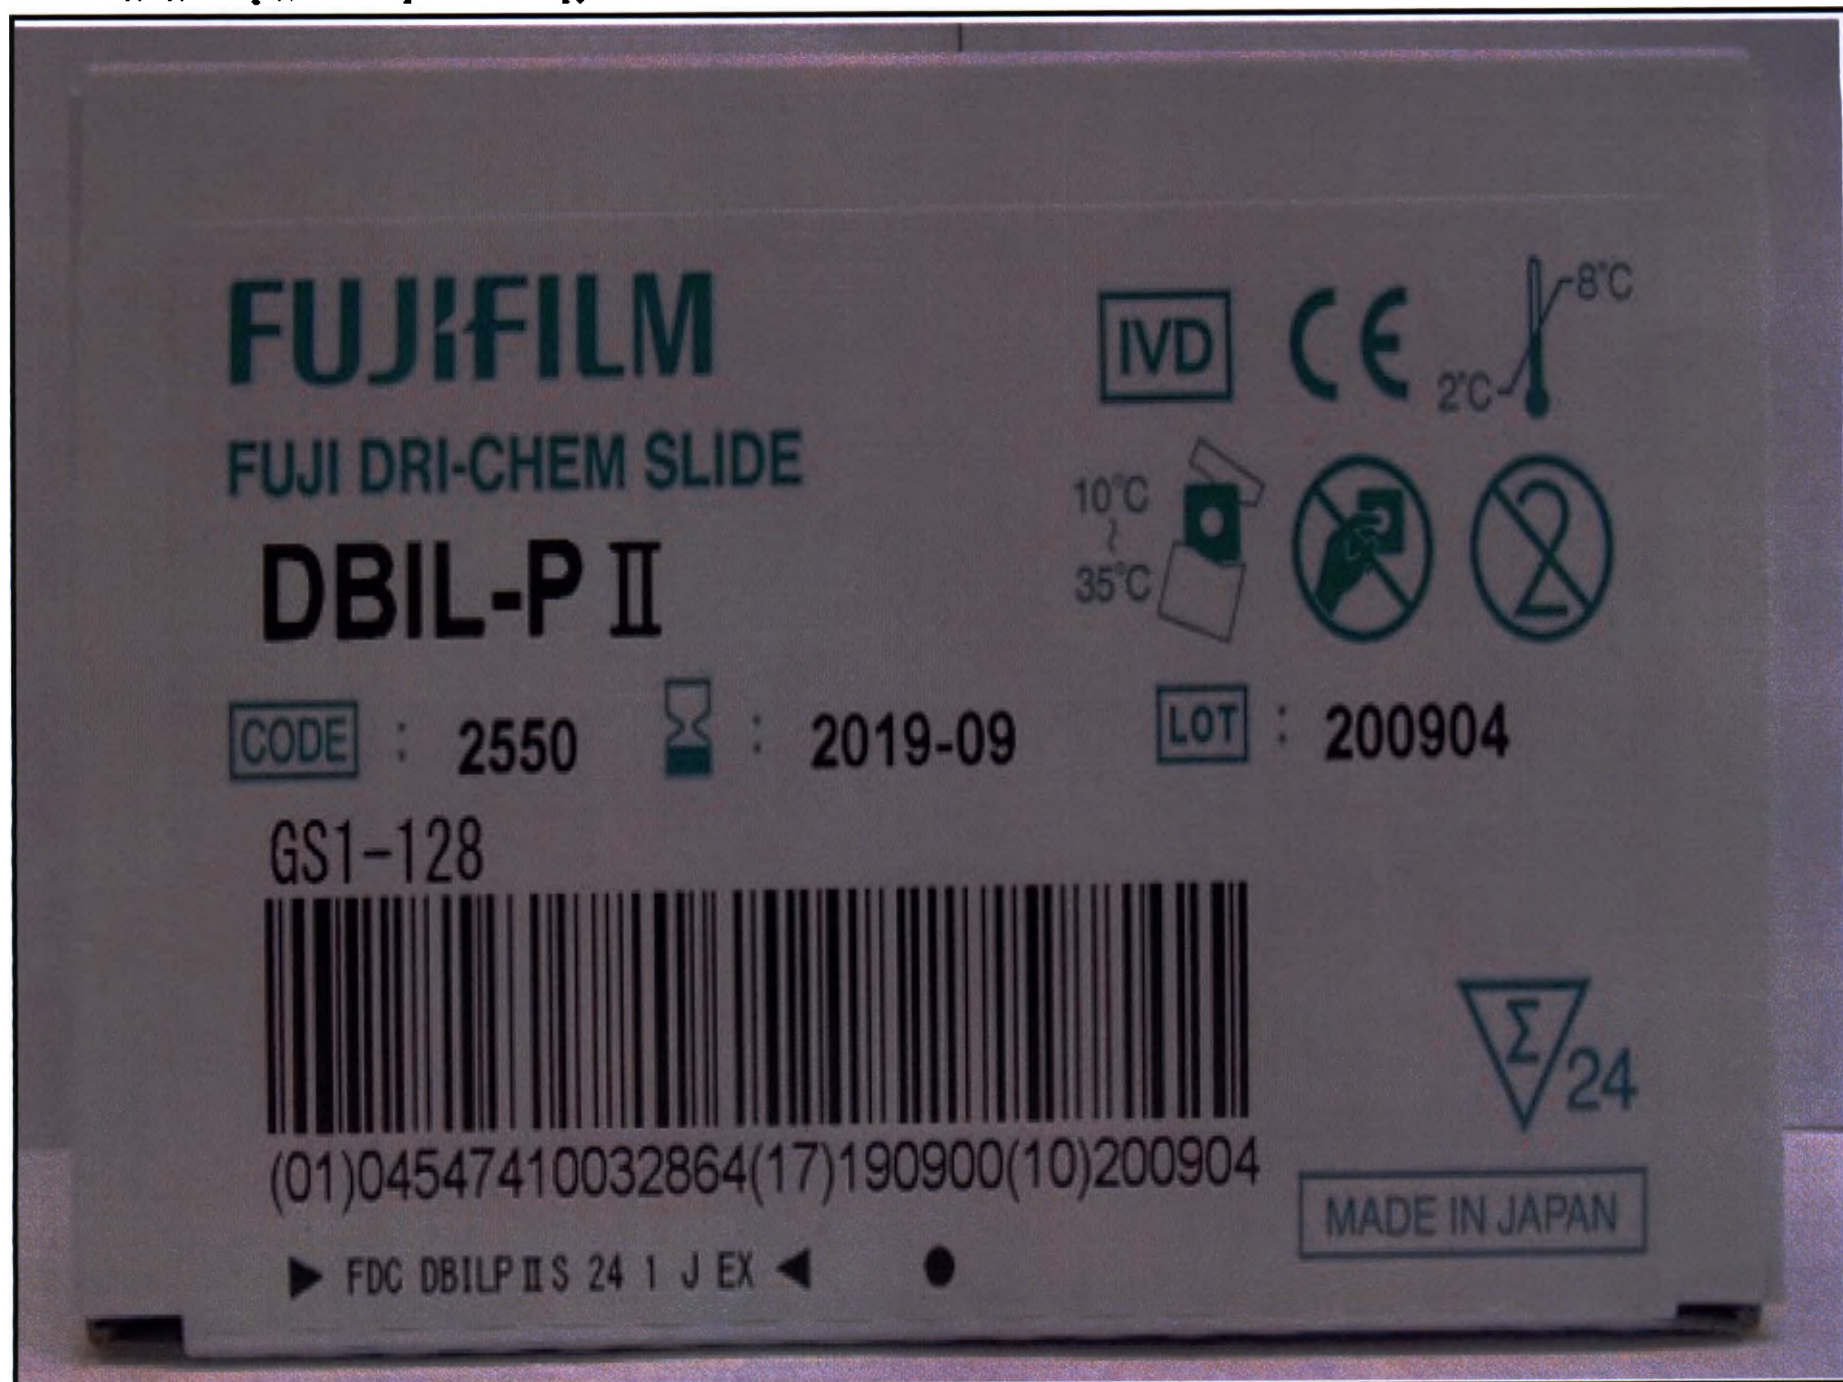

11. Слайды для определения прямого билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II

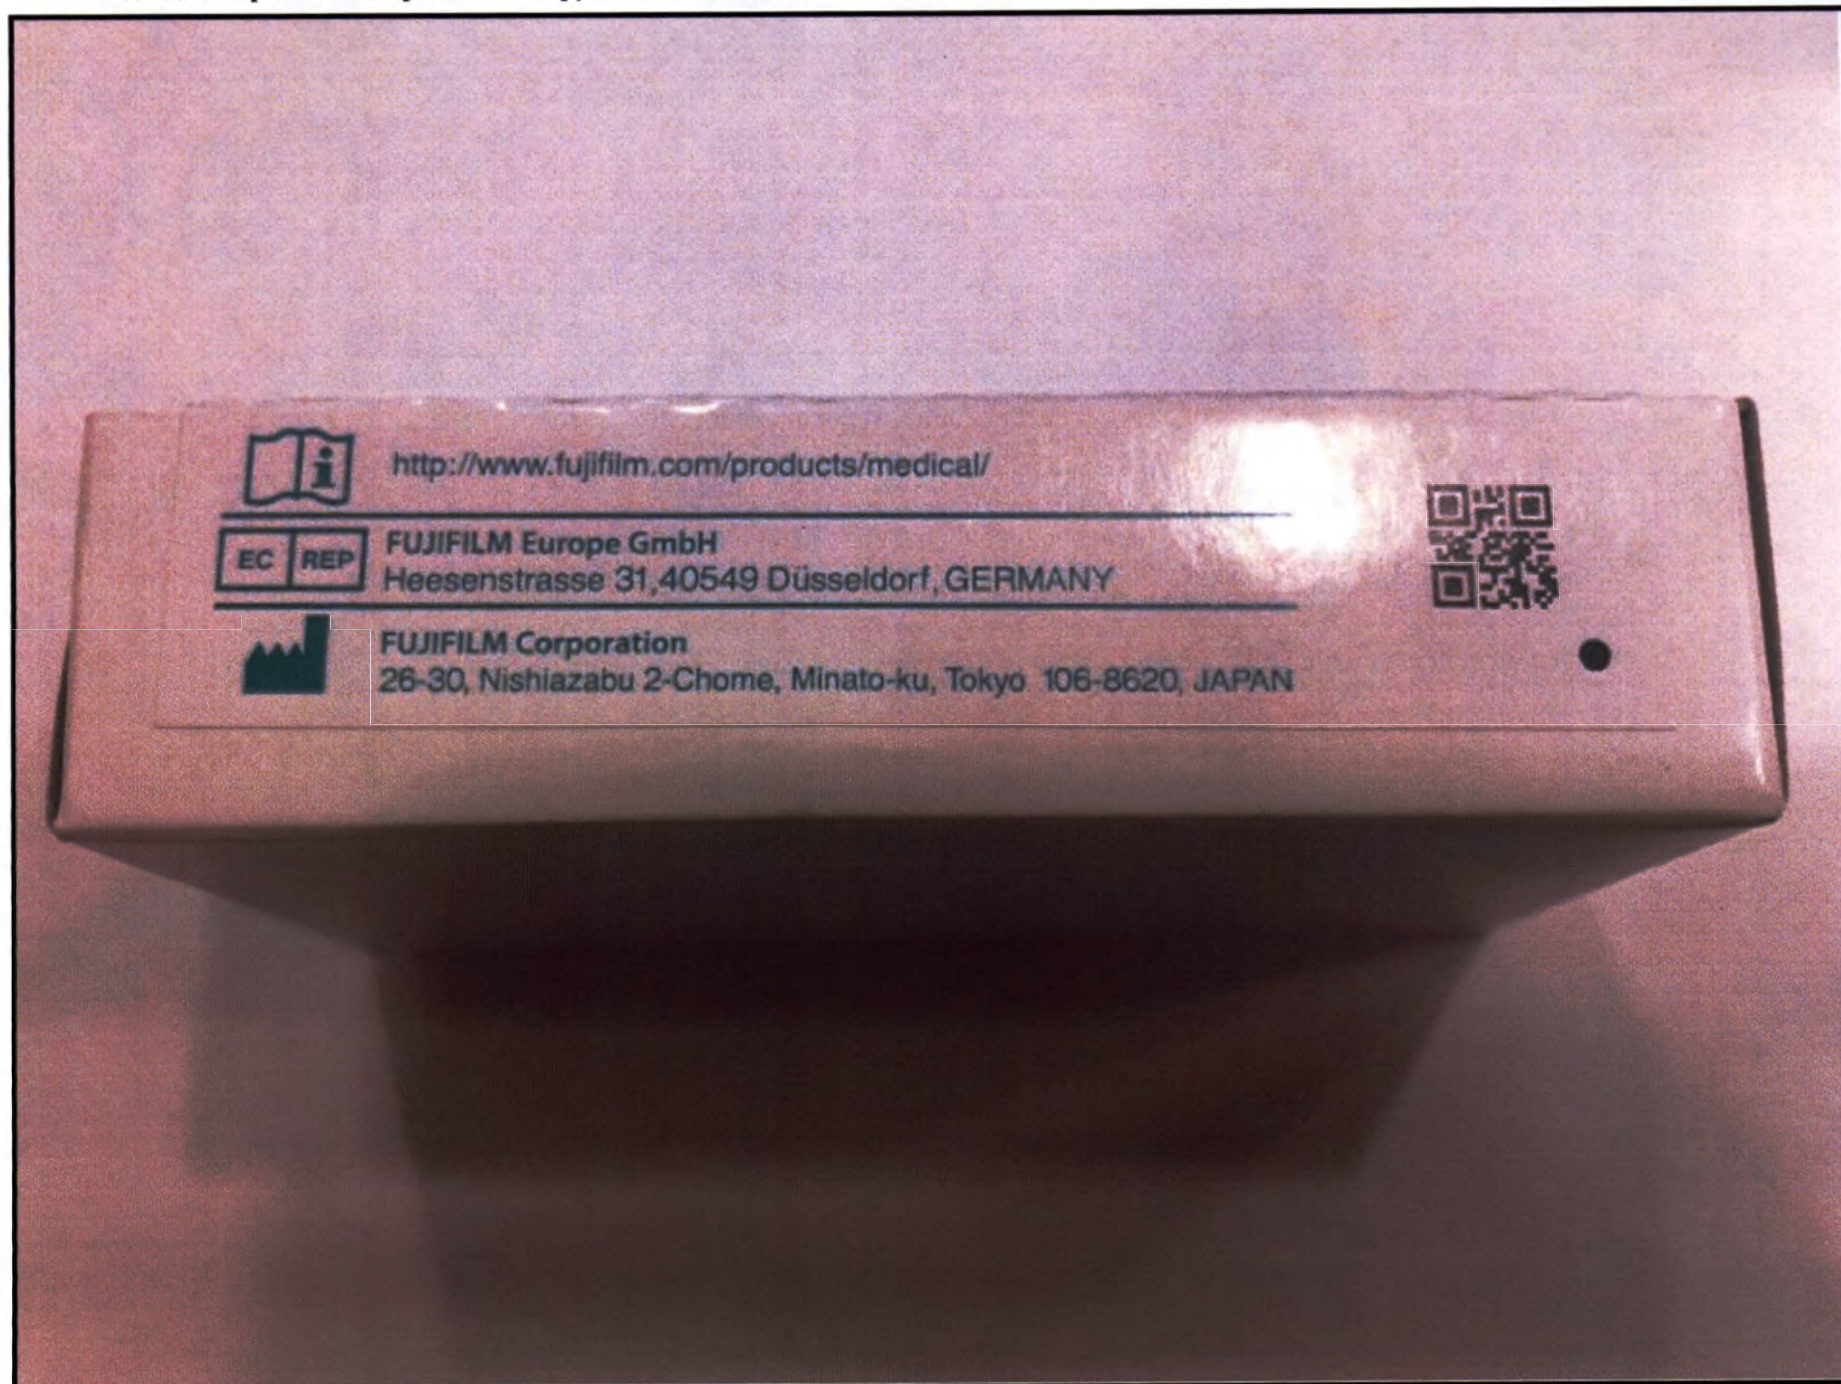

11. Слайды для определения прямого билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II



11. Слайды для определения прямого билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения прямого билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-P II - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809504

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

12. Слайды для определения гамма-глутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDE GGT-P III

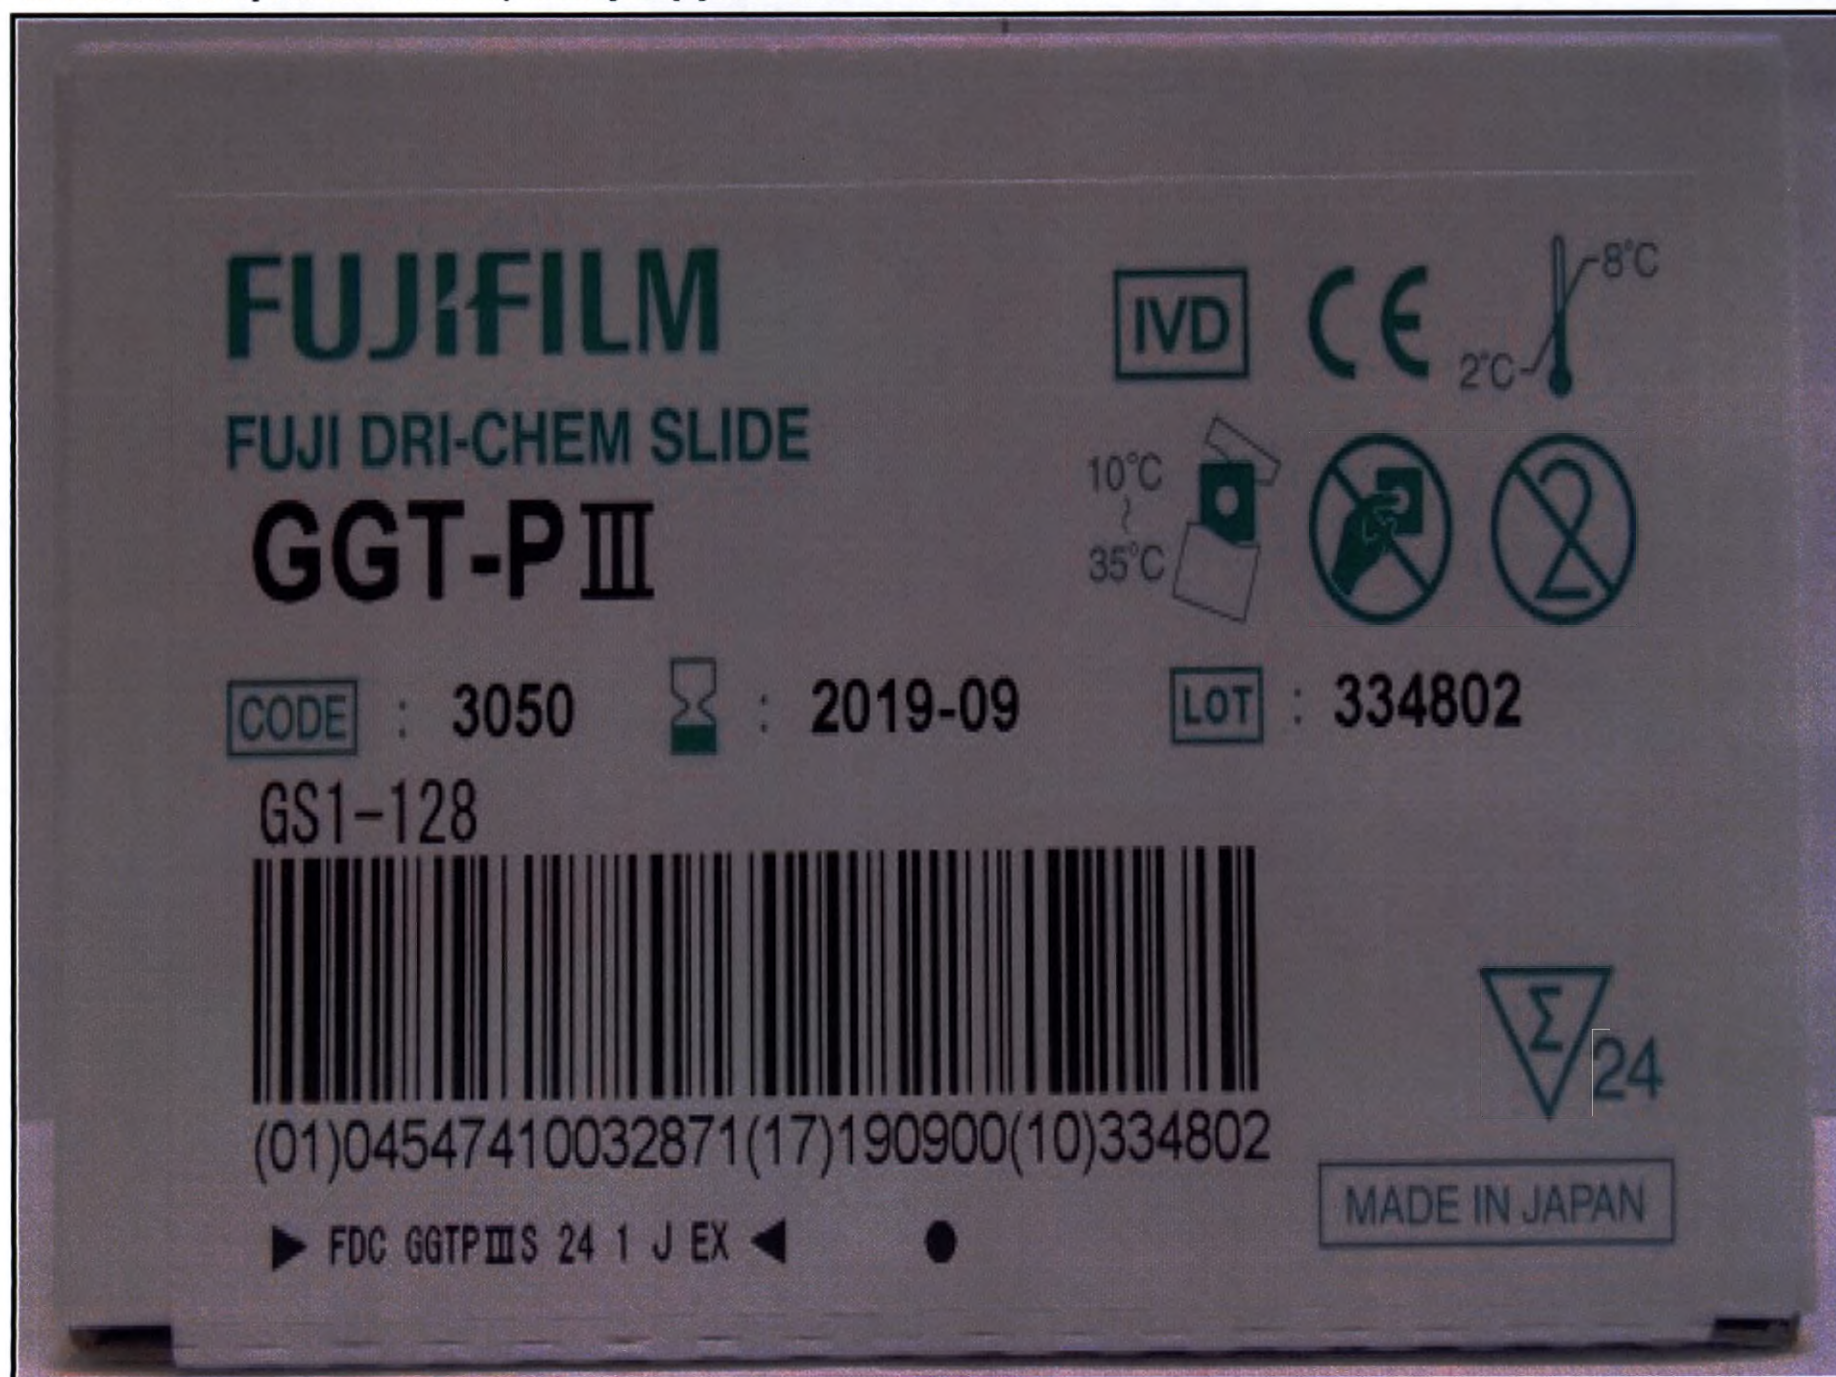

12. Слайды для определения гамма-глутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDE GGT-P III

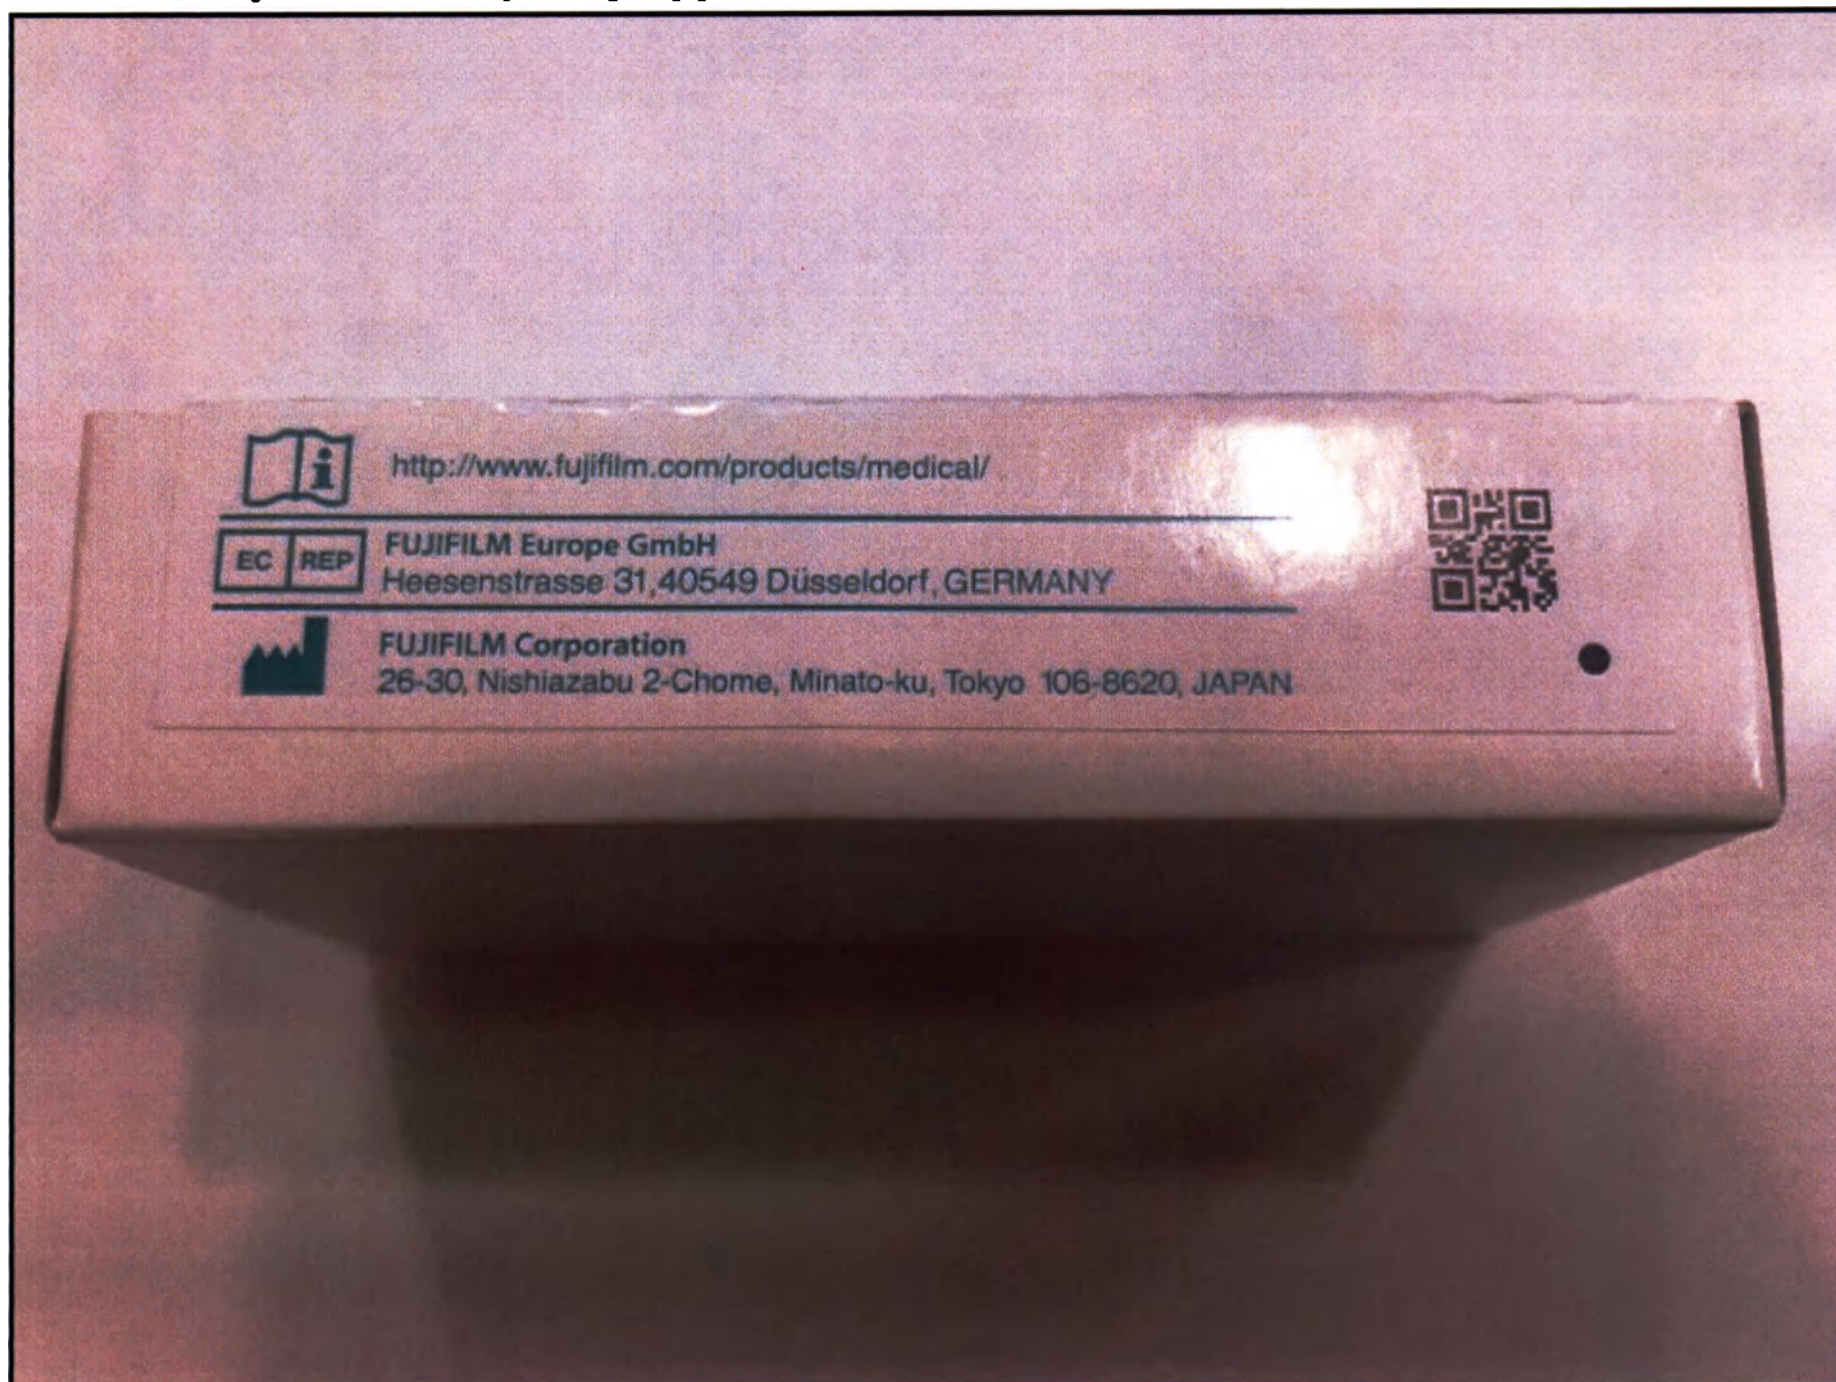

12. Слайды для определения гамма-глутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDE GGT-P III



12. Слайды для определения гамма-глутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDE GGT-P III — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения гамма-глутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDE GGT-P III -24 шт./1 уп.

Кат. № 15809516

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


13. Слайды для определения глюкозы FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-P III

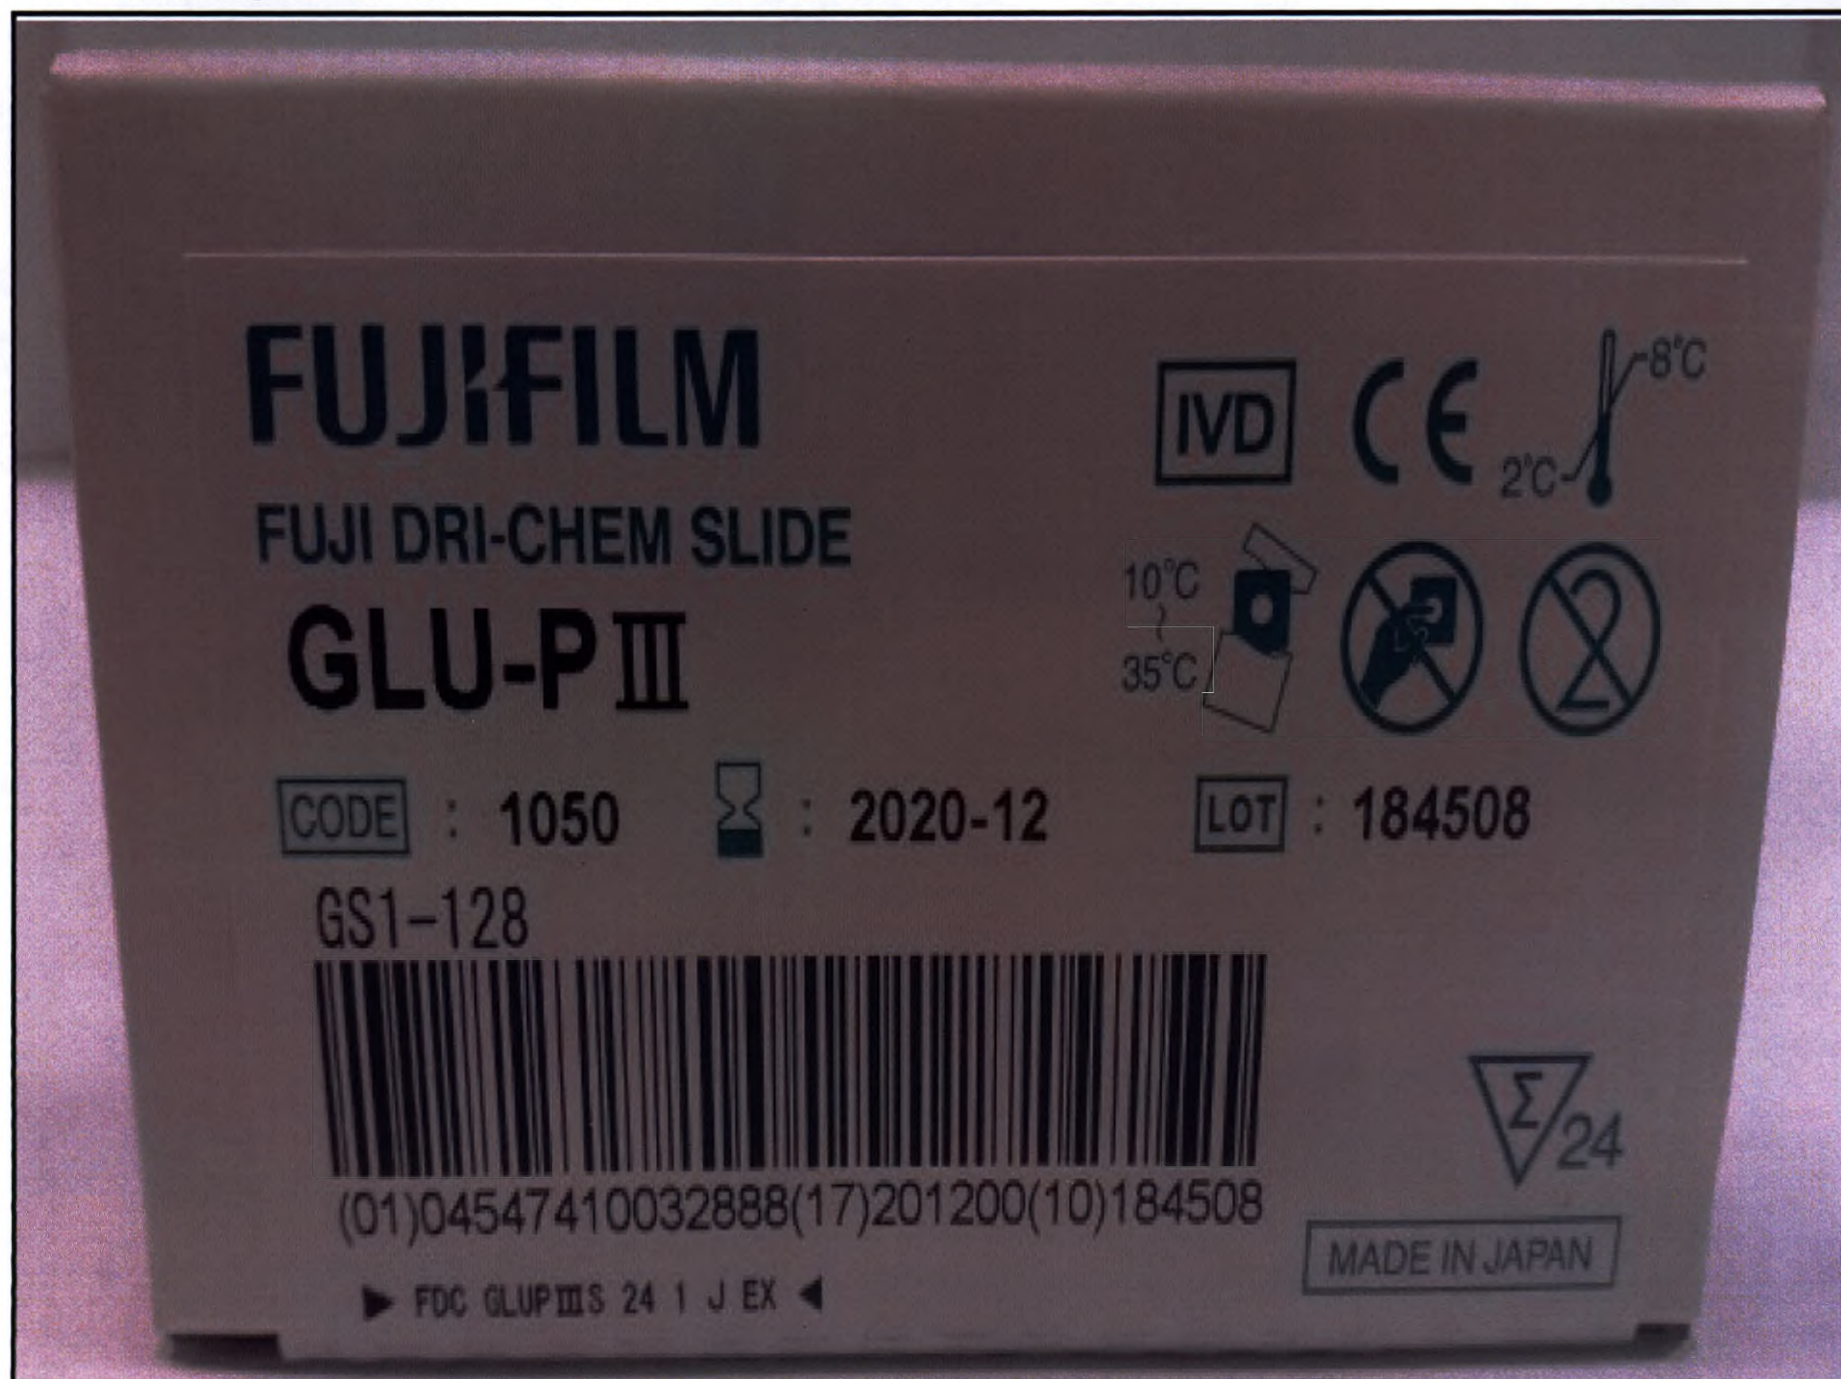

13. Слайды для определения глюкозы FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-P III

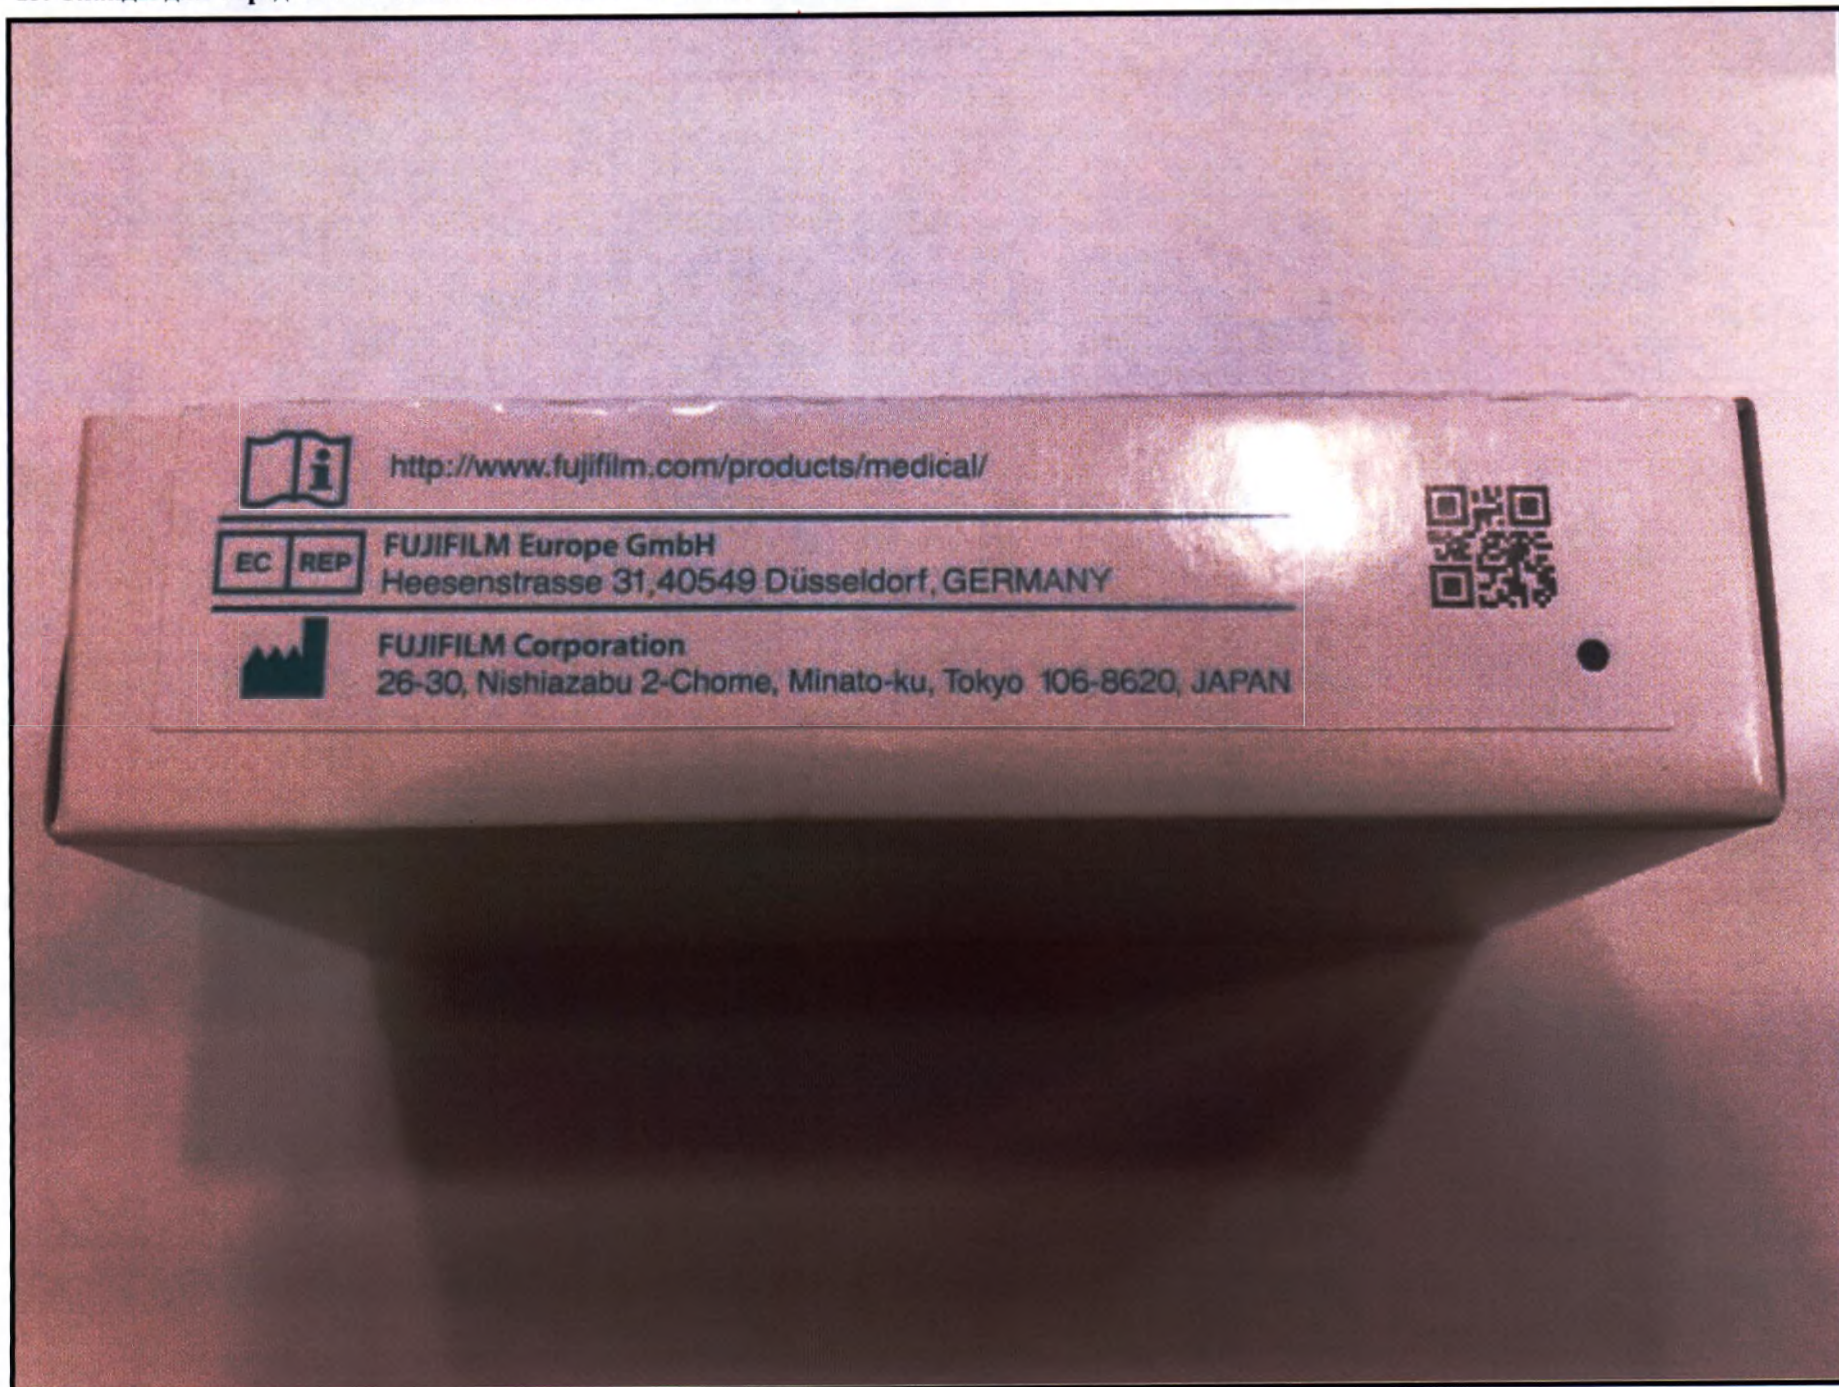

13. Слайды для определения глюкозы FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-P III

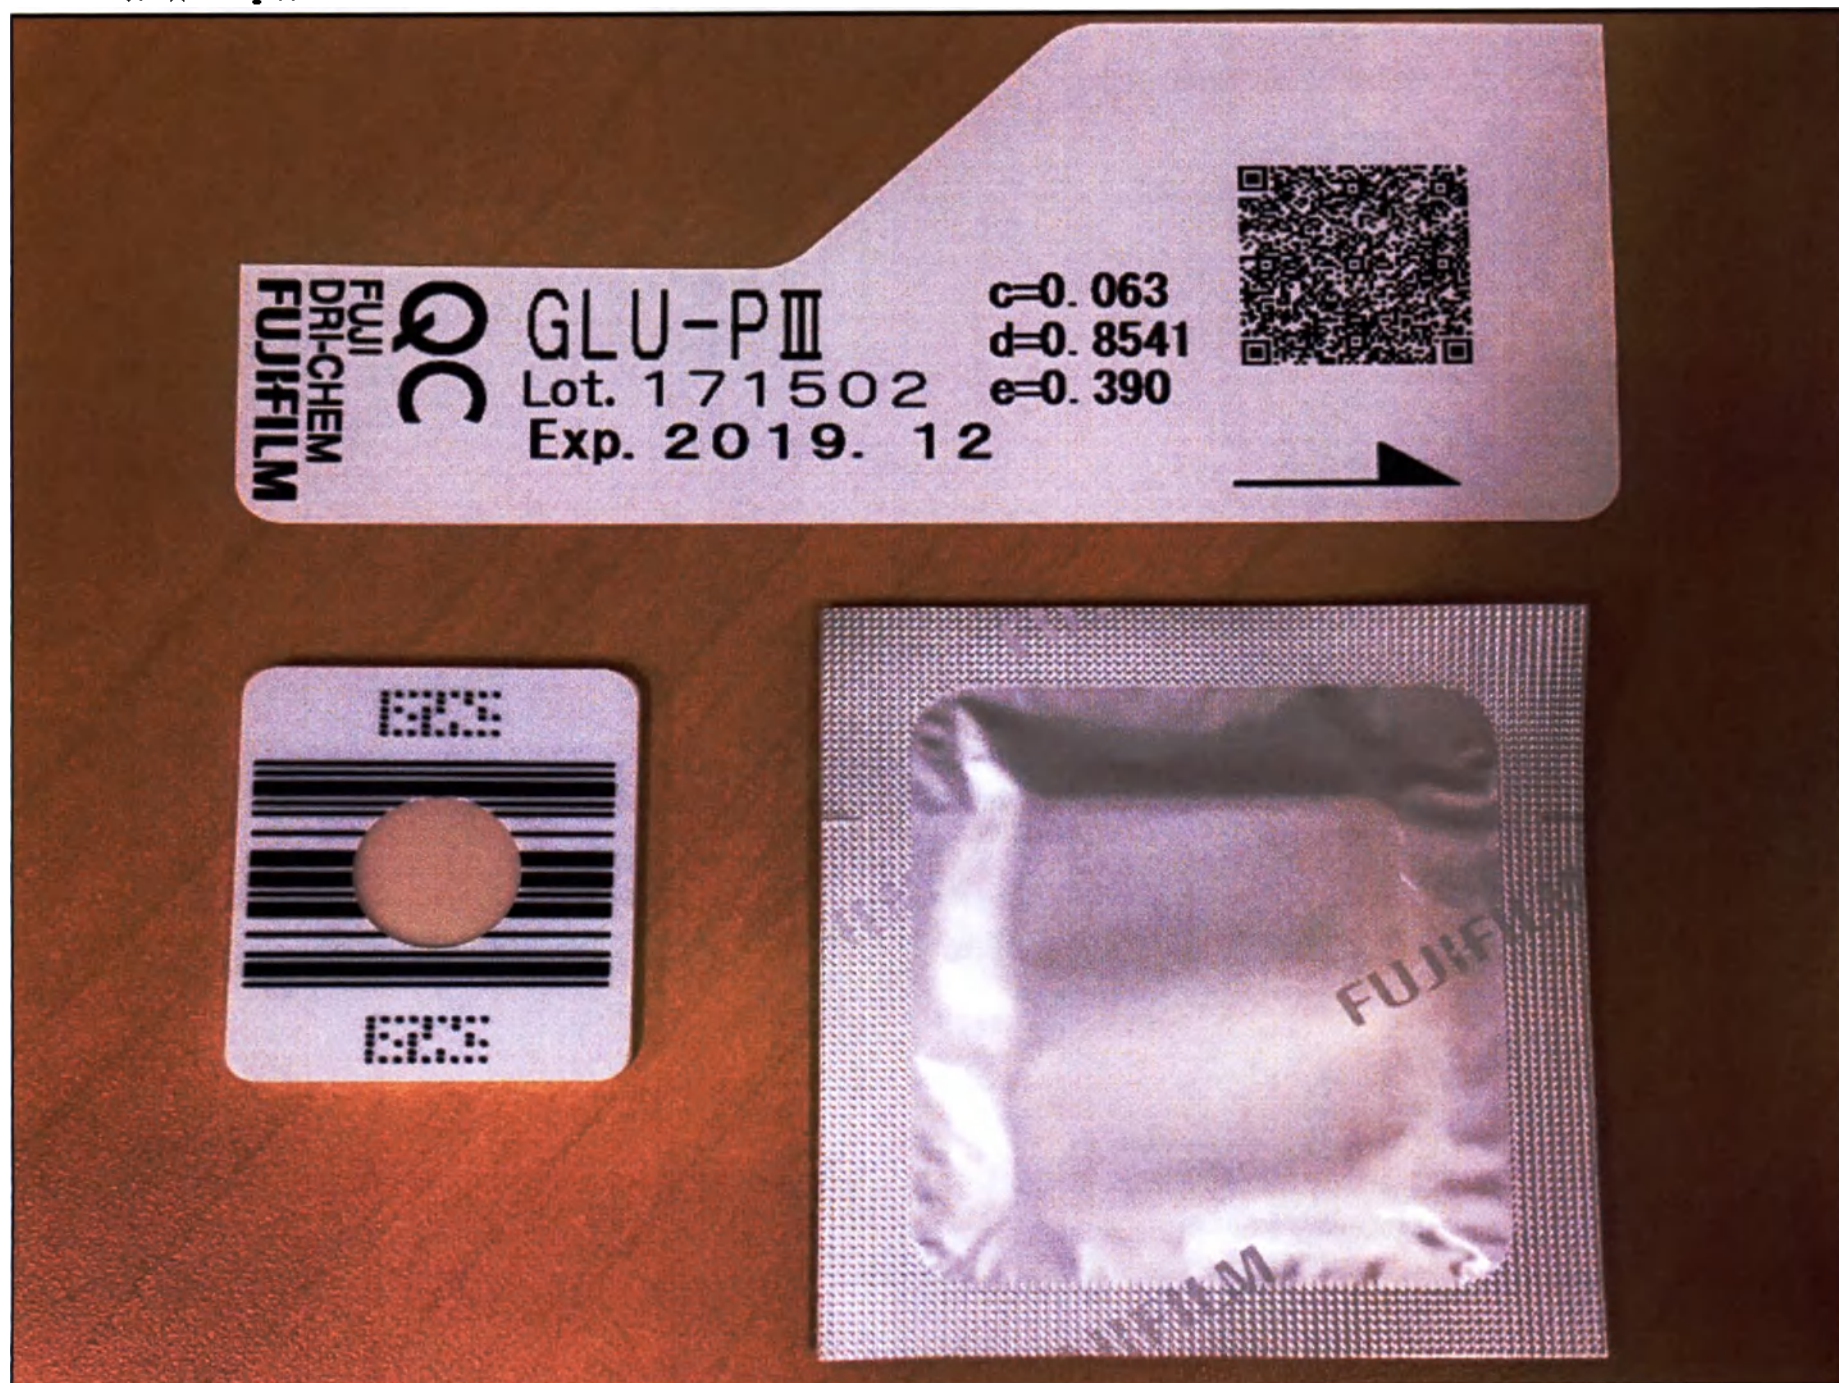

13. Слайды для определения глюкозы FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения глюкозы FUJI DRI-CHEM SLIDE
GLU-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809528

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,
Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп.
1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


14. Слайды для определения глутамат-оксалаат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III

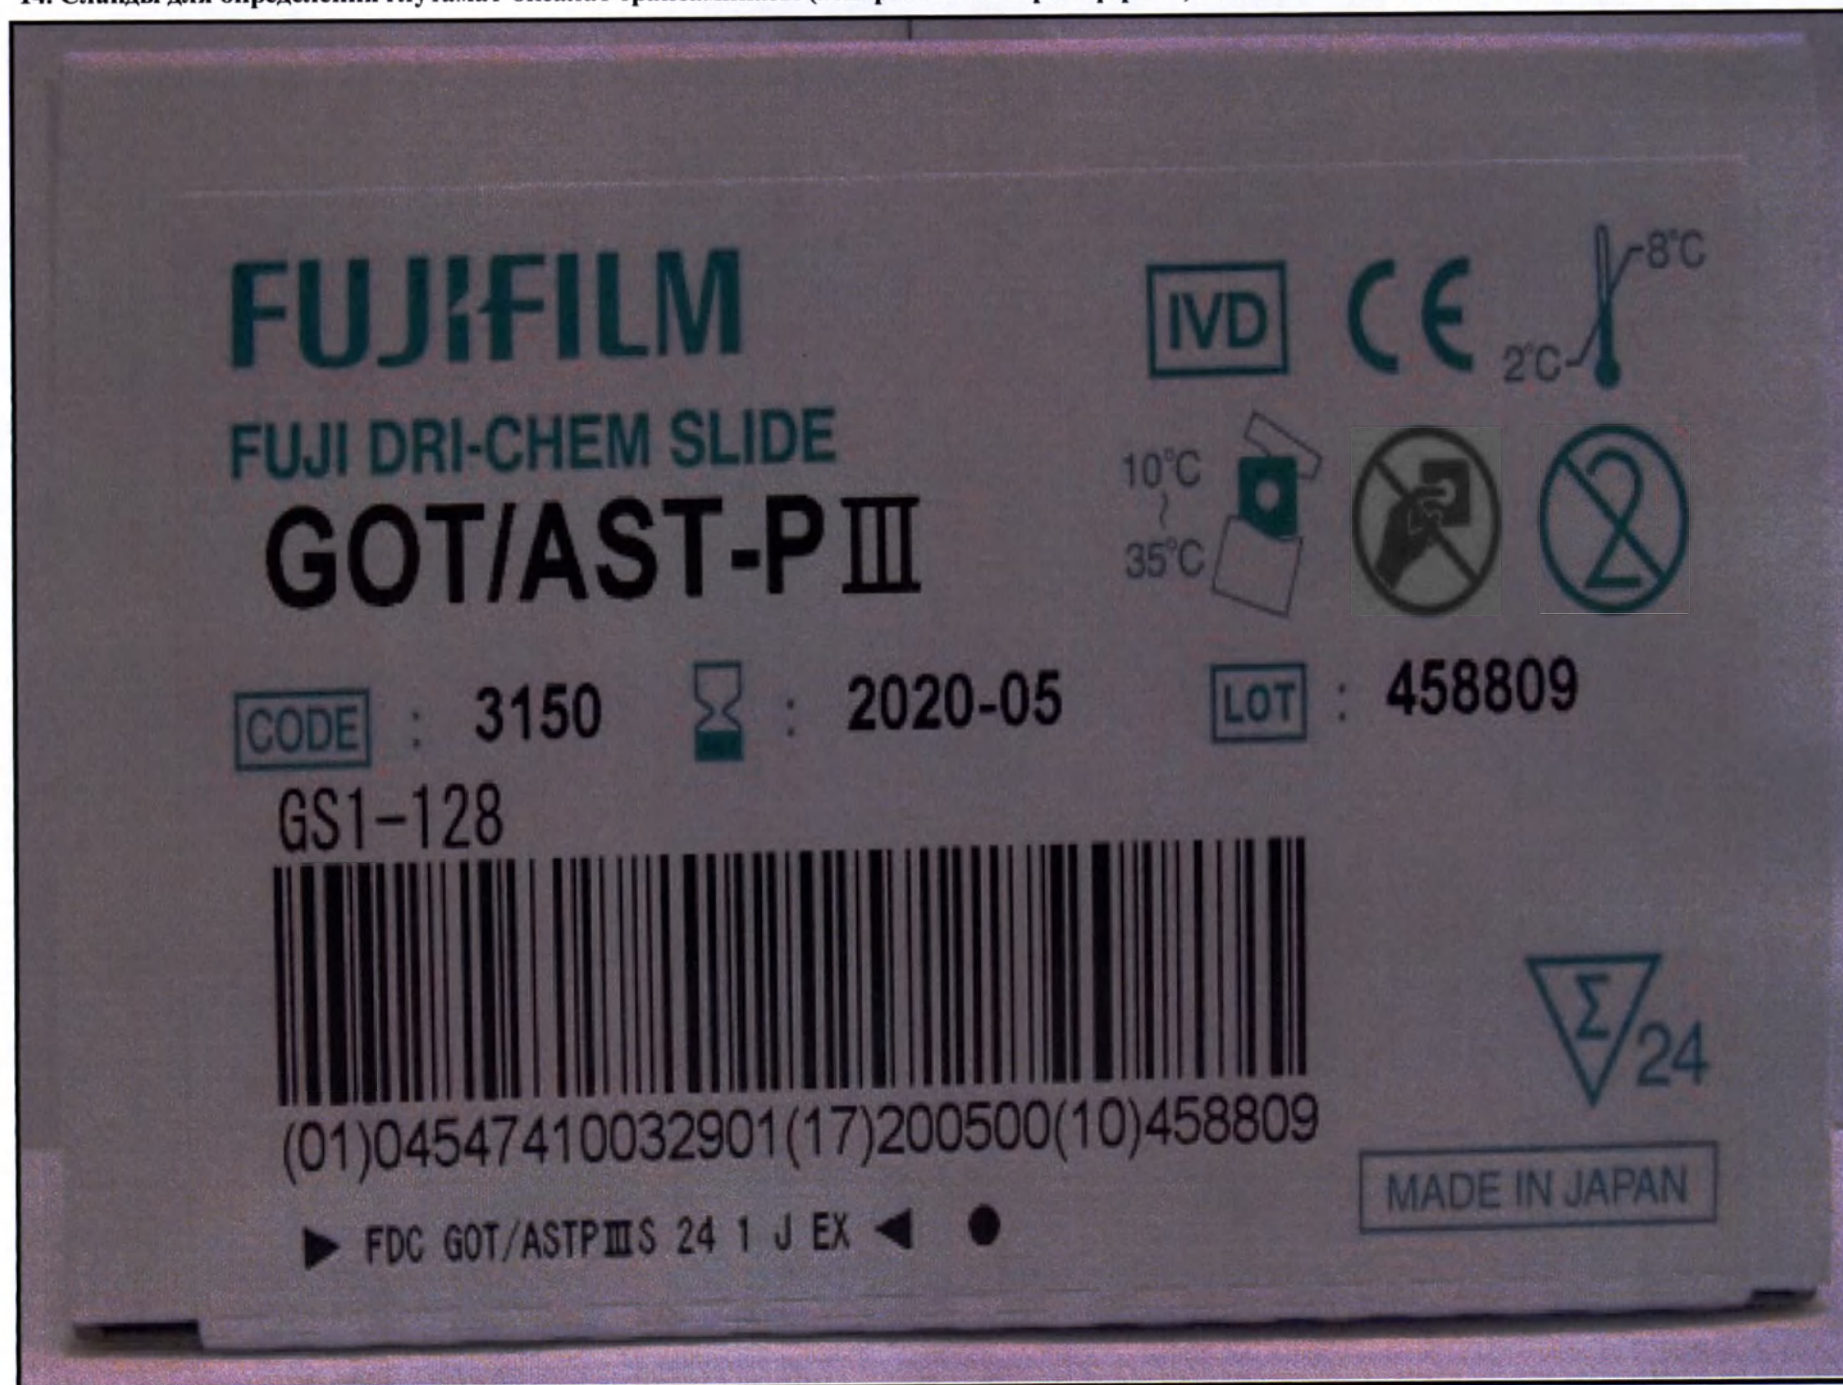

14. Слайды для определения глутамат-оксалаат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III

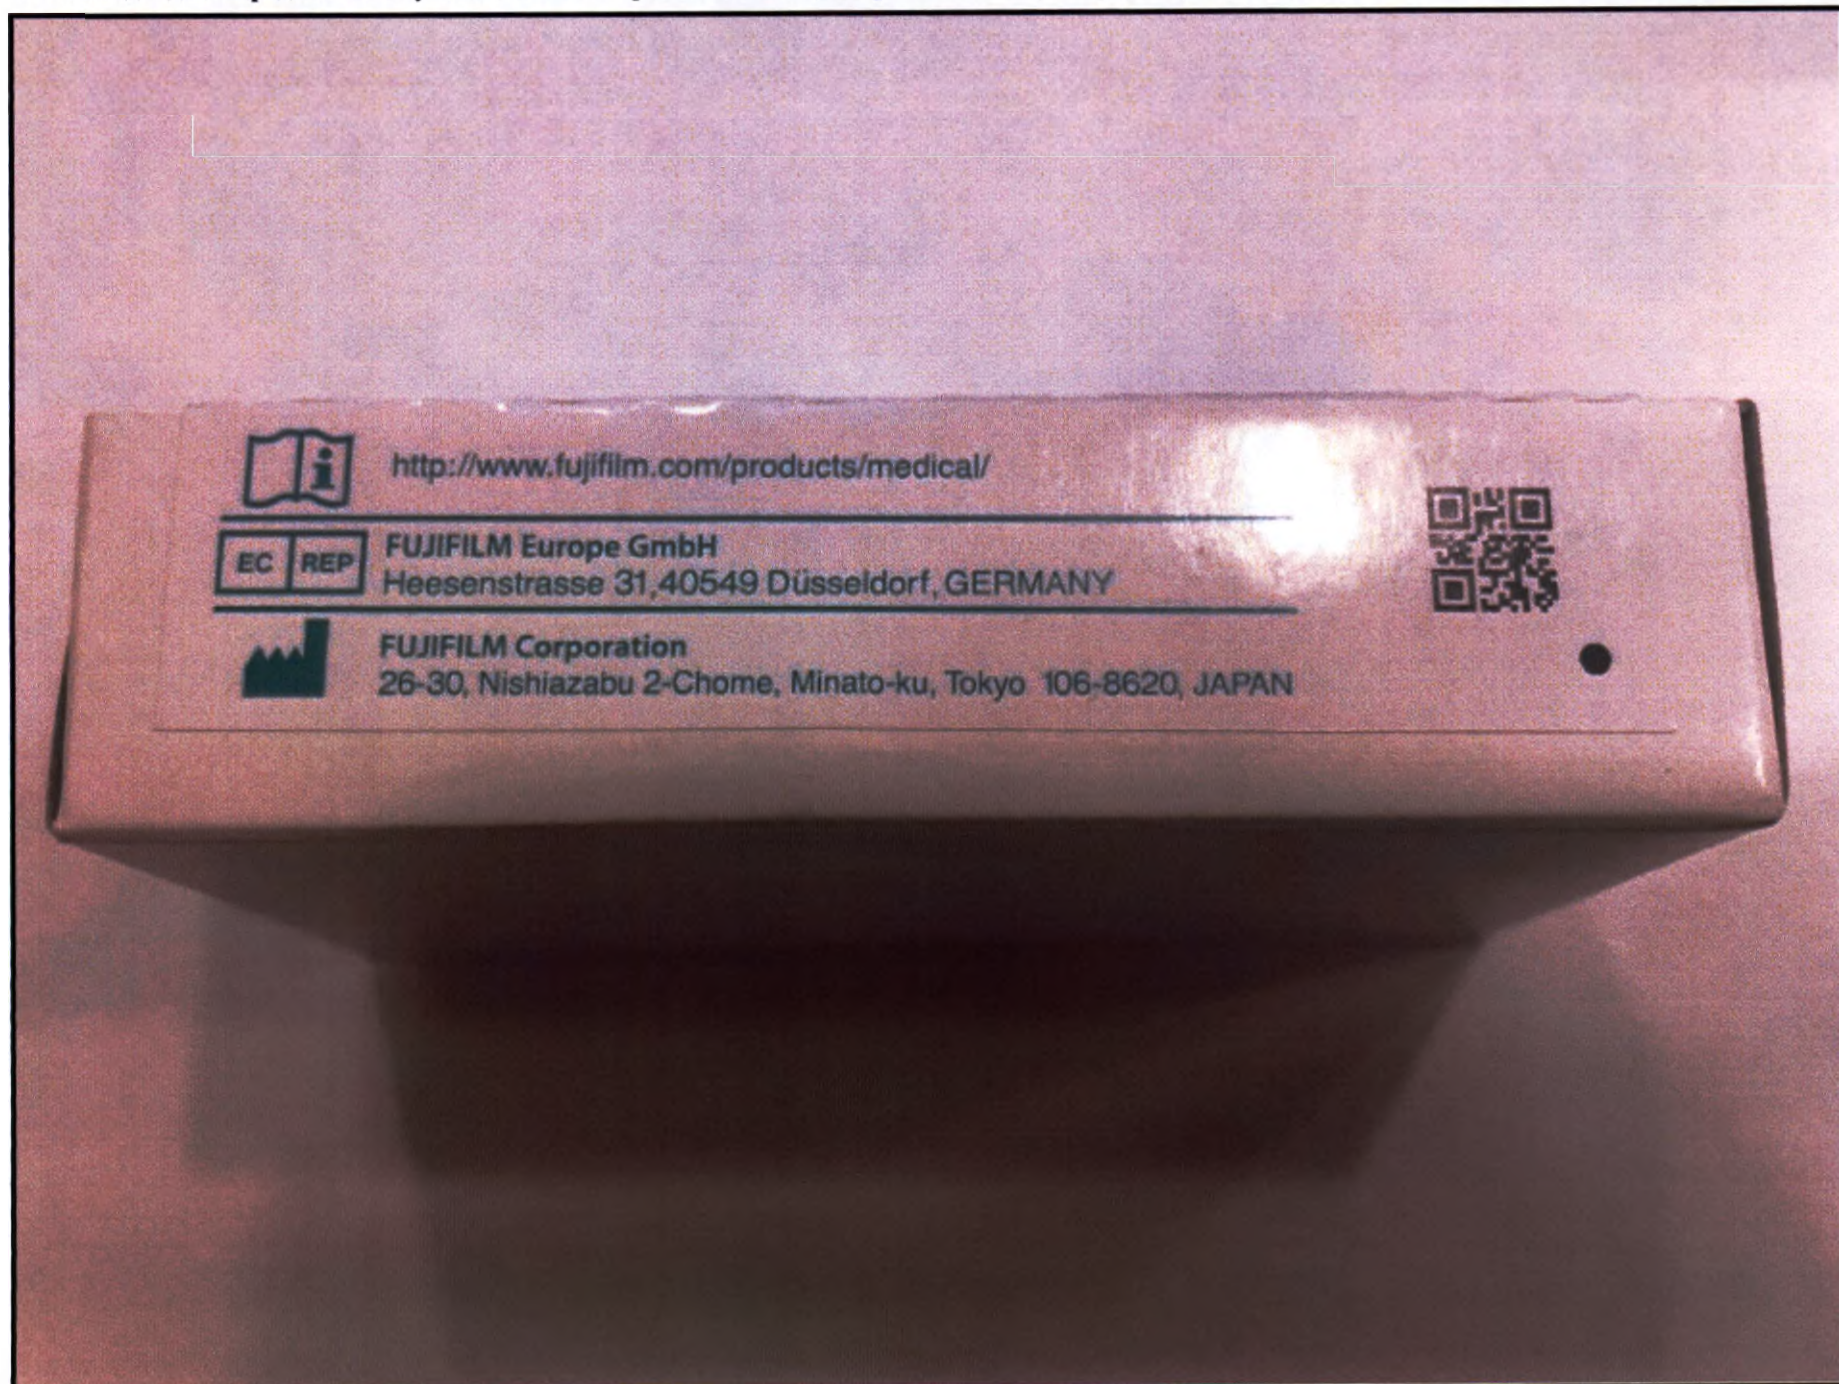

14. Слайды для определения глутамат-оксалаат трансминазы (аспартат-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III

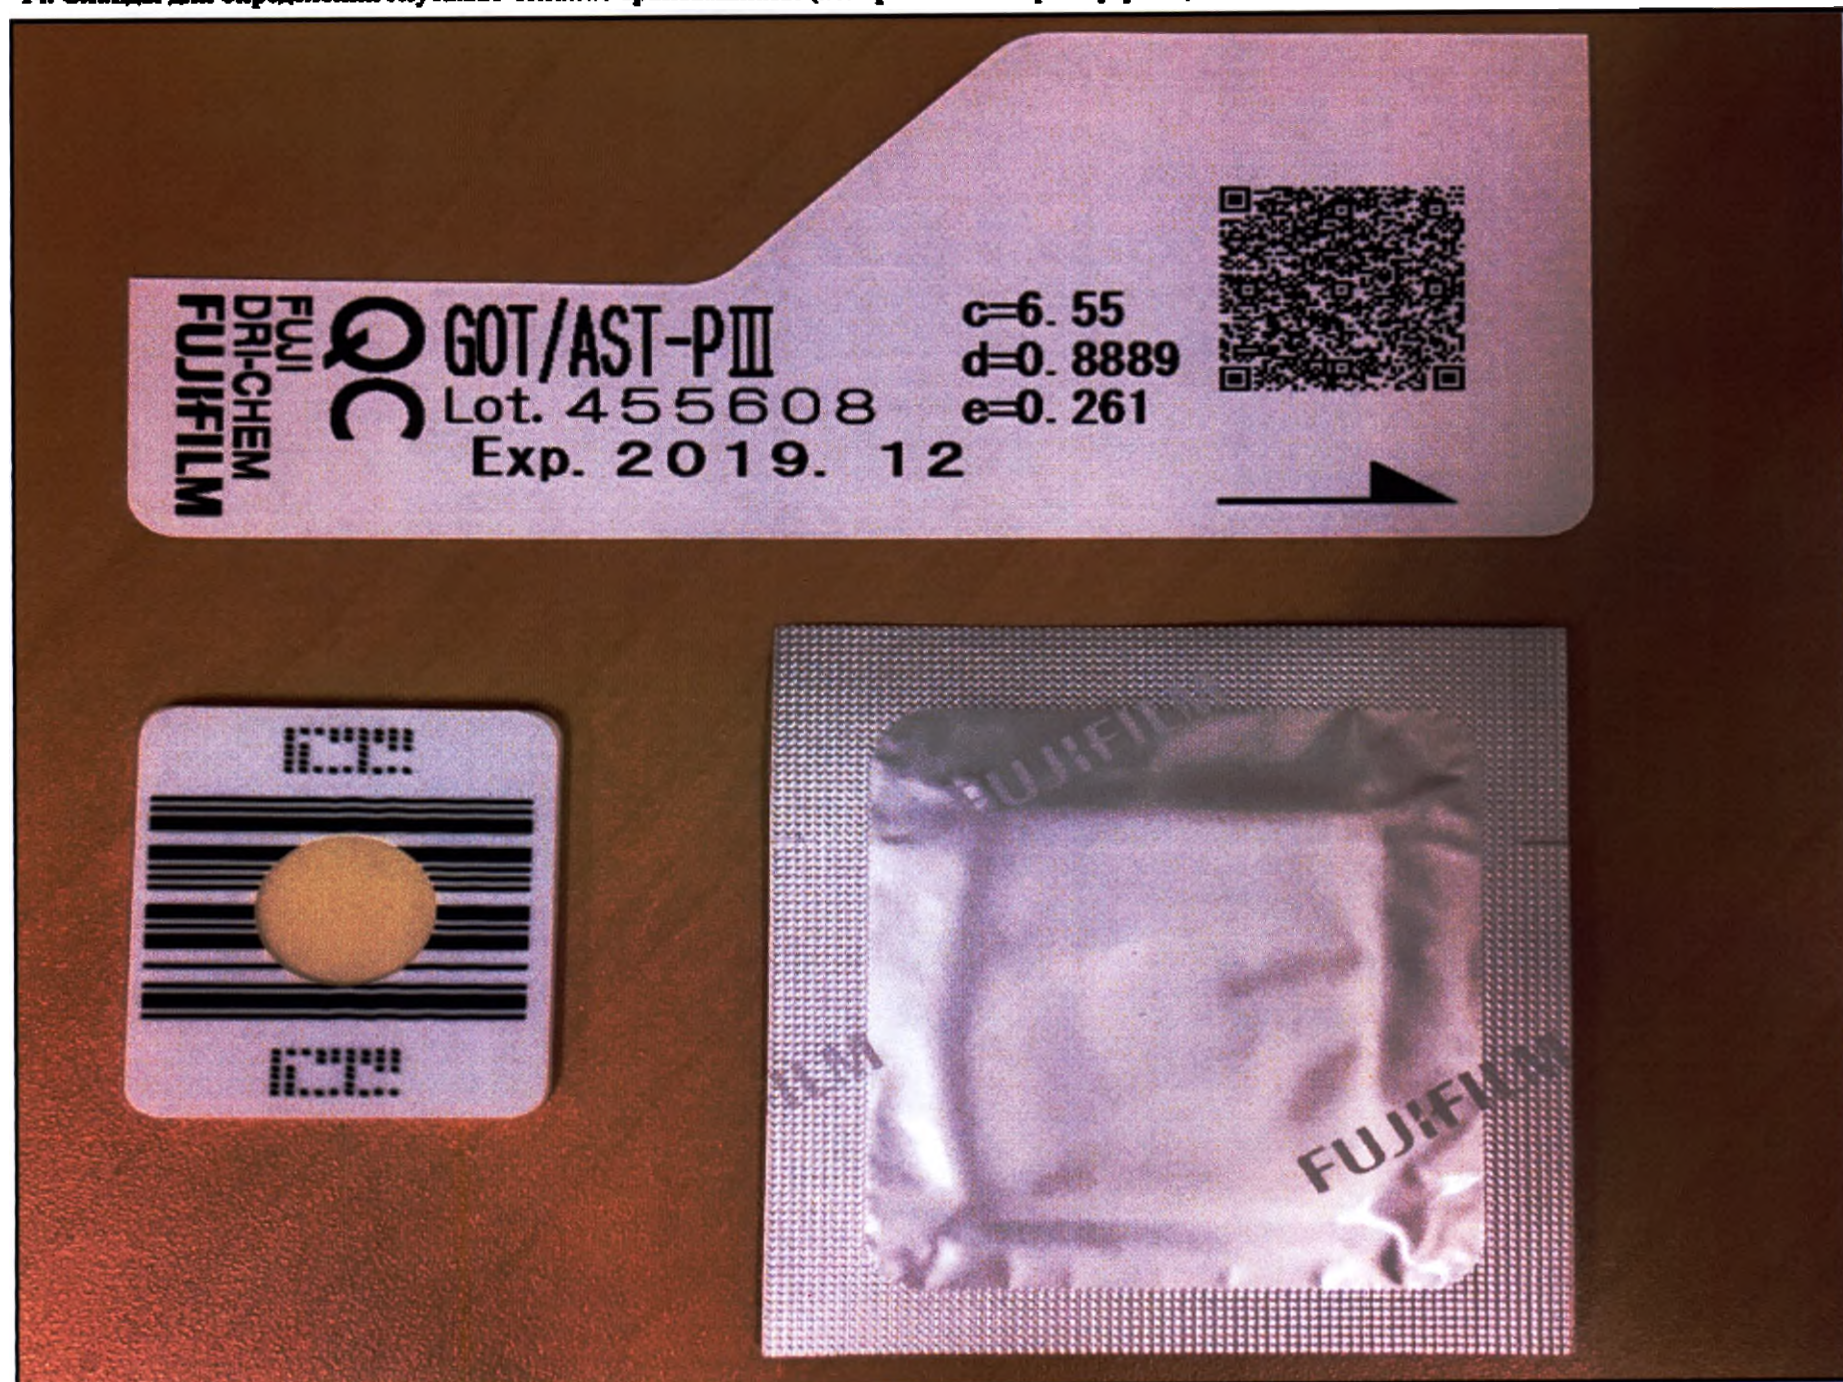

14. Слайды для определения глутамат-оксалаат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения глутамат-оксалаат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809542

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

15. Слайды для определения глутамат-пируват трансминазы (аланин-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-P III

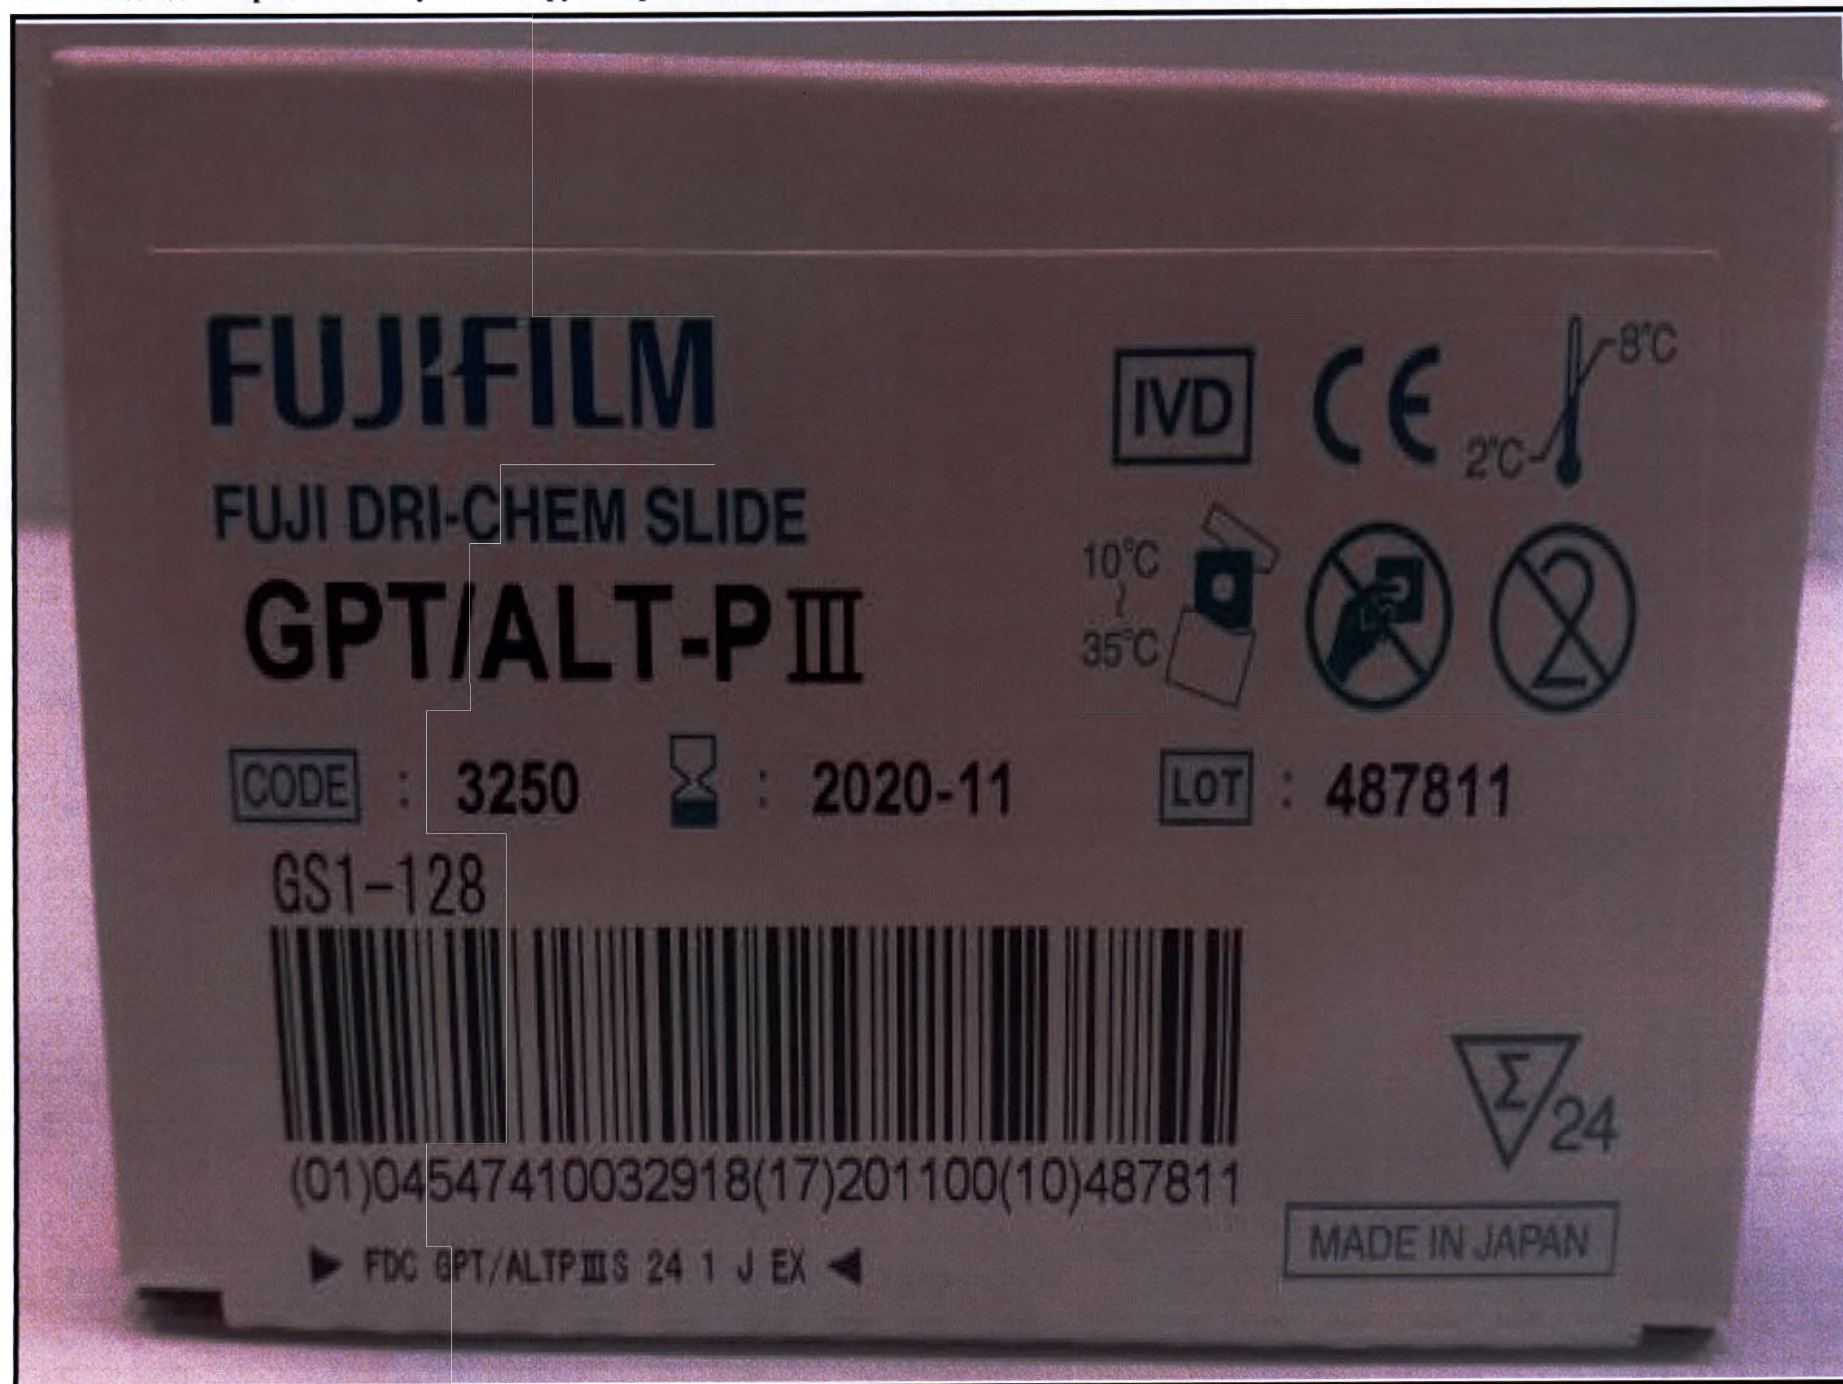

15. Слайды для определения глутамат-пируват трансминазы (аланин-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-P III



15. Слайды для определения глутамат-пируват трансминазы (аланин-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-P III



Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения глутамат-пируват трансминазы (аланин-аминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809554

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

16. Слайды для определения HDL холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE HDL-C-P IID

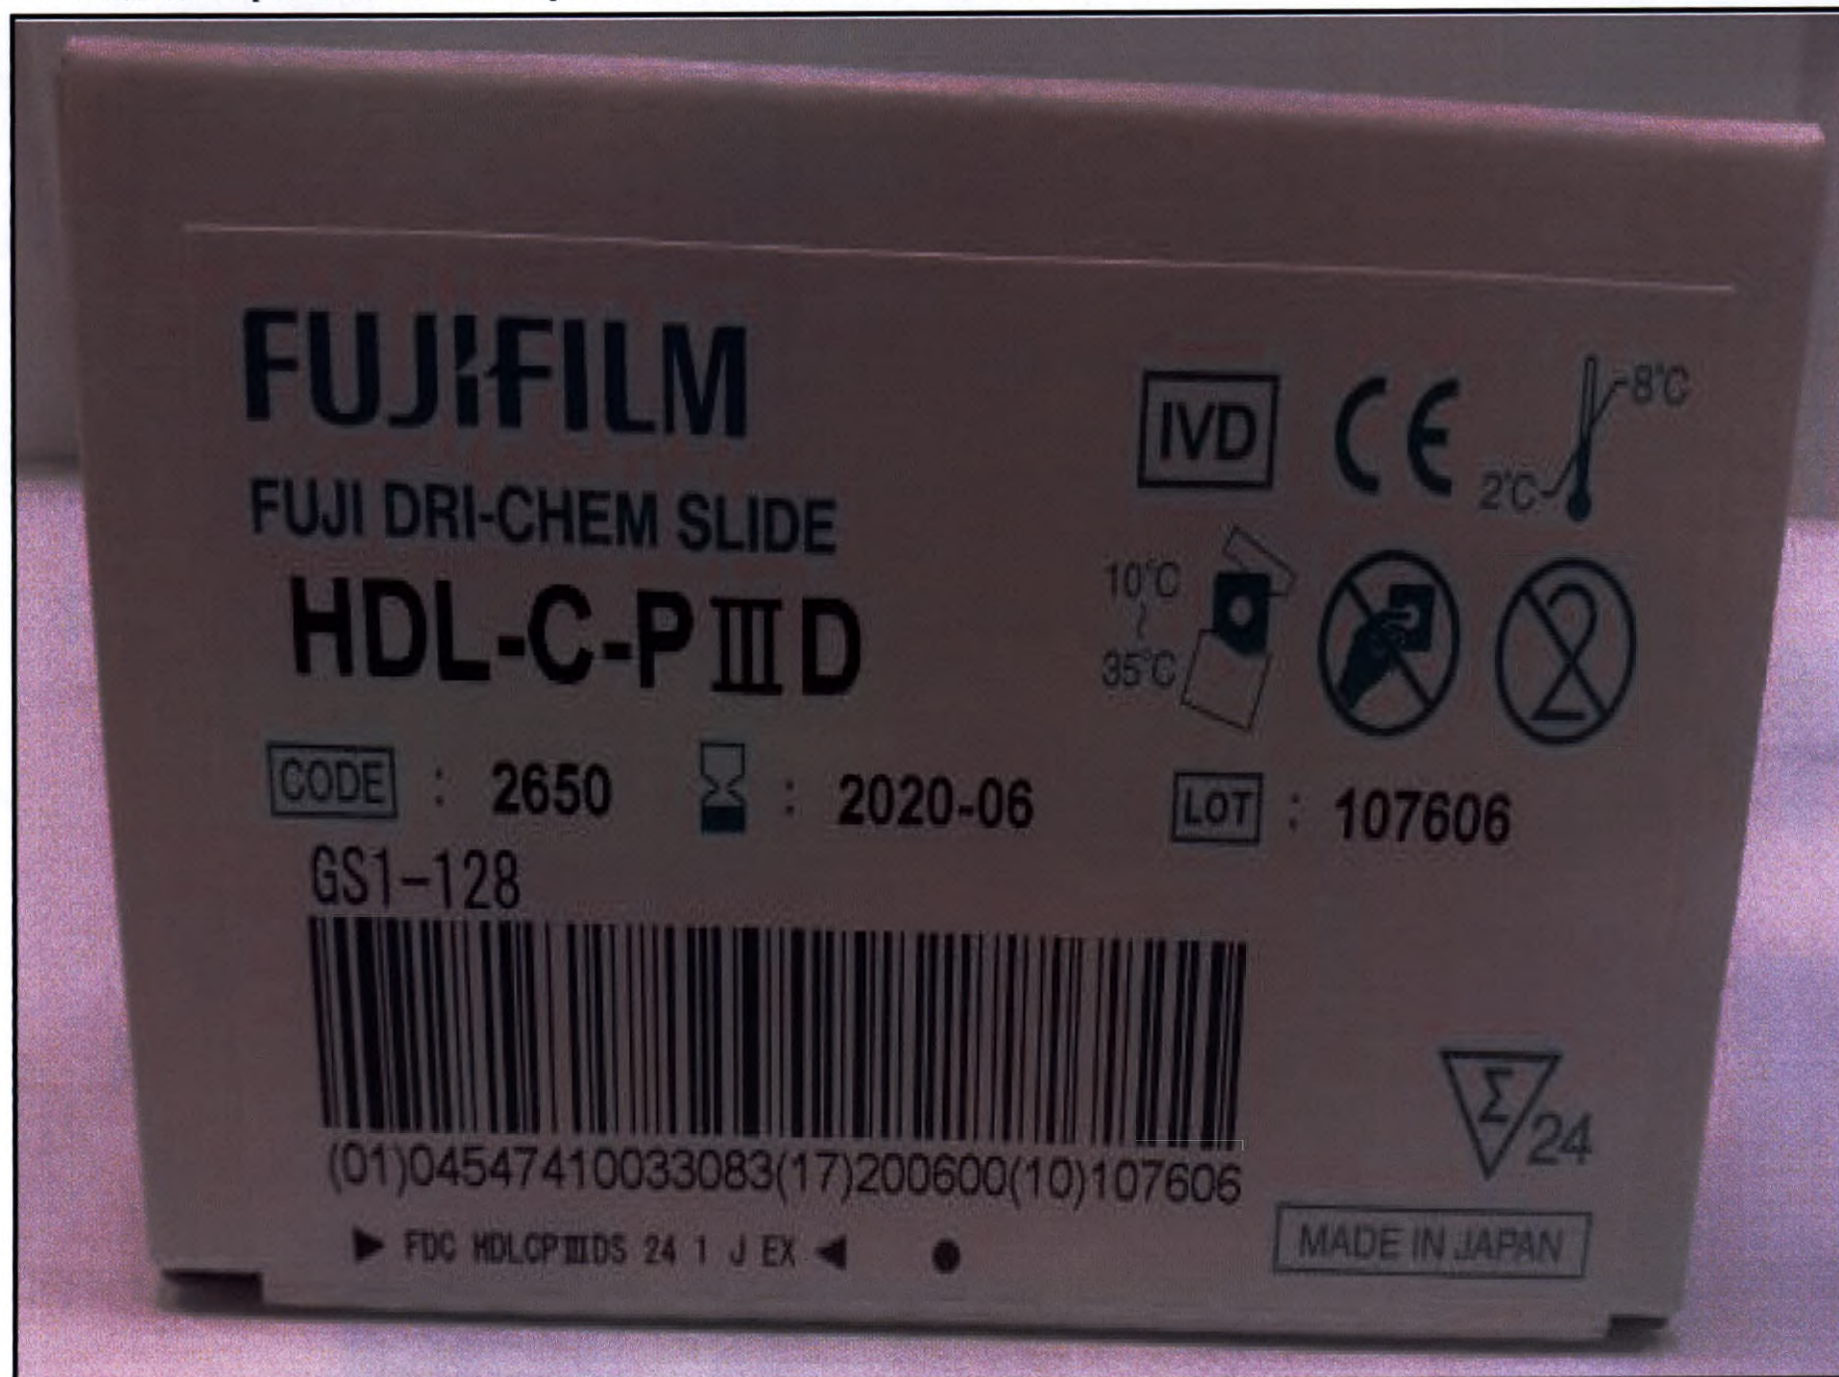

16. Слайды для определения HDL холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE HDL-C-P IID



16. Слайды для определения HDL холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE HDL-C-P IID



16. Слайды для определения HDL холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE HDL-C-P IID — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения HDL холестерина FUJI DRI-CHEM
SLIDE HDL-C-P IID - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809736

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


17. Слайды для определения неорганического фосфора FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P

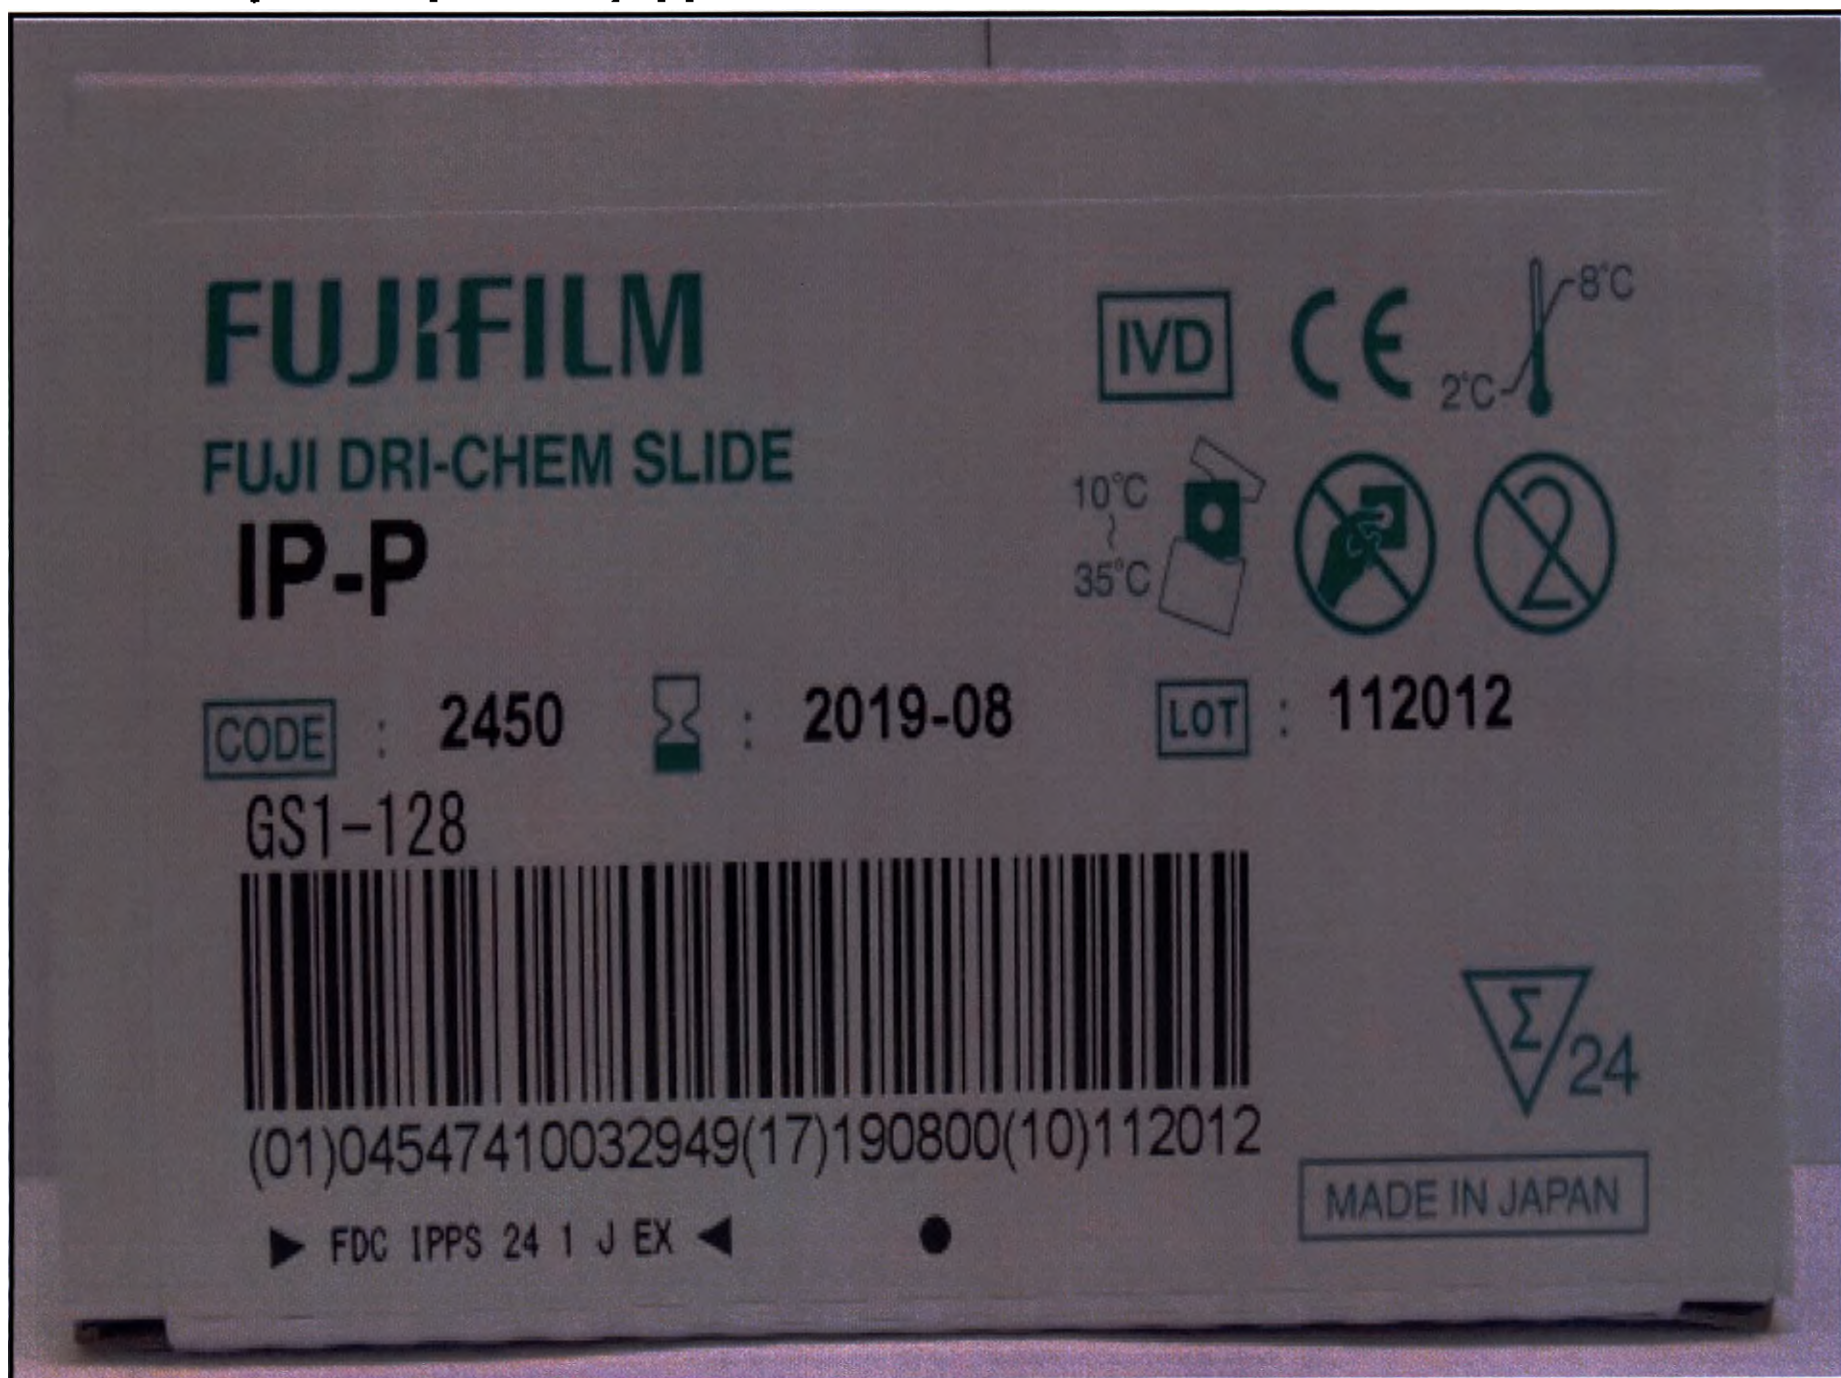

17. Слайды для определения неорганического фосфора FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P

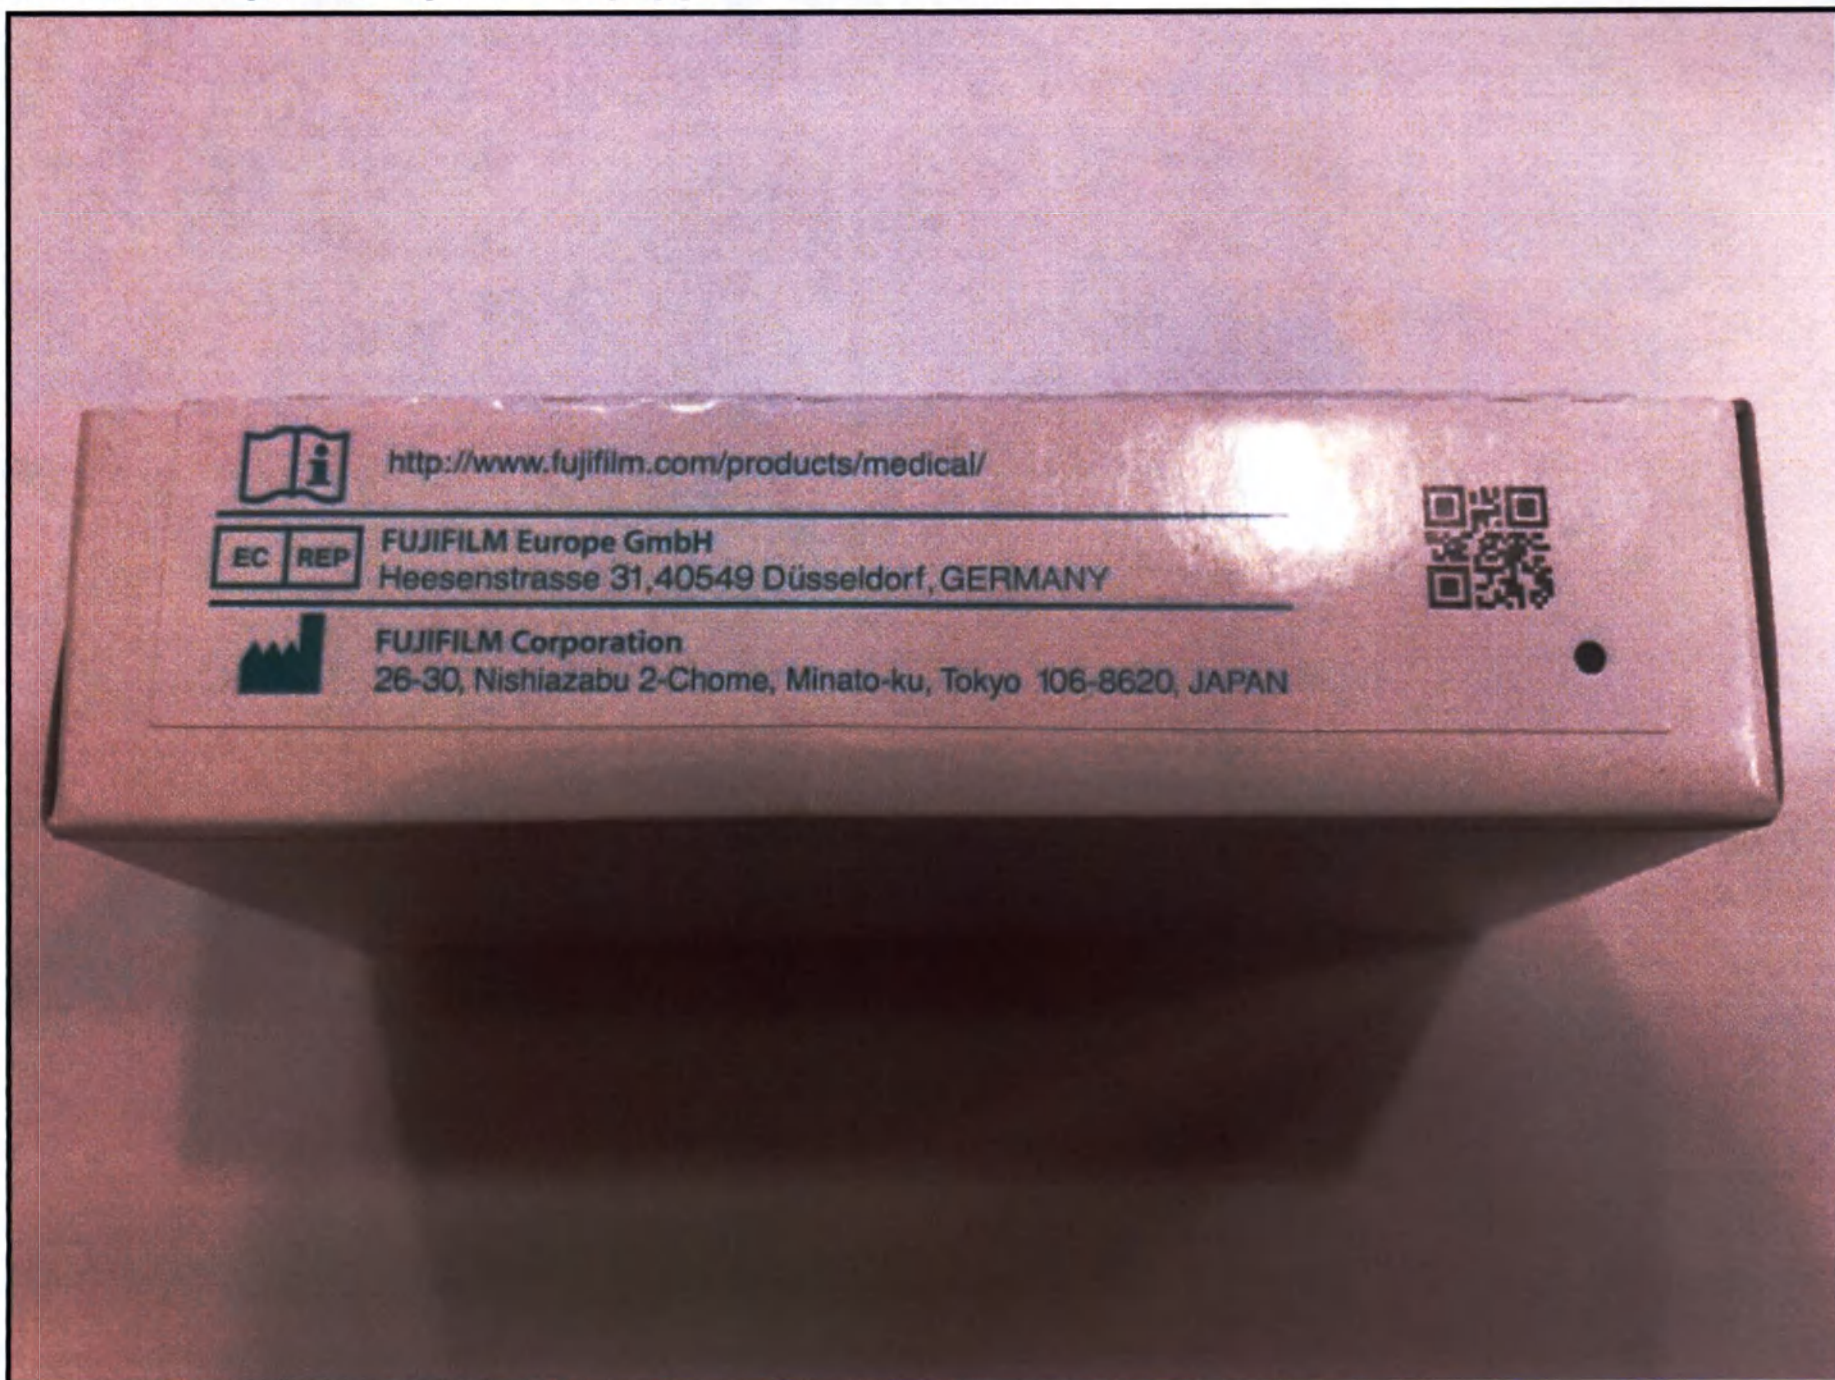

17. Слайды для определения неорганического фосфора FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P

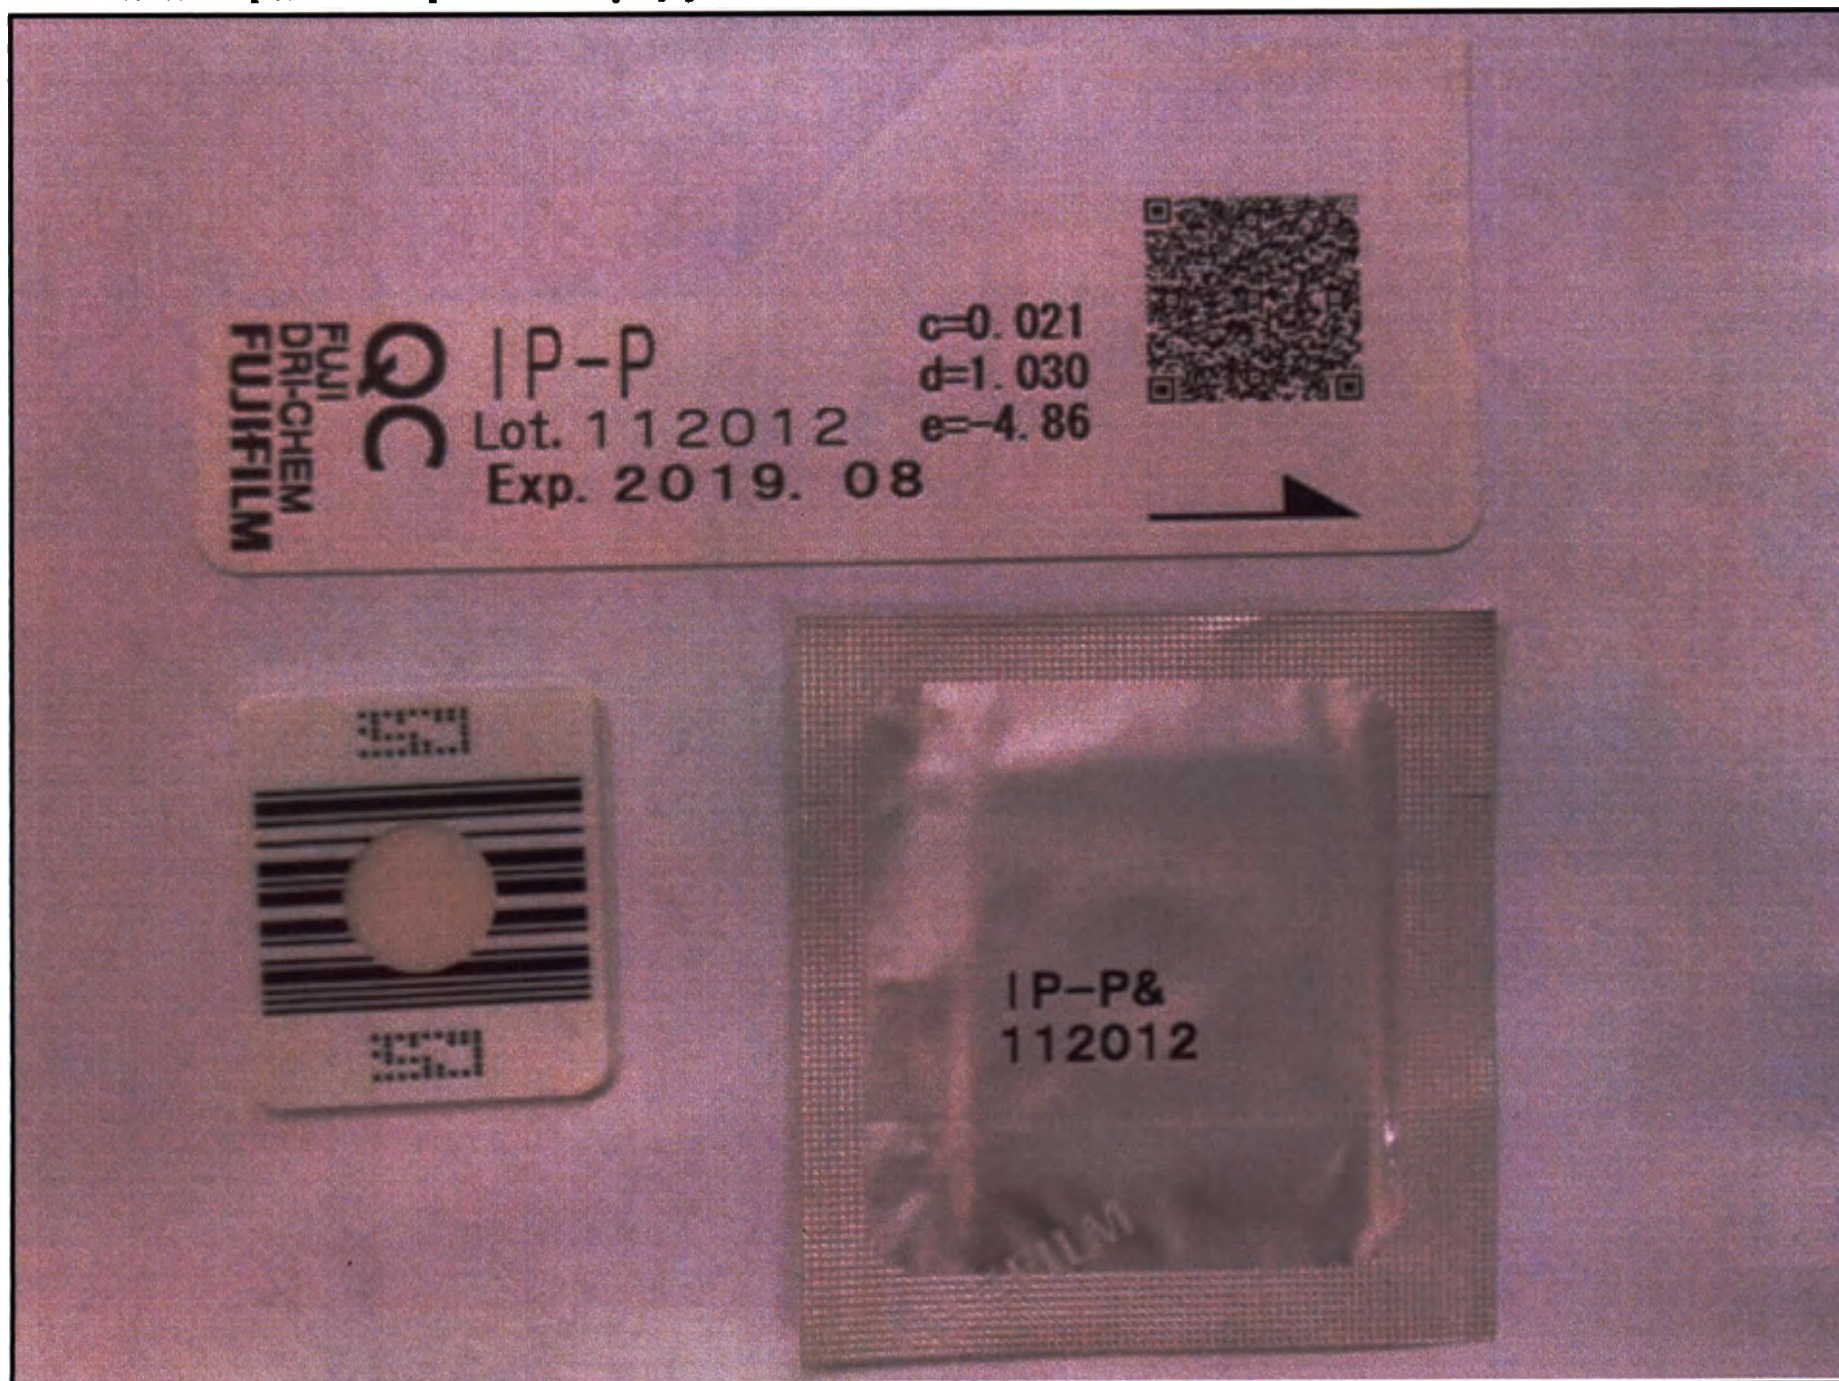

17. Слайды для определения неорганического фосфора FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения неорганического фосфора FUJI DRI-CHEM SLIDE IP-P - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809580

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Токуо 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

18. Слайды для определения лейцинаминопептидазы FUJI DRI-CHEM SLIDE LAP-P

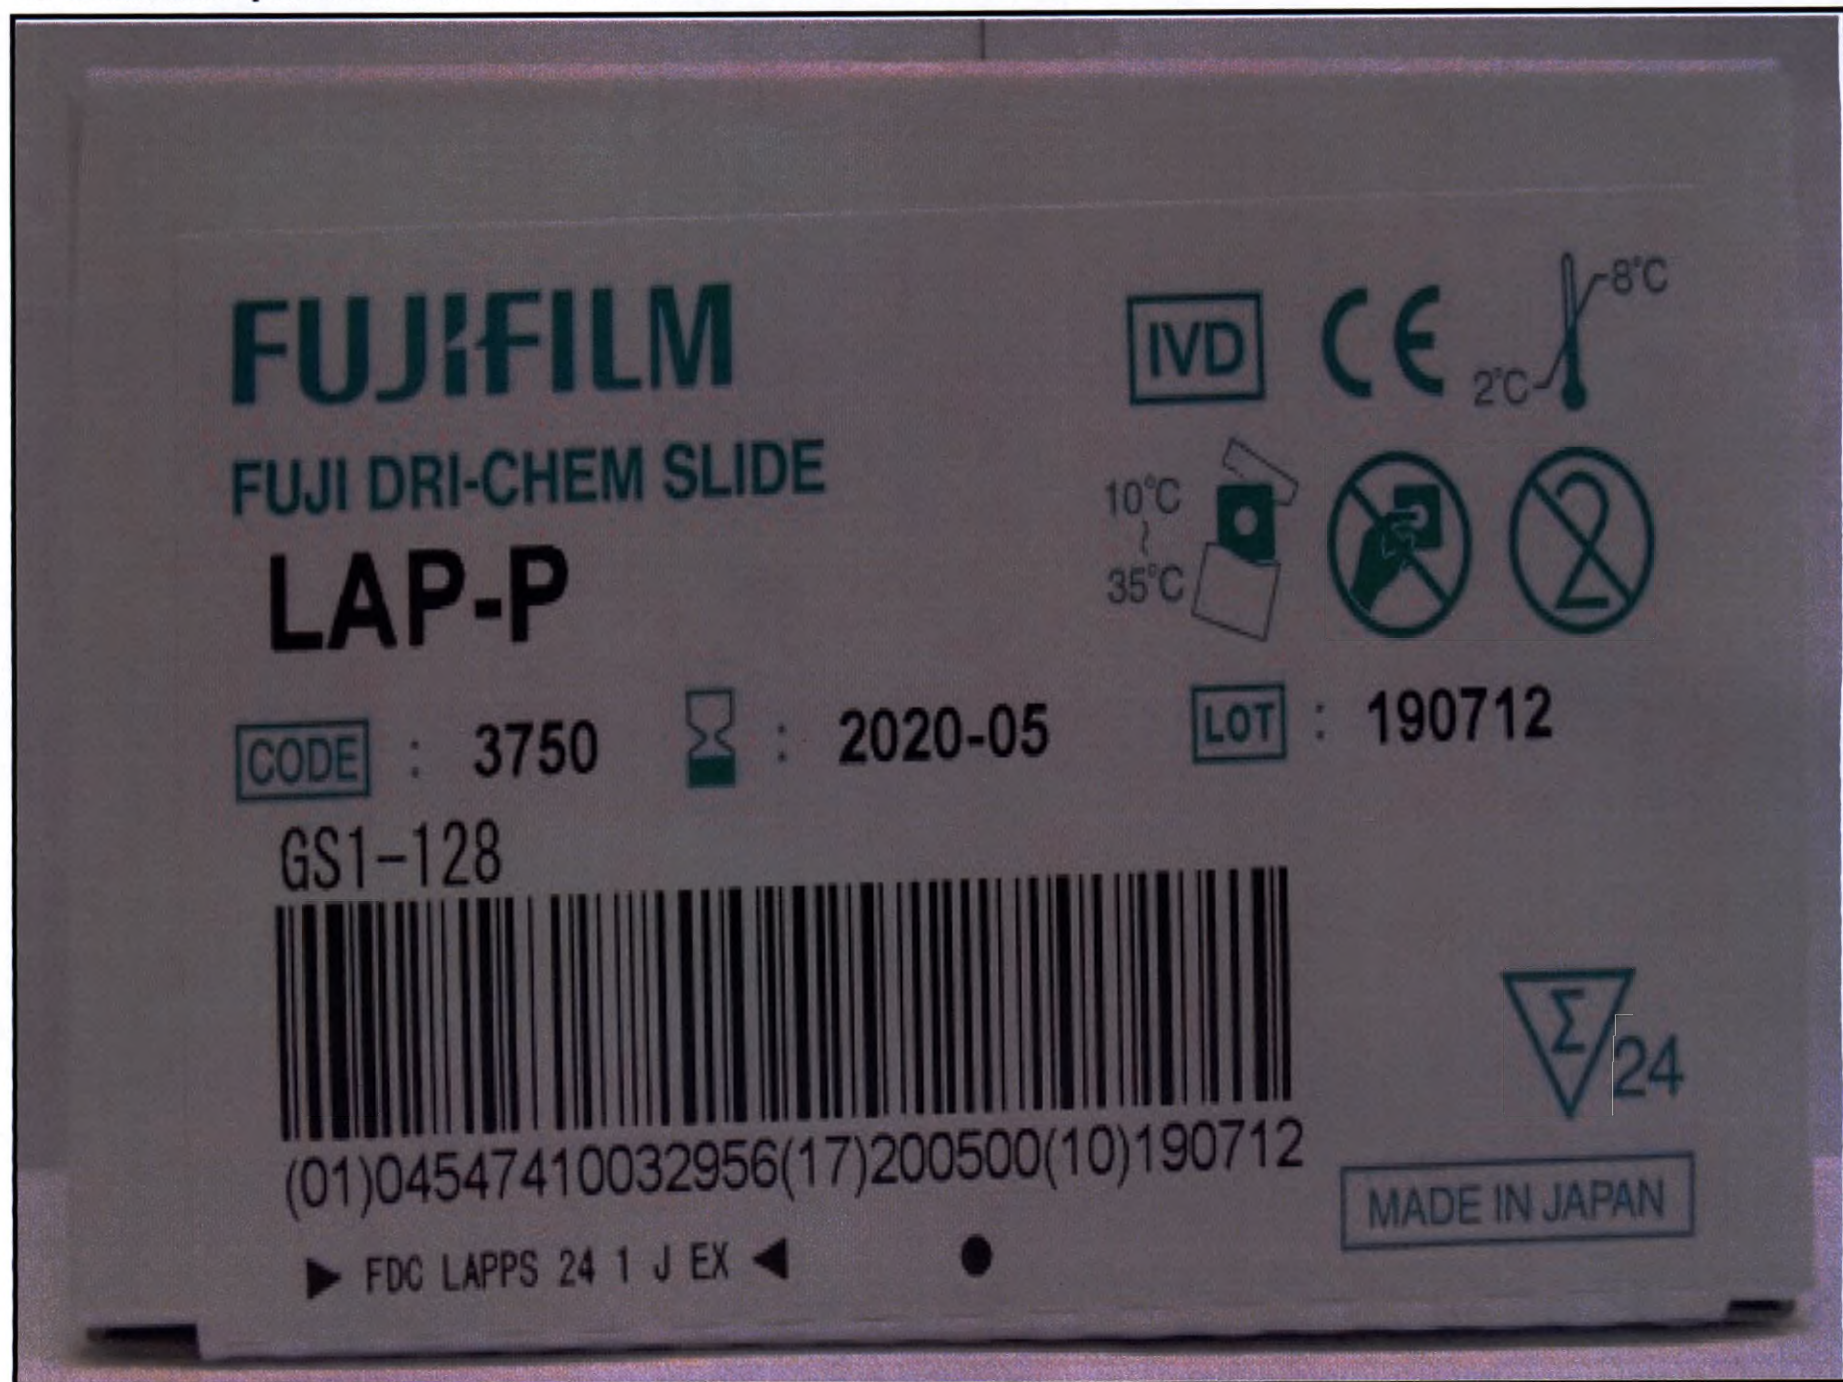

18. Слайды для определения лейцинаминопептидазы FUJI DRI-CHEM SLIDE LAP-P

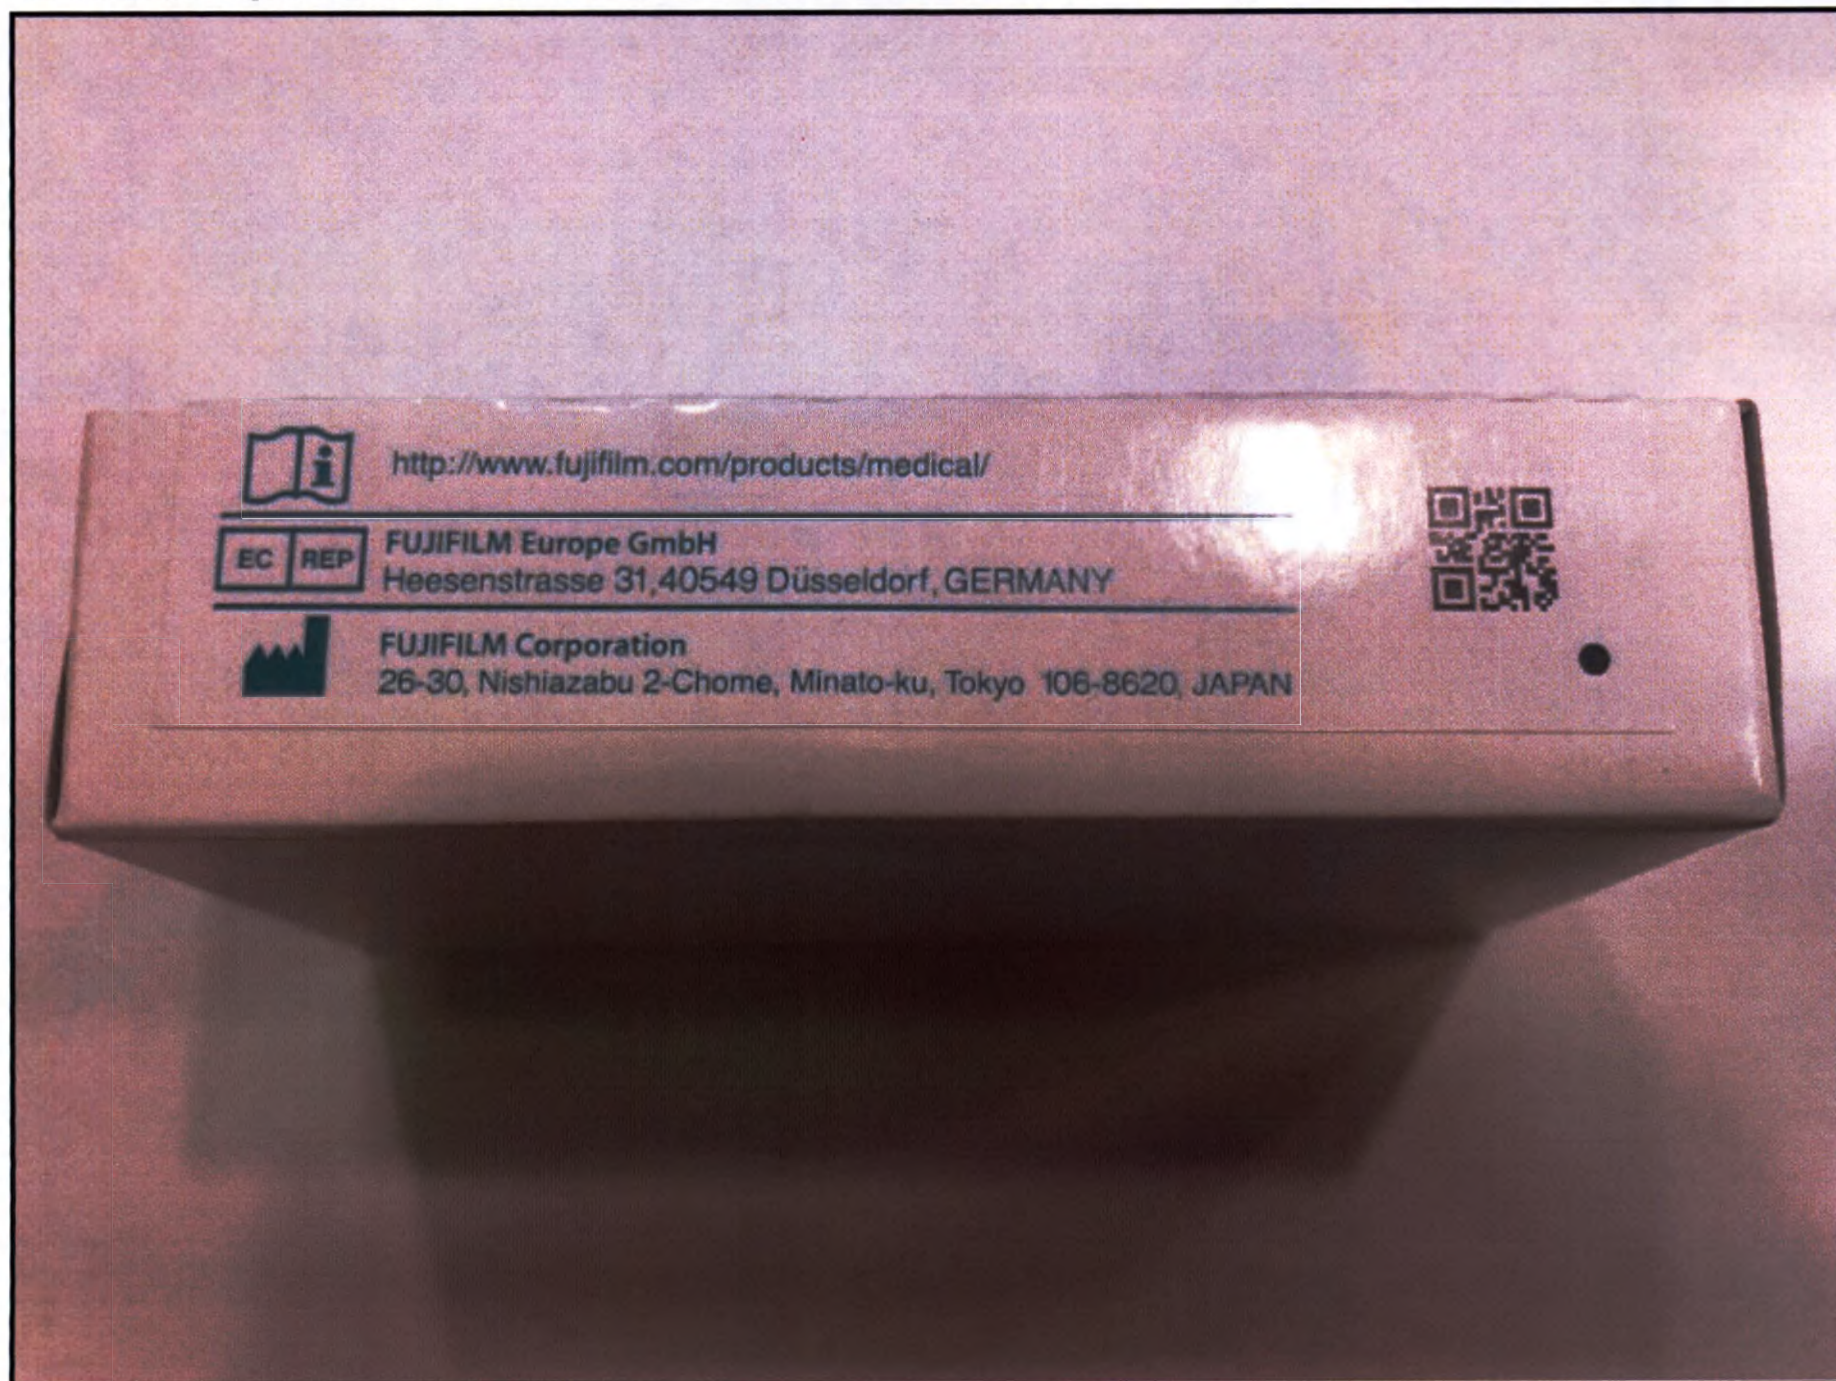

18. Слайды для определения лейцинамминопептидазы FUJI DRI-CHEM SLIDE LAP-P



18. Слайды для определения лейцинамипептидазы FUJI DRI-CHEM SLIDE LAP-P —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения лейцинамипептидазы FUJI DRI-CHEM SLIDE LAP-P -24 шт./1уп.

Кат. № 15809592

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Токио 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Барзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


19. Слайды для определения лактатдегидрогеназы FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-P III

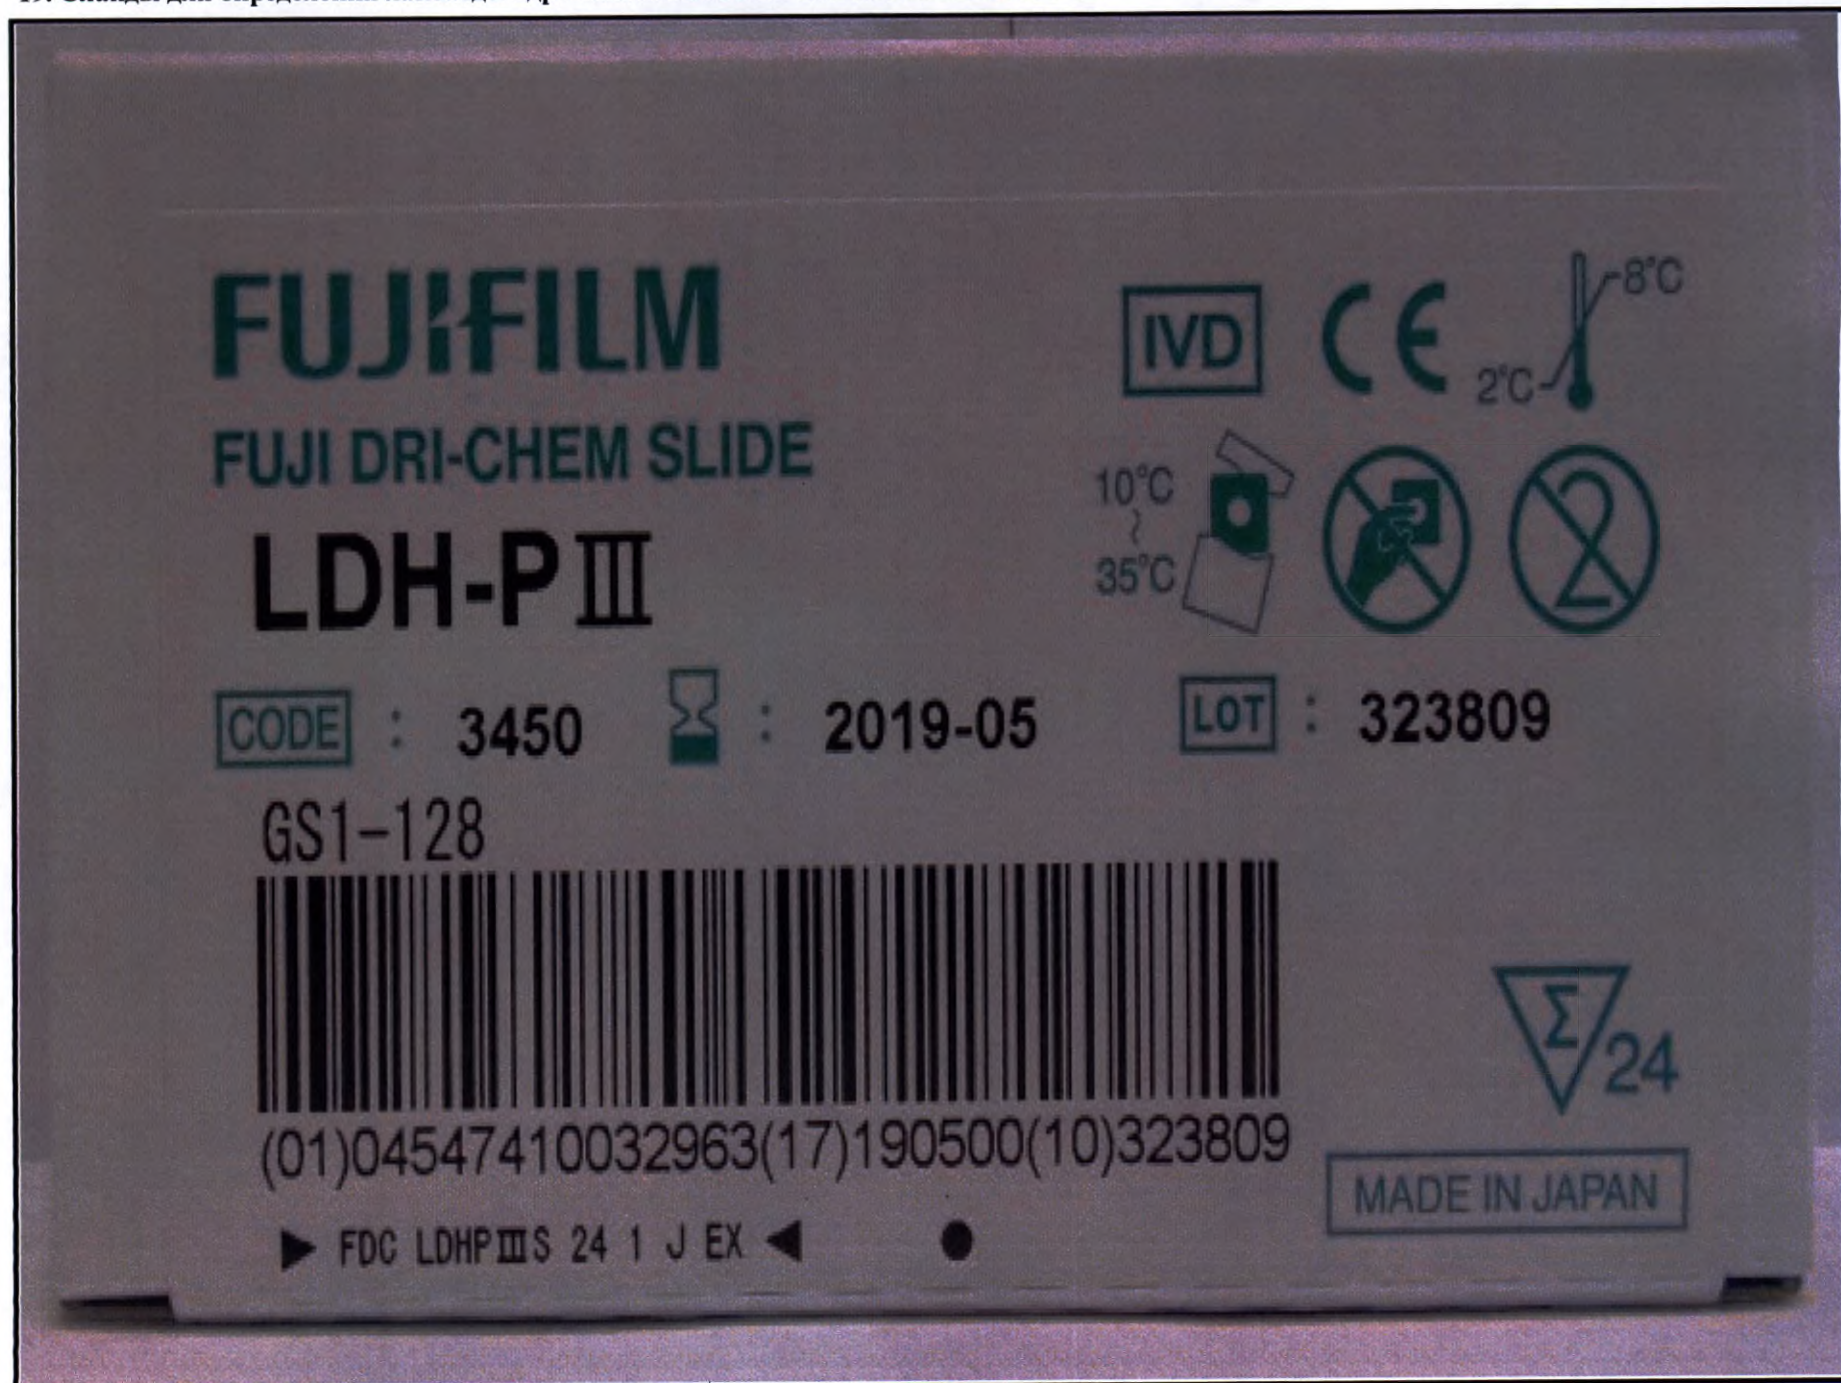

19. Слайды для определения лактатдегидрогеназы FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-P III

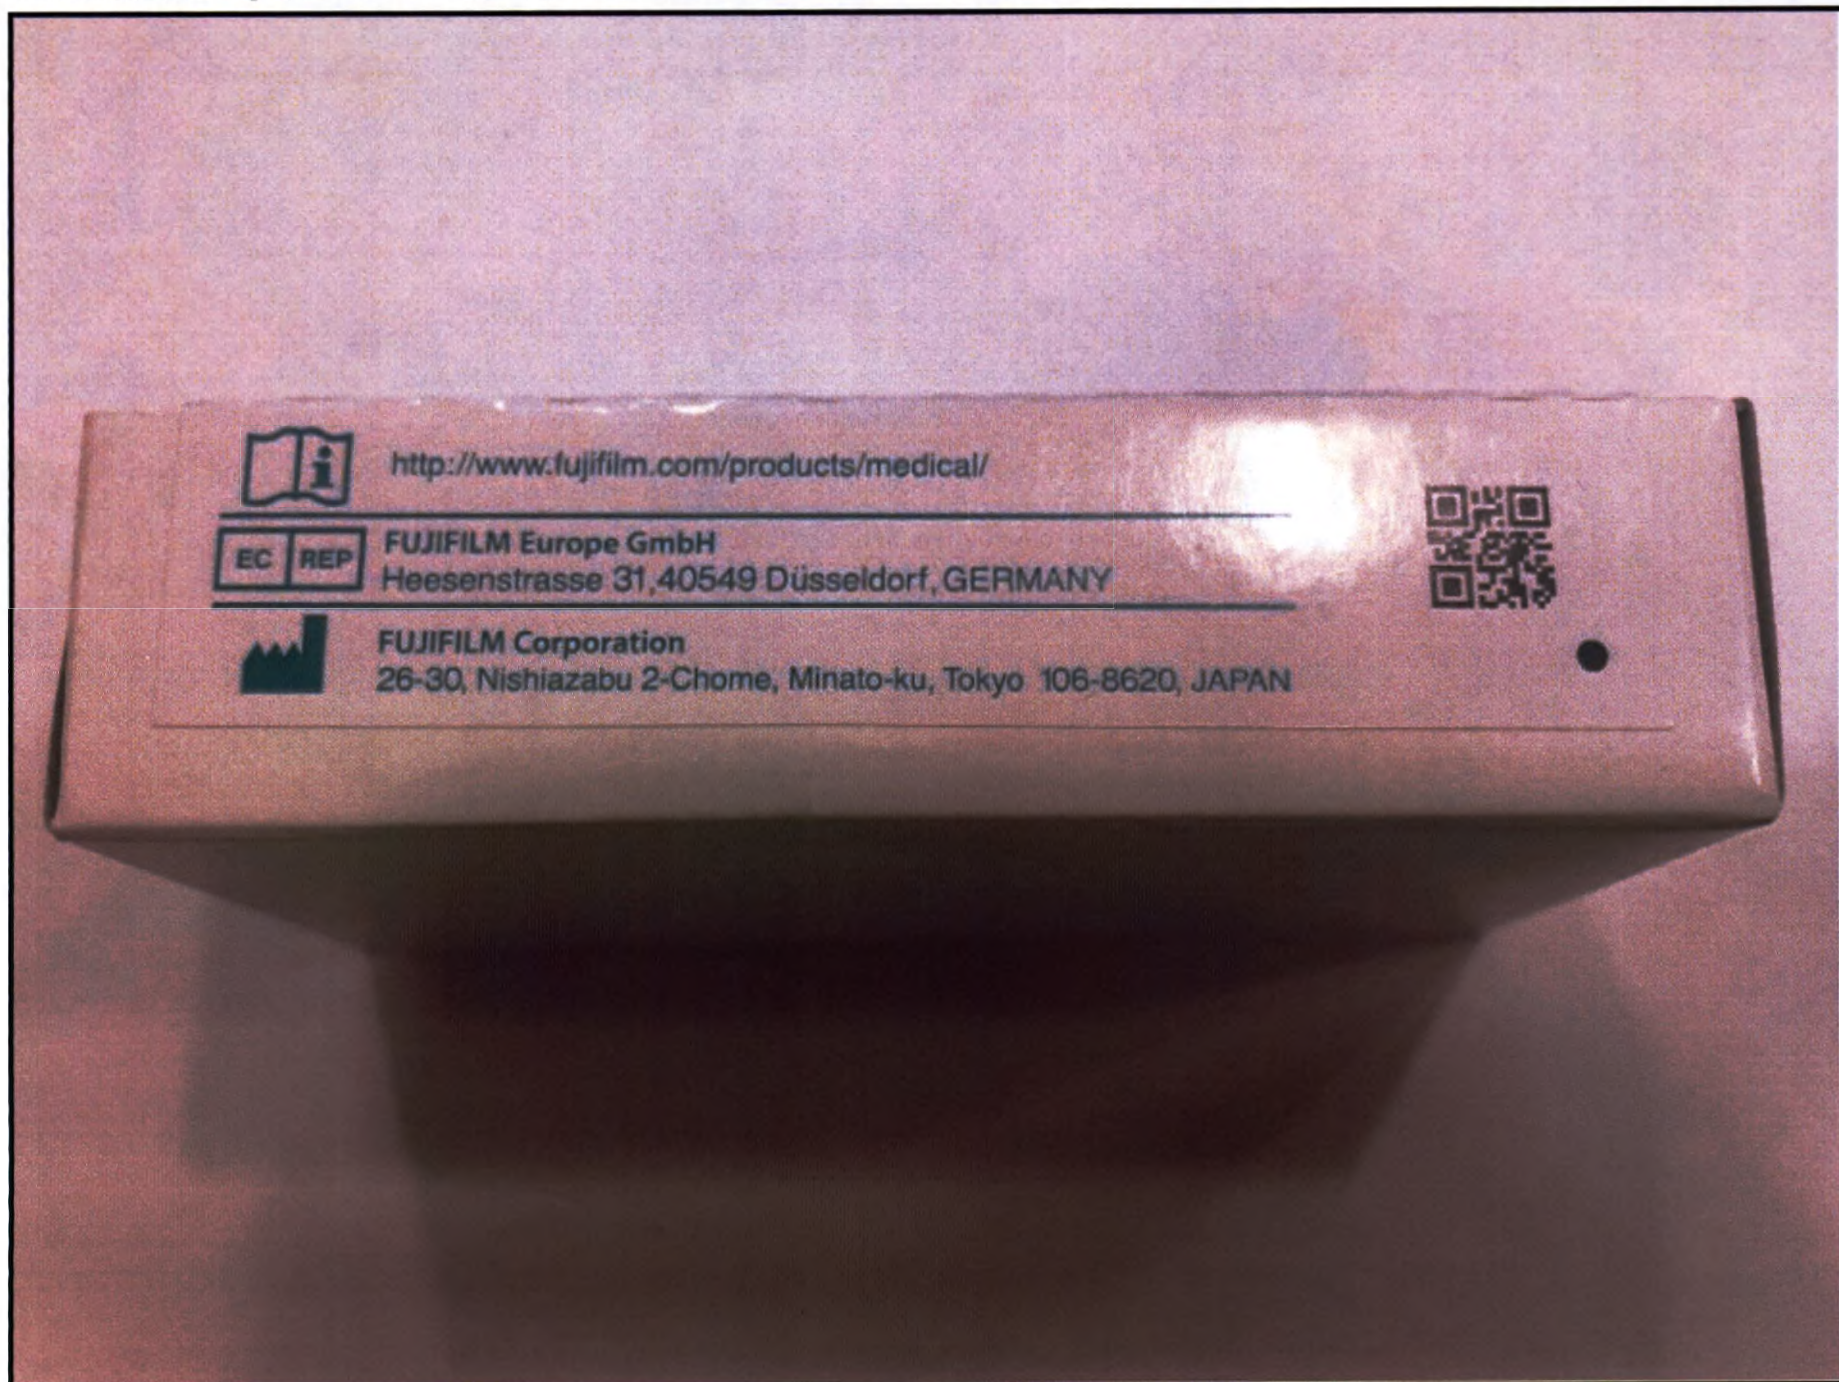

19. Слайды для определения лактатдегидрогеназы FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-P III

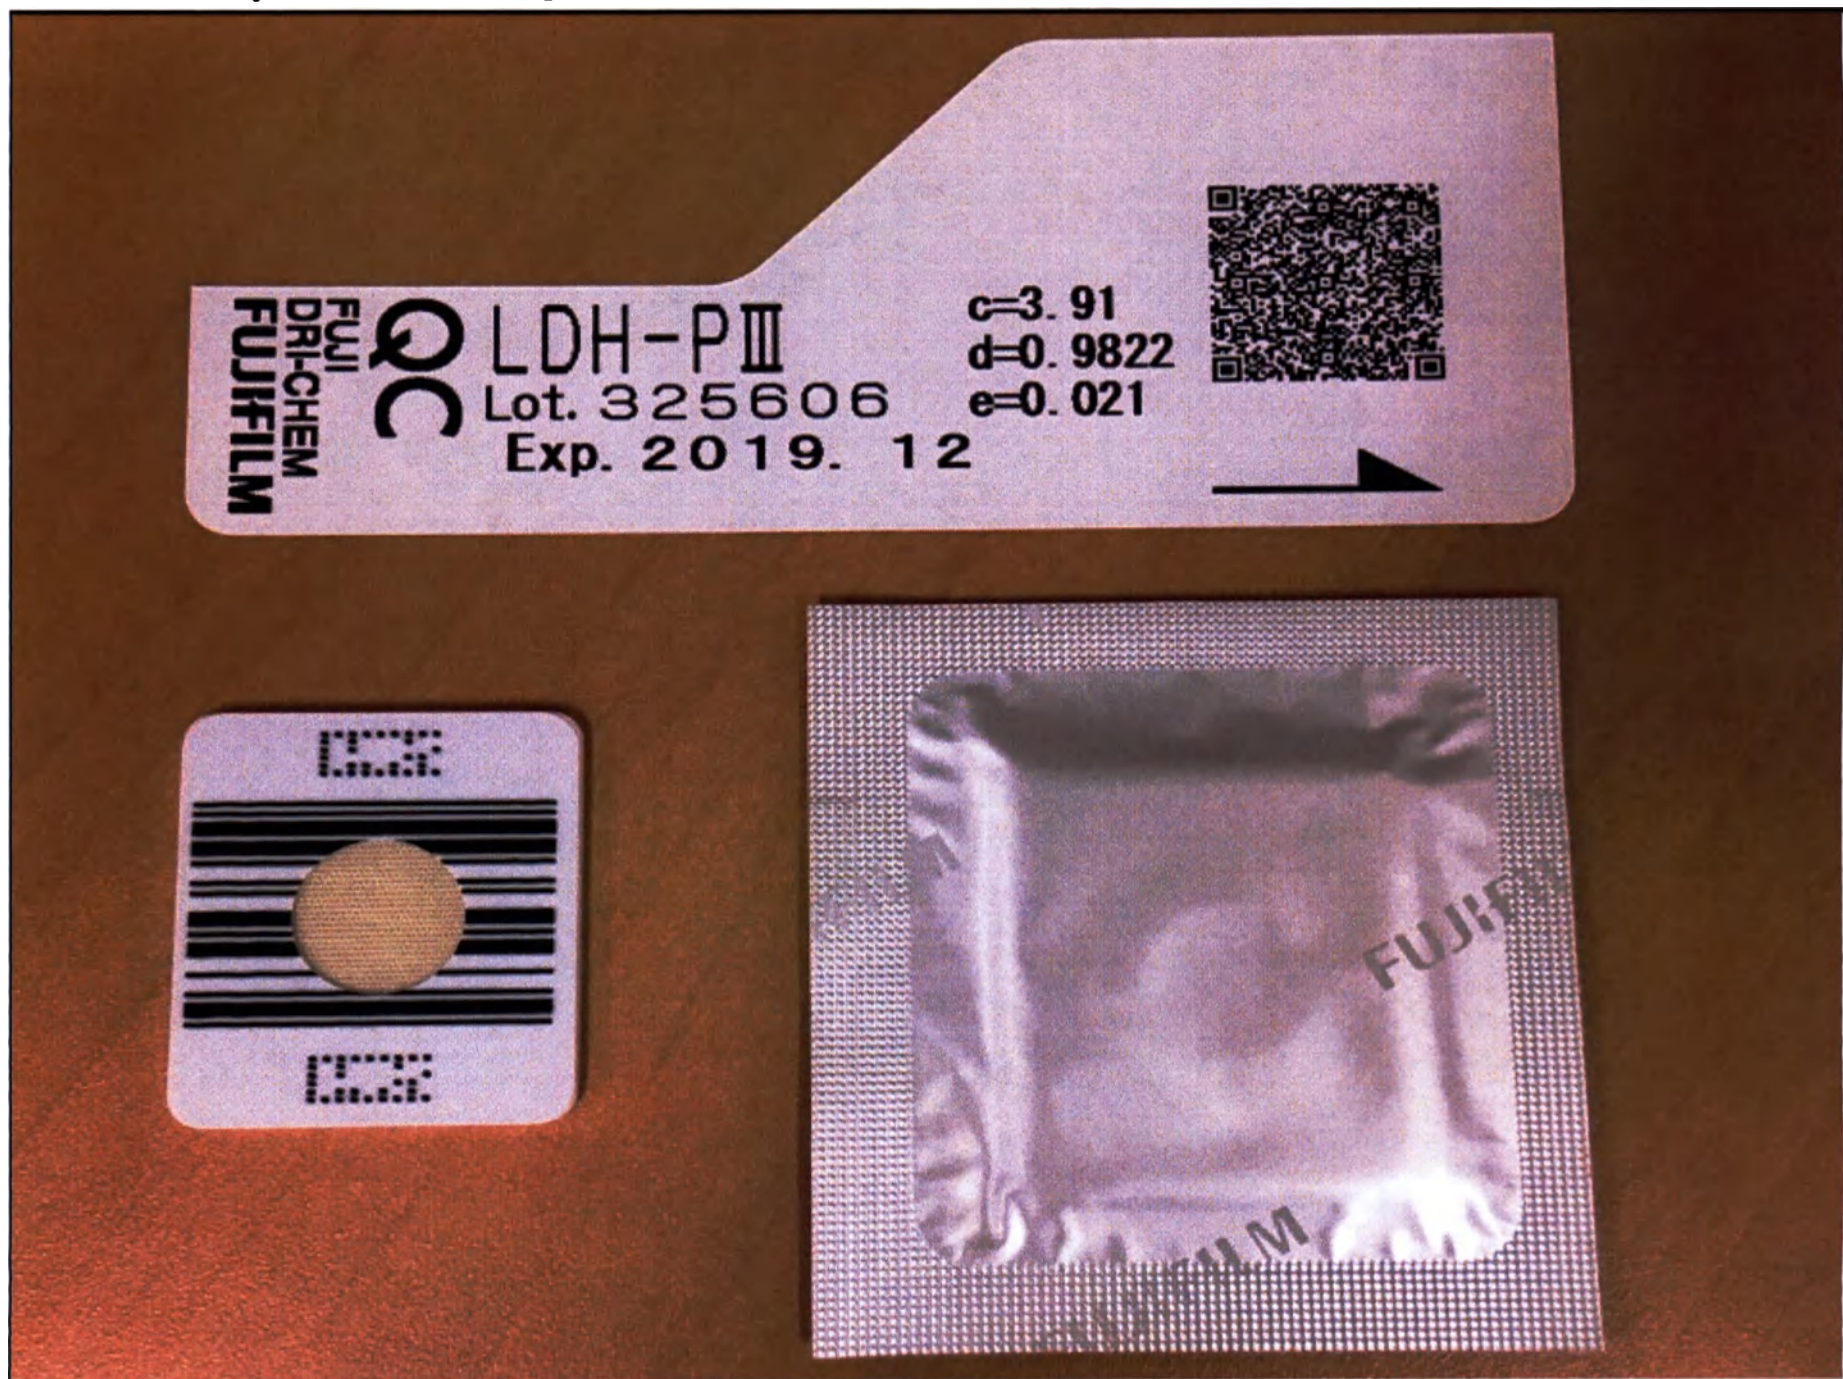

19. Слайды для определения лактатдегидрогеназы FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения лактатдегидрогеназы FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809607

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


20. Слайды для определения магния FUJI DRI-CHEM SLIDE Mg-P III

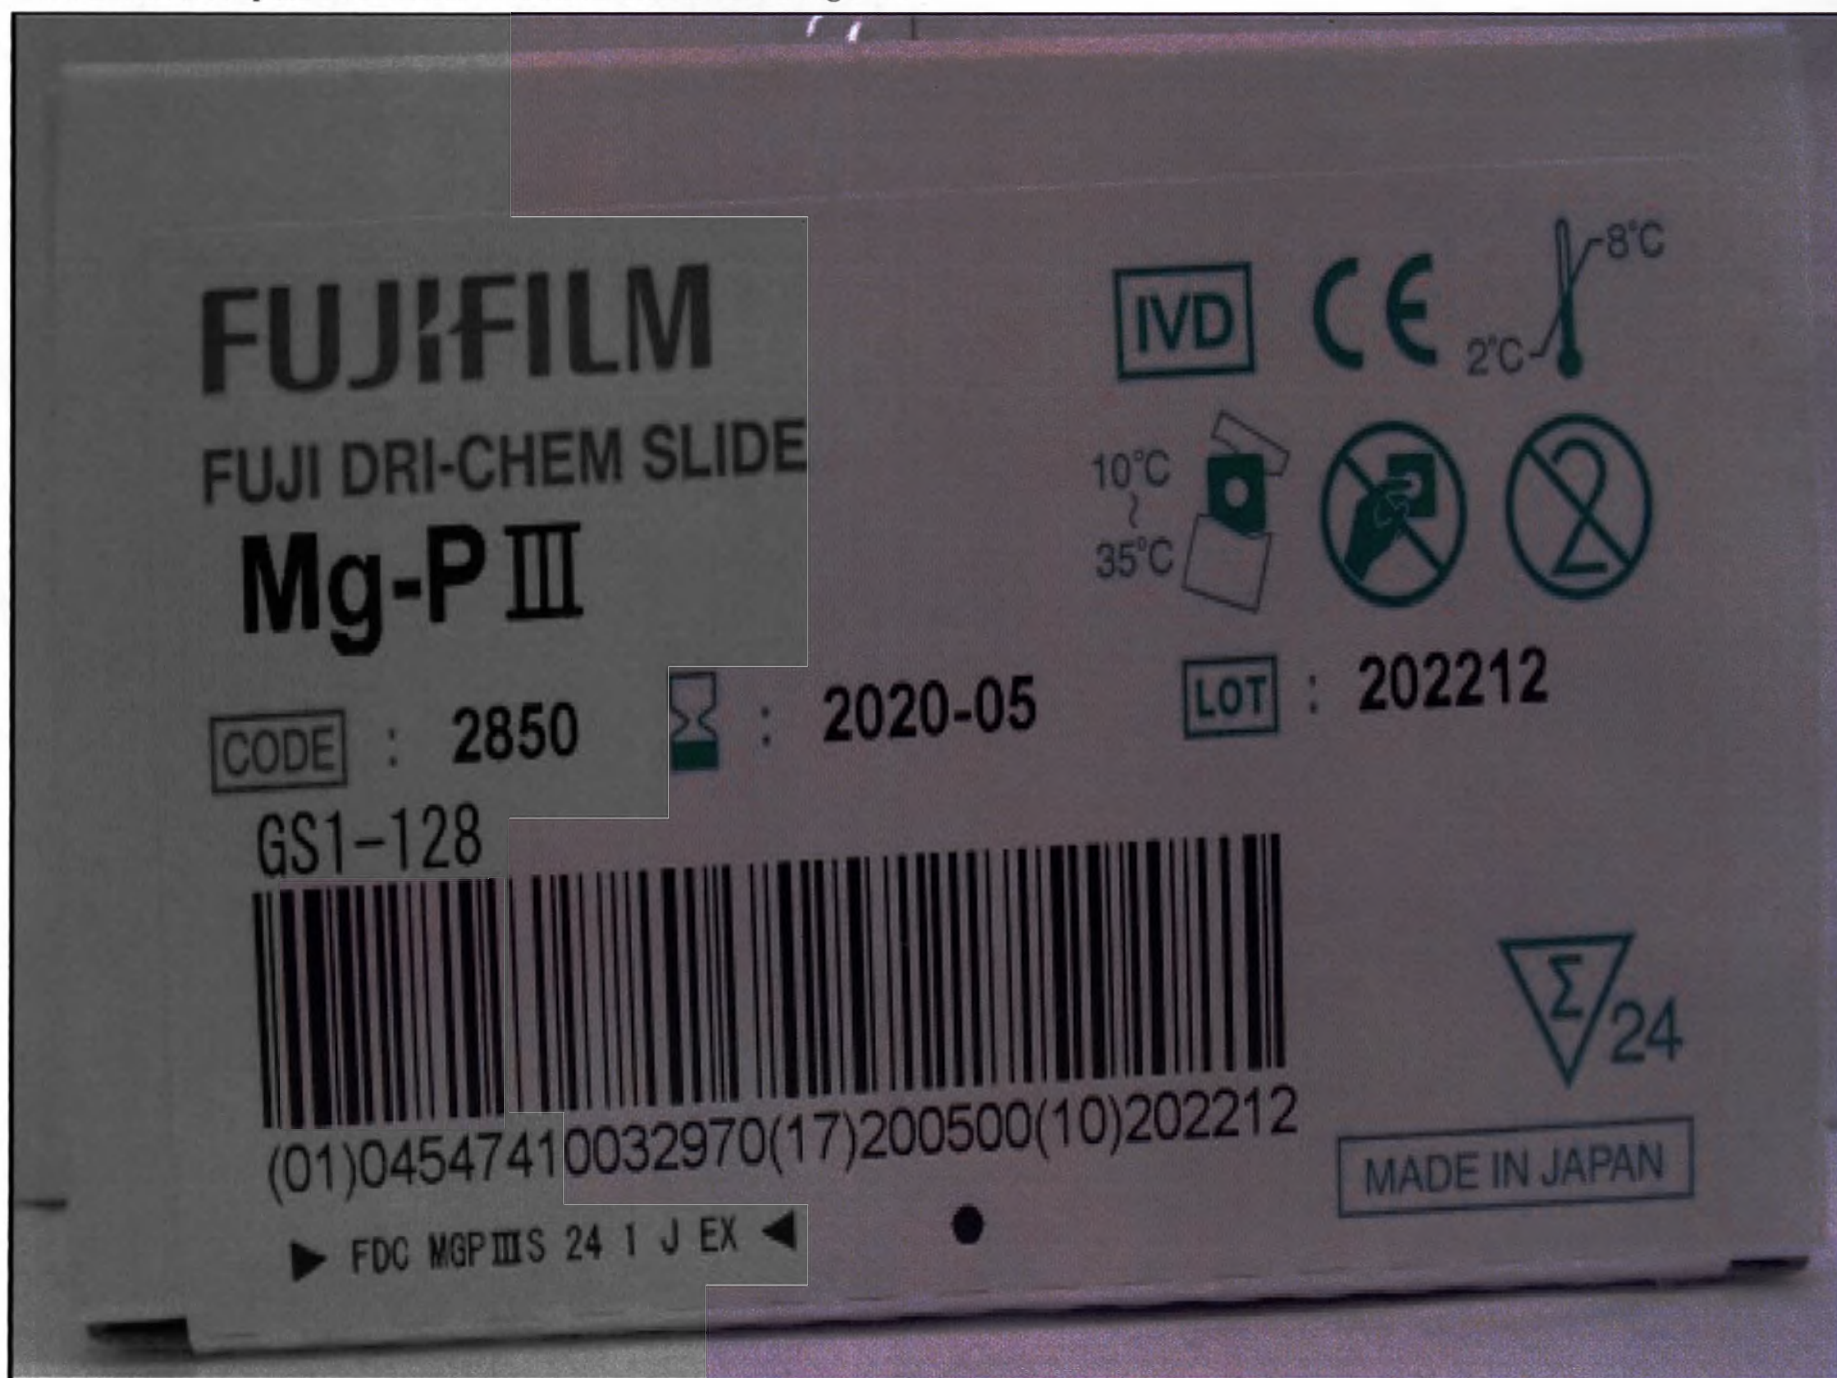

20. Слайды для определения магния FUJI DRI-CHEM SLIDE Mg-P III

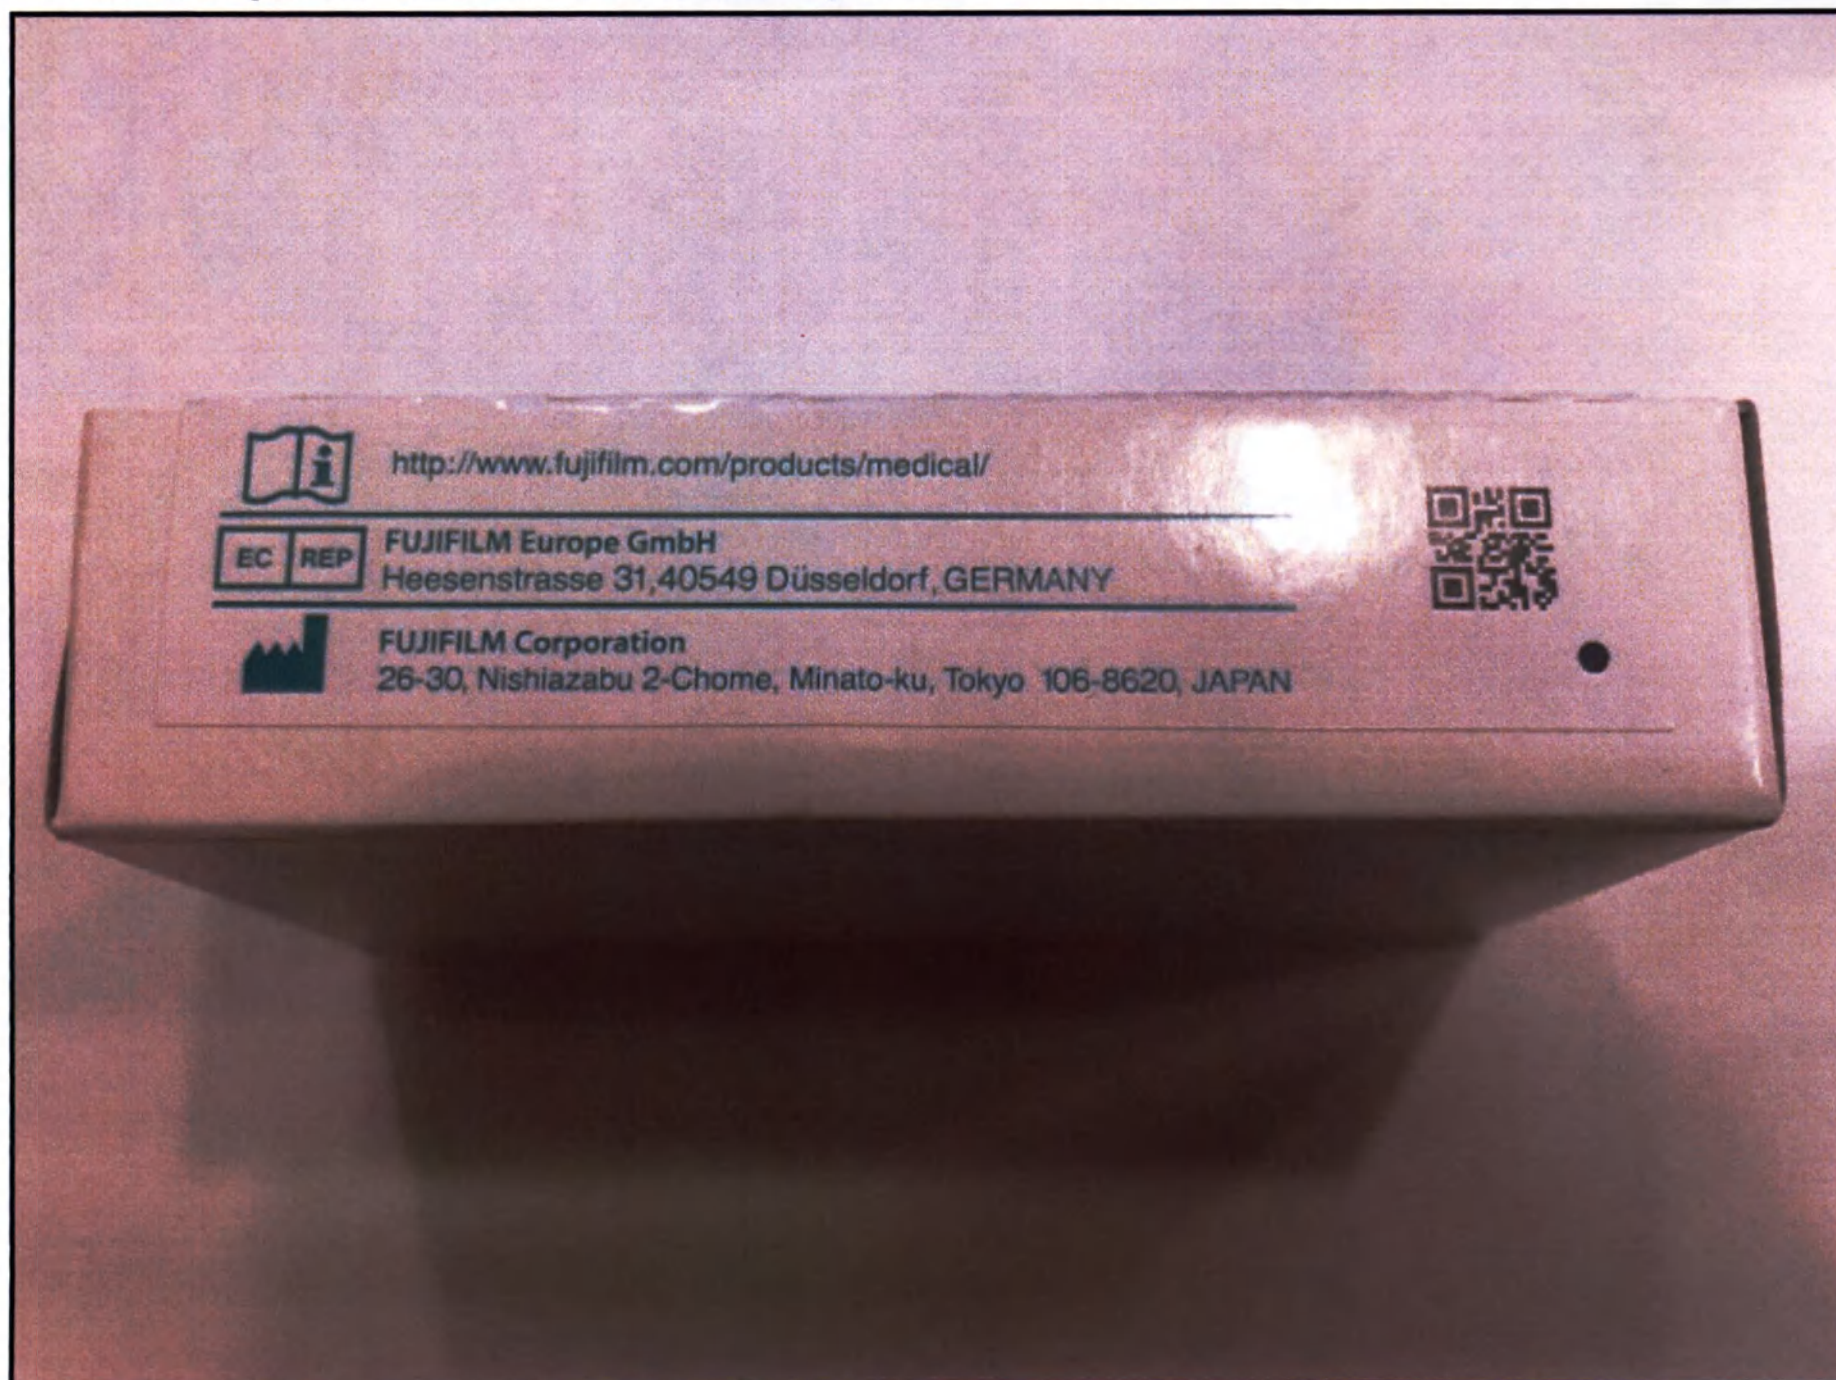

20. Слайды для определения магния FUJI DRI-CHEM SLIDE Mg-P III

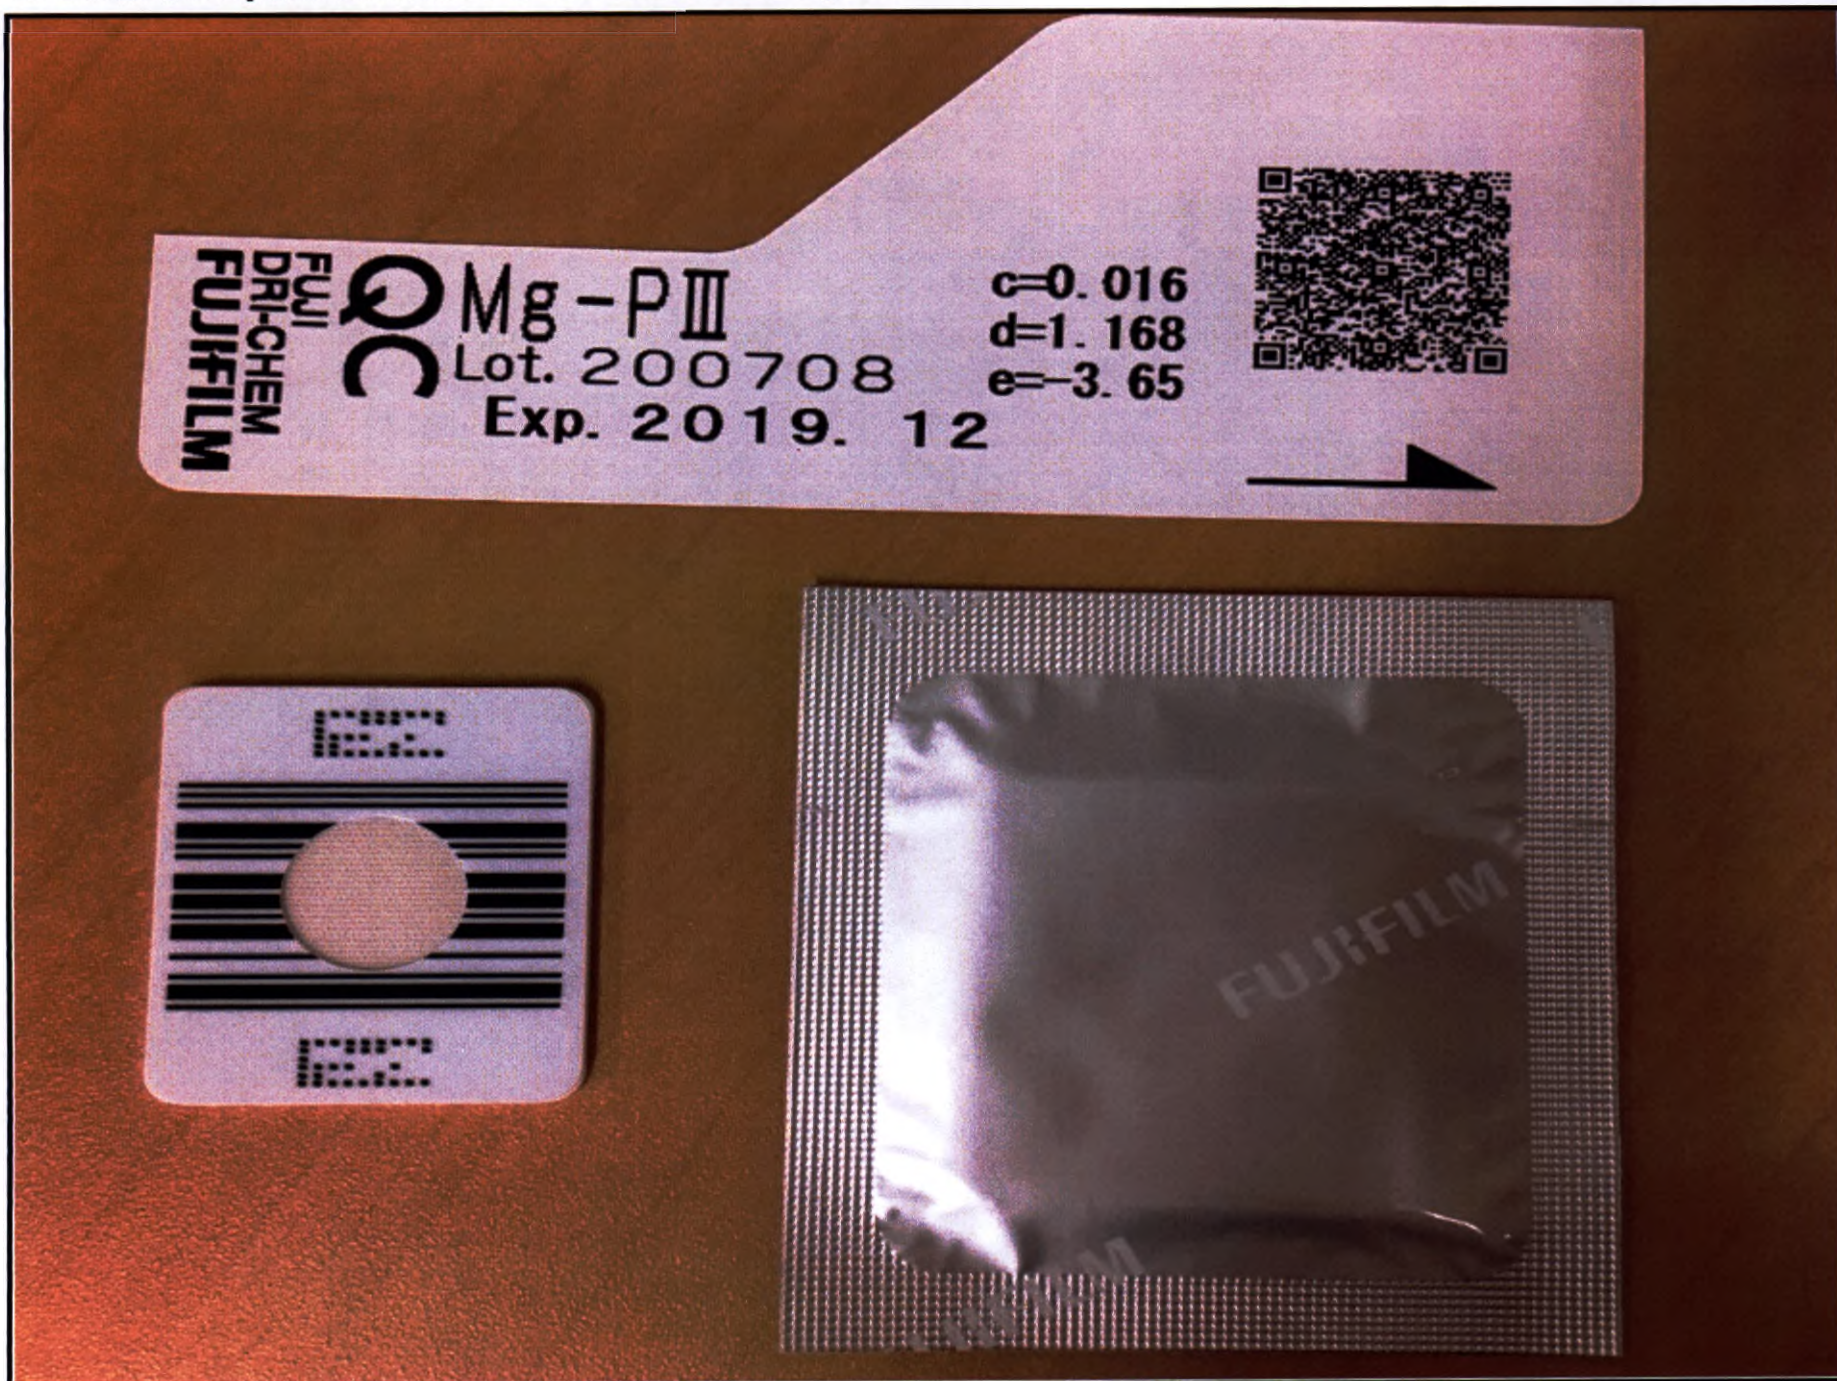

20. Слайды для определения магния FUJI DRI-CHEM SLIDE Mg-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения магния FUJI DRI-CHEM SLIDE Mg-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809619

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com


21. Слайды для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl

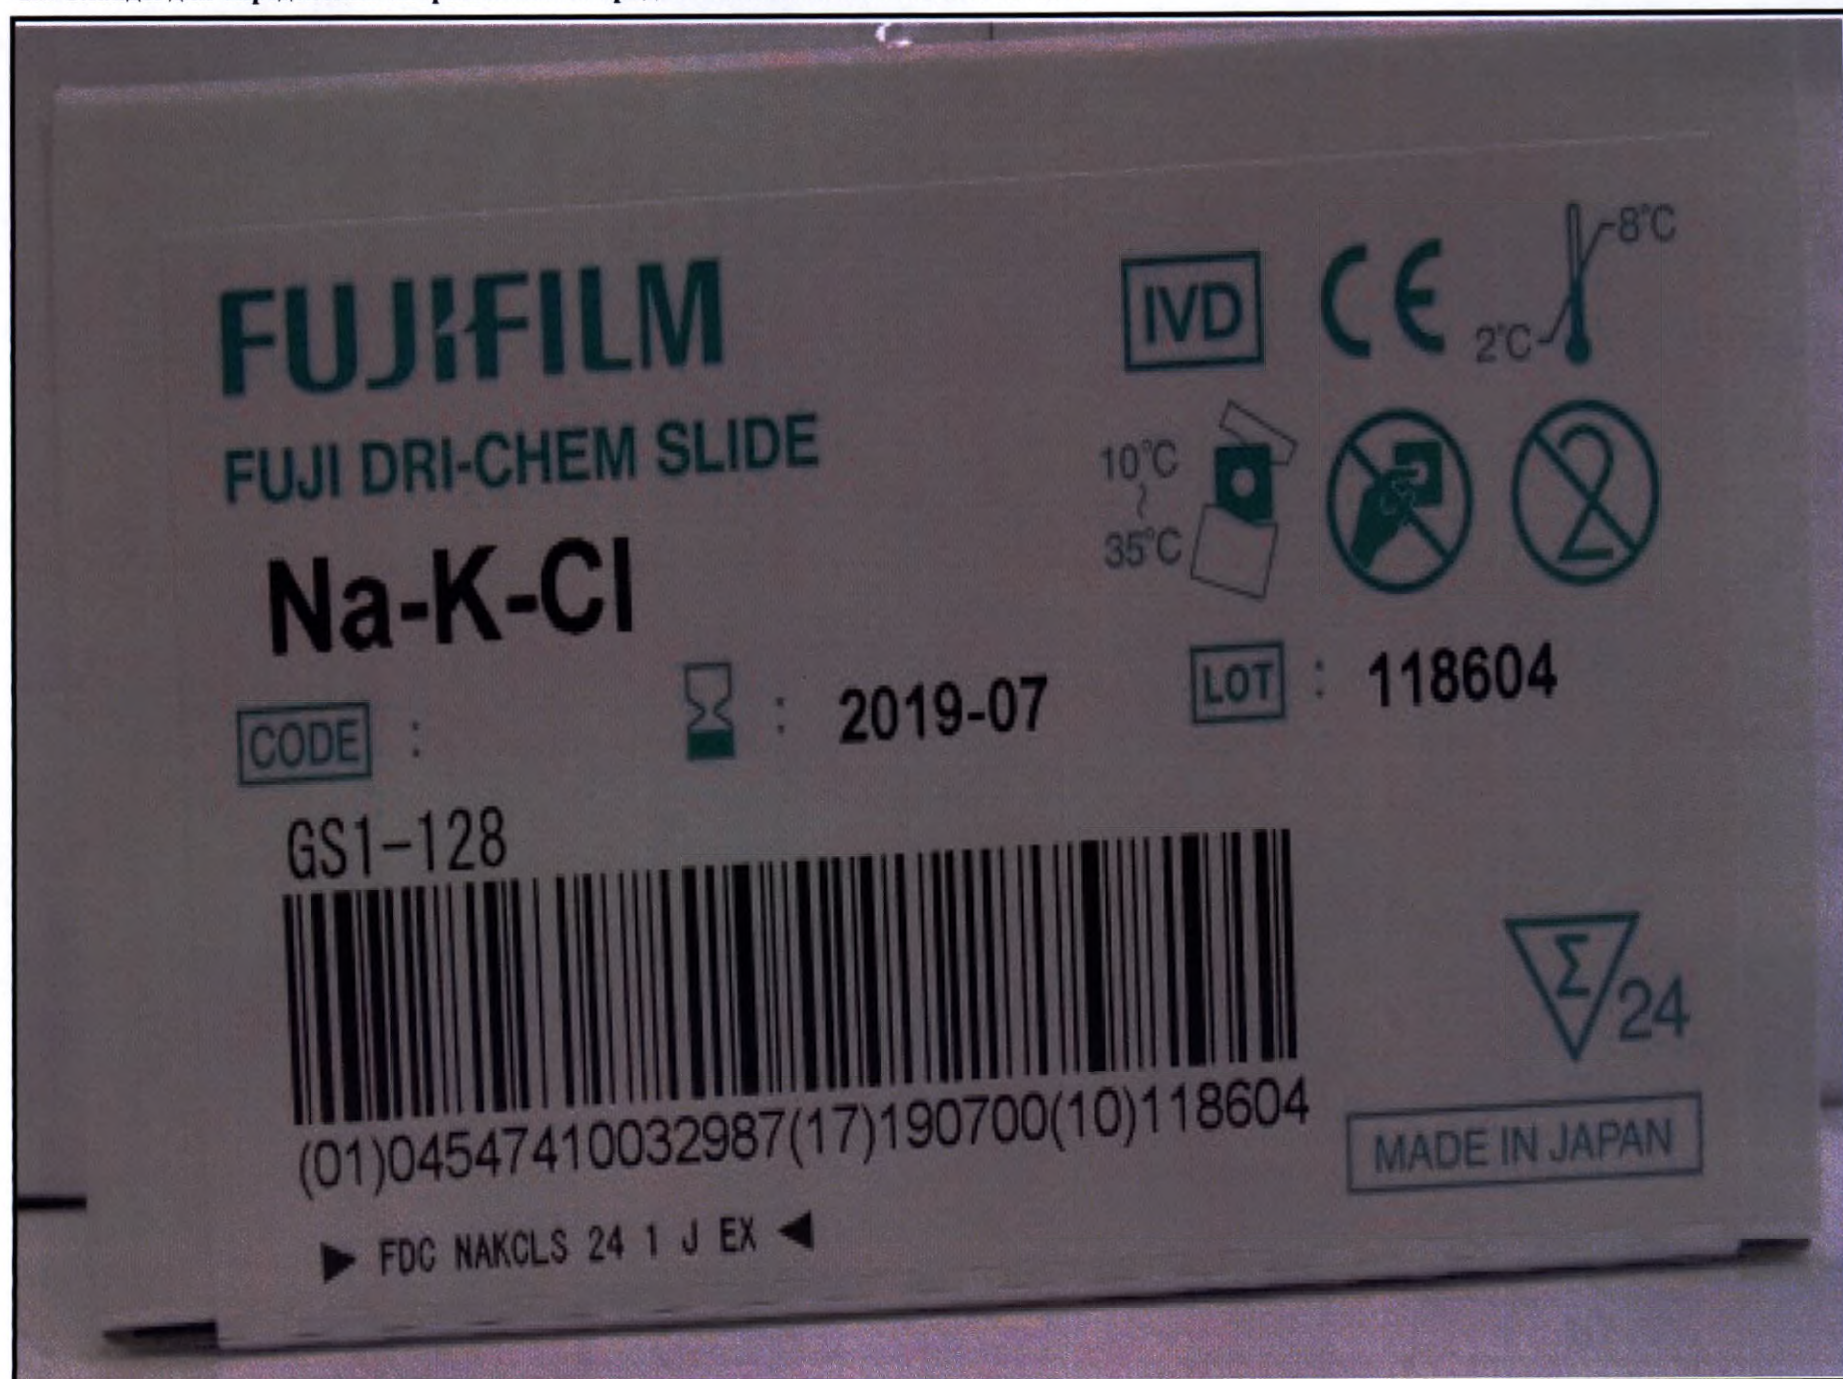

21. Слайды для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl

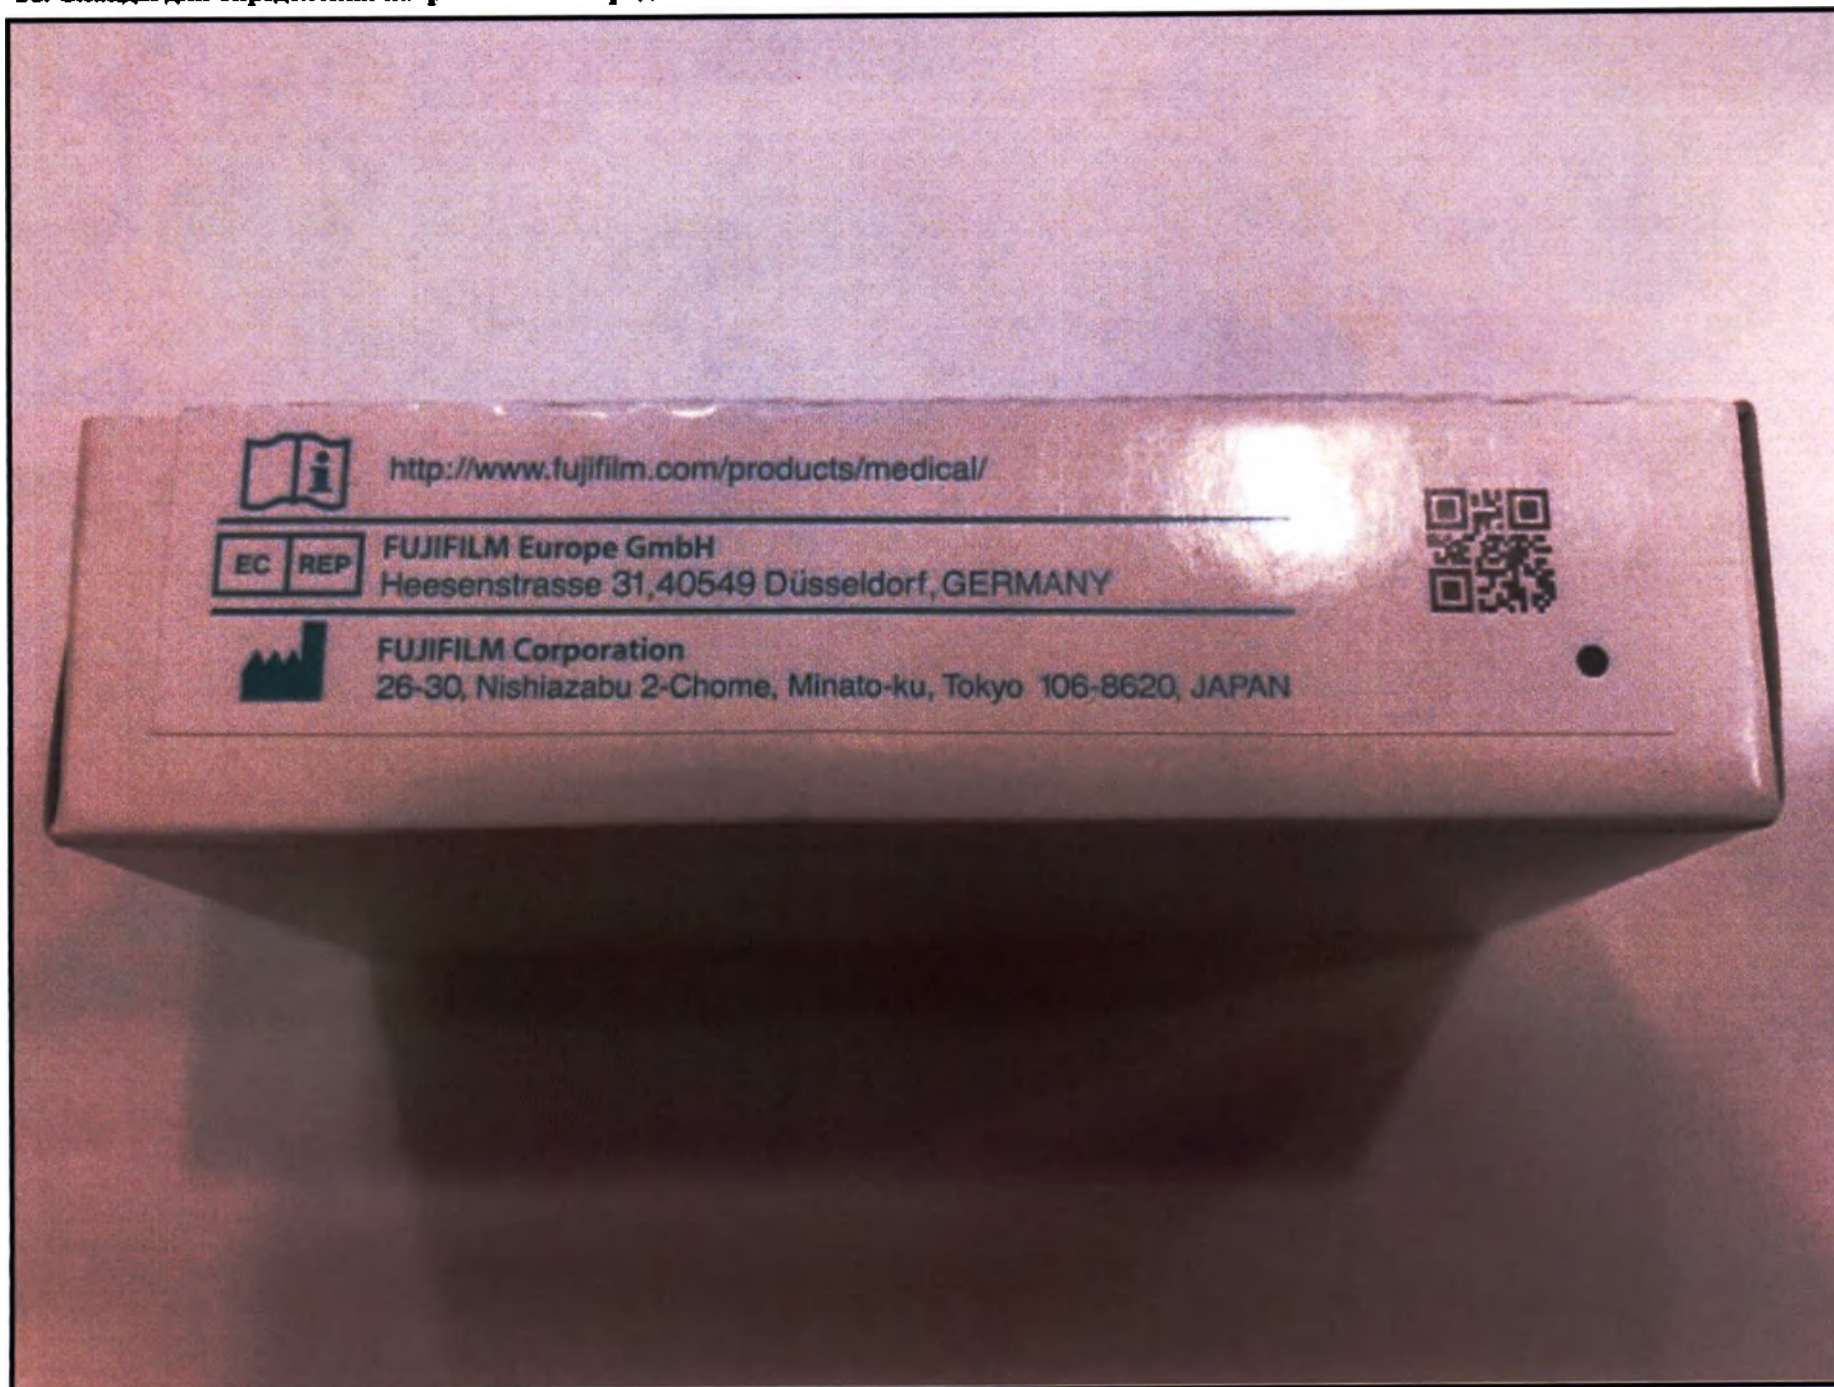

21. Слайды для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl

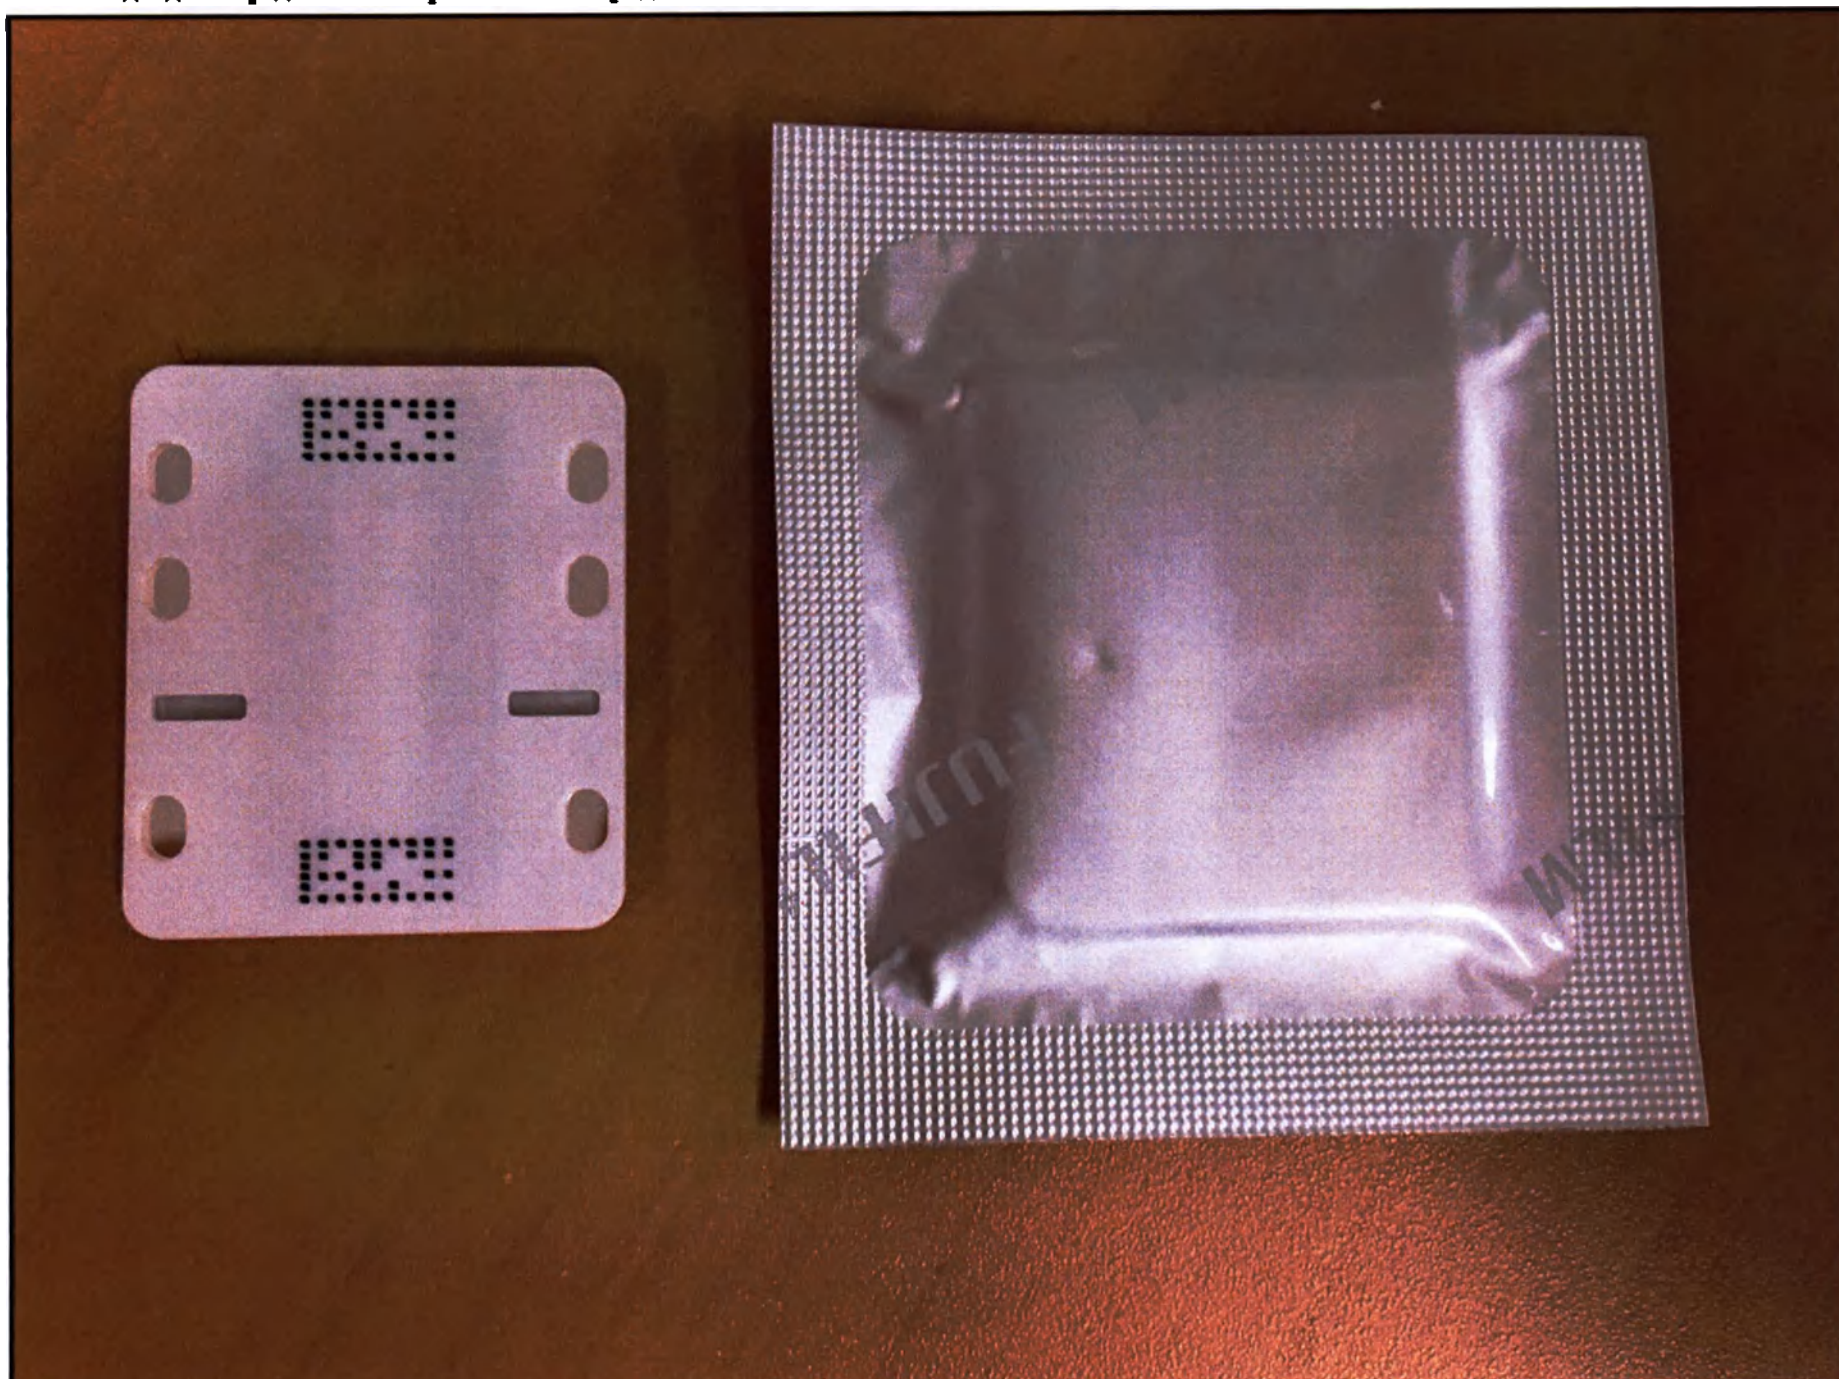

21. Слайды для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809621

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

22. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-P II

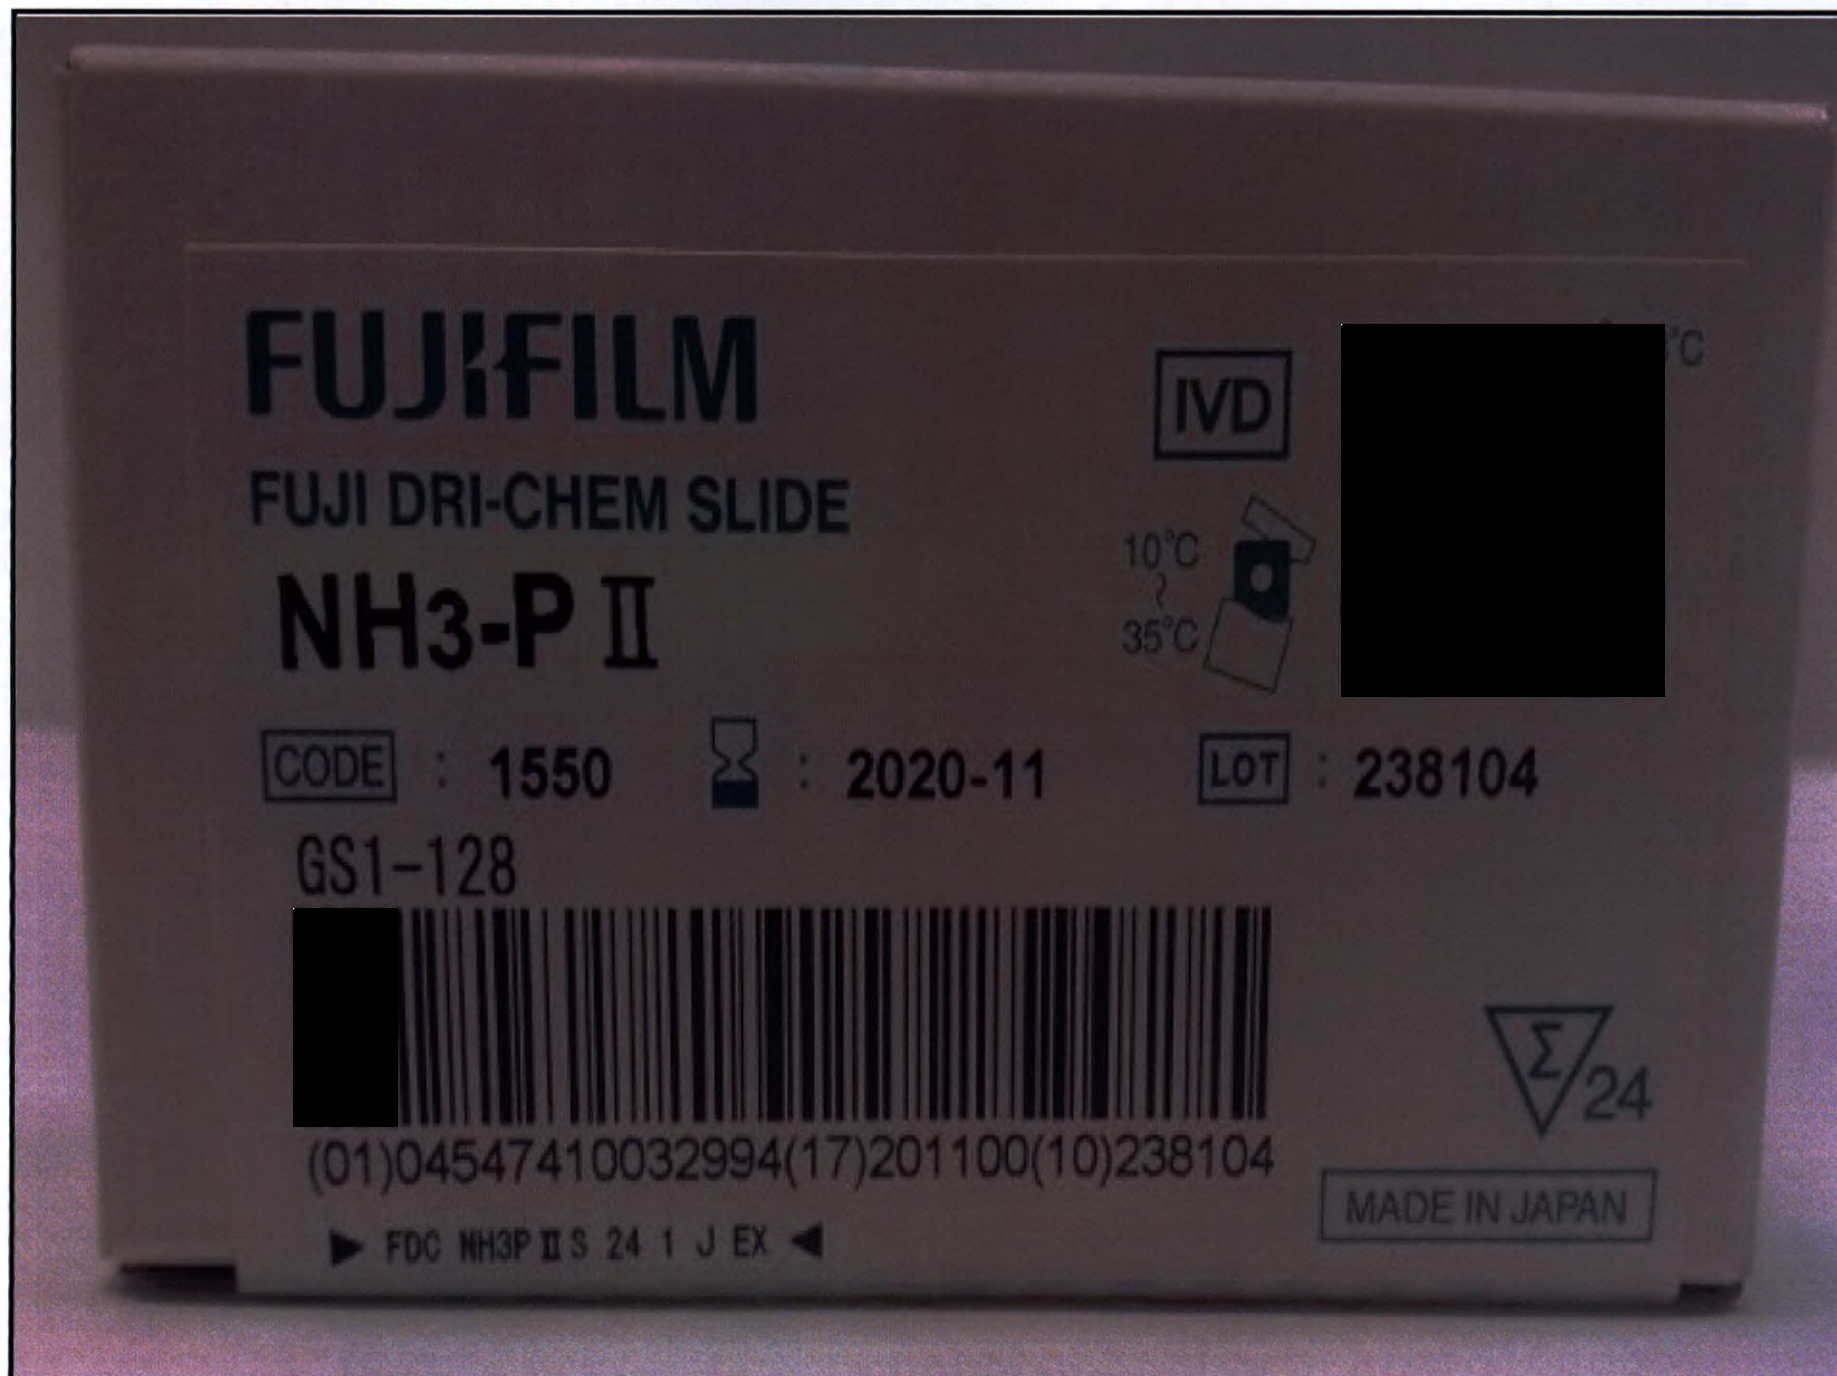

22. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-P II

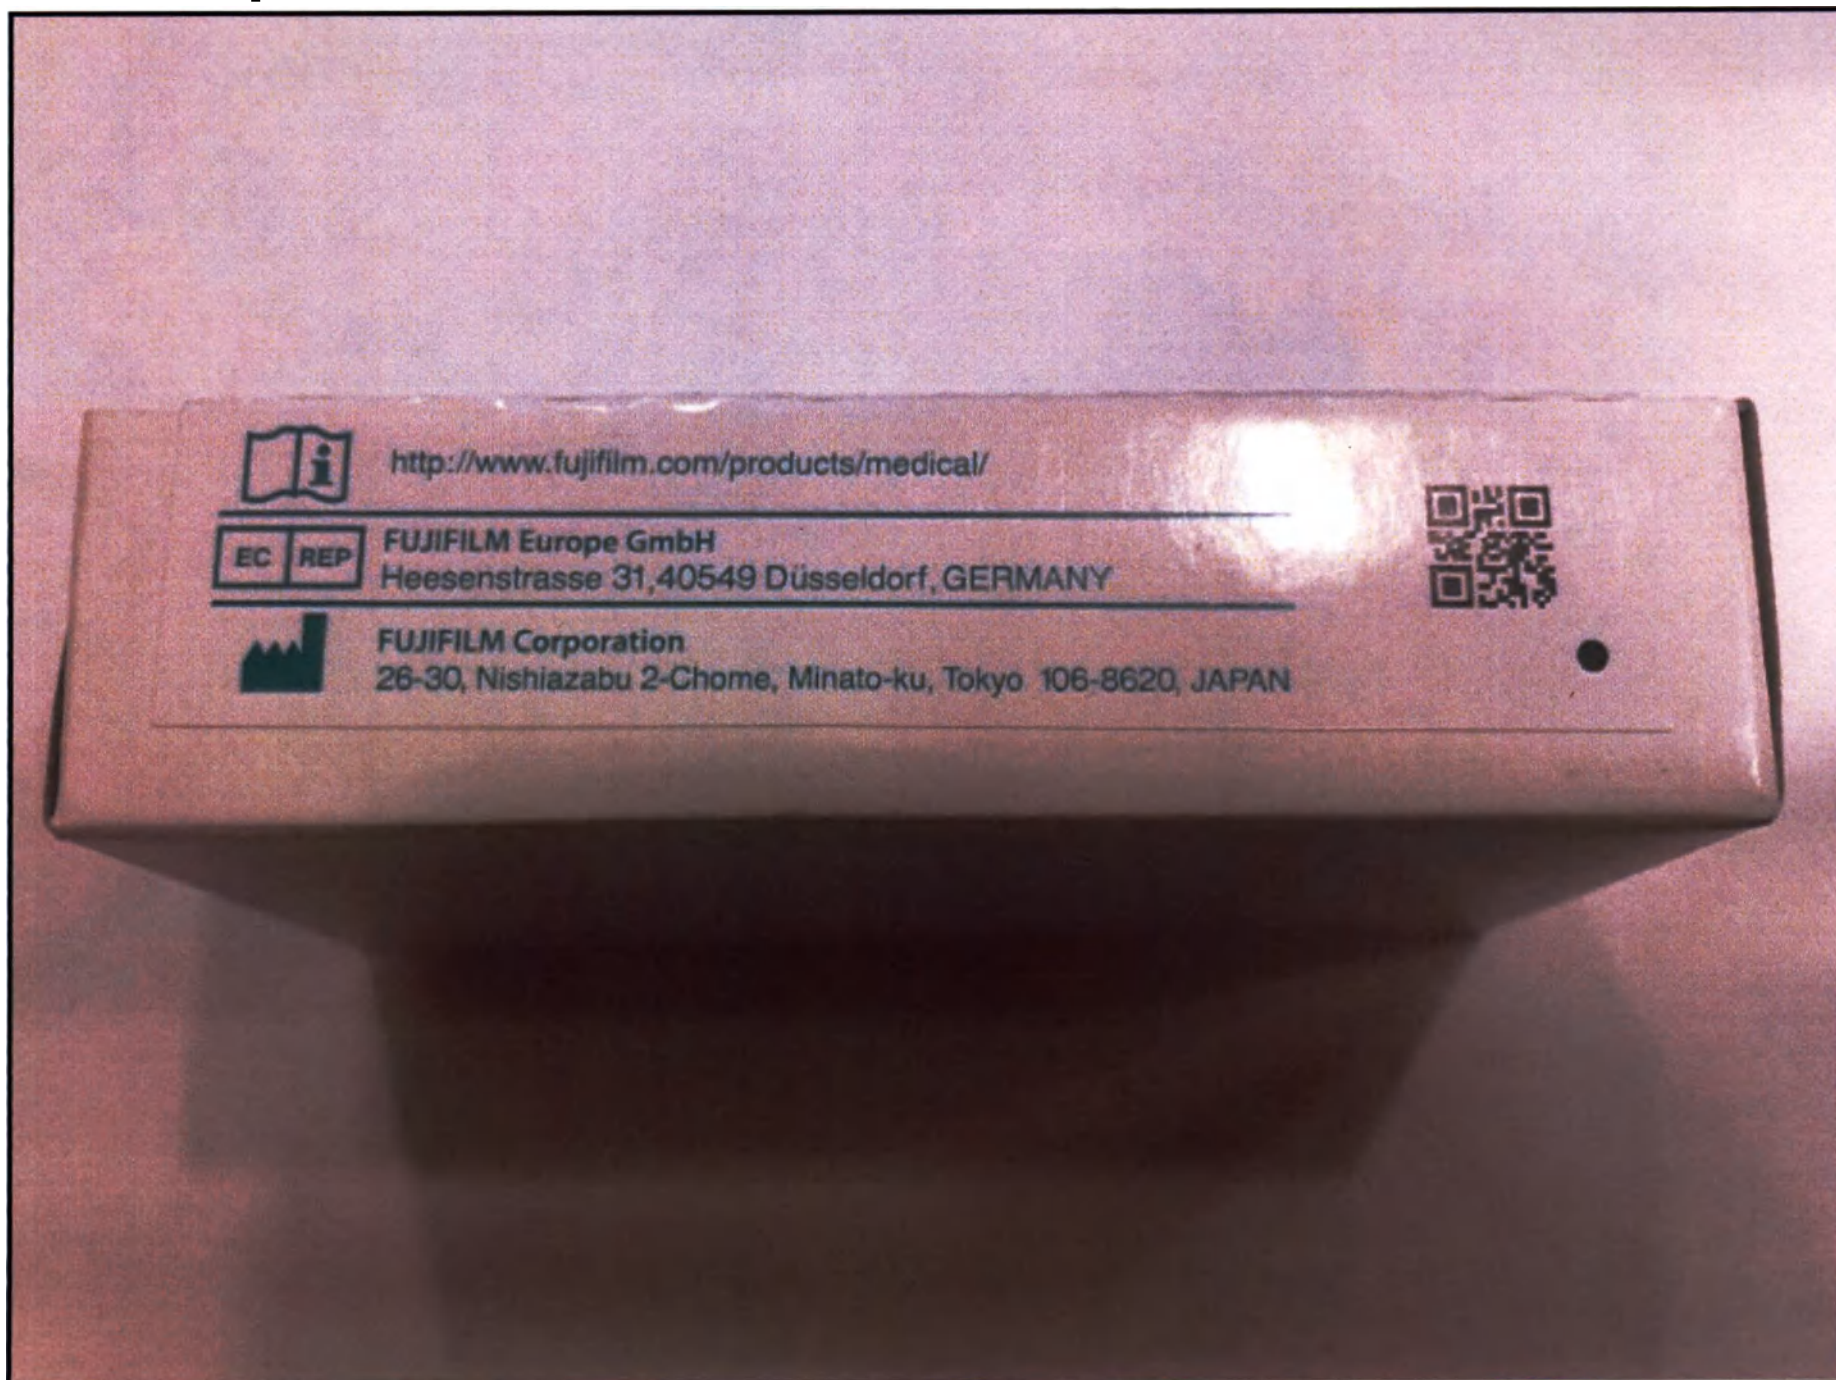

22. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-P II



22. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-P II —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-P II - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809633

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

23. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-W II

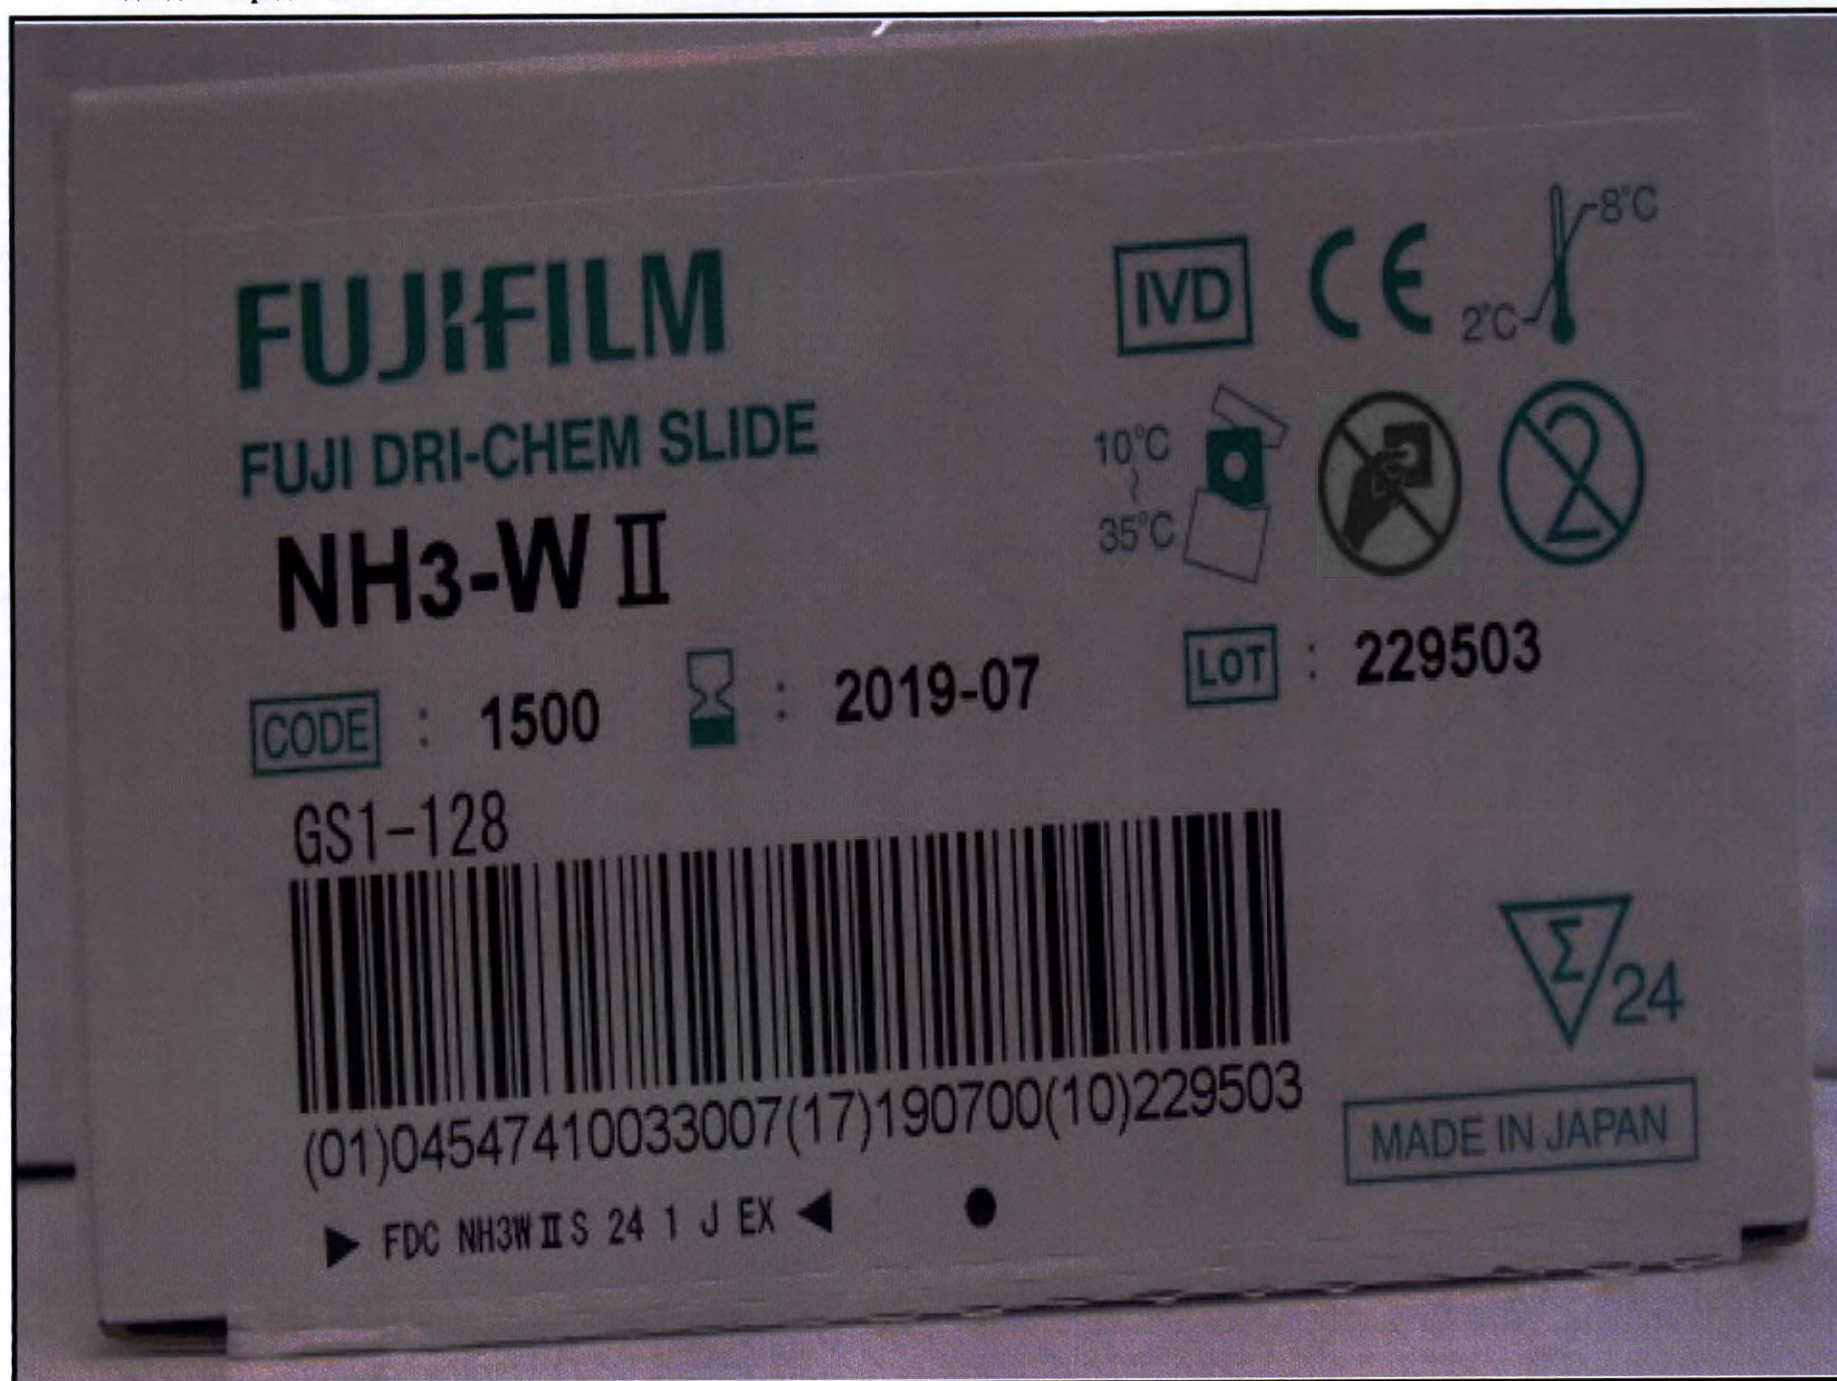

23. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-W II

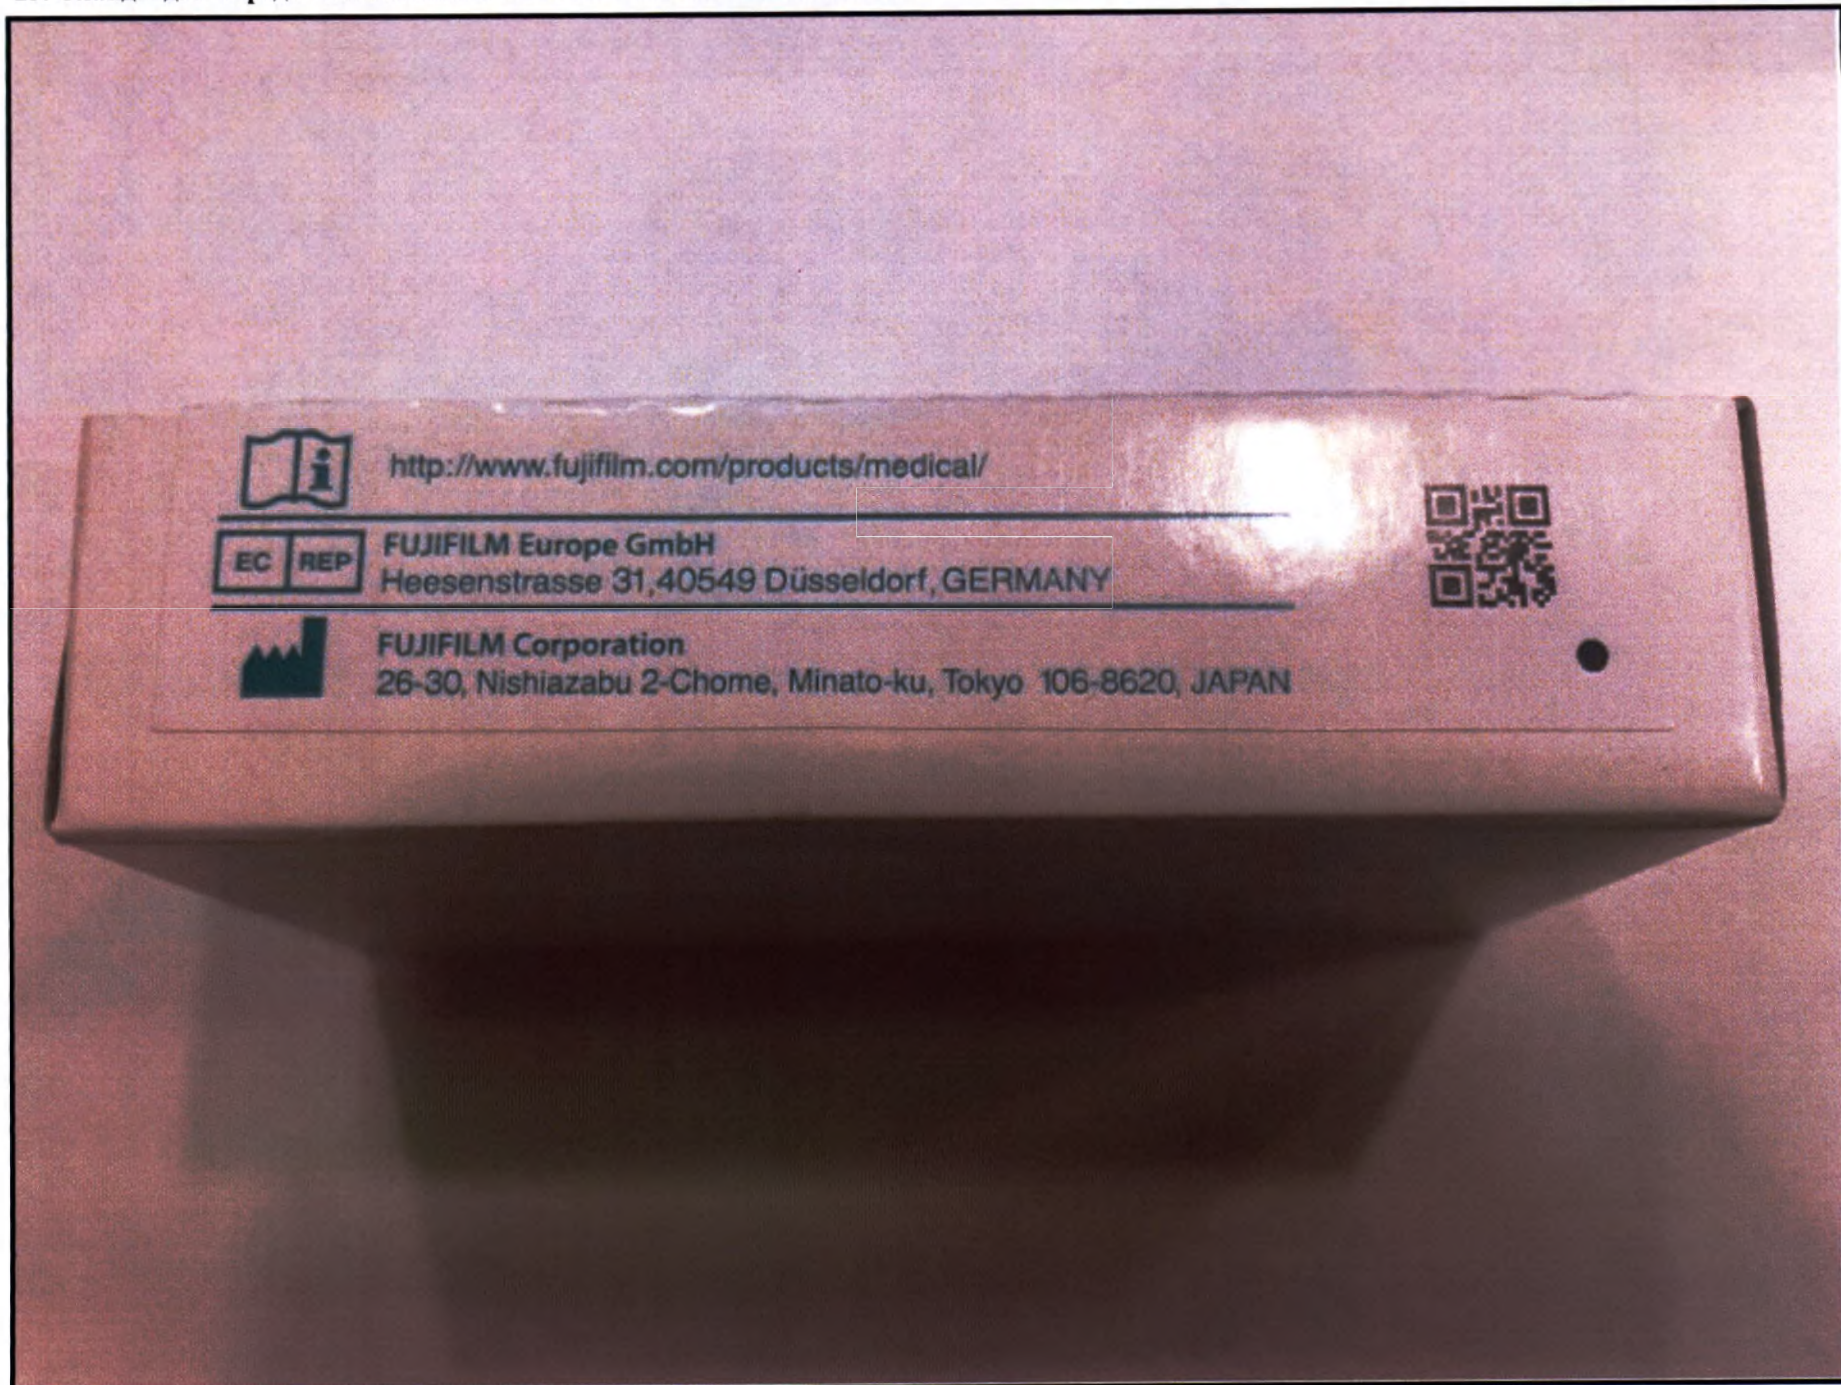

23. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-W II



23. Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-W II —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения аммиака FUJI DRI-CHEM SLIDE NH3-W II - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809845

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

24. Слайды для определения общего (непрямого) билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III

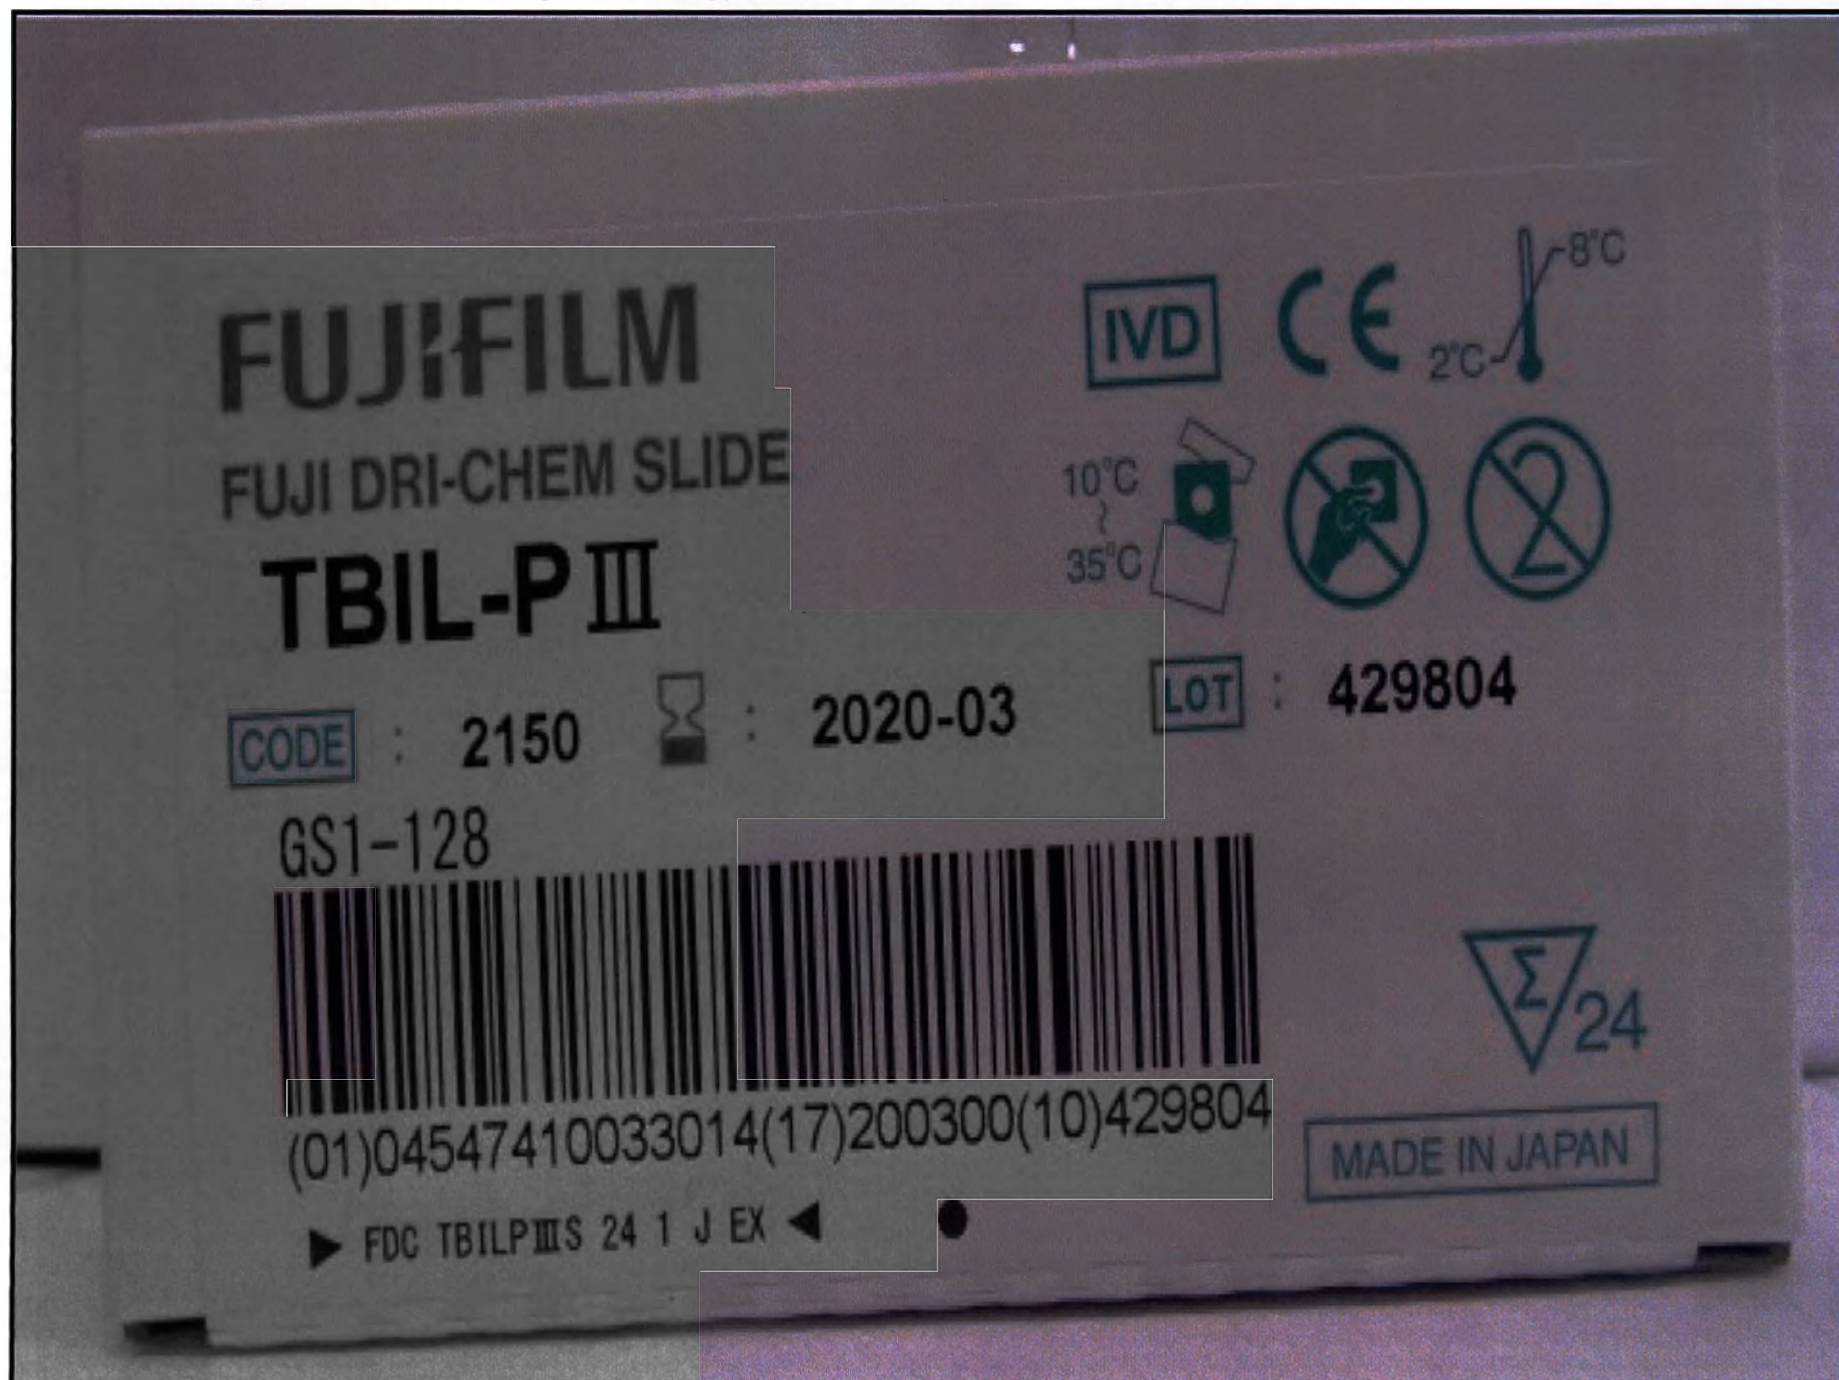

24. Слайды для определения общего (непрямого) билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III

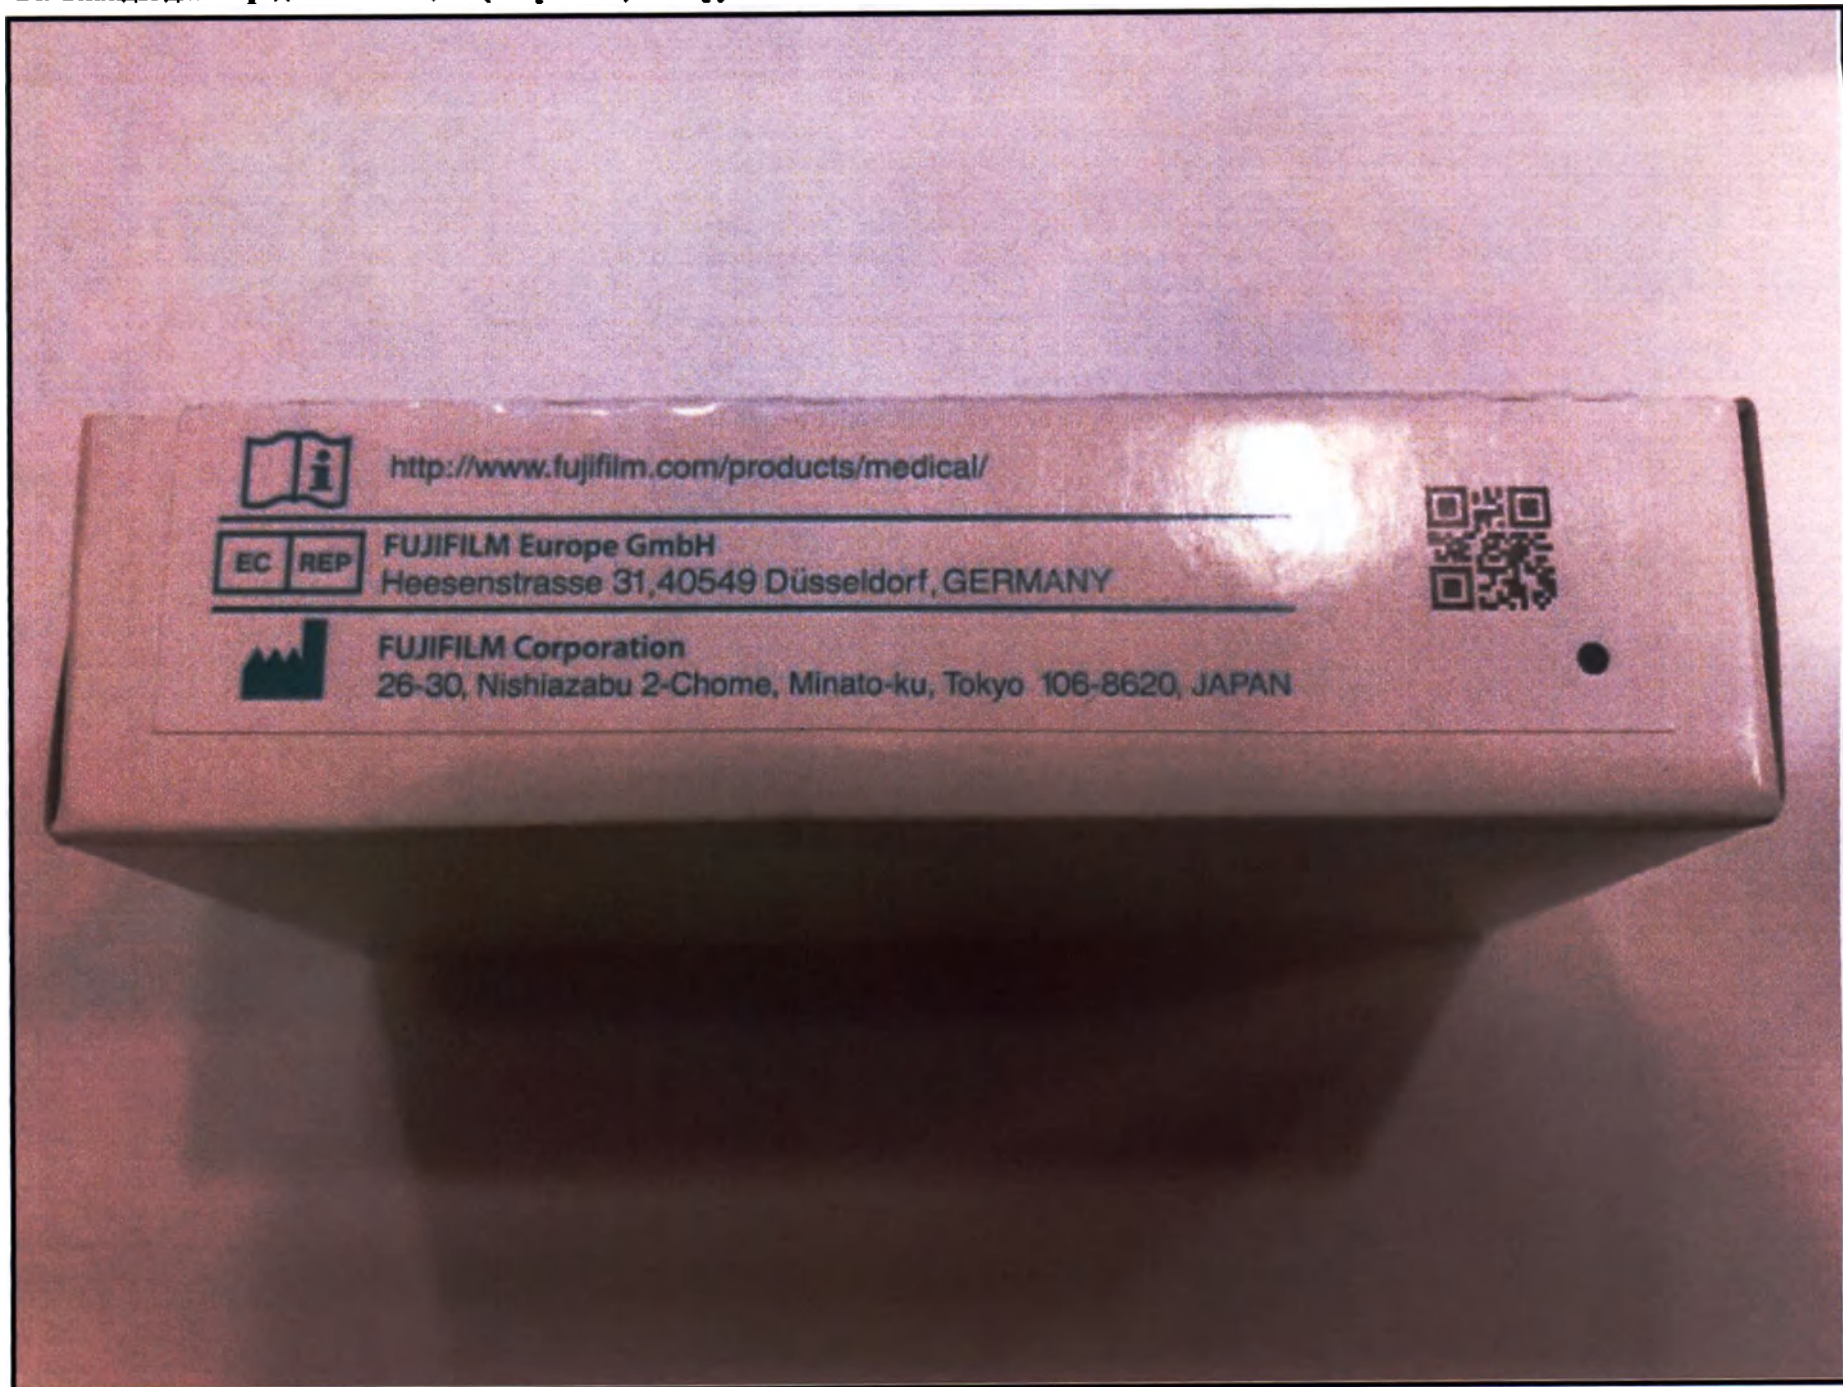

24. Слайды для определения общего (непрямого) билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III



24. Слайды для определения общего (непрямого) билирубина FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения общего (непрямого) билирубина
FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-P III - 24 шт./л уп.

Кат. № 15809657

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/08254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

25. Слайды для определения общего холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-P III

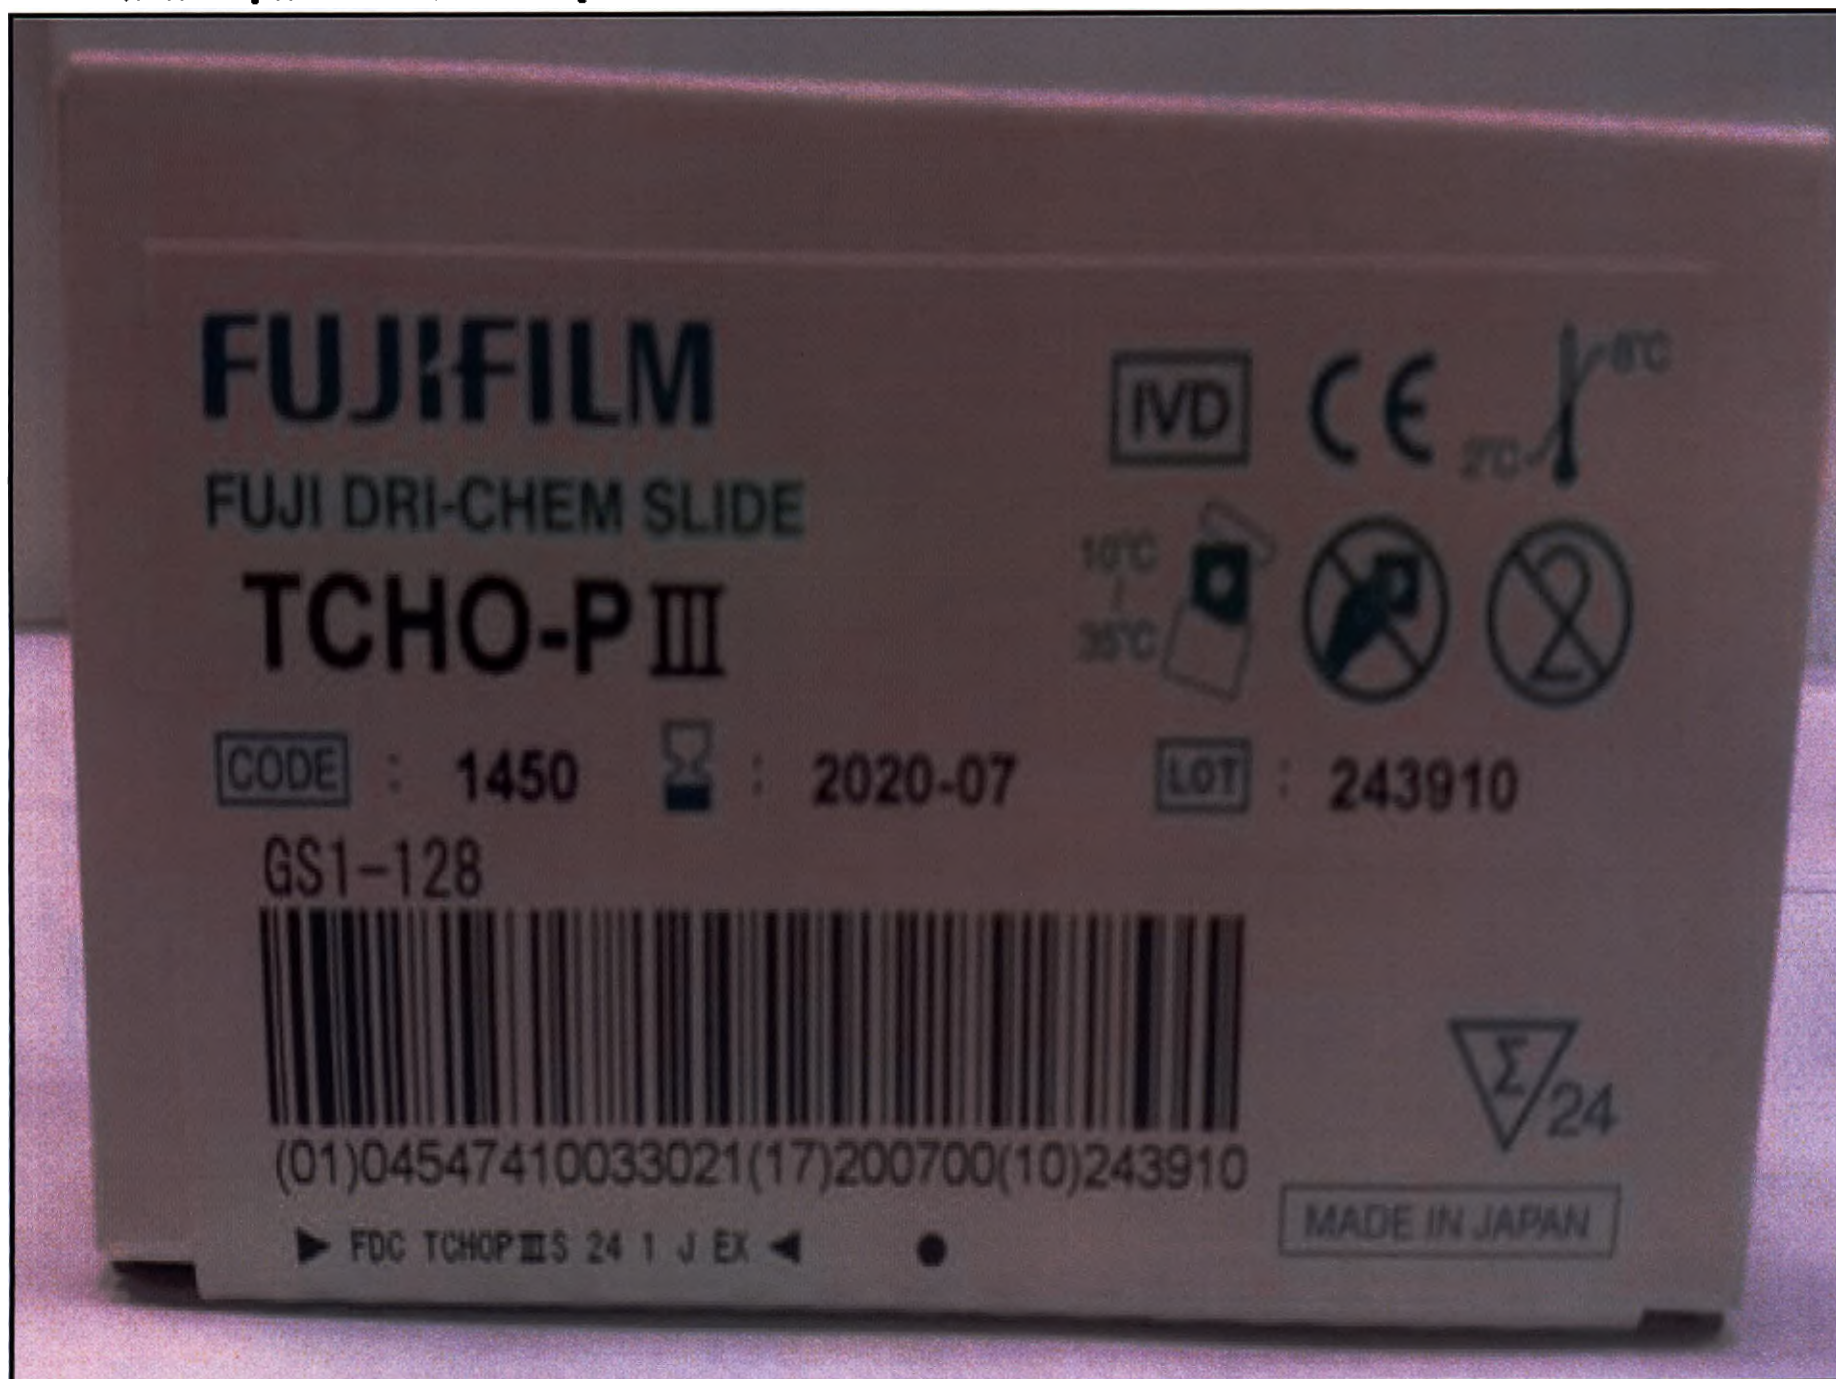

25. Слайды для определения общего холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-P III

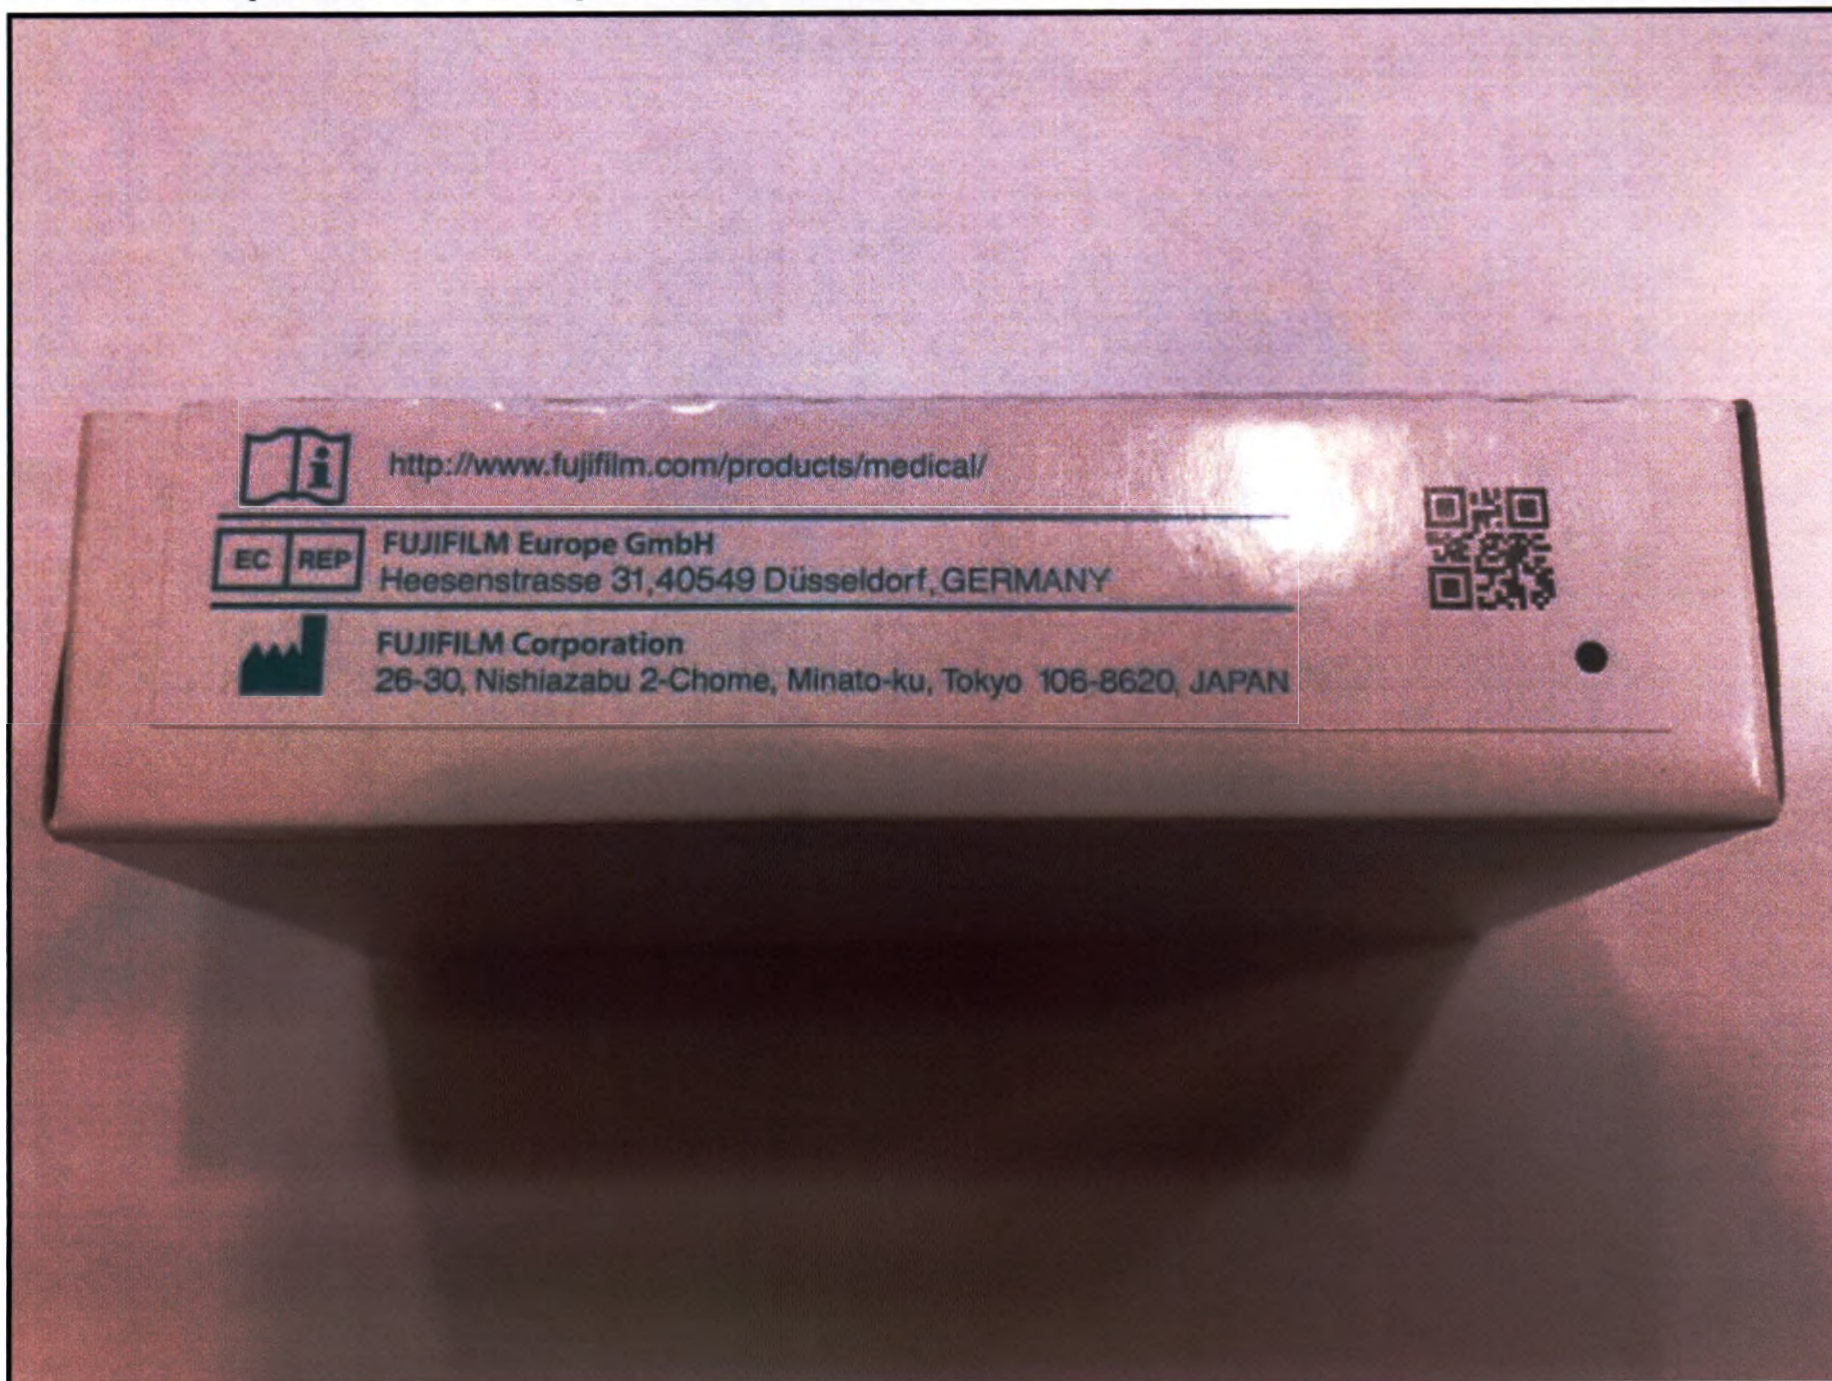

25. Слайды для определения общего холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-P III



25. Слайды для определения общего холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения общего холестерина FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-P III - 24 шт./л уп.

Кат. № 15809669

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

26. Слайды для определения триглицерида FUJI DRI-CHEM SLIDE TG-P III

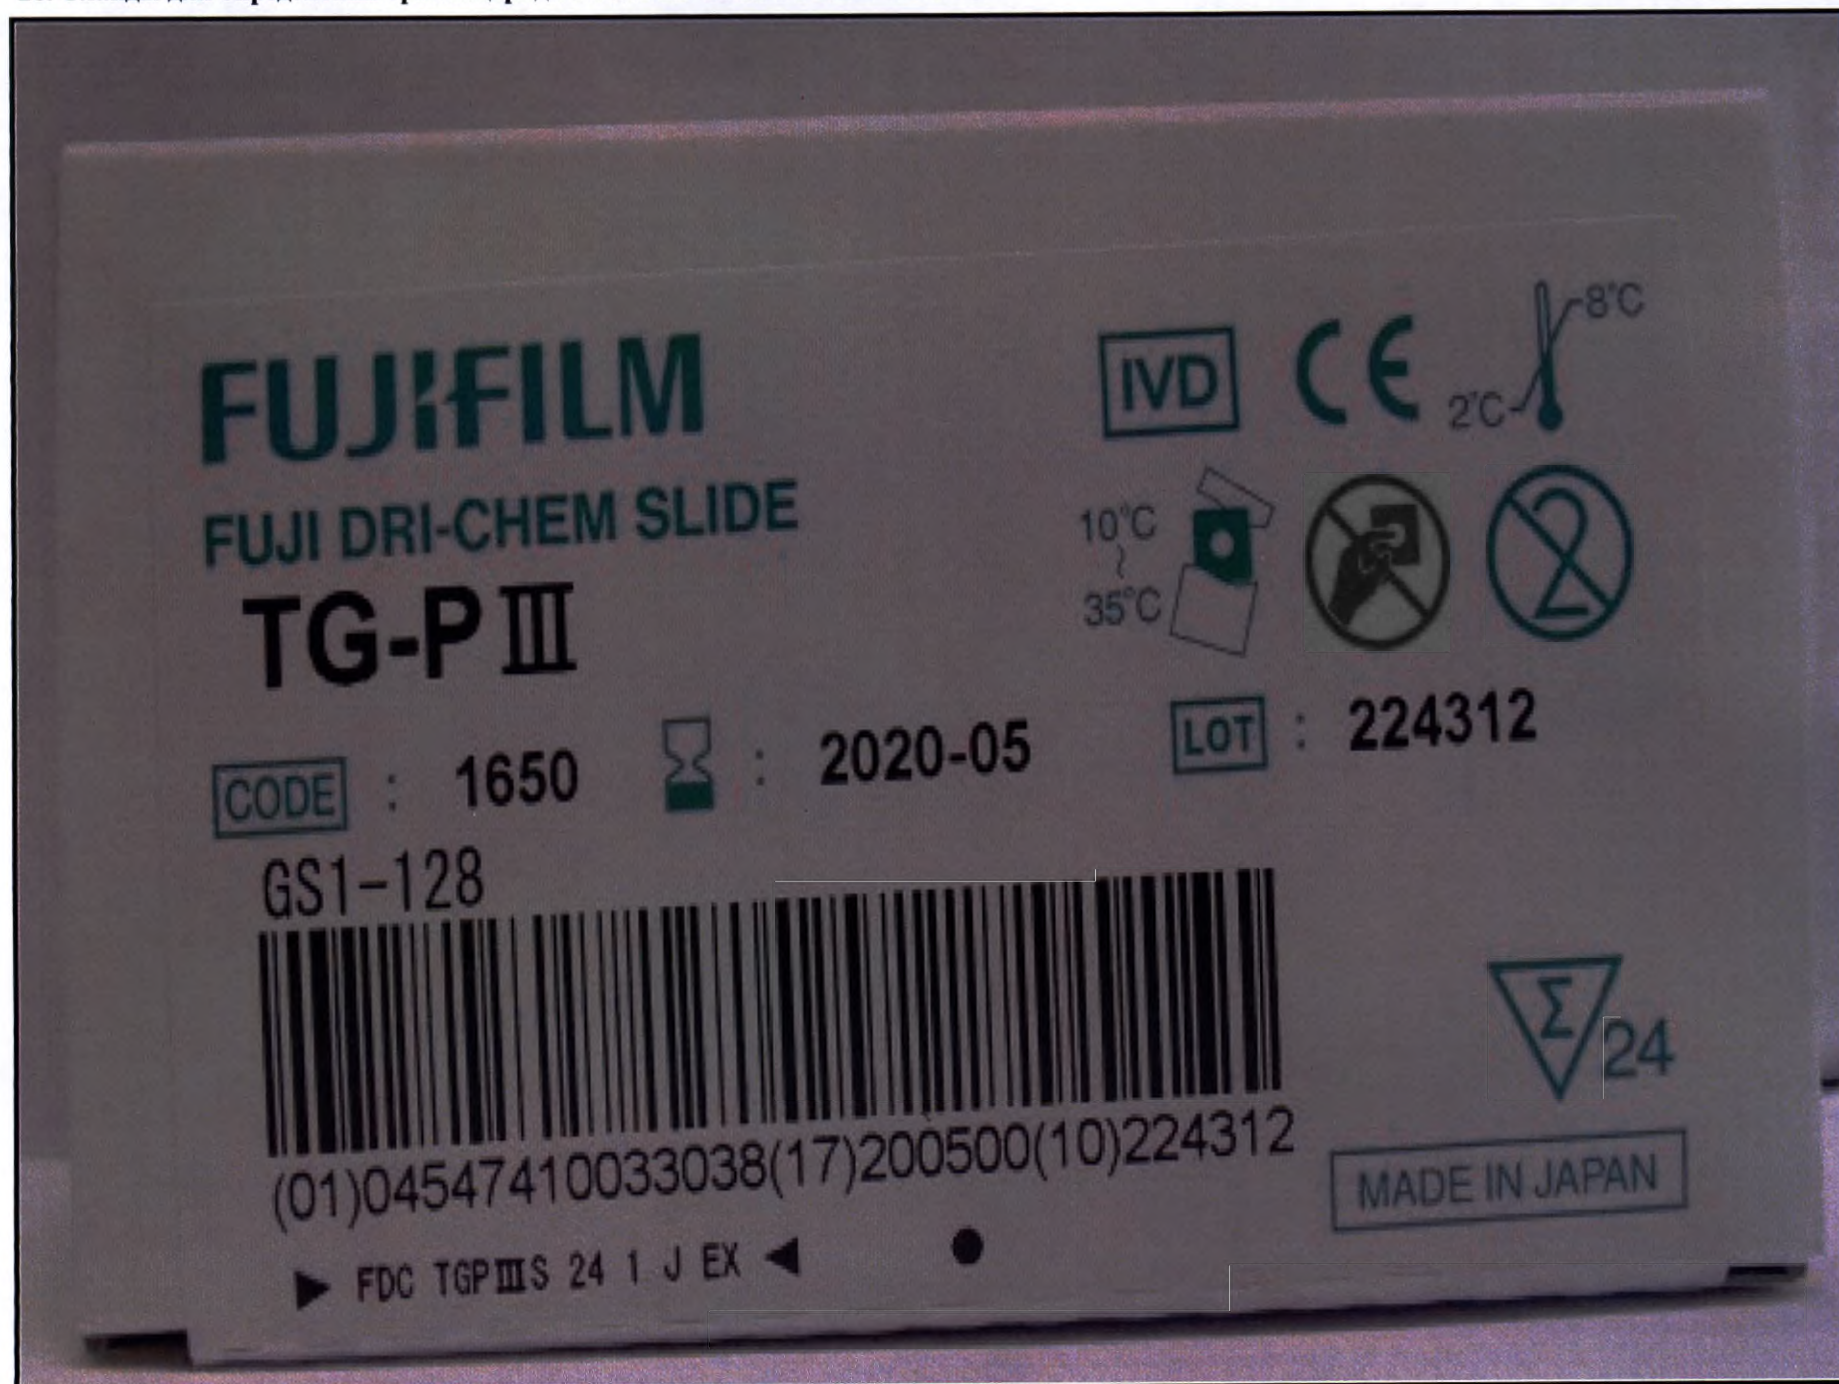

26. Слайды для определения триглицерида FUJI DRI-CHEM SLIDE TG-P III

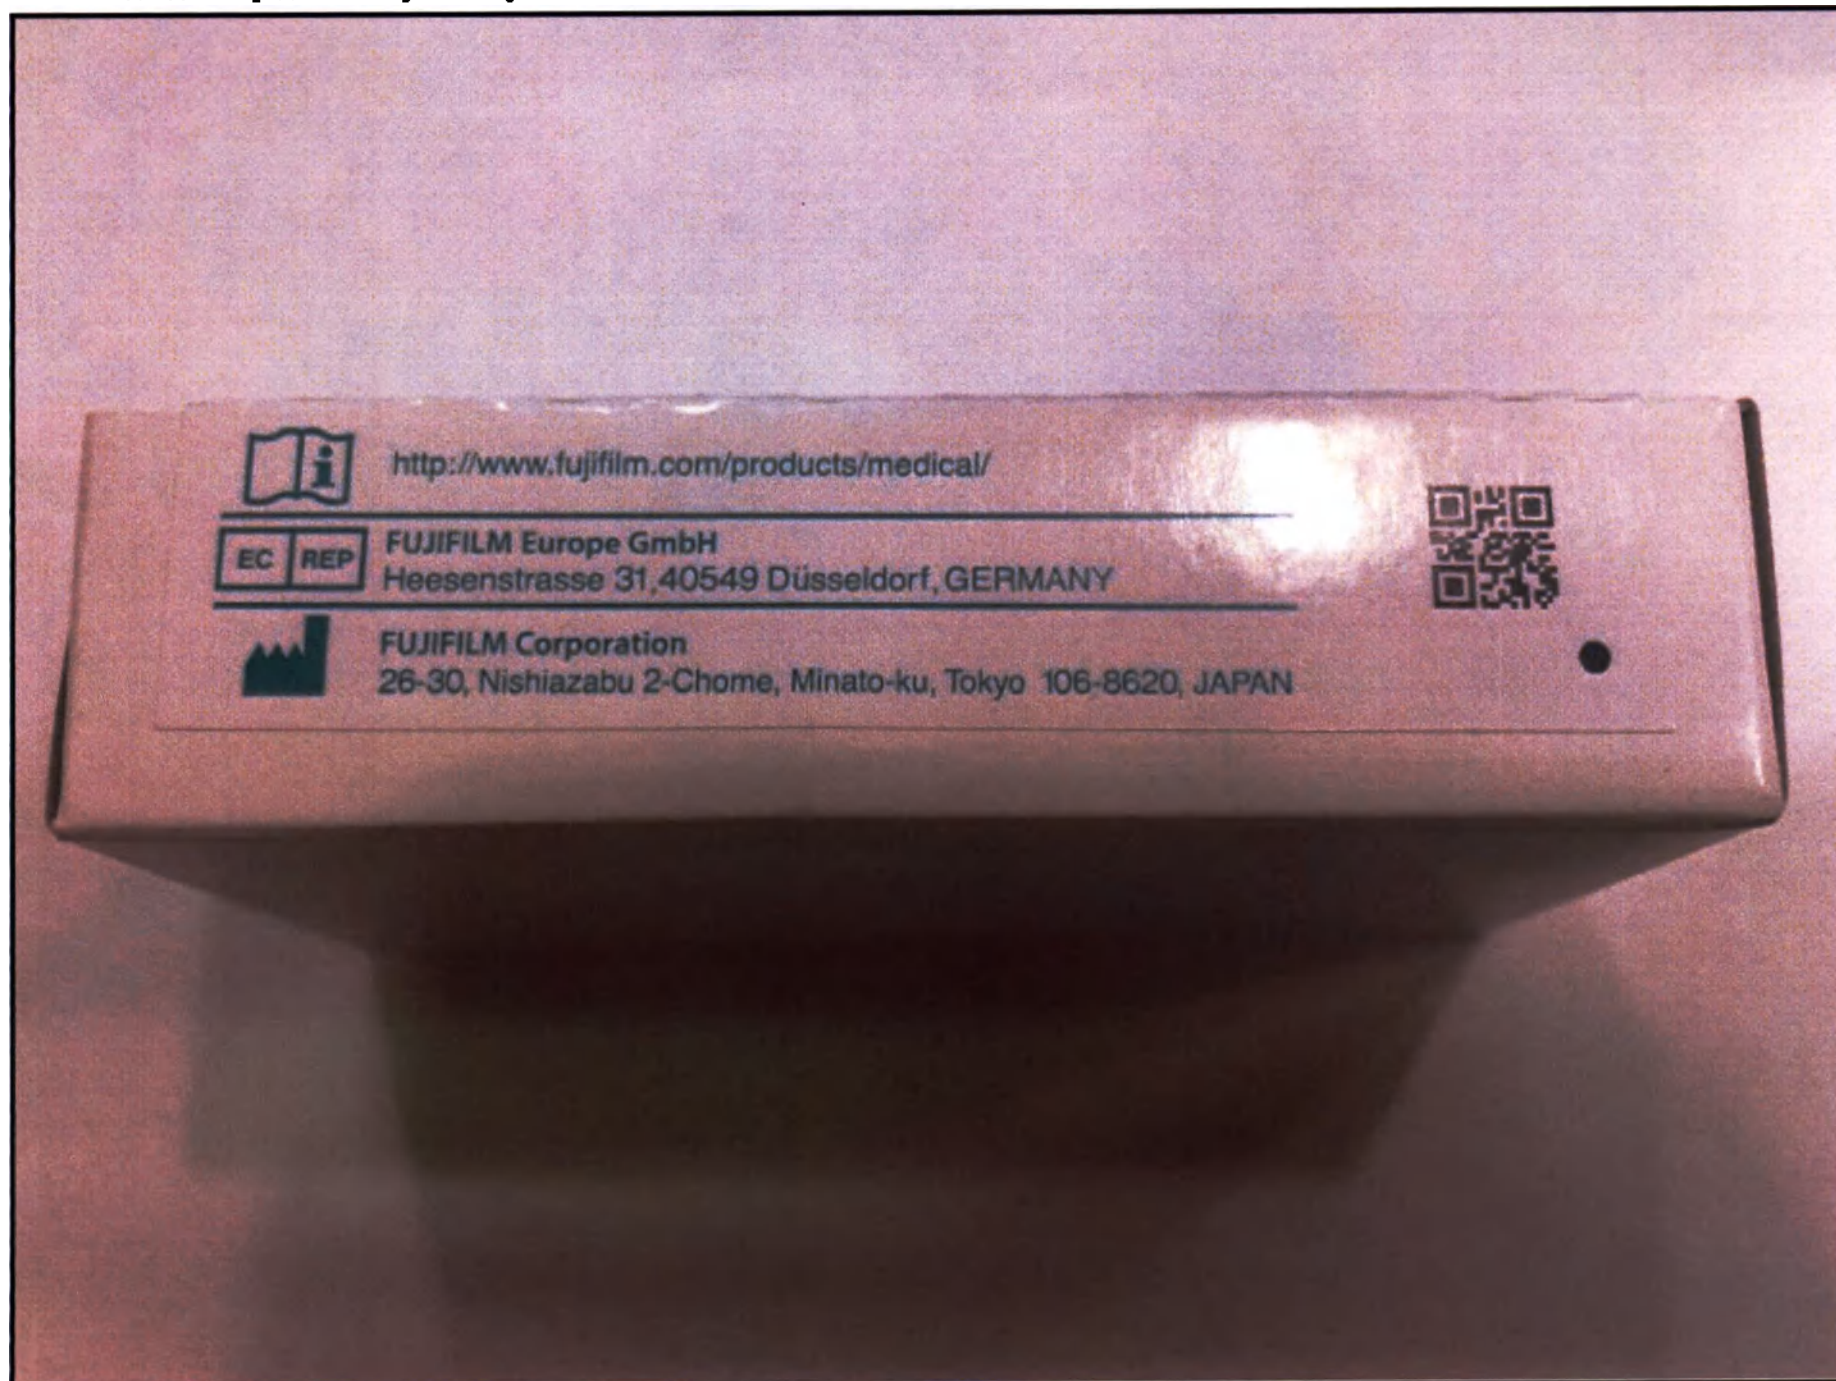

26. Слайды для определения триглицерида FUJI DRI-CHEM SLIDE TG-P III



26. Слайды для определения триглицерида FUJI DRI-CHEM SLIDE TG-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения триглицерида FUJI DRI-CHEM
SLIDE TG-P III - 24 шт./л уп.

Кат. № 15809671

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп.

1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

27. Слайды для определения общего белка FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-P III



27. Слайды для определения общего белка FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-P III

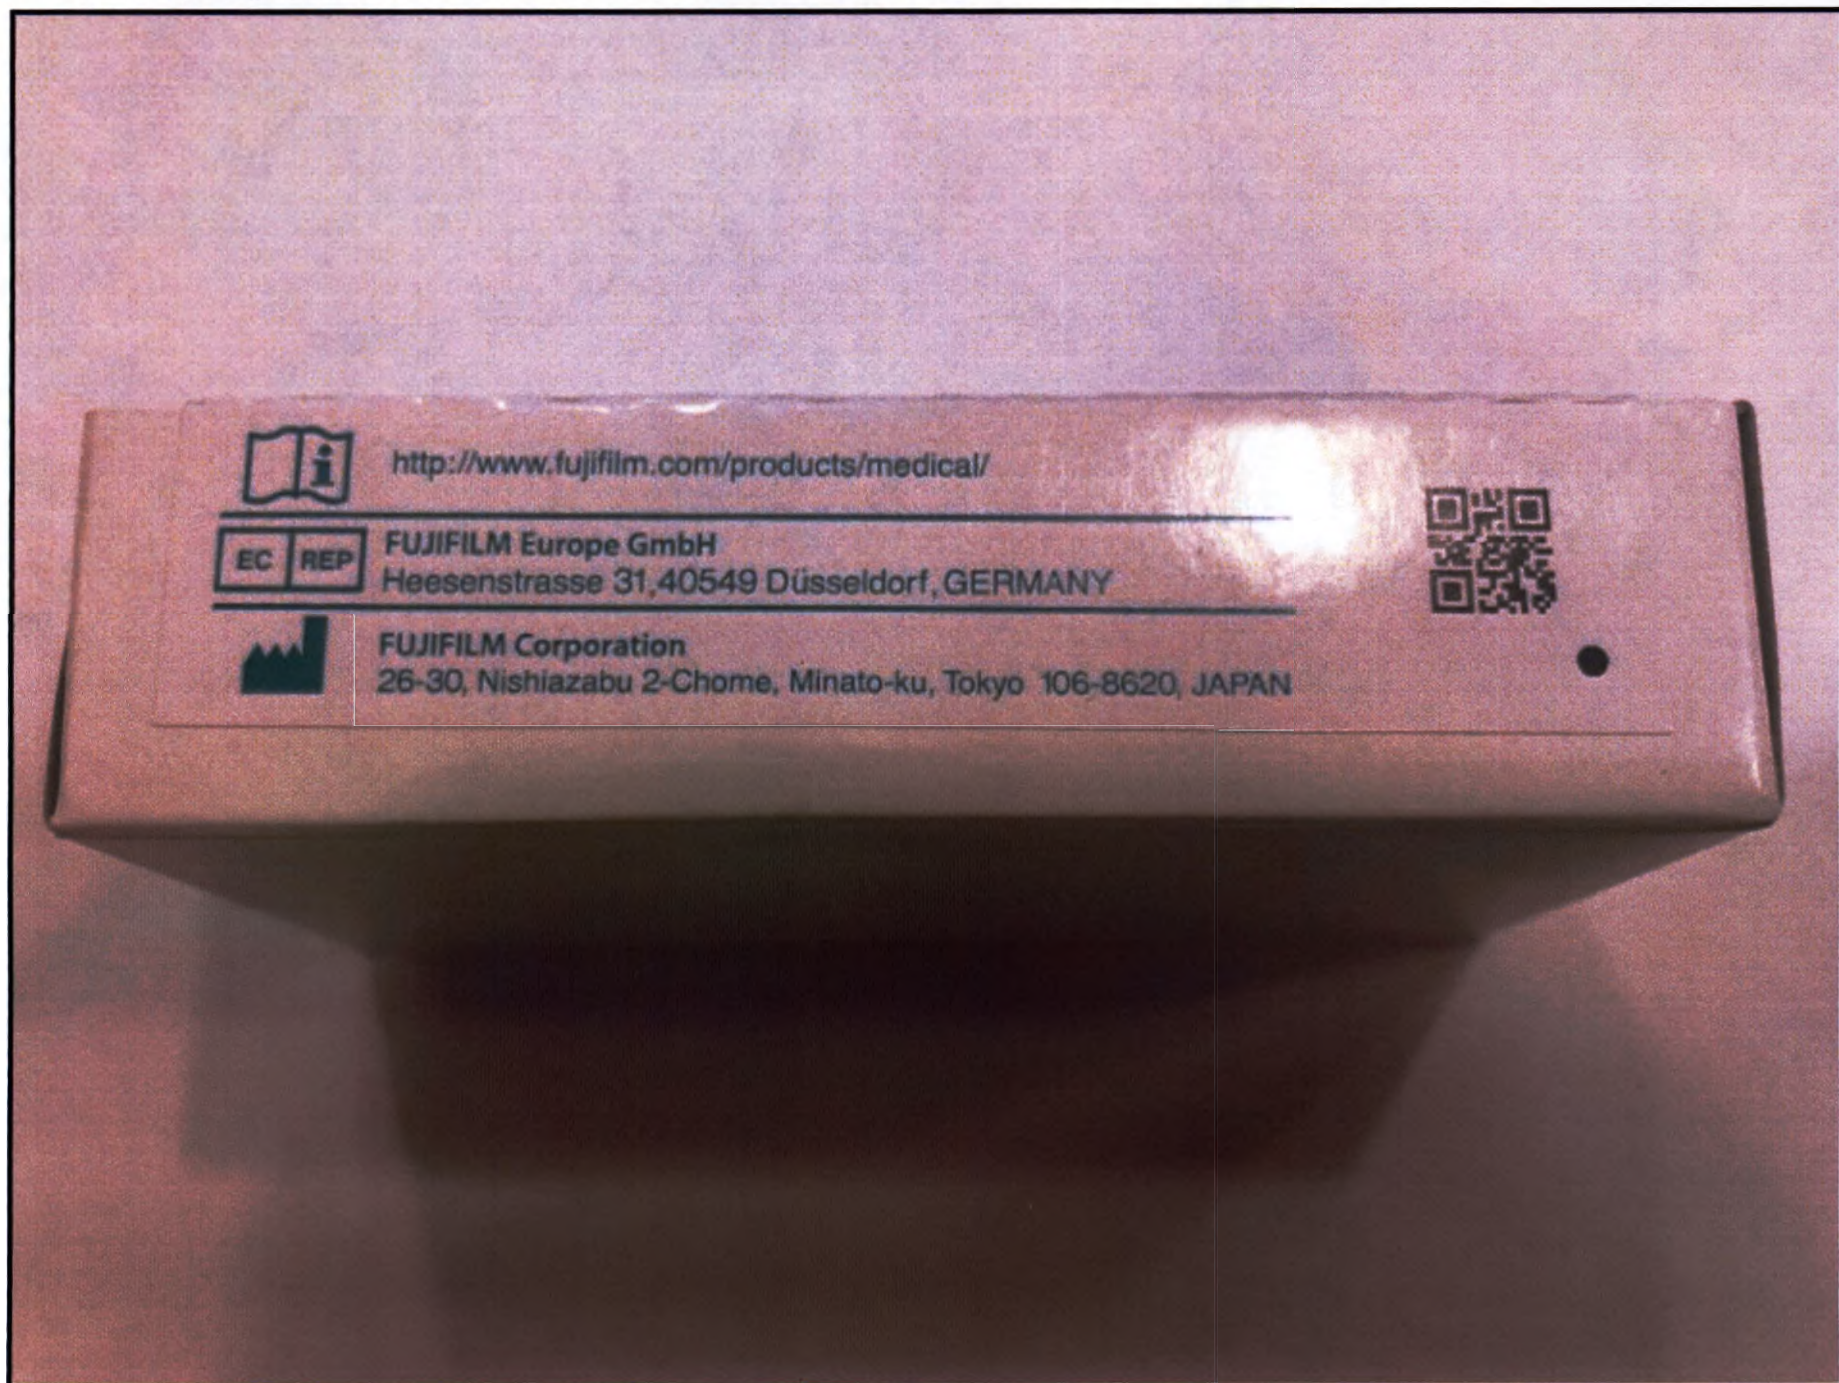

27. Слайды для определения общего белка FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-P III



27. Слайды для определения общего белка FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения общего белка FUJI DRI-CHEM
SLIDE TP-P III - 24 шт./1 уп.

Кат. № 15809683

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937


info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

28. Слайды для определения мочевой кислоты FUJI DRI-CHEM SLIDE UA-P III

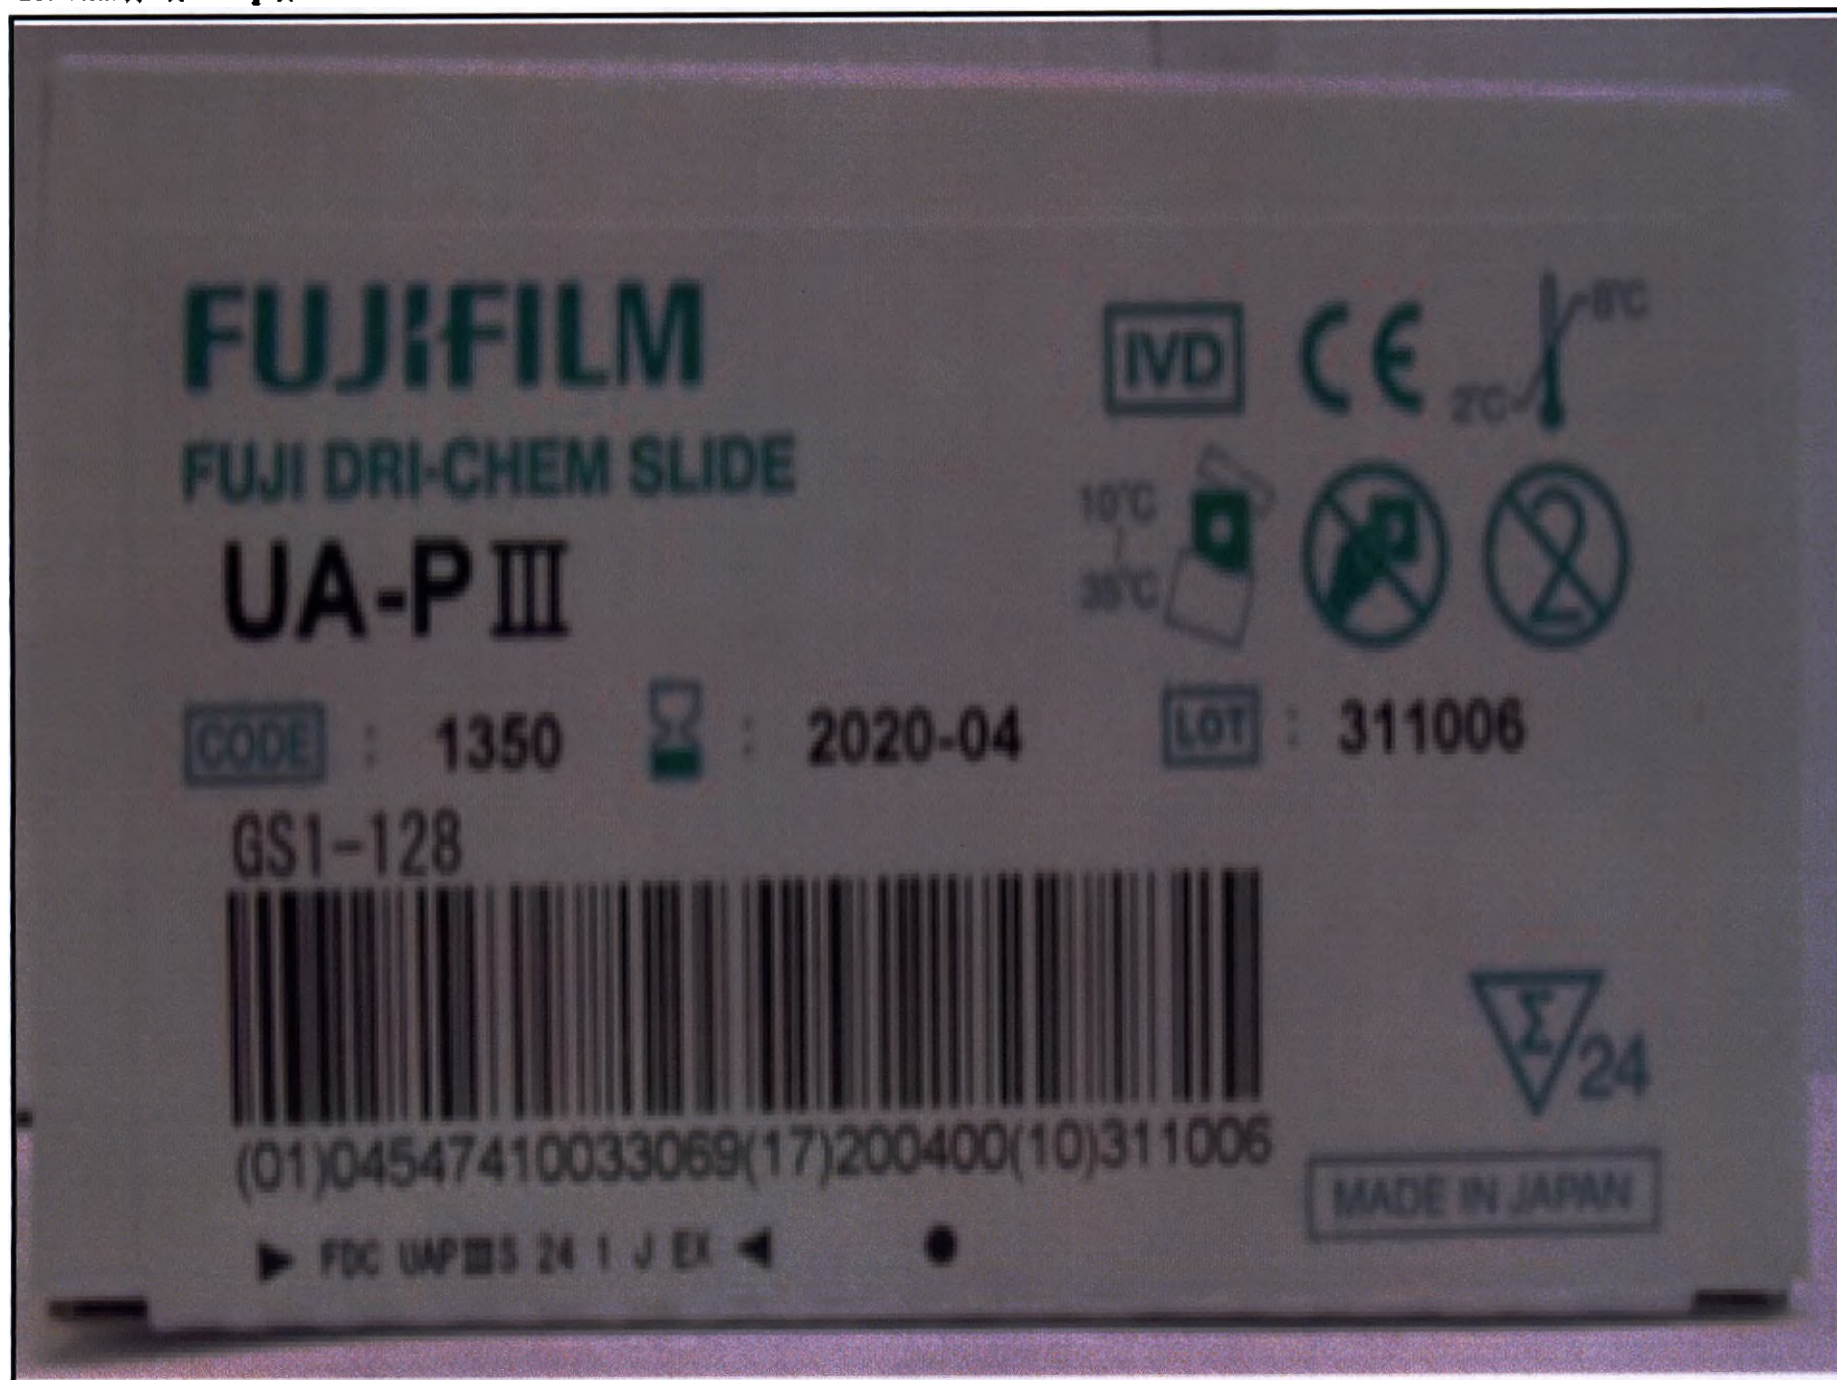

28. Слайды для определения мочевой кислоты FUJI DRI-CHEM SLIDE UA-P III

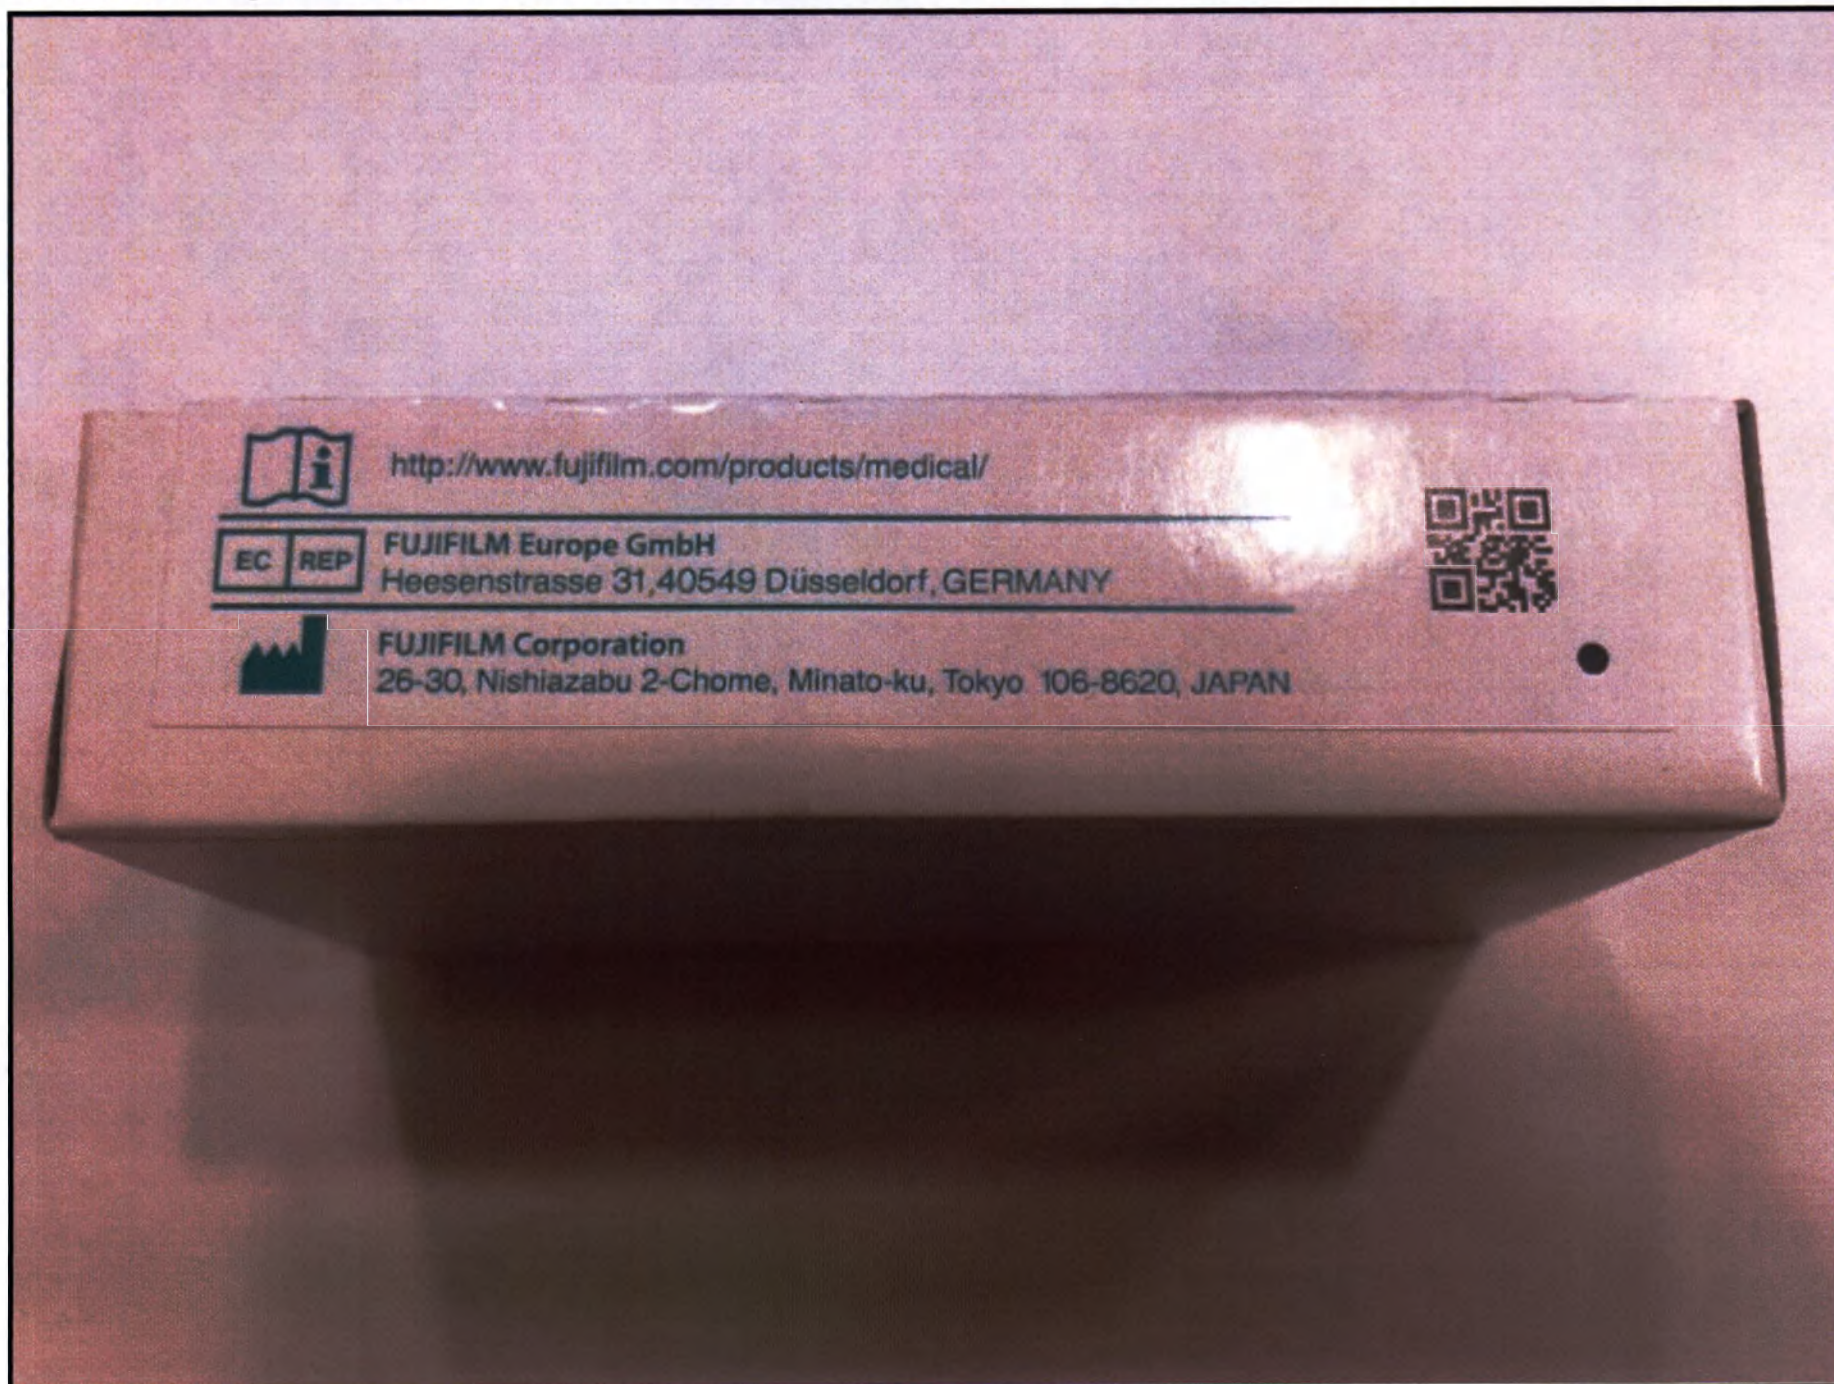

28. Слайды для определения мочевой кислоты FUJI DRI-CHEM SLIDE UA-P III



28. Слайды для определения мочевой кислоты FUJI DRI-CHEM SLIDE UA-P III —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Слайды для определения мочевой кислоты FUJI DRI-CHEM
SLIDE UA-P III - 24 шт./л уп

Кат. № 15808700

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,
Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп.
1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

**Контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора
биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM**

1. Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H



1. Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H—макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H- 3 мл/6 фл./1 уп.

Кат. № 15622384

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

2. Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L



2. Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QP- L - 3 мл/6 фл./1 уп.

Кат. № 15622396

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 26.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

3. Контроль FUJI DRI-CHEM ELECTROLYTE CONTROL QE

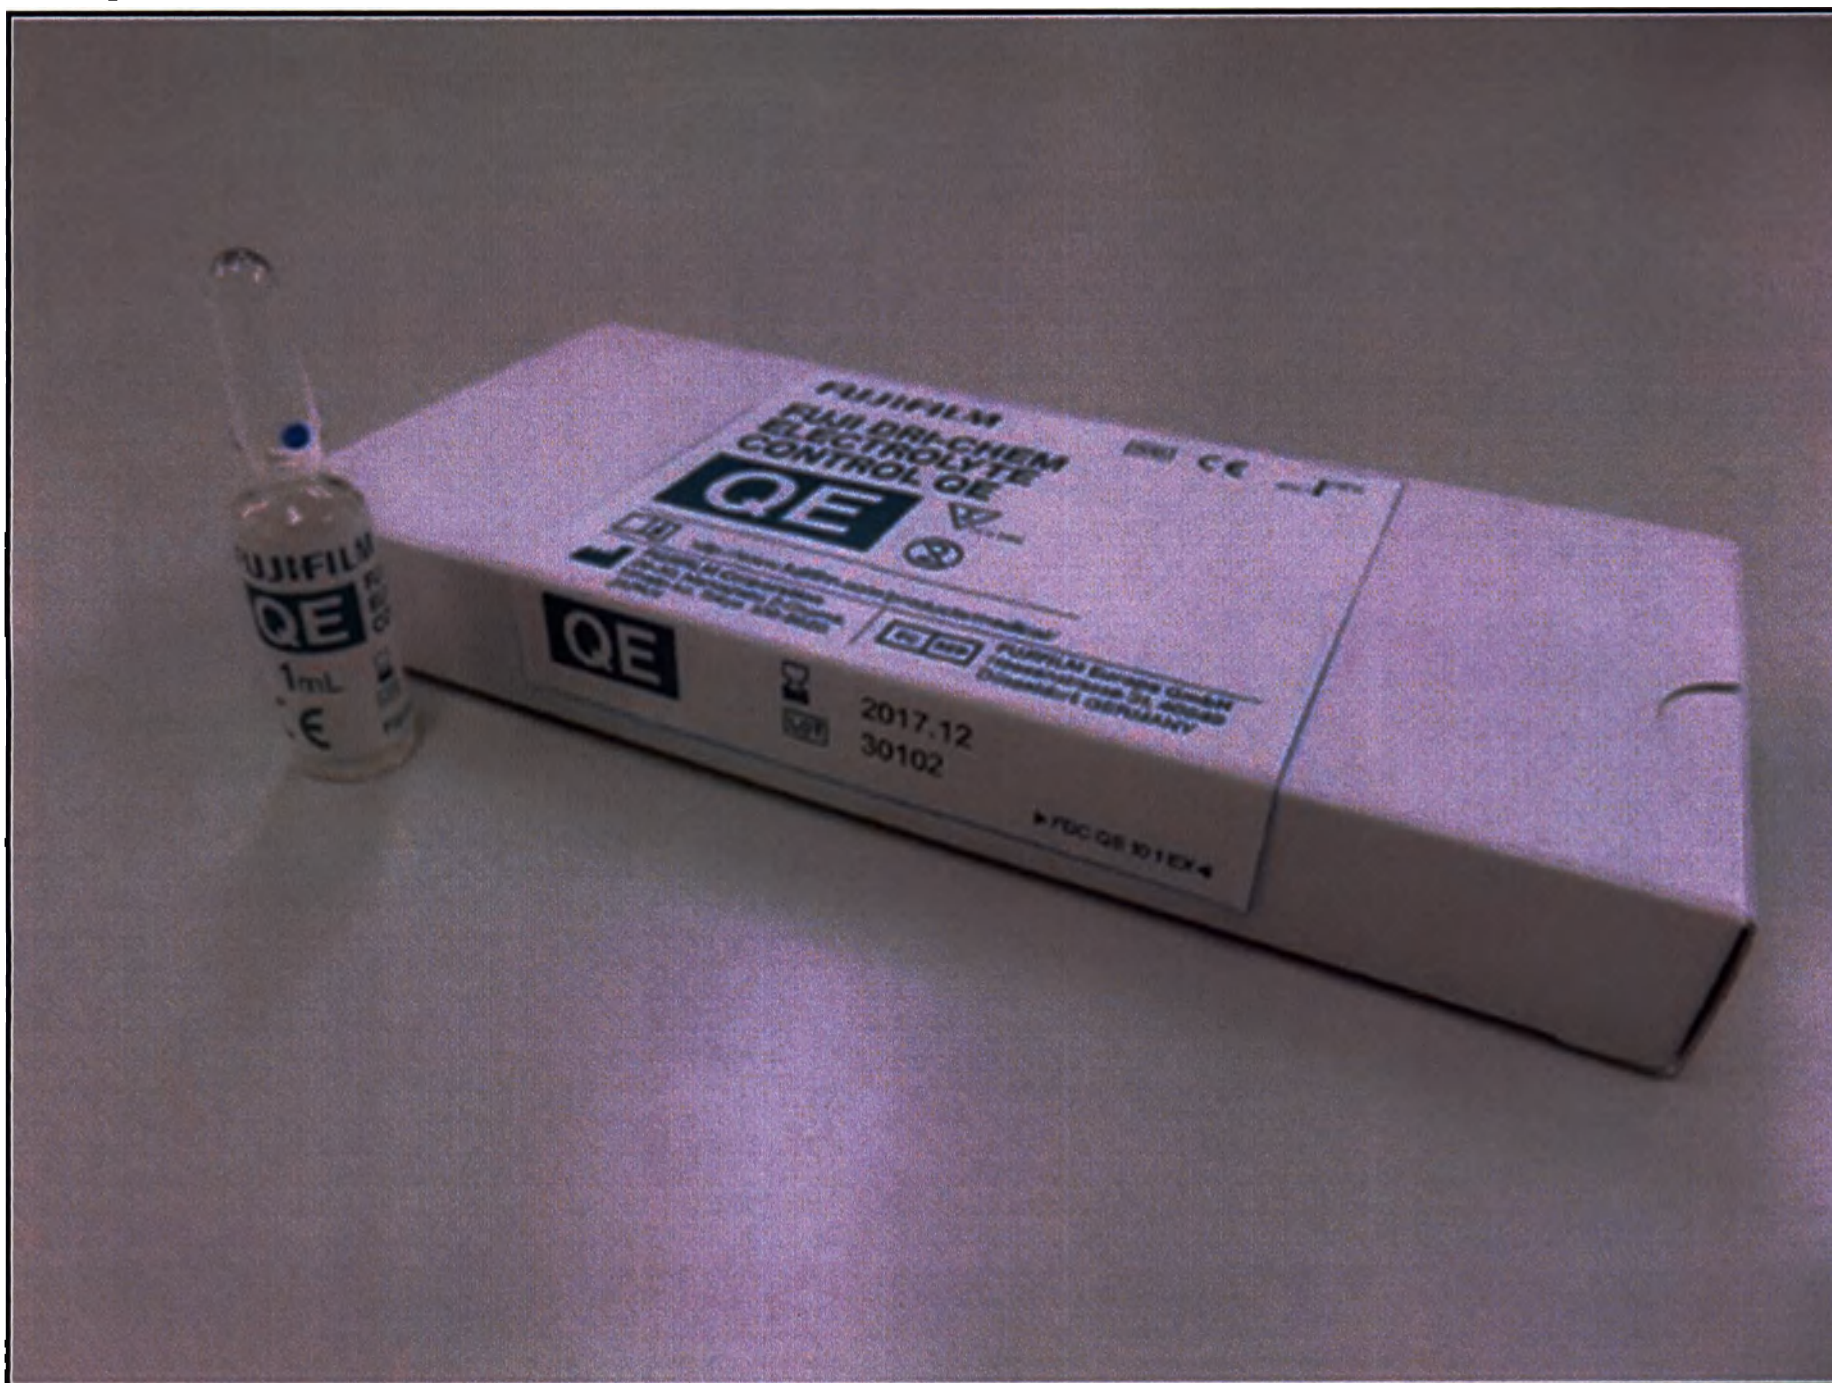

3. Контроль FUJI DRI-CHEM ELECTROLYTE CONTROL QE —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Контроль FUJI DRI-CHEM ELECTROLYTE CONTROL QE - 1
мл/10 амп./1 уп.

Кат. № 15622437

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 25.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,

Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

4. Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QN



4. Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QN —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QN - 3 мл/2 фл./1 уп.

Кат. № 15622425

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09284 от 26.01.2019г

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,
Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Барзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

5. Разбавитель FUJI DRI-CHEM Diluent DL(CRP)

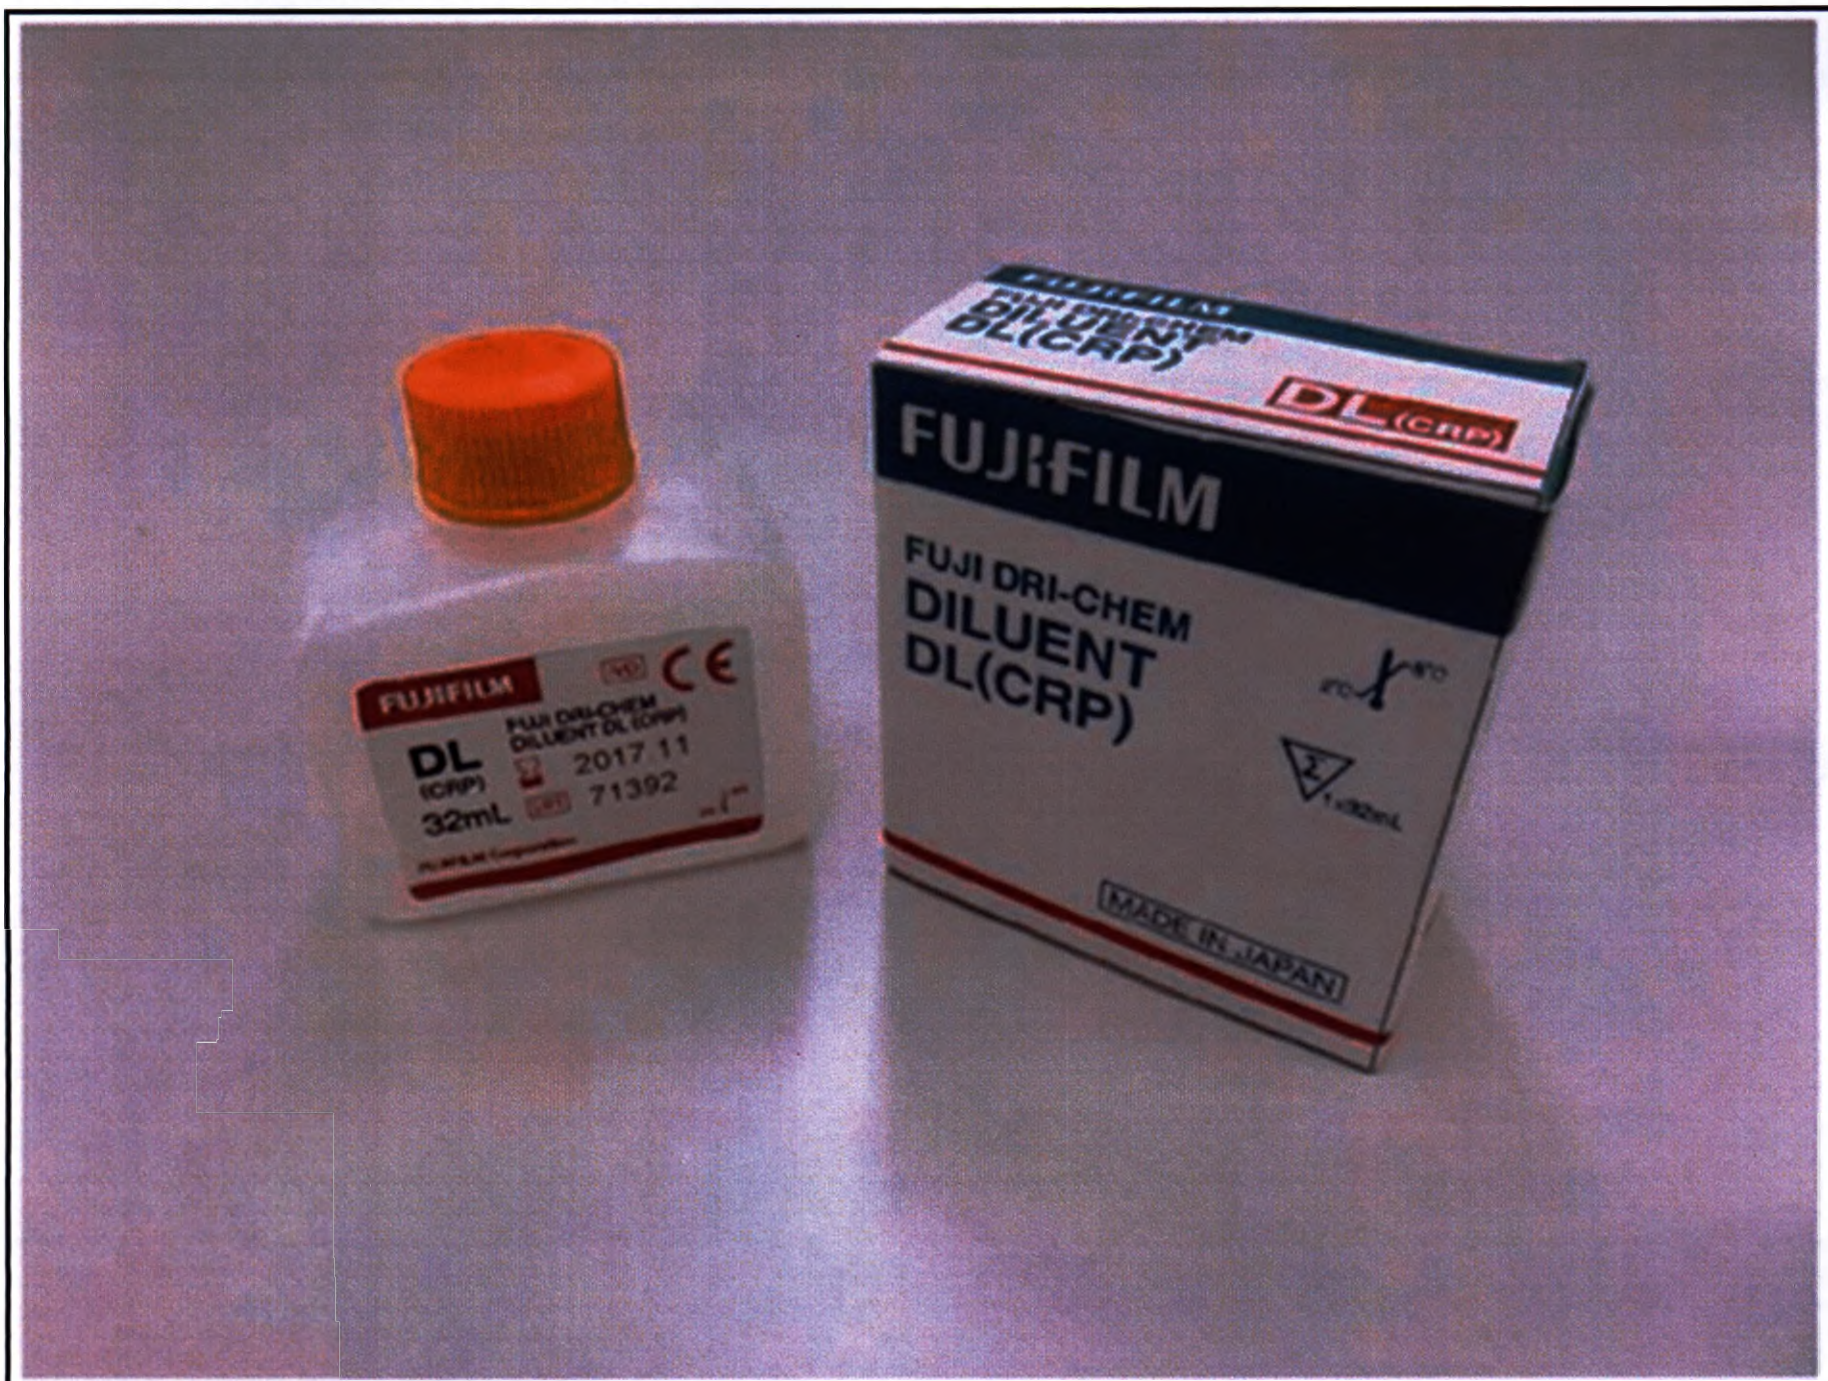

5. Разбавитель FUJI DRI-CHEM Diluent DL(CRP) — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Разбавитель FUJI DRI-CHEM Diluent DL(CRP)- 32 мл/1 фл./1 уп.

Кат. № 15809748

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09254 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»


Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

6. Эталонный раствор FUJI DRI-CHEM REFERENCE FLUID RE

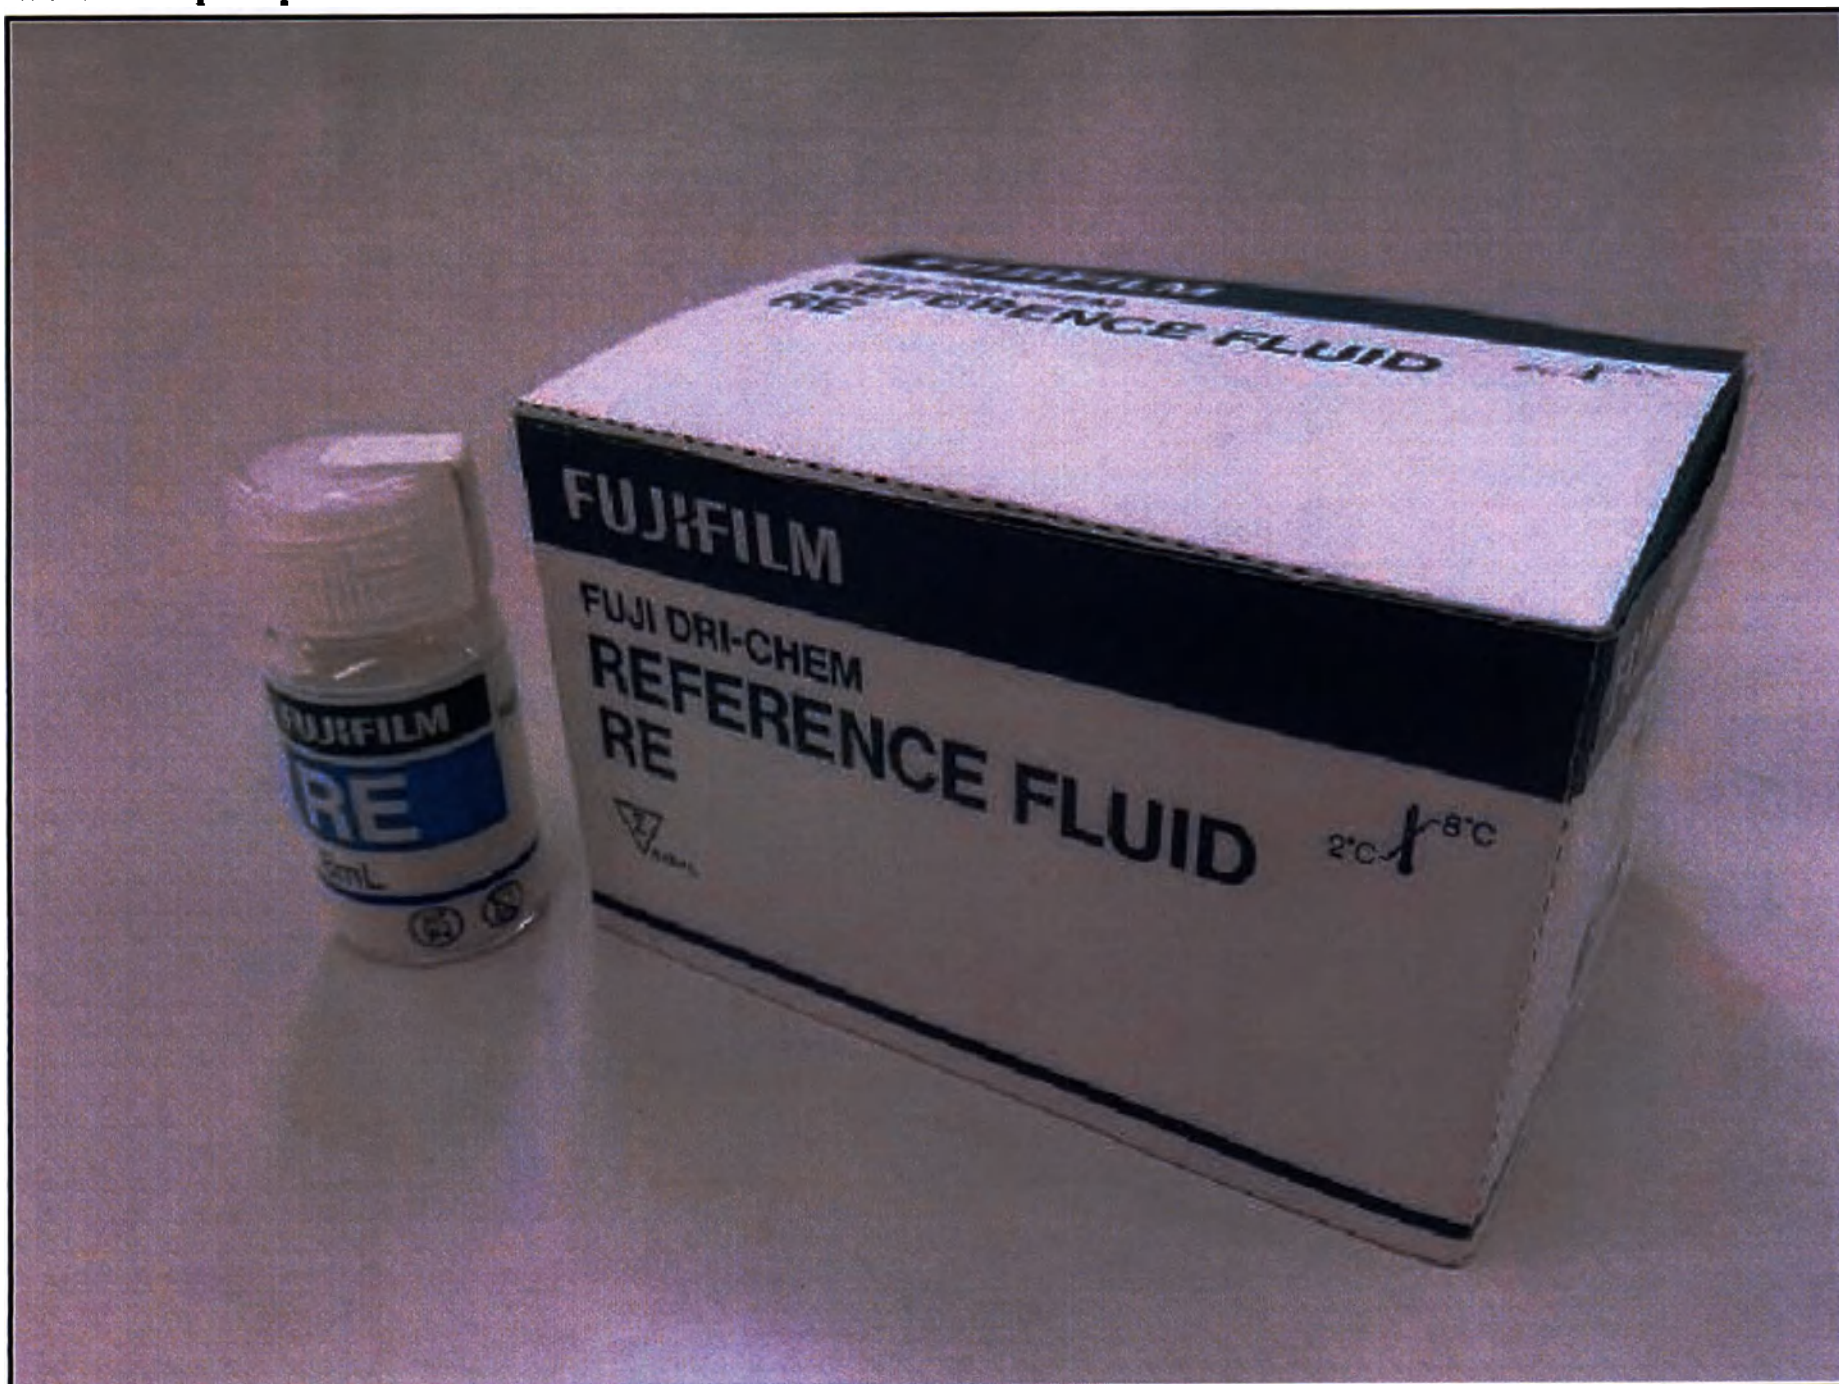

6. Эталонный раствор FUJI DRI-CHEM REFERENCE FLUID RE —макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Эталонный раствор FUJI DRI-CHEM REFERENCE FLUID RE
- 8 мл/ 6 фл./1 уп.

Кат. № 15809786

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 26.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku,
Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарины, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

7. Калибратор FUJI DRI-CHEM CALIBRATOR CP(CRP)



7. Калибратор FUJI DRI-CHEM CALIBRATOR CP(CRP) — макет маркировки

Слайды и контрольные материалы FUJI DRI-CHEM для анализатора биохимического автоматического FUJI DRI-CHEM

Калибратор FUJI DRI-CHEM CALIBRATOR CP(CRP) – 1 мл/3 шт./1 уп.

Кат. № 15994232

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2011/09264 от 25.01.2019г.

Условия хранения, номер партии и срок годности: см. на упаковке.

Только для диагностики ин витро.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель:

«ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония

FUJIFILM Corporation, 28-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Япония

Уполномоченный представитель производителя:

АО «Р-Фарм»

Адрес: Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19 корп. 1.

Телефон: (495) 9567937

info@rpharm.ru

www.r-pharm.com

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 130 листа(ов).

Короневский

В.И.

для
ментов

М.П.

21

ОСКВА