

Генеральный директор ООО «М.П.А. Медицинские партнеры»




УТВЕРЖДАЮ

Э.Б. Алексеев

2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Датчики ультразвуковые к системам ультразвуковым 1300, 2300»
BK Medical ApS (БК Медикал АпС), Дания

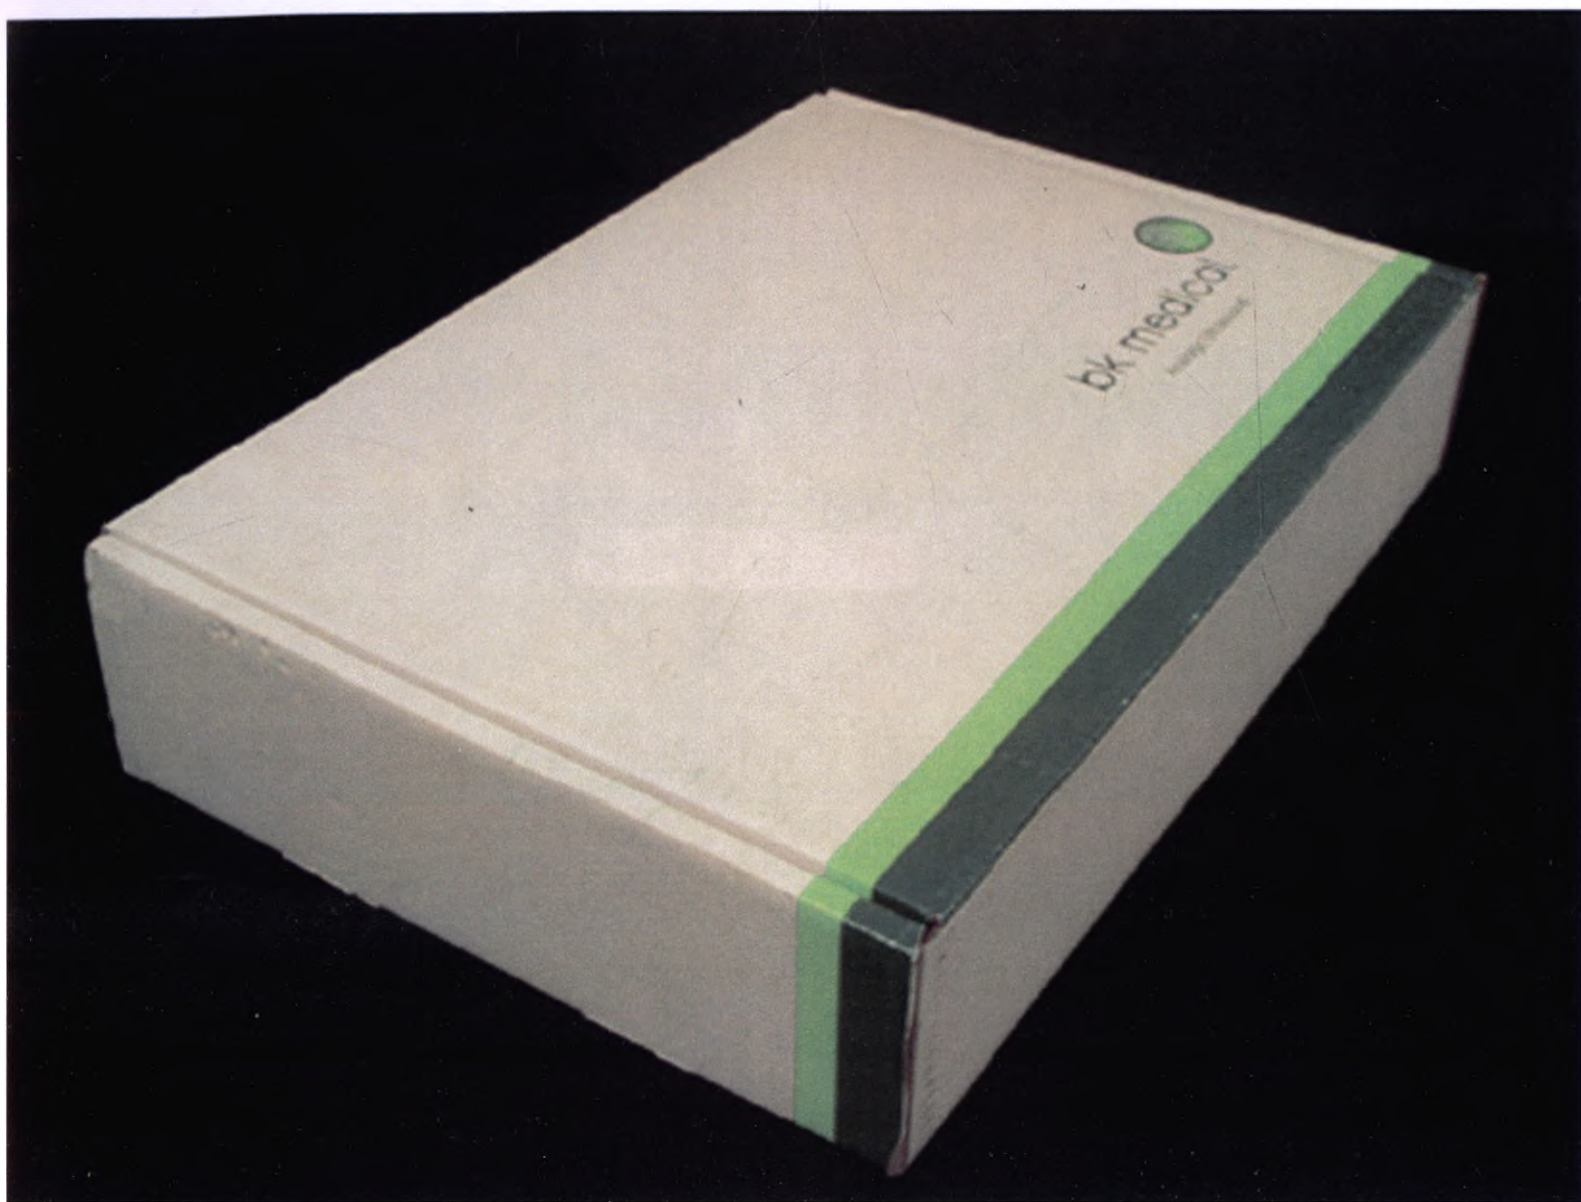

Общий вид упаковки к датчикам ультразвуковым (картонная коробка)



Общий вид упаковки к датчикам ультразвуковым (пластиковый кейс)



Пример маркировки датчика ультразвукового

9008 3121115

E11C3b REF 9008 SN 3121115 CE 0543



(01)05704916000325(11)180521(21)3121115

Made for:




BK Medical ApS

Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark




9008-3121115

Пример маркировки упаковки датчика ультразвукового

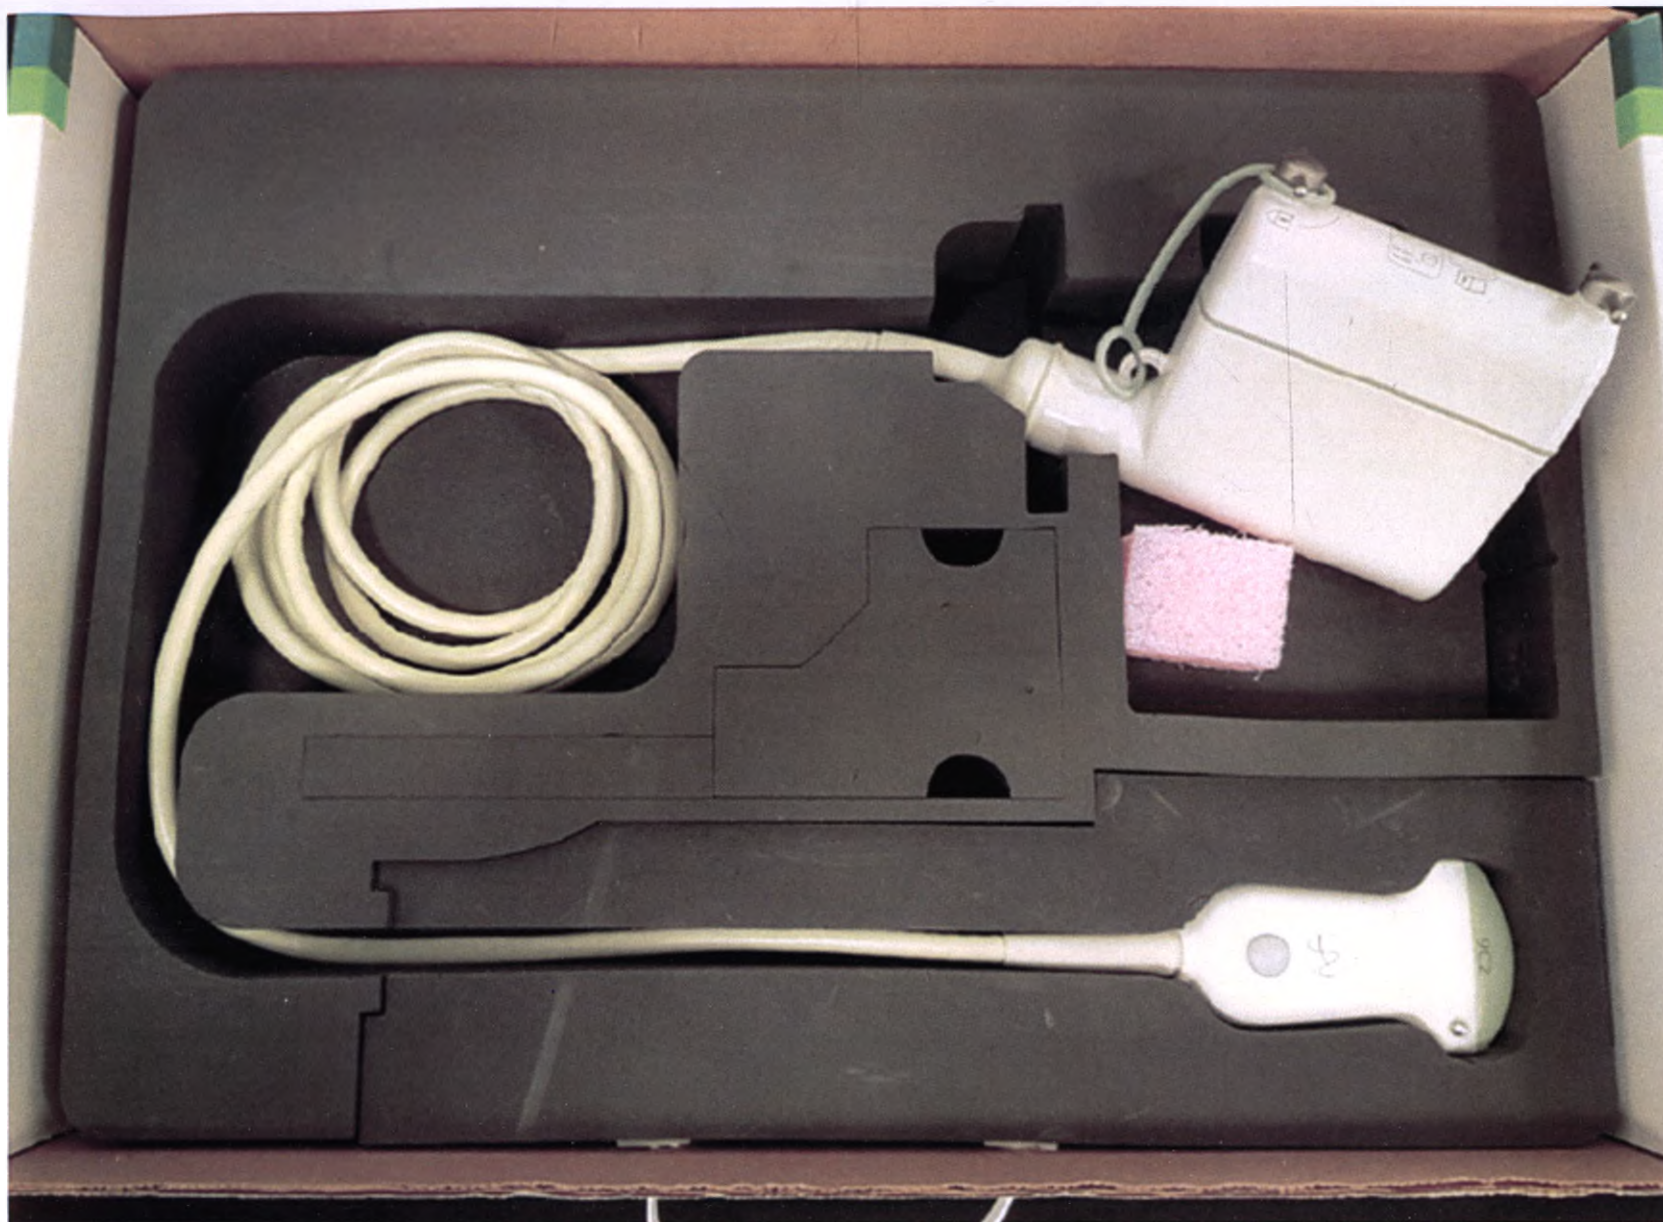

Датчик ультразвуковой конвексный, тип 9002/9C2 (общий вид)

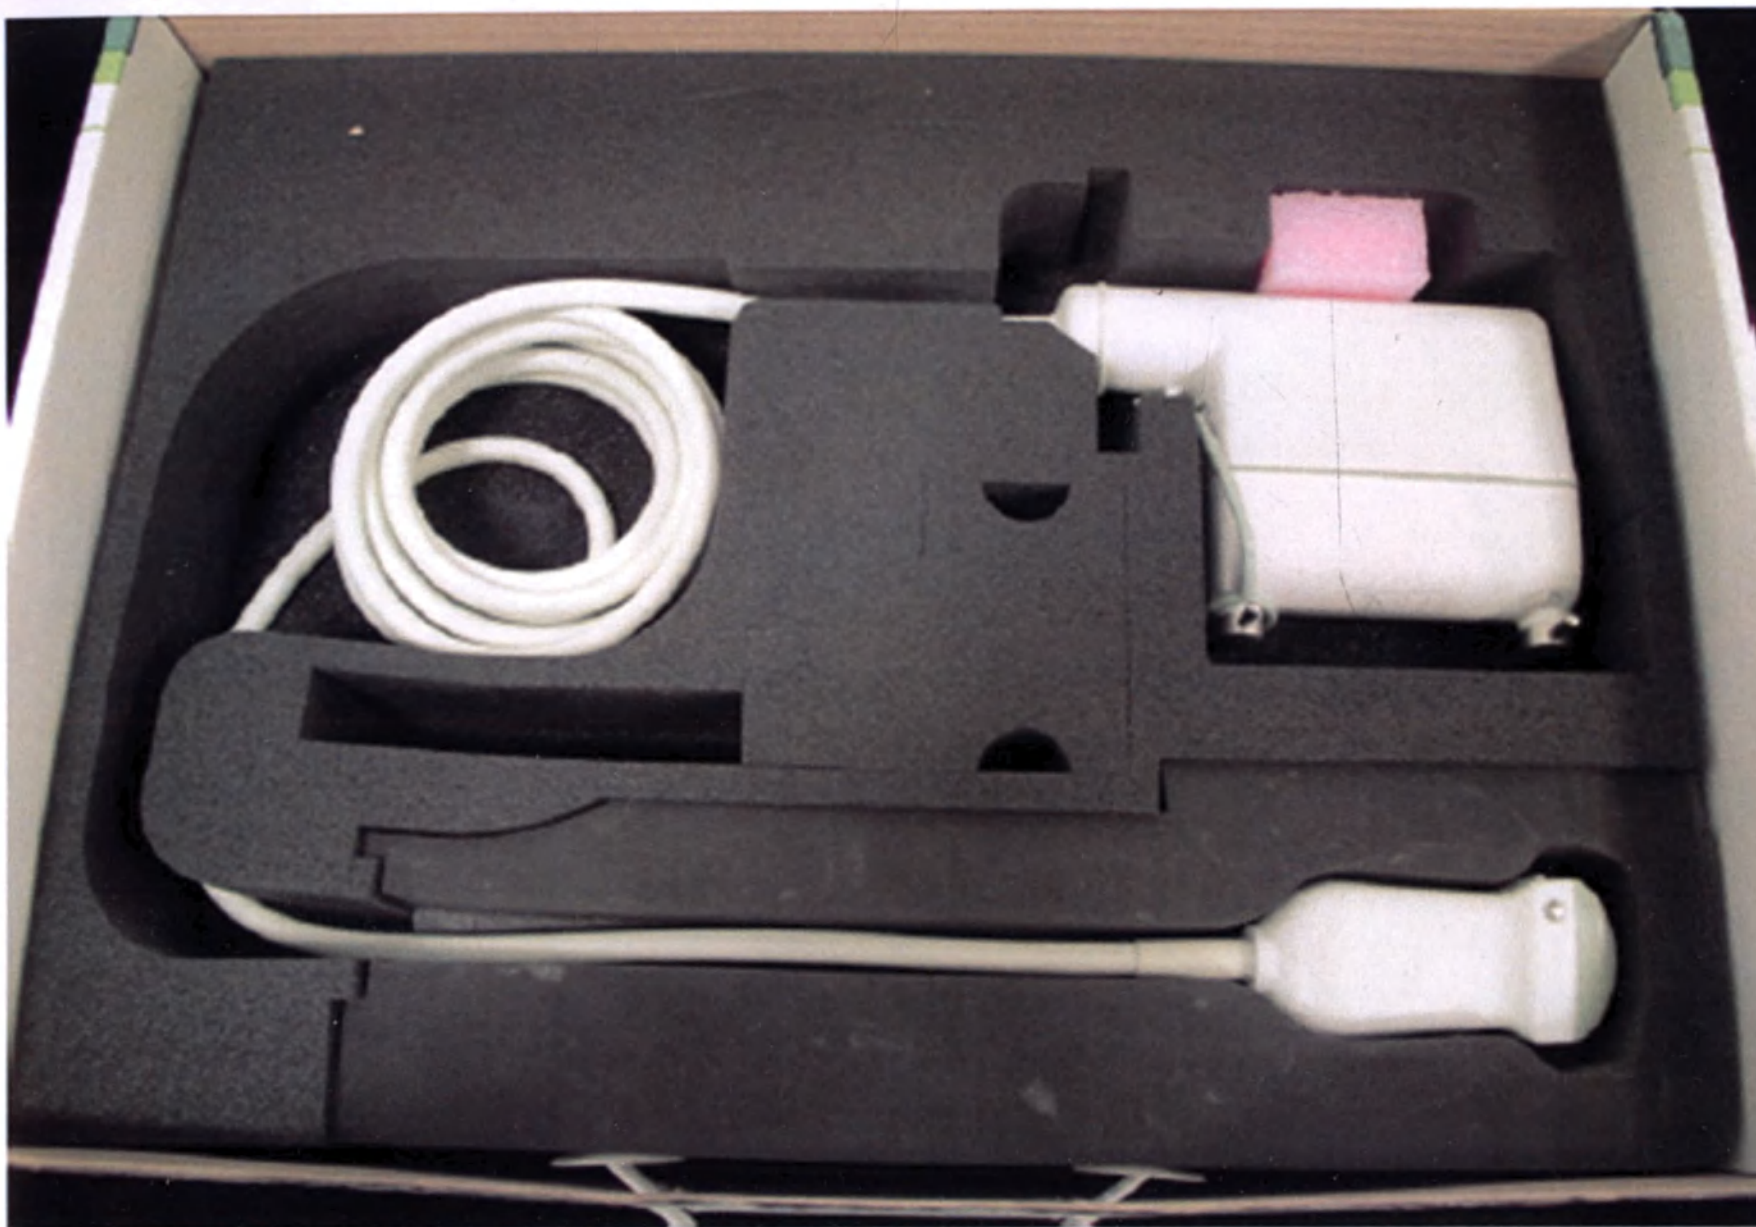


Датчик ультразвуковой конвексный, тип 9023/6C2s (общий вид)




Датчик ультразвуковой конвексный, тип 9040/6C2 (общий вид)




Датчик ультразвуковой конвексный, тип 9085/5C1e (общий вид)

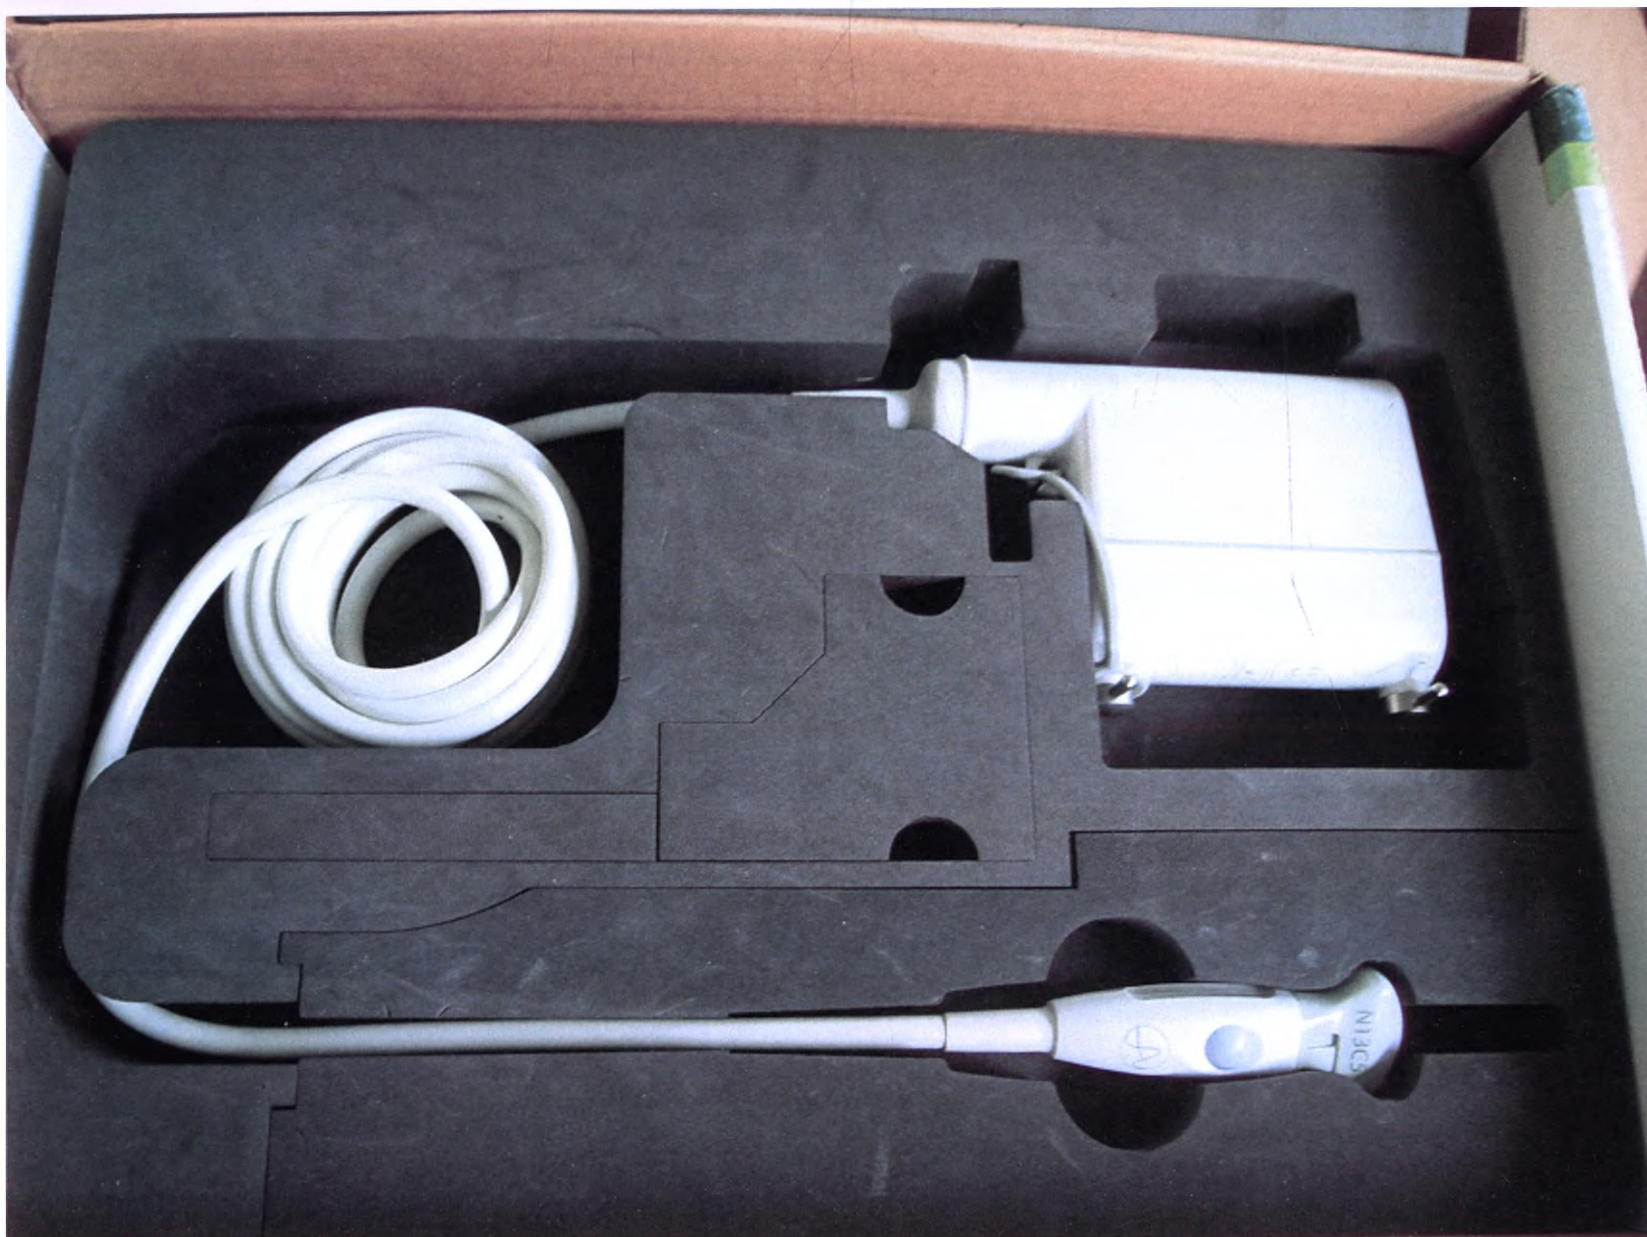


Датчик ультразвуковой конвексный, тип 9062/N13C5 (общий вид)

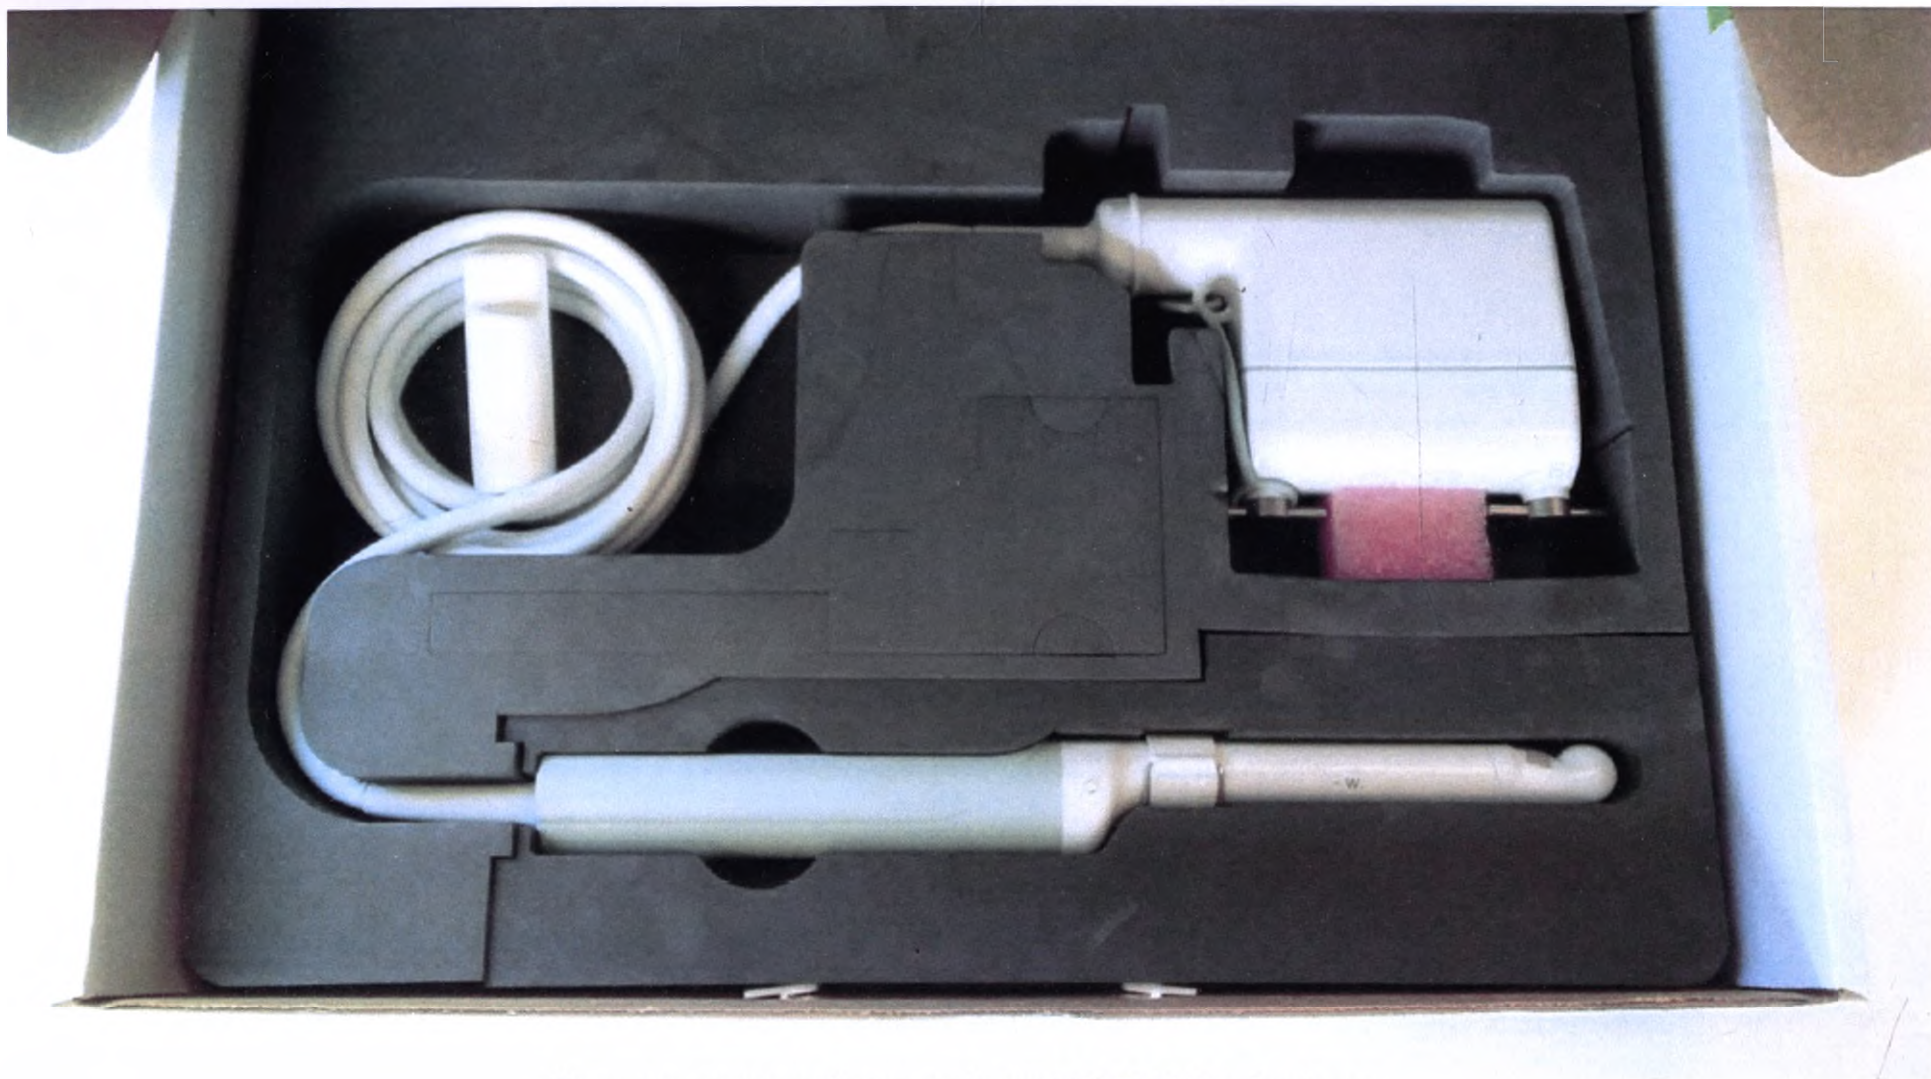


Датчик ультразвуковой полостной, тип 9008/E11C3b (общий вид)

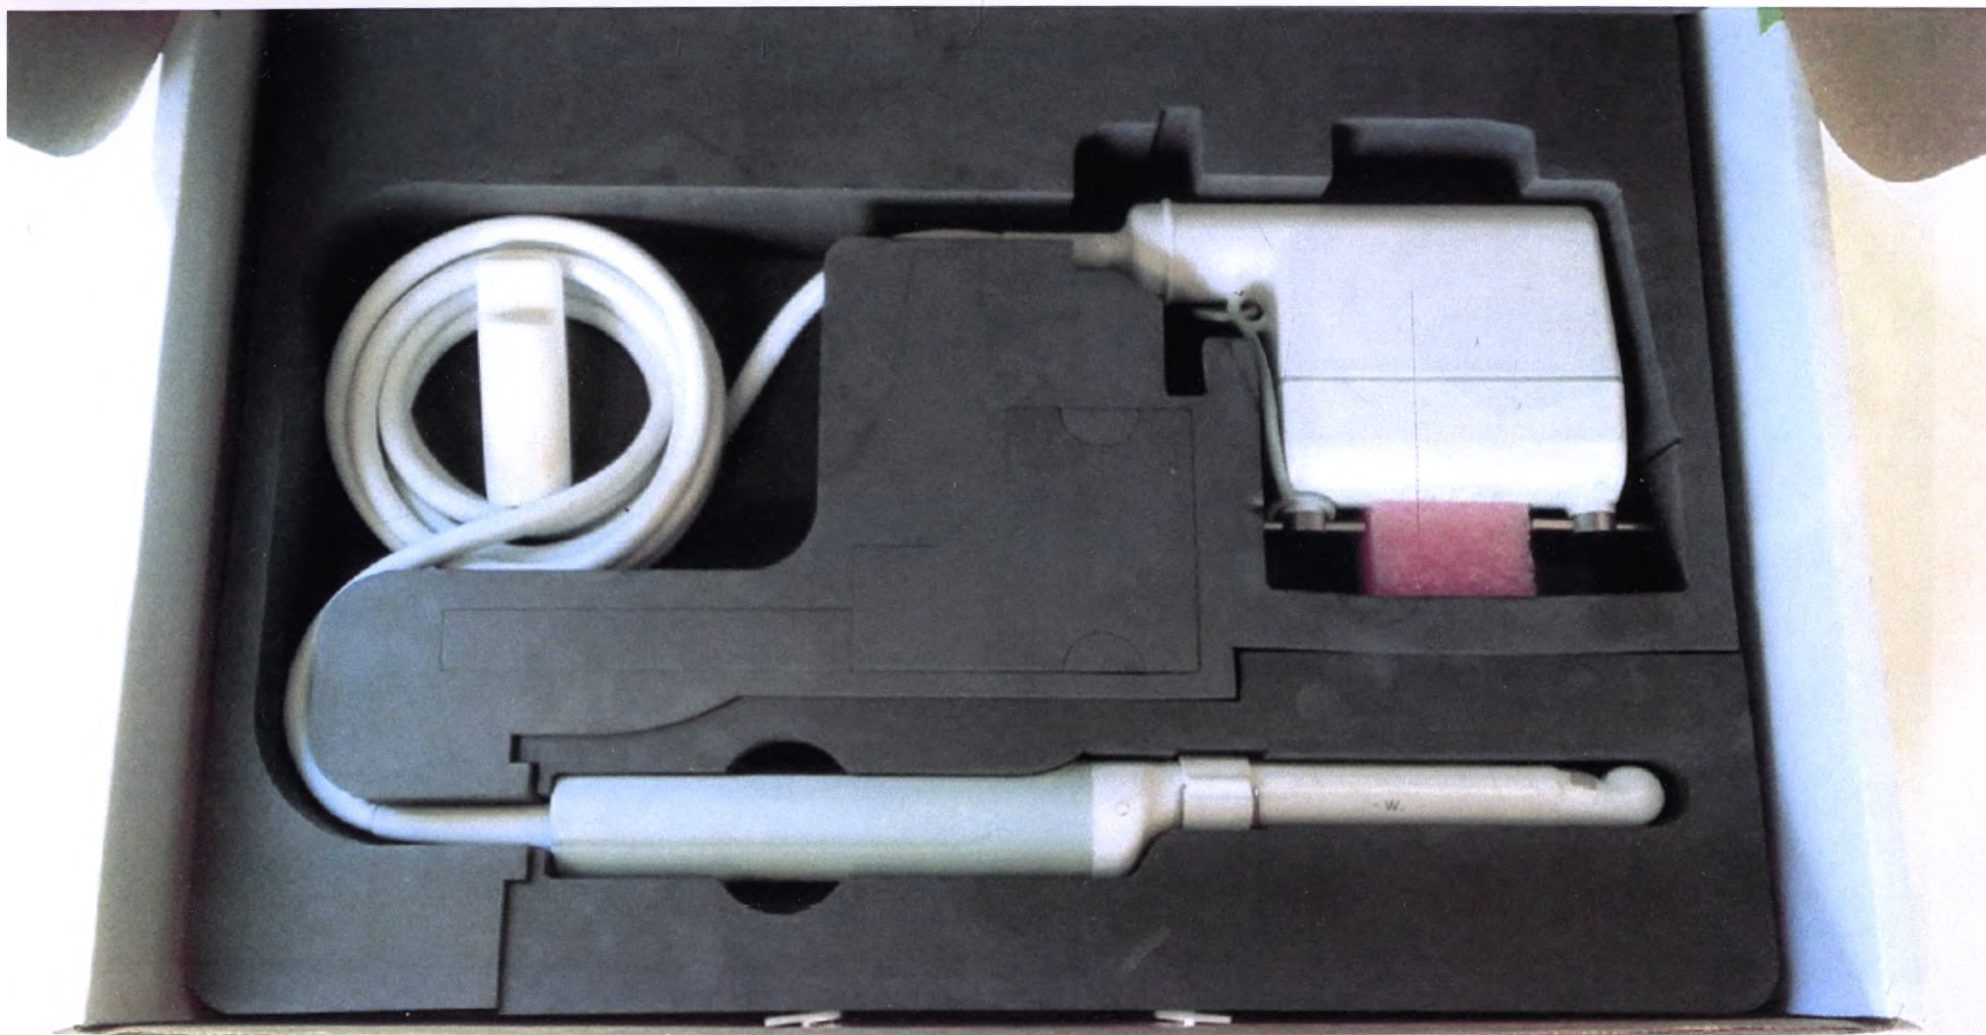

Датчик ультразвуковой полостной, тип 9018/E14C4t (общий вид)

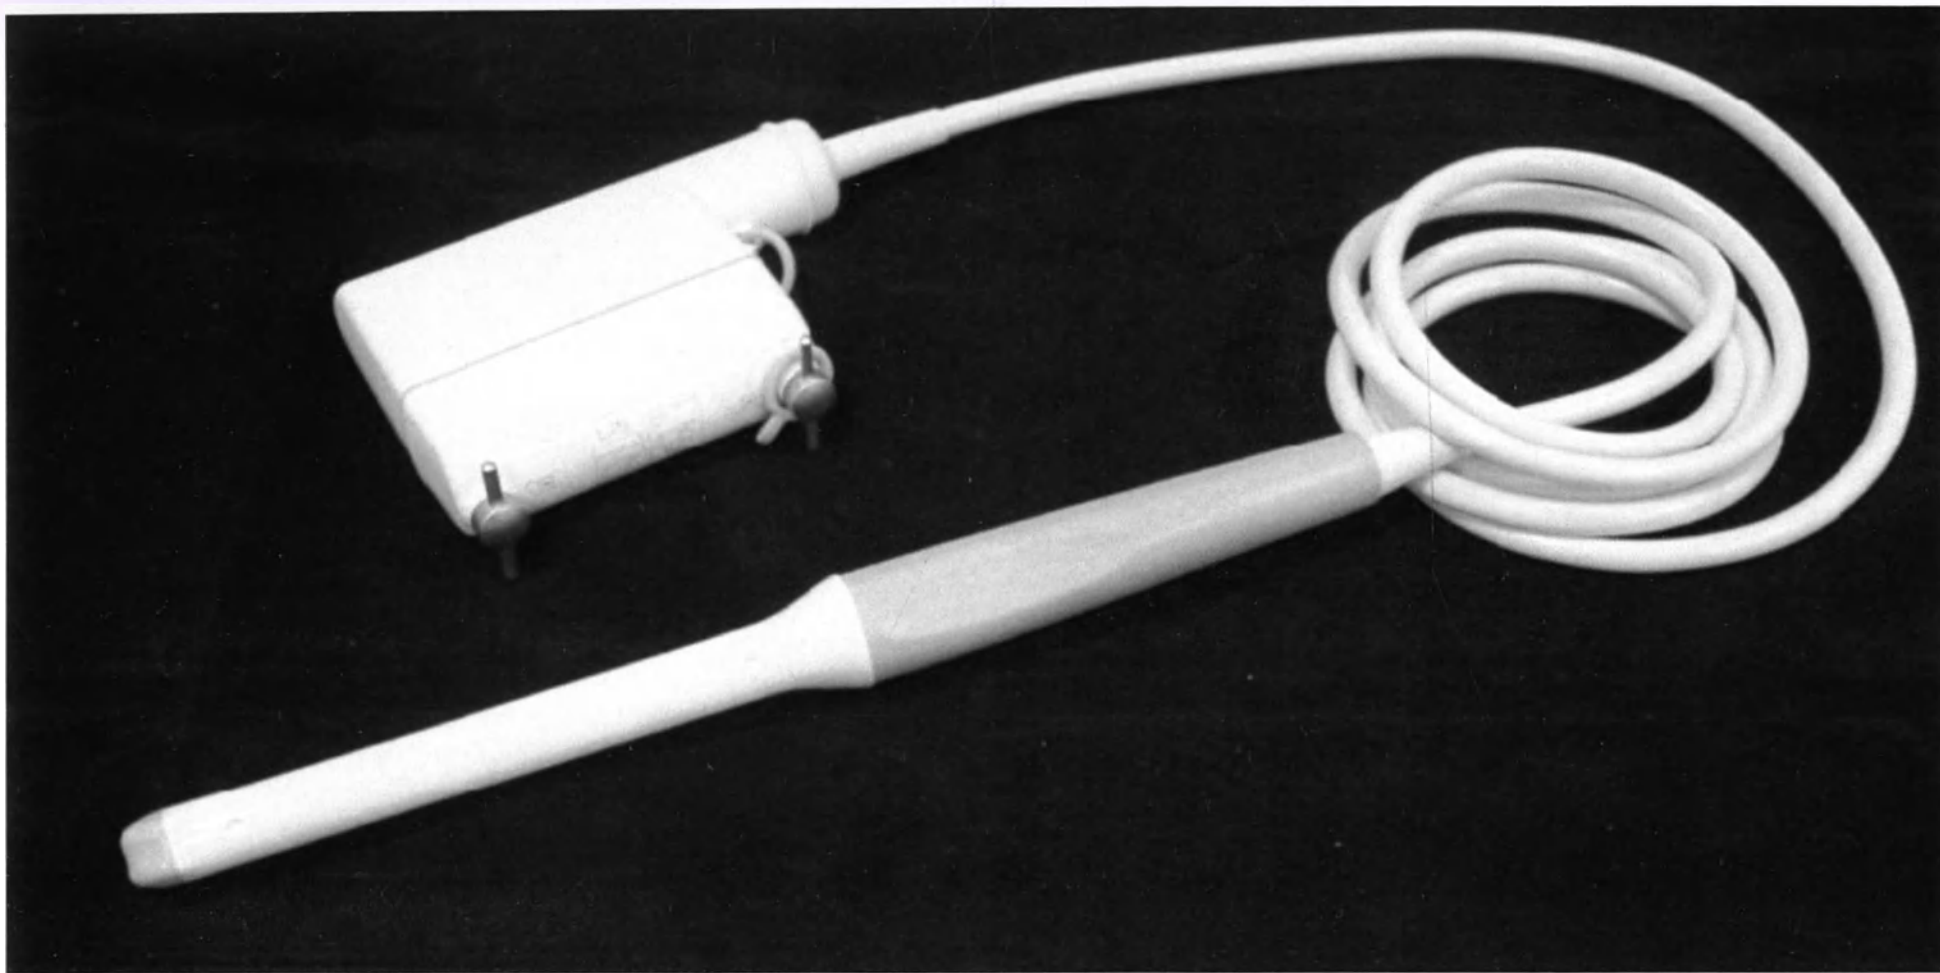

Датчик ультразвуковой полостной, тип 9019/E10C4 (общий вид)

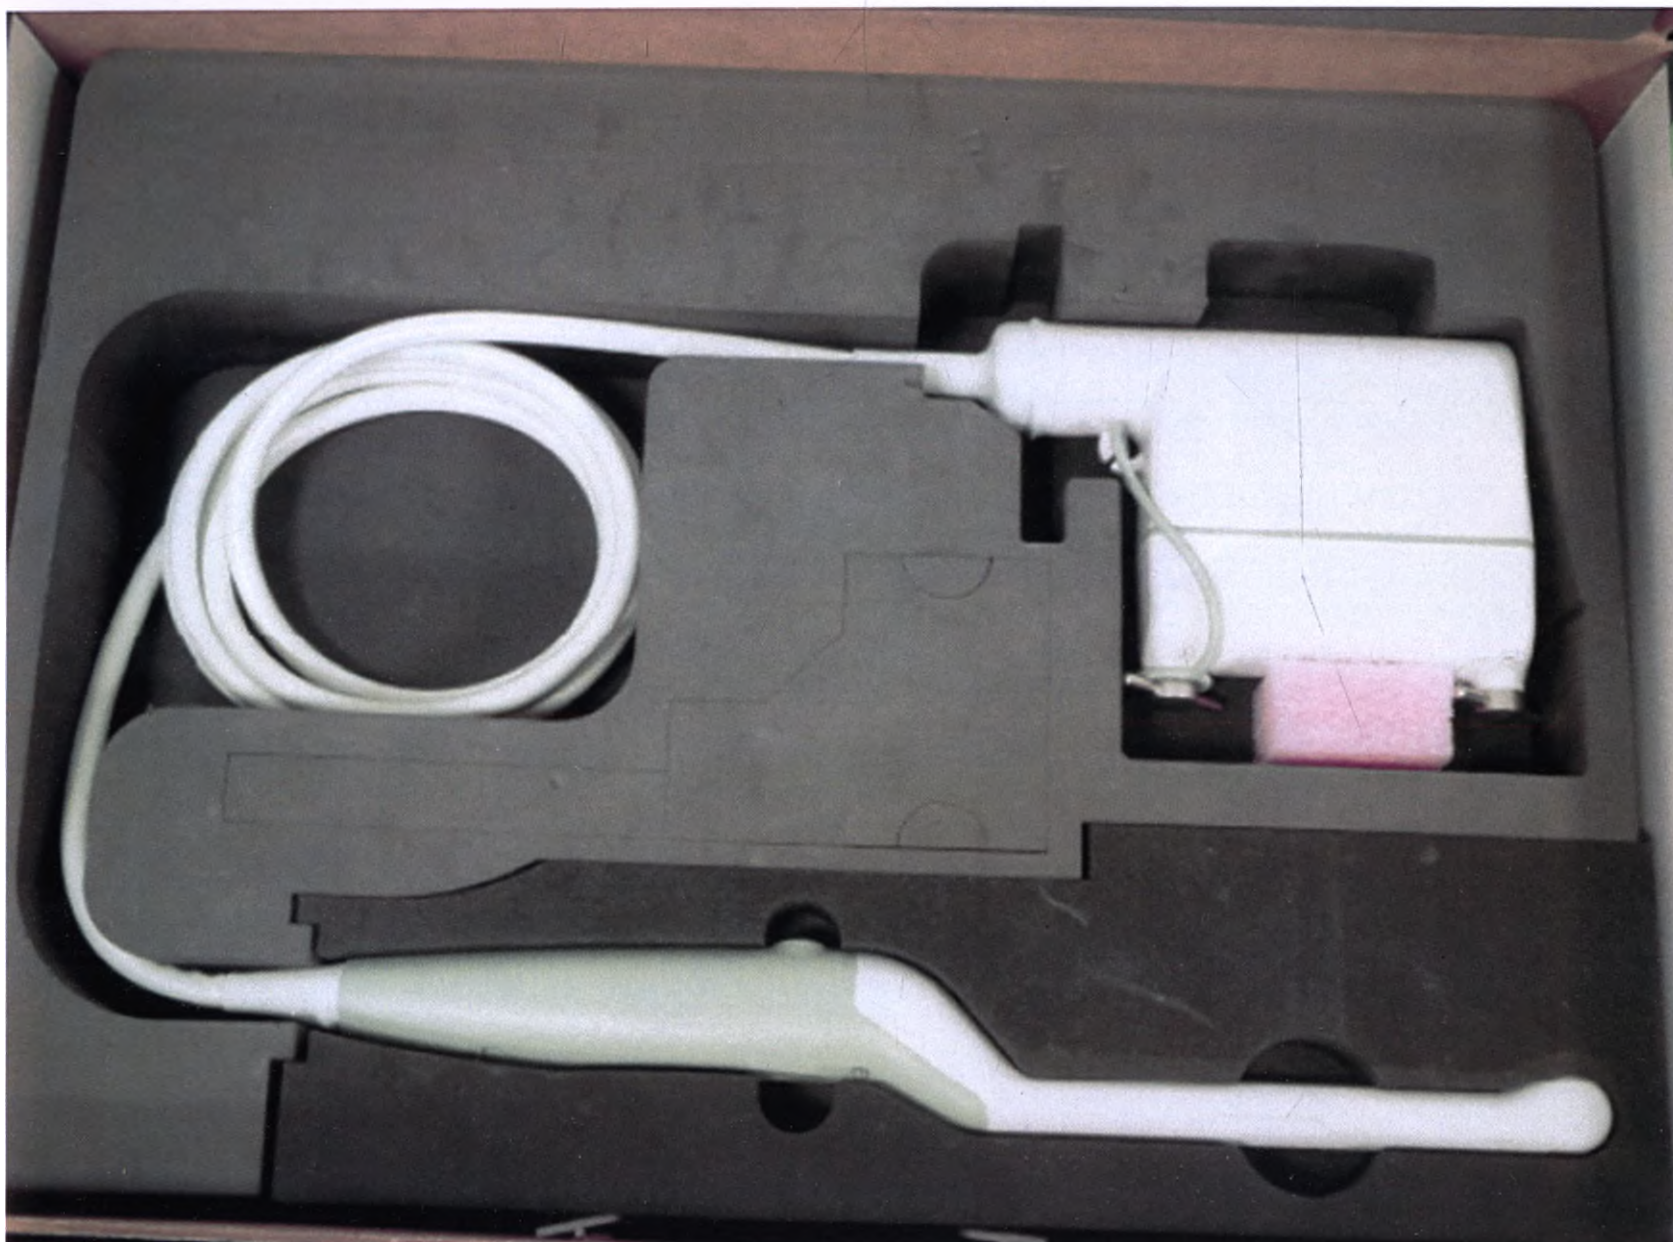


Датчик ультразвуковой полостной, тип 9029/E13C2 (общий вид)




Датчик ультразвуковой полостной, тип 9048/E14CL4b (общий вид)



Датчик ультразвуковой полостной, тип 9038/X14L4 (общий вид)

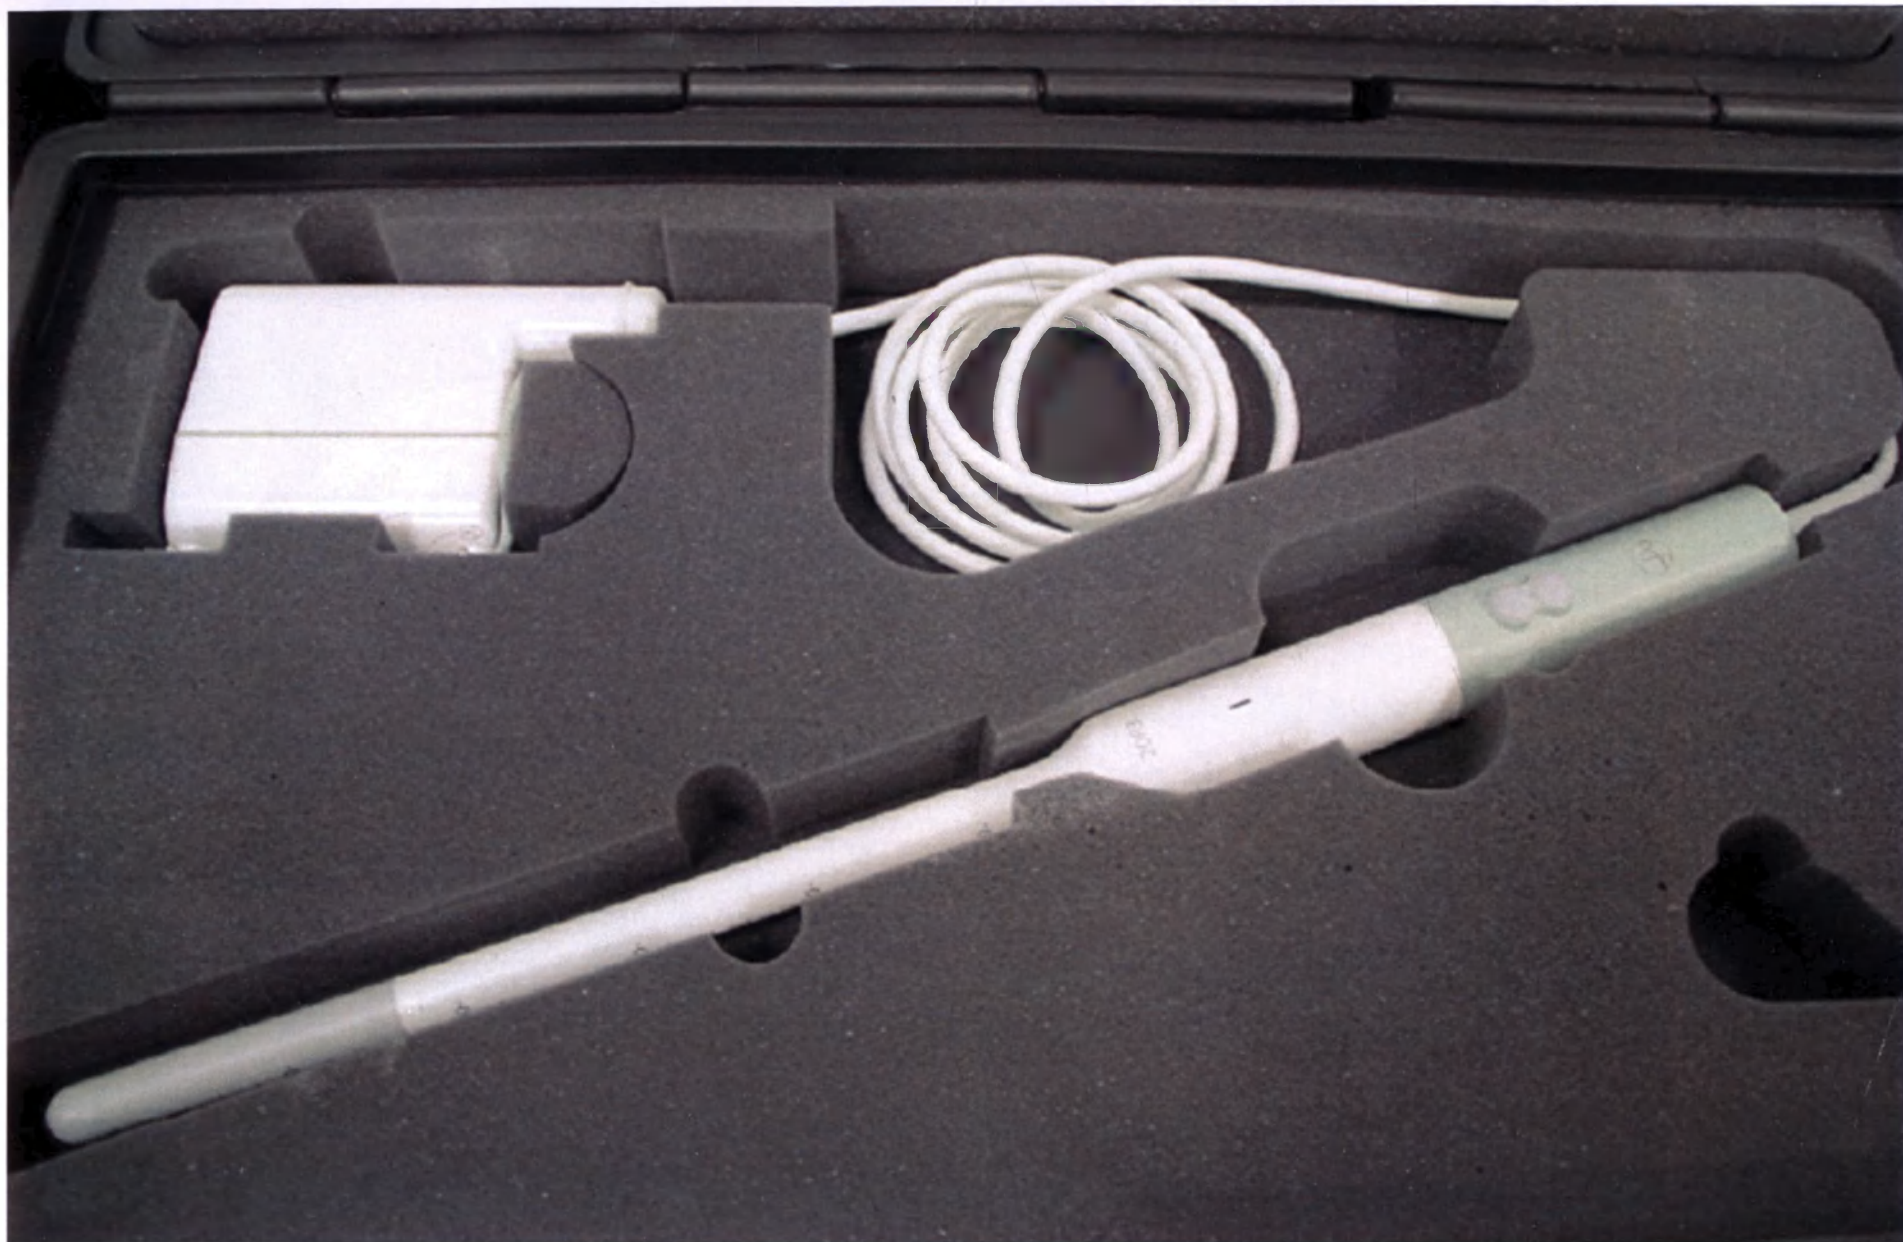


Датчик ультразвуковой полостной, тип 9052/20R3 (общий вид)

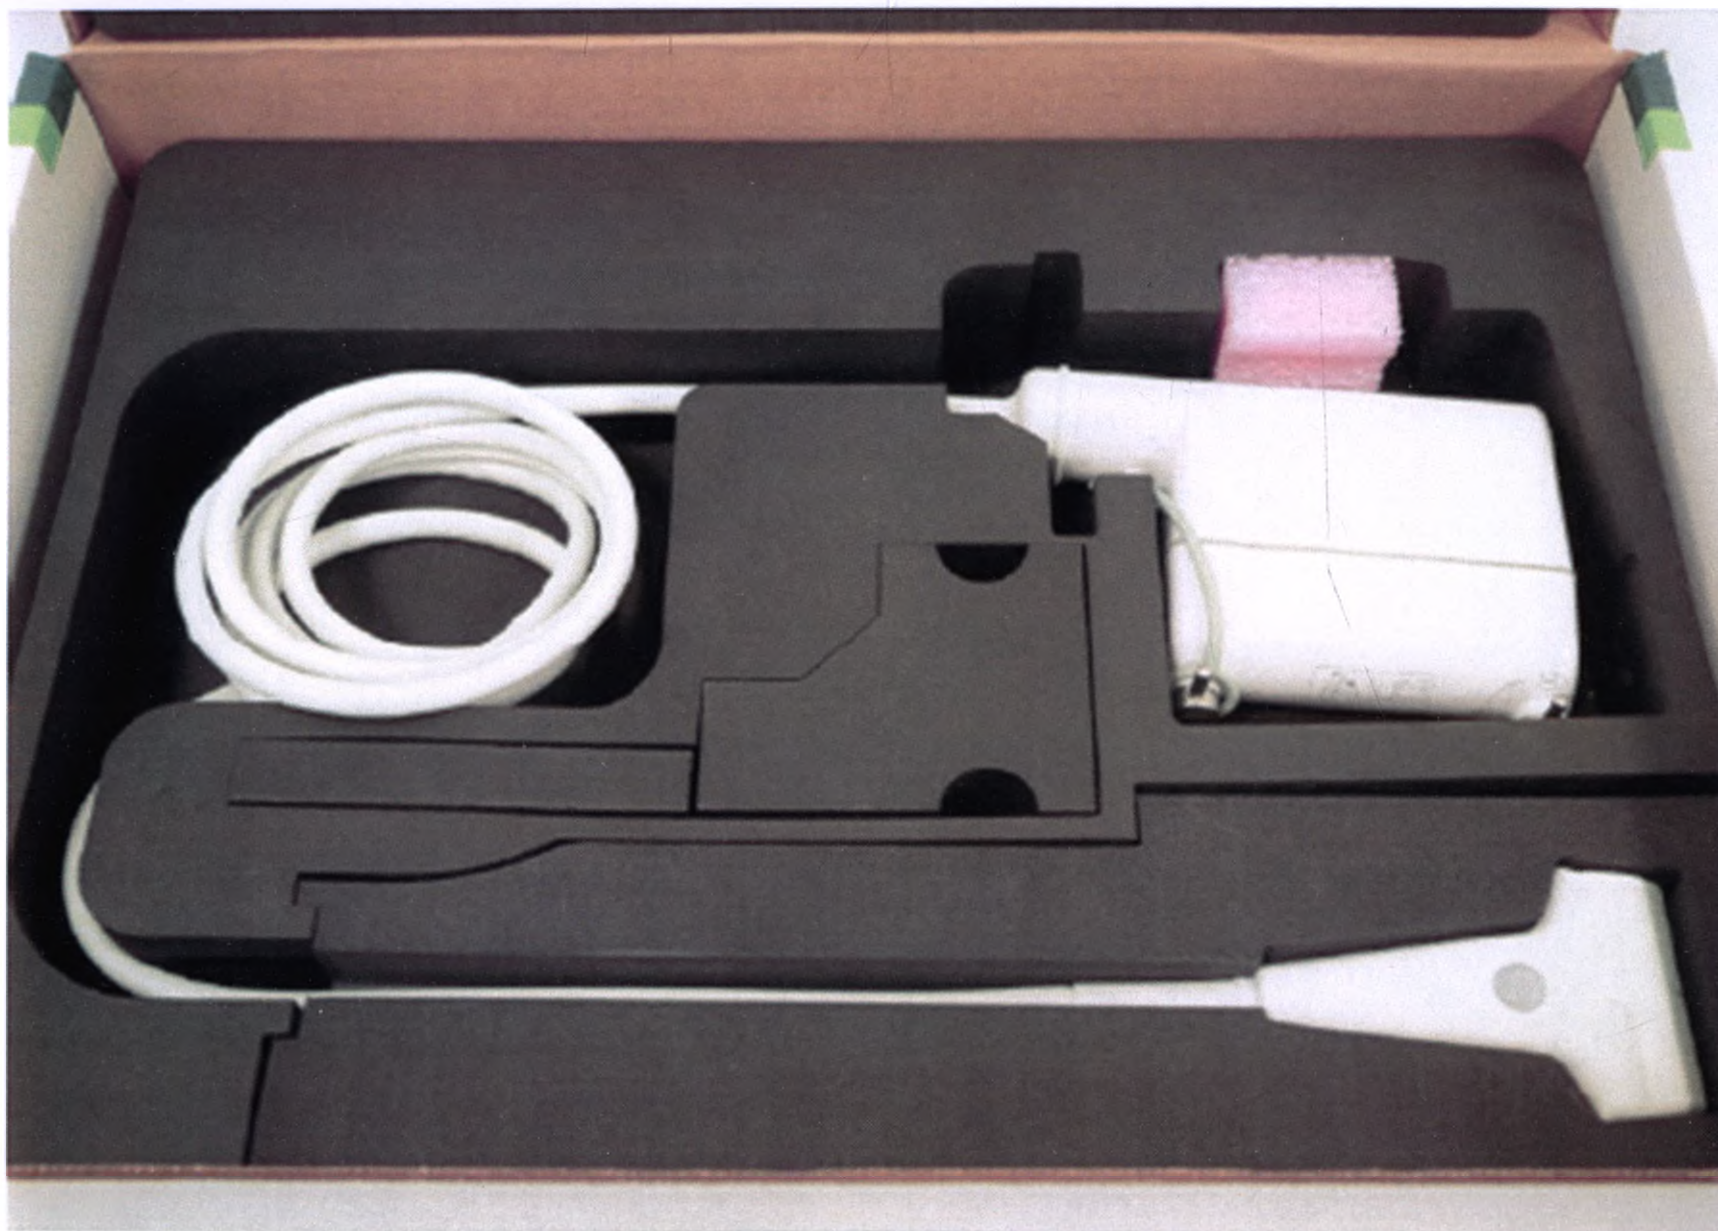

Датчик ультразвуковой линейный, тип 9011/13L4w (общий вид)



Датчик ультразвуковой линейный, тип 9051/14L3 (общий вид)

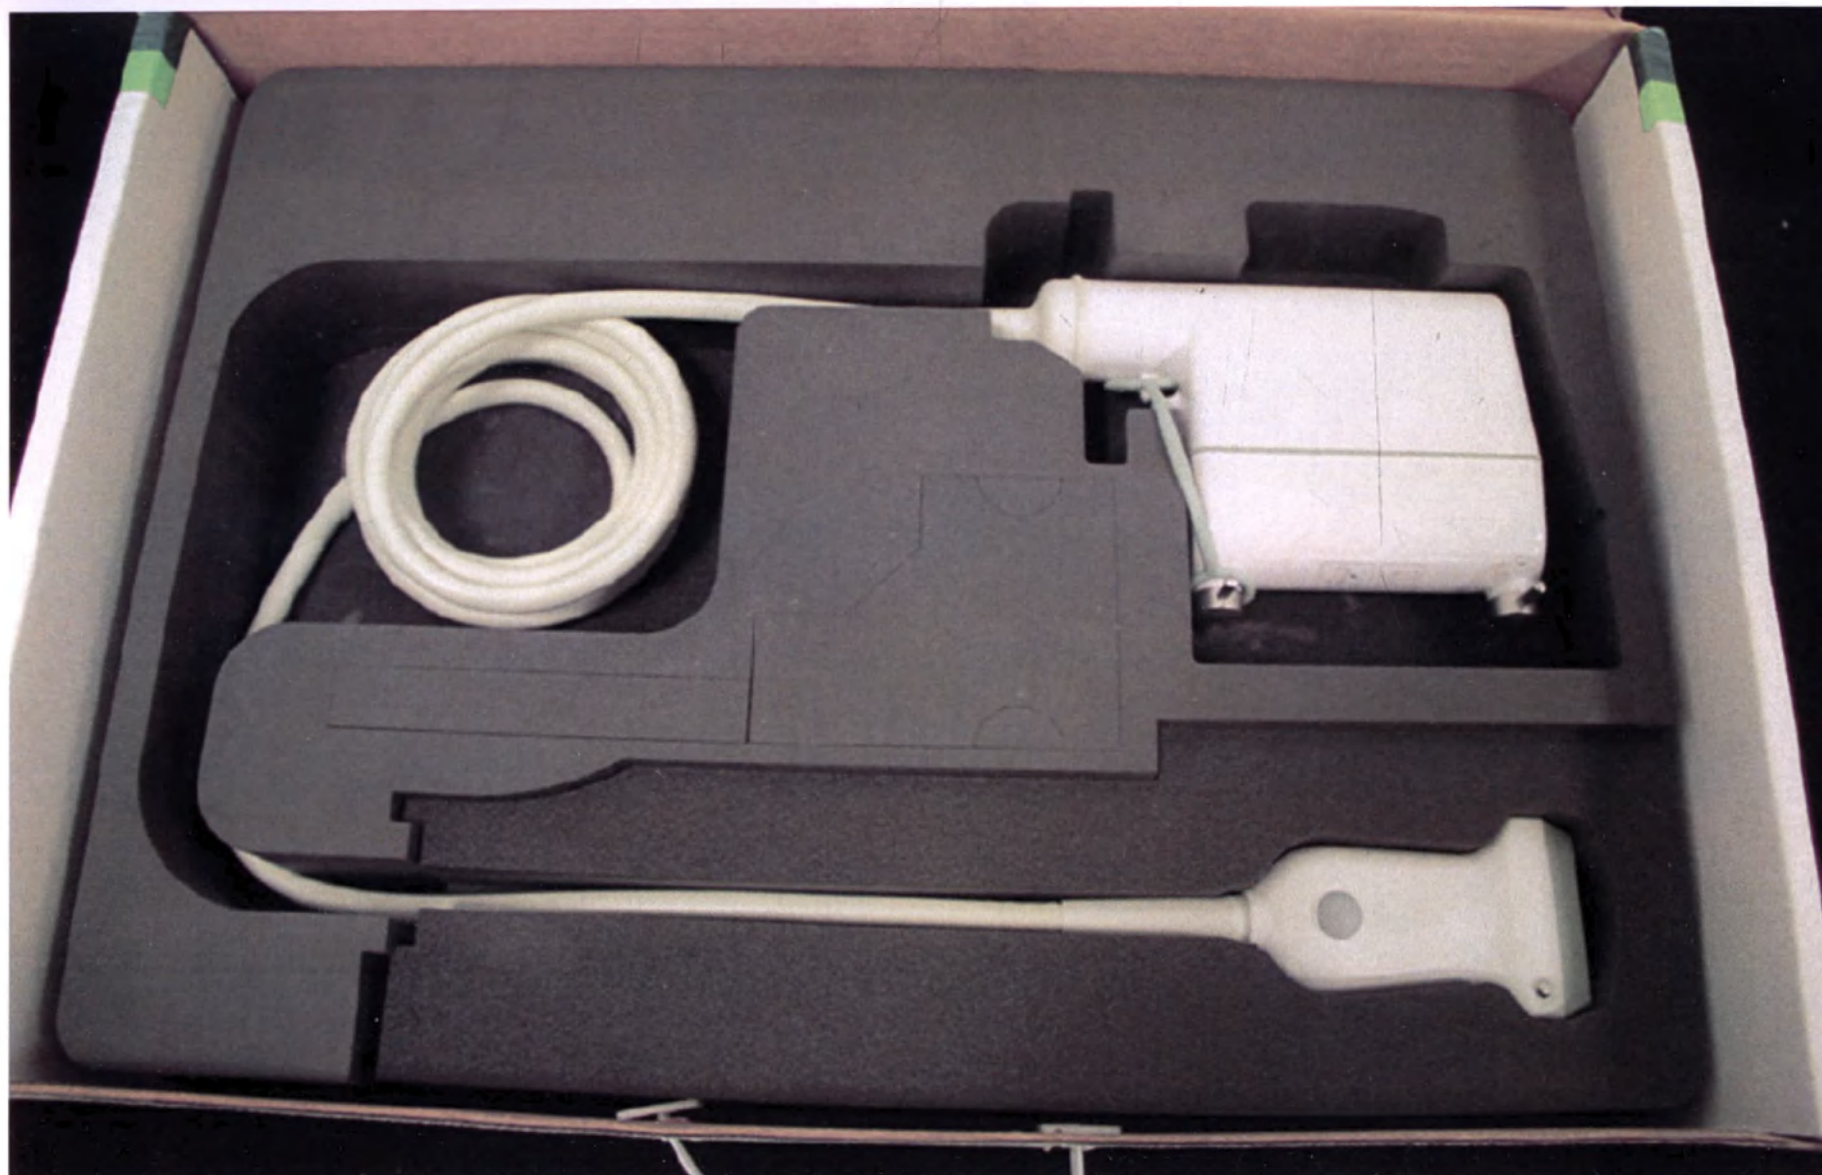


Датчик ультразвуковой линейный, тип 9070/18L5 (общий вид)




Датчик ультразвуковой линейный, тип 9086/14L3e (общий вид)



Датчик ультразвуковой линейный, тип 9022/10L2w (общий вид)

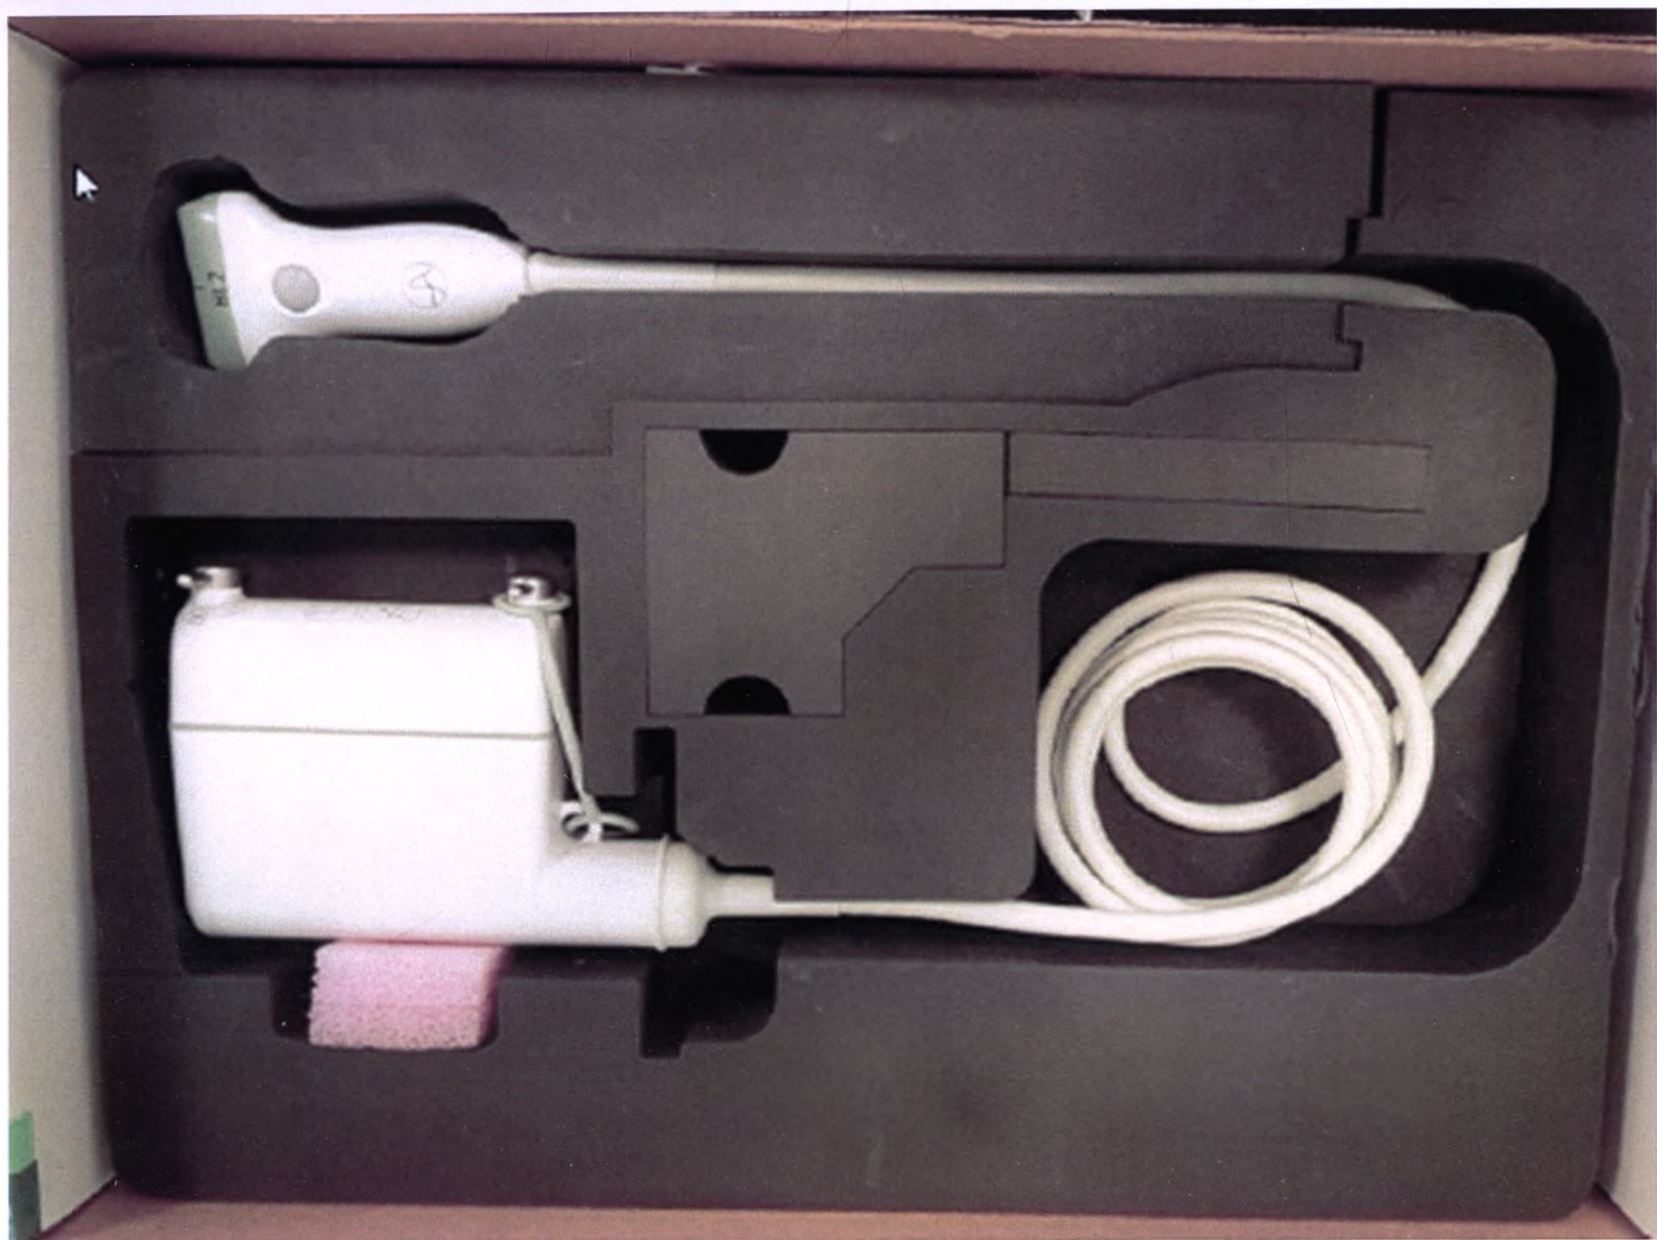

Датчик ультразвуковой линейный, тип 9032/8L2 (общий вид)

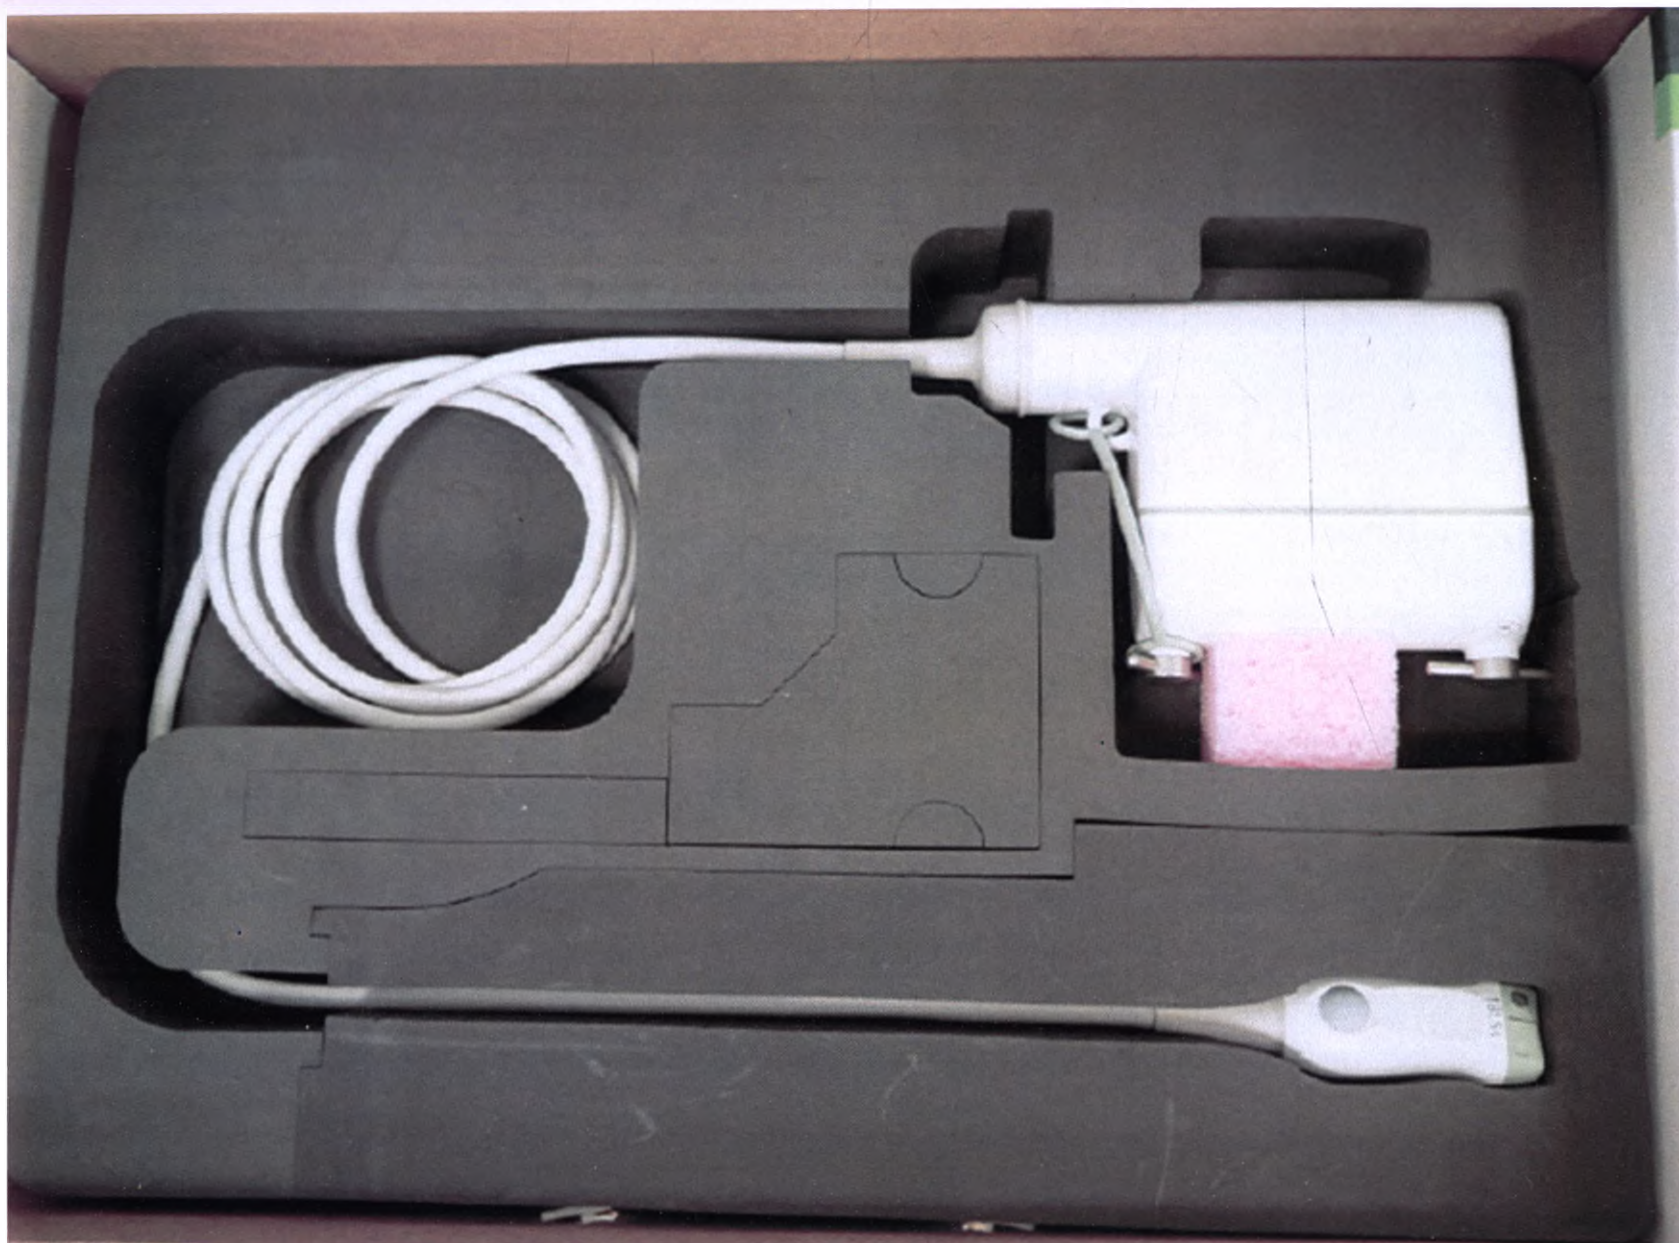

Датчик ультразвуковой линейный, тип 9081/18L5s (общий вид)



Датчик ультразвуковой фазированный, тип 9087/5P1e (общий вид)



Датчик ультразвуковой фазированный, тип 9077/5P1 (общий вид)



Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9015/П14С5I (общий вид)



Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9016/I14C5T (общий вид)



Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9024/I12C5b (общий вид)




Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9066/I12C4f (общий вид)




Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9063/N11C5s (общий вид)



Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9026/X12C4 (общий вид)

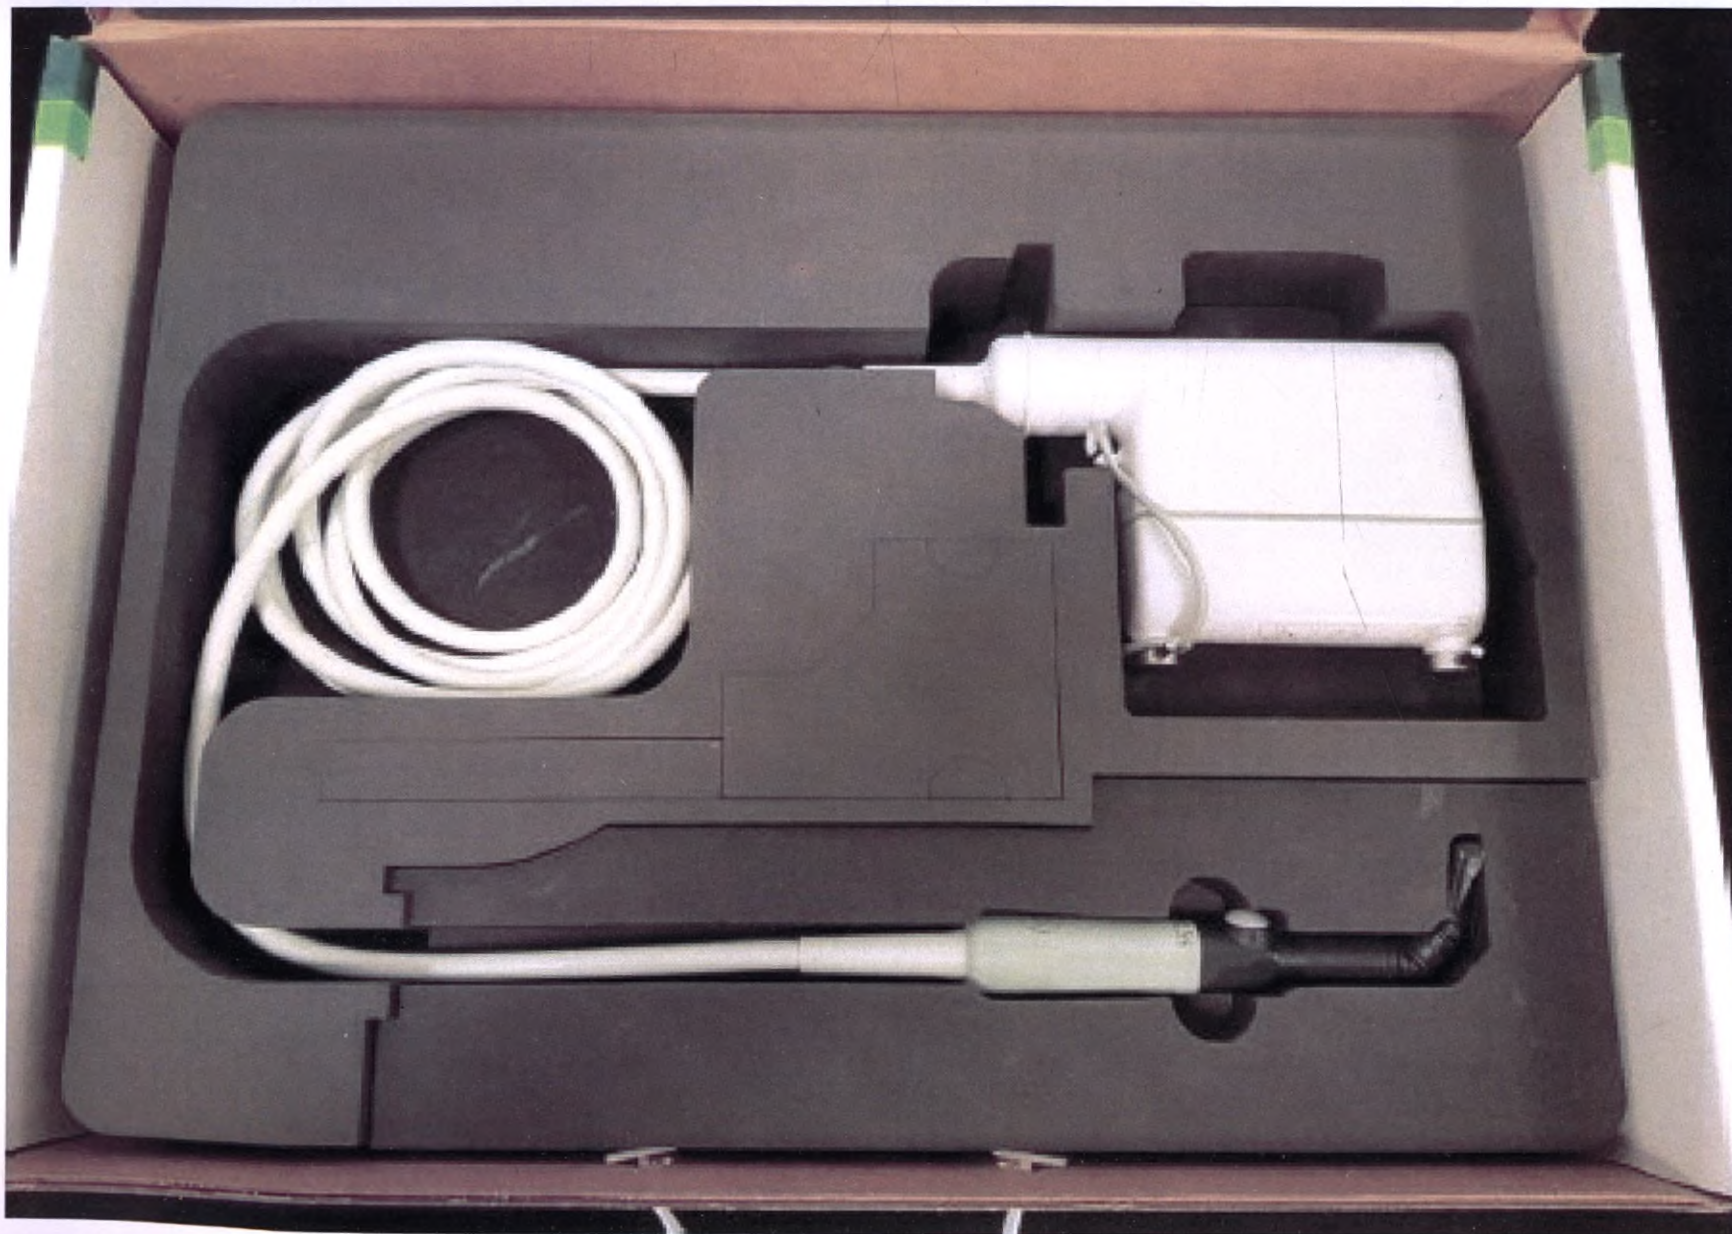

Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9009/X18L5s (общий вид)

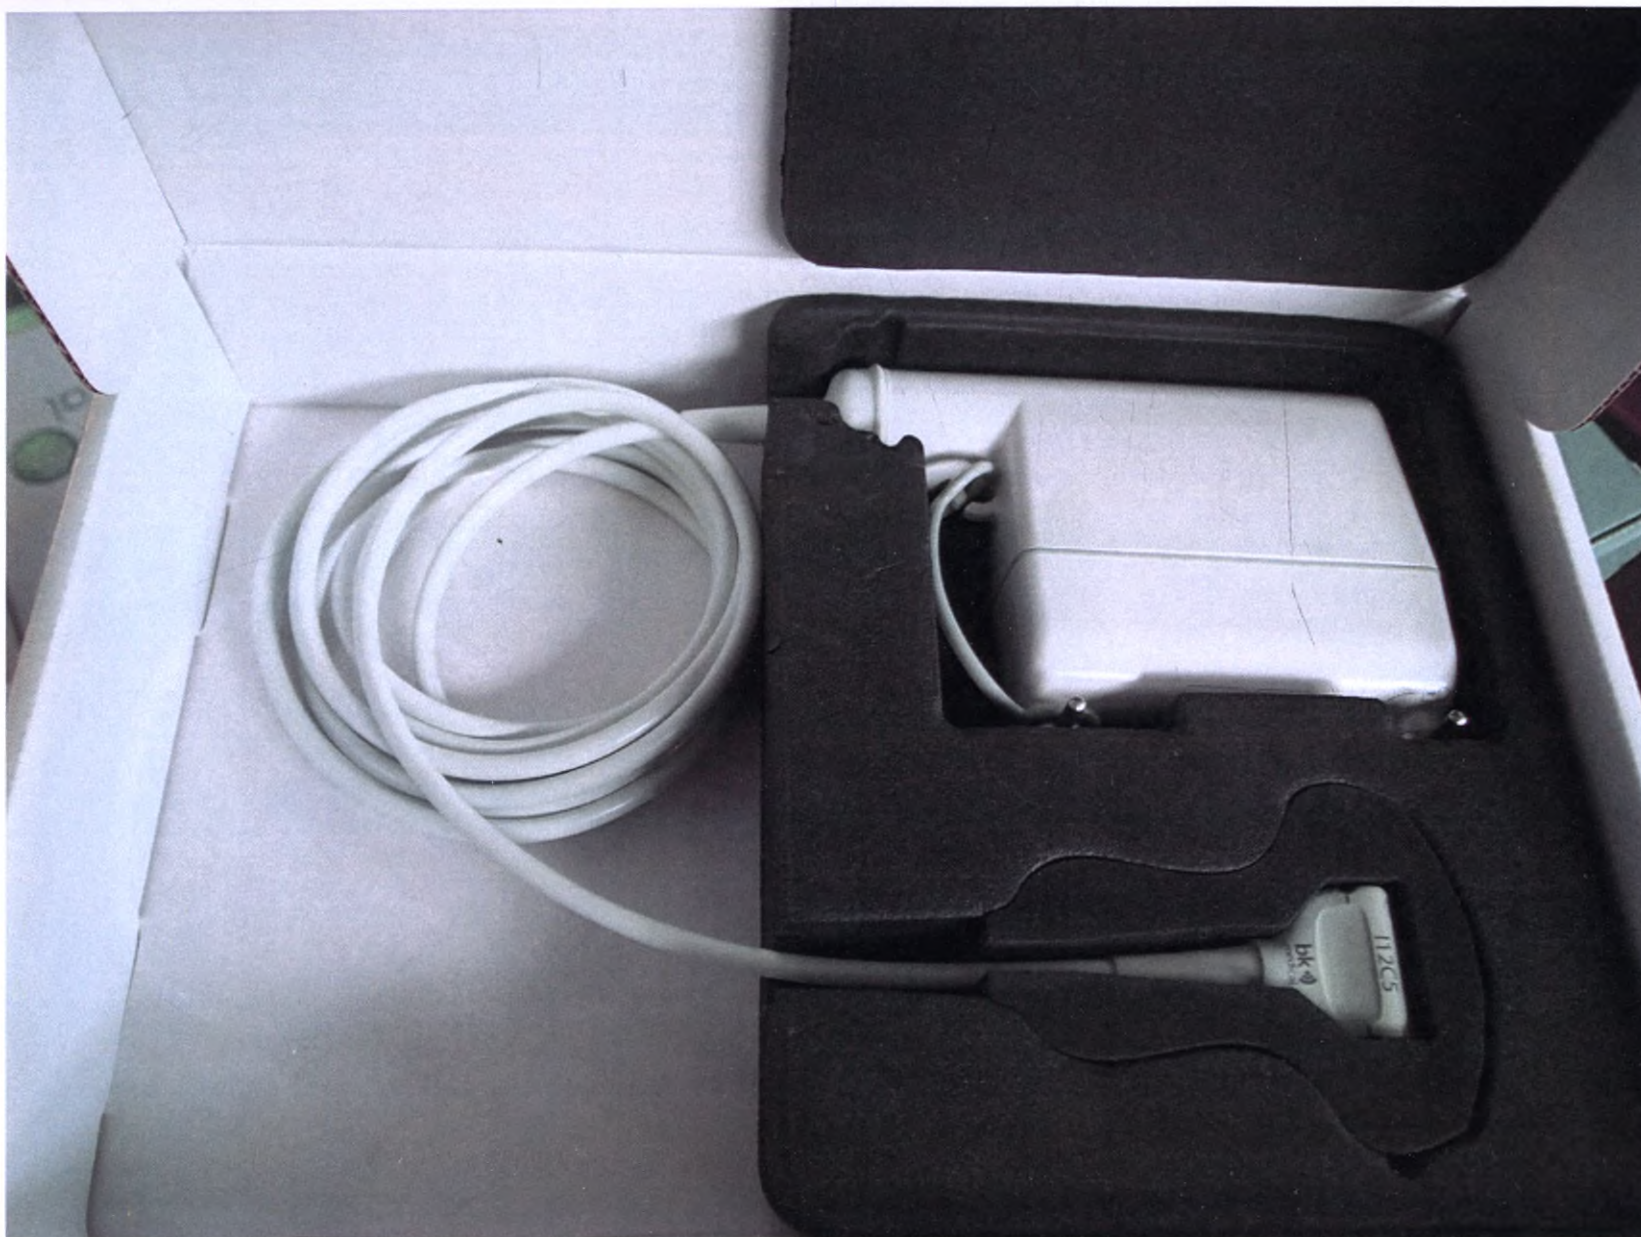


Датчик ультразвуковой интраоперационный Mini T, тип 9034/112C5 (общий вид)



Датчик ультразвуковой интраоперационный, тип 9096/Rob12C4 (общий вид)




Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1326; для датчиков 9008 и 9018 (общий вид)

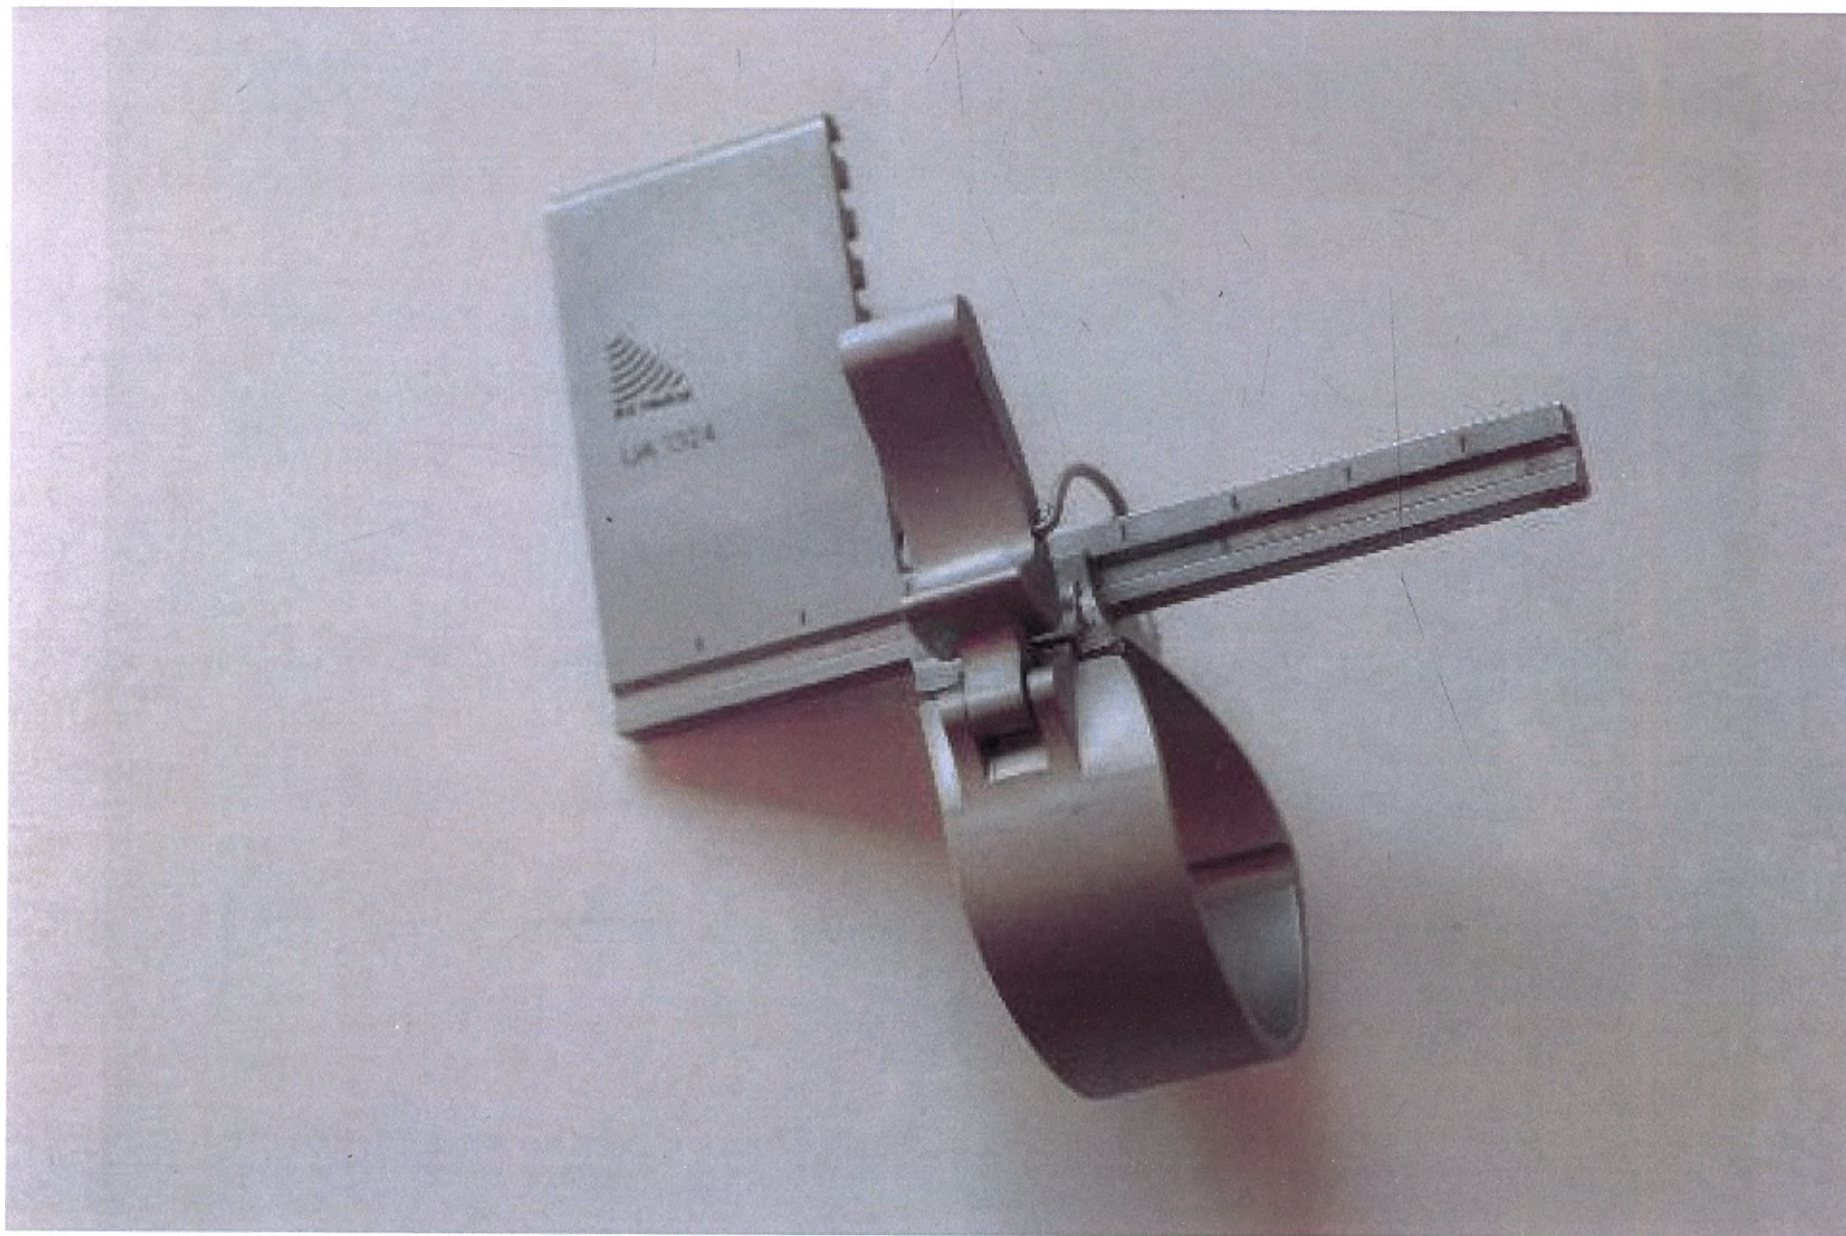


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1324; для датчиков 9008 и 9018 (общий вид)



Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1250; для датчиков 9002/9023 и 9040 (общий вид)

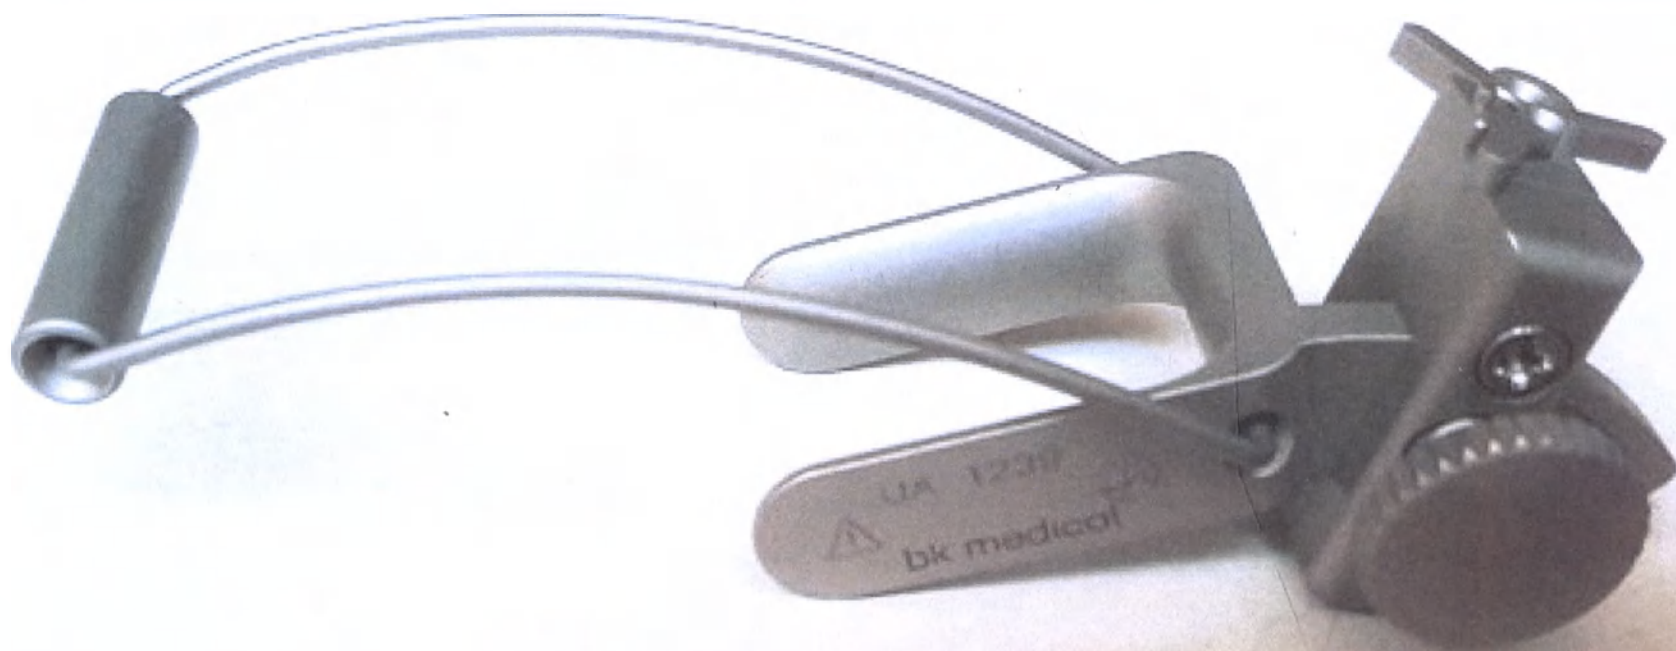


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1239; для датчиков 9011 и 9022 (общий вид)

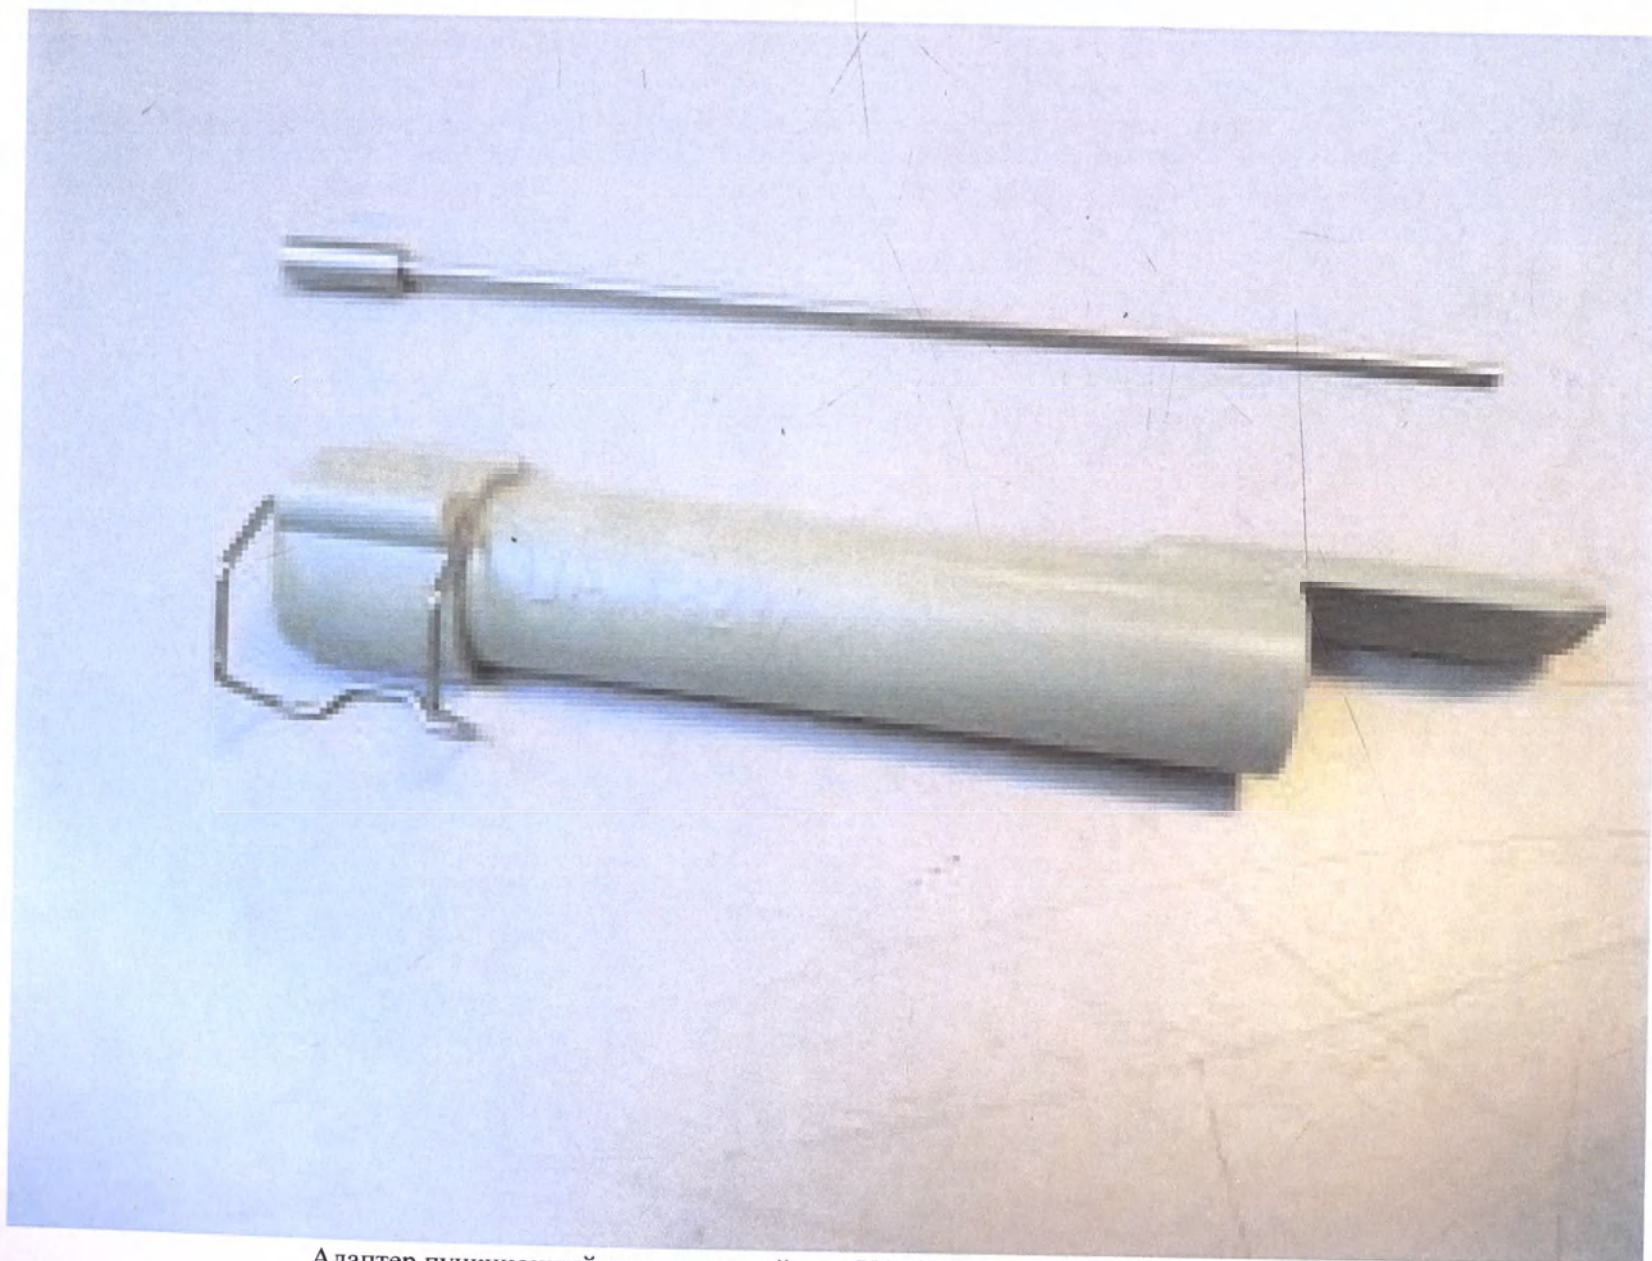


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1327; для датчика 9018 (общий вид)




Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1328; для датчика 9018 (общий вид)

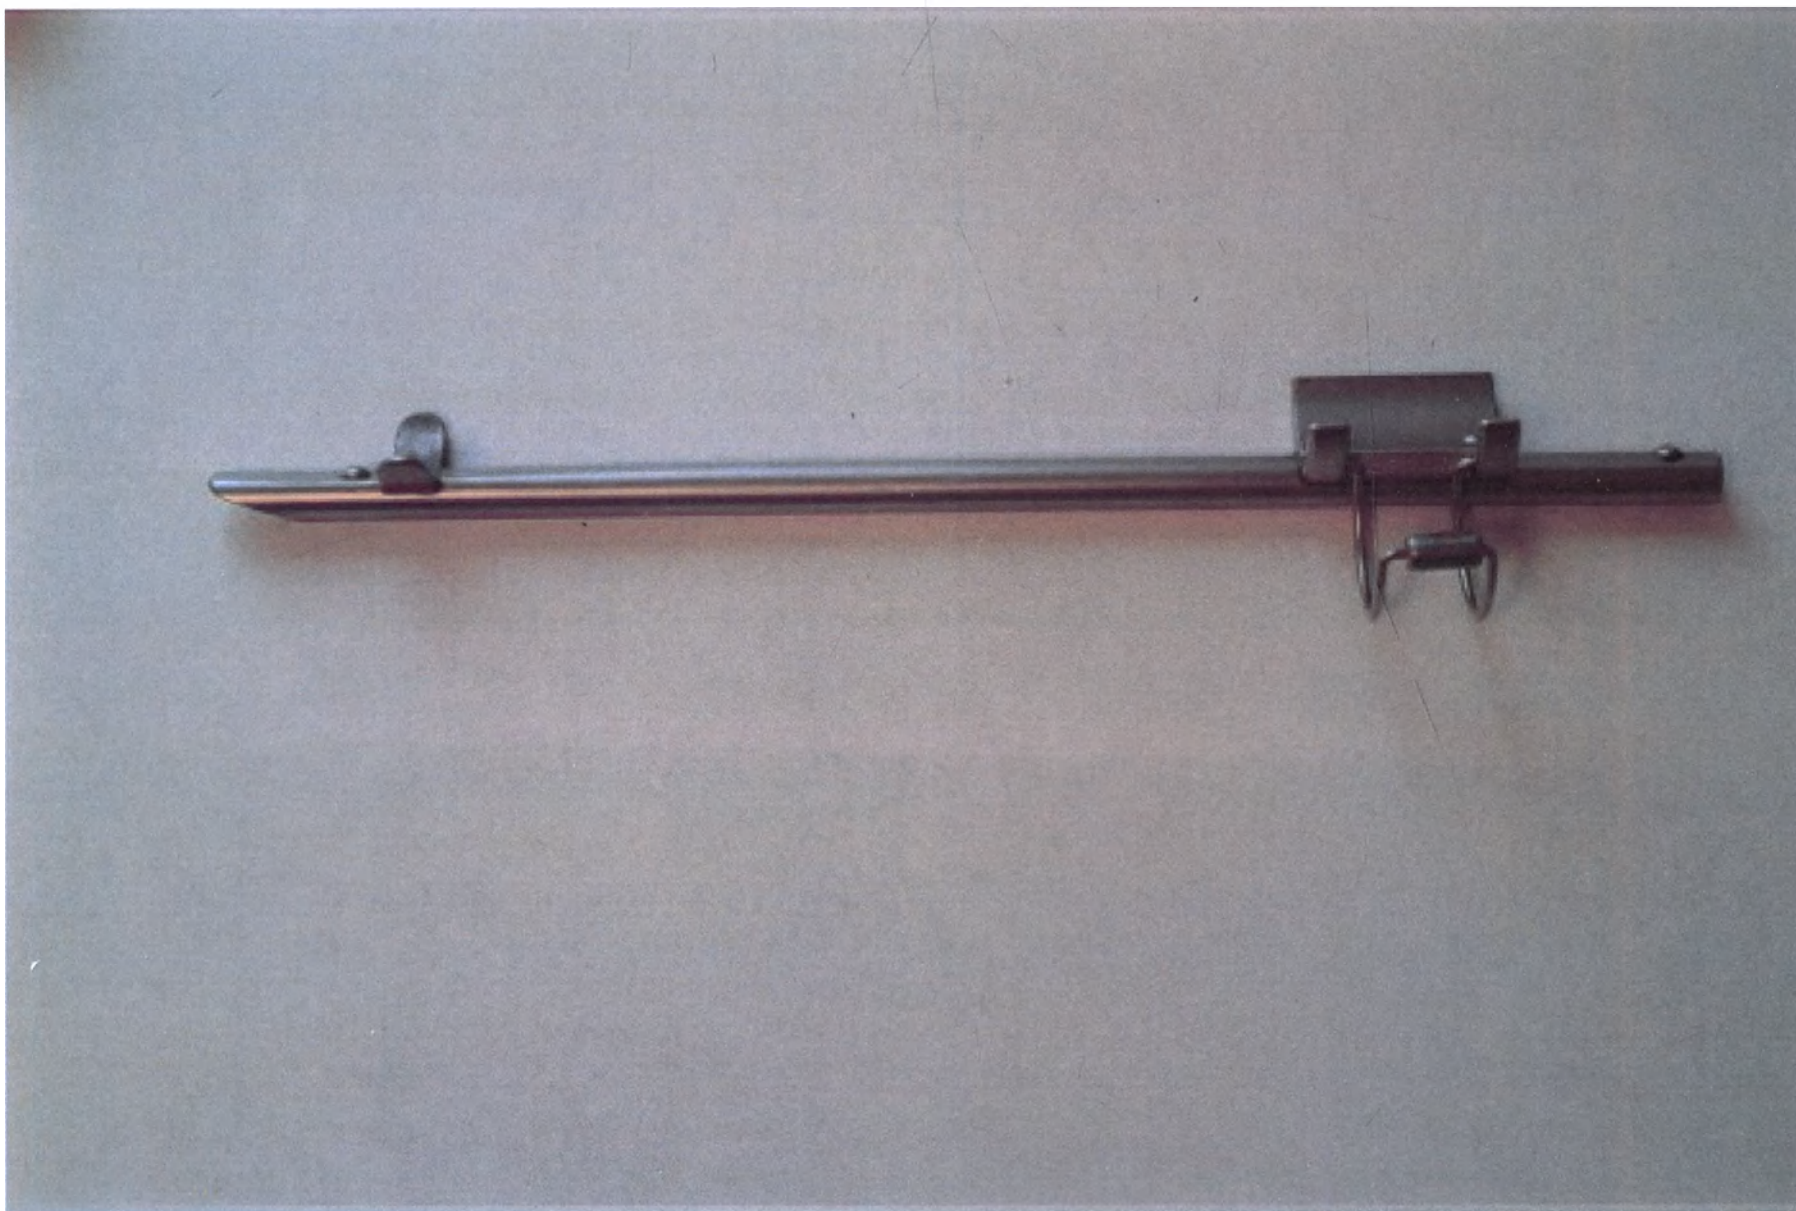


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1282; для датчика 9019 (общий вид)

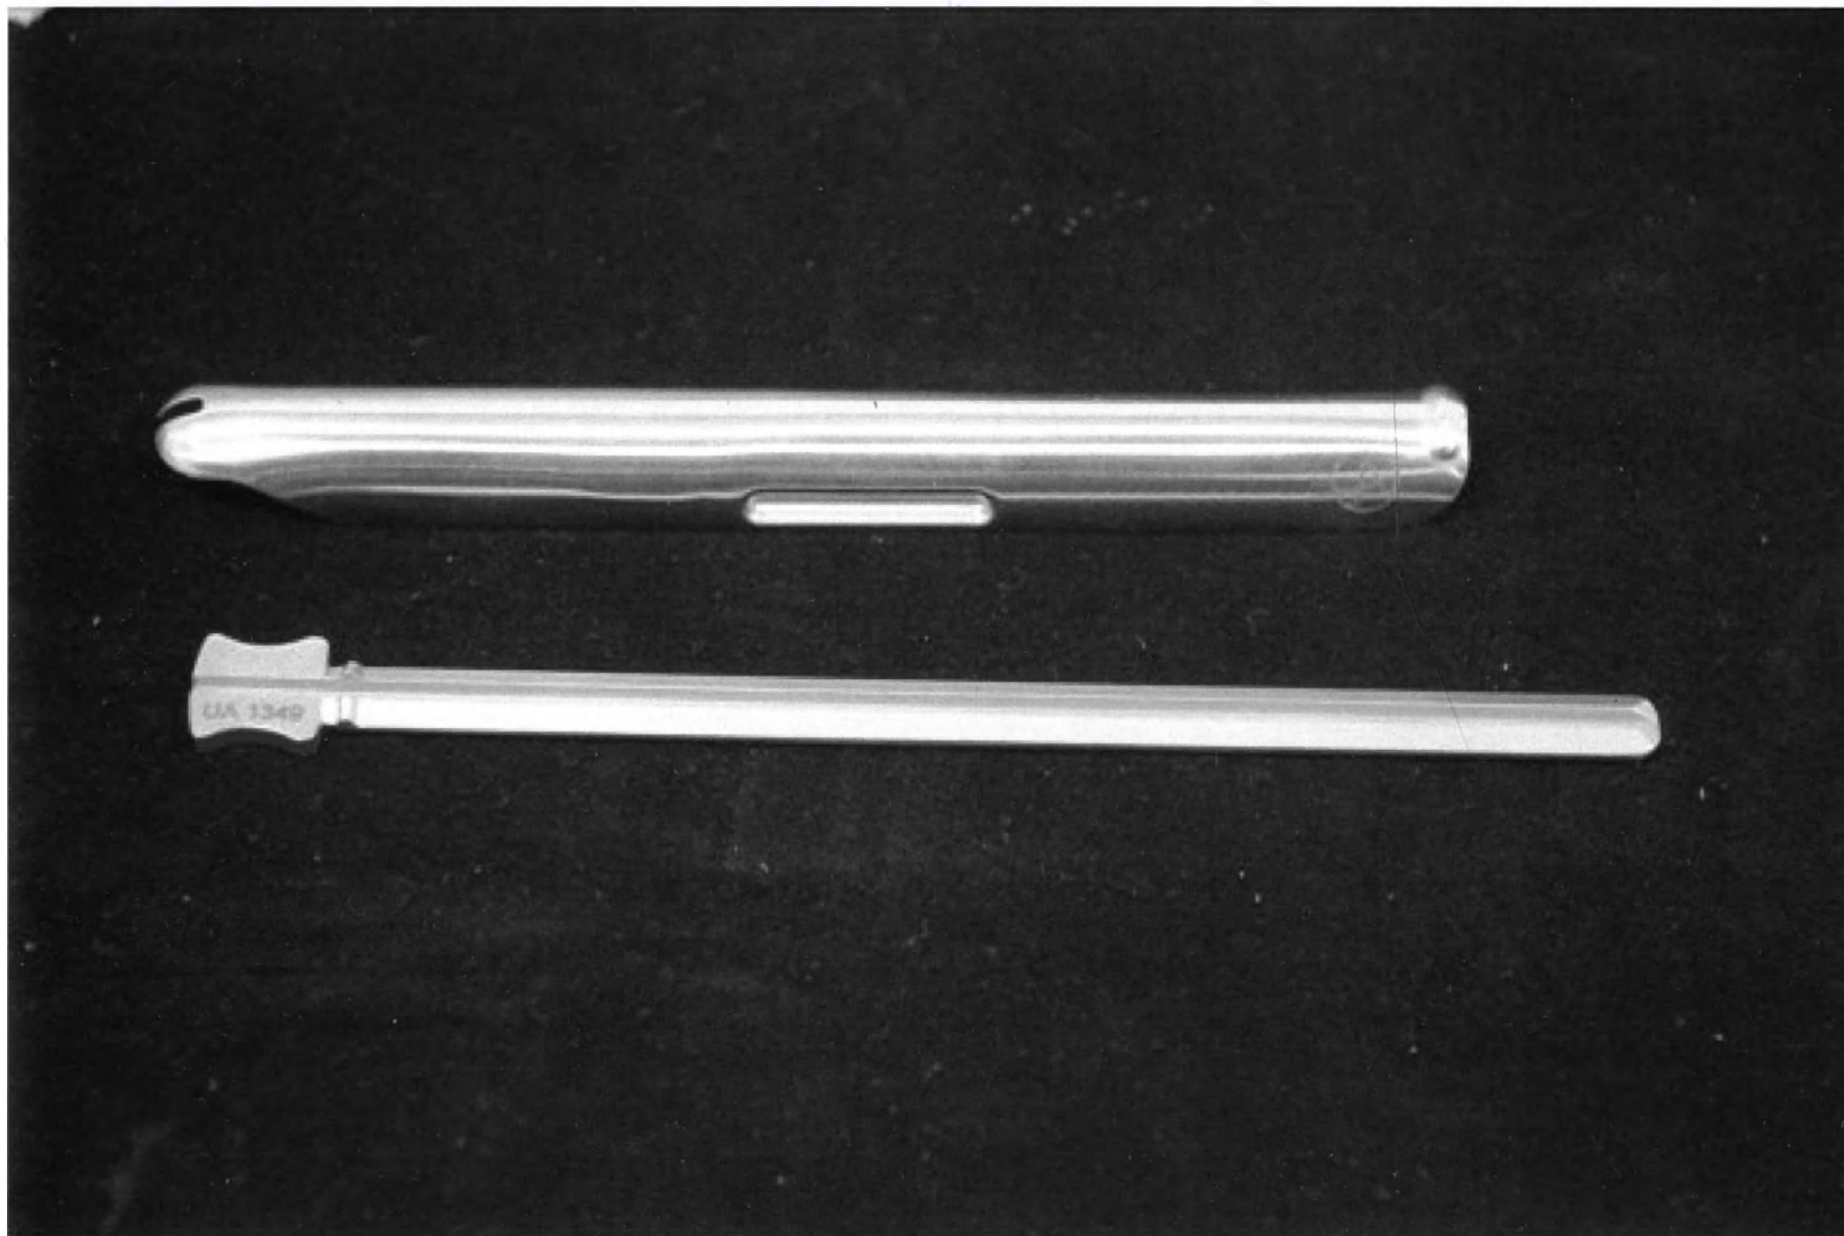


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1349 для датчика 9029 (общий вид)

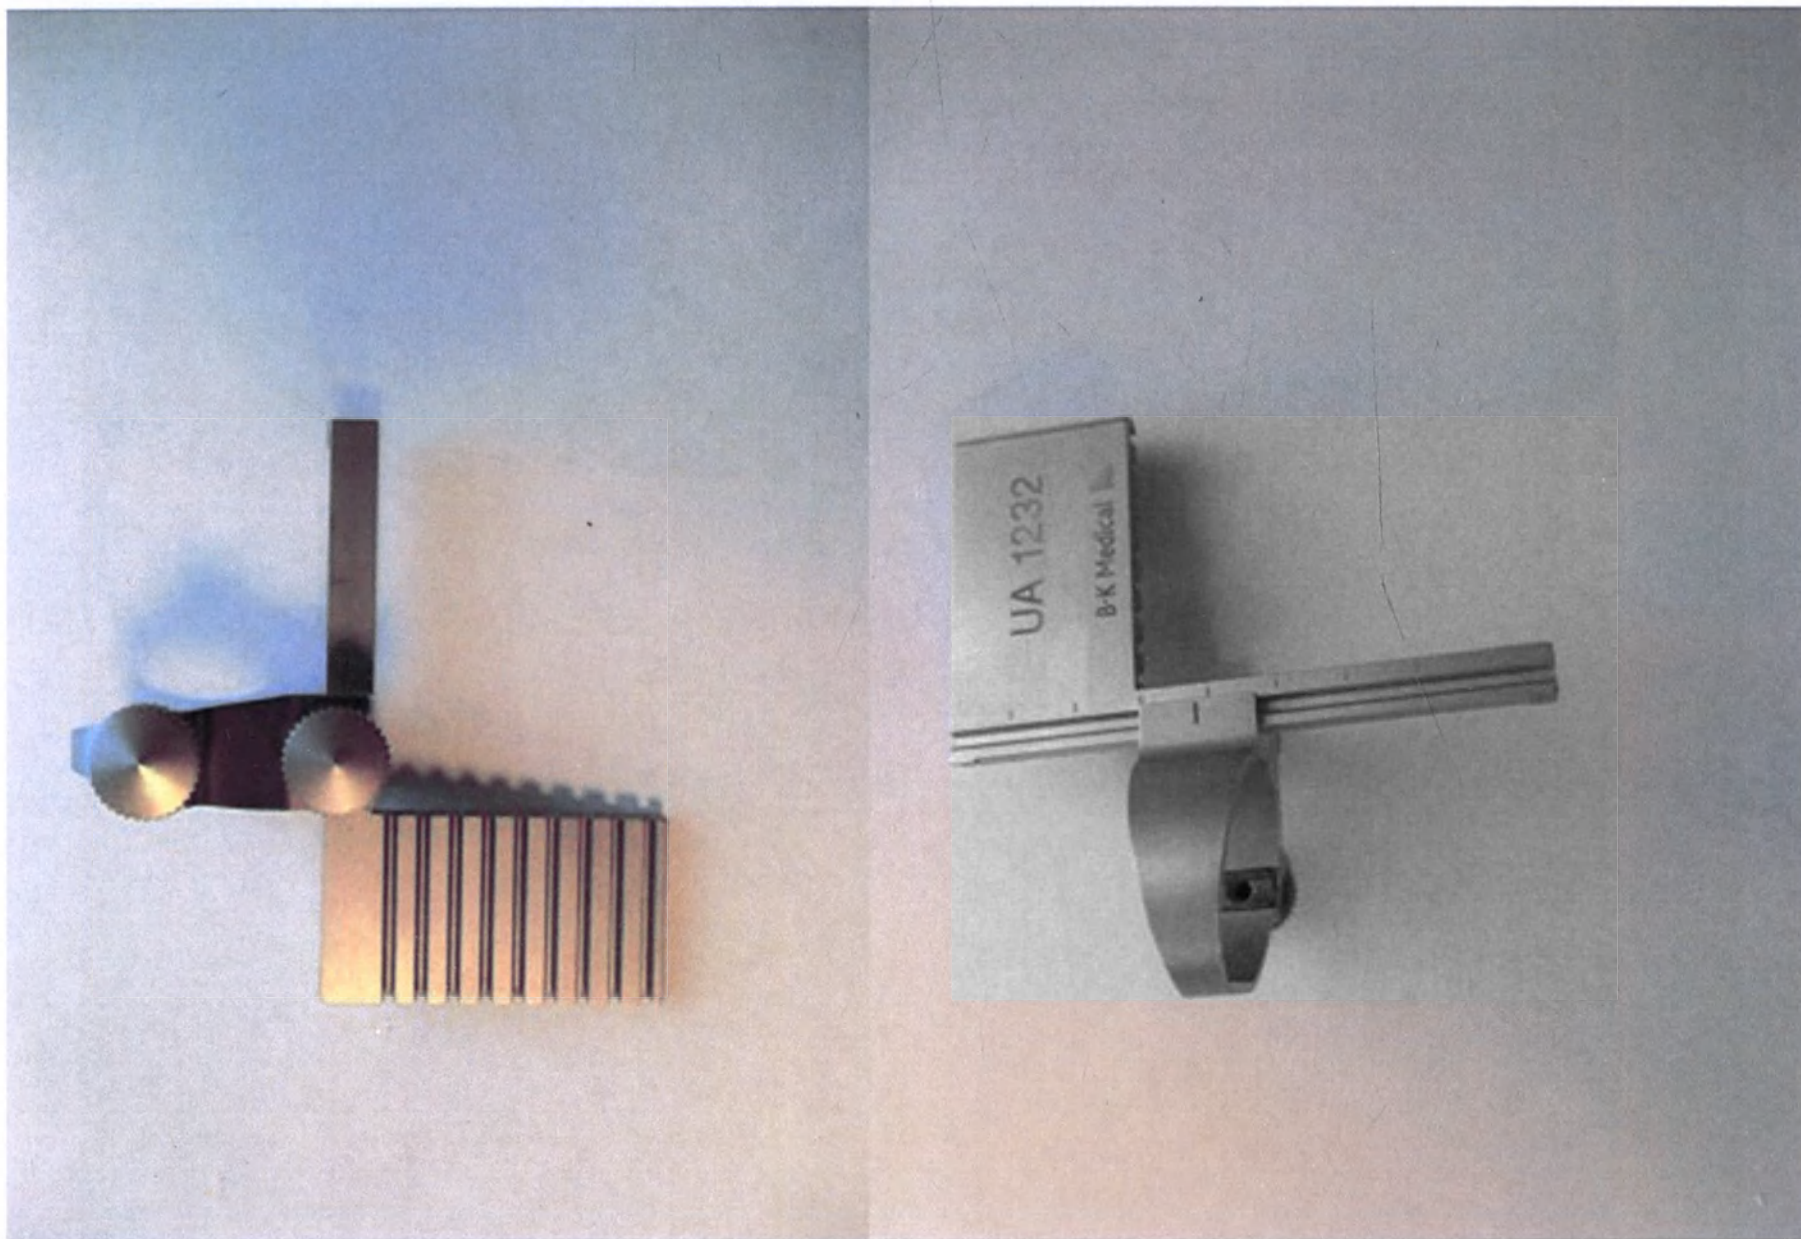


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1232 для датчика 9048 (общий вид)

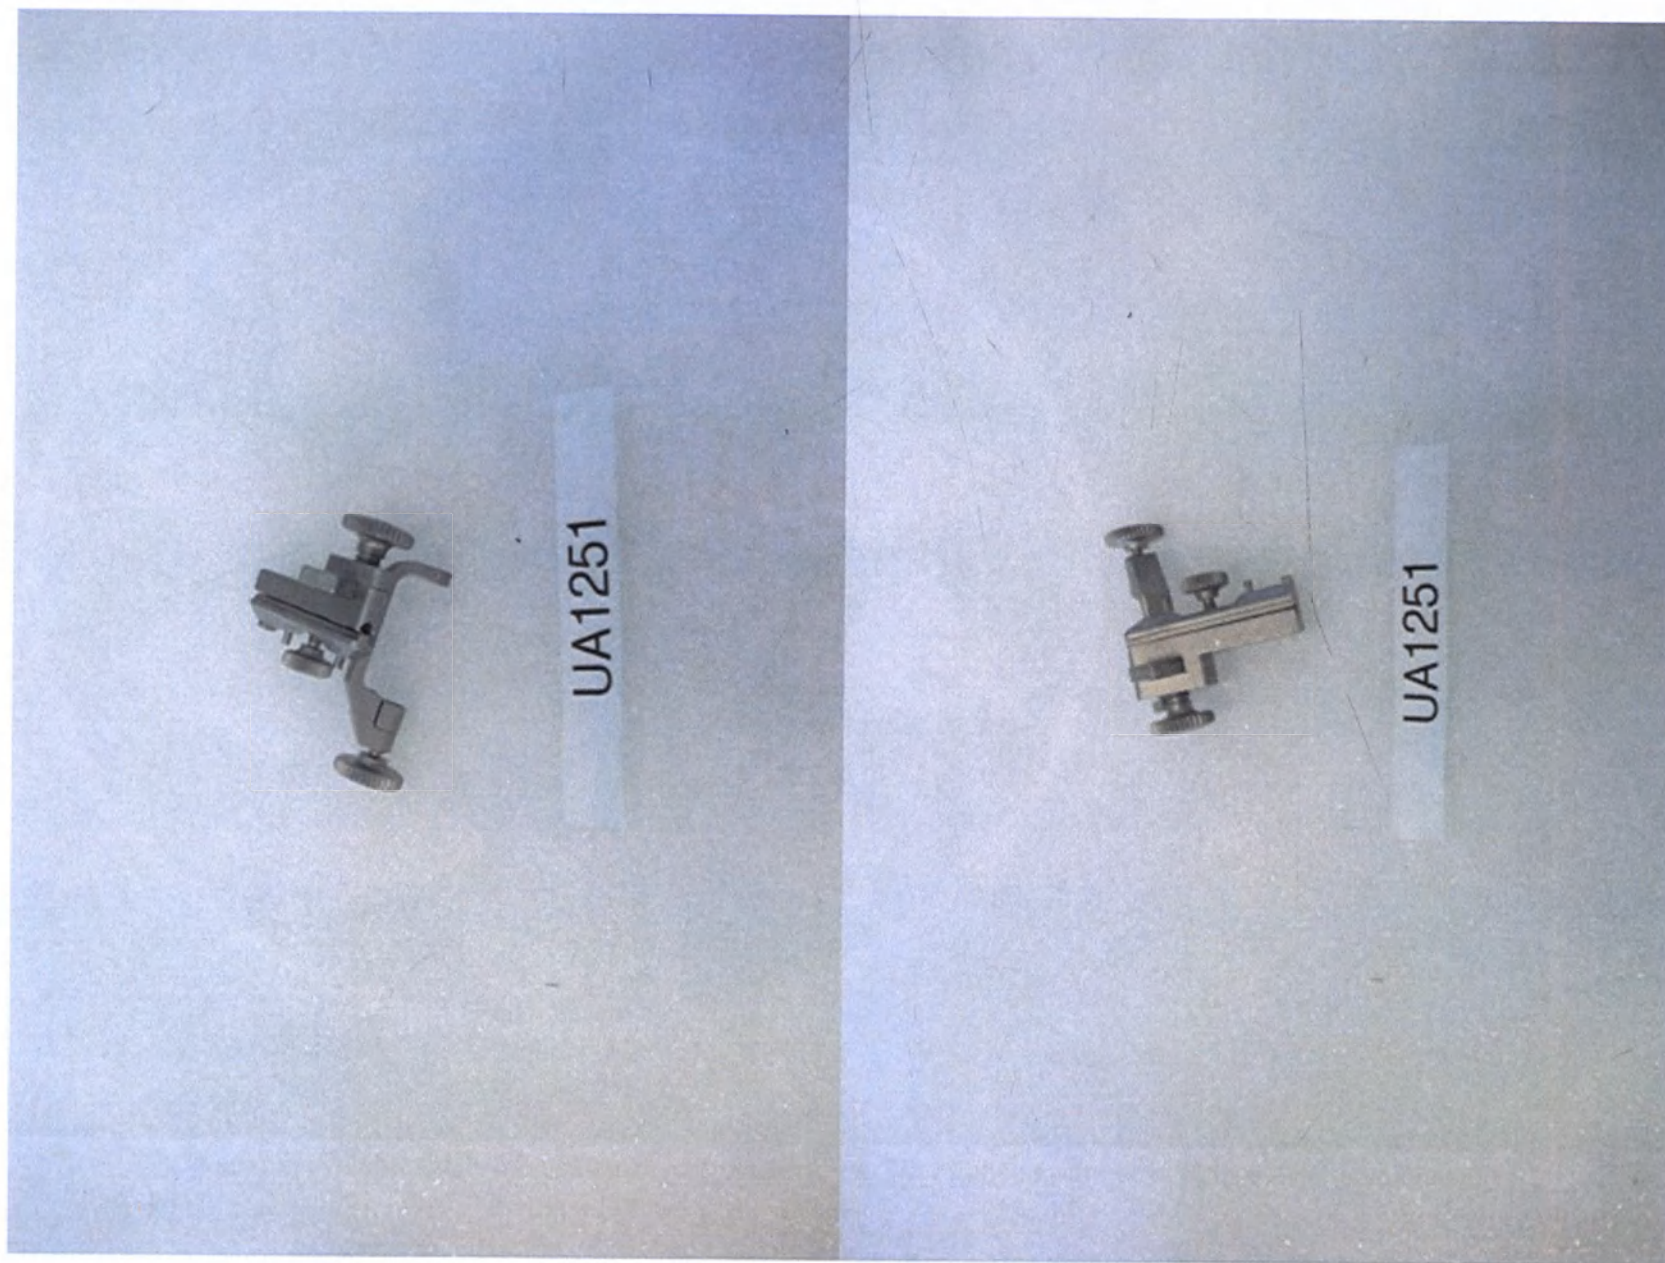


Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1251 для датчика 9070 (общий вид)

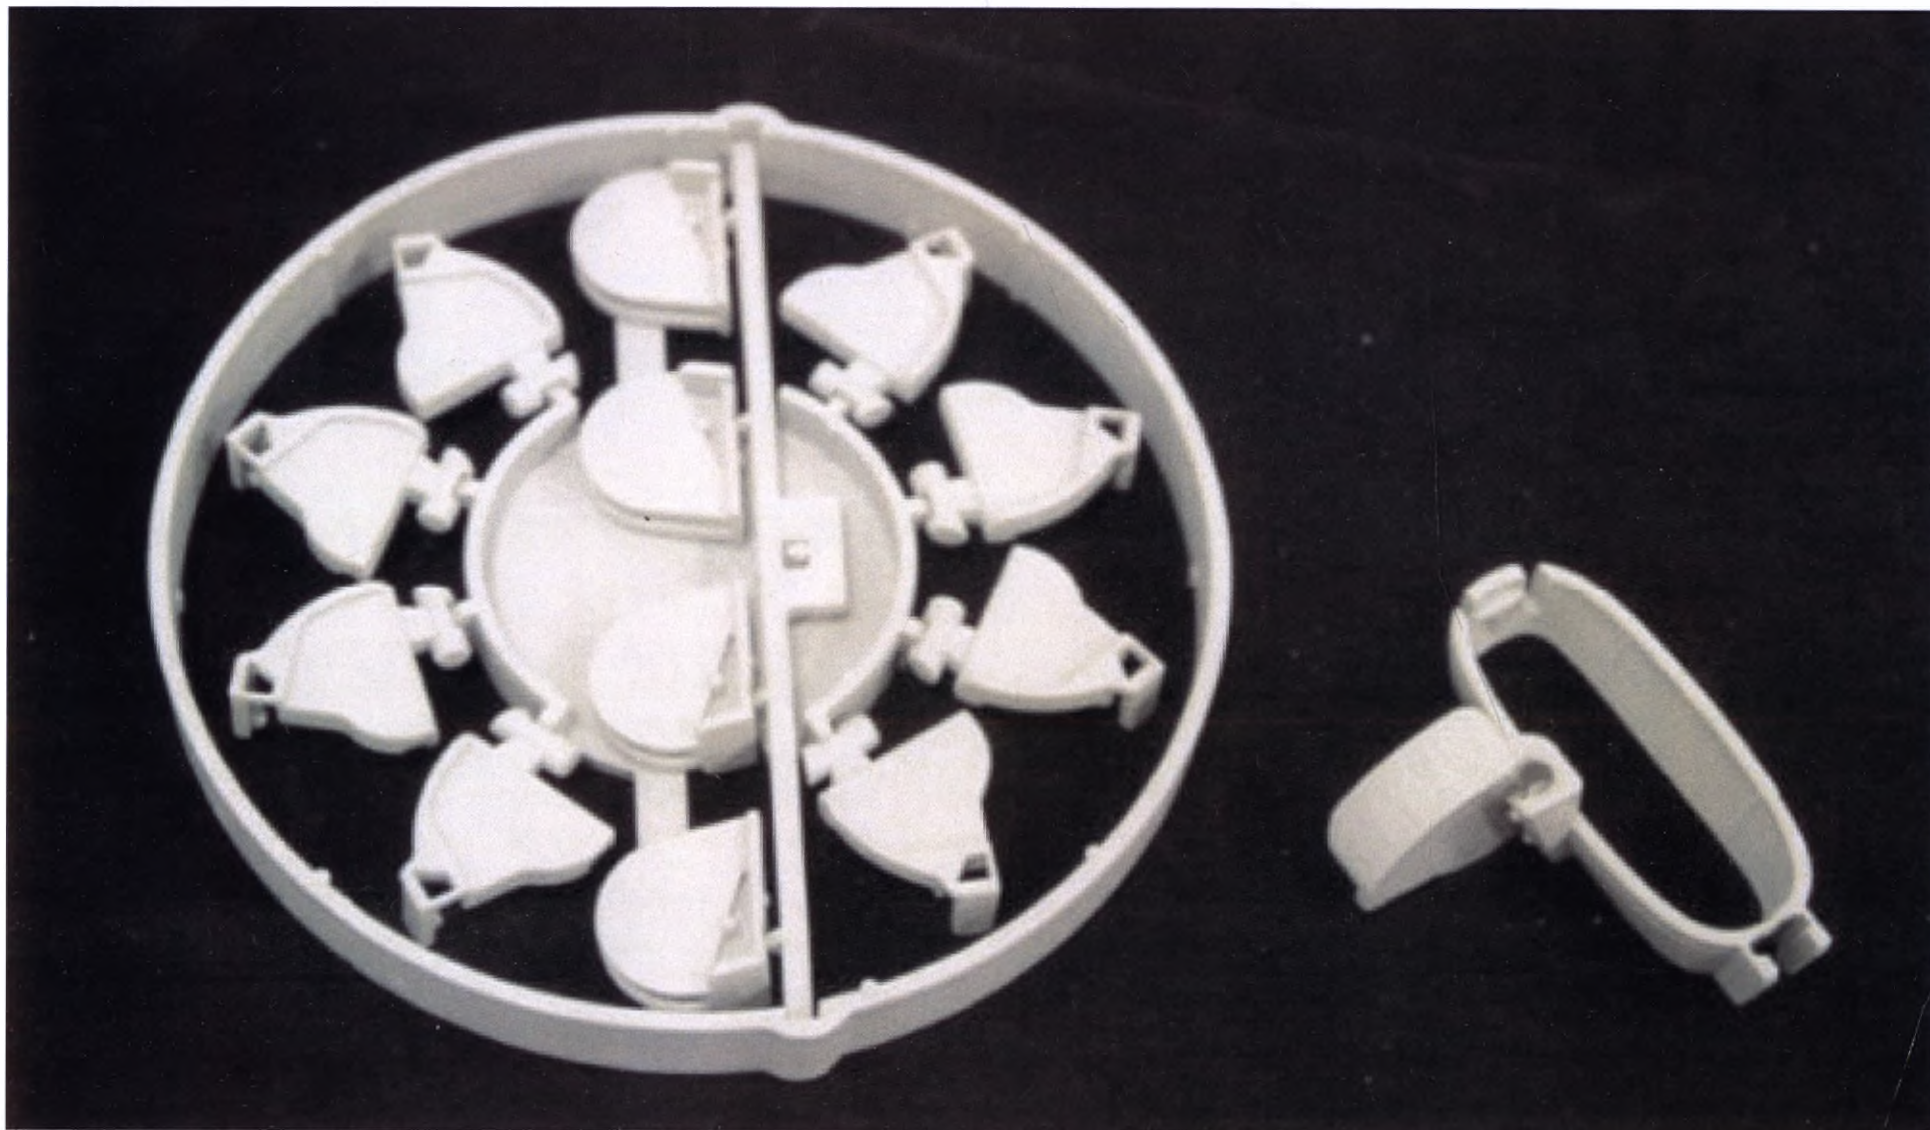


Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1338; для датчиков 9051 и 9086 (общий вид)

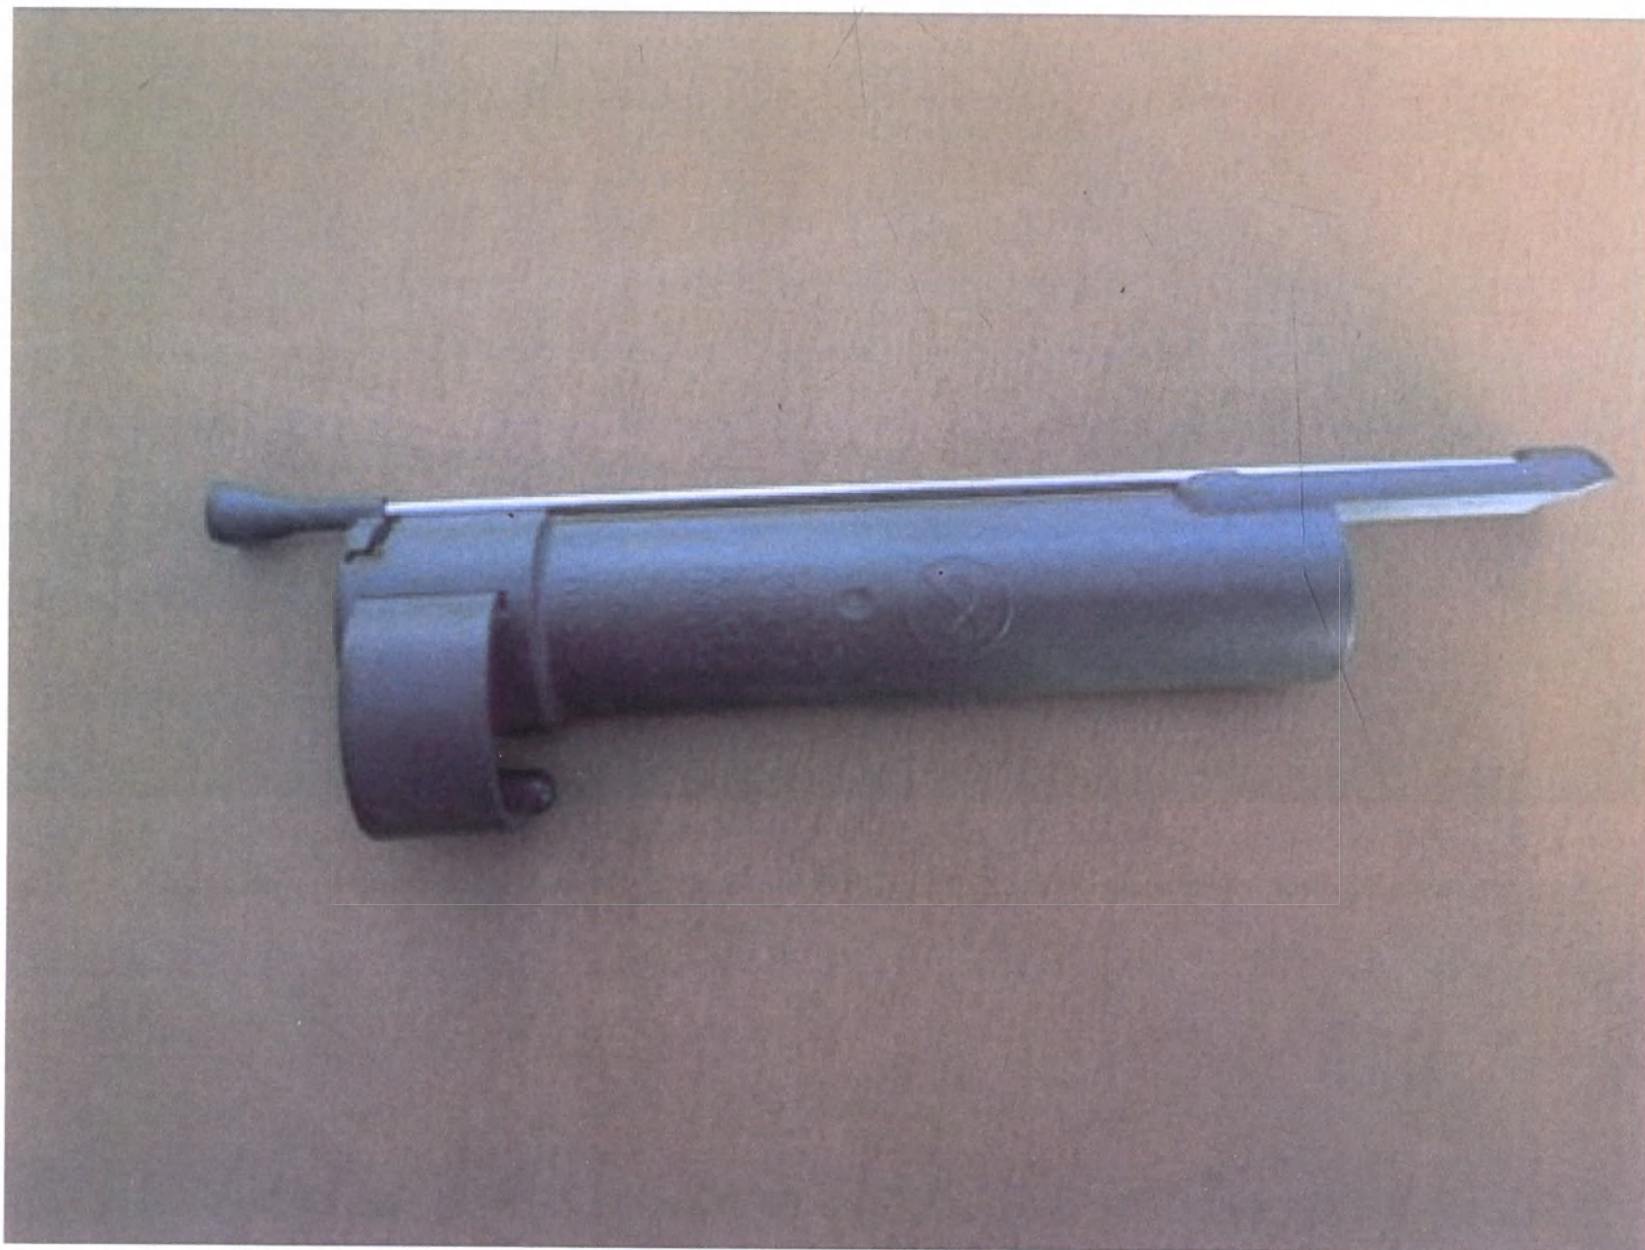

Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1323-S; для датчика 9018 (общий вид)

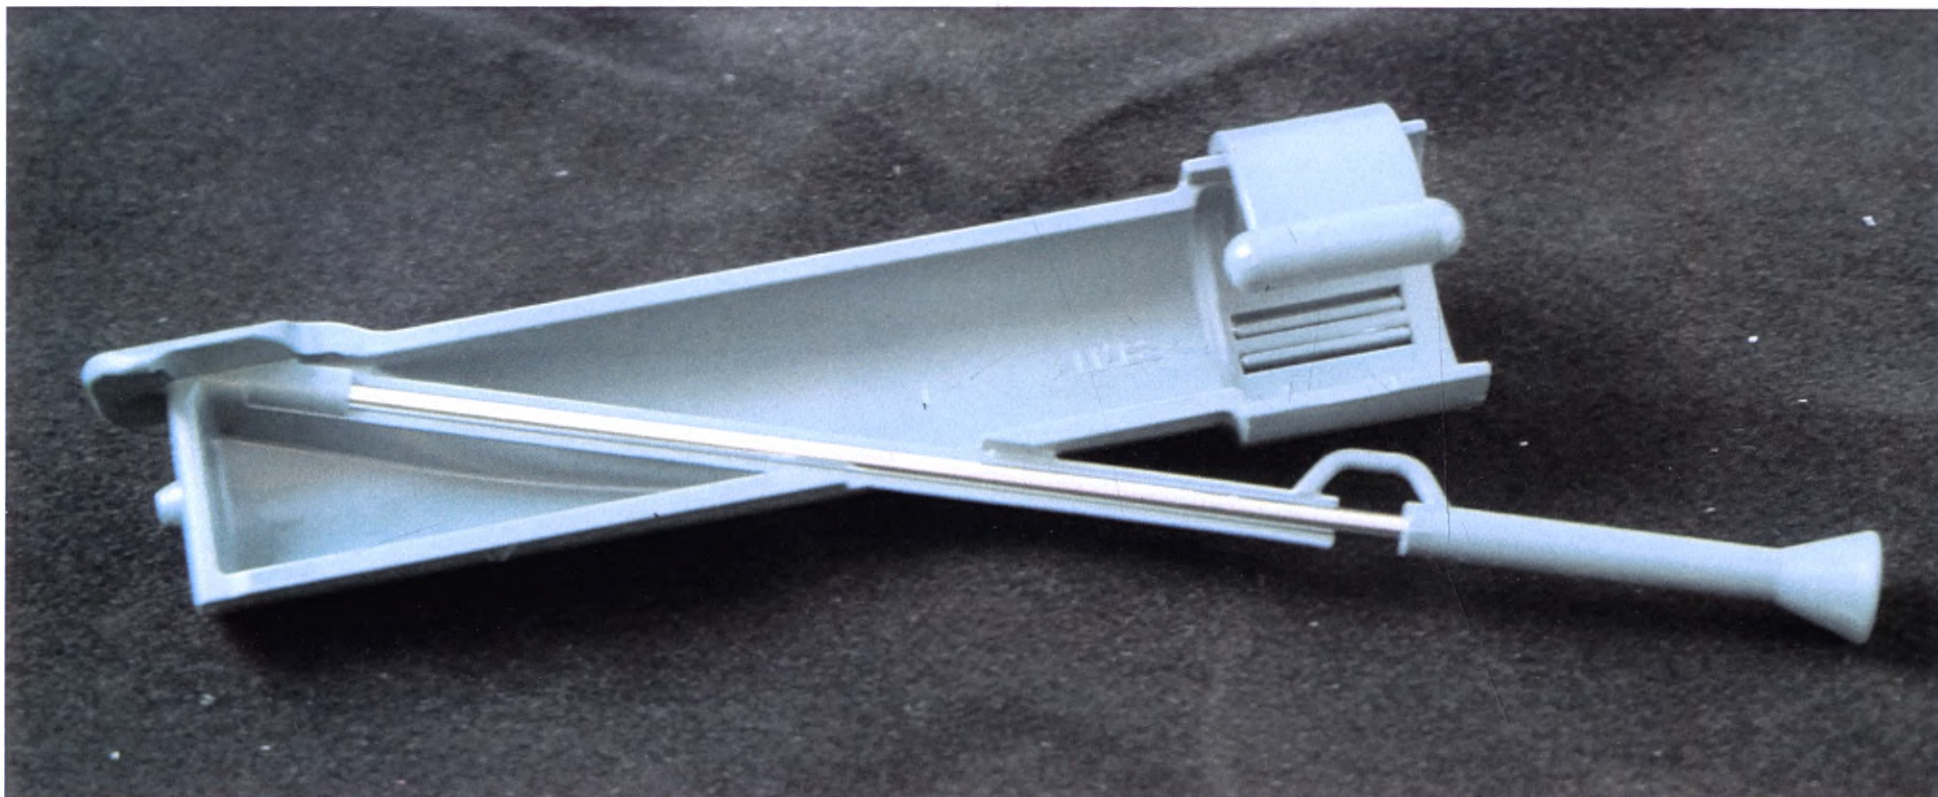

Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1322-S; для датчиков 9008 и 9018 (общий вид)

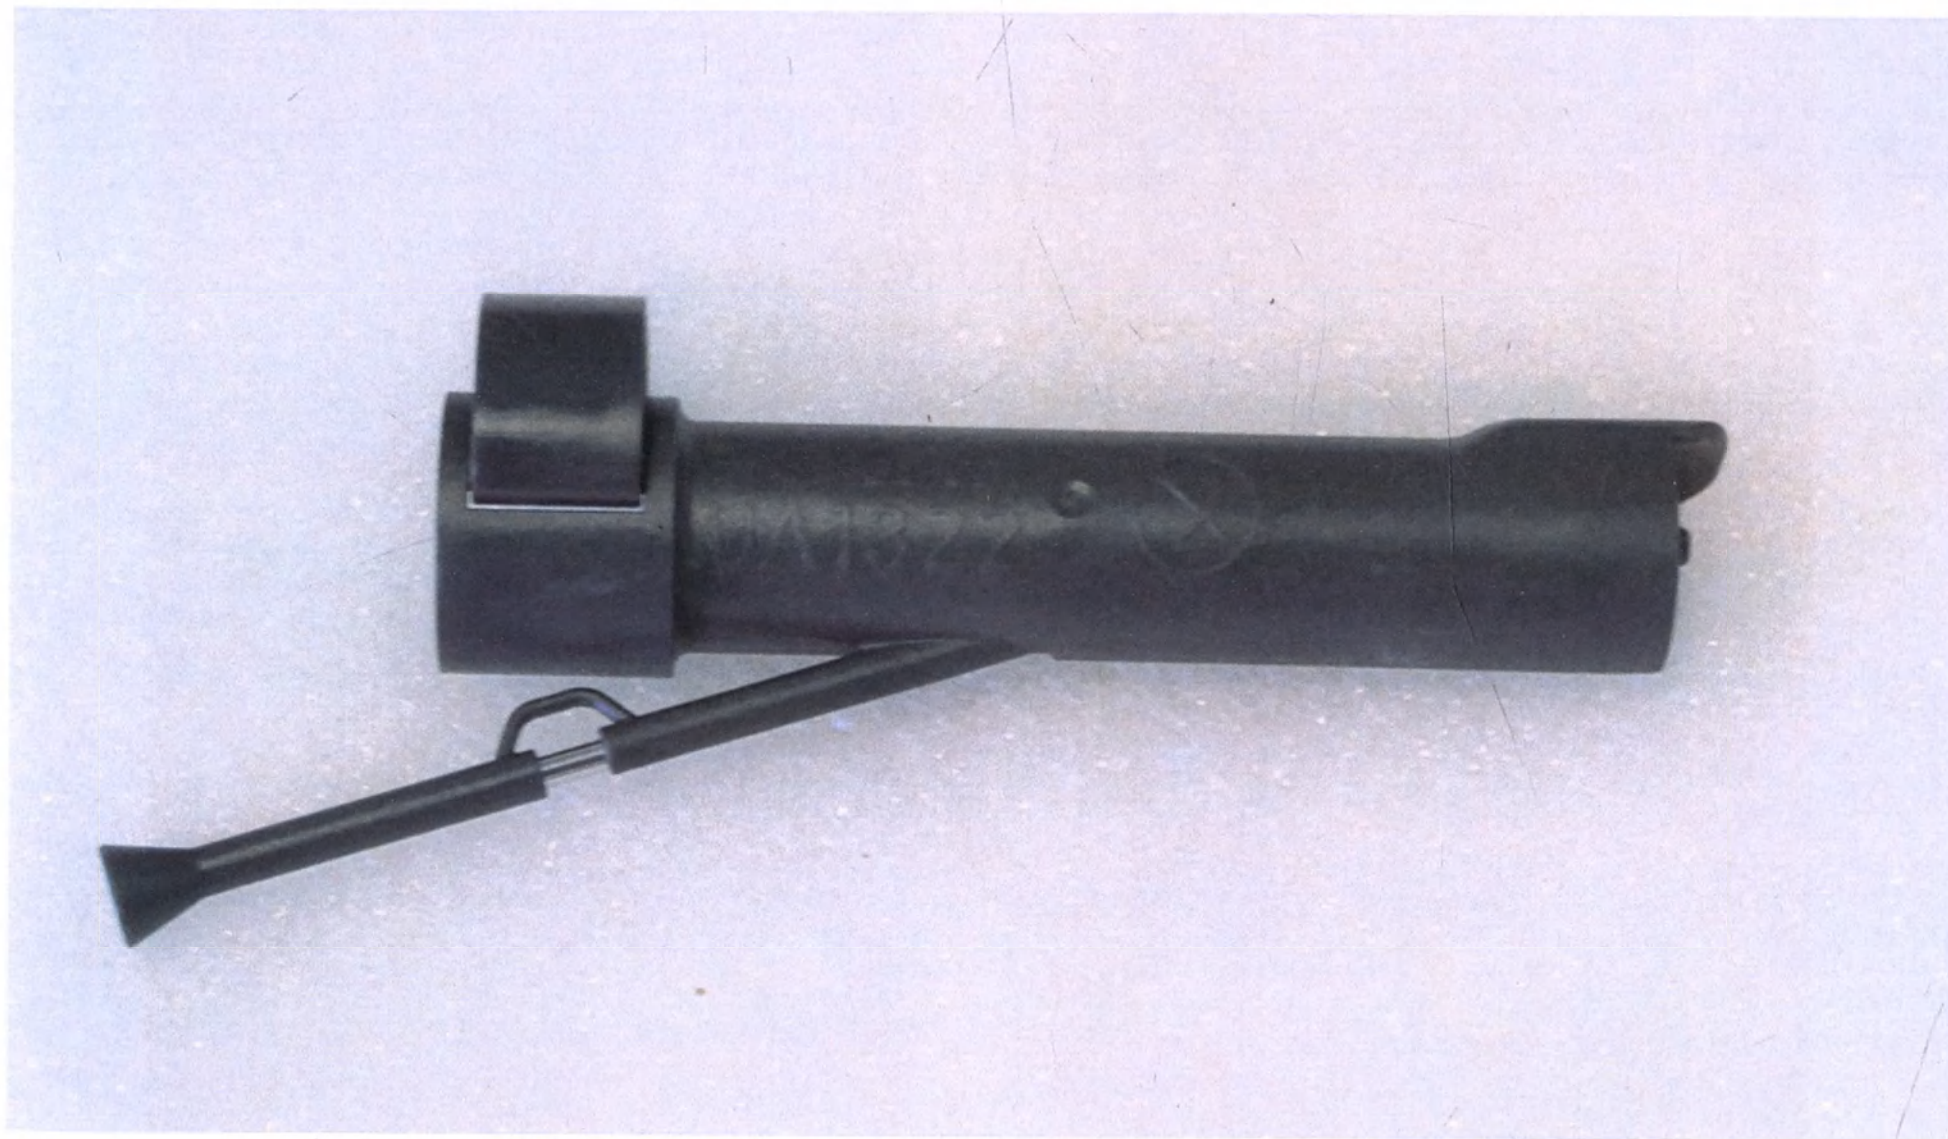


Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1322-S14; для датчиков 9008 и 9018 (общий вид)




Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1329-S; для датчика 9018 (общий вид)




Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1339; для датчика 9029 (общий вид)

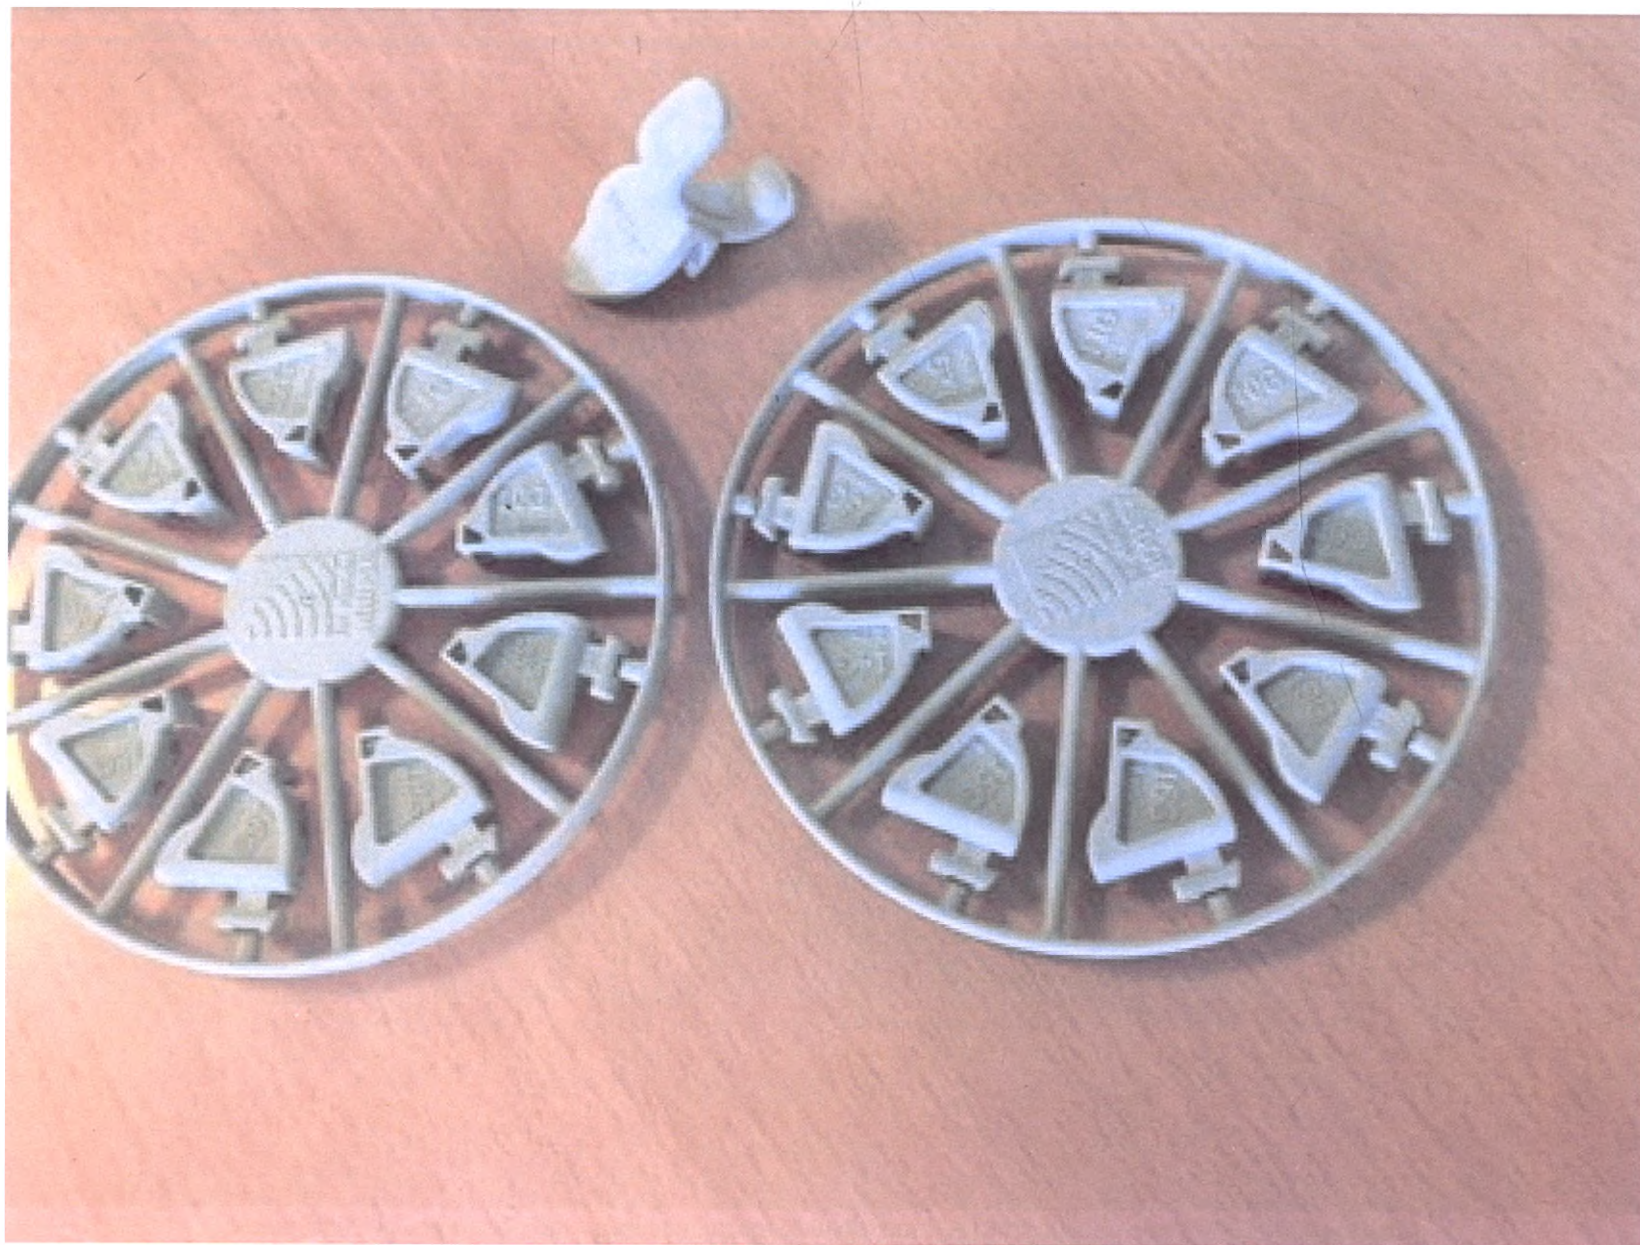


Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1344 для датчика 9085 (общий вид)

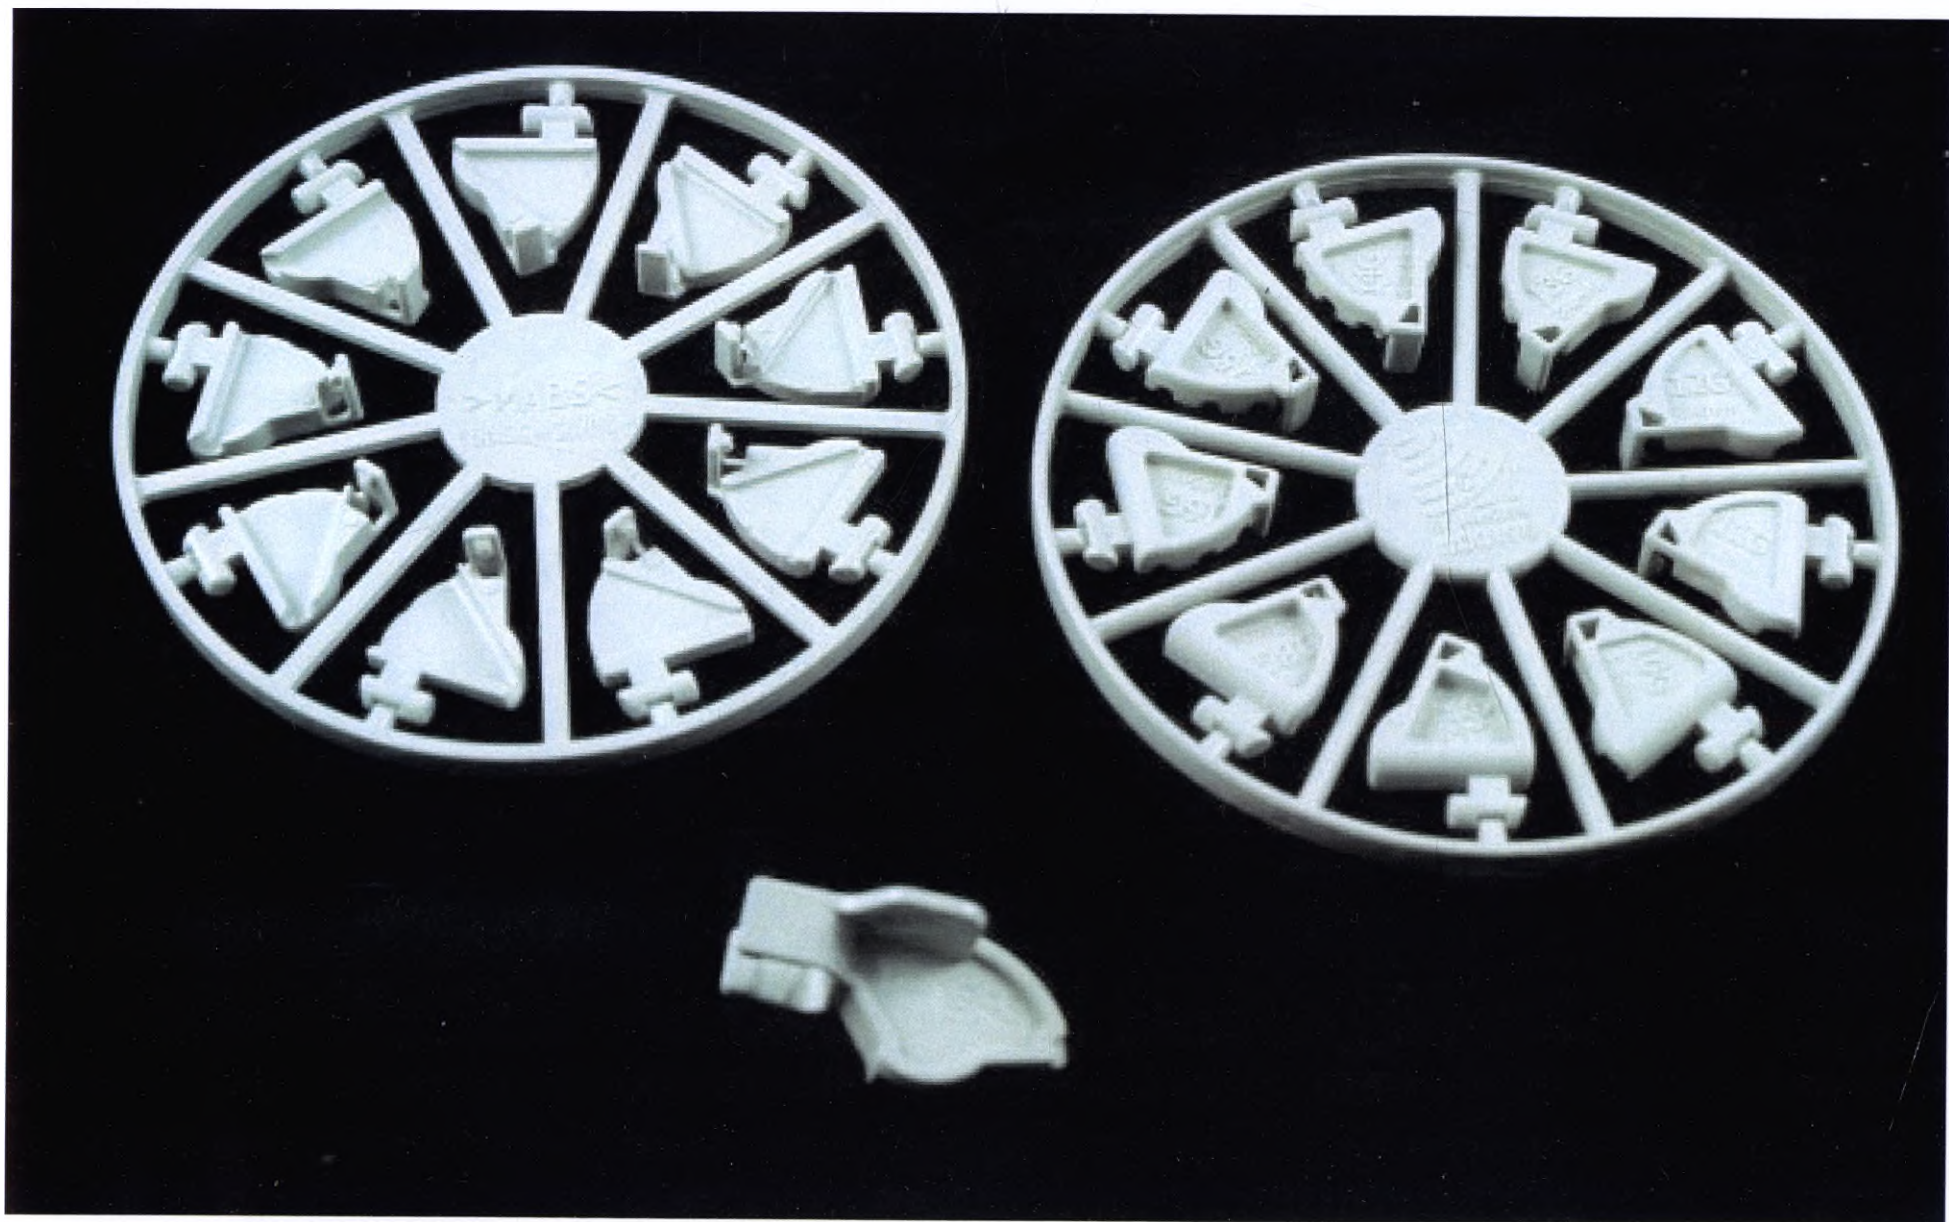


Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1345; для датчика 9062 (общий вид)

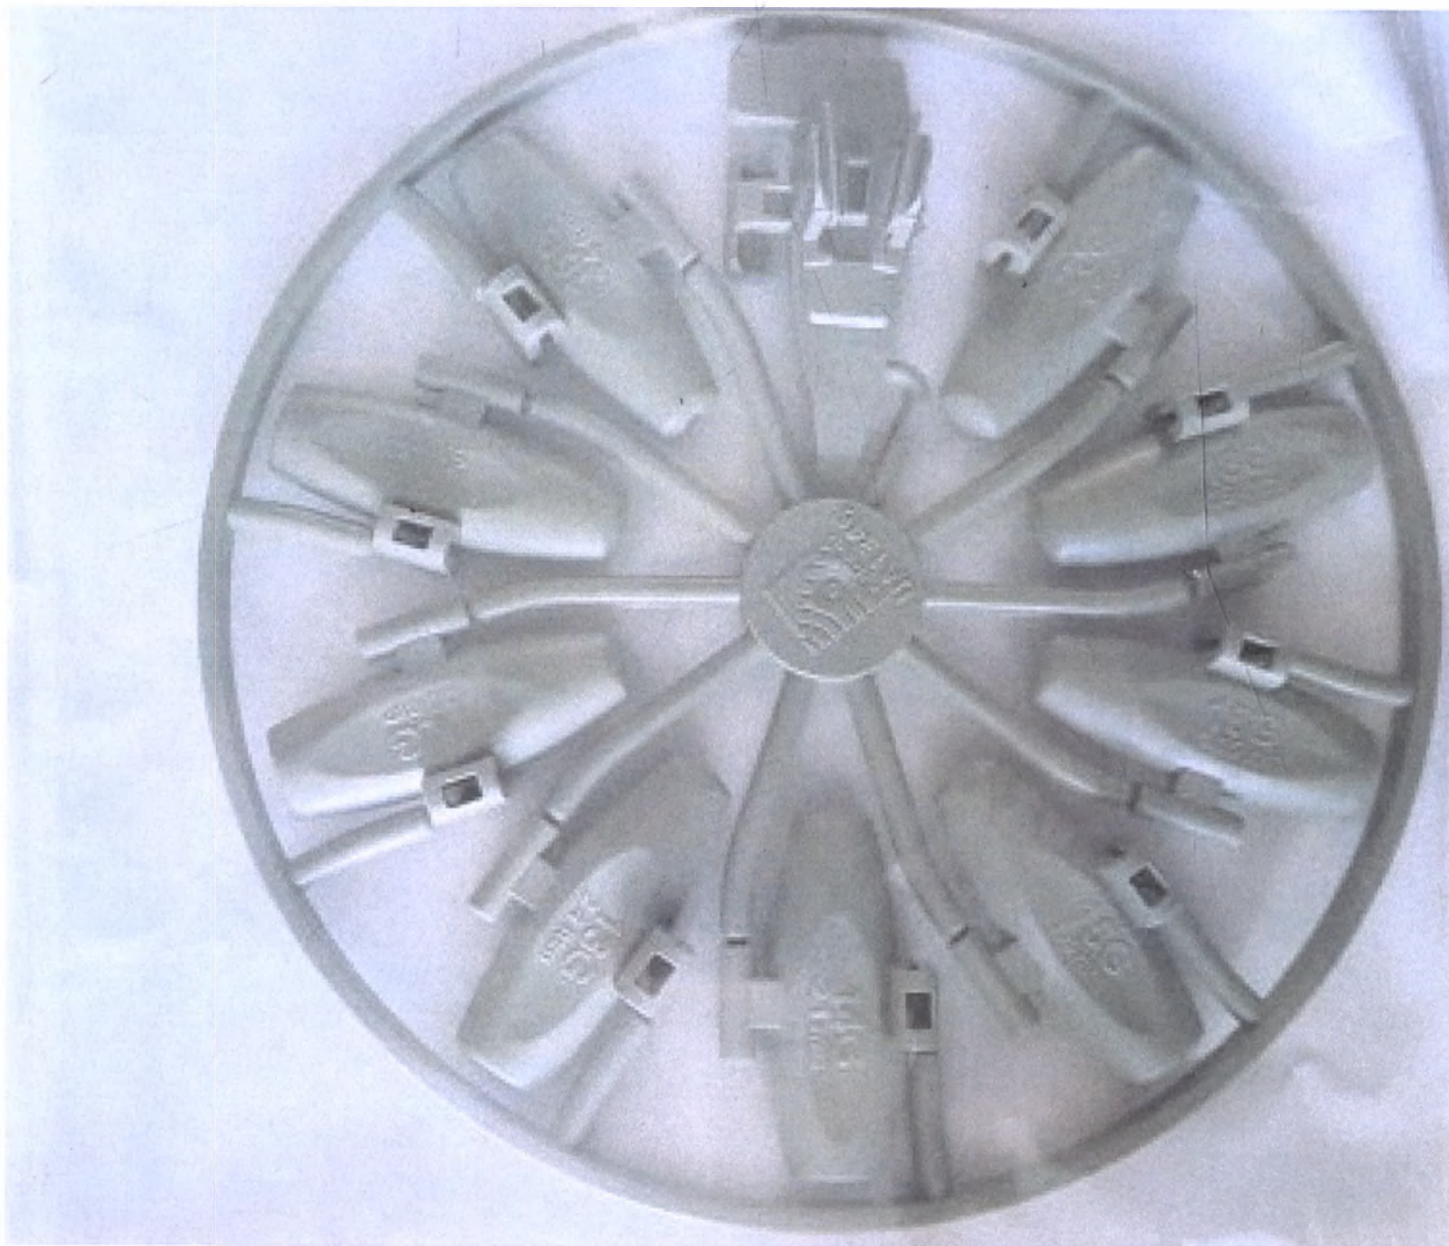

Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1346; для датчика 9063 (общий вид)

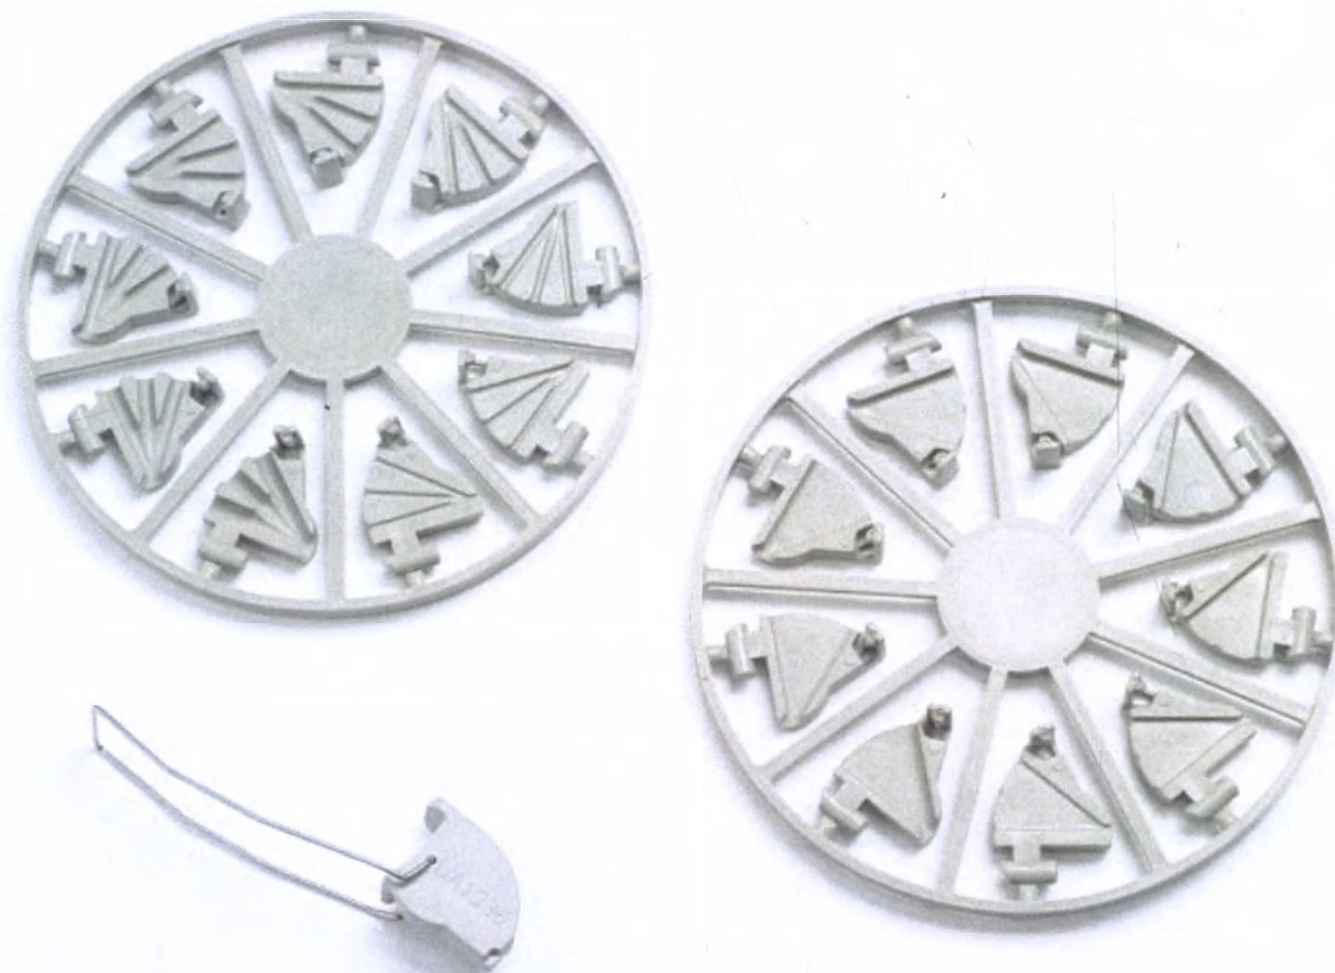


Адаптер функциональный, одноразовый, стерильный, тип UA1336; для датчика 9015 (общий вид)

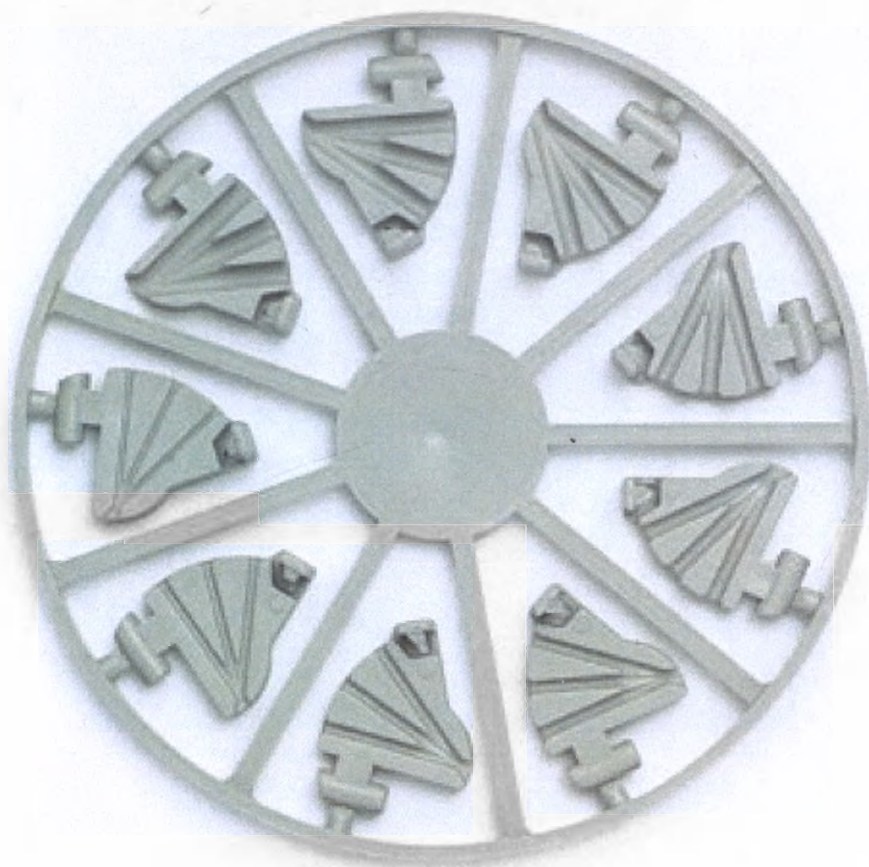

Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1337; для датчика 9024 (общий вид)



Кольцо для фиксирования презерватива на датчике 9052, тип UA0671 (общий вид)

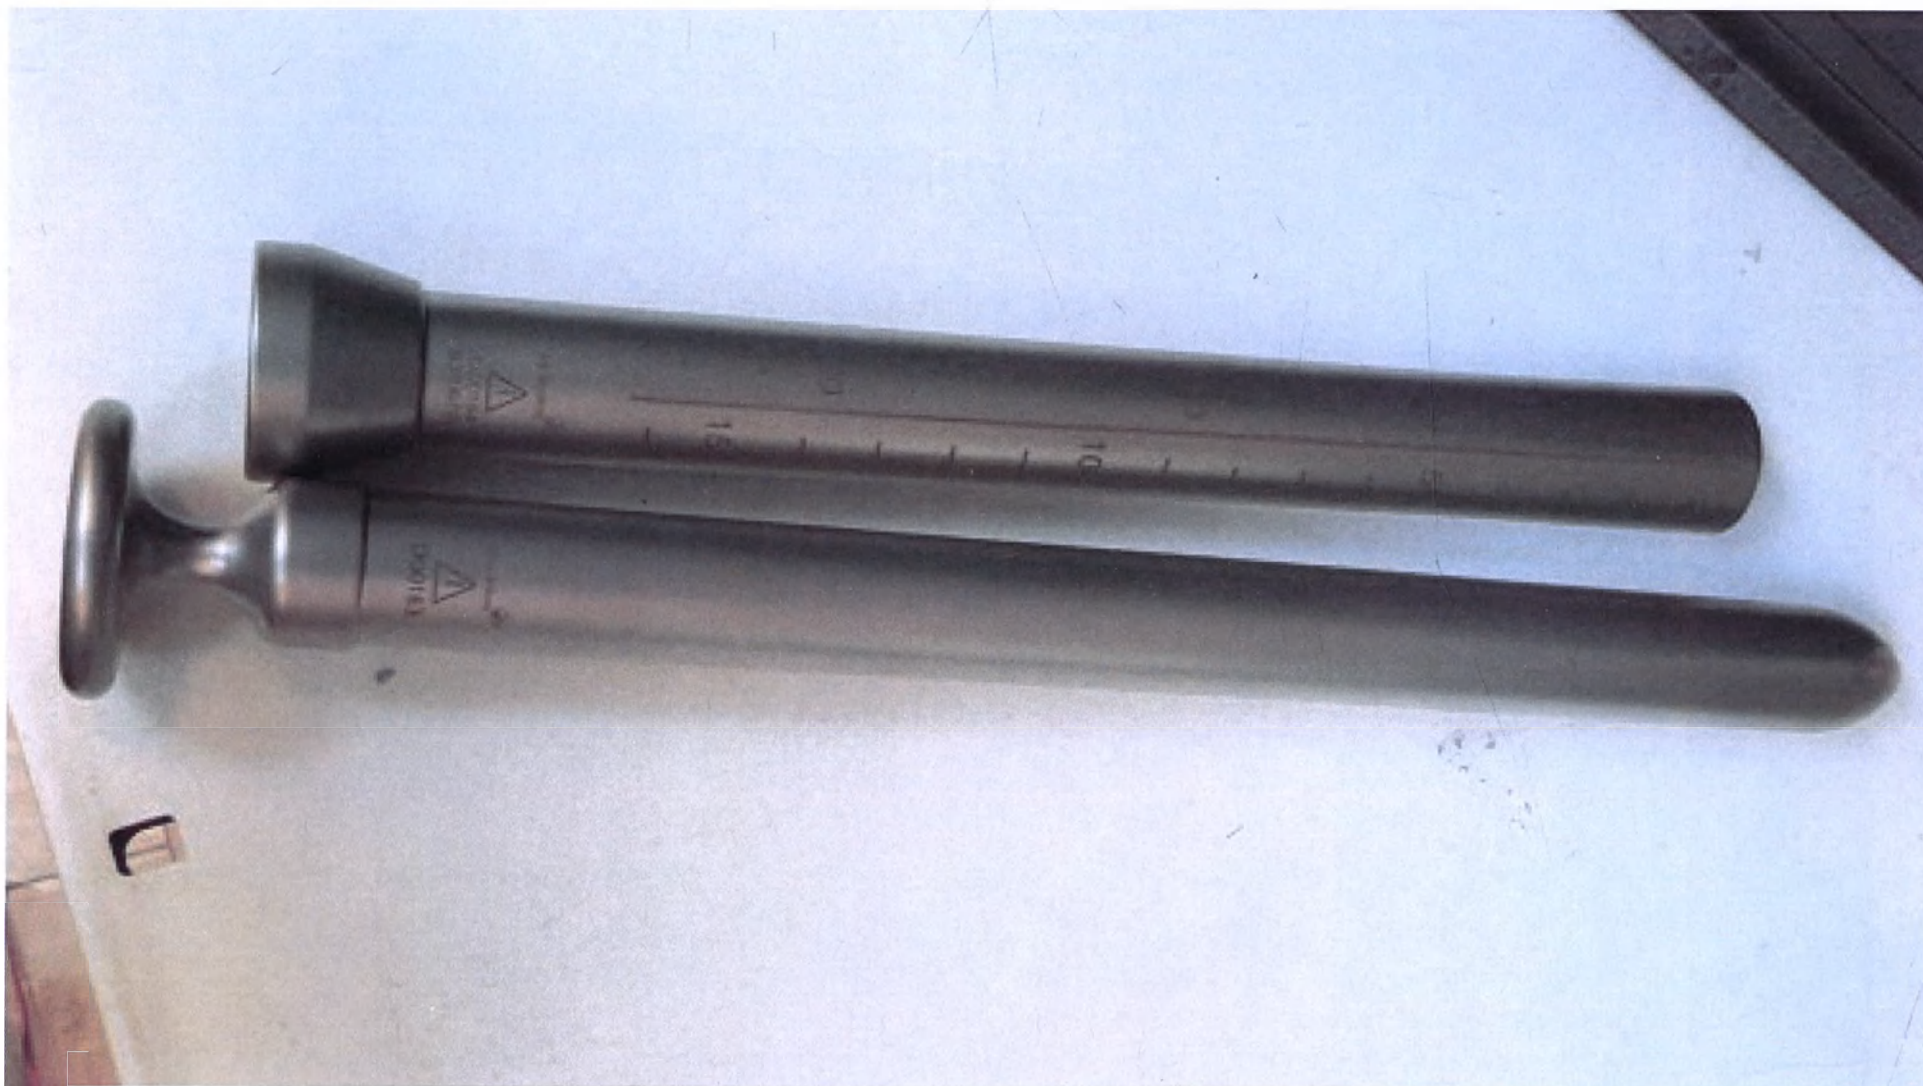

Ректосигмоидоскоп с obtуратором, тип UA0672 (общий вид)



Ректосигмоидоскоп с обтуратором, тип UA0673 (общий вид)



Сенсор Электромагнитный, тип UA2371 (общий вид)



Зажим для Сенсора Электромагнитного, тип UA2377 (общий вид)




Зажим для Сенсора Электромагнитного, тип UA2399 (общий вид)




Зажим для Сенсора Электромагнитного, тип UA2378 (общий вид)



Держатель для датчиков полостных, тип UA2357 (общий вид)

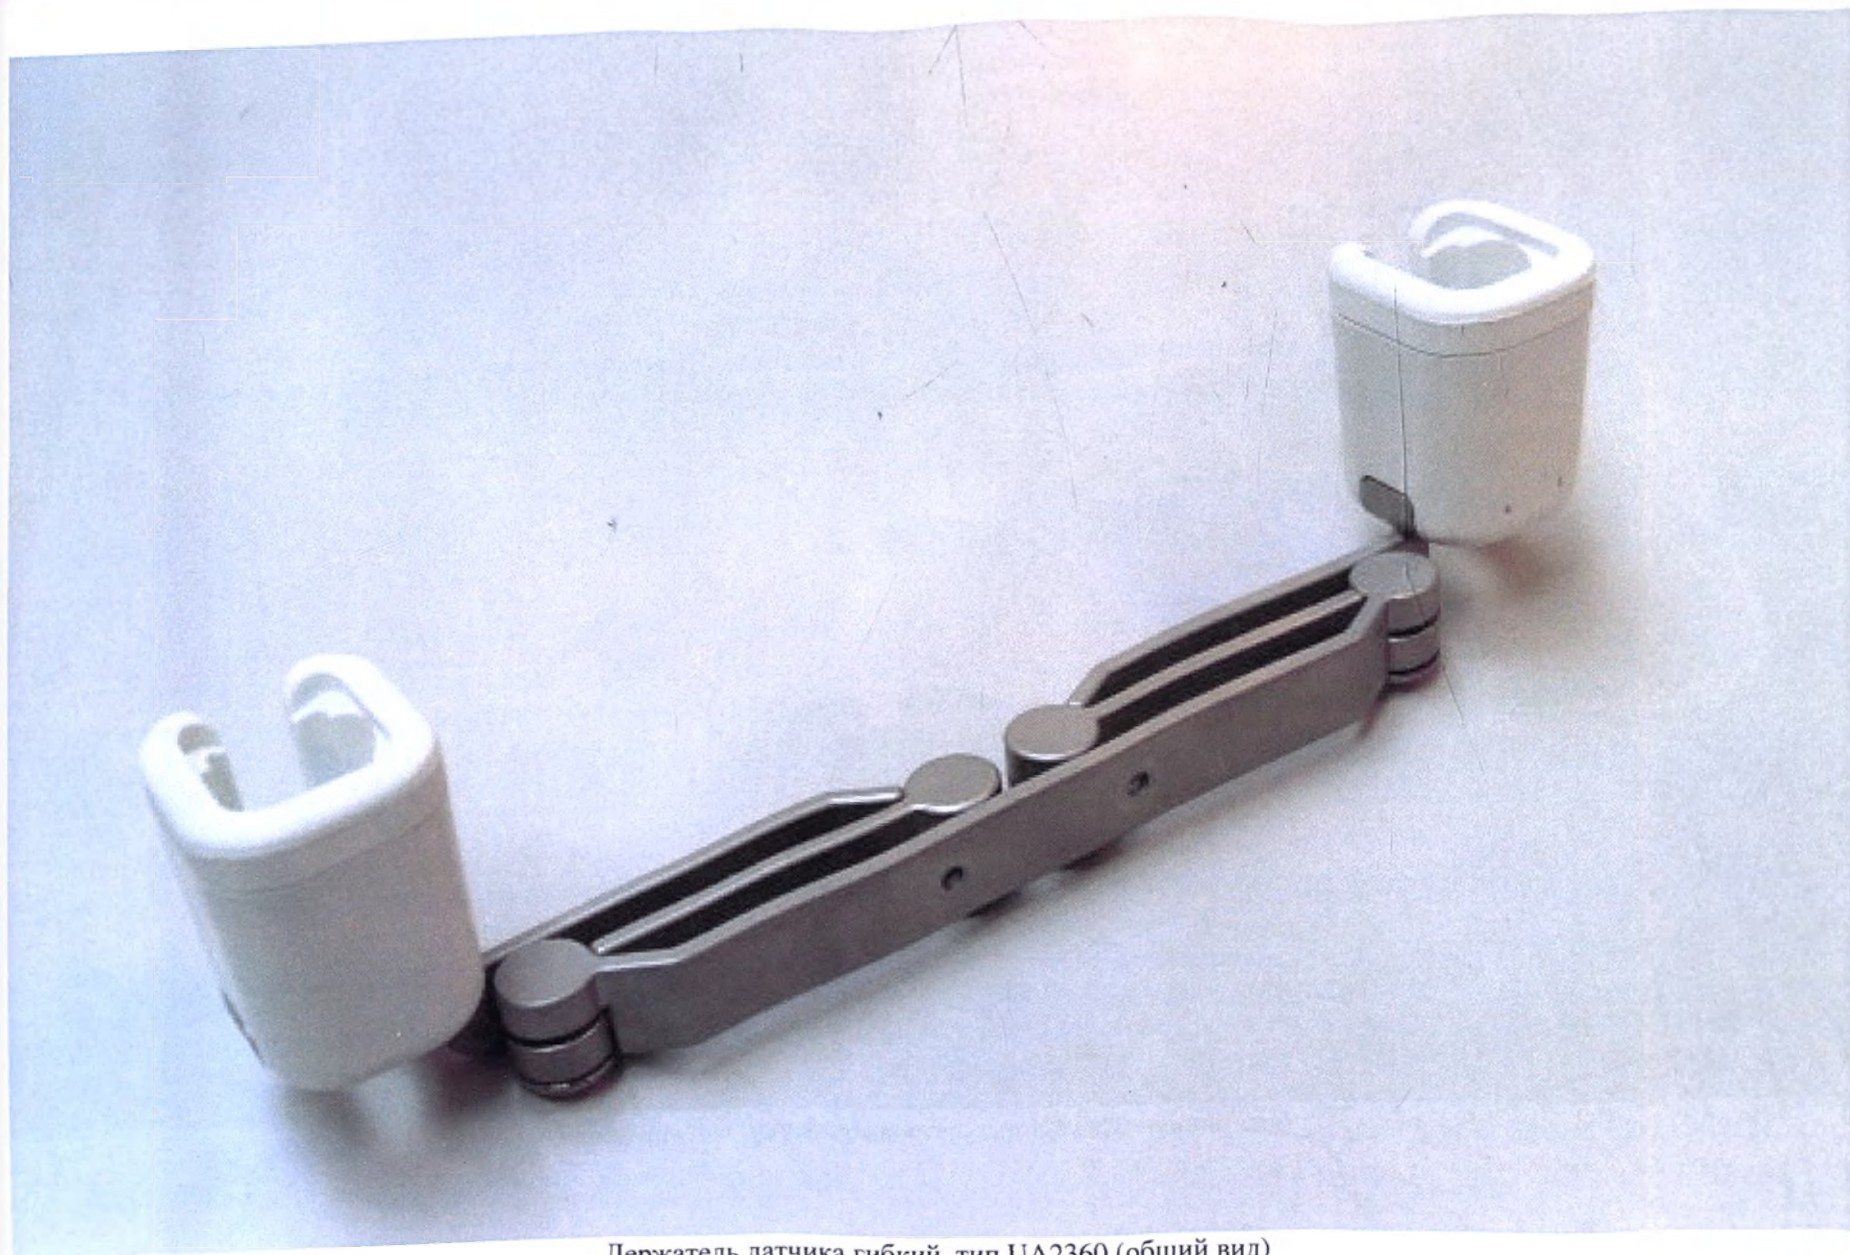


Держатель датчика гибкий, тип UA2360 (общий вид)

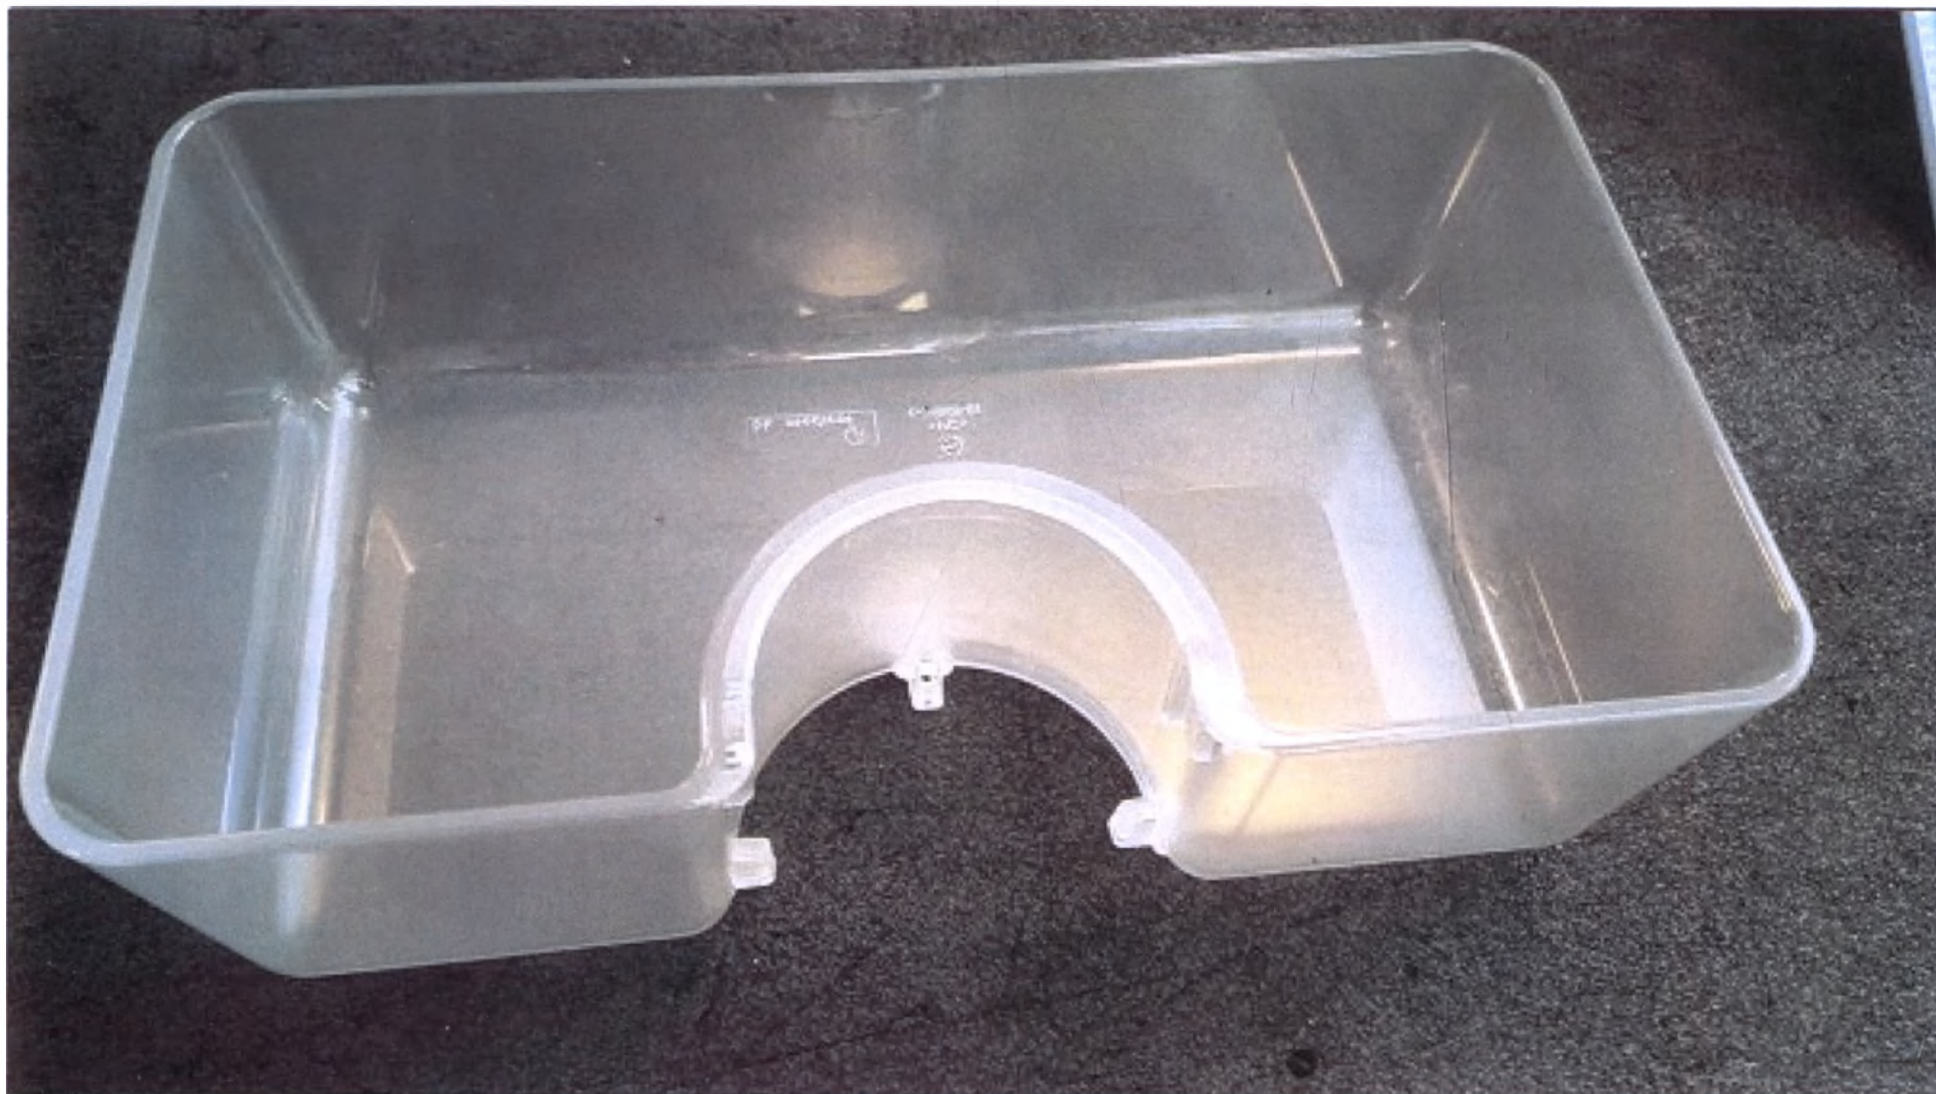

Корзина для принадлежностей, тип UA1370 (общий вид)



Полка для принтера, универсальная, тип UA2351 (общий вид)

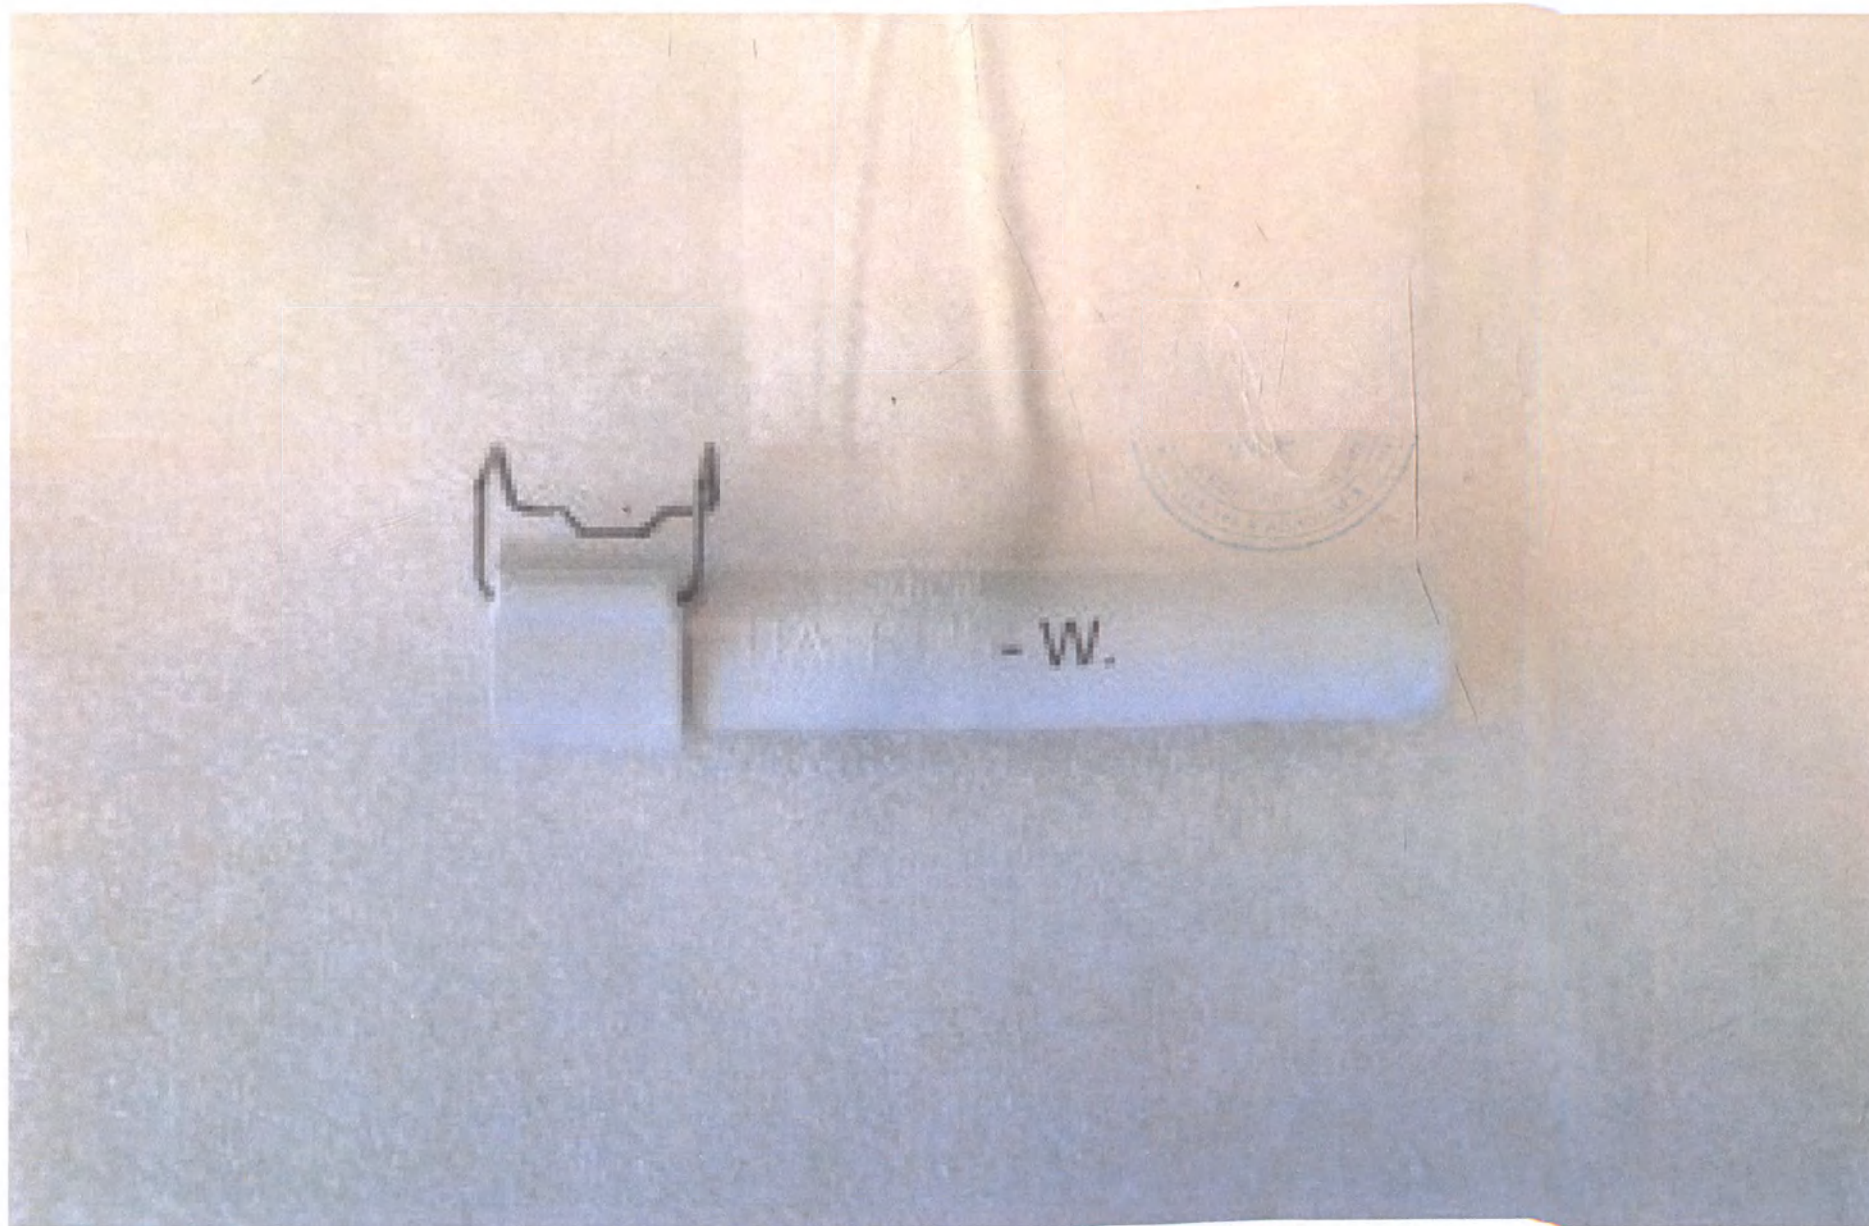

«Пустая канальная скоба», тип UA1325-w, для датчиков 9018 (общий вид)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

68

цифрами

(Шестьдесят восемь) листов
прописью

Генеральный директор
ООО «М.П.А. Медицинские партнеры»



Алексеев Э.Б.

Генеральный директор ООО «М.П.А. медицинские партнёры»

УТВЕРЖДАЮ

Алексеев Э.Б.

«17» августа 2022 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Датчики ультразвуковые к системам ультразвуковым 1300, 2300»
BK Medical ApS (БК Медикал АпС), Дания

«Датчики ультразвуковые к системам ультразвуковым 1300, 2300»:

Макет стикера на упаковку медицинского изделия для Российской Федерации

Датчик ультразвуковой конвексный, тип 9002/9C2



БК Medical ApS (БК Медикал АпС), Дания

Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark

Страна происхождения медицинского изделия: Дания.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «М.П.А. медицинские партнеры»

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 4, пом. XXVIII, ком. 4

тел./факс: Тел. +7 (495) 921-30-88. info@mpamed.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX
20XX года.



: см. на упаковке.




: см. на упаковке.

Срок службы: 8 лет с даты доставки

Ожидаемый срок службы: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенное руководство, только для профессионального применения.



Макет стикера на упаковку адаптера пункционного многоразового к медицинскому изделию для Российской Федерации

Адаптер пункционный, многоразовый, тип UA1250; для датчиков 9002/9023 и 9040

РУ № XXX от XX.XX.20XX Срок действия: не ограничен

Срок службы: 8 лет с даты доставки

Ожидаемый срок службы: 10 лет

Срок хранения: 10 лет



2020-04



Масса (без упаковки): 40 г

Масса (в упаковке): 100 г



: см. на упаковке.



Предостережение, ознакомьтесь с сопроводительными документами.

Производитель: BK Medical ApS (БК Медикал АпС), Дания

Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «М.П.А. медицинские партнеры»

Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 4, пом. XXVIII, ком. 4

Тел: +7 (495) 921-30-88 info@mpamed.ru

Макет стикера на упаковку адаптера пункционного одноразового к медицинскому изделию для Российской Федерации

**Адаптер пункционный, одноразовый, стерильный, тип UA1323-S,
для датчика 9018**

РУ № XXX от XX.XX.20XX Срок действия: не ограничен




2020-04-01



Масса (без упаковки): 10 г
Масса (в упаковке): 100 г



2023-04-01




Стерилизовано этиленоксидом



Не использовать
повторно



Не использовать при
повреждении упаковки



: см. на упаковке.



Не стерилизовать повторно



Предостережение, ознакомьтесь с сопроводительными документами.

Производитель: BK Medical ApS (БК Медикал АпС), Дания
Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «М.П.А. медицинские партнеры»

Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 4, пом. XXVIII, ком. 4

Тел: +7 (495) 921-30-88 info@mpamed.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4

(четыре) л.

Генеральный директор

ООО «М.П.А. медицинские
партнеры»

Алексеев Э.Б.

2022 г.

