



SAMSUNG MEDISON

ЗАО «МЕДИЭЙС»
Официальный дистрибьютор
САМСУНГ МЕДИСОН

Москва, 127422, Тимирязевская ул., д.1, стр.3
Тел.: +7 (495) 921 39 81, Факс: +7 (499) 641 55 35

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИЭЙС»
Викторов Н.В.

М.П.



«19» апреля 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Система диагностическая ультразвуковая RS85-RUS с принадлежностями



1. Консоль электронная, 2. Панель управления, 3. Специальный LED монитор, 4. Панель сенсорная, 5. Держатель датчиков, 6. Клавиатура.



Датчик конвексный CA1-7A



Датчик конвексный CA1-7S




Датчик конвексный CA3-10A




Датчик конвексный CA2-8A




Датчик микроконвексный CF4-9

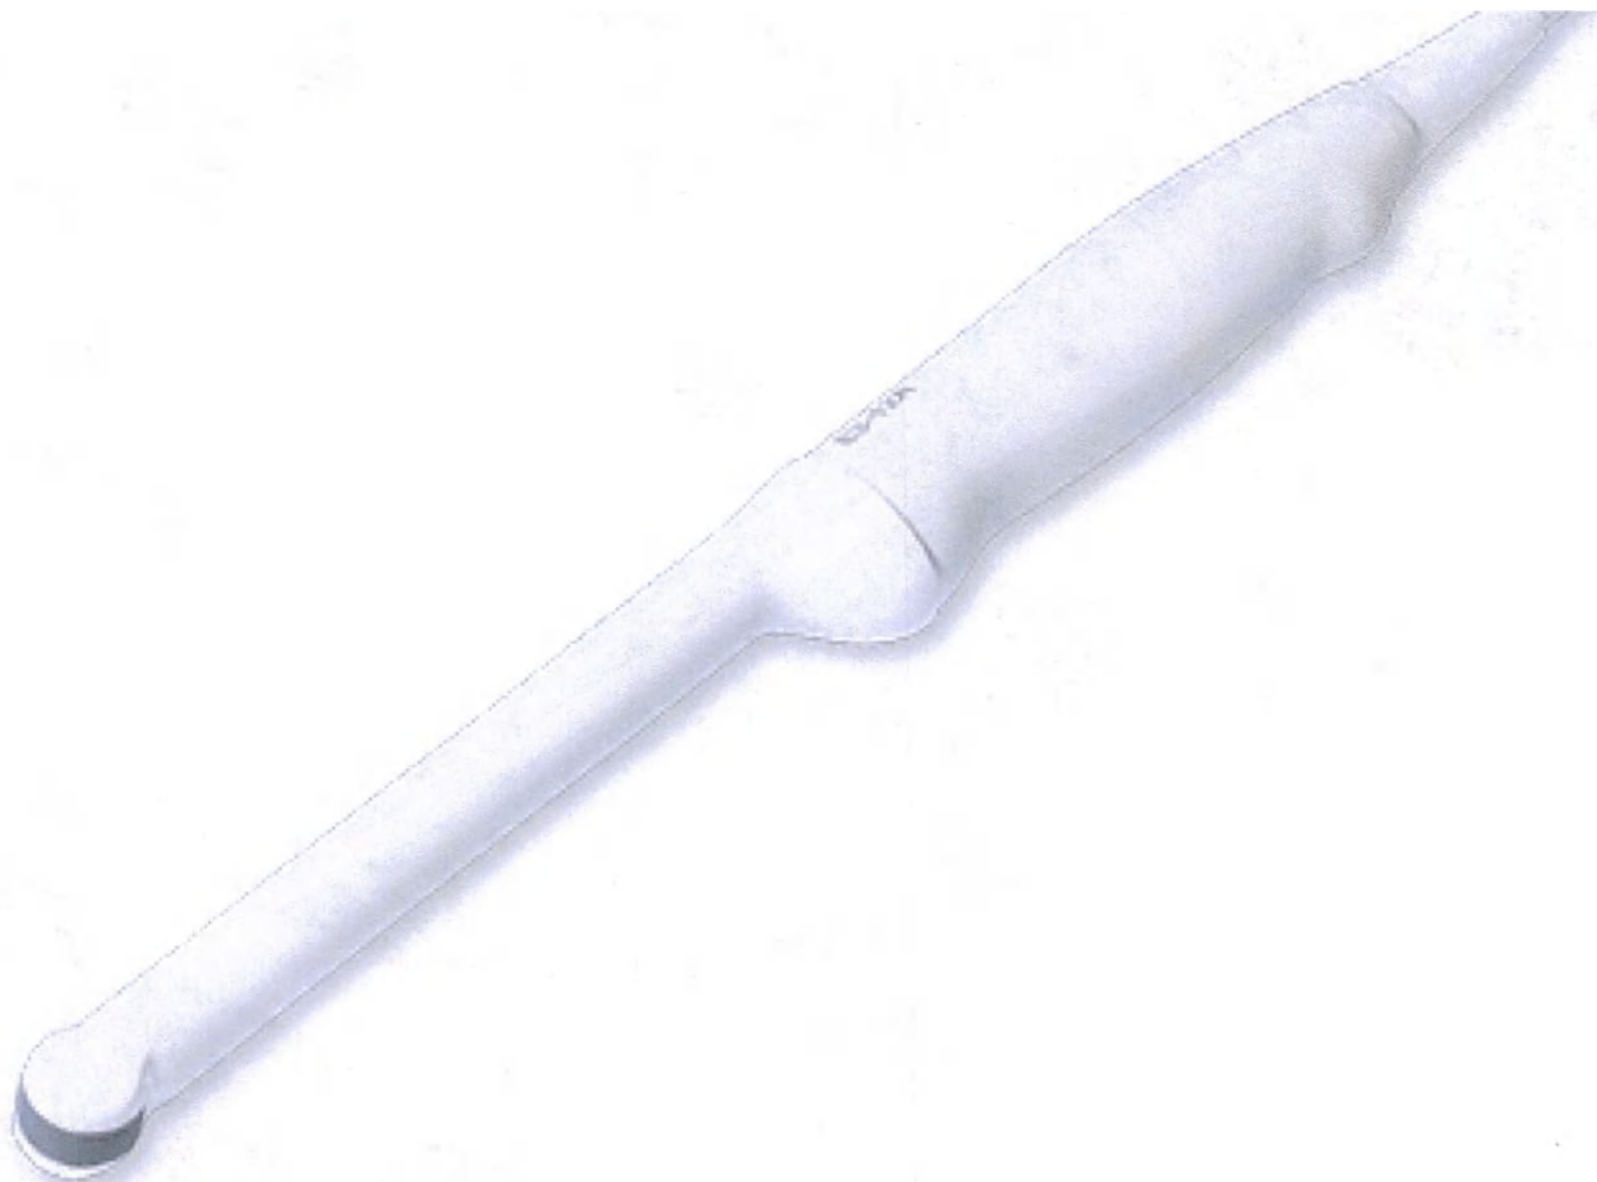


Датчик эндовагитальный ЕЗ-12А

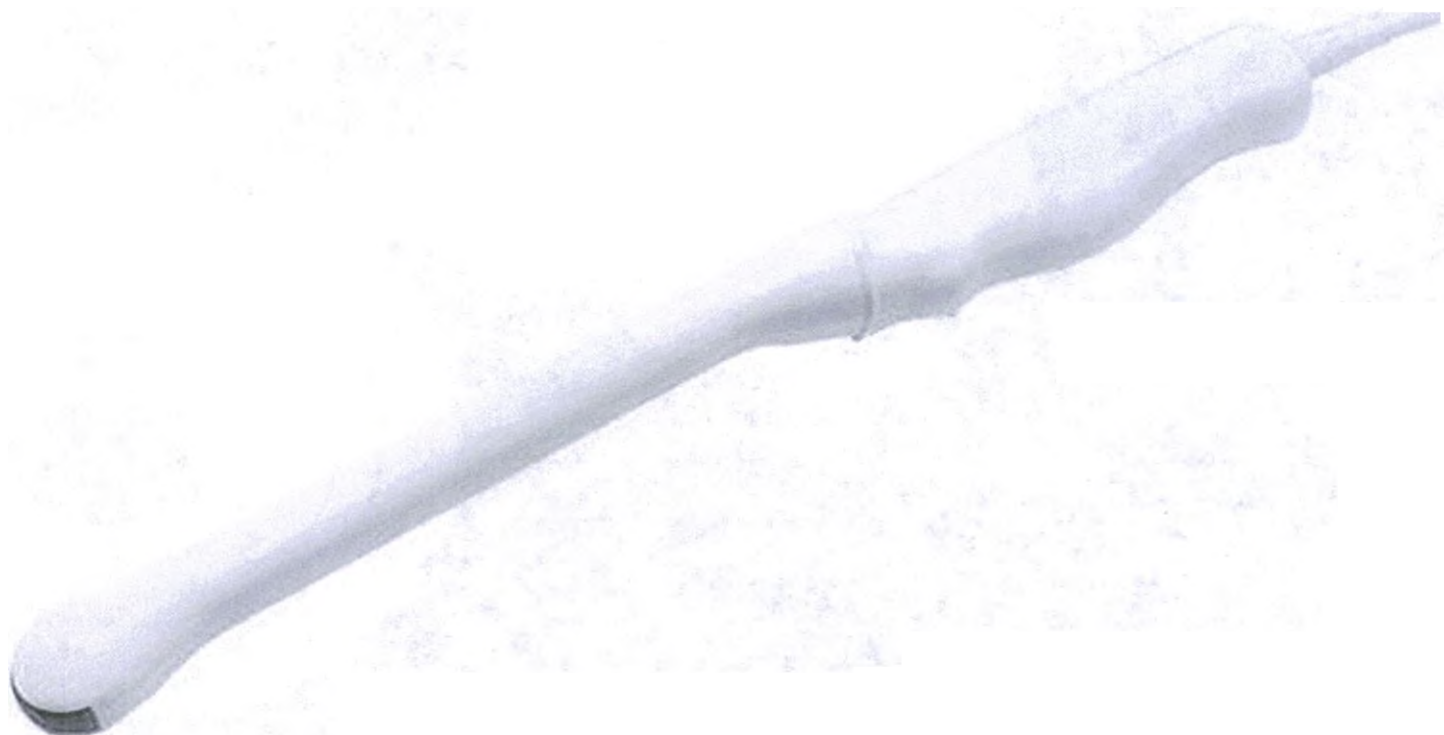

Датчик эндокавитальный EA2-11B

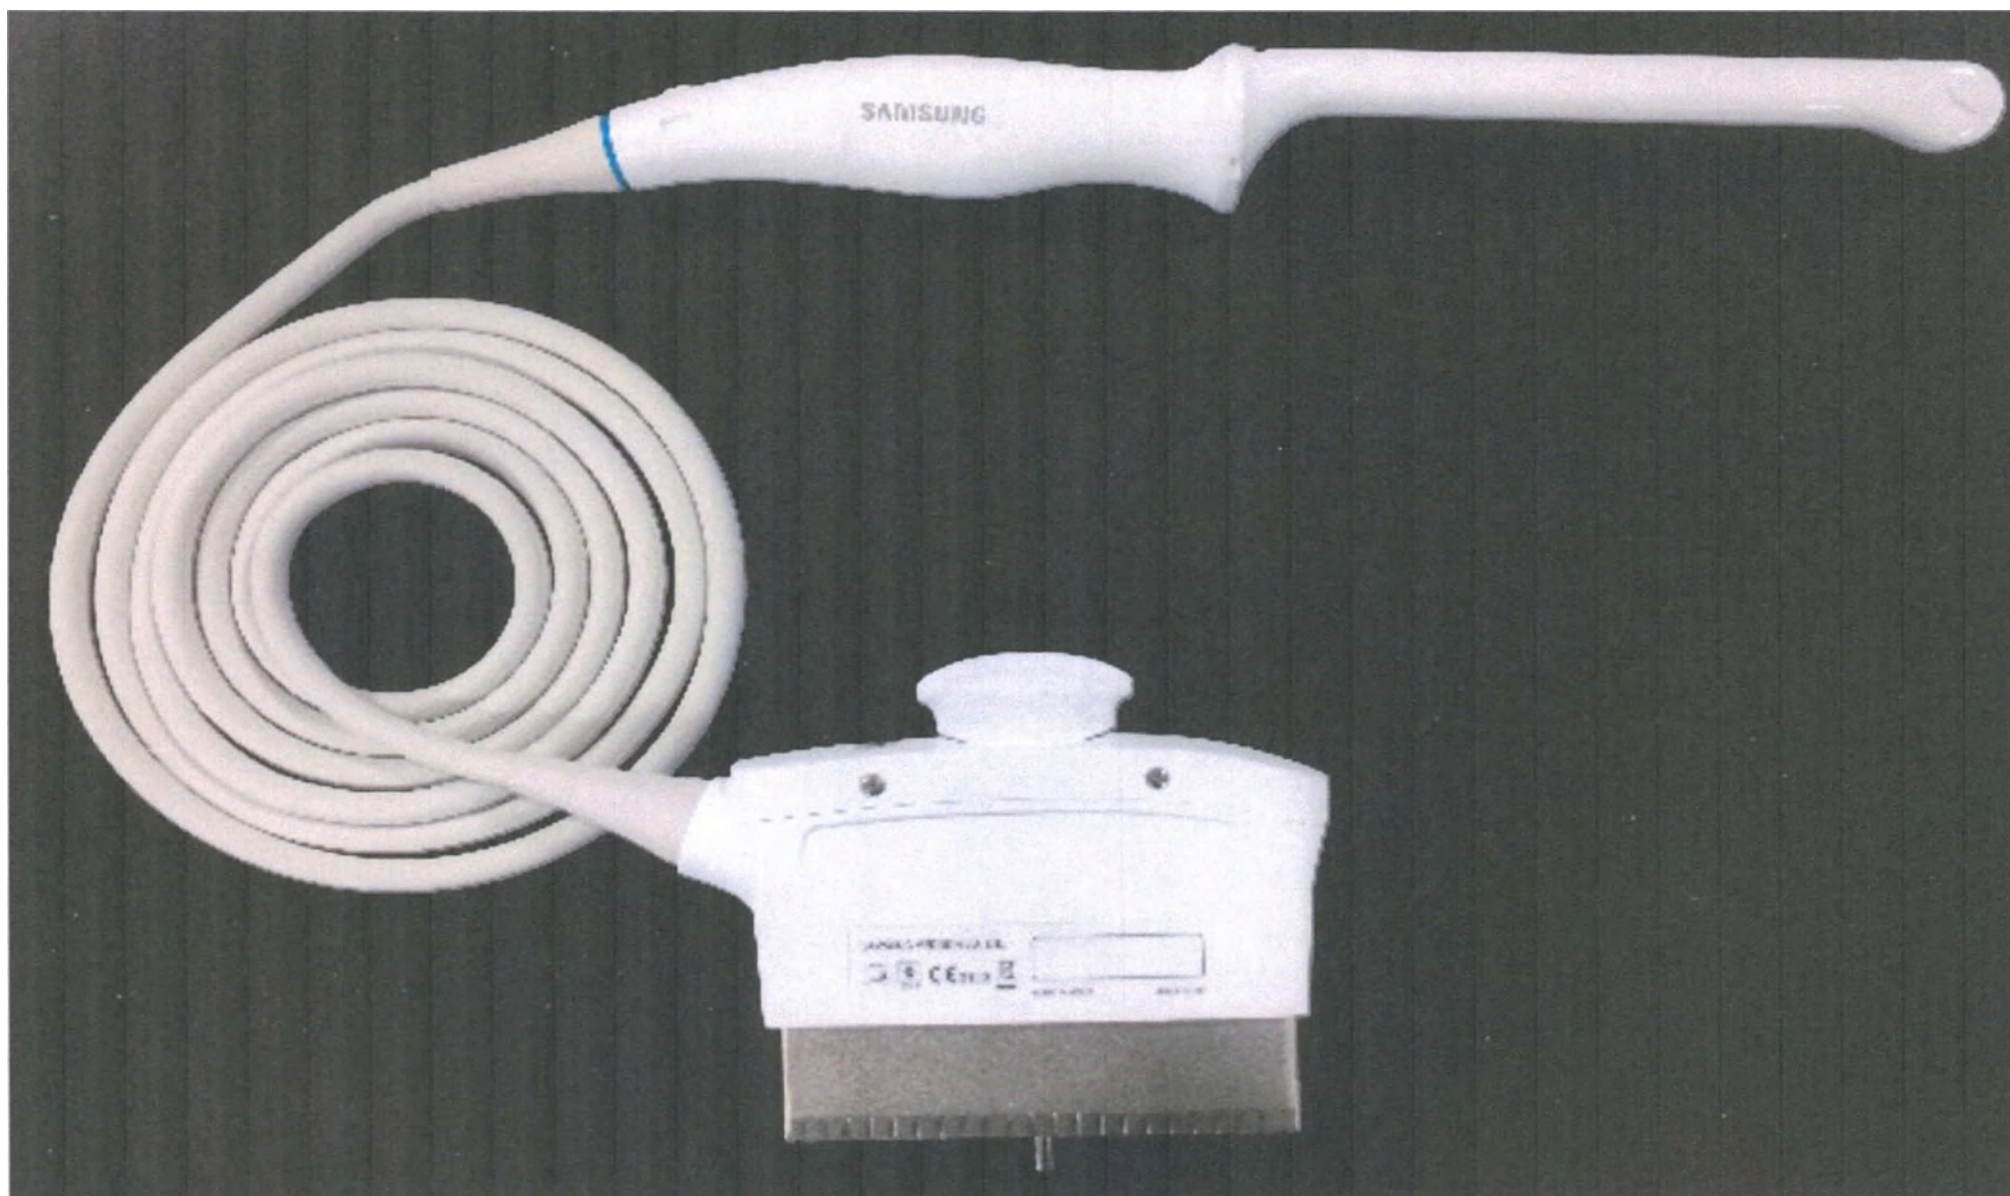


Датчик эндокавитальный EA2-11AR

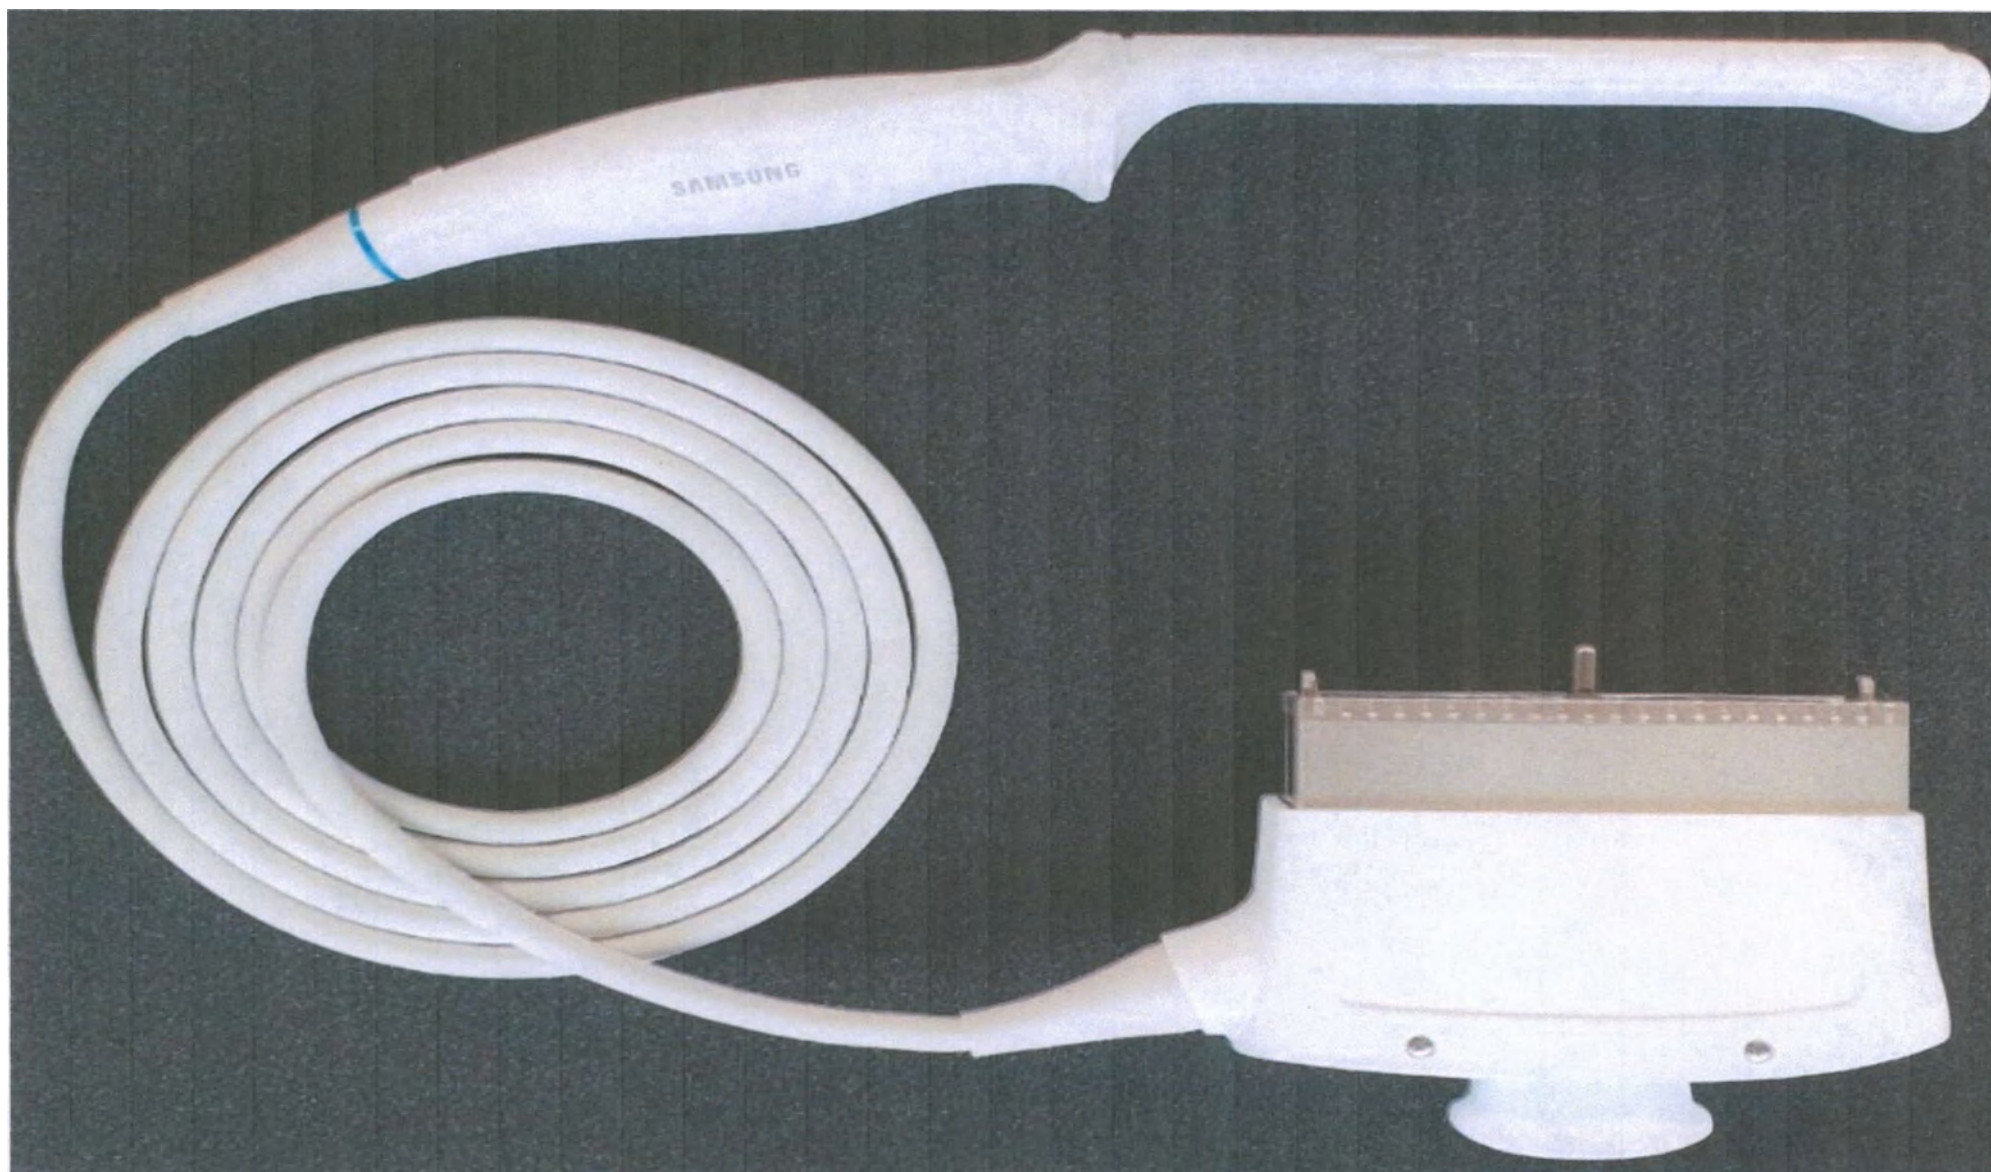

Датчик эндокавитальный EA2-11AV




Датчик объемный конвексный CV1-8A

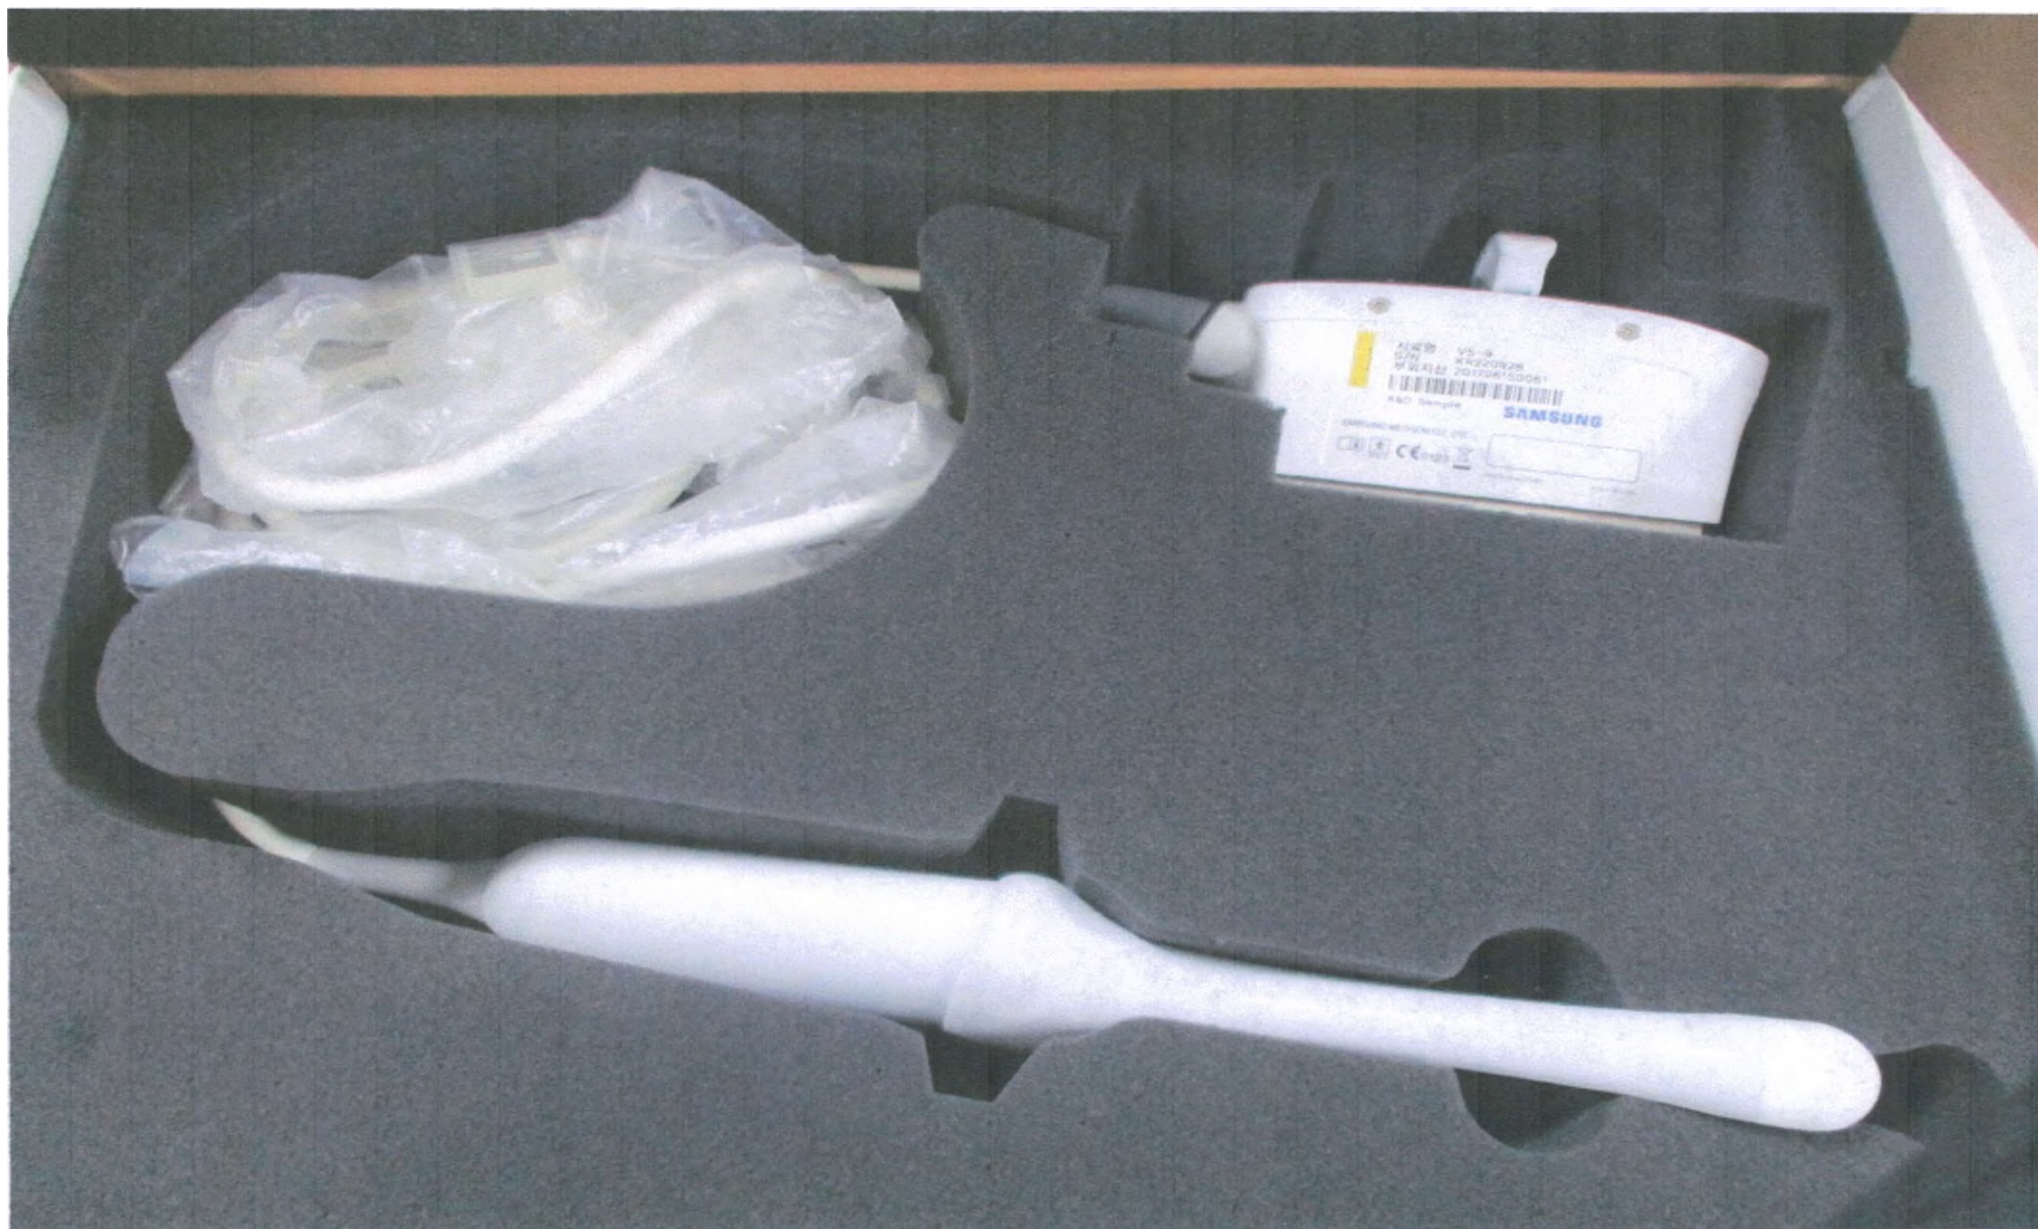

Датчик объемный эндокавитальный V5-9




Датчик объемный линейный LV3-15B

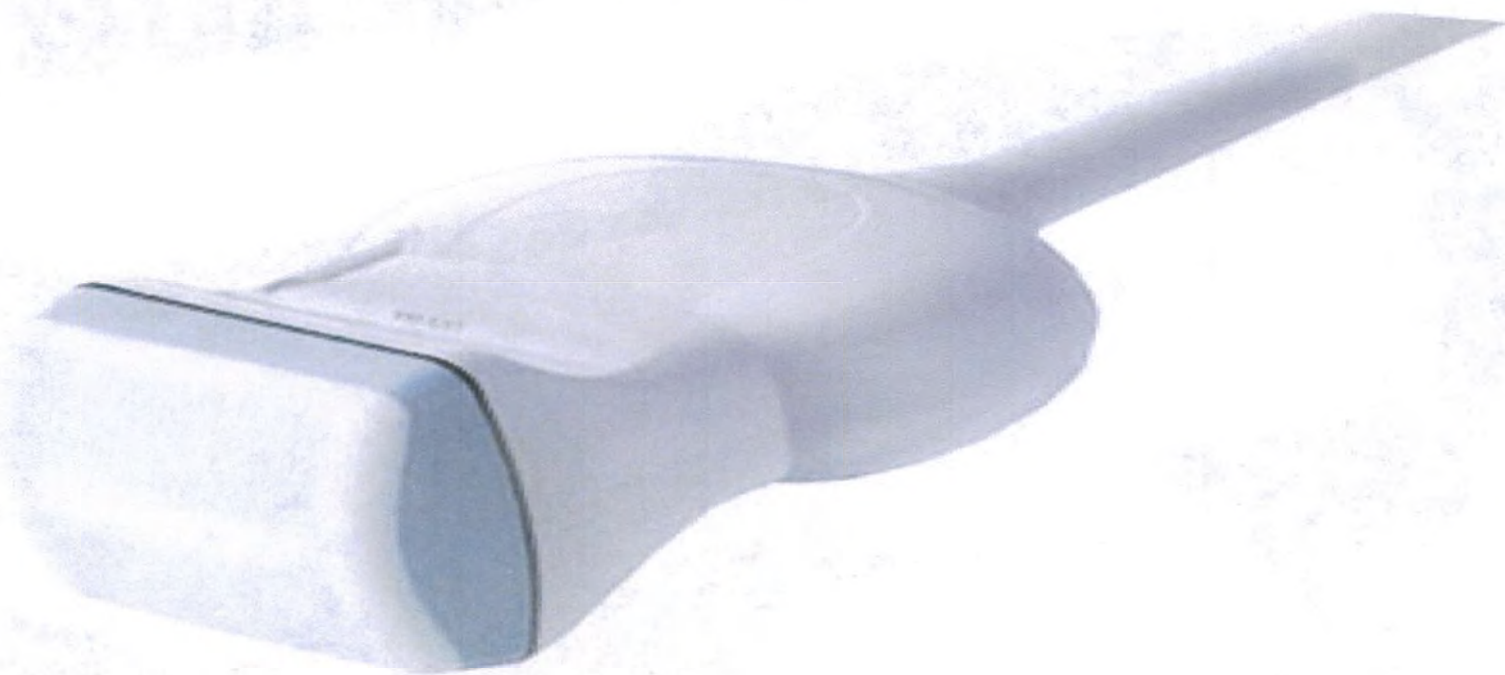

Датчик объемный линейный LV3-14A




Датчик объемный эндокавитальный EV3-10B

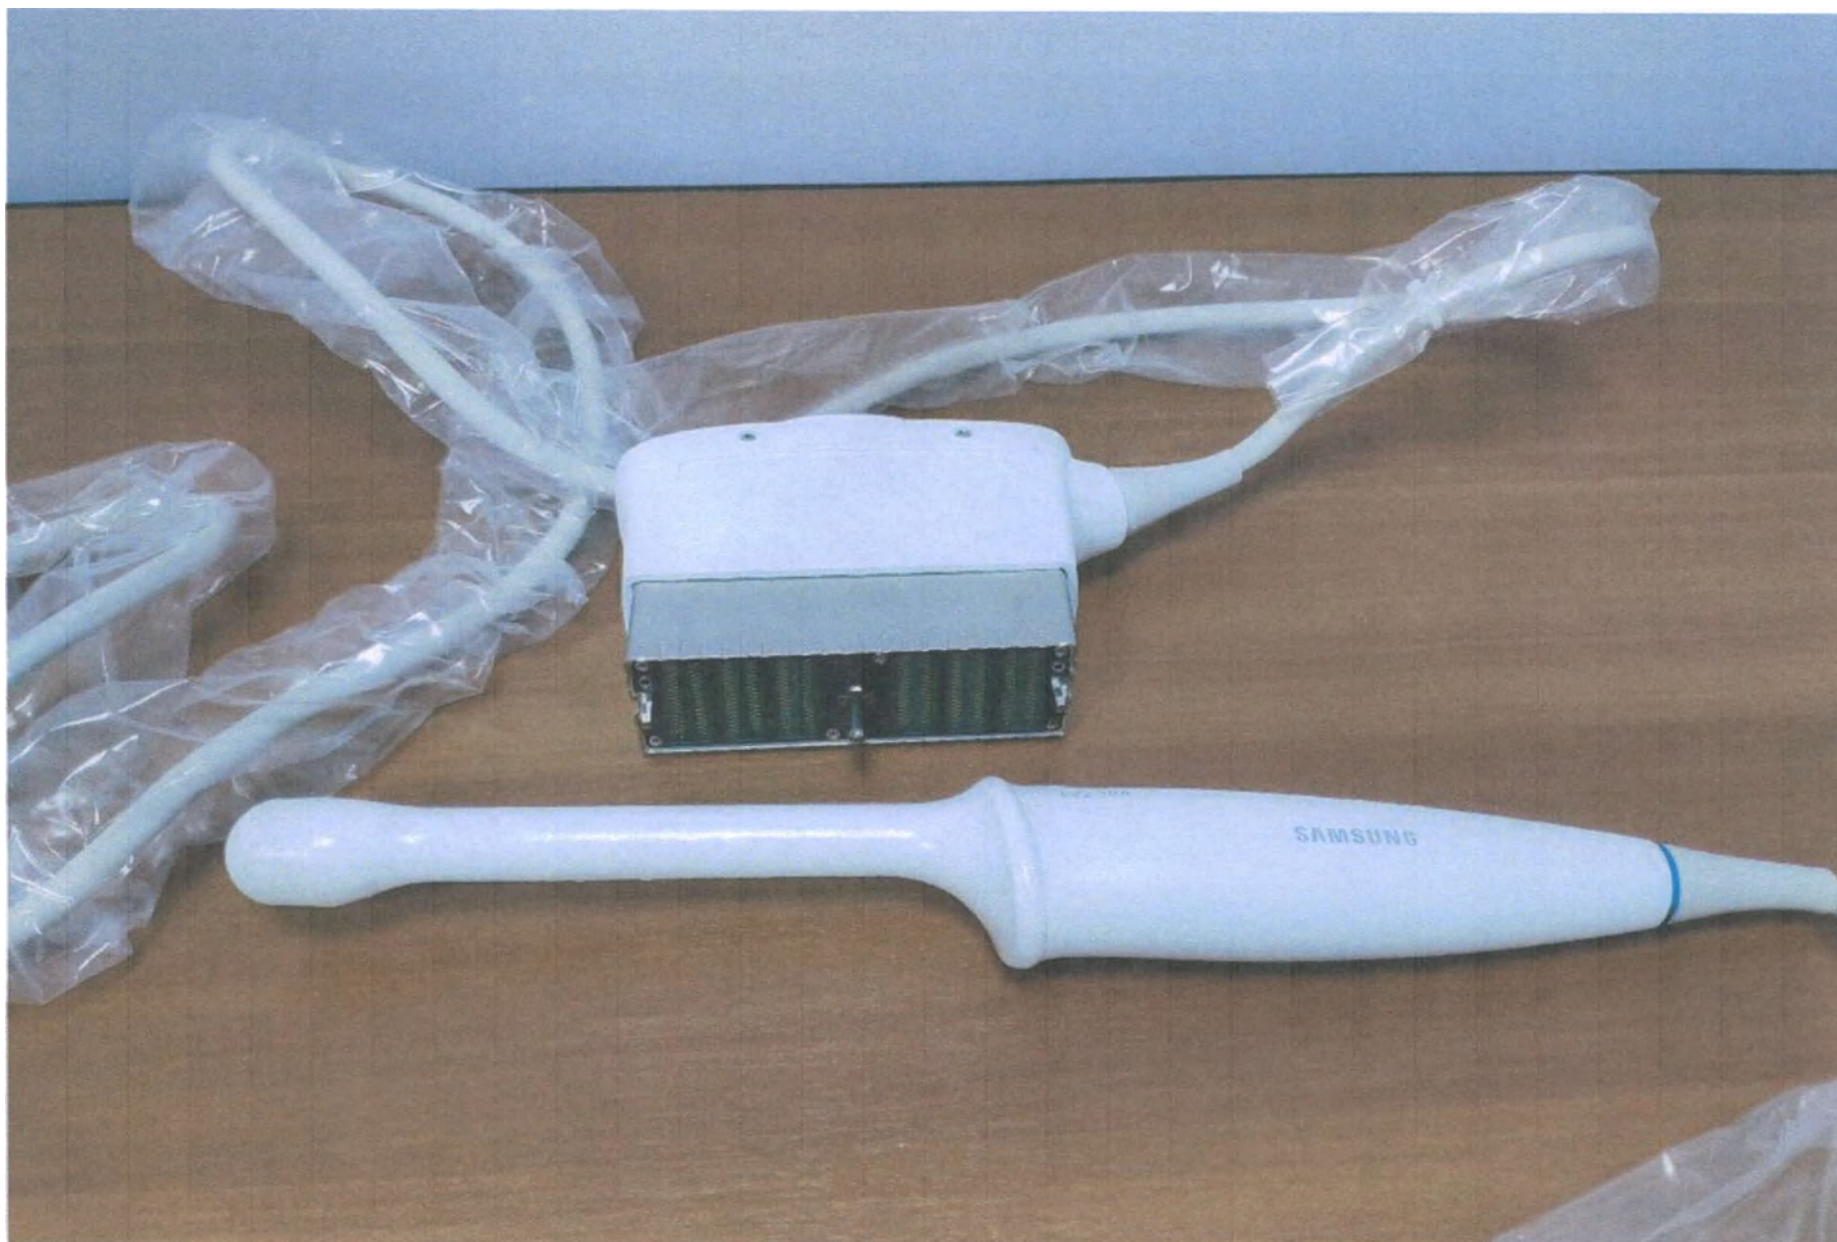

Датчик объемный эндокавитальный EV2-10A (РУ №РЗН 2019/8227)



Датчик линейный L3-12A

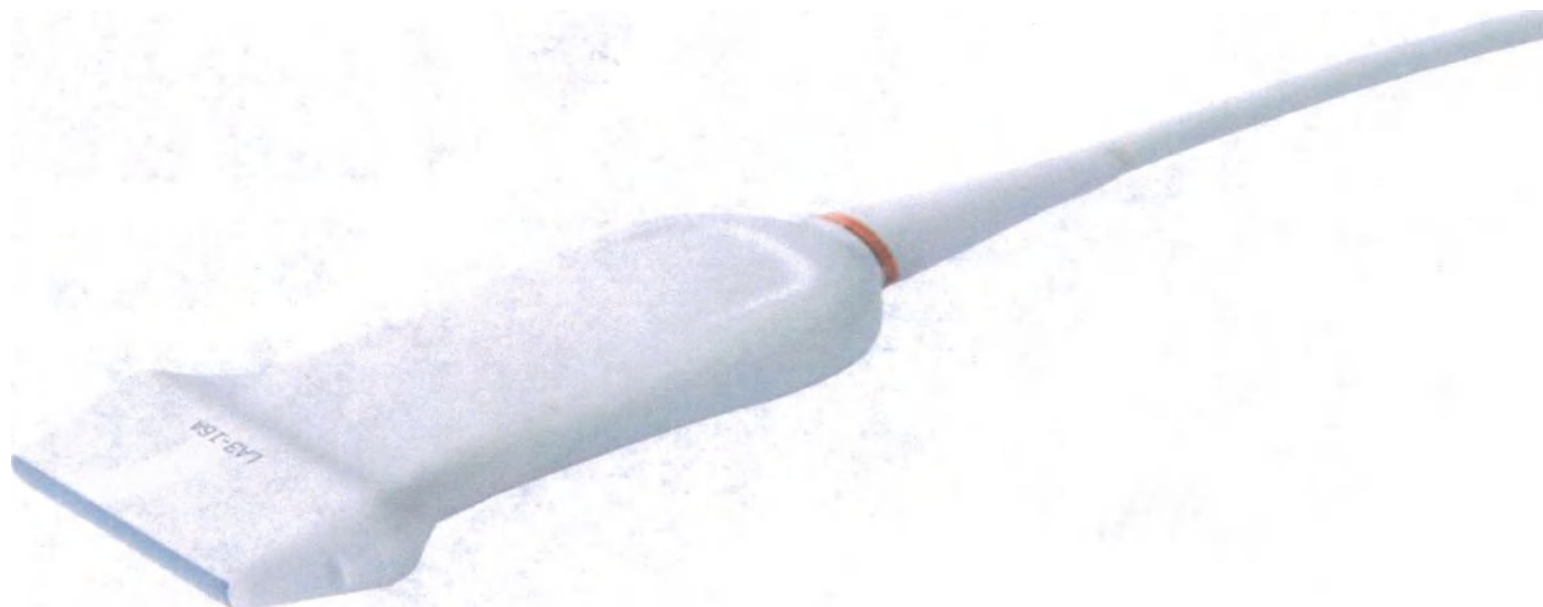

Датчик линейный LA3-16A



Датчик линейный LA2-9A




Датчик линейный LA3-16AI



Датчик линейный LA4-18B




Датчик линейный LM4-15B

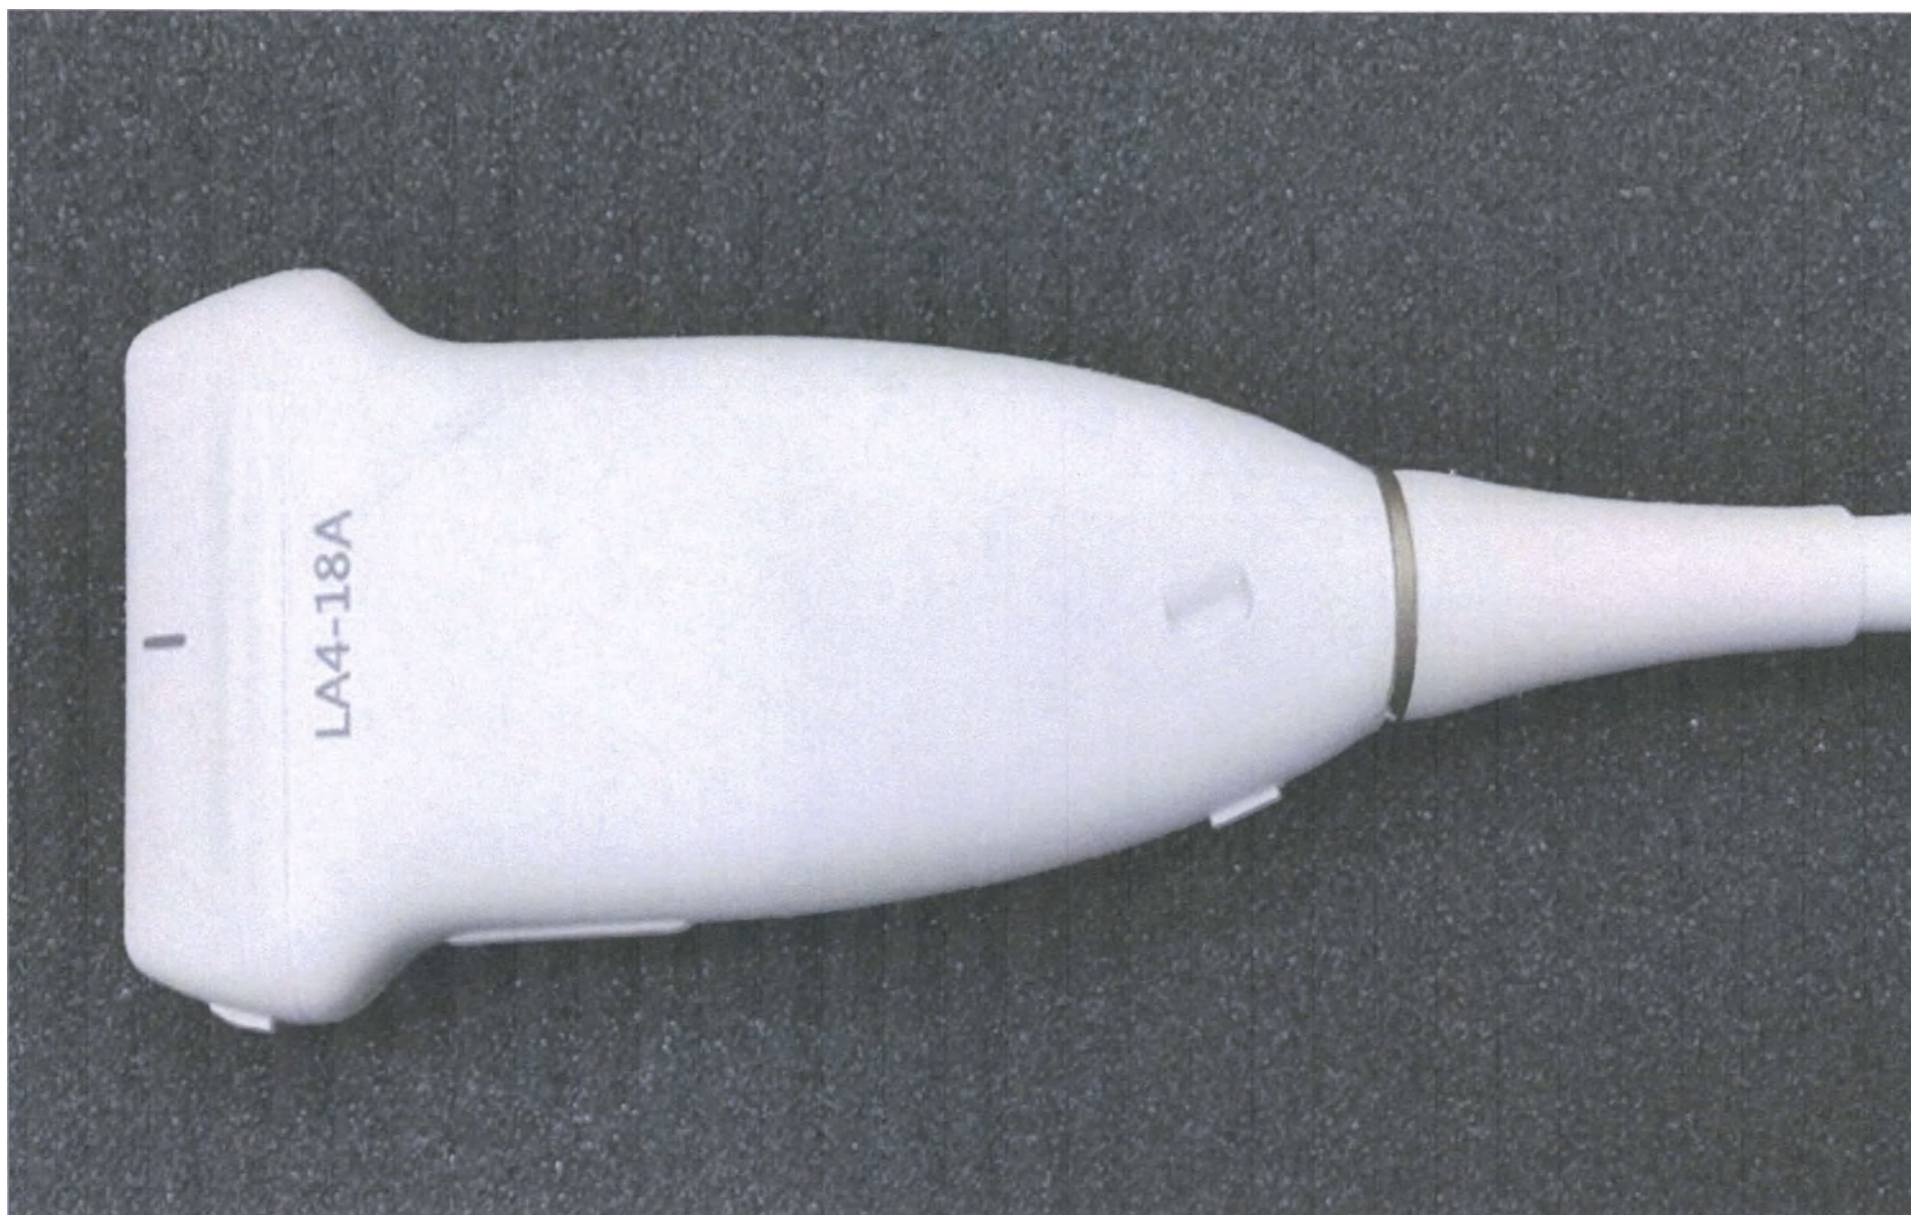

Датчик линейный LA4-18A



Датчик фазированный PM1-6A

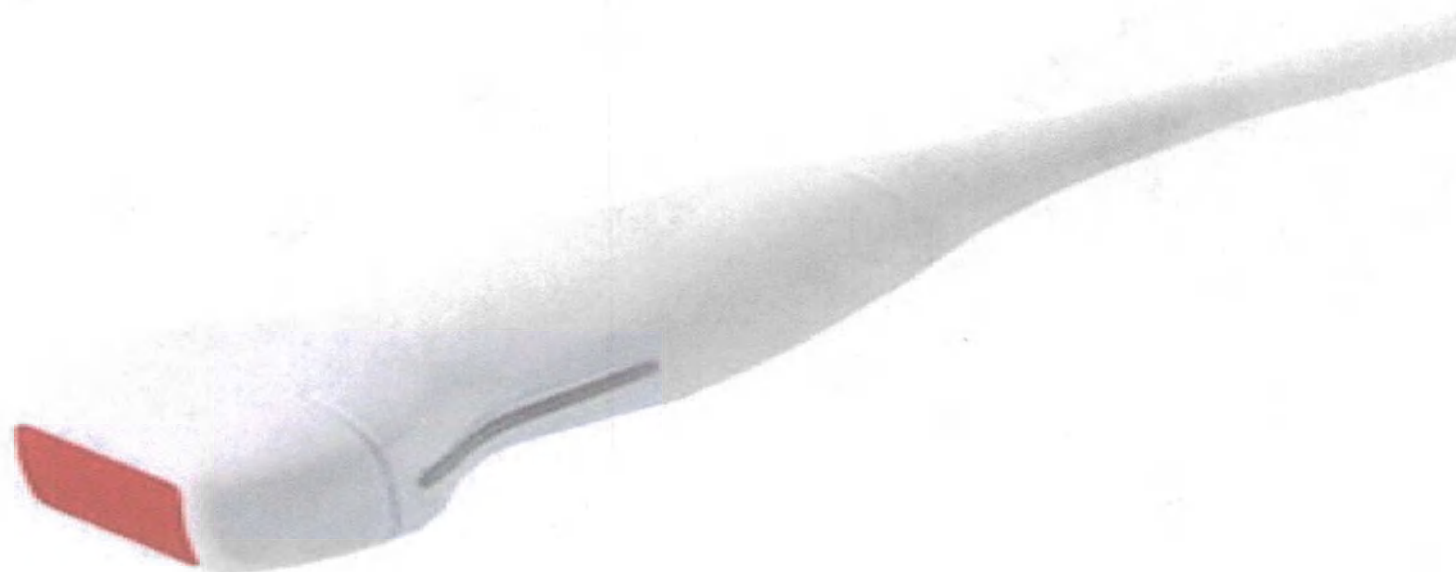

Датчик фазированный РА3-8В



Датчик фазированный PA4-12B




Датчик фазированный PA1-5A



Датчик фазированный чреспищеводный ММРТ3-7




Датчик постоянно-волновой CW6.0

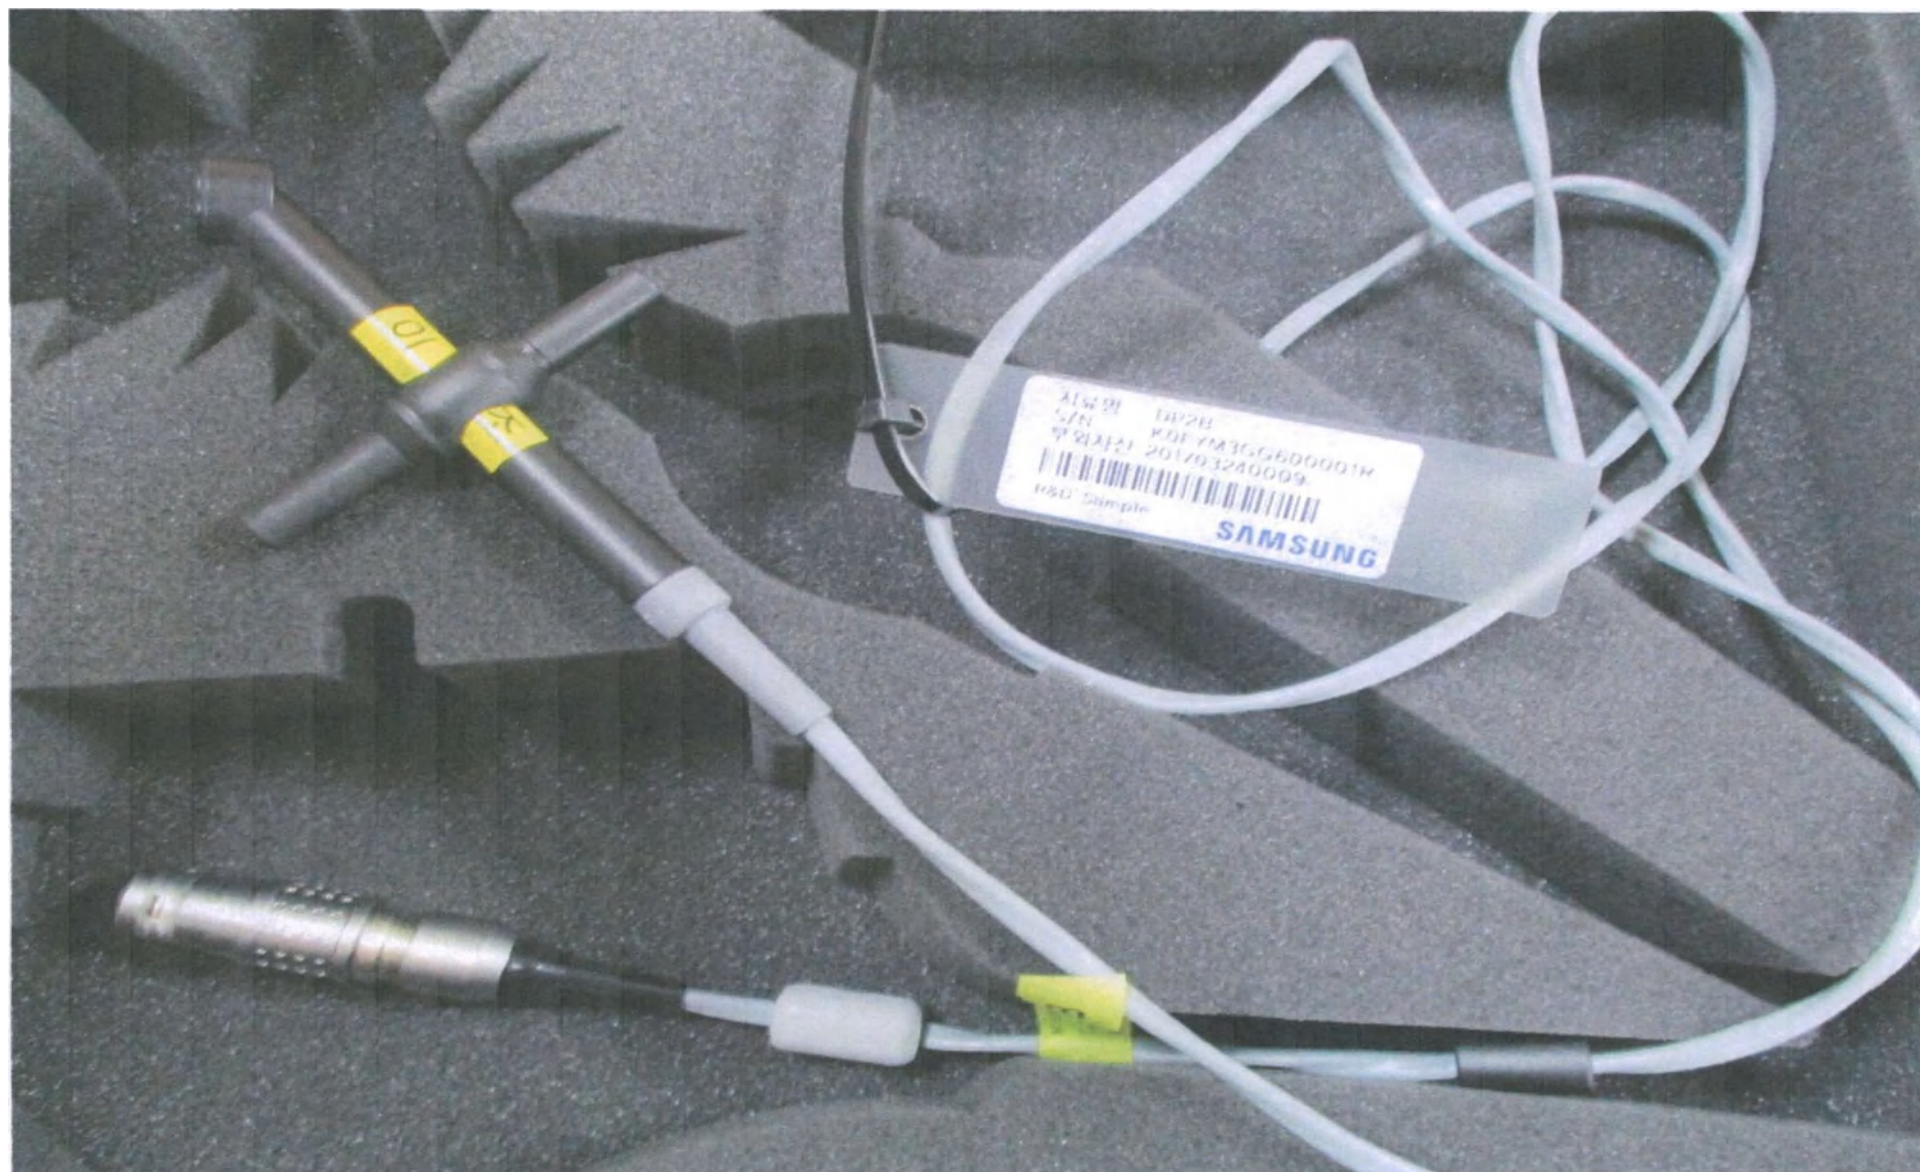

Датчик постоянно-волновой DP2B



Датчик постоянно-волновой DP8B

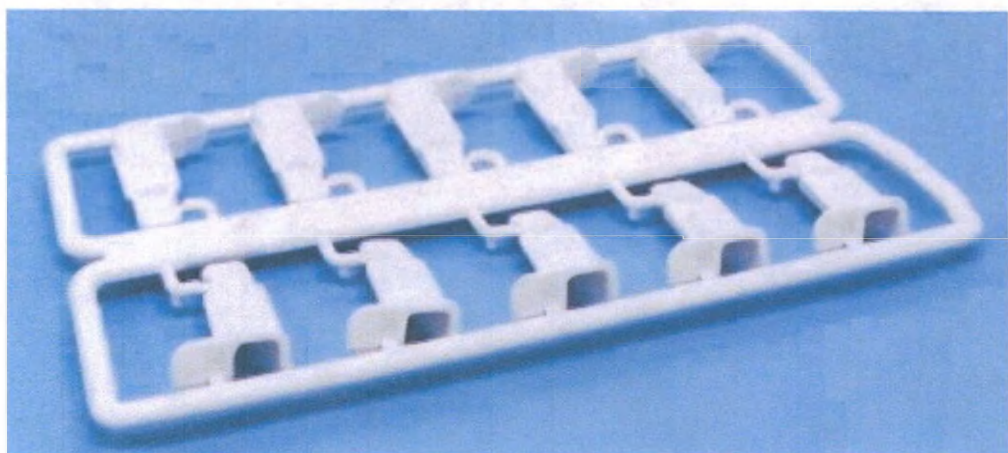

Крепления иглопроводника



Дополнительная батарея



Иглопроводник



Насадка для биопсии

Модуль мультимодальной визуализации S-Fusion



Блок слежения




Сенсор электромагнитный для слежения



Генератор электромагнитного поля




Внешний маркер

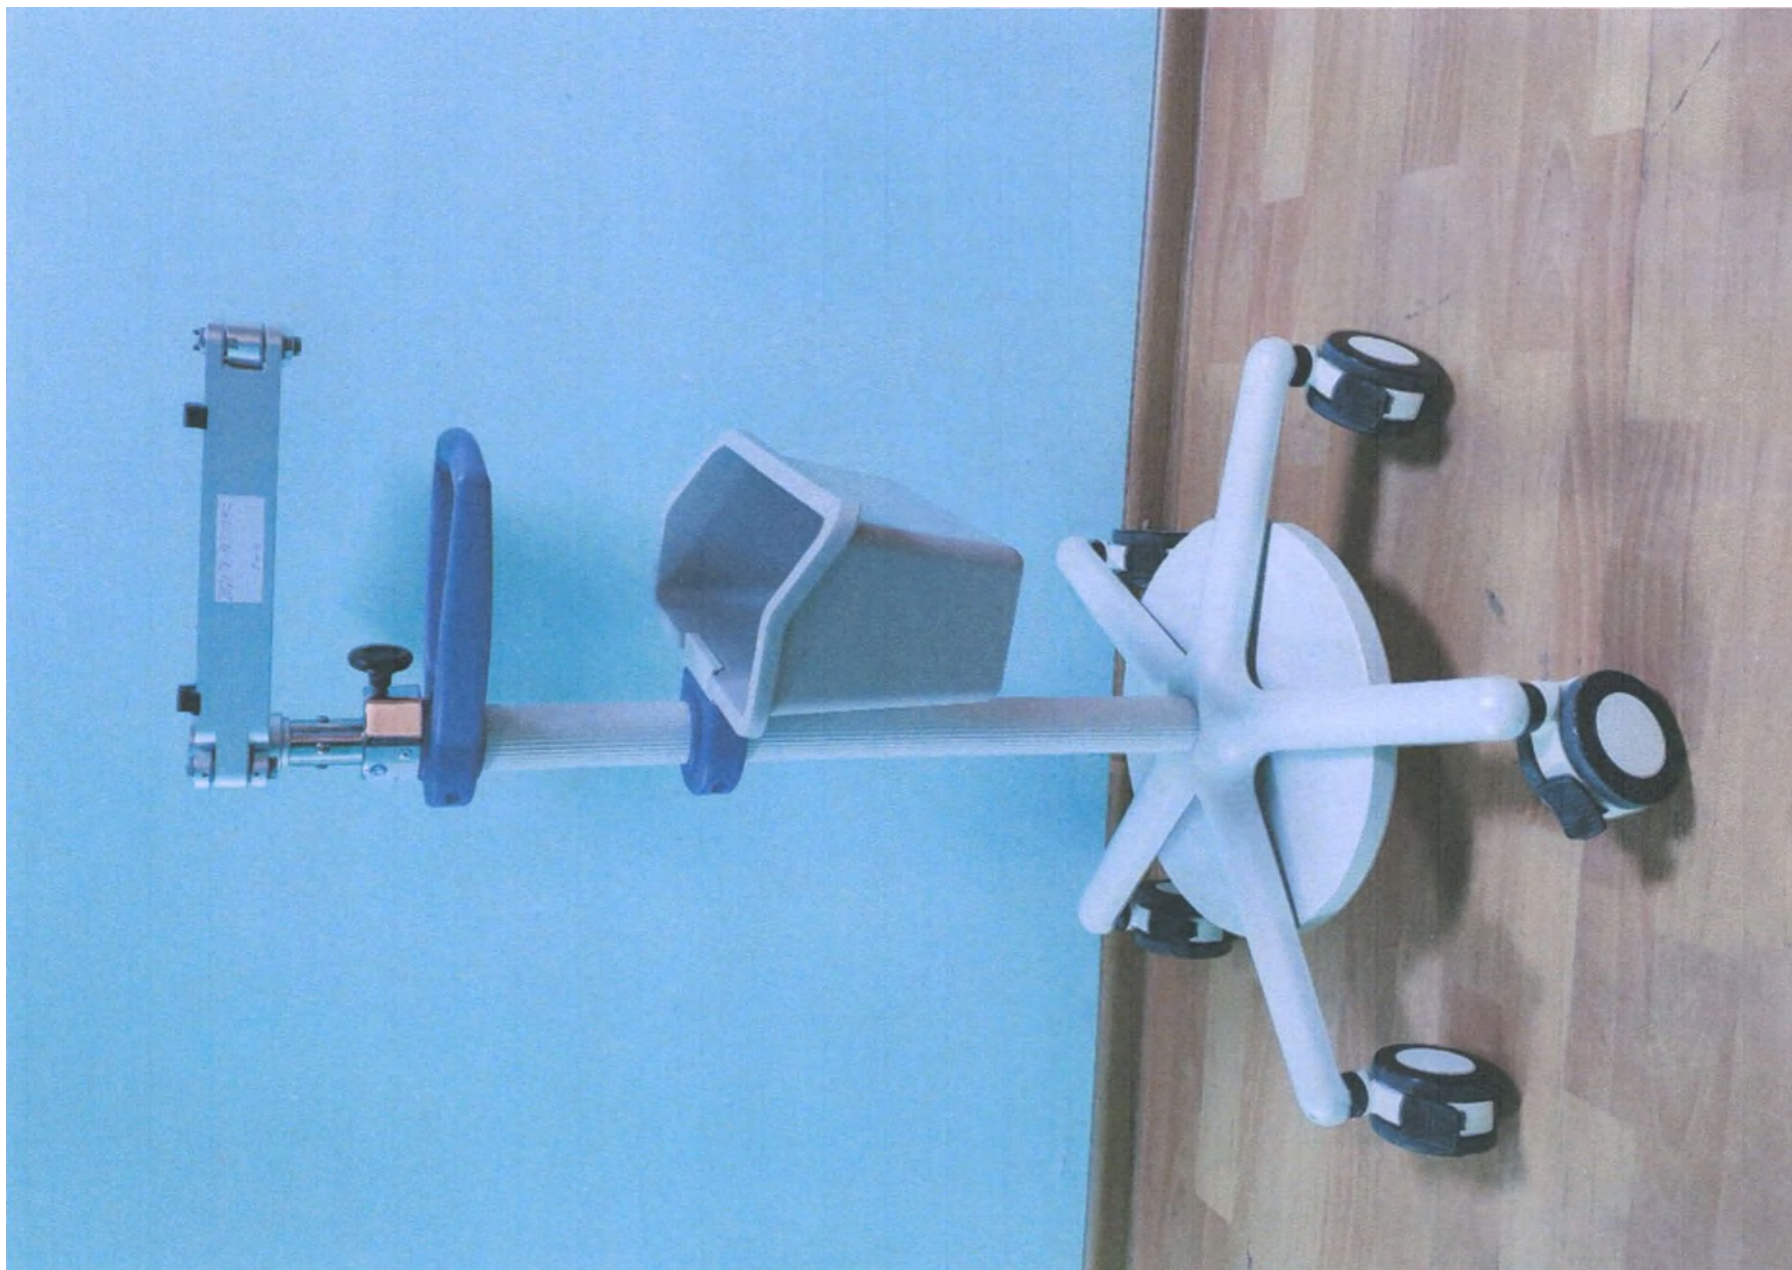


Стойка для генератора поля



Зажим нестерильный

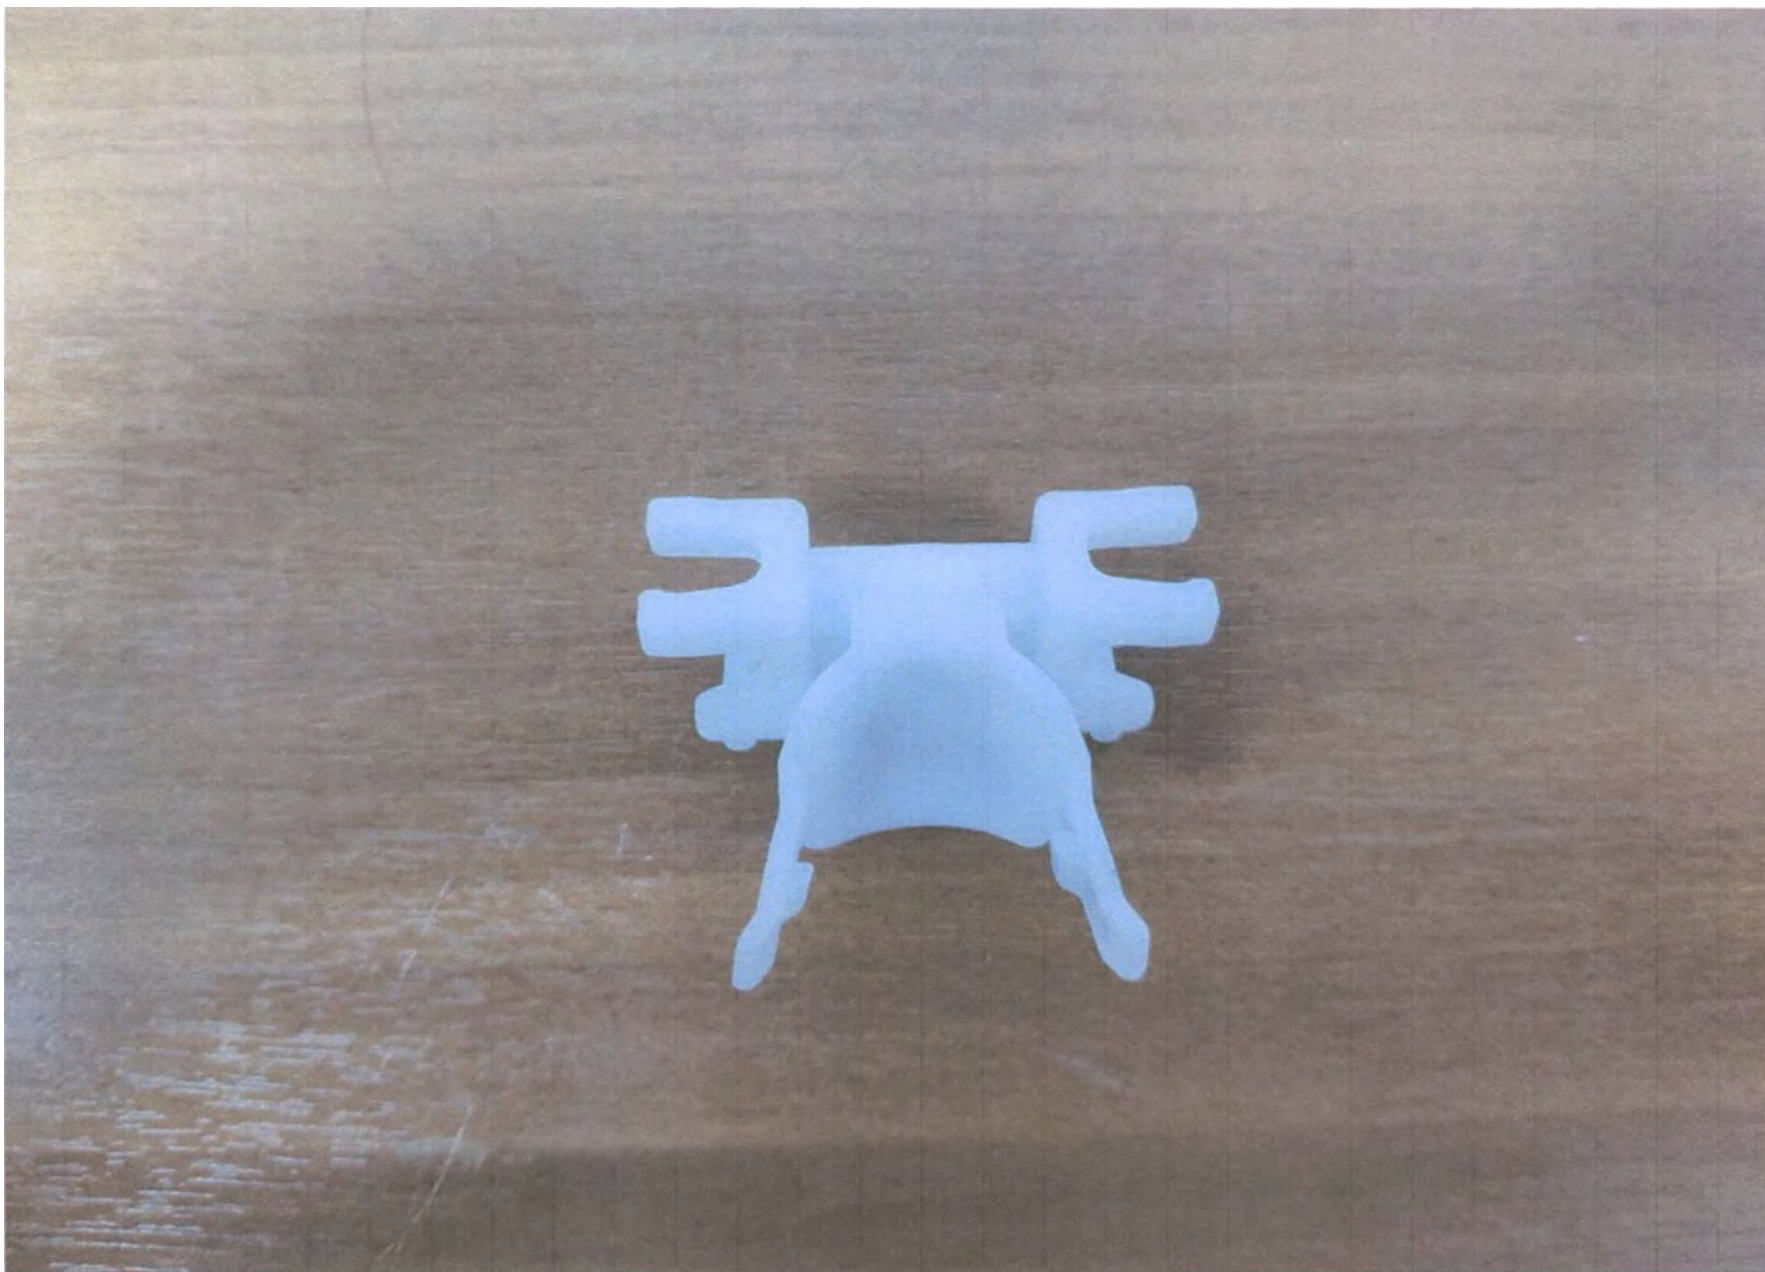


Насадка для крепления сенсора на датчик линейный L3-12A

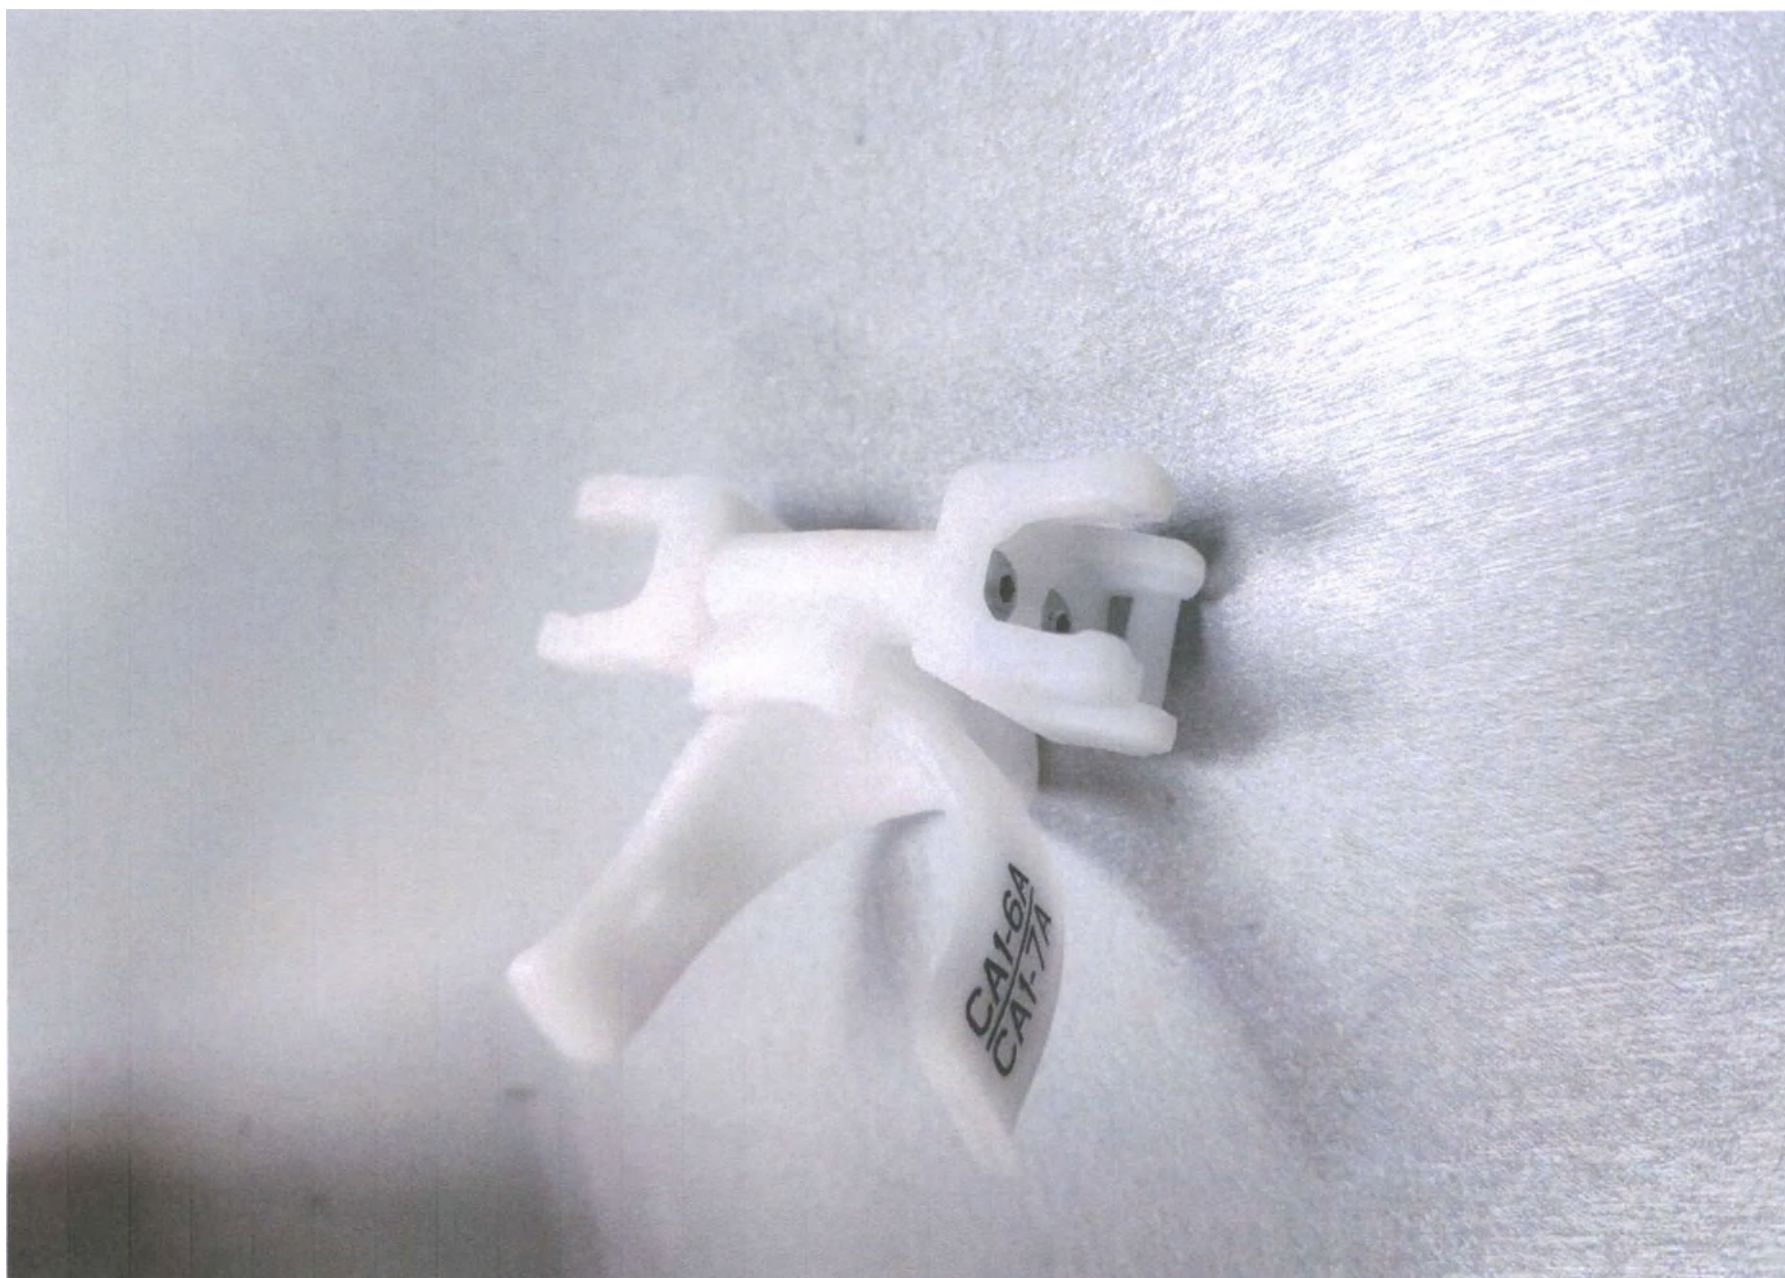


Насадка для крепления сенсора на датчик конвексный CA1-7A



Насадка для крепления сенсора на датчик эндокавитальный E3-12A

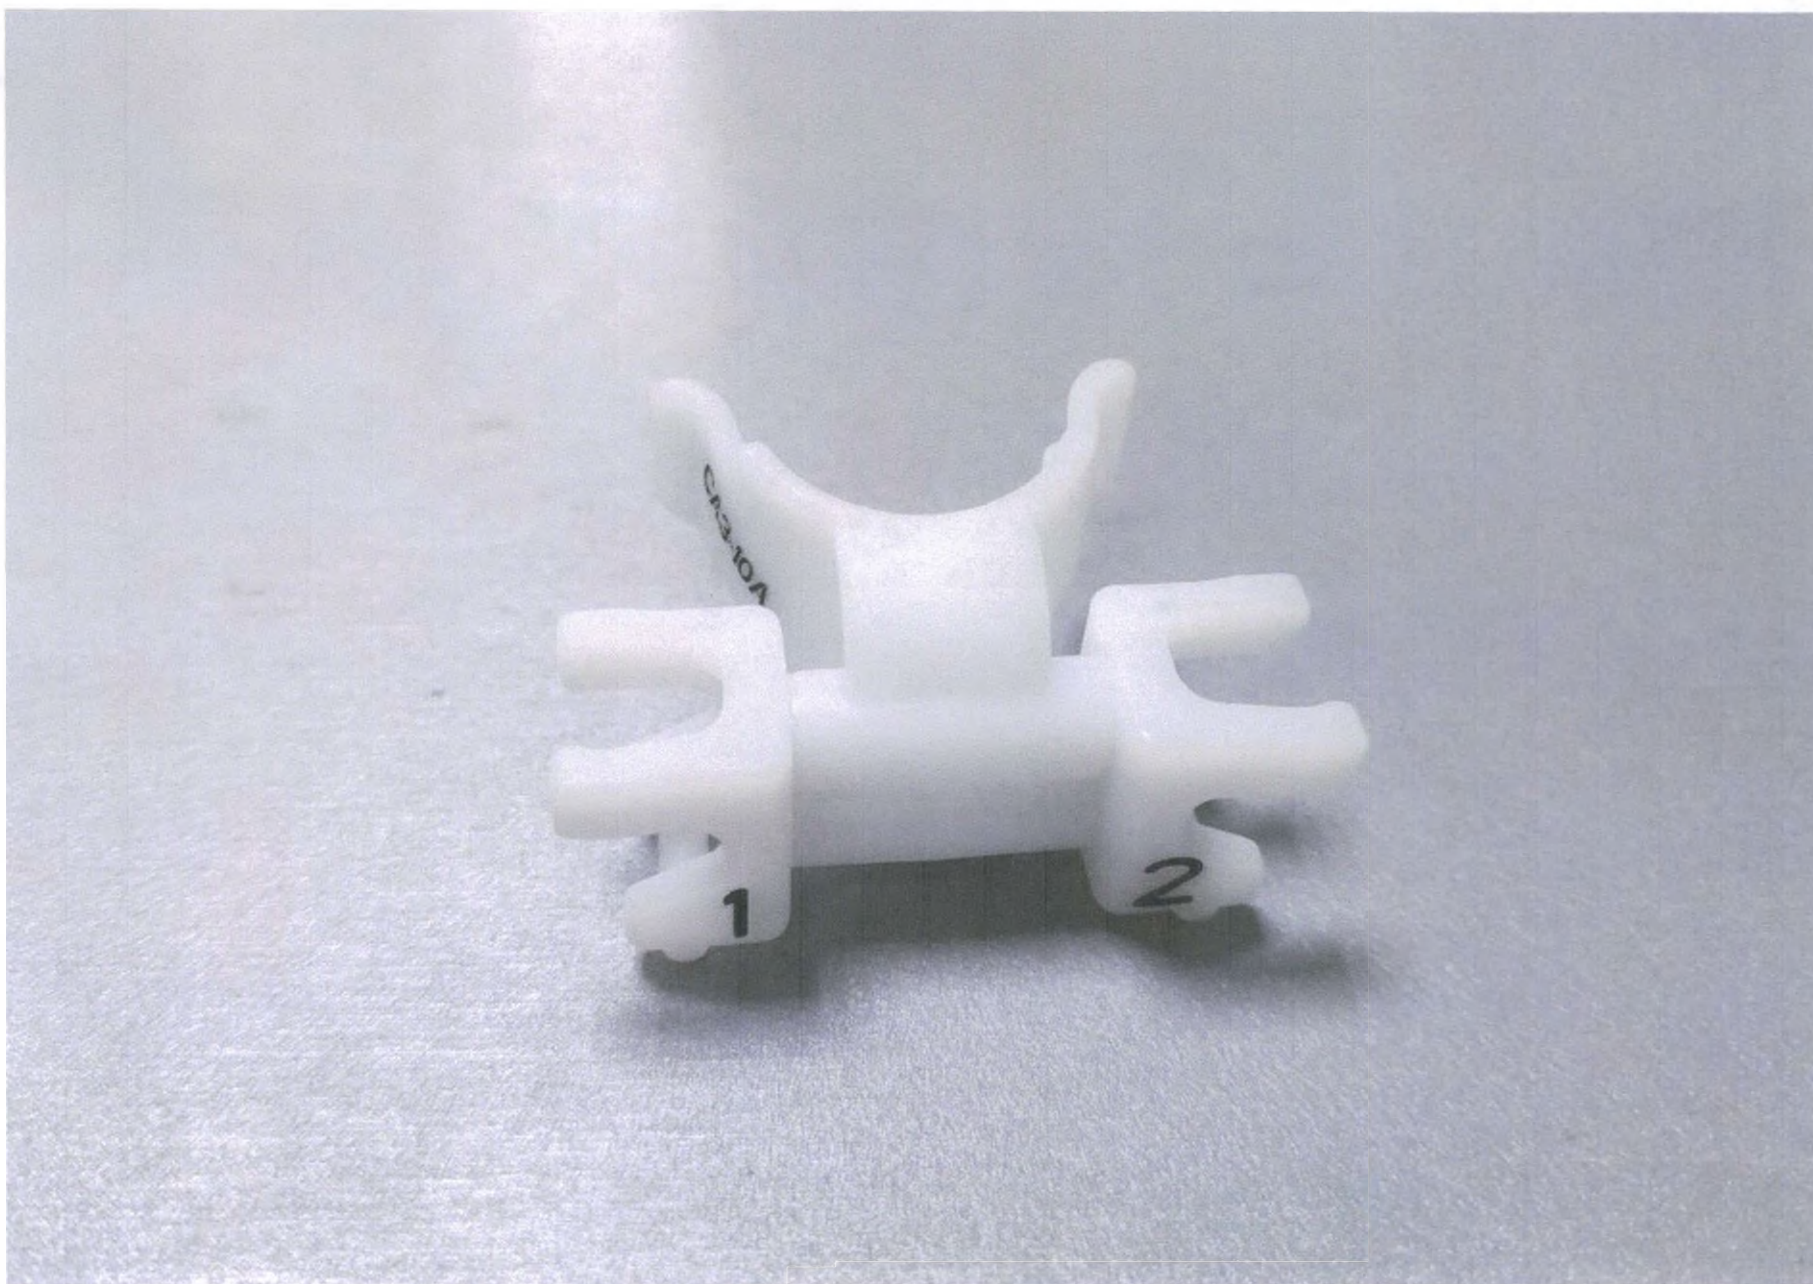

Насадка для крепления сенсора на датчик конвексный СА3-10А

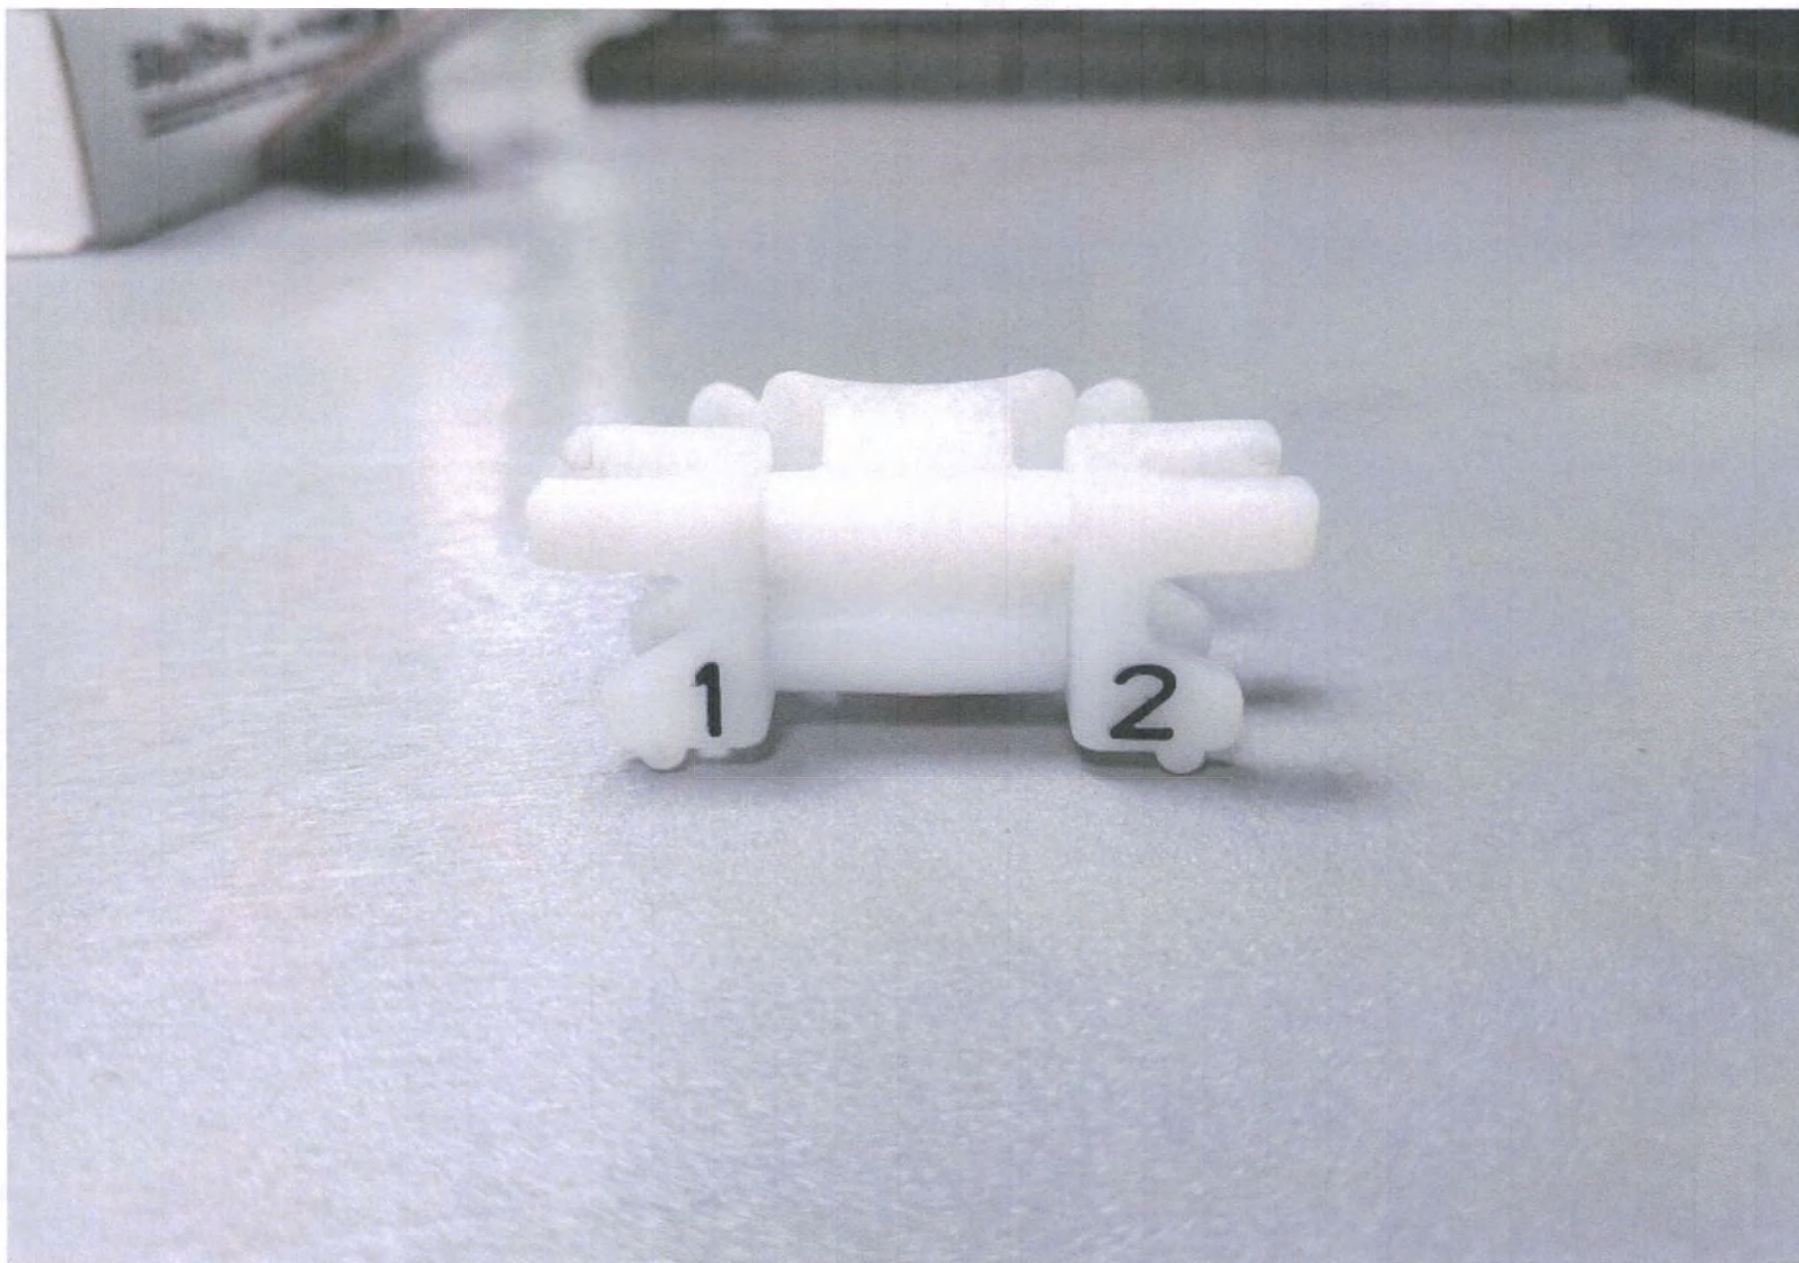


Насадка для крепления сенсора на датчик конвексный CA1-7S



Насадка для крепления сенсора на датчик эндовапитальный EA2-11AR/EA2-11AV



Переключатель ножной

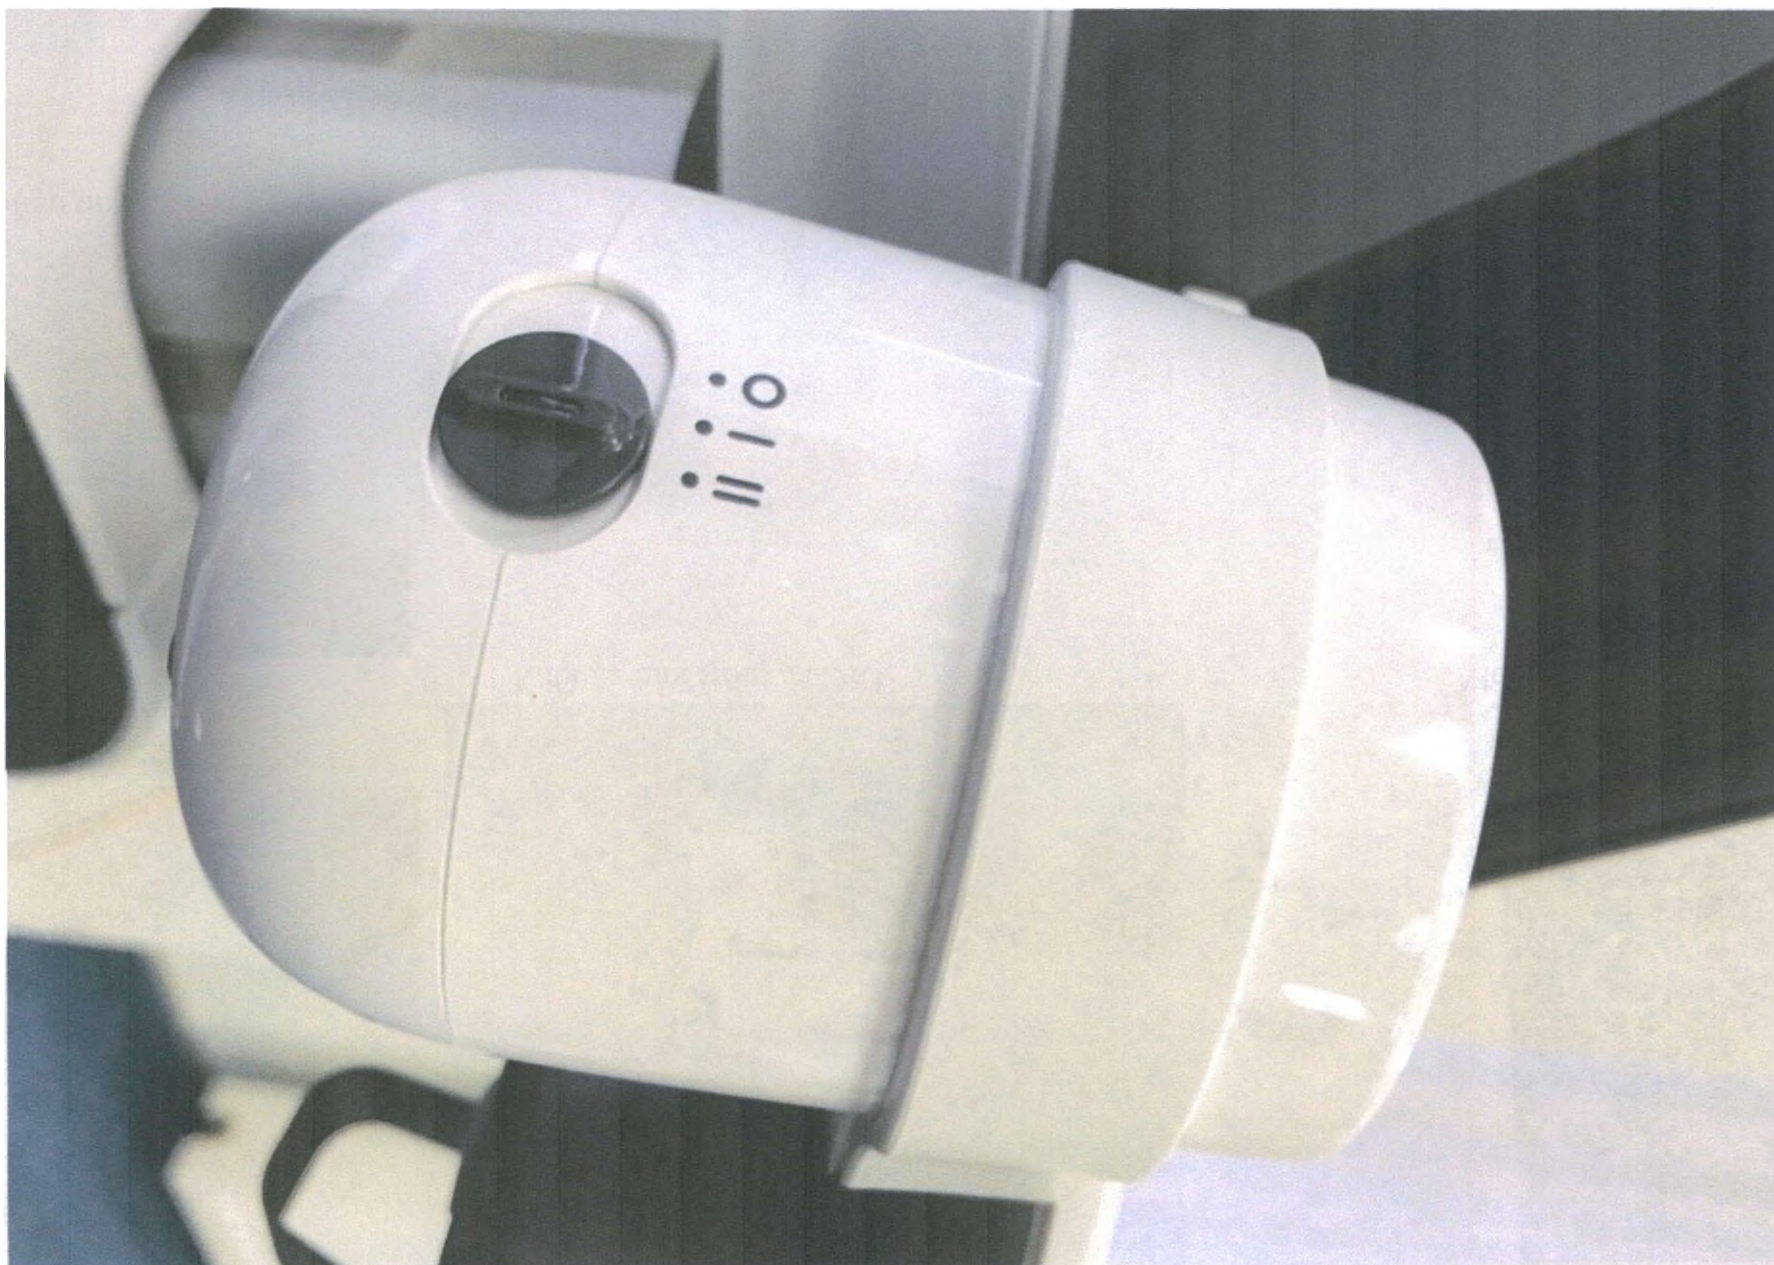

Подогреватель геля




Флэш-накопитель
данных



Кабель для модуля ЭКГ



Модуль ЭКГ

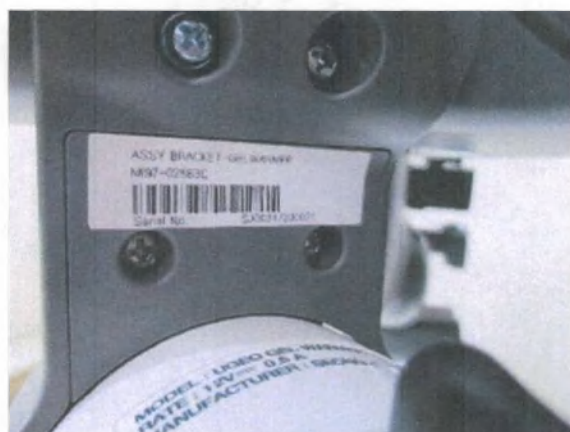

Позиционер подогревателя геля

Лицензионные ключи представляют собой буквенно-цифровые коды. Таким образом, предоставление фотографических изображений не представляется возможным.

Макет маркировки медицинского изделия

	SAMSUNG MEDISON CO., LTD. 3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108, REPUBLIC OF KOREA www.samsunghealthcare.com	
	Samsung Electronics GmbH Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY	 ВНИМАНИЕ
• MODEL/МОДЕЛЬ: RS85-RUS • POWER/ПИТАНИЕ: 100-240В~, 50/60Гц, 1000VA макс. • WEIGHT/ВЕС: около 151 кг		MEDICAL DEVICE - Do not remove the system's covers; hazardous voltages are present inside. The cabinet panels must be in place while the system is in use. - Внутри системы опасное для жизни высокое напряжение. Никогда не включайте в сеть УЗ сканер со снятыми панелями корпуса. Всегда используйте защитное заземление при работе системы.
 MI68-03665C RUS-0431		   
СДЕЛАНО В КОРЕЕ		

Генеральный
директор
Виктор А.В.



Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

(126) ЛИСТОВ