

Директор по качеству и регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»

«Сименс А.В. Фирстова»
«26» _____ 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения тироксина на анализаторах иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Total Thyroxine (Atellica IM T4))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

2022

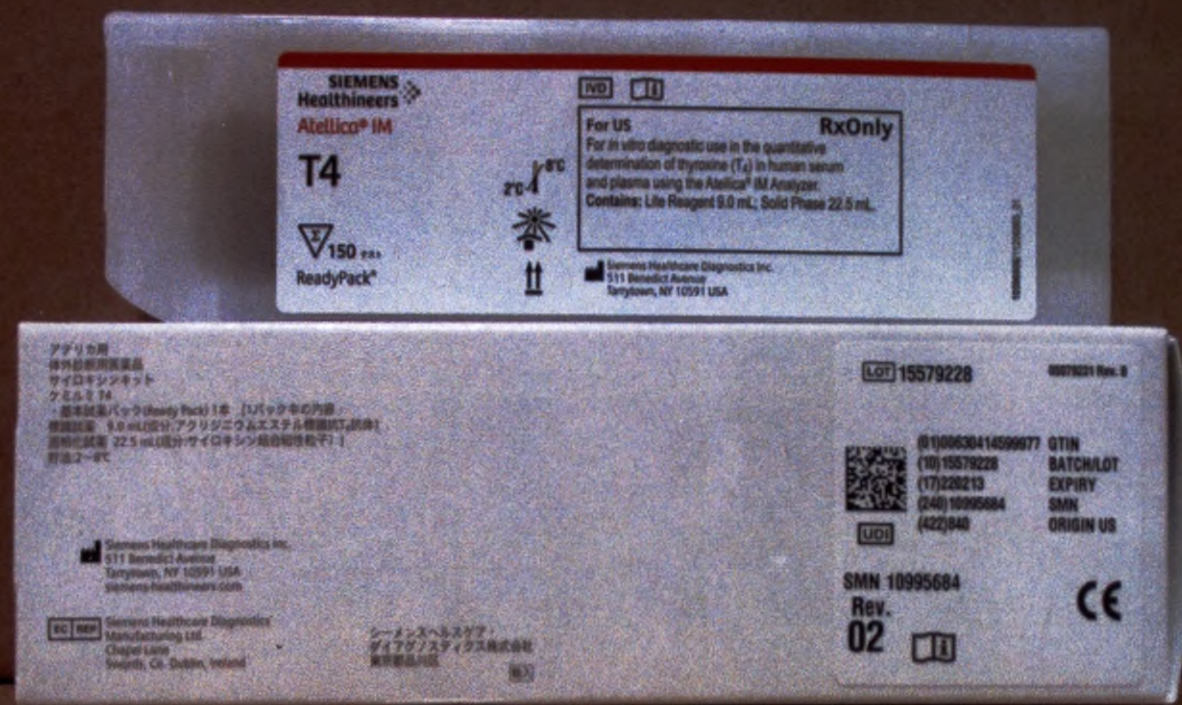


Рисунок 1. «Набор реагентов для определения тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine (Atellica IM T4))». Фасовка 150 тестов.

Общий вид

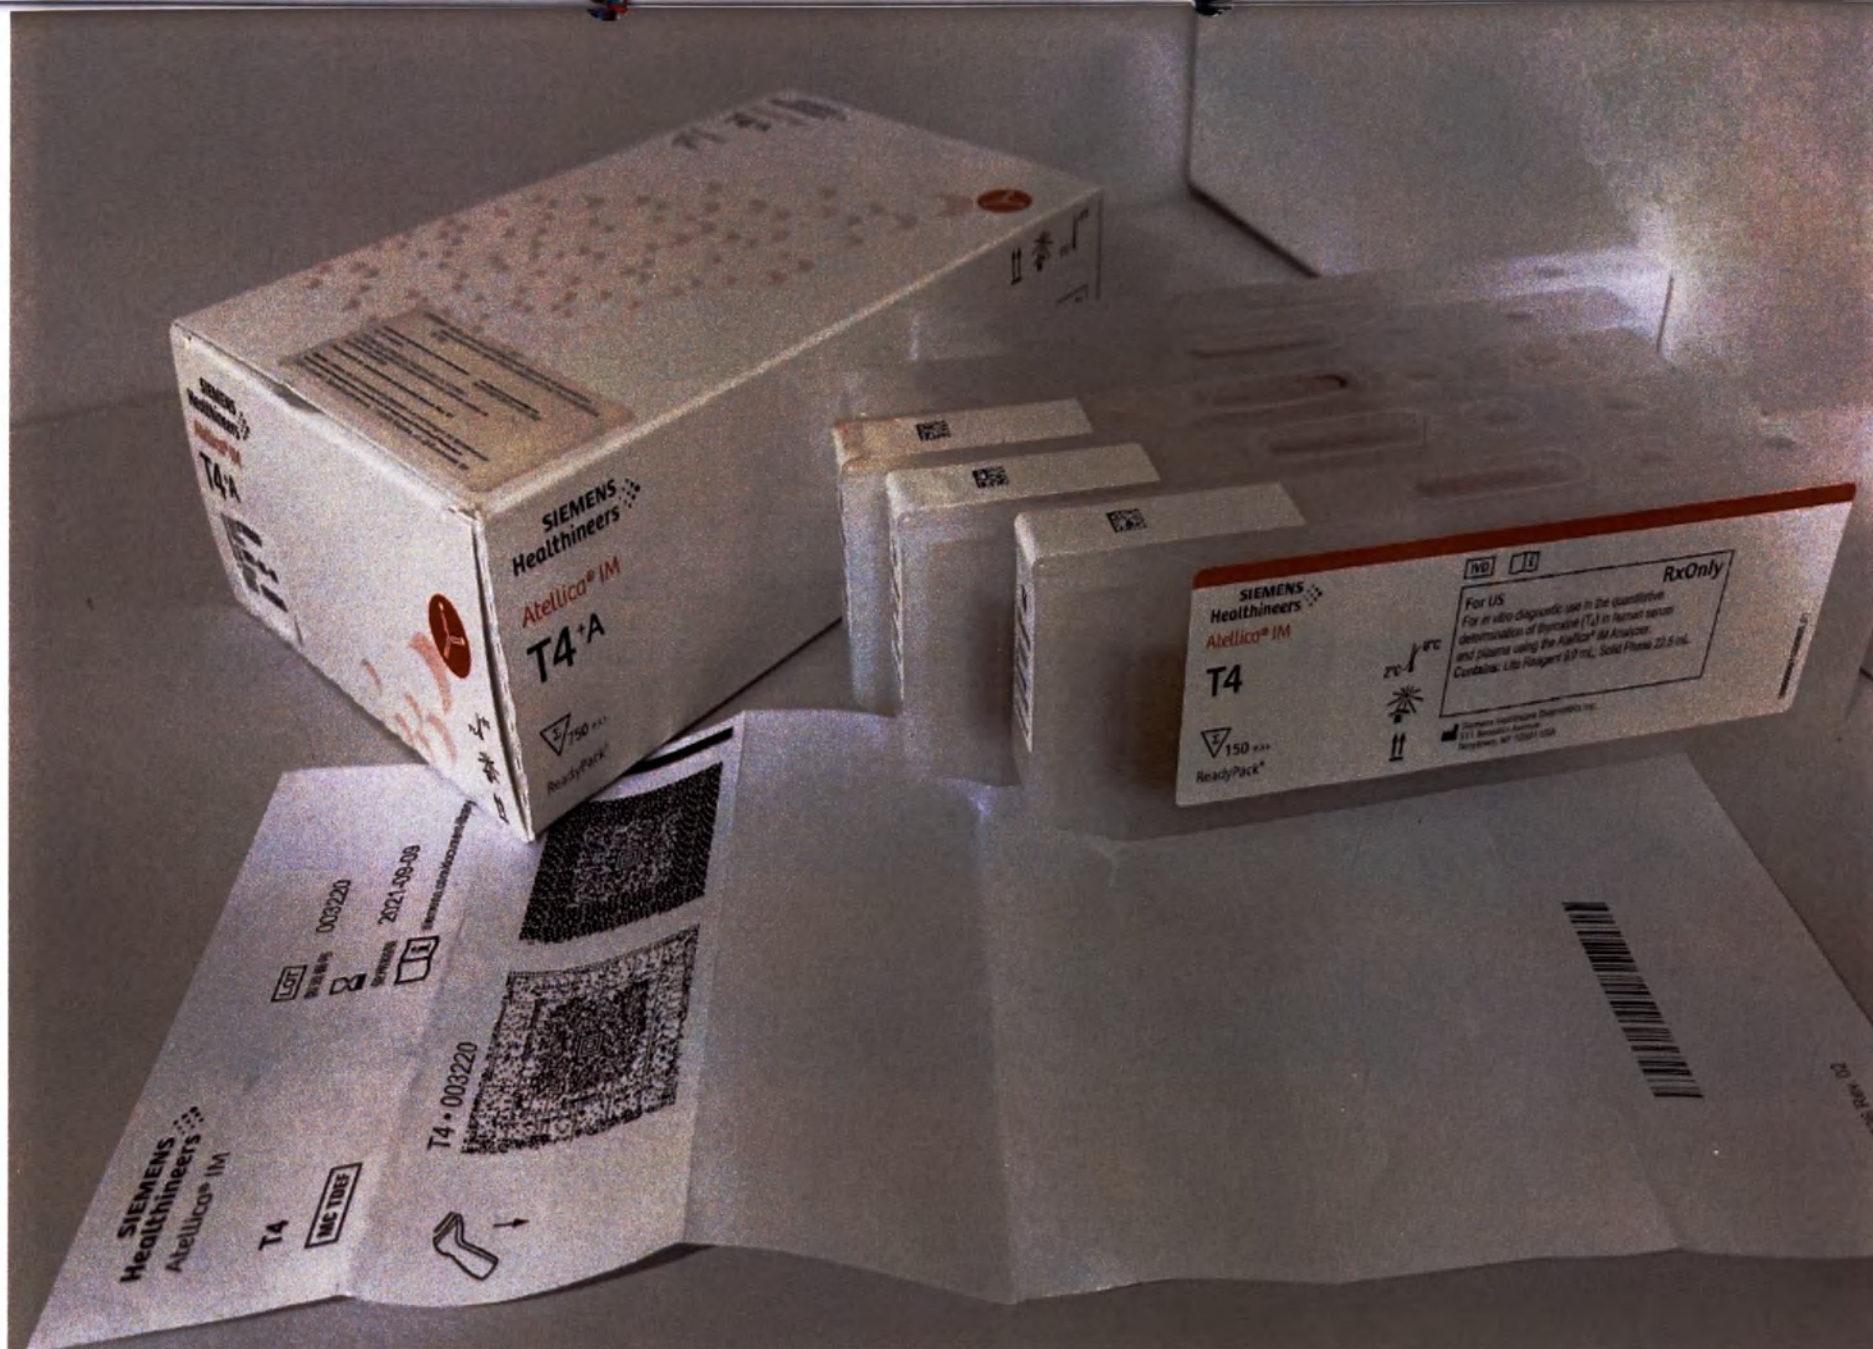


Рисунок 2. «Набор реагентов для определения тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine (Atellica IM T4))». Фасовка 750 тестов.

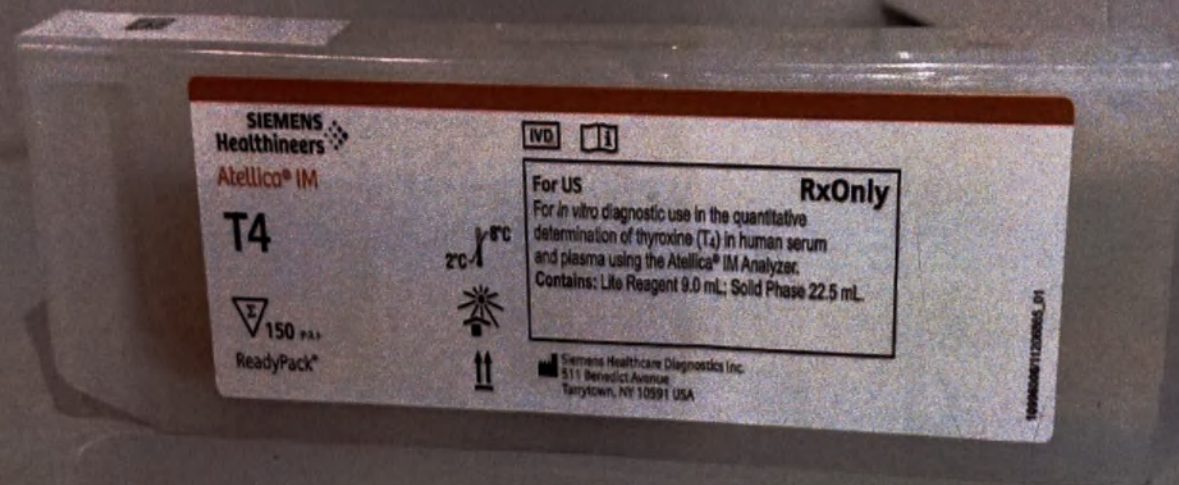


Рисунок 3. «Набор реагентов для определения тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine (Atellica IM T4))». Первичный реагент

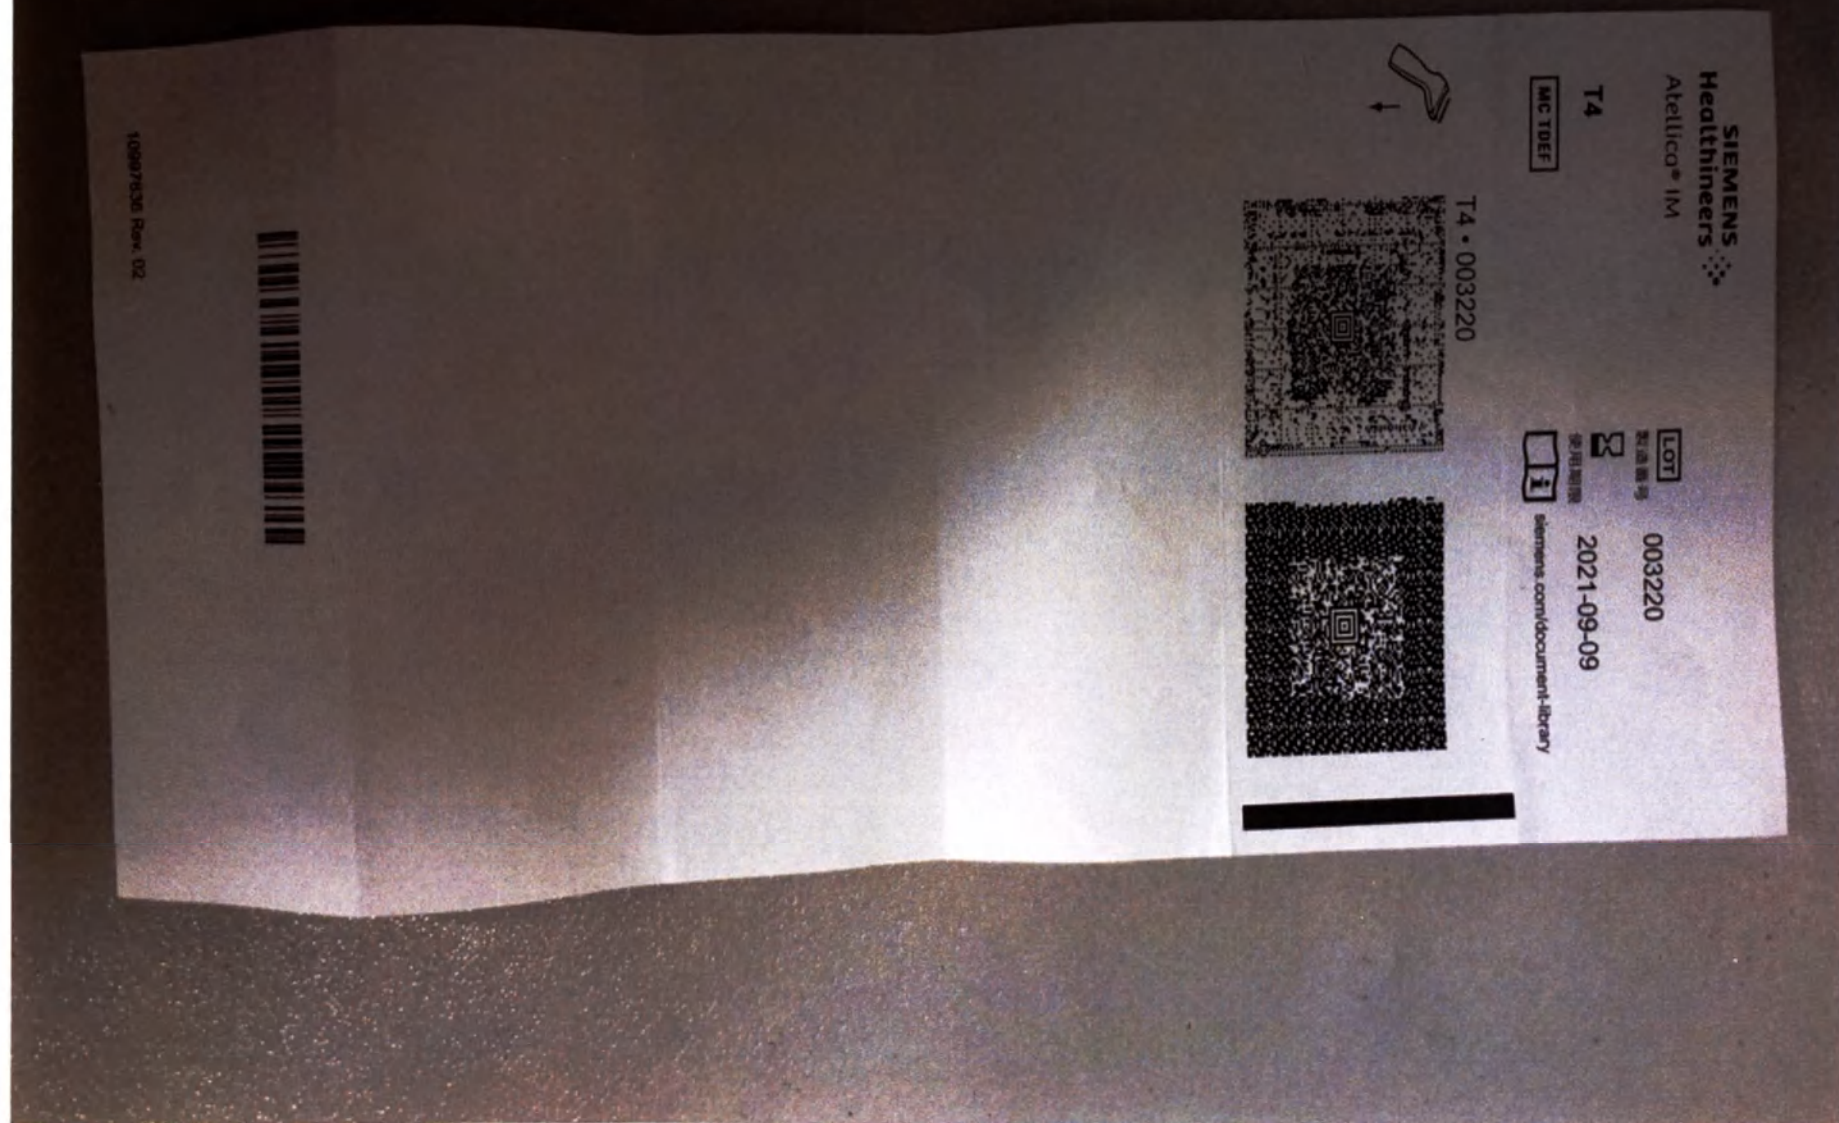


Рисунок 4. «Набор реагентов для определения тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine (Atellica IM T4))». Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM T4

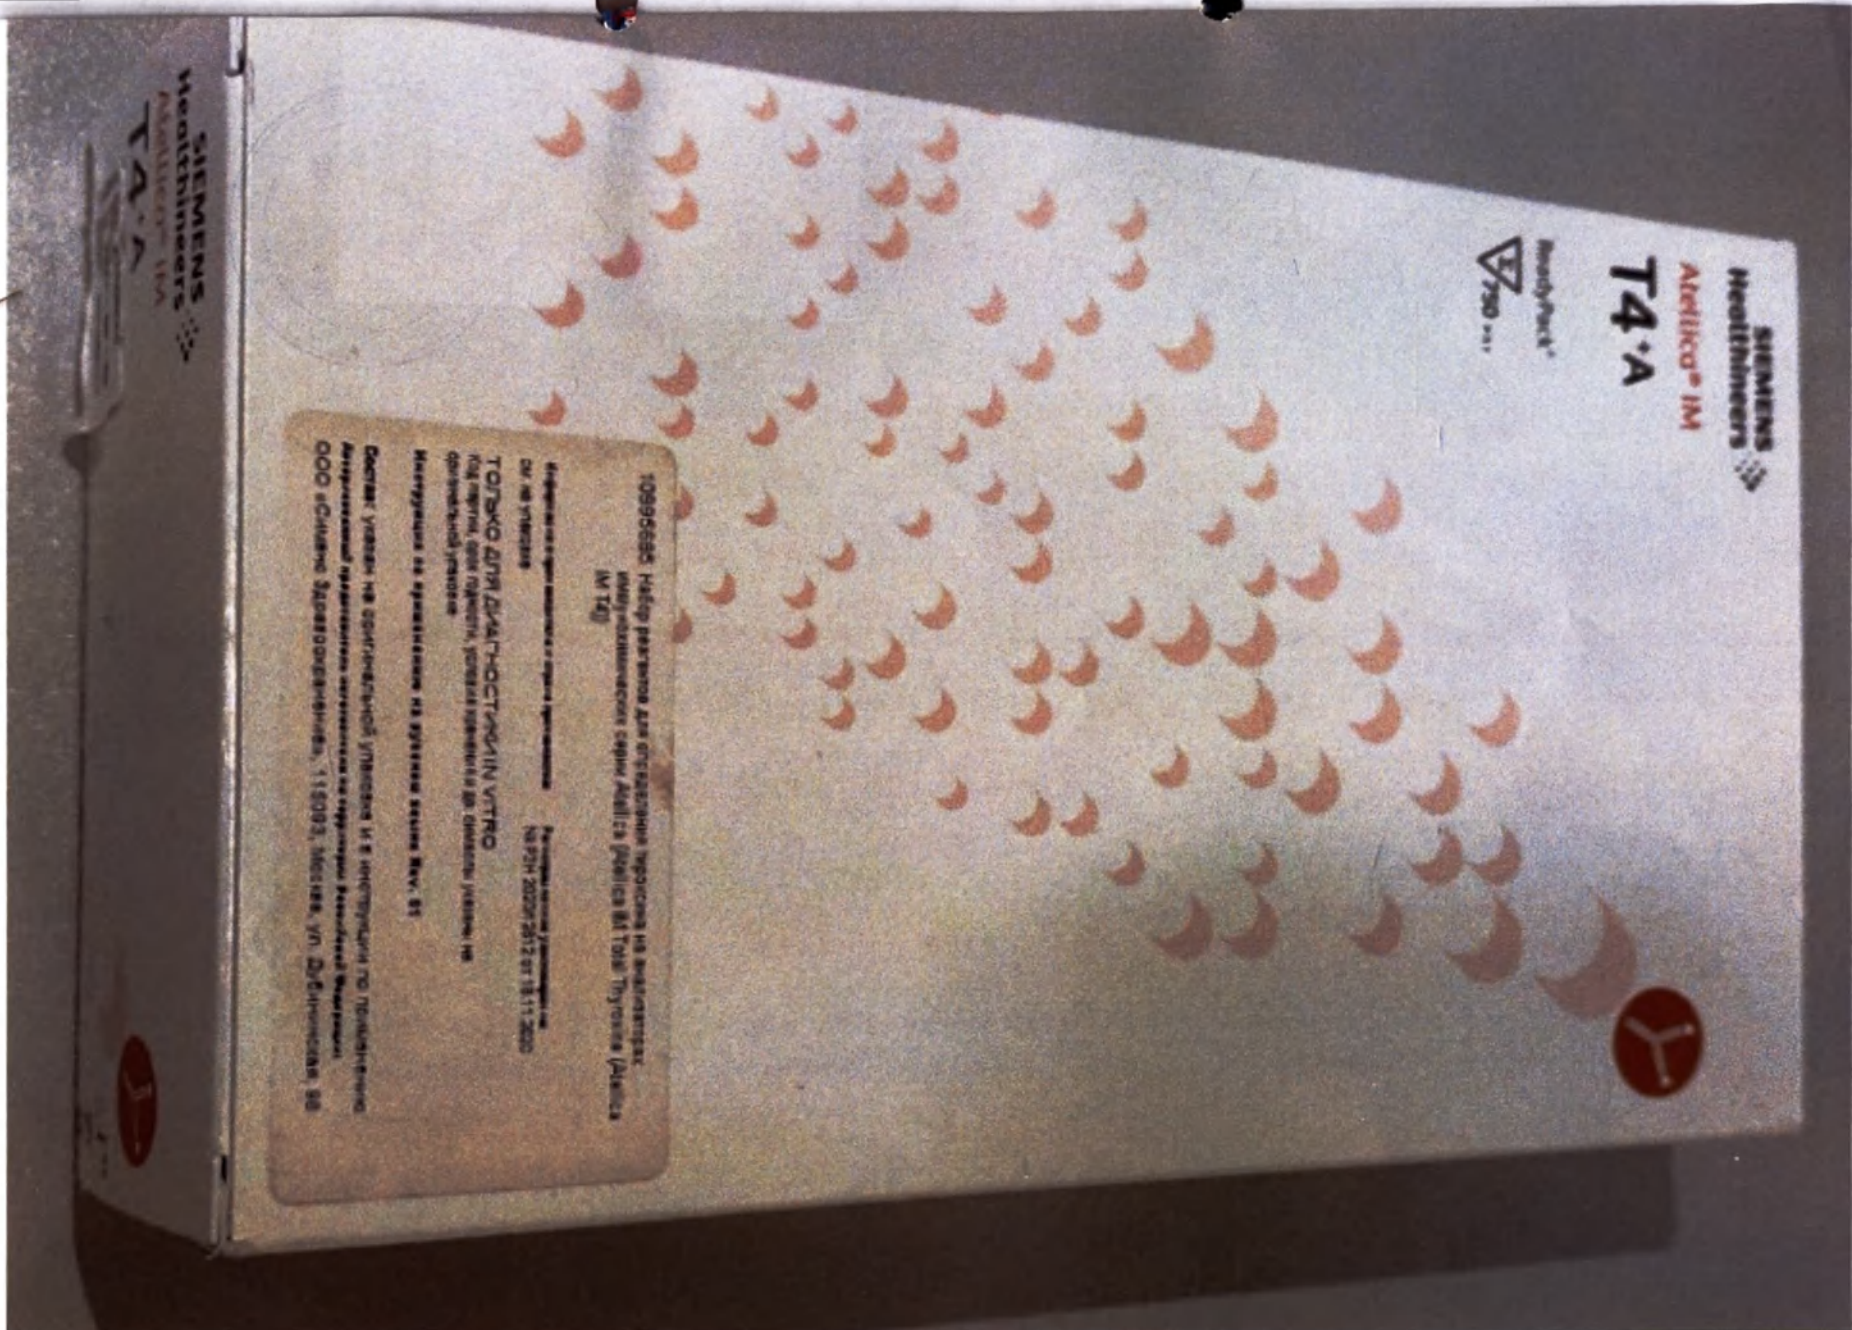


Рисунок 5. «Набор реагентов для определения тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine (Atellica IM T4))». Русскоязычный макет маркировки.



Всё прочитано и пронумеровано
в 5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»