

Макет маркировки картонной коробки медицинского изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови


Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018»



2

Gmate LIFE

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GOD

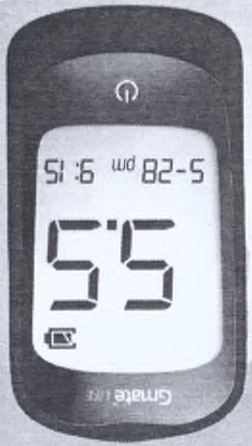

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GOD

Содержимое упаковки:

- Глюкометр Gmate Life (GOD) 1 шт.
- Фуринг 1 шт.
- Литиевая батарея (CR2032) 1 шт.
- Лампочка 1 шт.
- Тест-полоски GOD 25 шт.
- Устройство для прокалывания пальца (карификатор) 1 шт.
- Ветрушки 3 шт.

Сделано в России



Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GOD

Для самостоятельного использования. Не требует Gmate / Ye Tonlyo и тест-полосок Gmate.

Анализ осуществляется для измерения уровня глюкозы в крови.

См. инструкцию к устройству.

Ad

TV 26.60.12-001-87000462-2018


Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови

Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018»



Макет маркировки грузовых мест медицинского изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови

Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018»

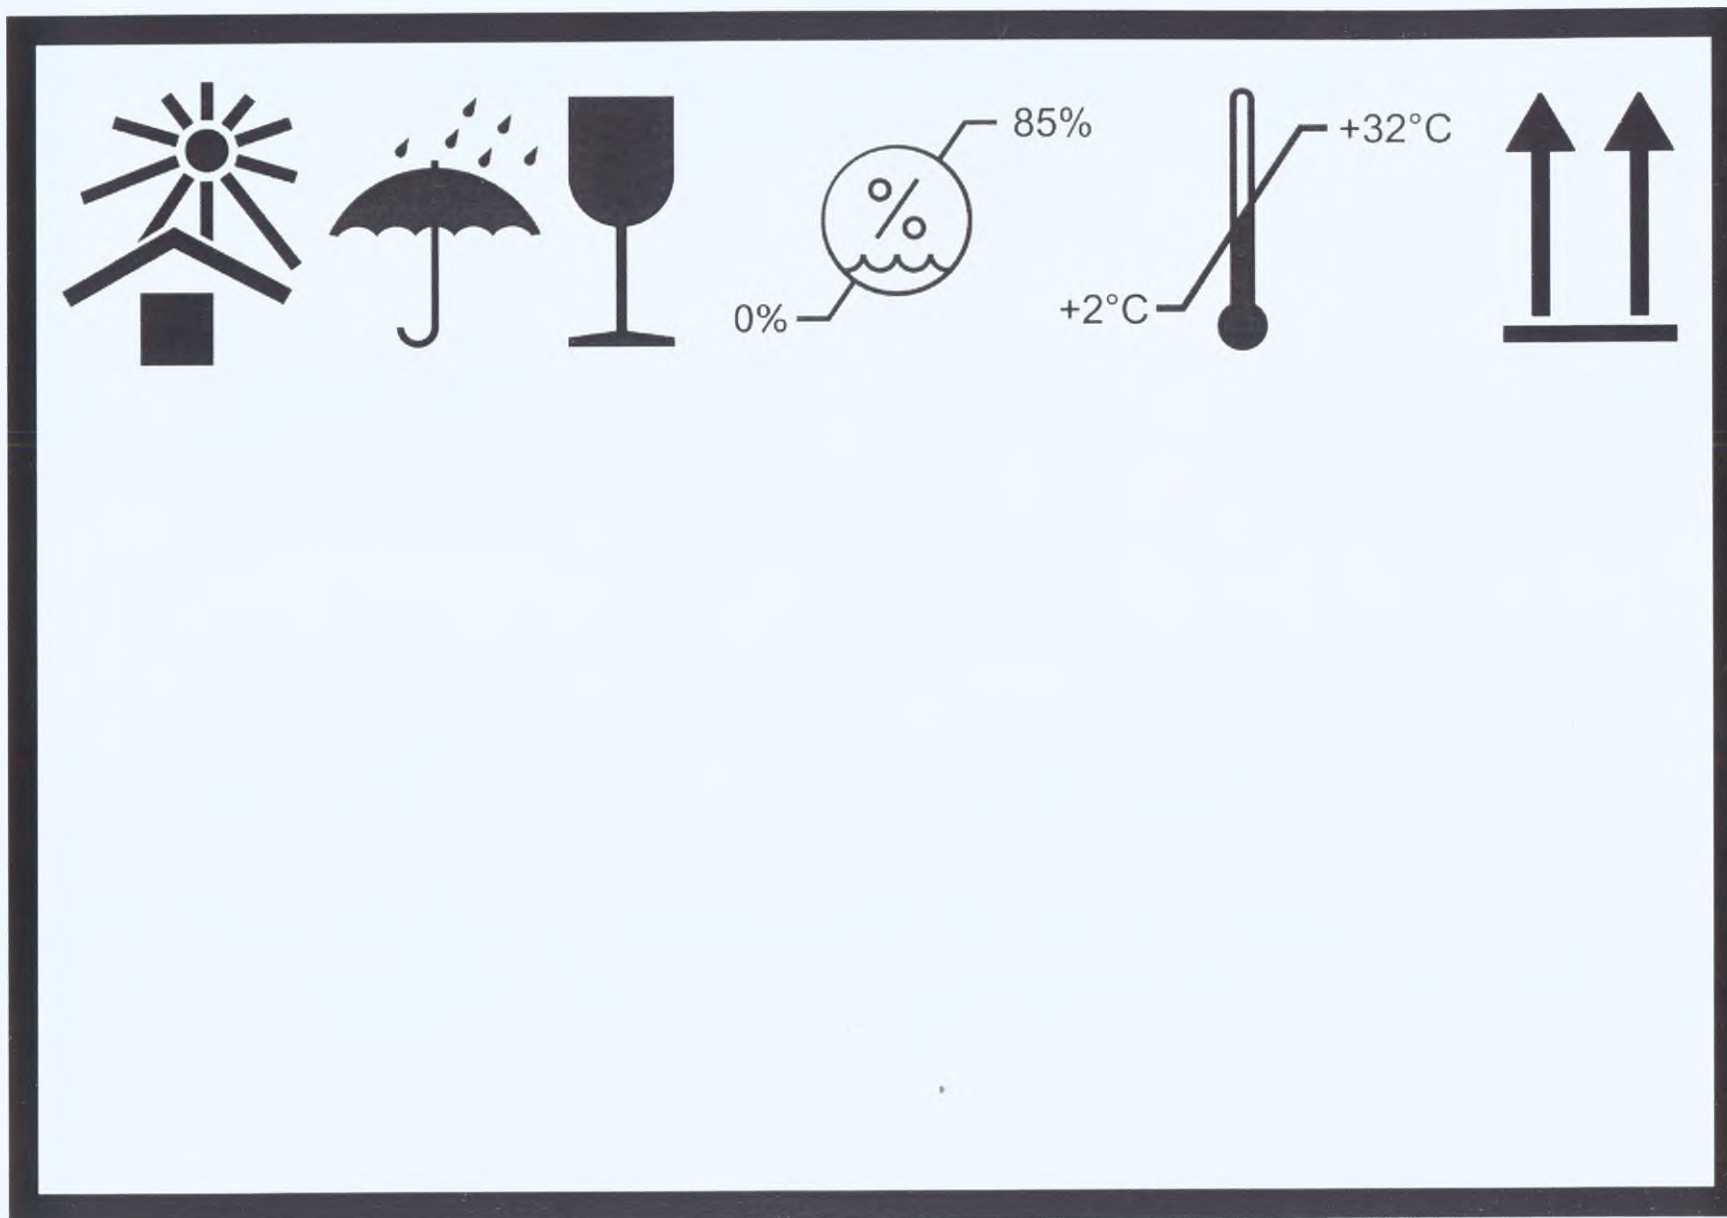

Система контроля уровня глюкозы в крови

Gmate *LIFE* GDH

3V  CR2032 10mW

Для самотестирования.

Использовать только
с тест-полосками Gmate Life.



SN

LOT



ООО «МедТехСервис», Россия, Иркутская обл.
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 546

Система контроля уровня глюкозы в крови

Gmate *LIFE* GOD

3V  CR2032 10mW

Для самотестирования.

Использовать только
с тест-полосками Gmate Life.



SN

LOT



ООО «МедТехСервис», Россия, Иркутская обл.
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 546

Генеральный директор
ООО «МедТехСервис»



Журавлев Артём Андреевич

Всего страниц, пронумерованных
и утвержденных (из 24)

интер.

Подпись: *[подпись]*


Д.В. *[подпись]*

Д.В. *[подпись]*




Фотографические изображения

«Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018», в вариантах исполнения

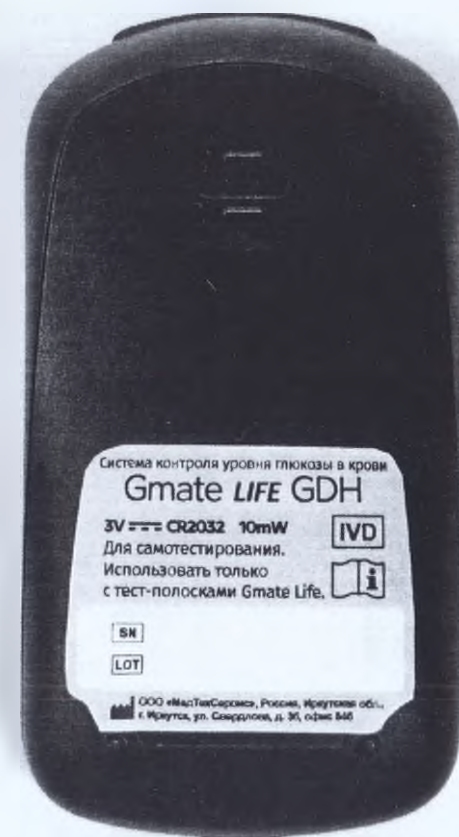


Глюкометр Gmate Life (GDH)

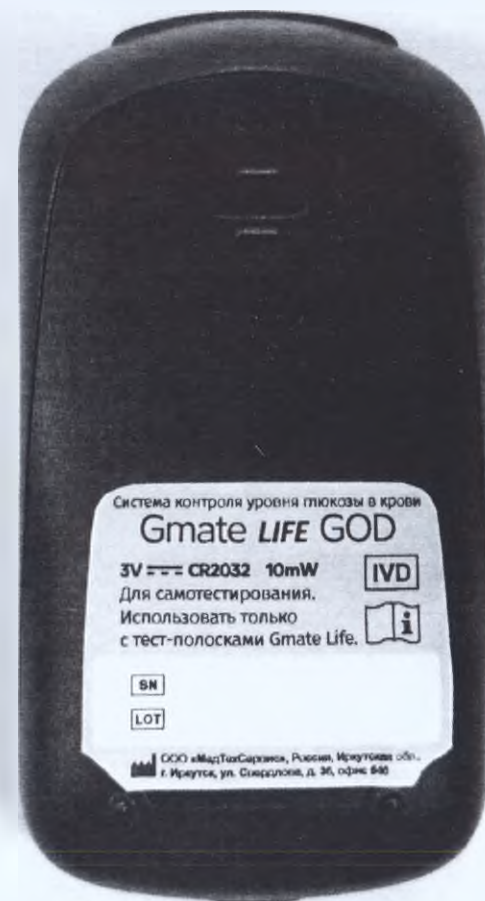

Глюкометр Gmate Life (GOD)



Тест-полоски GOD 35×5 мм

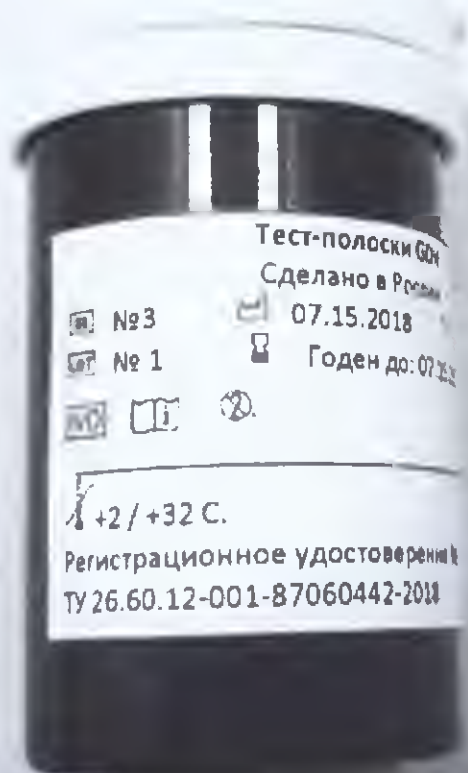

Тест-полоски GDH 30x5 мм




Литиевая батарея (CR2032)





Футляр





Устройство для прокалывания пальца(скарifikатор) (РУ №ФСЗ 2012/13227 от 09.11.2012 г.)

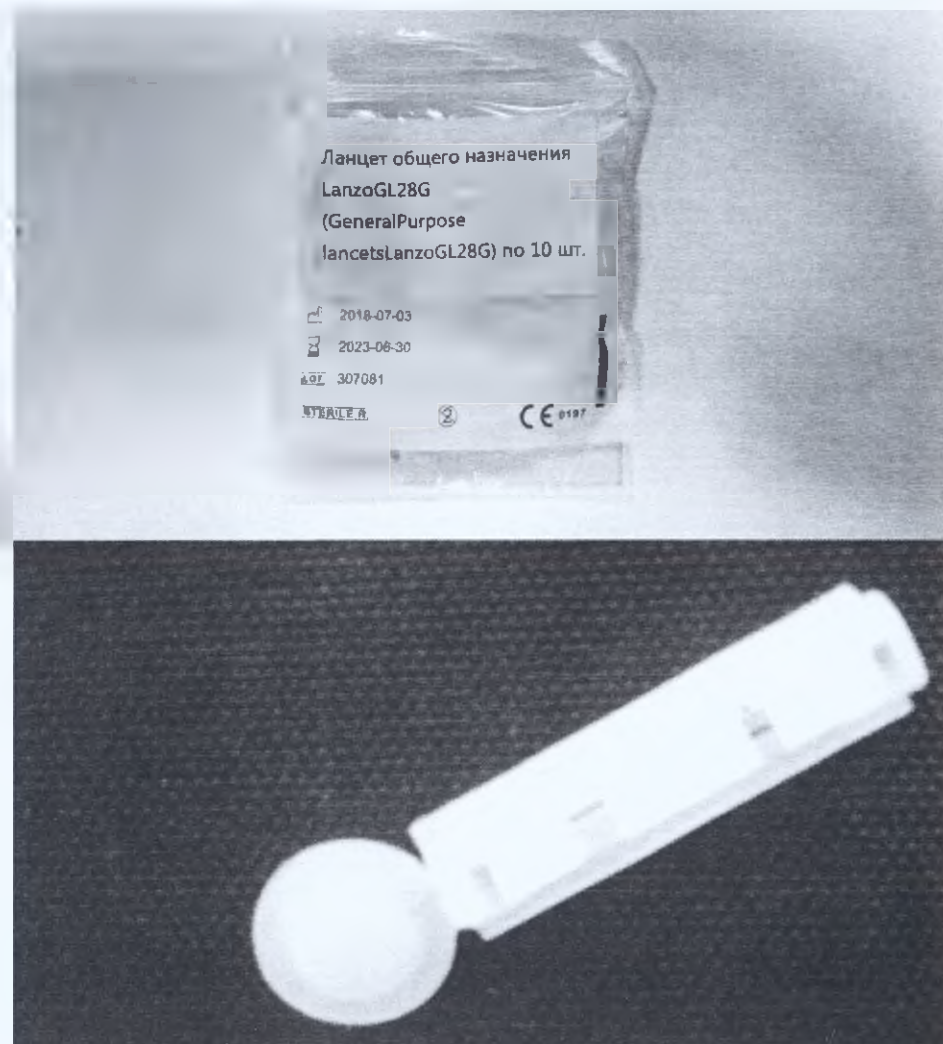

Ланцеты (РУ №ФСЗ 2012/13227 от 09.11.2012 г.)

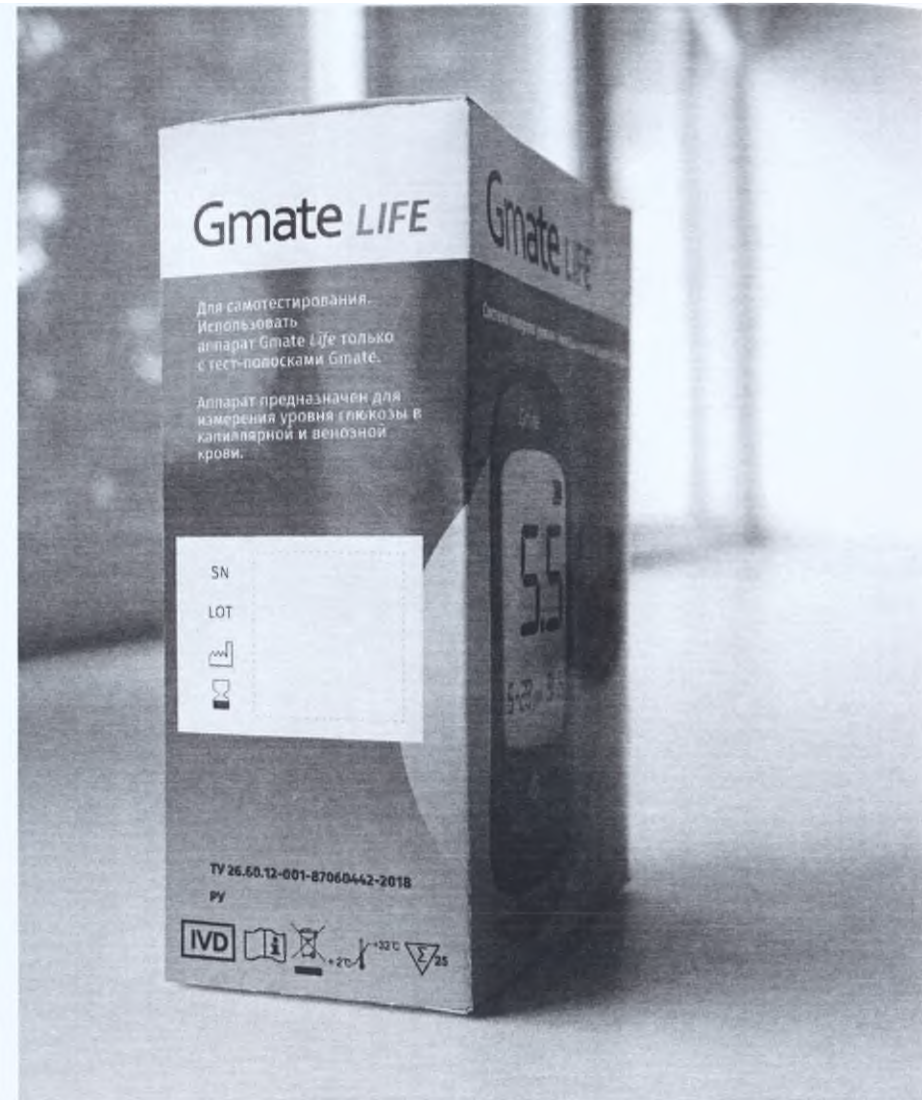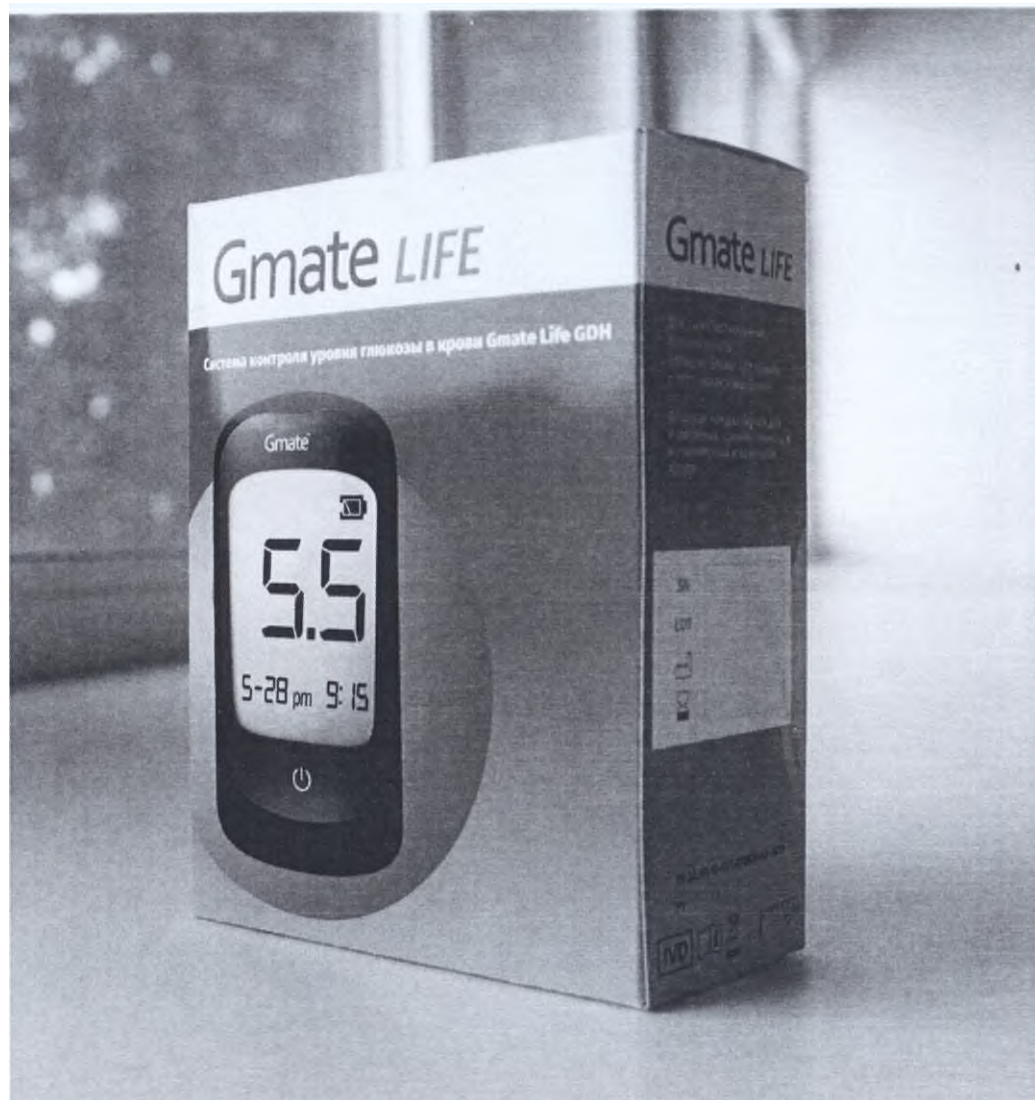

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GDH

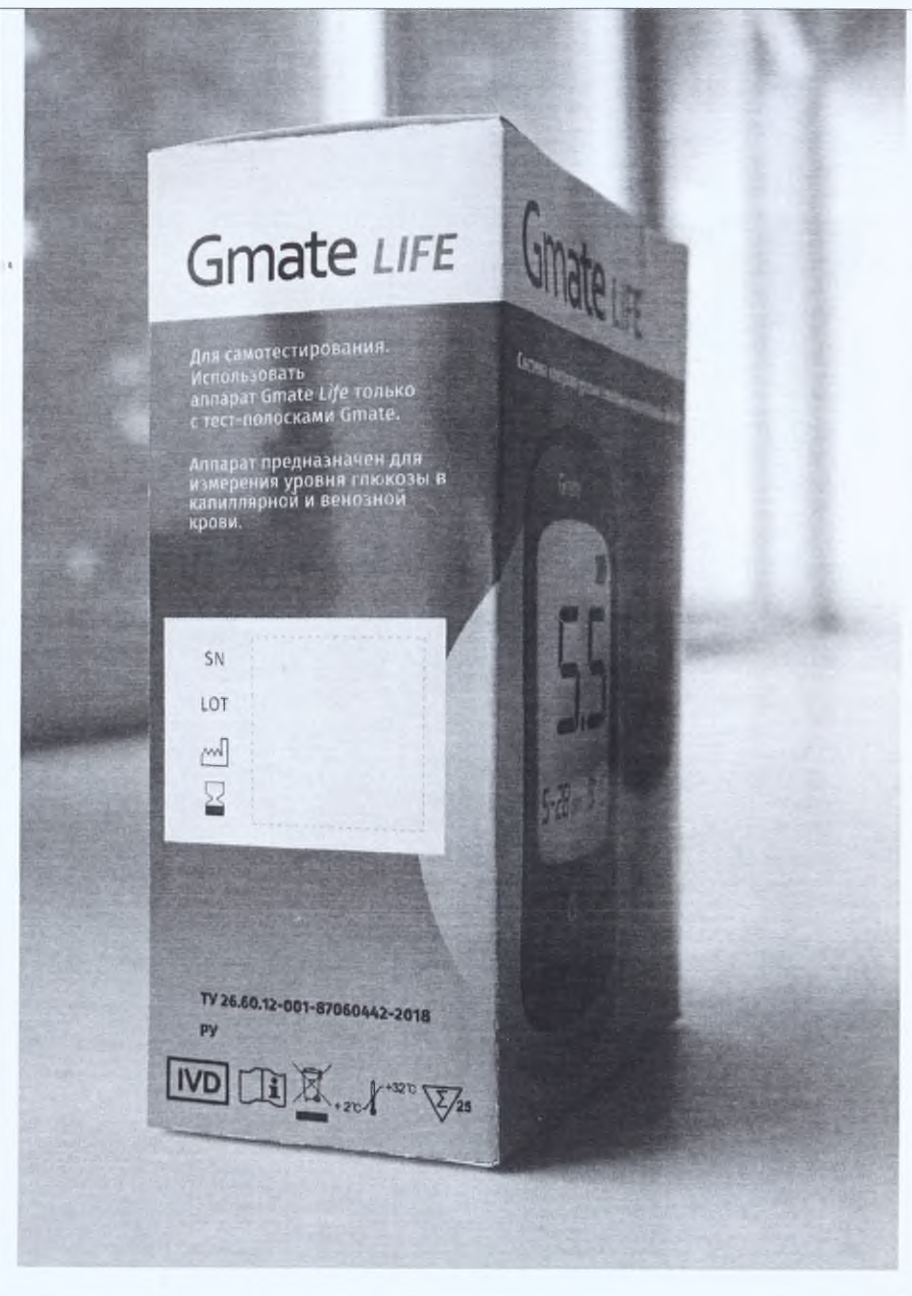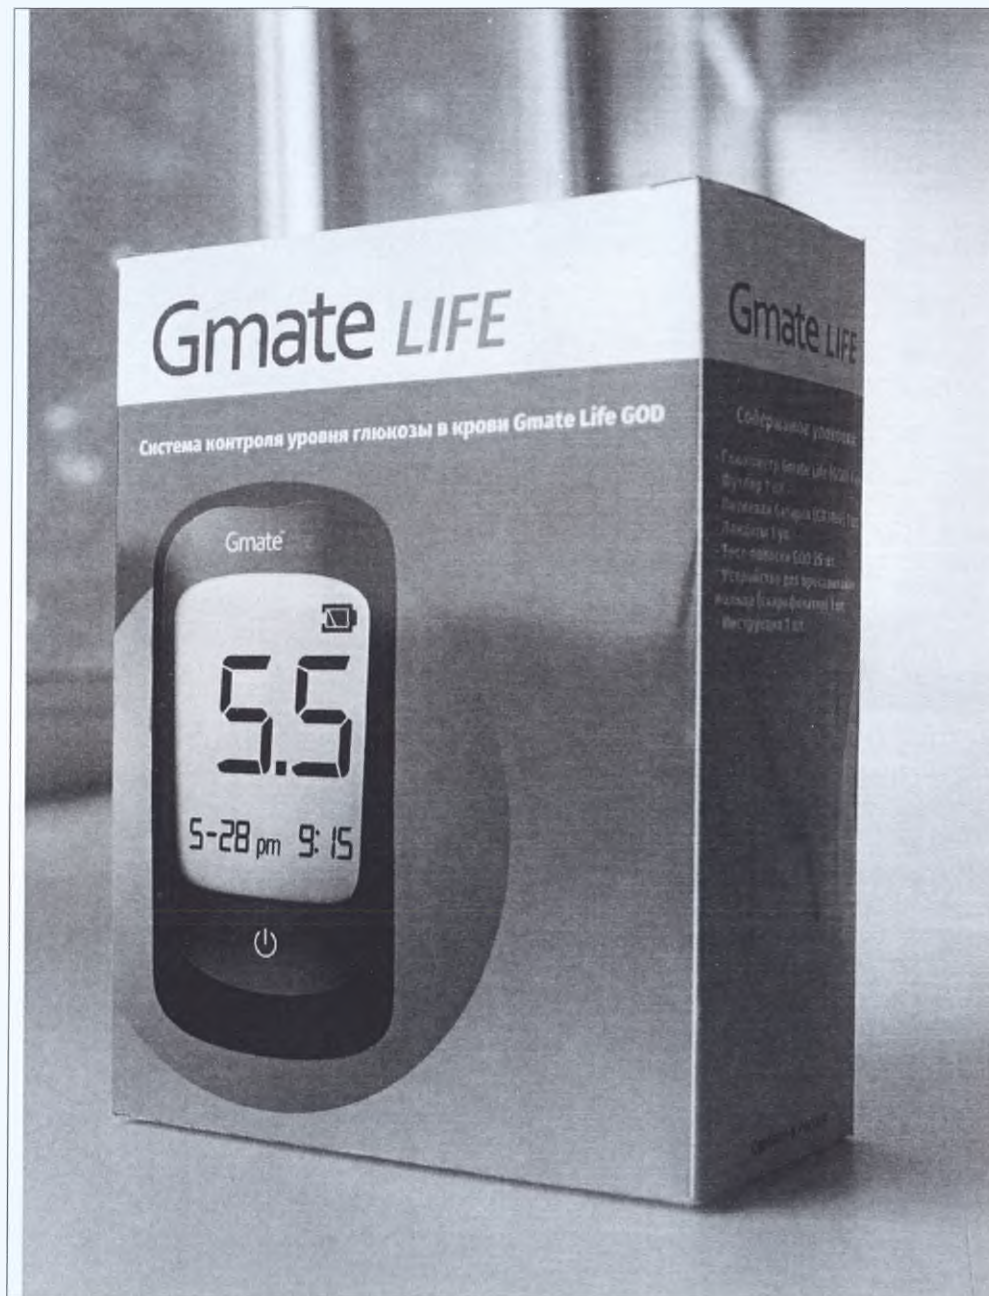

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GOD

Внес изменений, проанализировано
использовано 100% (100%)
материалов

Температура да 100%
ООО «МедТек»
А.А. Мерзляков

