

Фотографии медицинского изделия
Аппарат рентгеновский диагностический
телеуправляемый Р-600 «Полидиагност»,
производства ООО «ВКО Медпром», Россия




МЕДПРОМ


АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» ИСПОЛНЕНИЕ 1

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

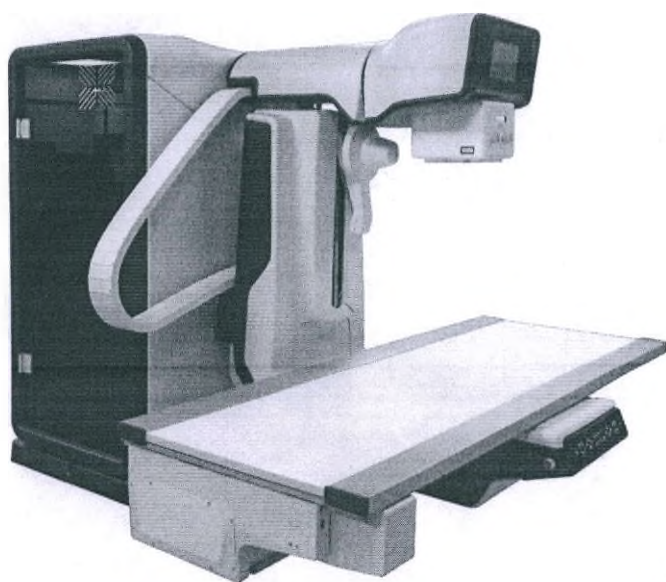


Стол телеуправляемый



РПУ



**Педаль включения
рентгеновского излучения**

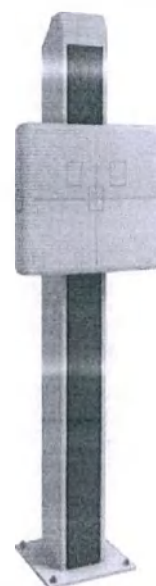

**Стойка снимков
цифровая**

Пультовая:



Пульт управления



**Педаль включения
рентгеновского излучения**



АРМ лаборанта



МЕДПРОМ

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» ИСПОЛНЕНИЕ 2

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:



Стол телеуправляемый




**Двойная педаль
включения экспозиции**




РПУ

Стол-каталка X Mobil

Пультовая:

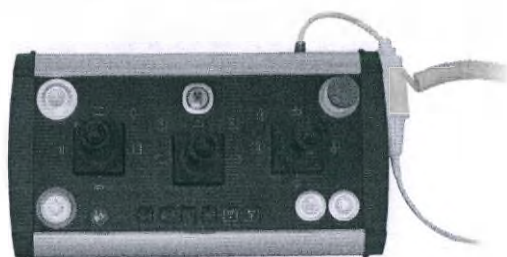

Пульт управления

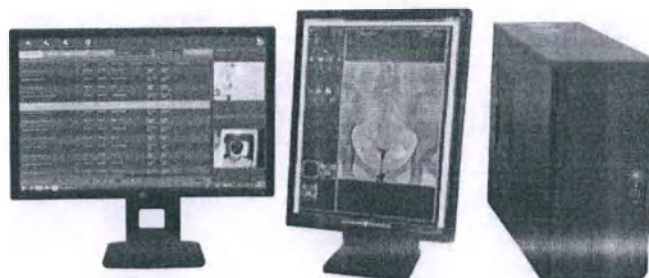

АРМ оператора



**Двойная педаль
включения экспозиции**




МЕДПРОМ


АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» ИСПОЛНЕНИЕ 3

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

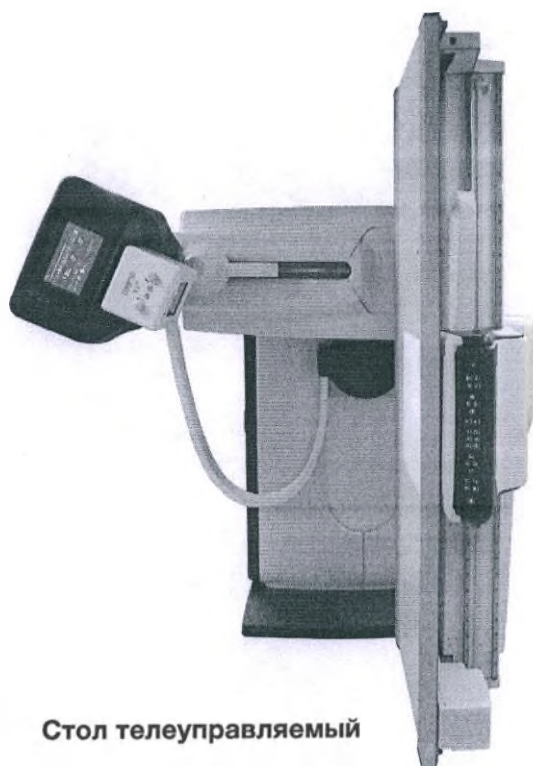

Стол телеуправляемый



РПУ



Педаль включения
рентгеновского
излучения



Стойка мониторная
на ней консоль управления

Пультовая:



Пульт управления



Педаль включения
рентгеновского излучения



АРМ оператора




МЕДПРОМ


АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» ИСПОЛНЕНИЕ 4

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

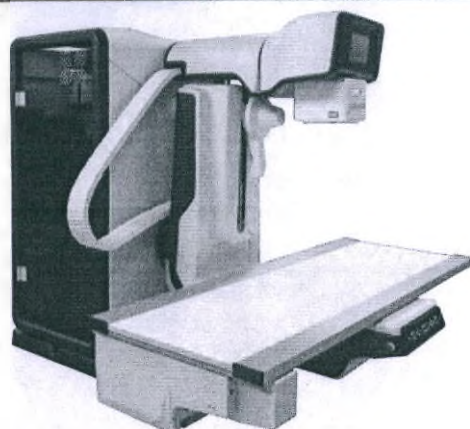


Стол телеуправляемый



РПУ




Двойная педаль
включения экспозиции

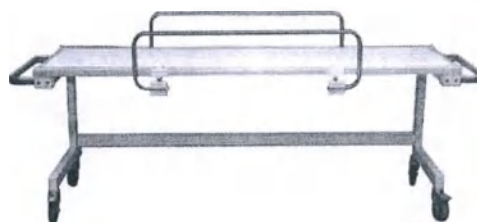


Стол пациента передвижной

Пультовая:

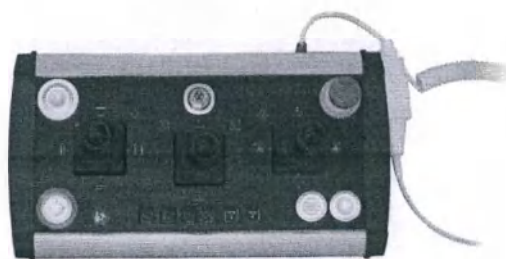

Пульт управления

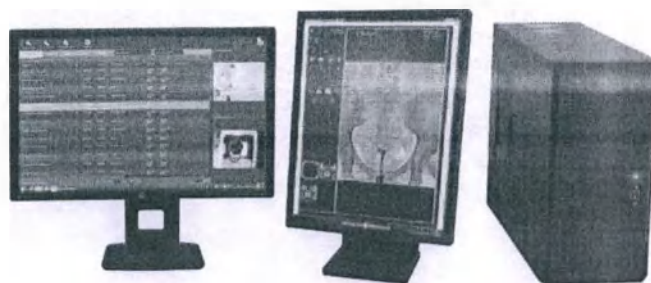


АРМ оператора




Двойная педаль
включения экспозиции

Процедурная:

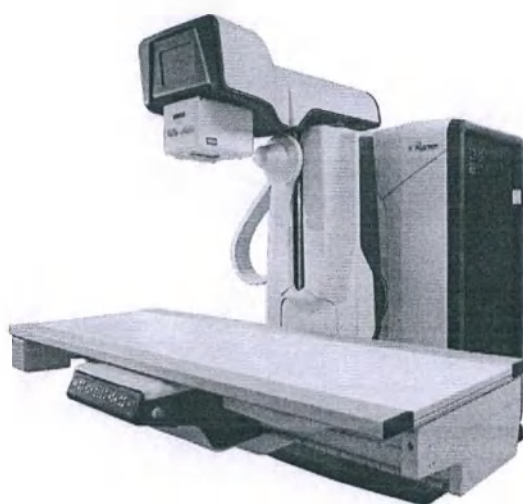


Стол телеуправляемый



РПУ



**Двойная педаль
включения экспозиции**

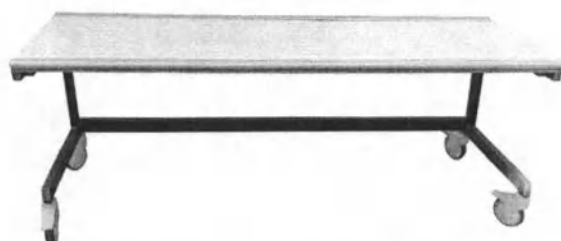

Стол пациента передвижной


Пультовая:



Пульт управления



**Двойная педаль
включения экспозиции**

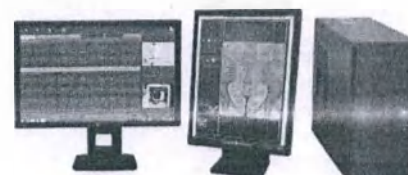

АРМ оператора


АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» ИСПОЛНЕНИЕ 6

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:



Стол
телеуправляемый




РПУ



Стойка мониторная
на ней консоль управления




Педаля включения
рентгеновского излучения

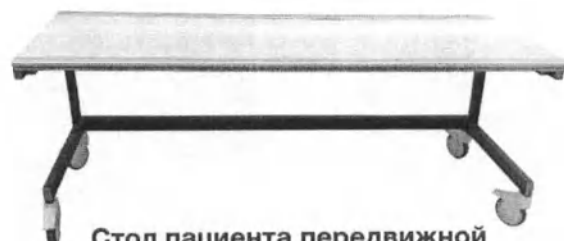

Стол пациента передвижной

Пультовая:

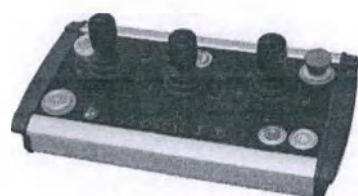

Пульт управления




Педаля включения
рентгеновского излучения



АРМ оператора

Процедурная:

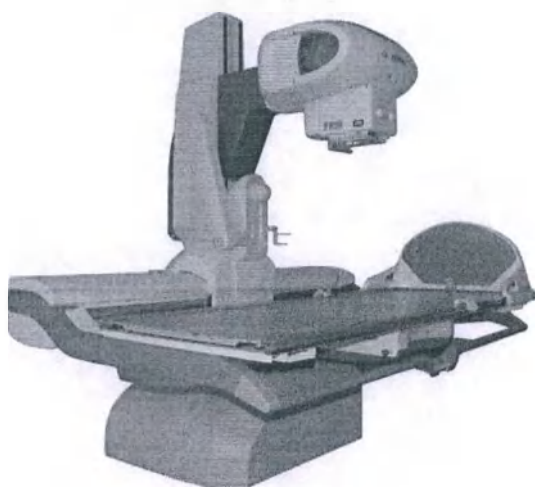

Стол телеуправляемый



Педаля включения флюороскопии




РПУ




Стол-каталка X Mobil

Пультовая:

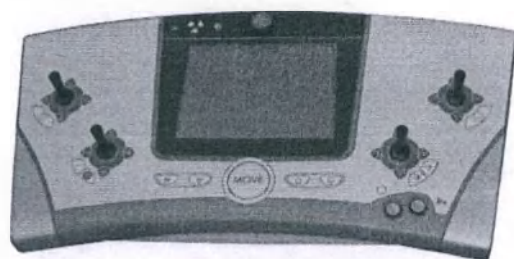


Пульт управления

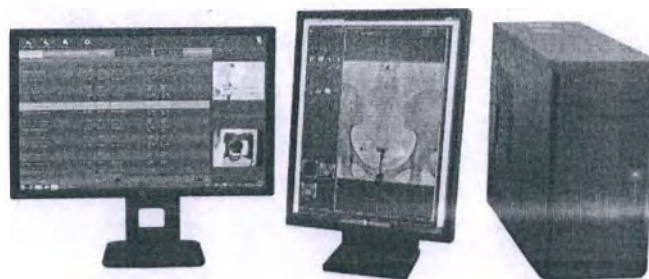


АРМ оператора




Педаля включения флюороскопии

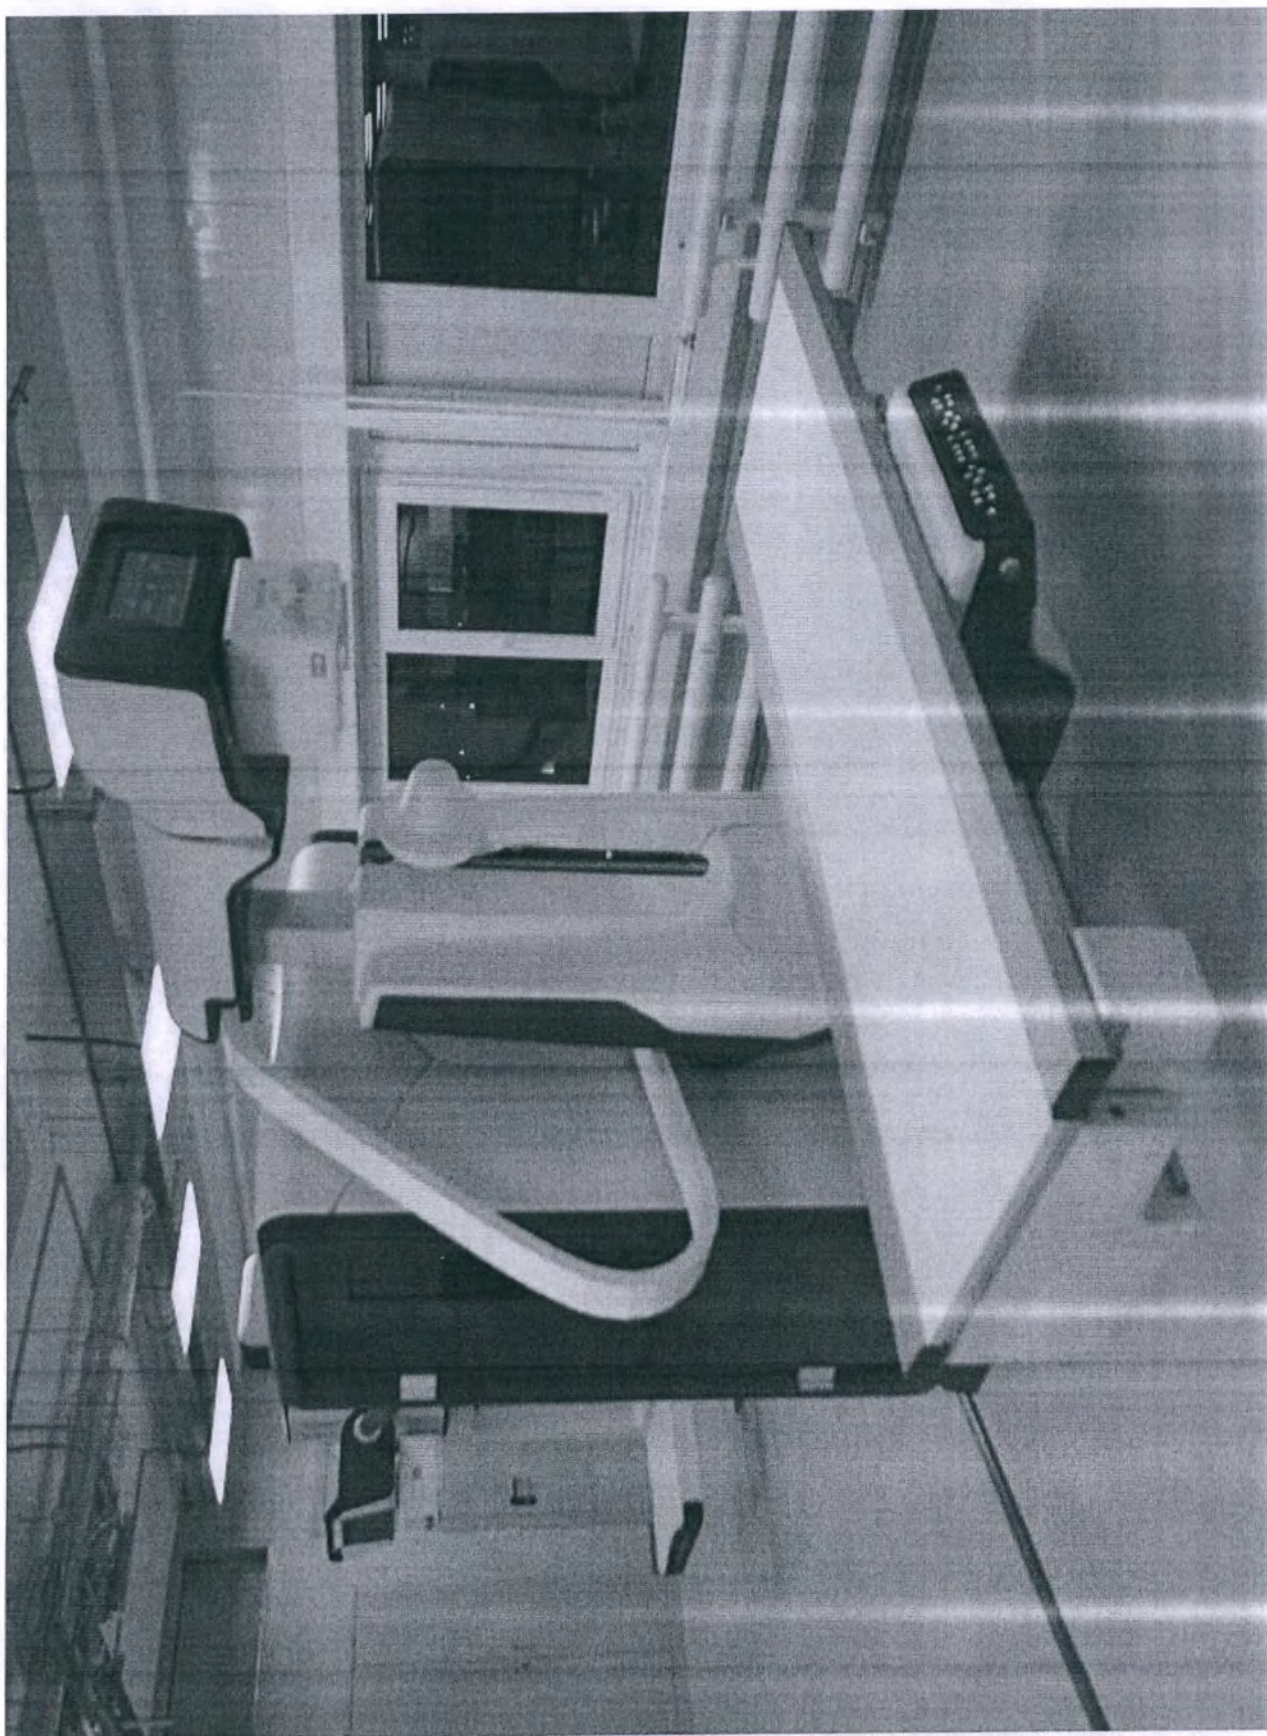

Стол телеуправляемый, (с возможностью перемещения деки в двух или четырех направлениях, с лифтом стола или без лифта стола) T1-B0200, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

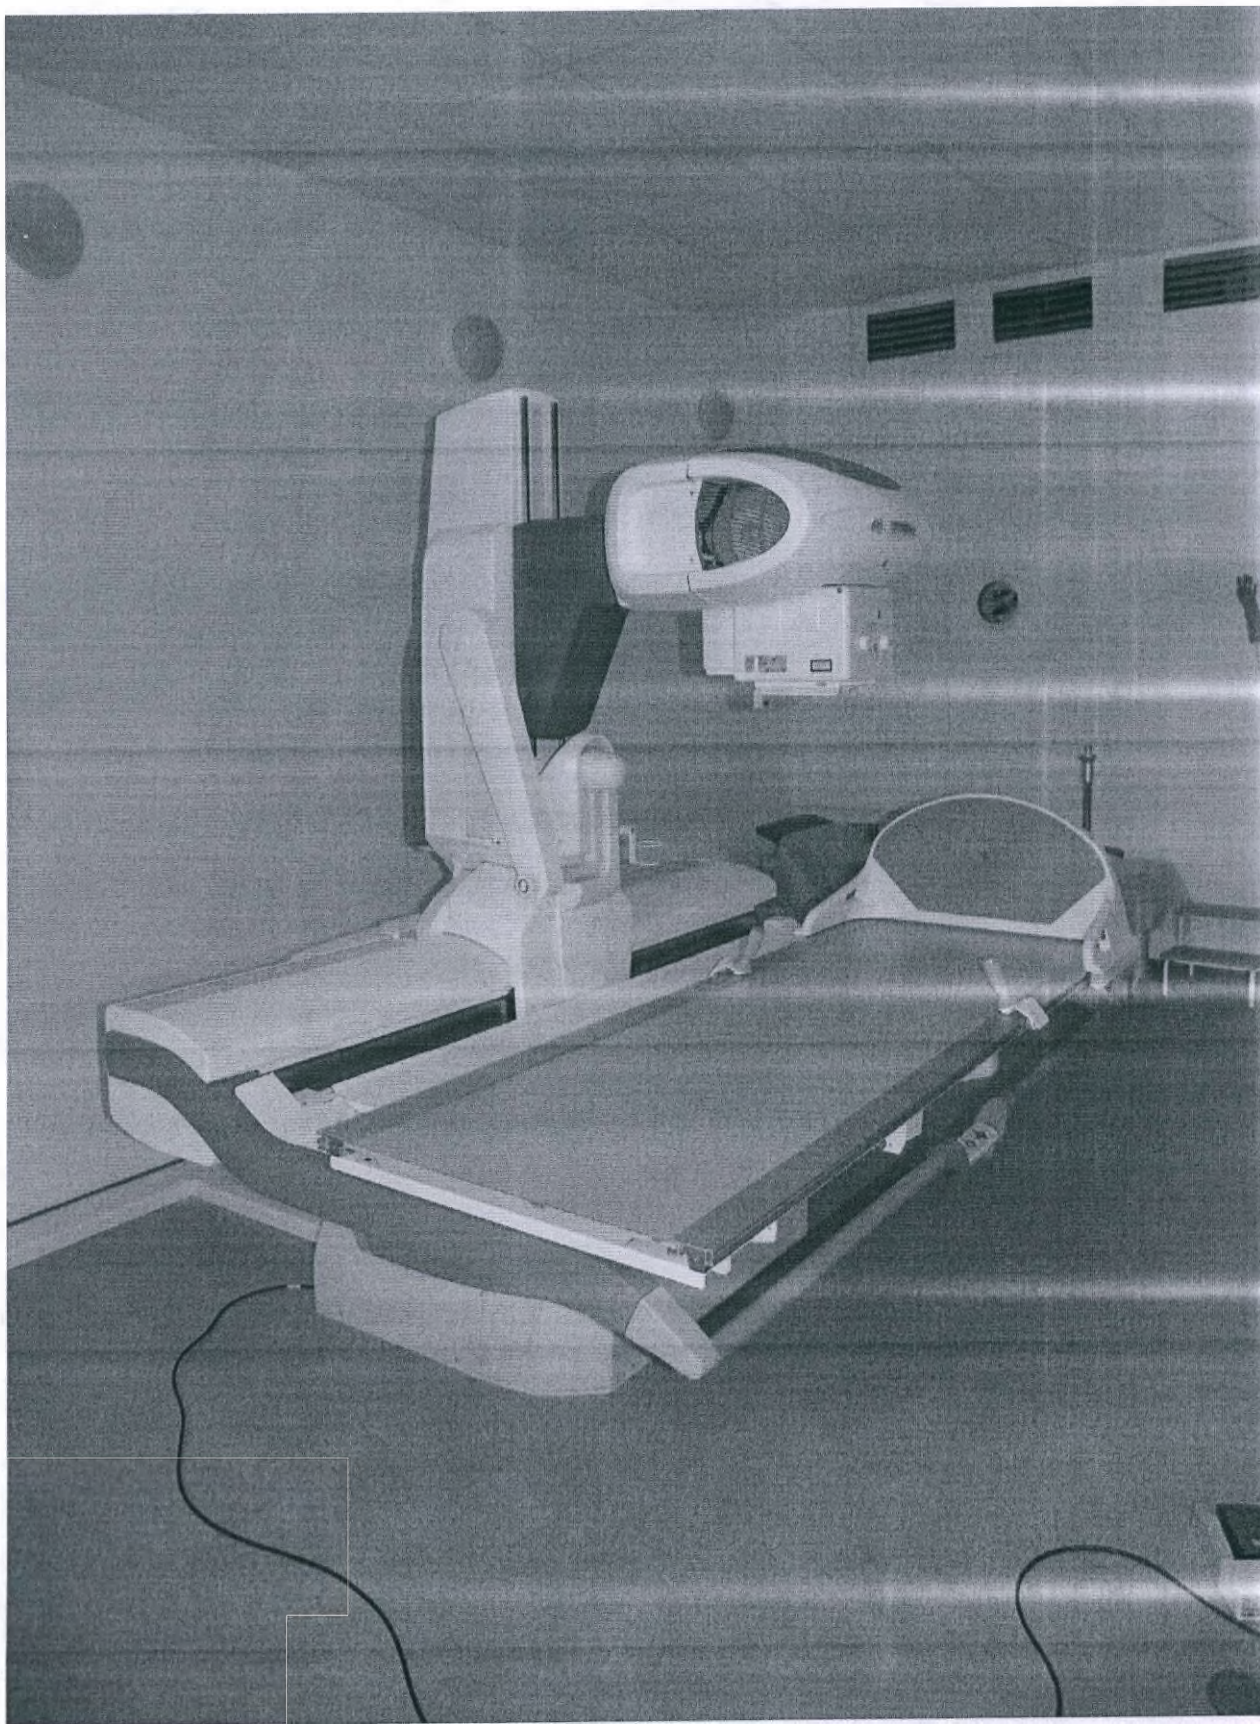


Стол телеуправляемый, (с возможностью перемещения деки в двух или четырех направлениях, с лифтом стола или без лифта стола) серии D2RS, производства STEPHANIX, Франция

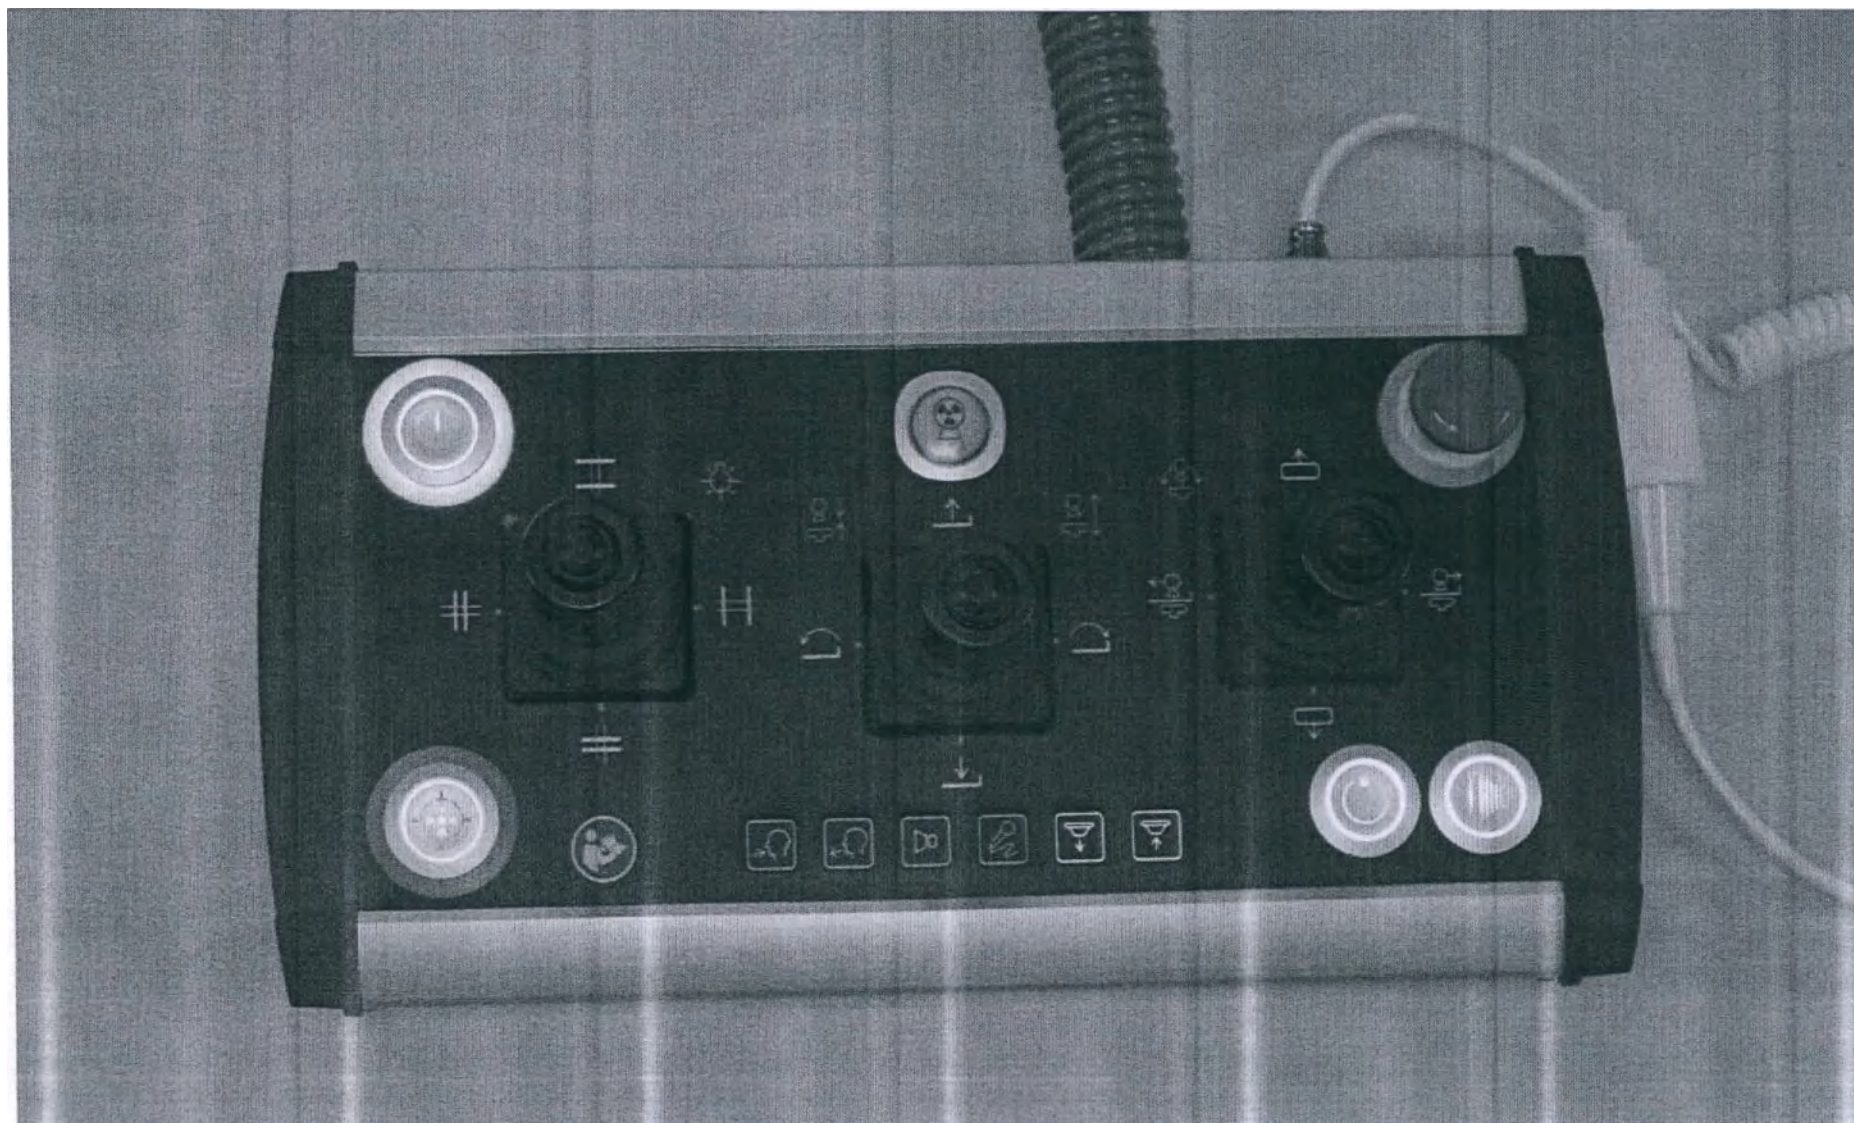

Пульт управления T1-B0300, производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Консоль управления Т1-В0700, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

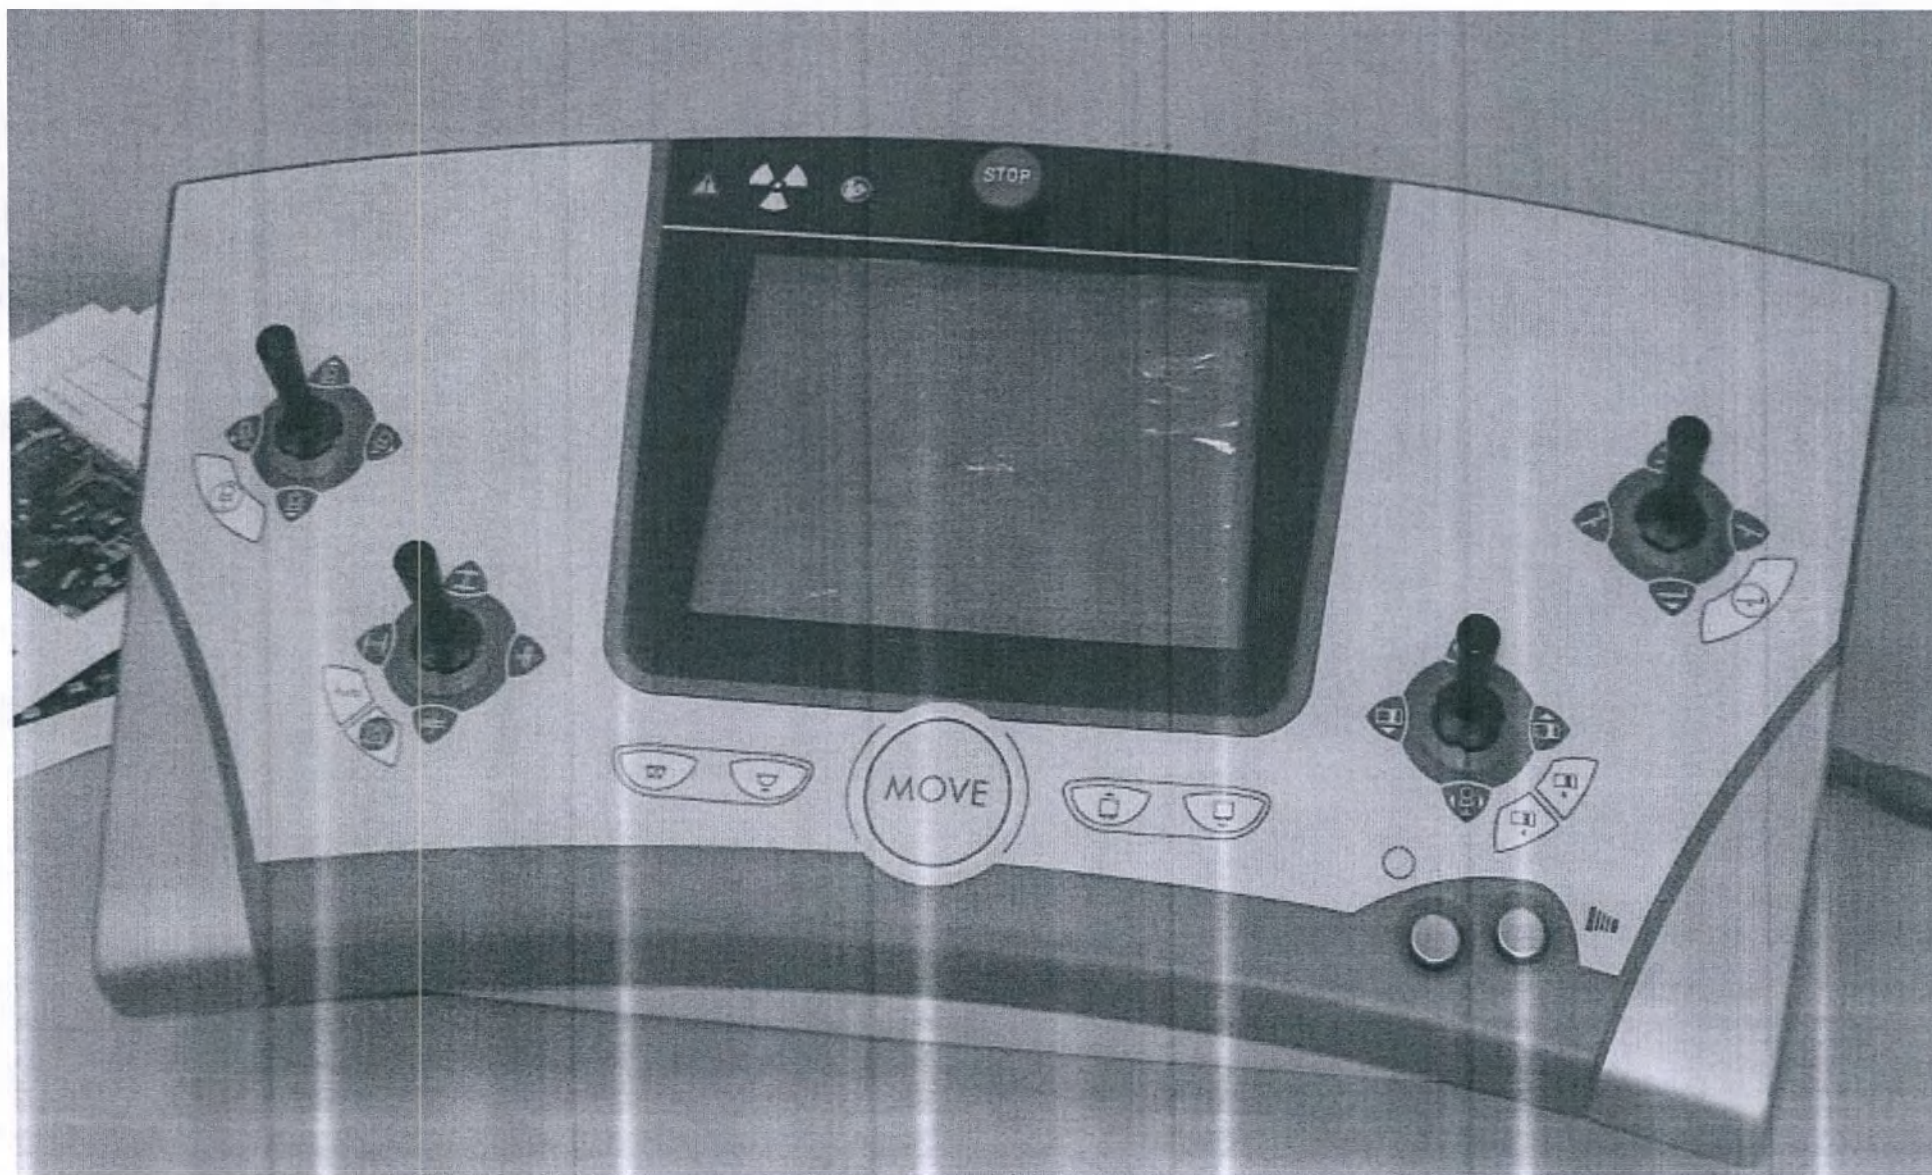


Консоль управления стола телеуправляемого, производства STEPHANIX, Франция




Устройство управления беспроводное, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

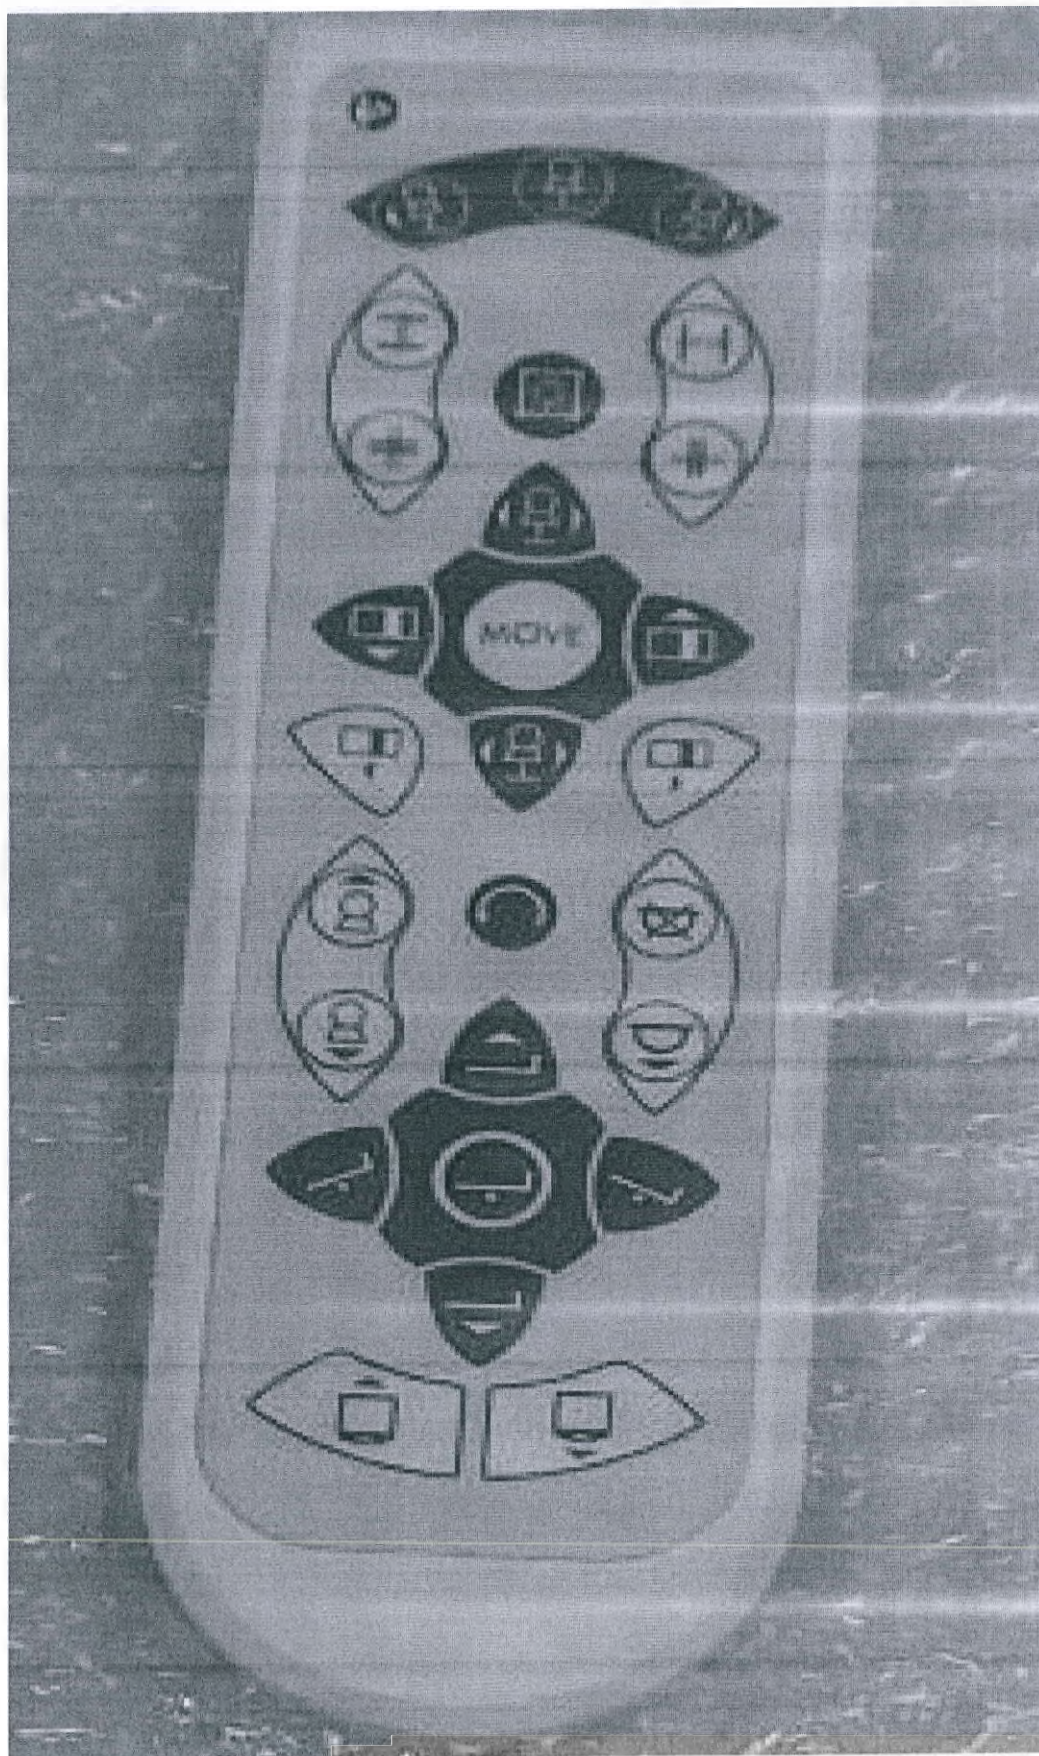


Дистанционный ИК-пульт управления стола телеуправляемого, производства STEPHANIX, Франция

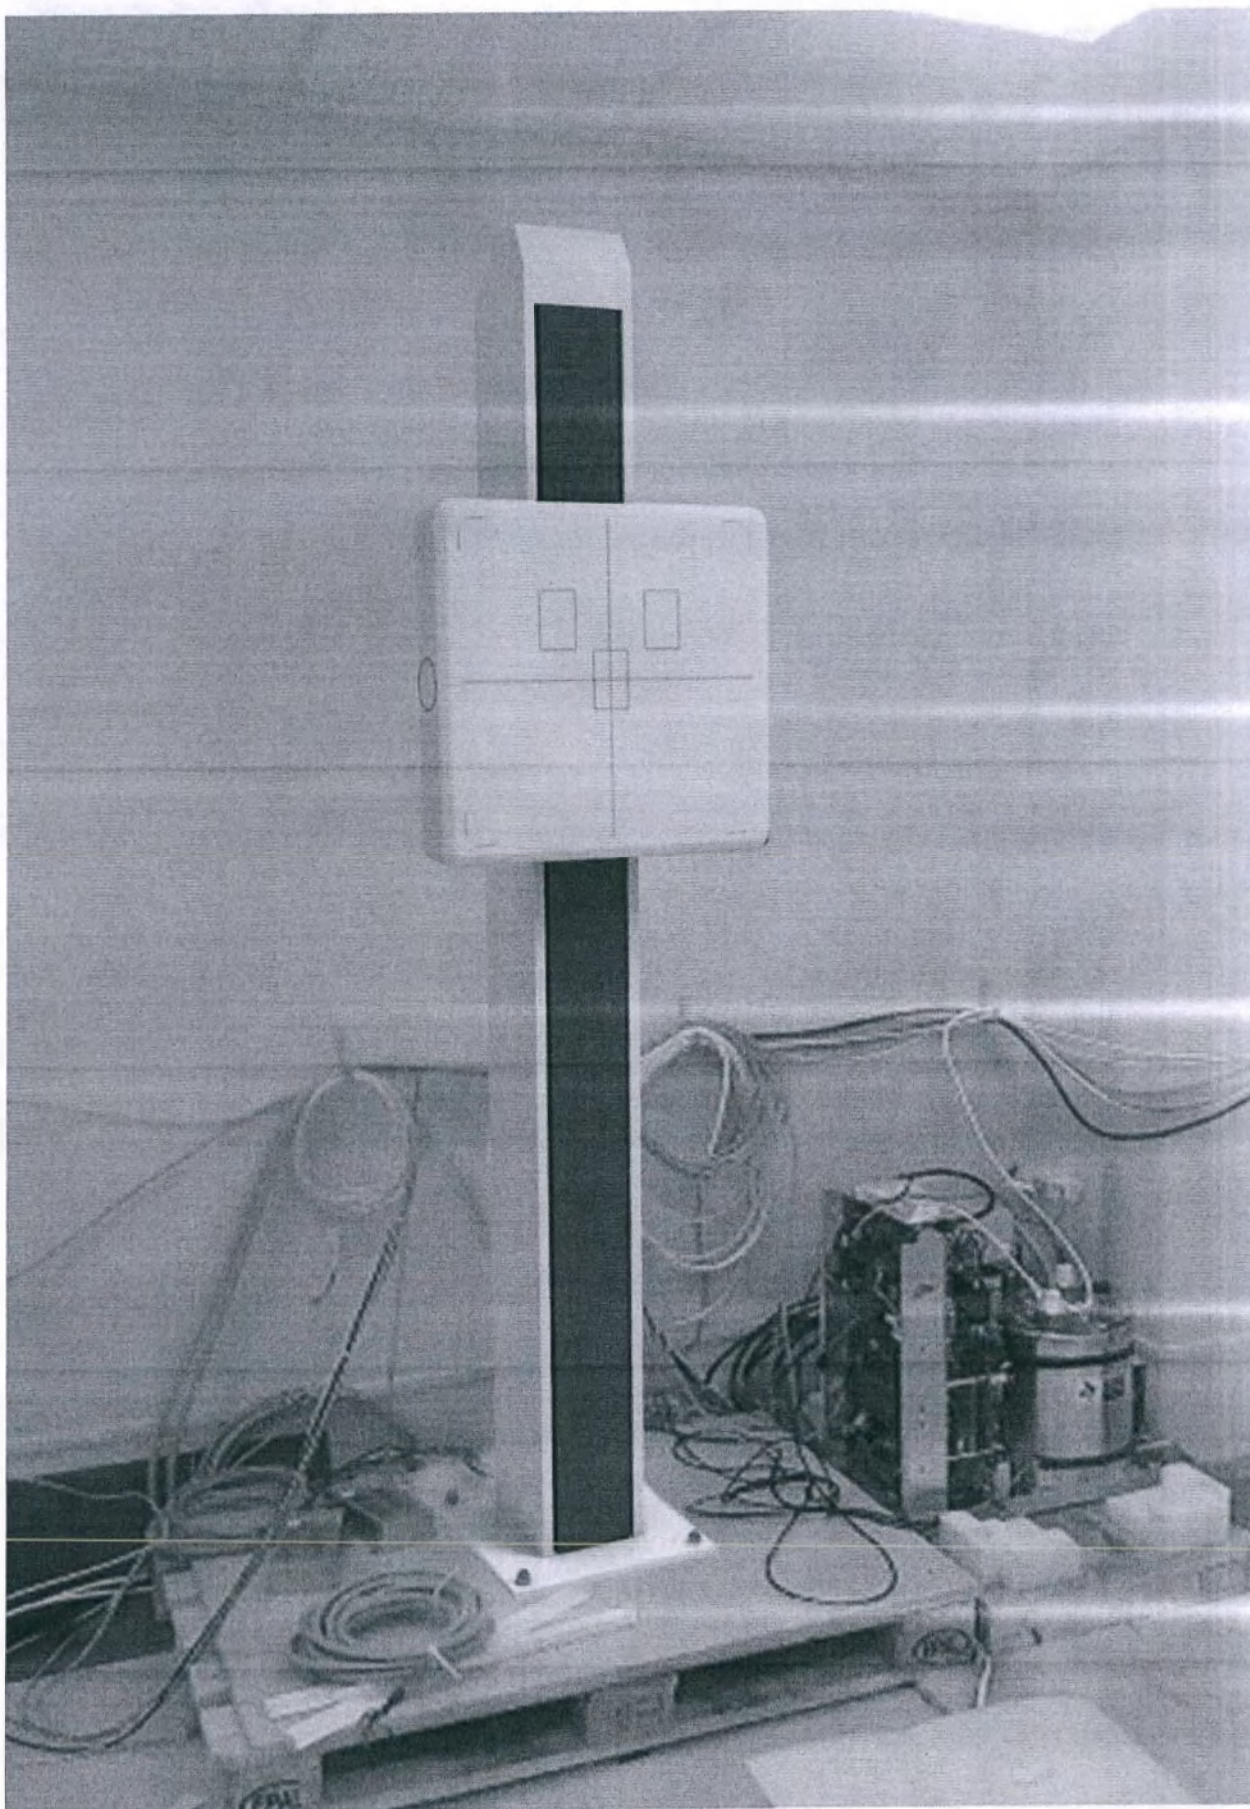


Стойка снимков цифровая А1-В0100, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

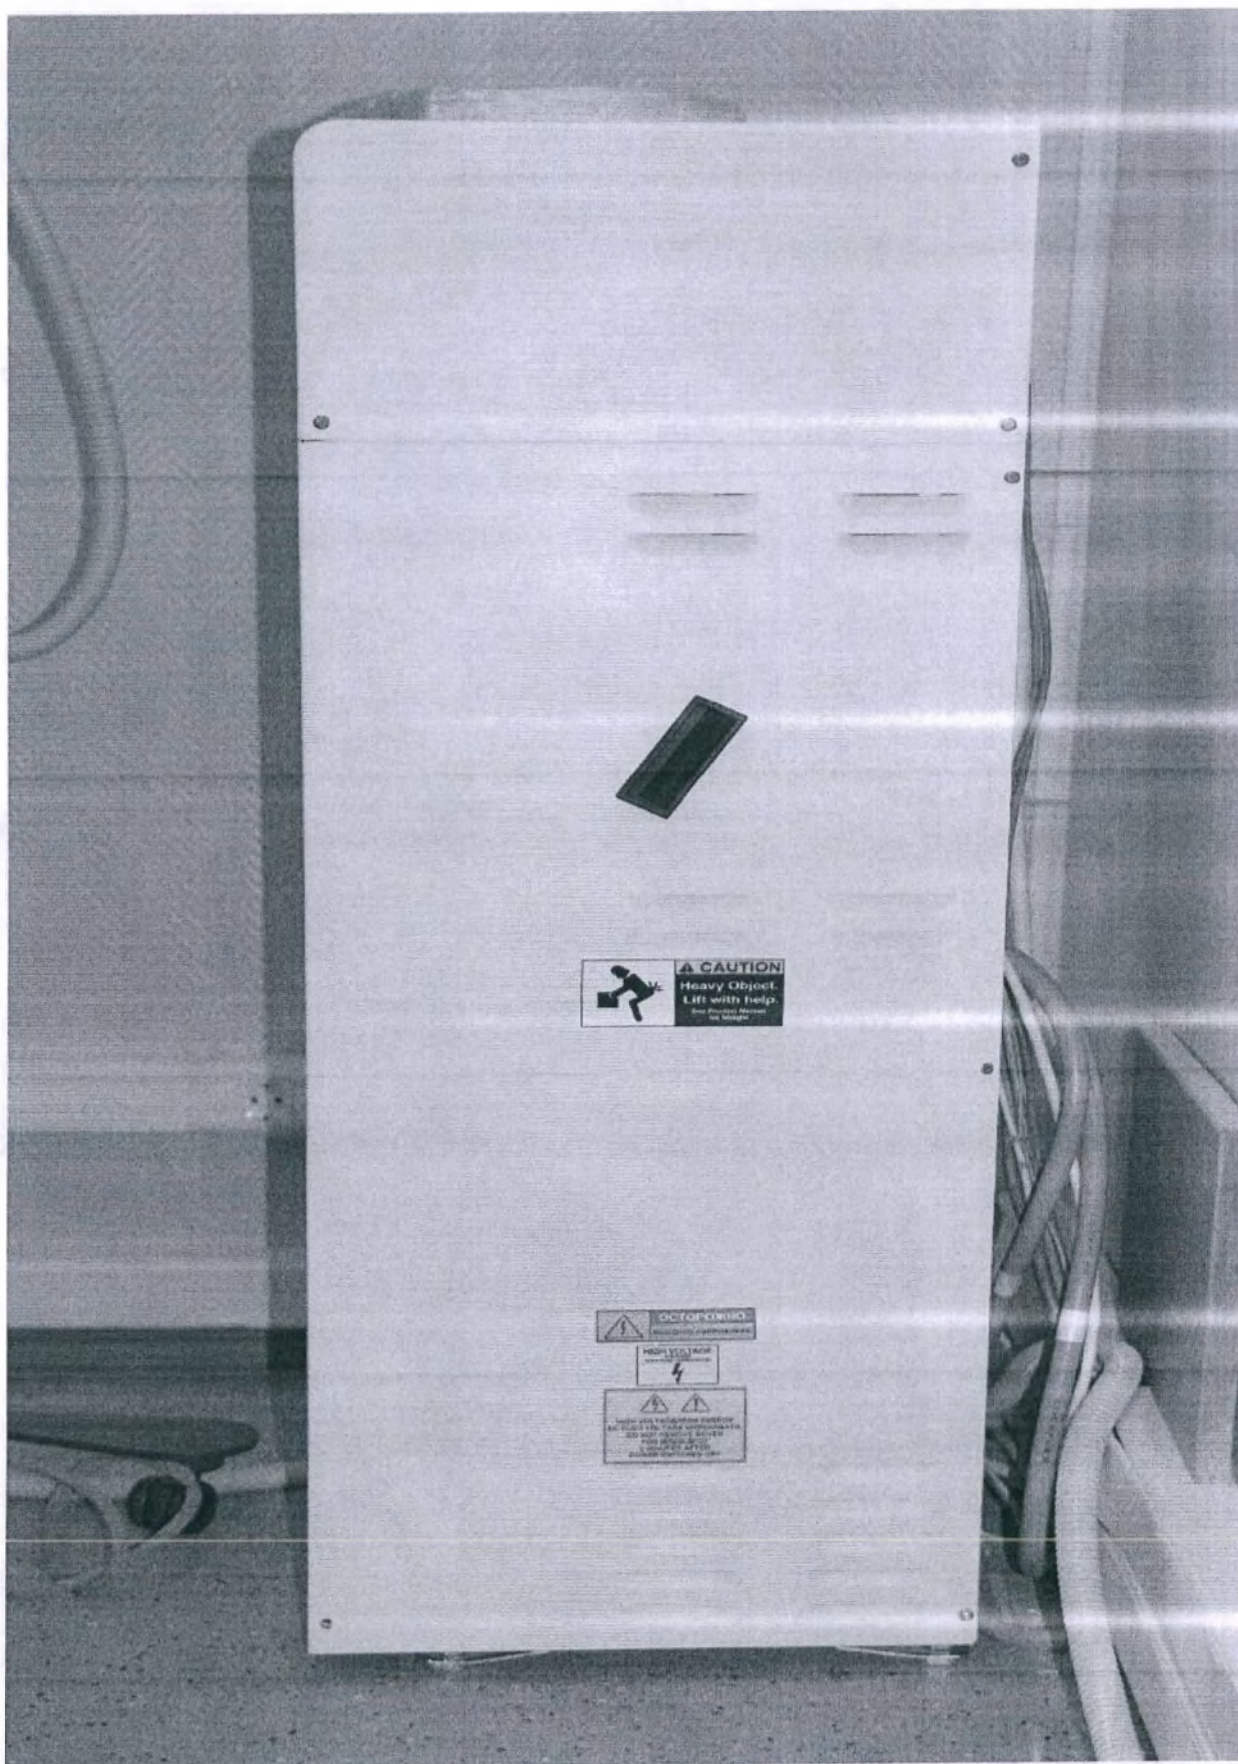


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) INDICO IQ 50 kW или INDICO IQ 65 kW или INDICO IQ 80 kW производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

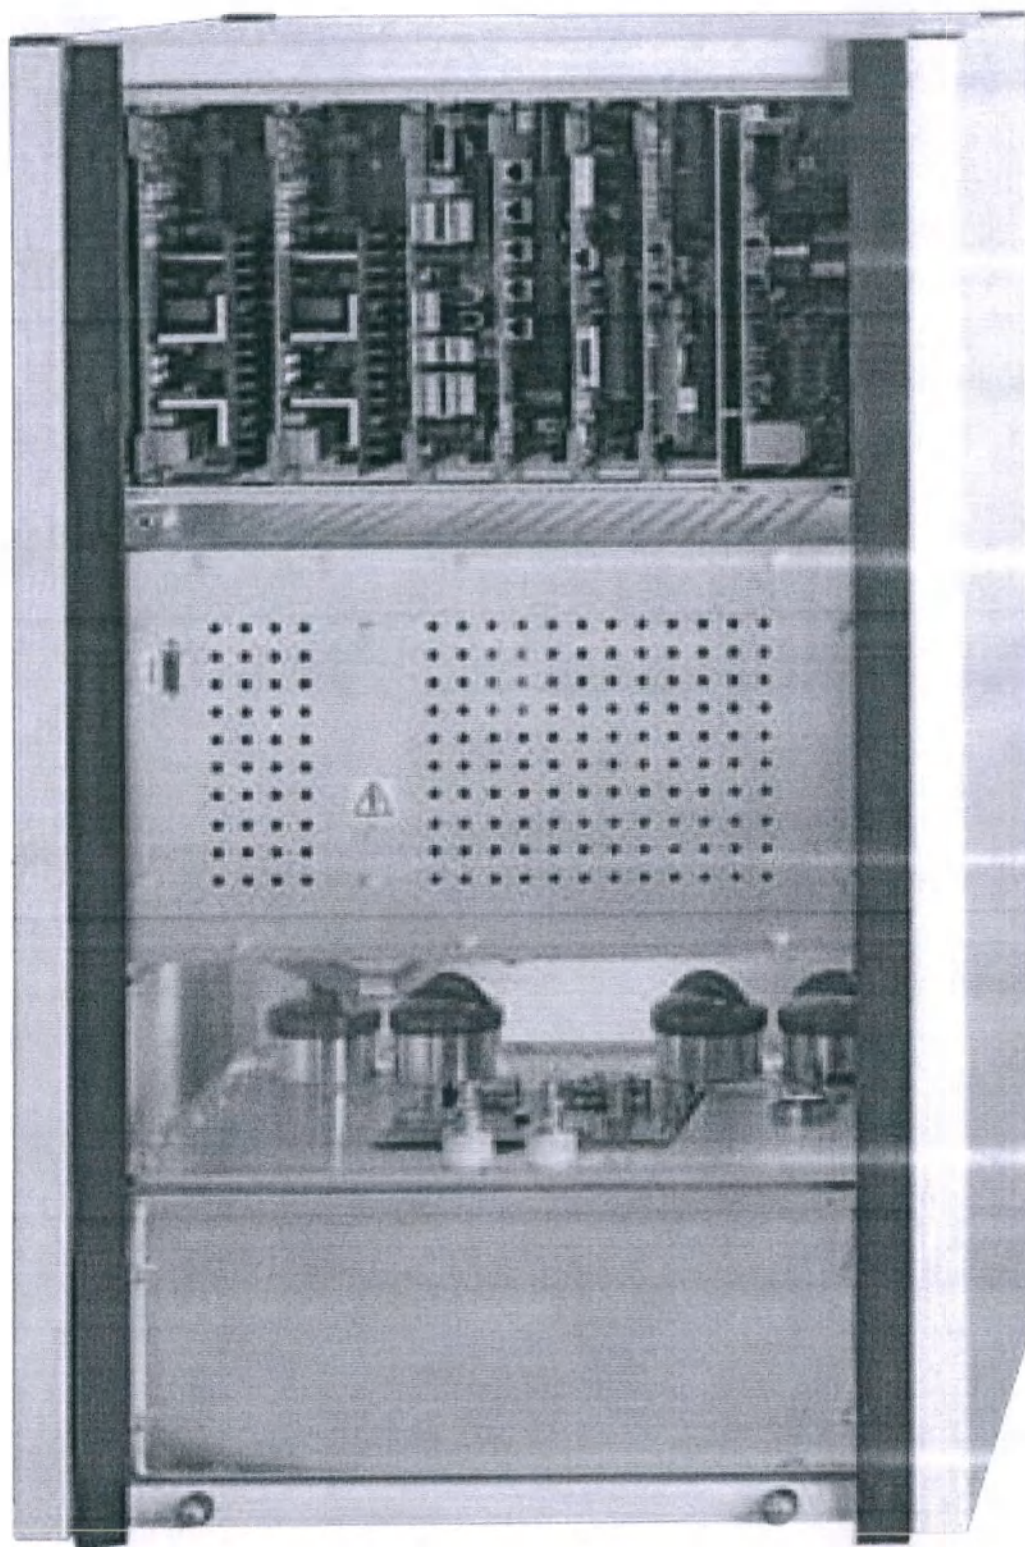


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) EDITOR HFe 501
50 kW или EDITOR HFe 601 65 kW или EDITOR HFe 801 80 kW
производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics
GmbH, Германия

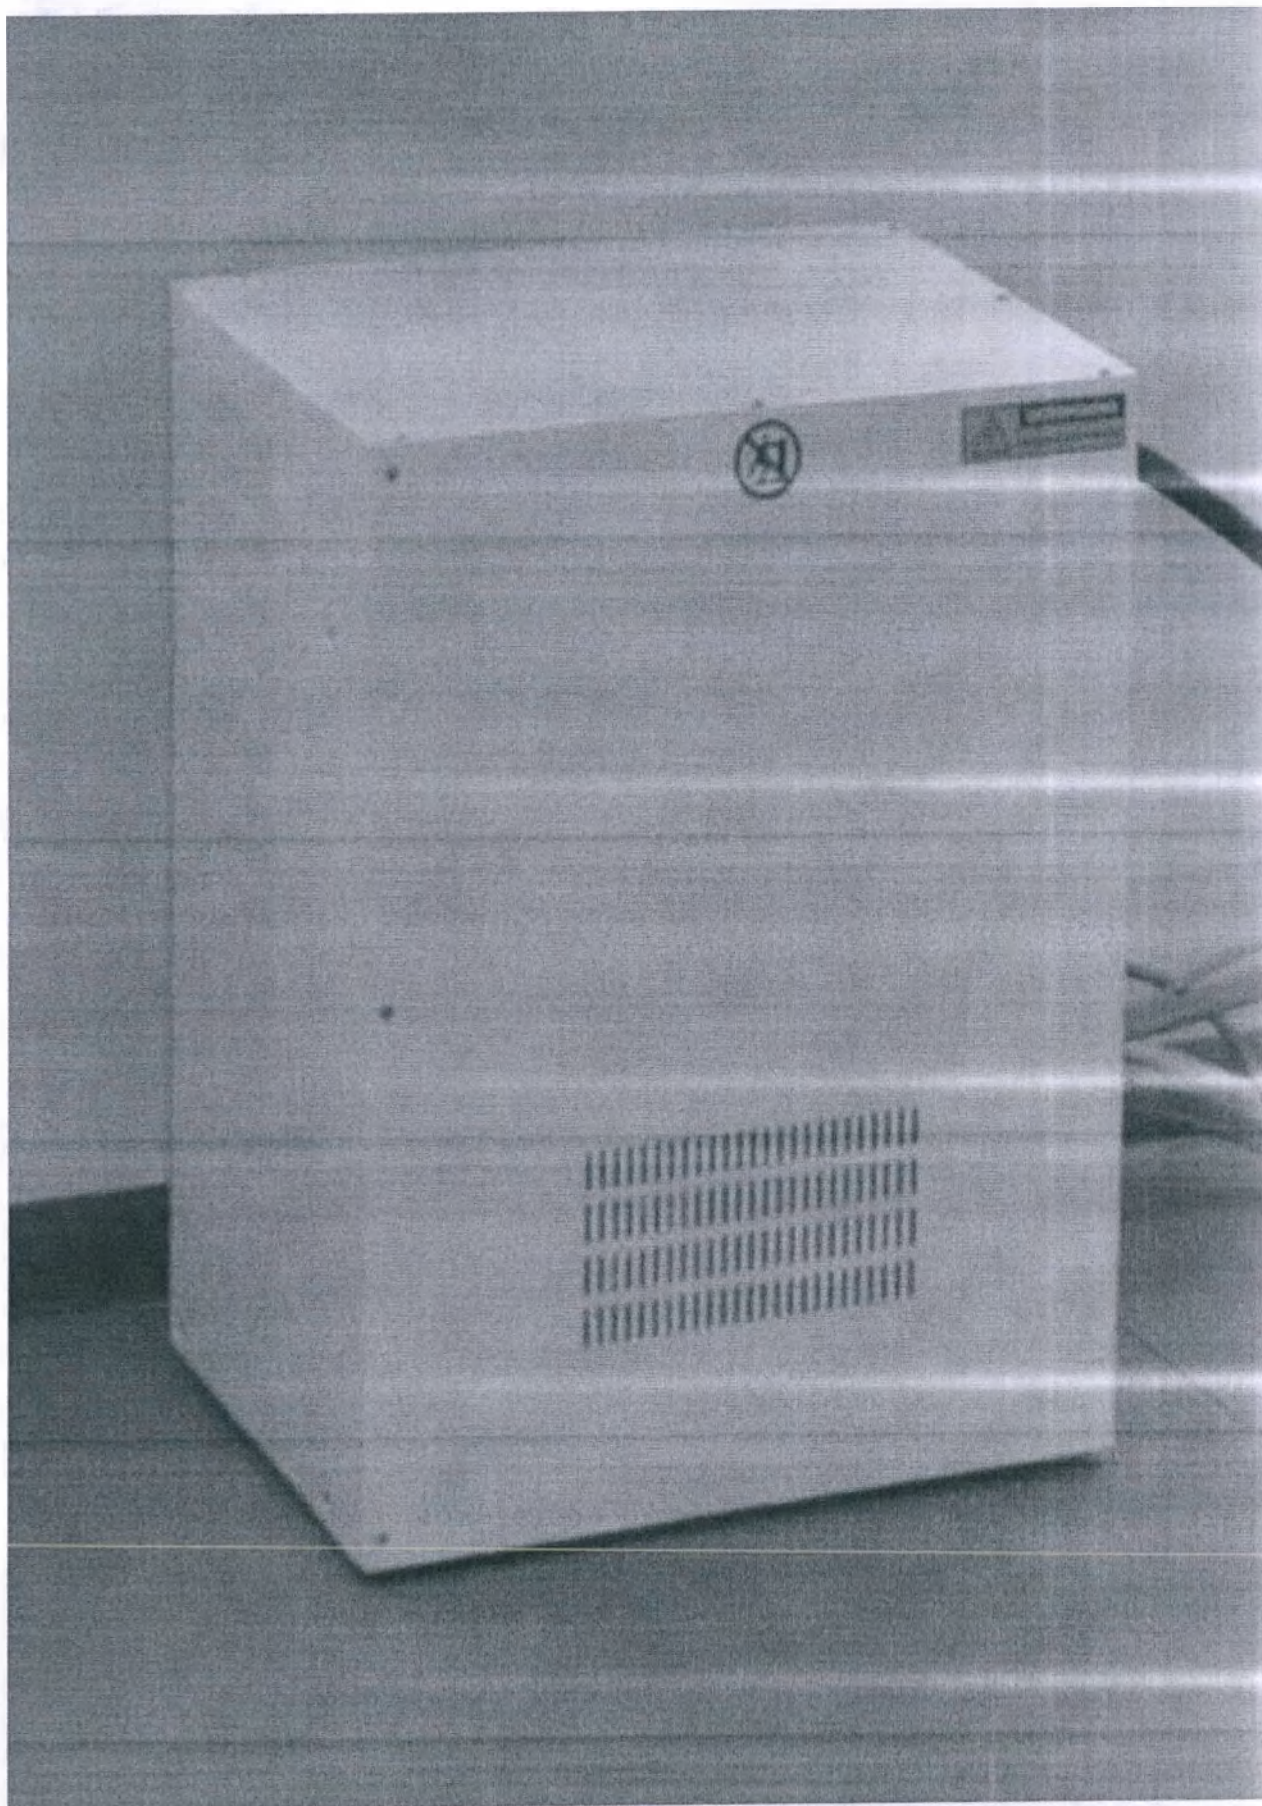


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) SHFR 600 65 кВт или SHFR 800 80 кВт производства Sedecal S.A., Испания

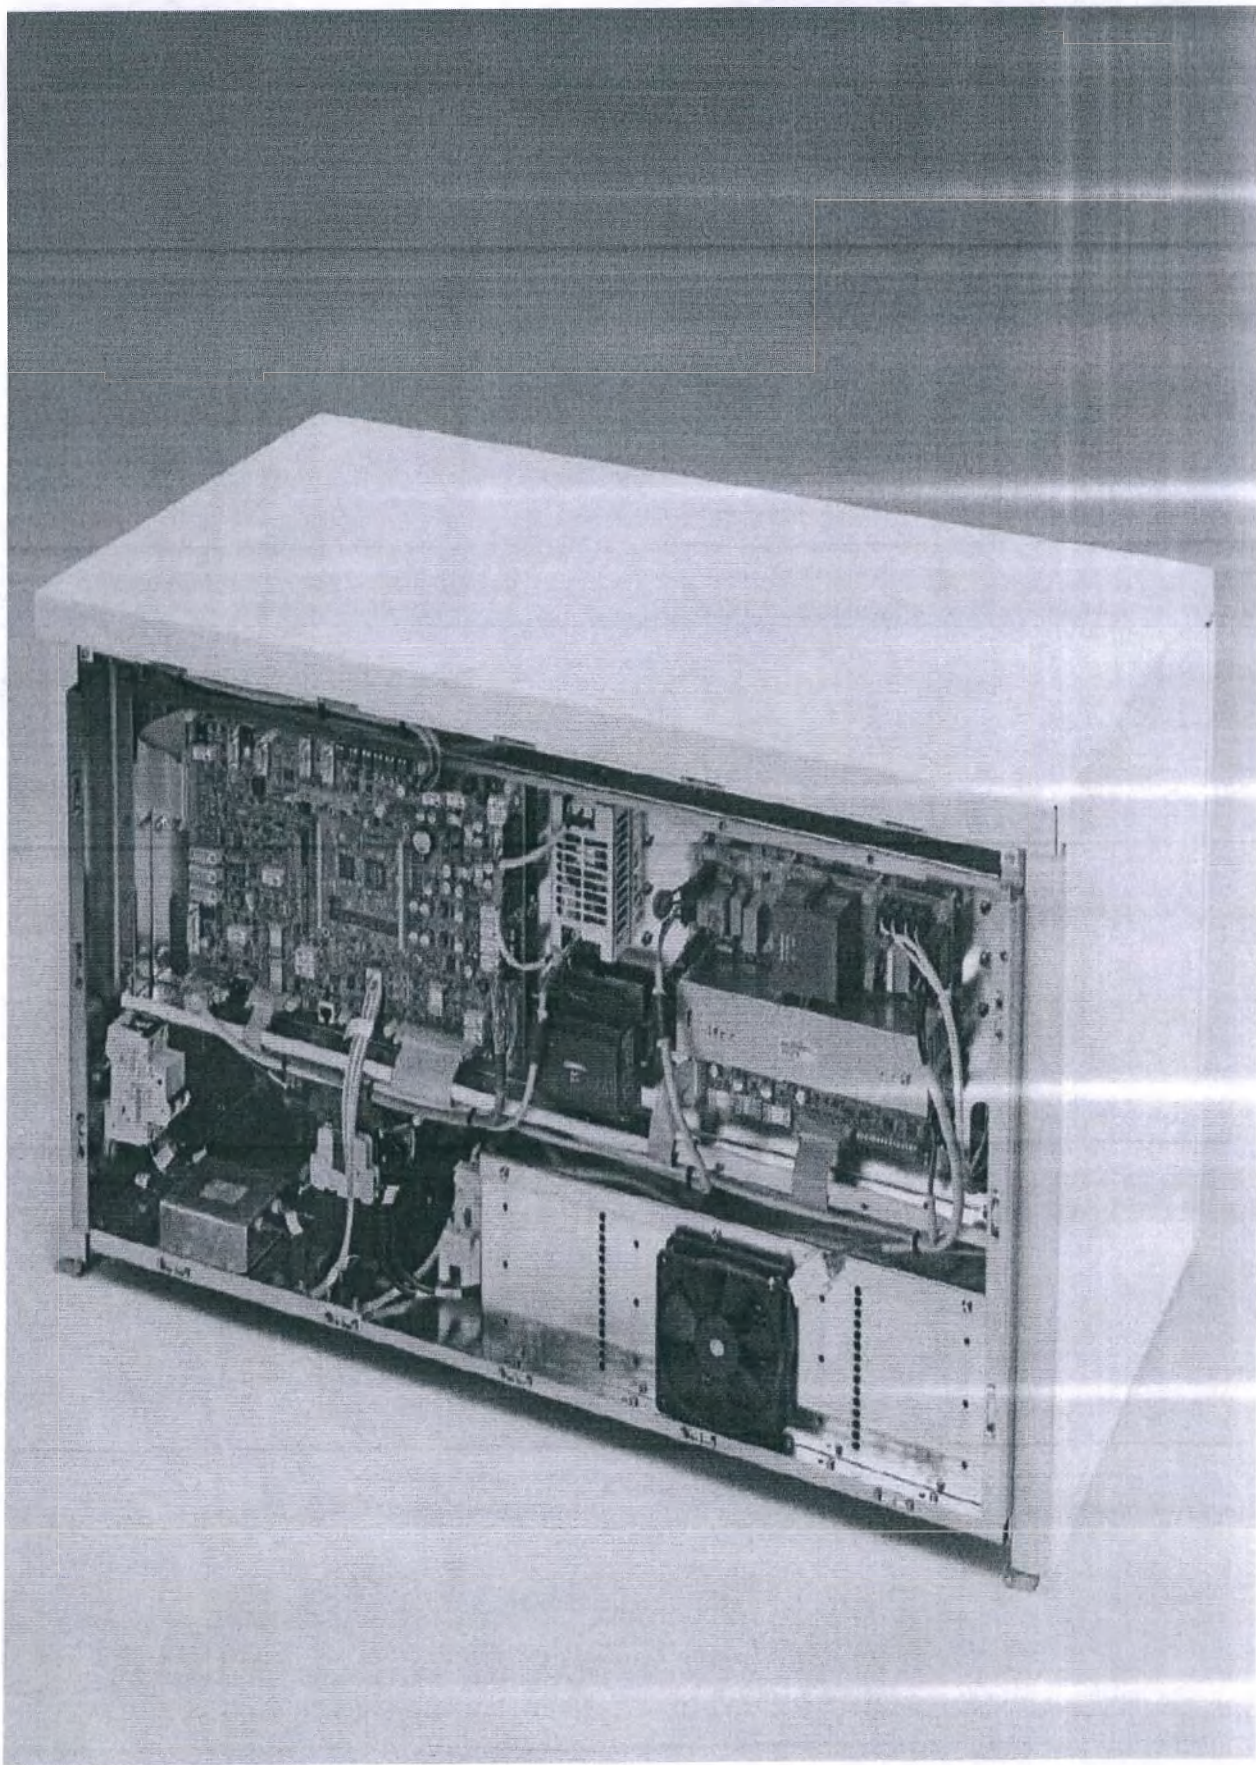


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) Polydörös RF 80 55kW
или Polydörös RF 80 65kW или Polydörös RF 80 80kW производства
Siemens, Германия

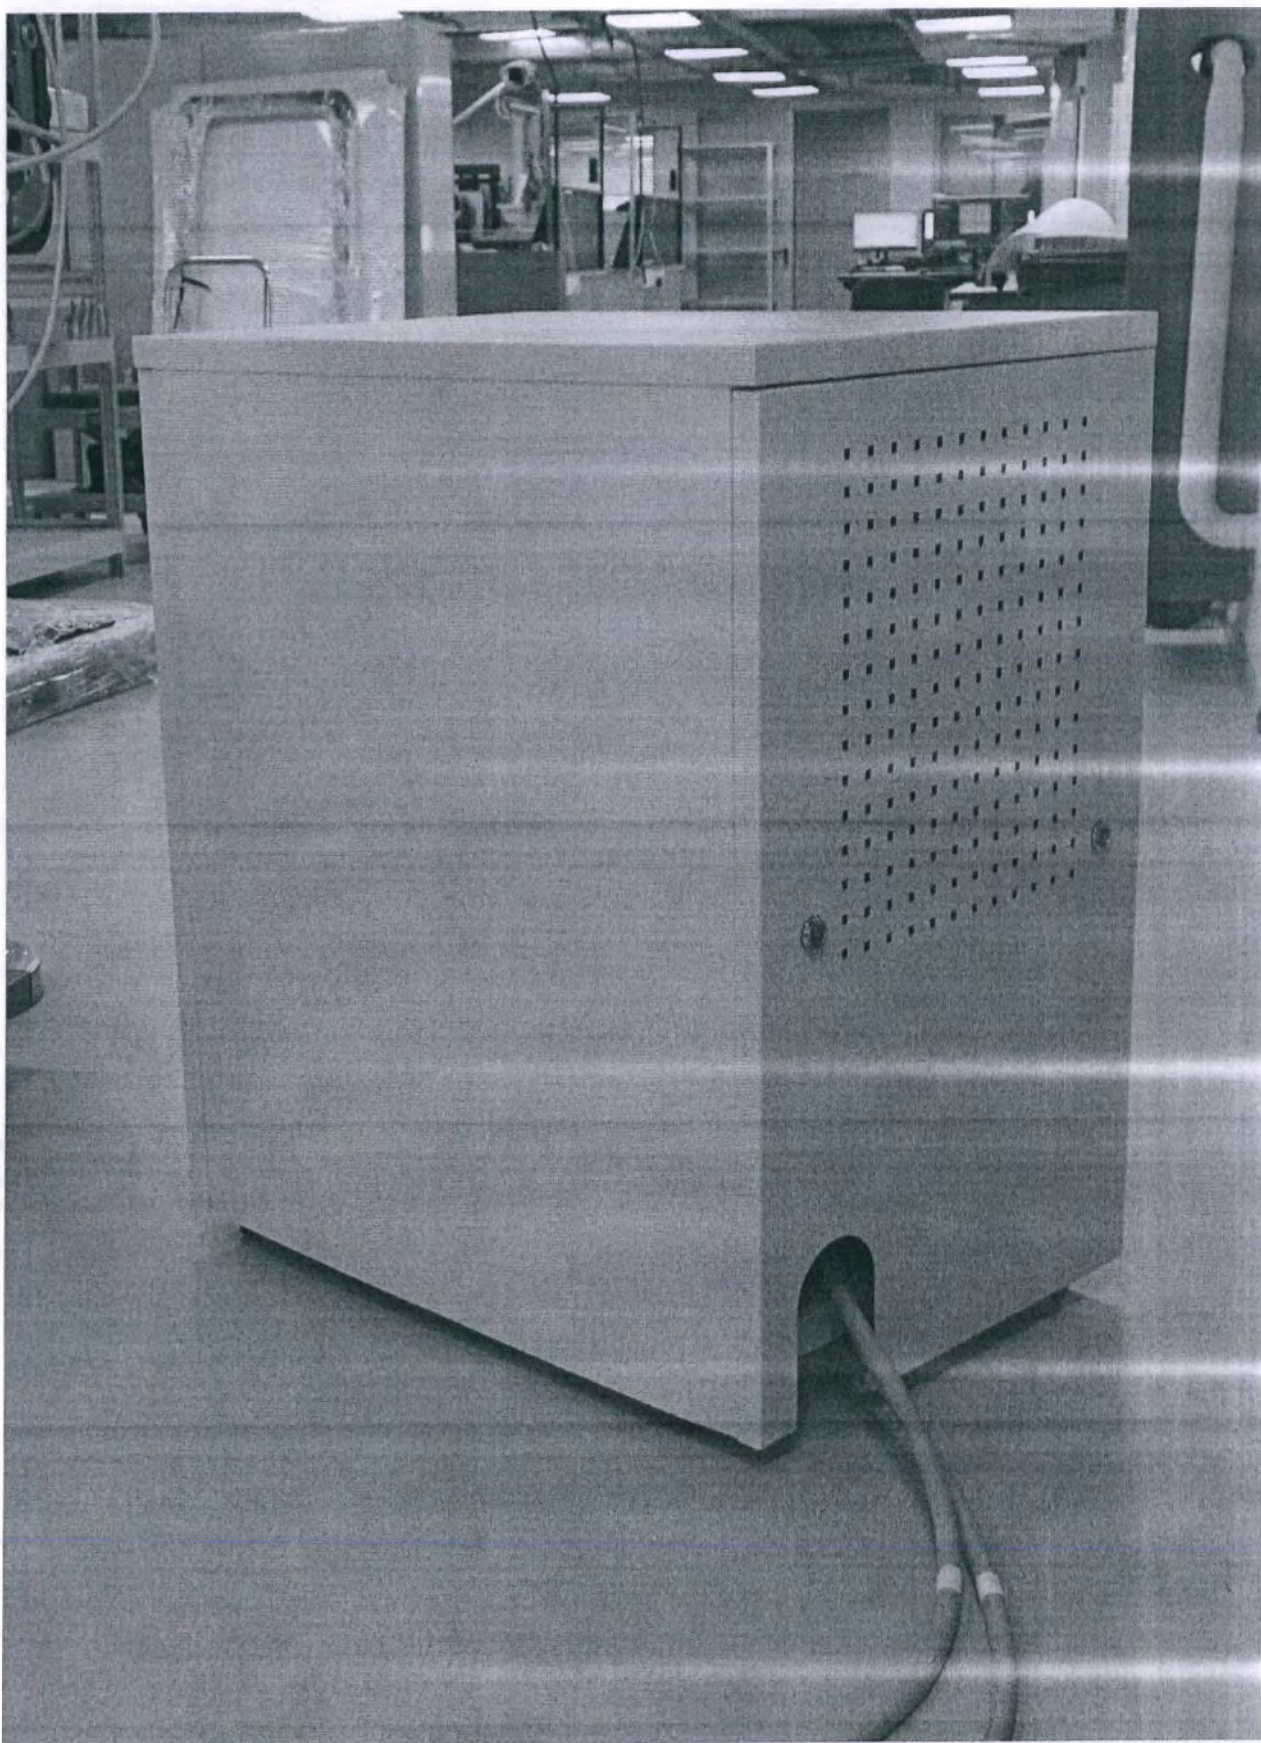


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0700-01 или X1-B0800-01, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

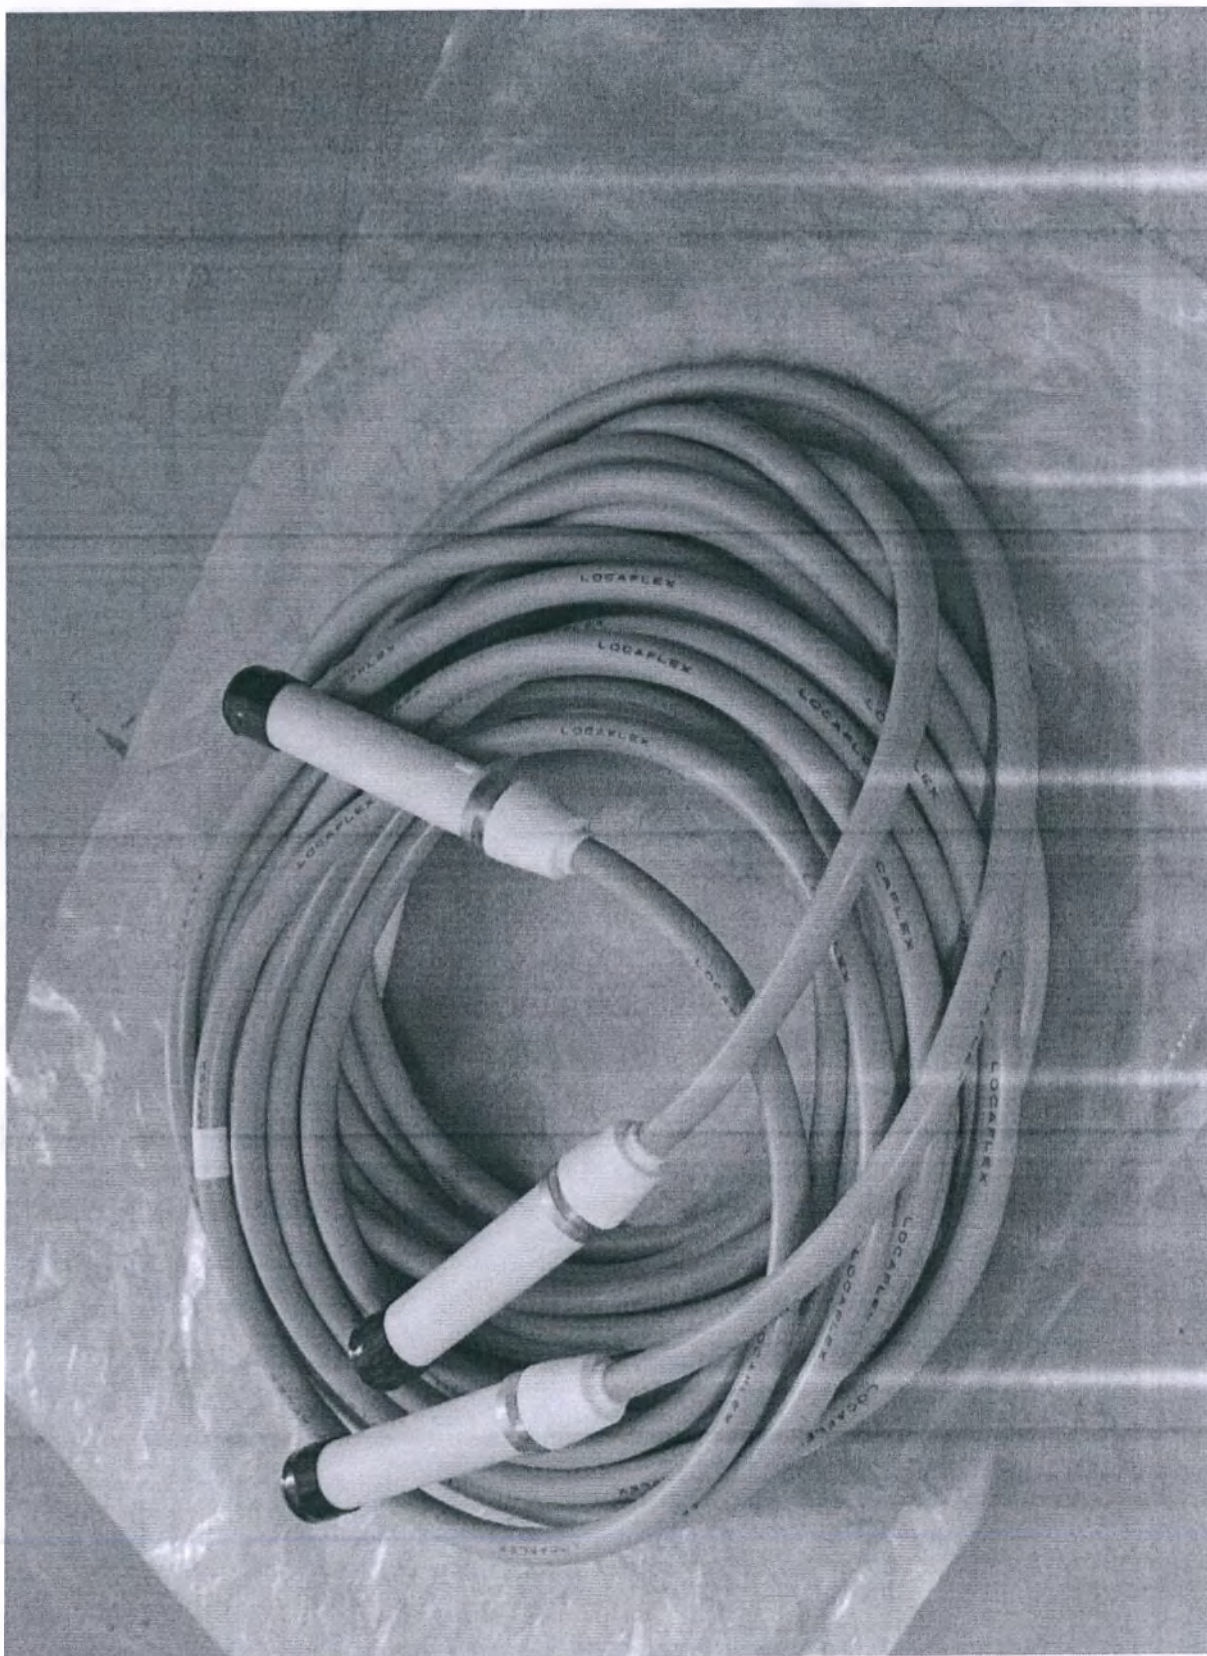

Комплект (пара) кабелей высоковольтных с наконечниками, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины или Varex Imaging Corporation, Китай или производства Tianjin Wanbo Wire & Cable Co.,Ltd, Китай

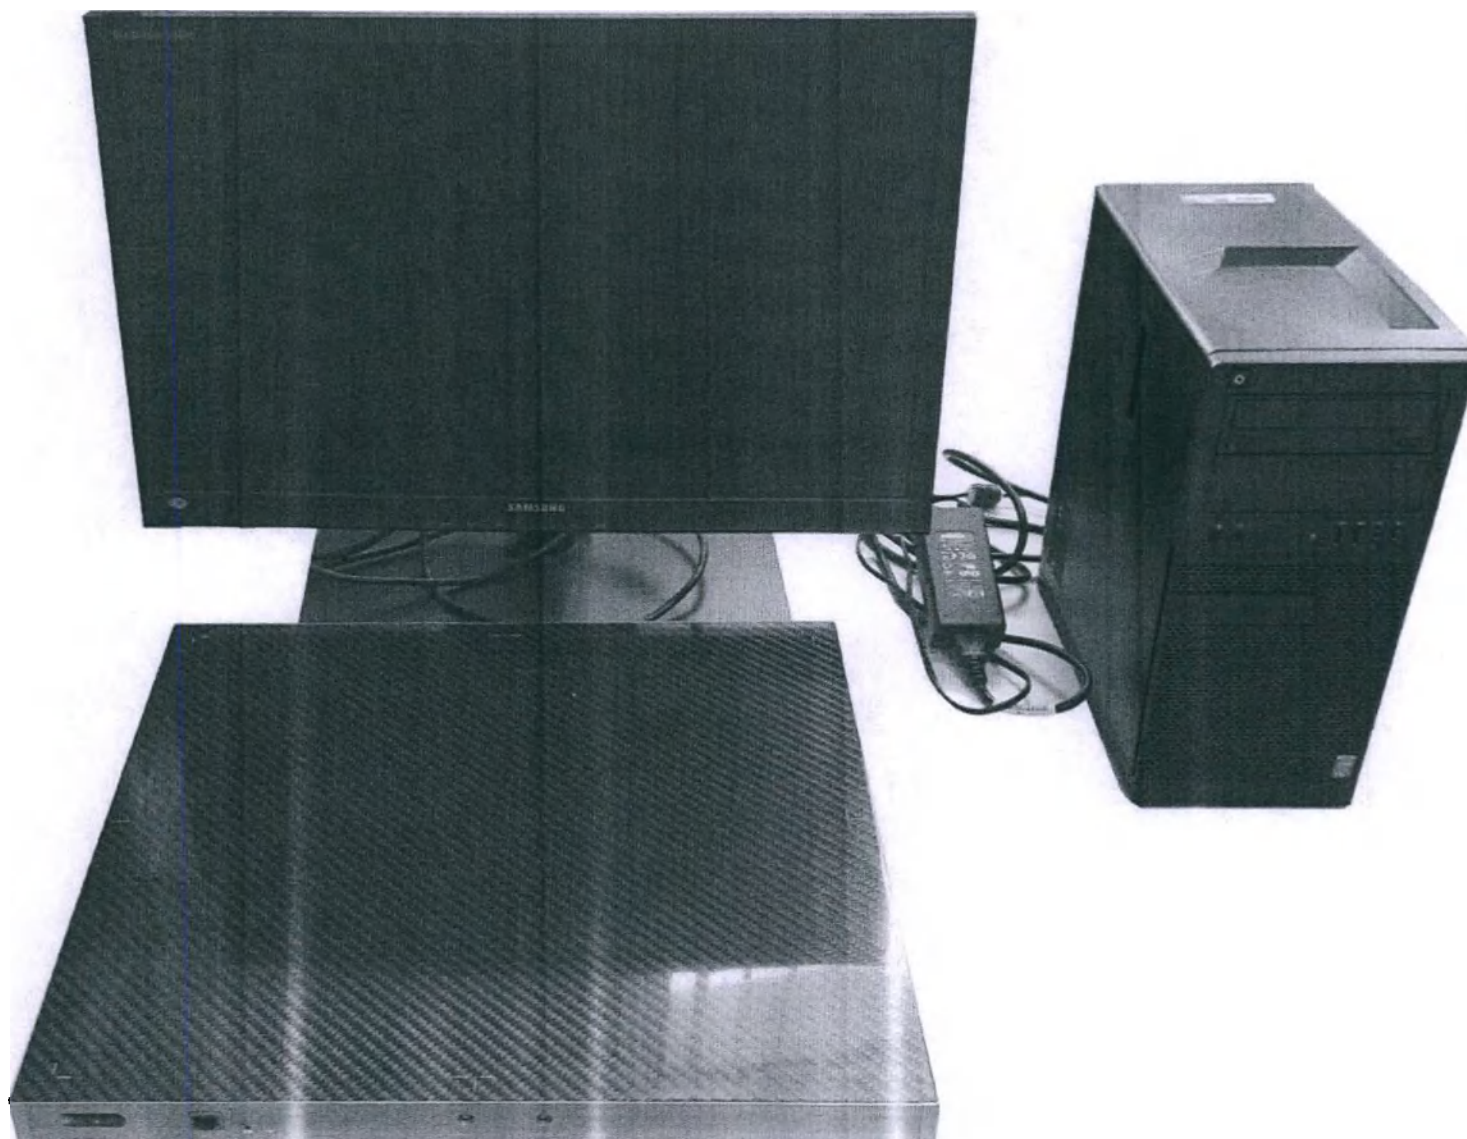


Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ»,
производства АО «МТЛ», Россия

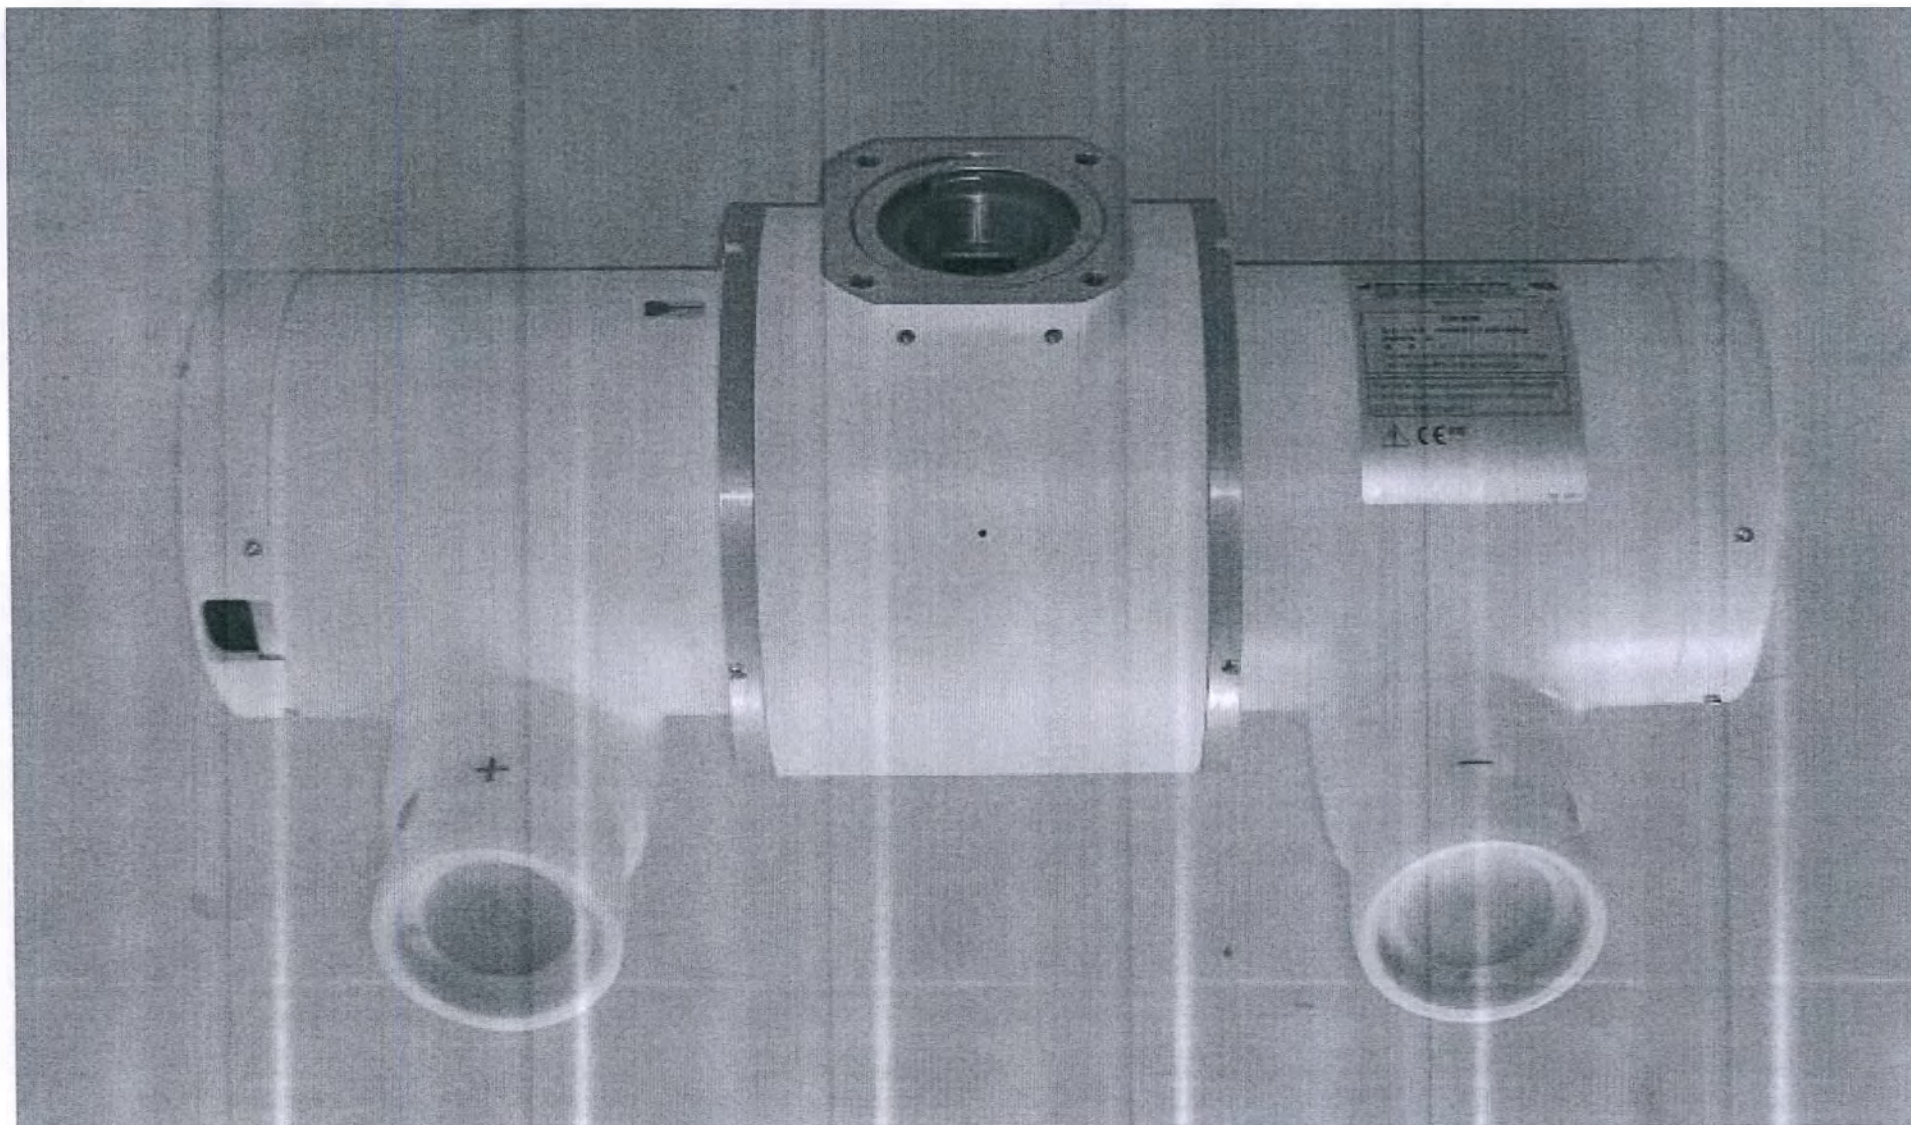


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской E7252 X или E7252 FX или E7252 GX или E7869 X или E7864 X, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония




Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской серии RTM101HS, производства IAE Spa, Италия

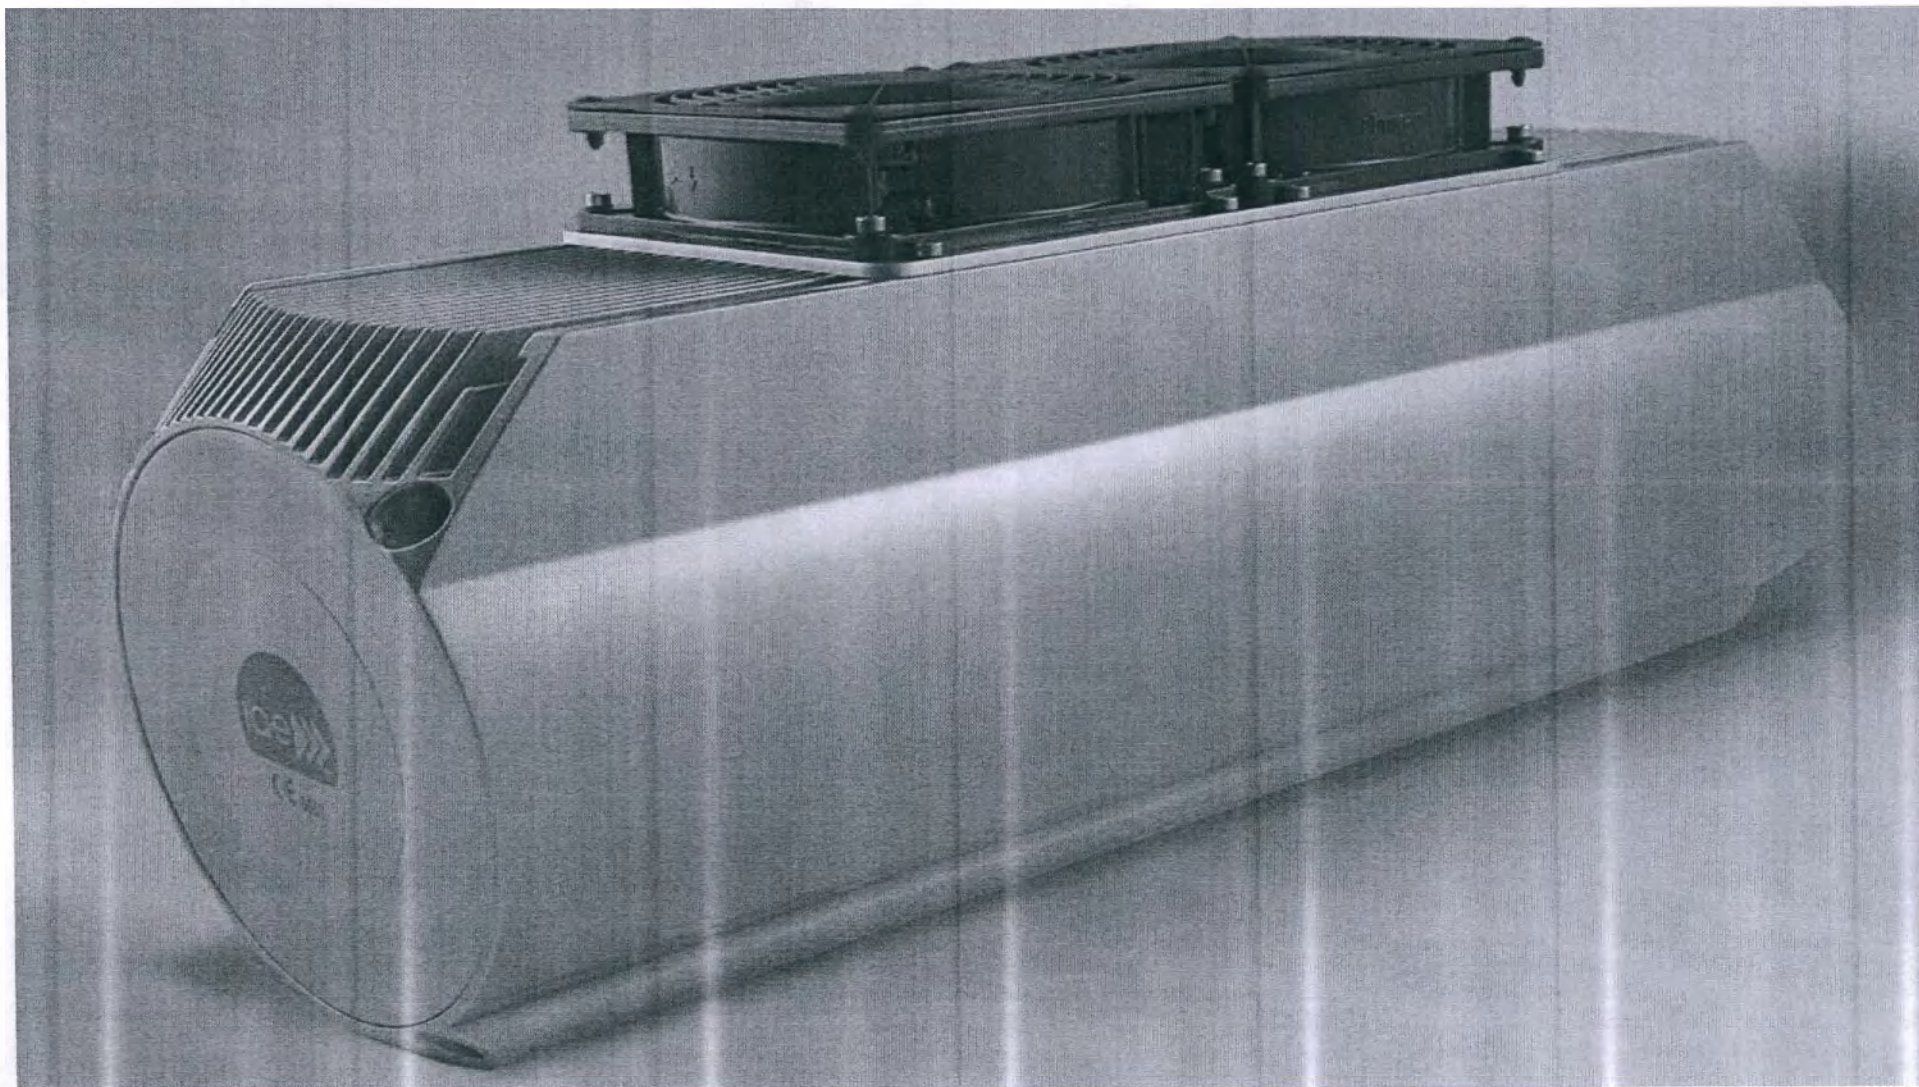


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской серии RTC700HS, производства IAE Spa, Италия

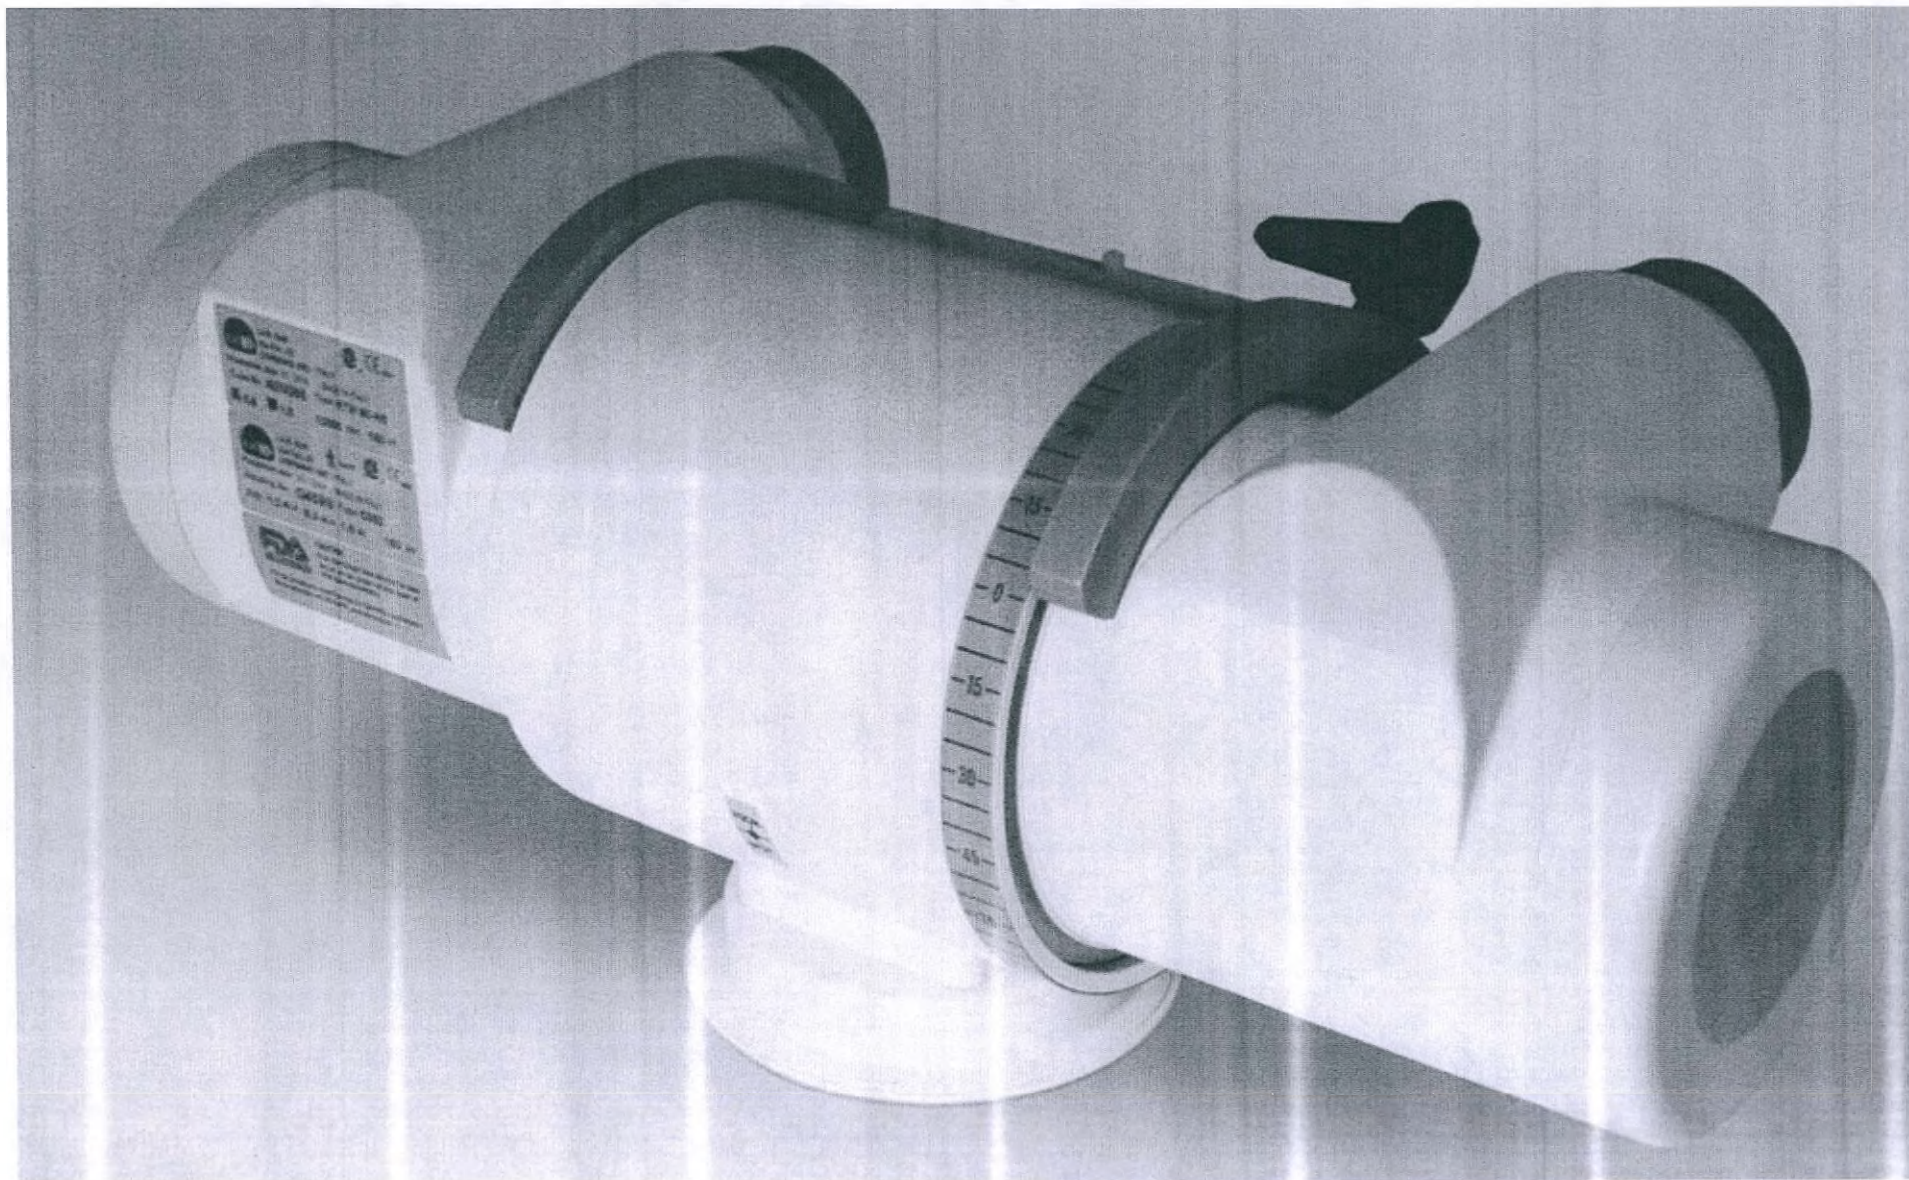


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской серии RTM782HS, производства IAE S.p.A, Италия

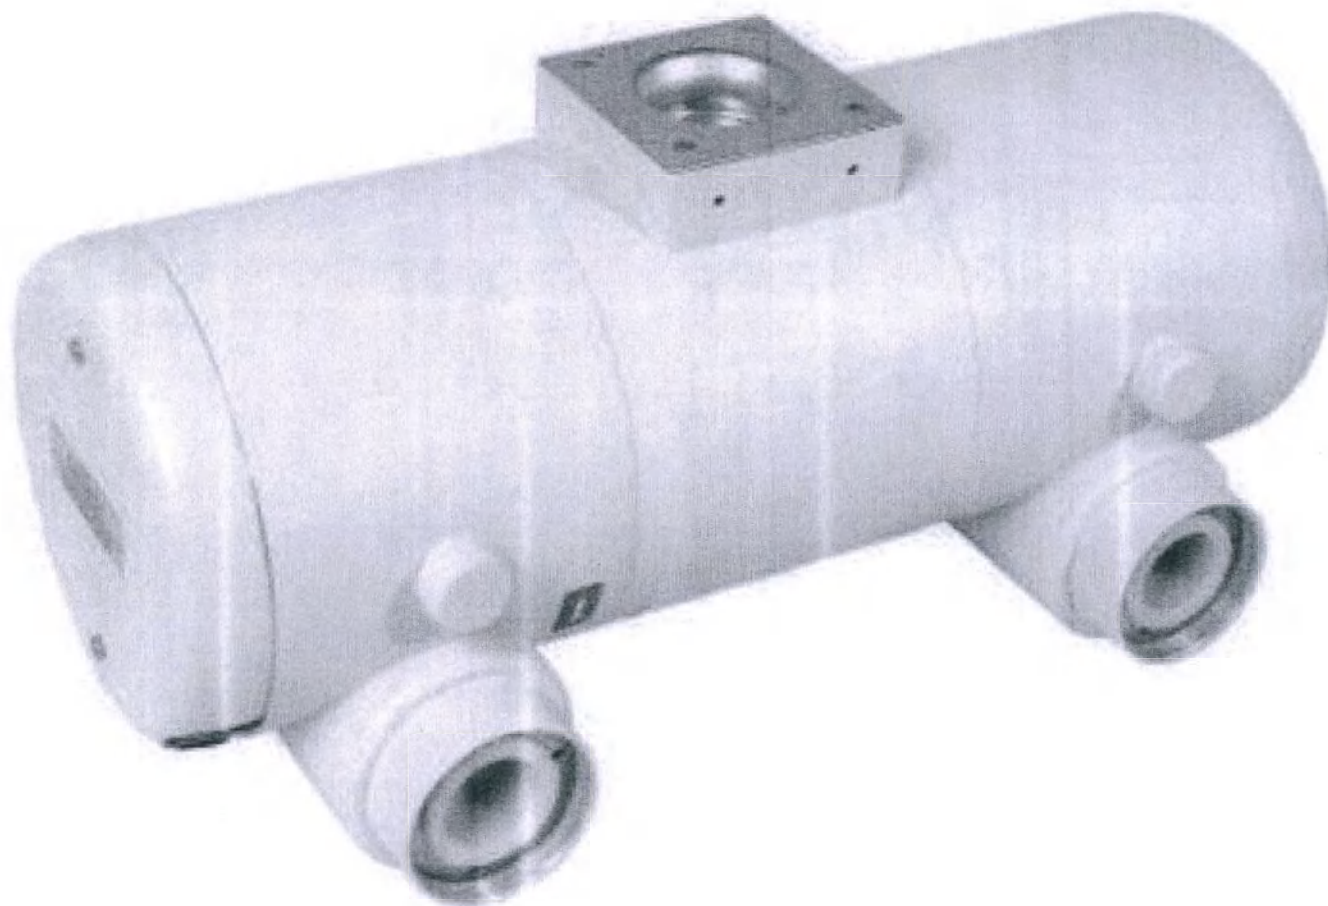

Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской G-892/B-130 или A-297/B-130 или G-292/B-130H, производства
Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США

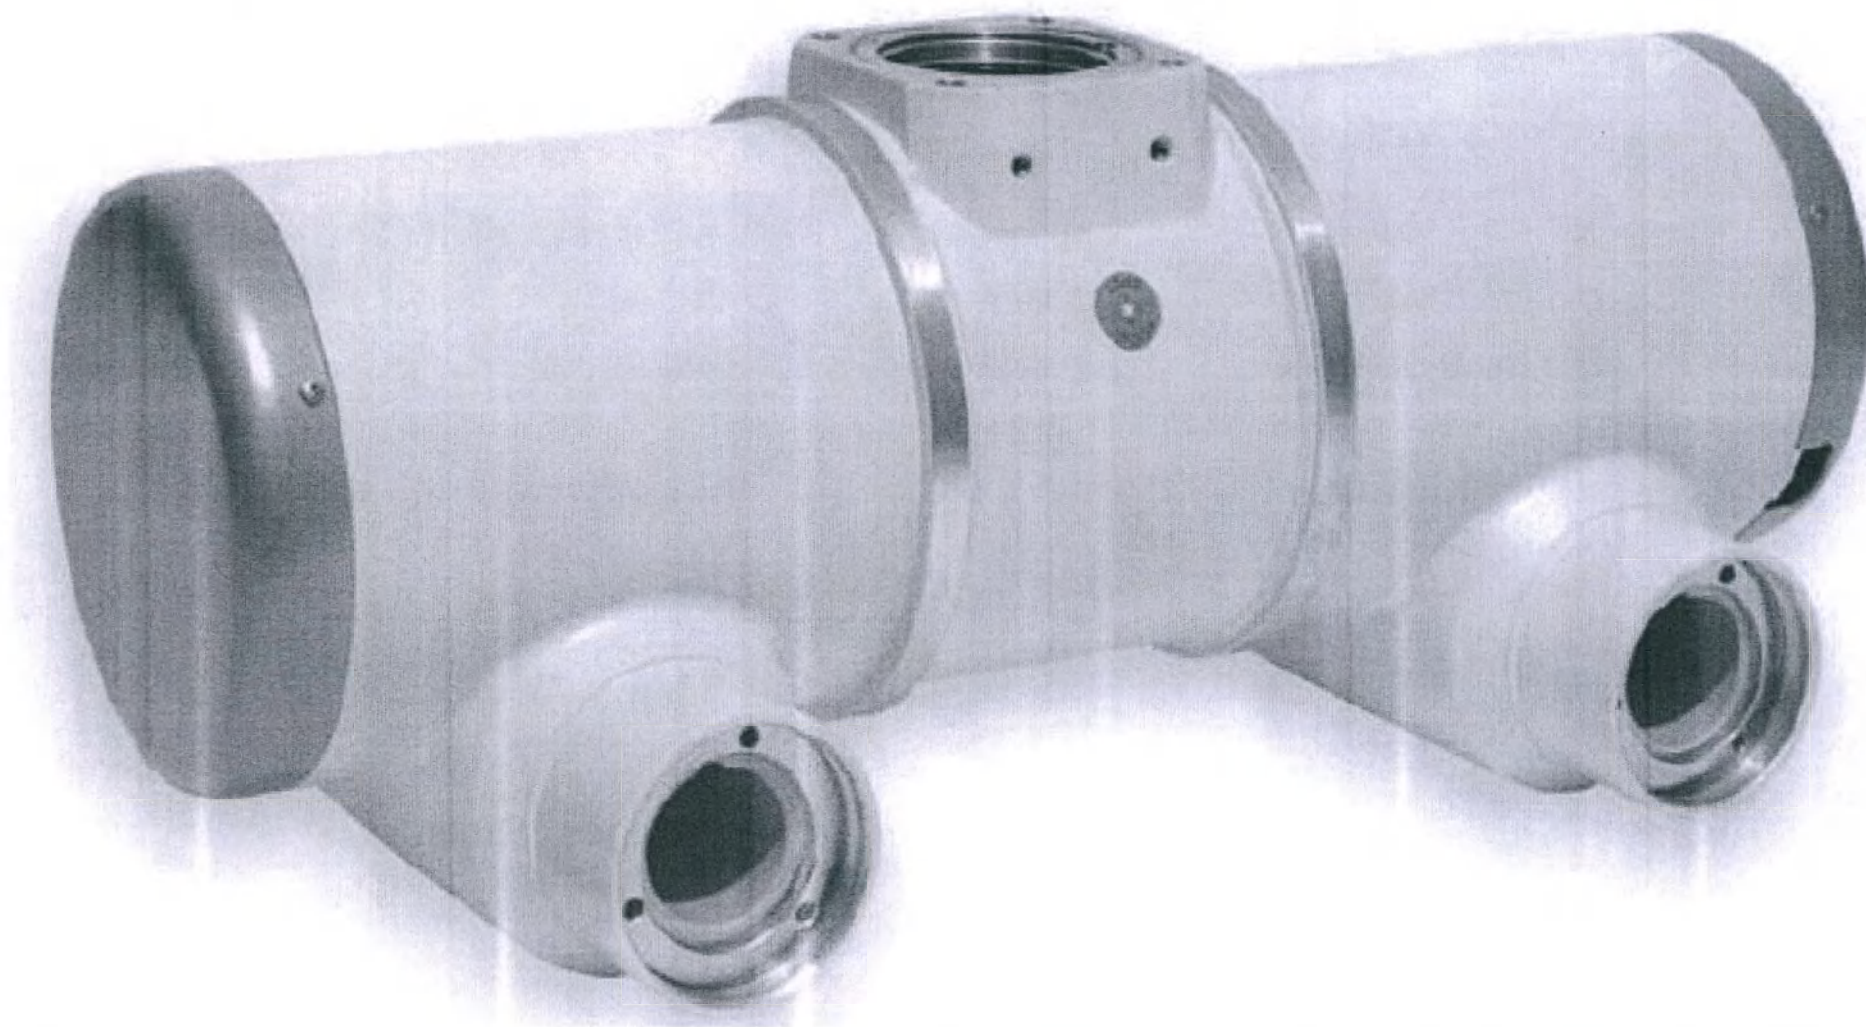


Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской RAD 14/Leo, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США

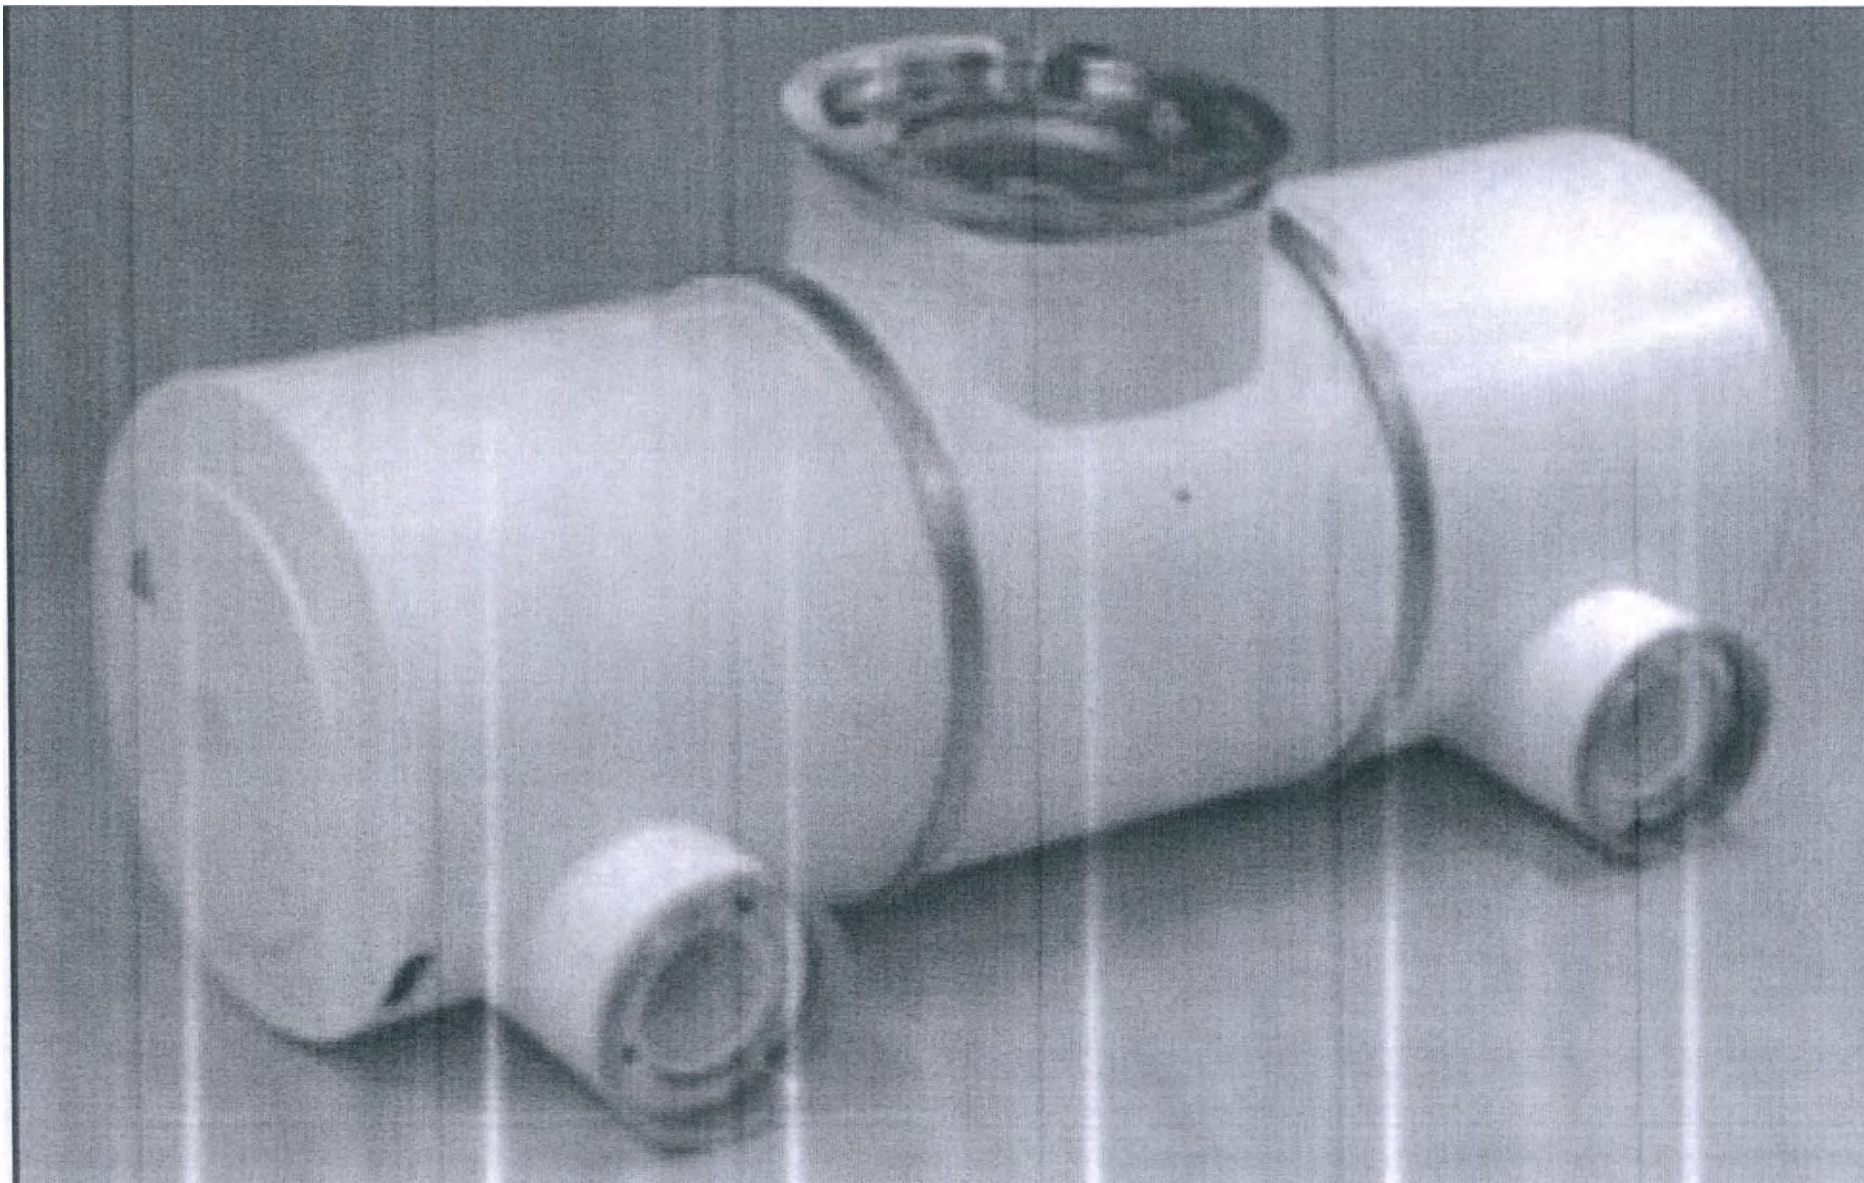

Излучатель рентгеновский с трубкой рентгеновской SV 150/40/80HC-100 или SV 150/40/80C-100


производства Siemens, Германия

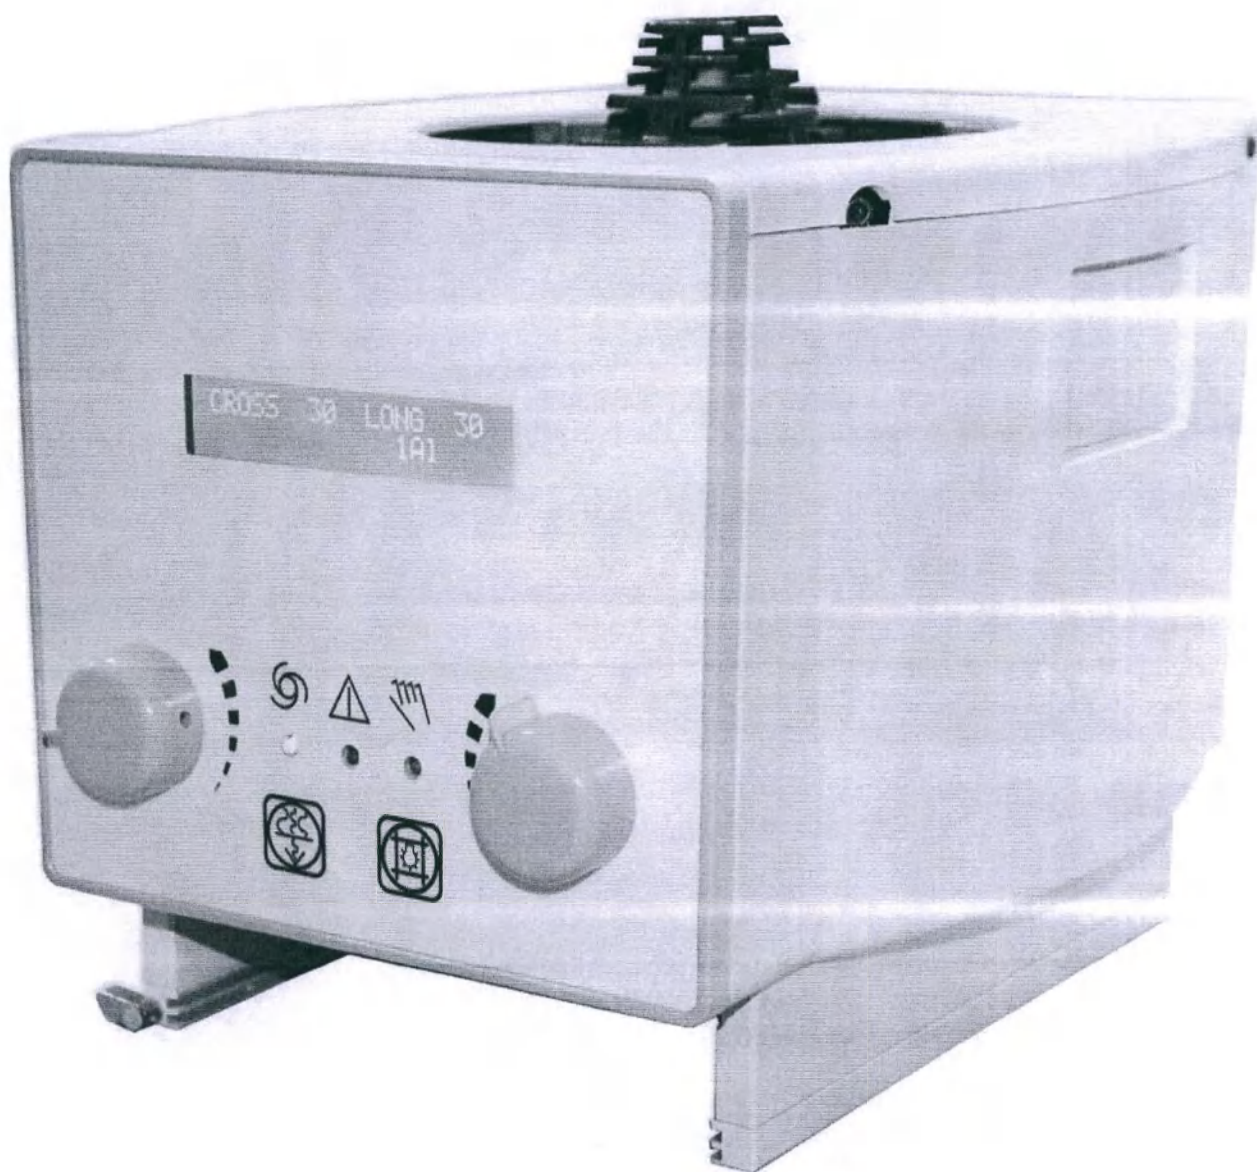


Коллиматор (диафрагма) R 221 ACS, производства Ralco srl.,
Италия




Коллиматор (диафрагма) R 225 ACS, производства Ralco srl.,
Италия

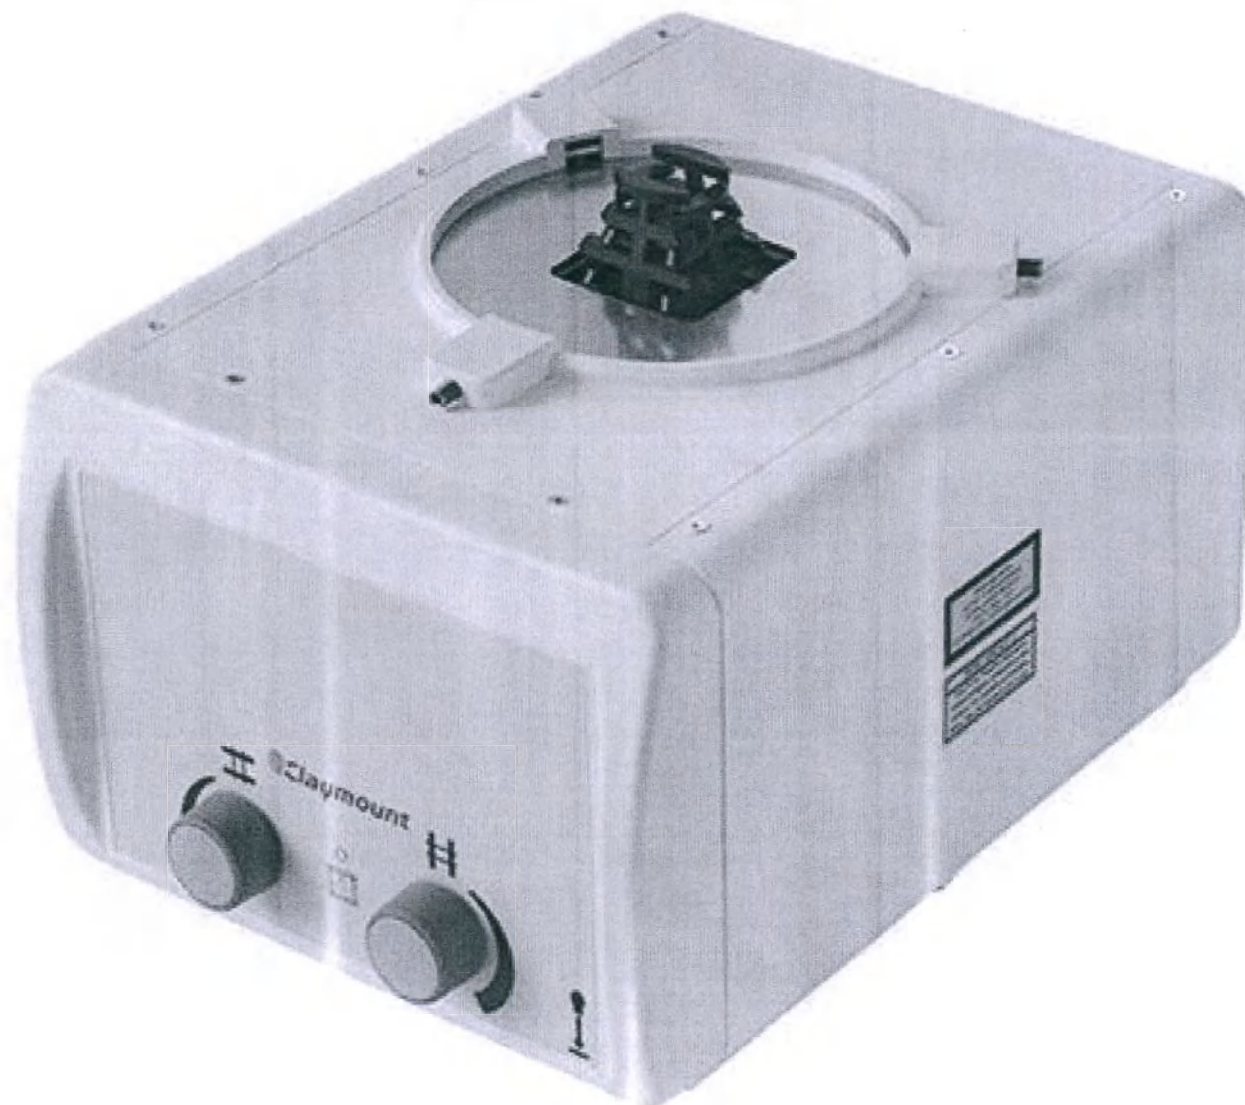

Коллиматор (диафрагма) Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V.,
Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США

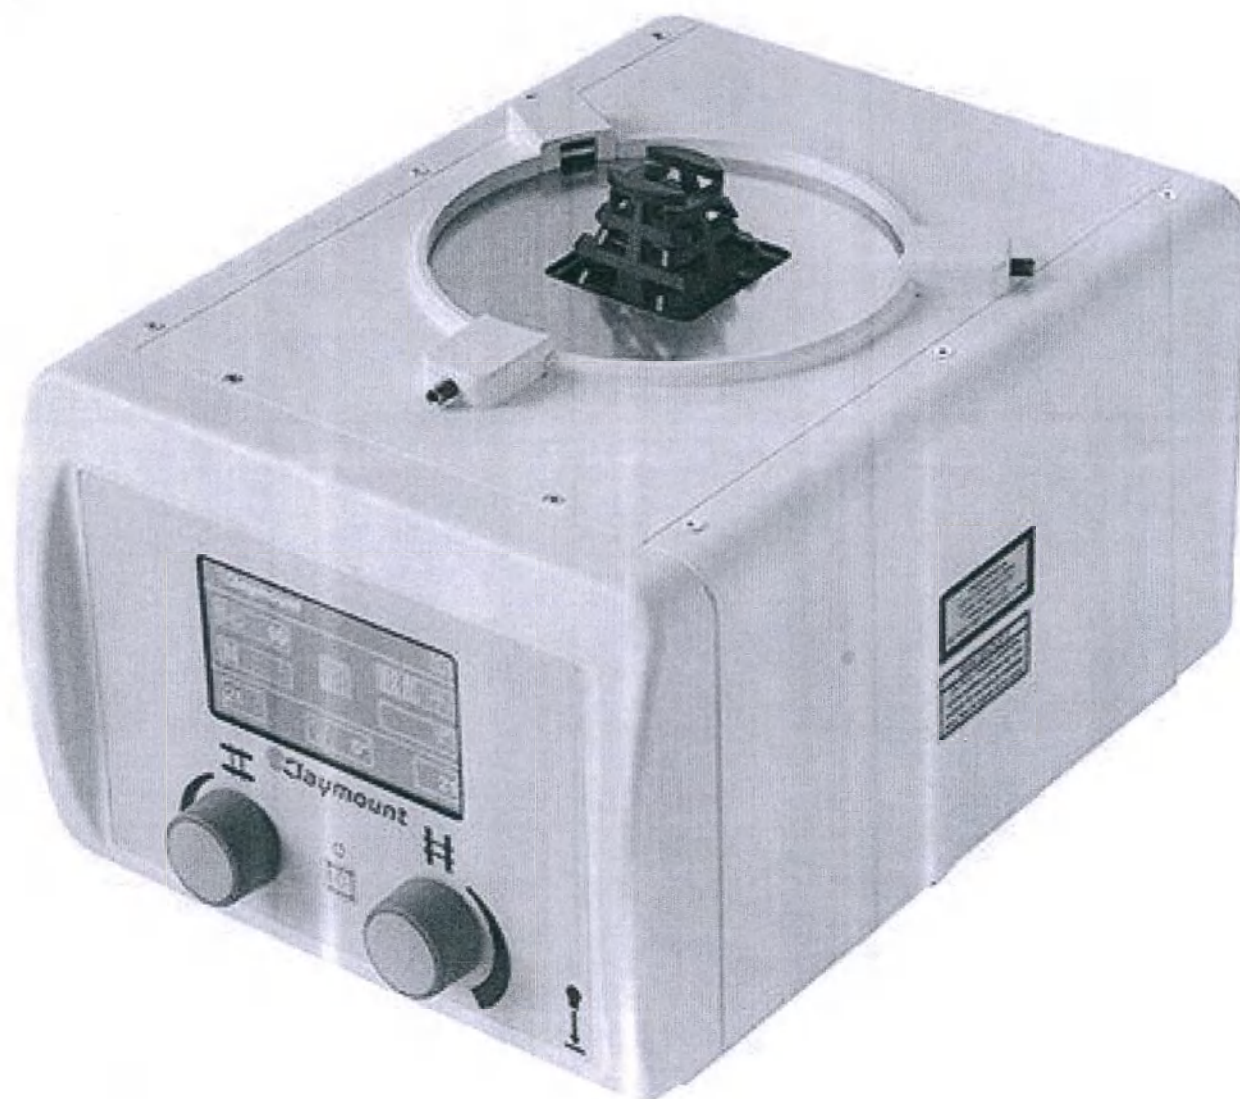


Коллиматор (диафрагма) Optica 40, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или
Varex Imaging Corporation, США

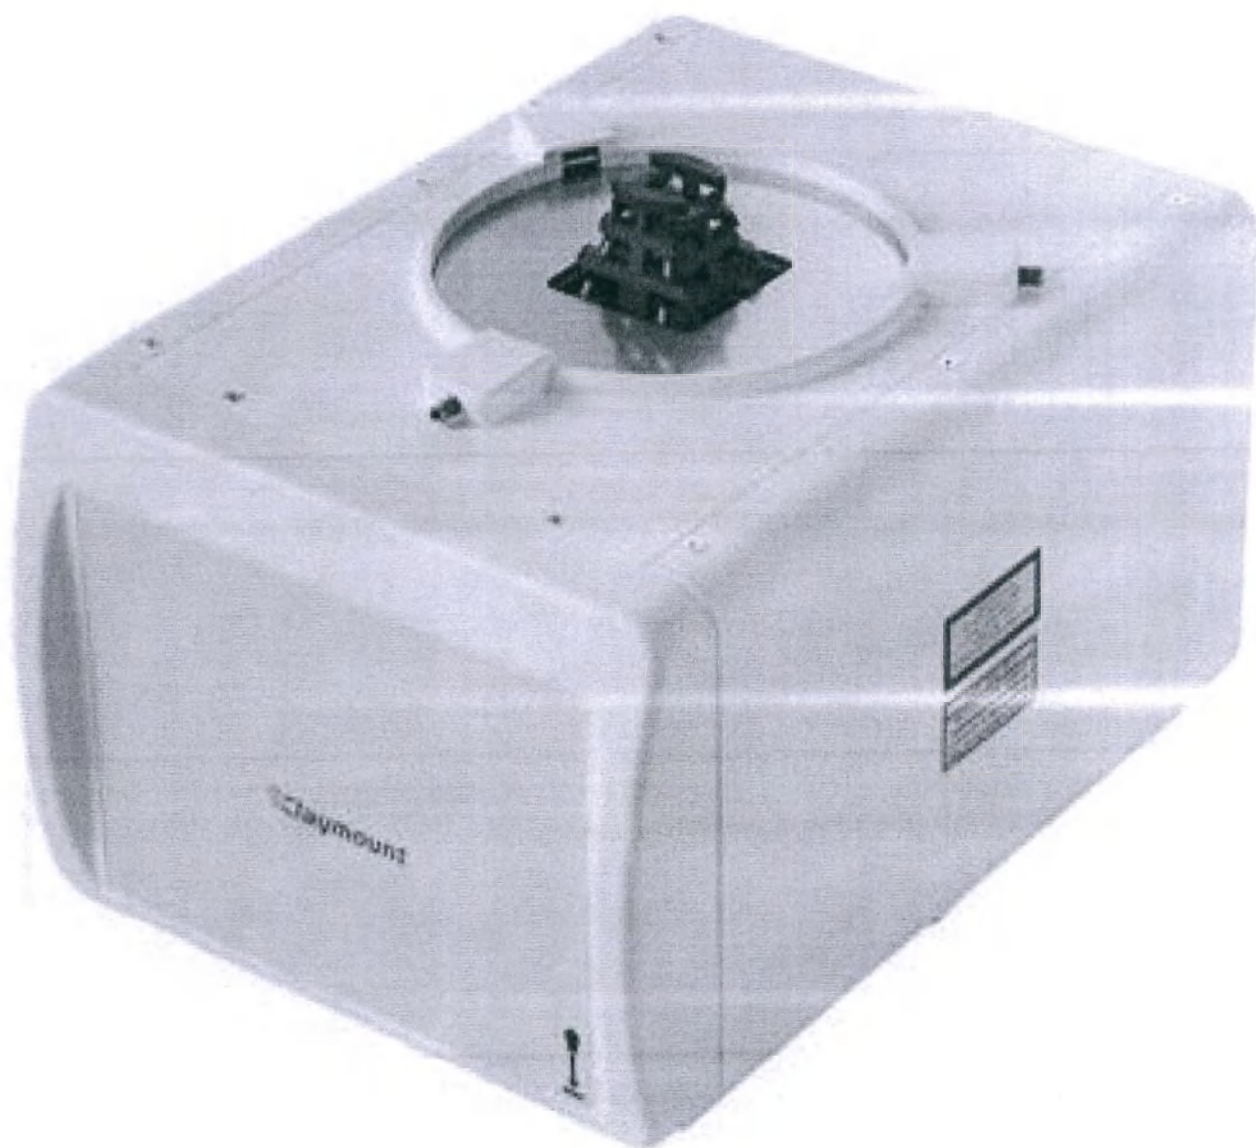


Коллиматор (диафрагма) Optica 50, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США




Коллиматор (диафрагма) AL 02 II eL или AFL 01 II eL,
производства Siemens, Германия

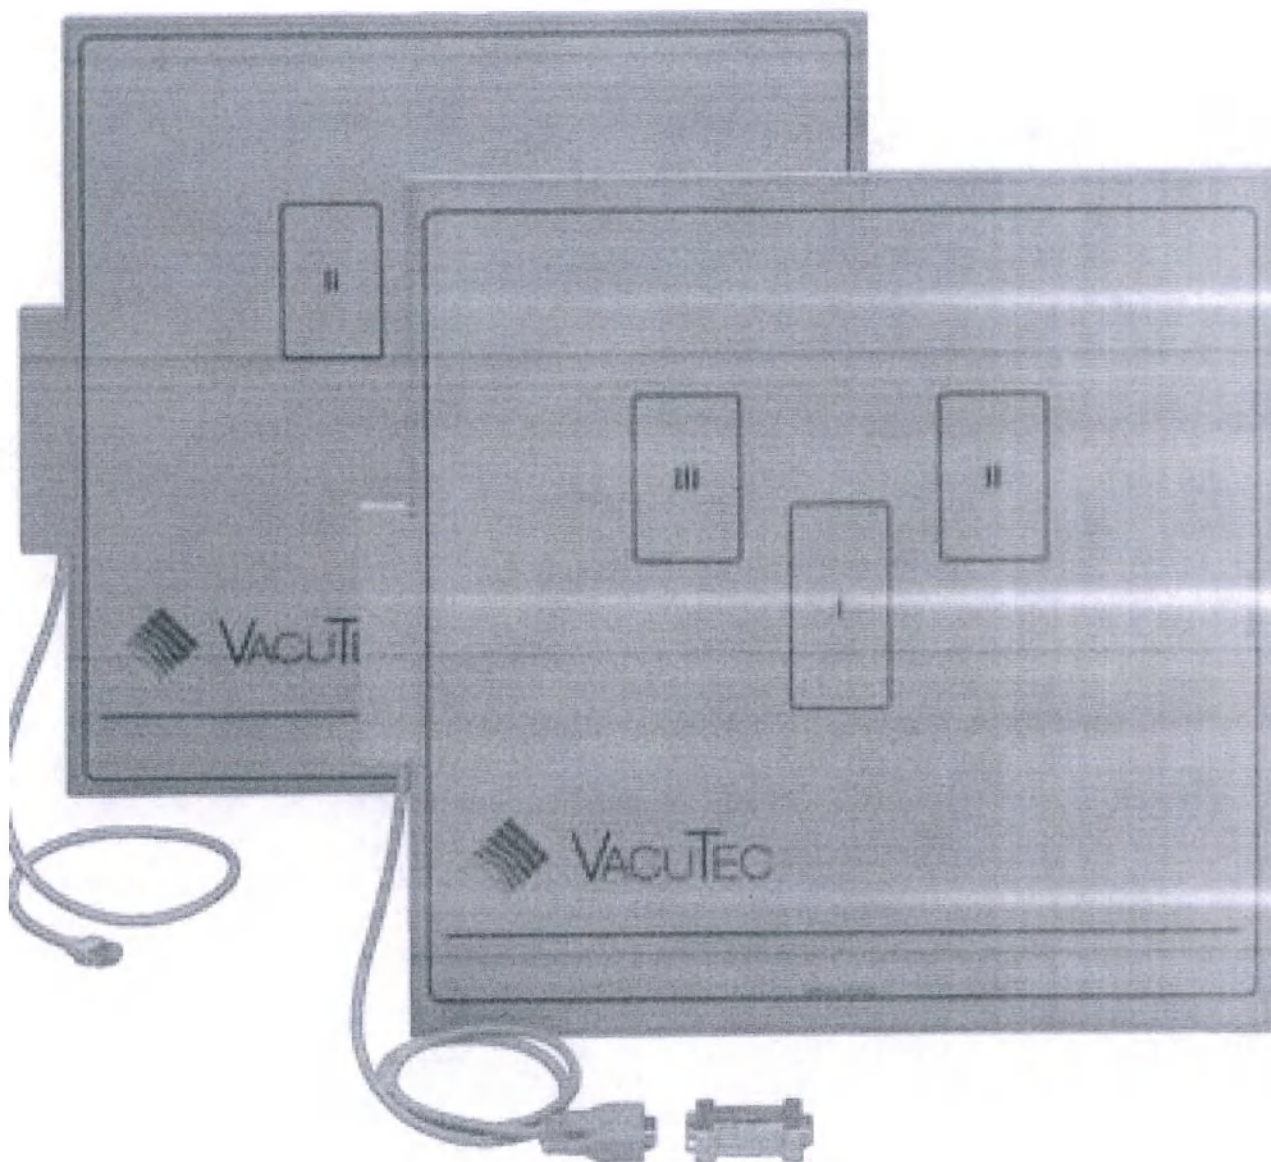

Камера ионизационная серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

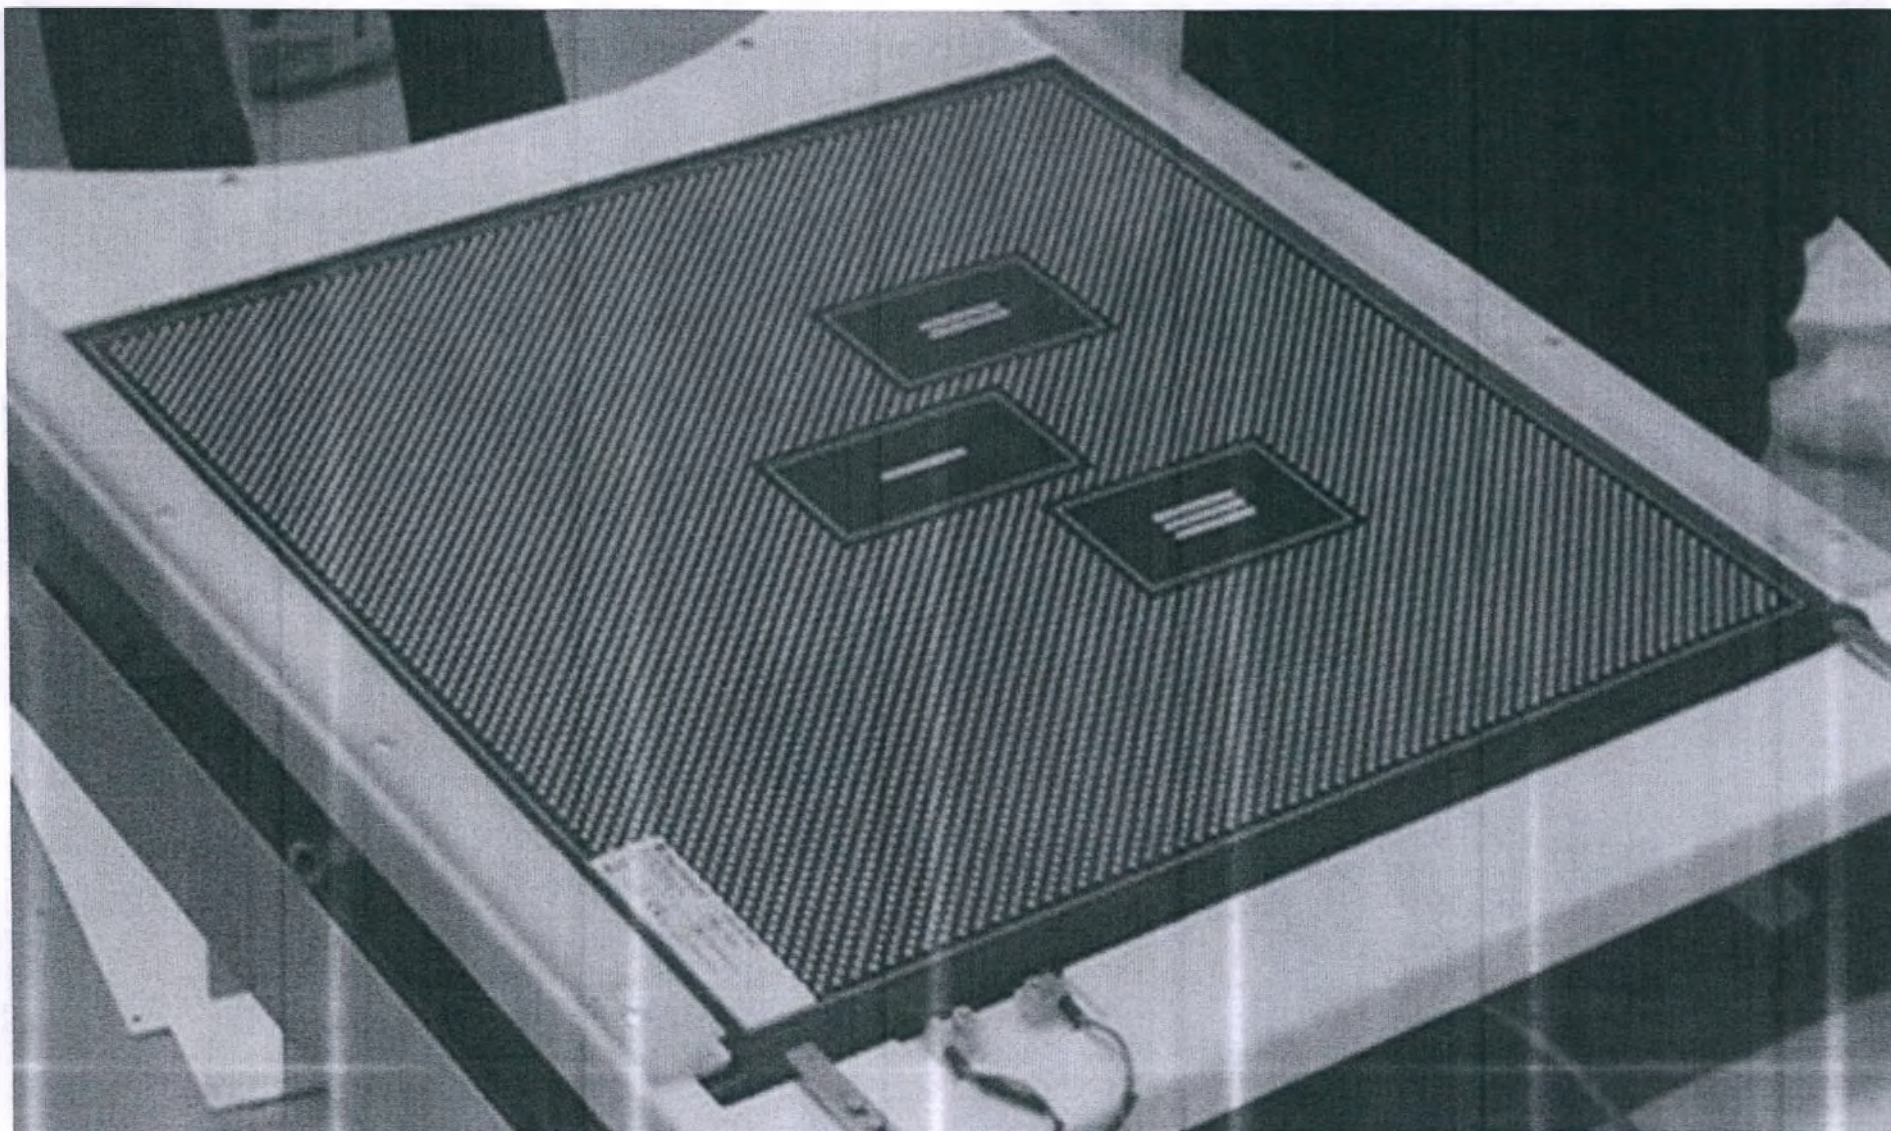


Камера ионизационная серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

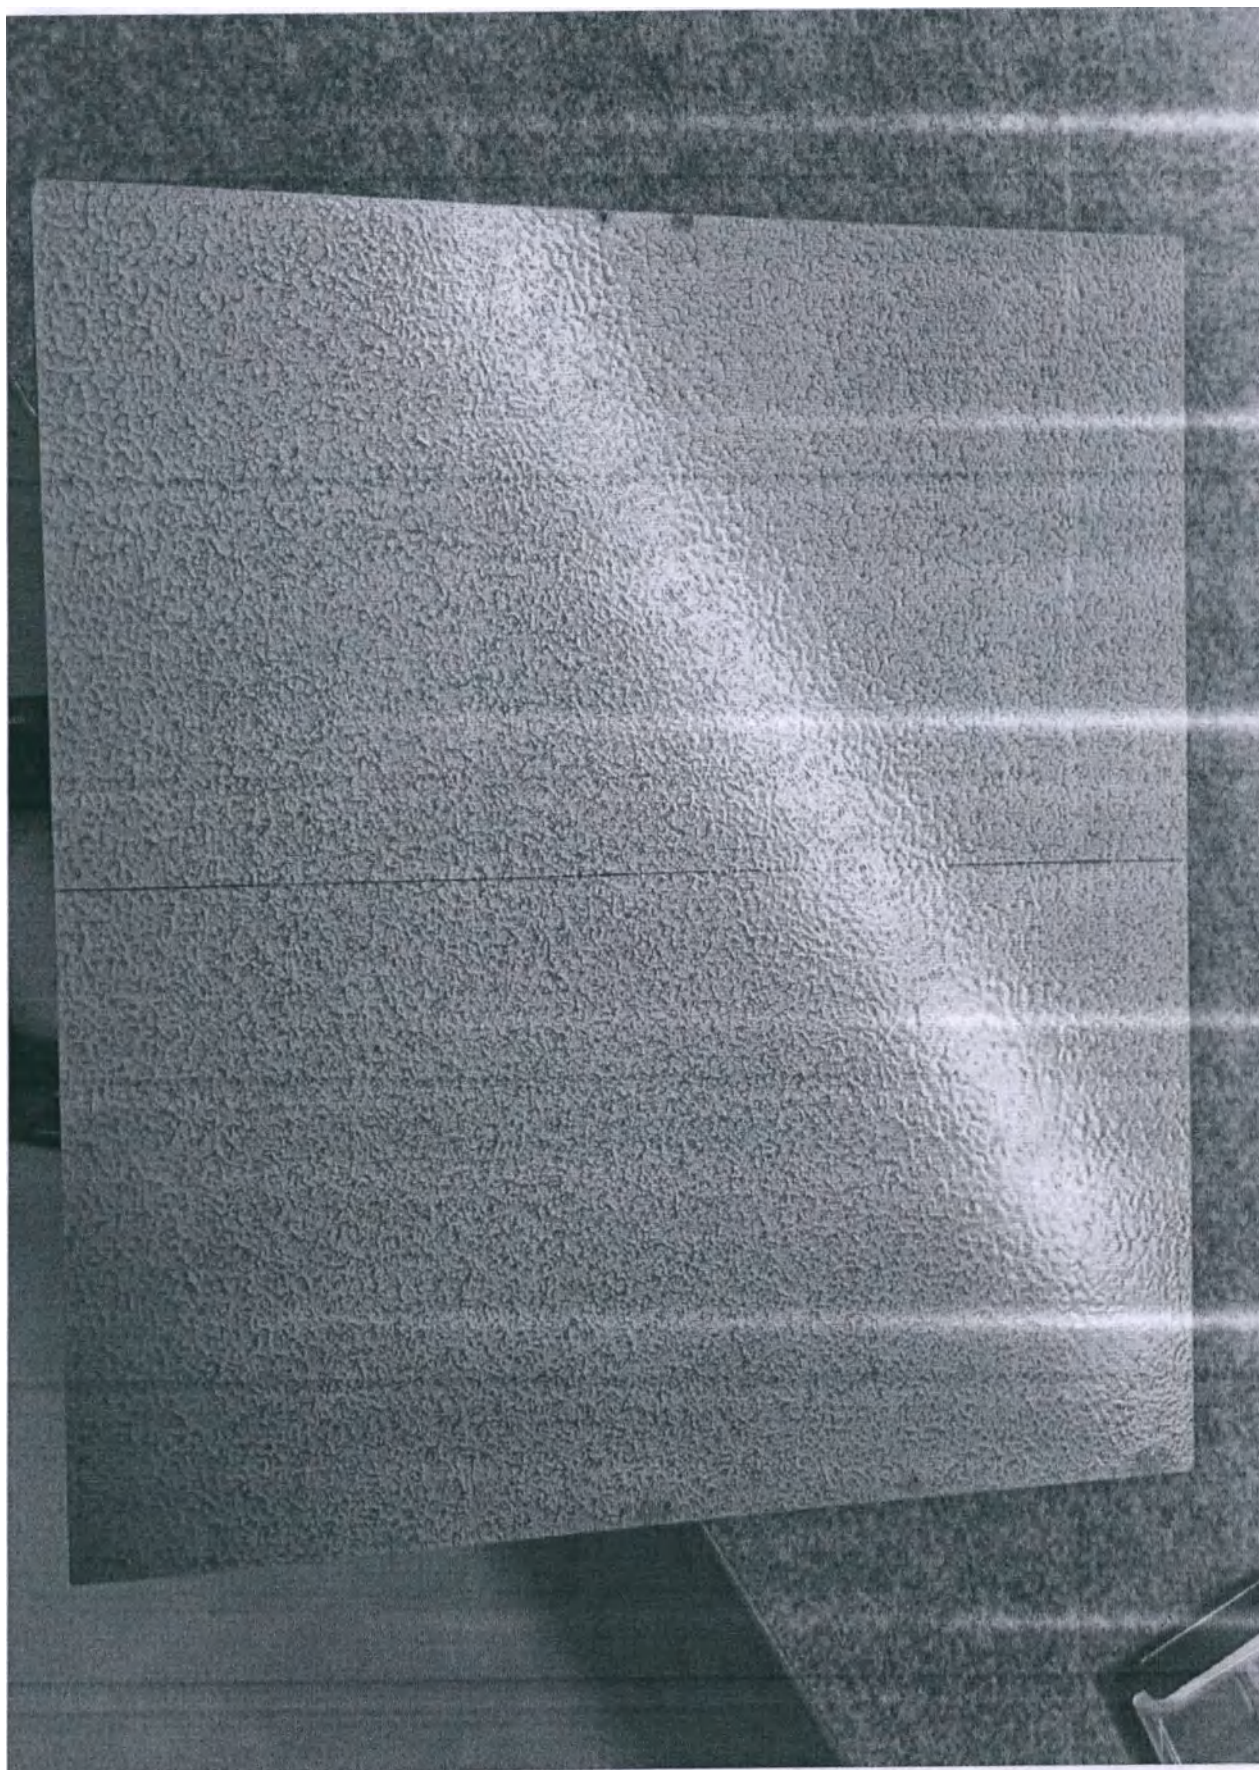


Растр рентгеновский отсеивающий (решетка фокусирующая) серии Lysholm, производства Gridline A.B., Швеция




Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

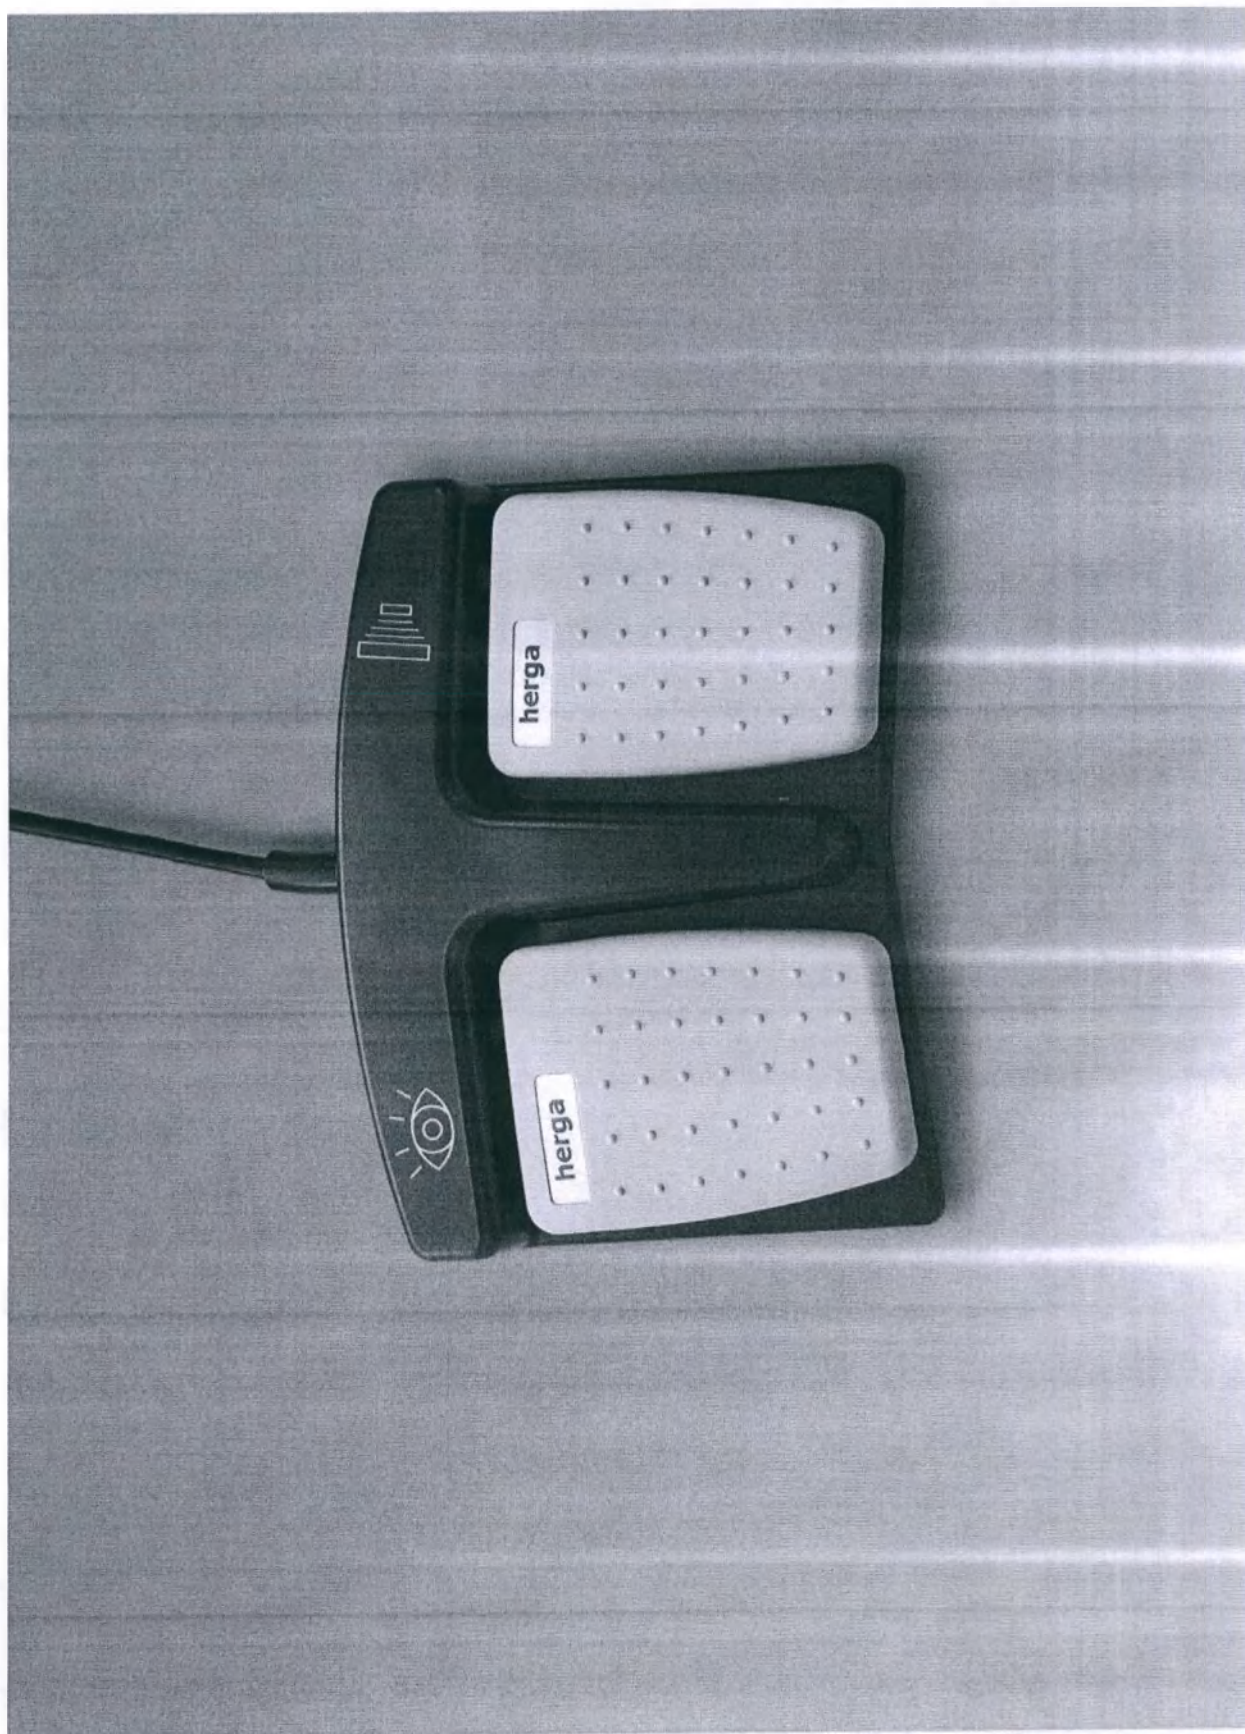


Двойная педаль включения экспозиции, производства Herga Technology Ltd., Великобритания

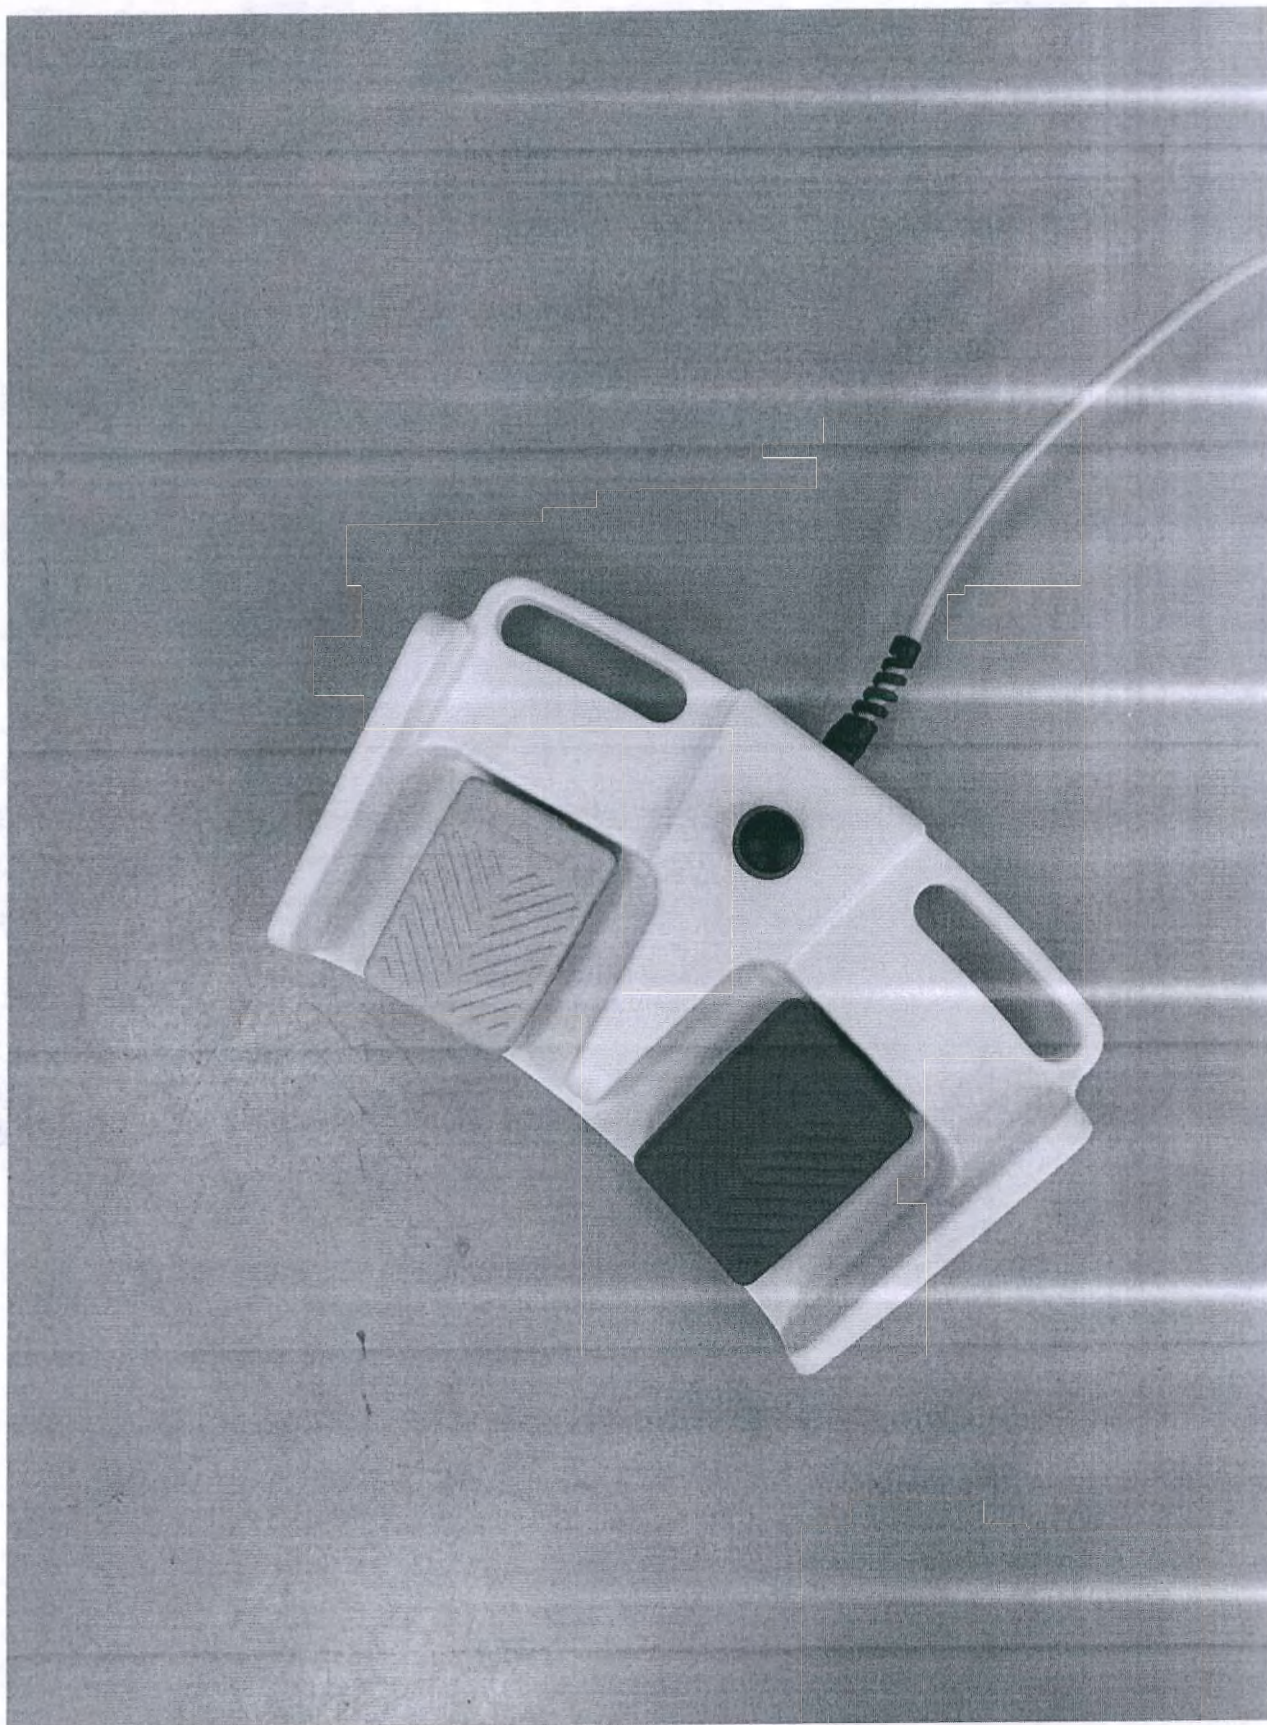


Педаль включения рентгеновского излучения в проводном и беспроводном исполнении, производства SUNS International, LLC, США (Китай)

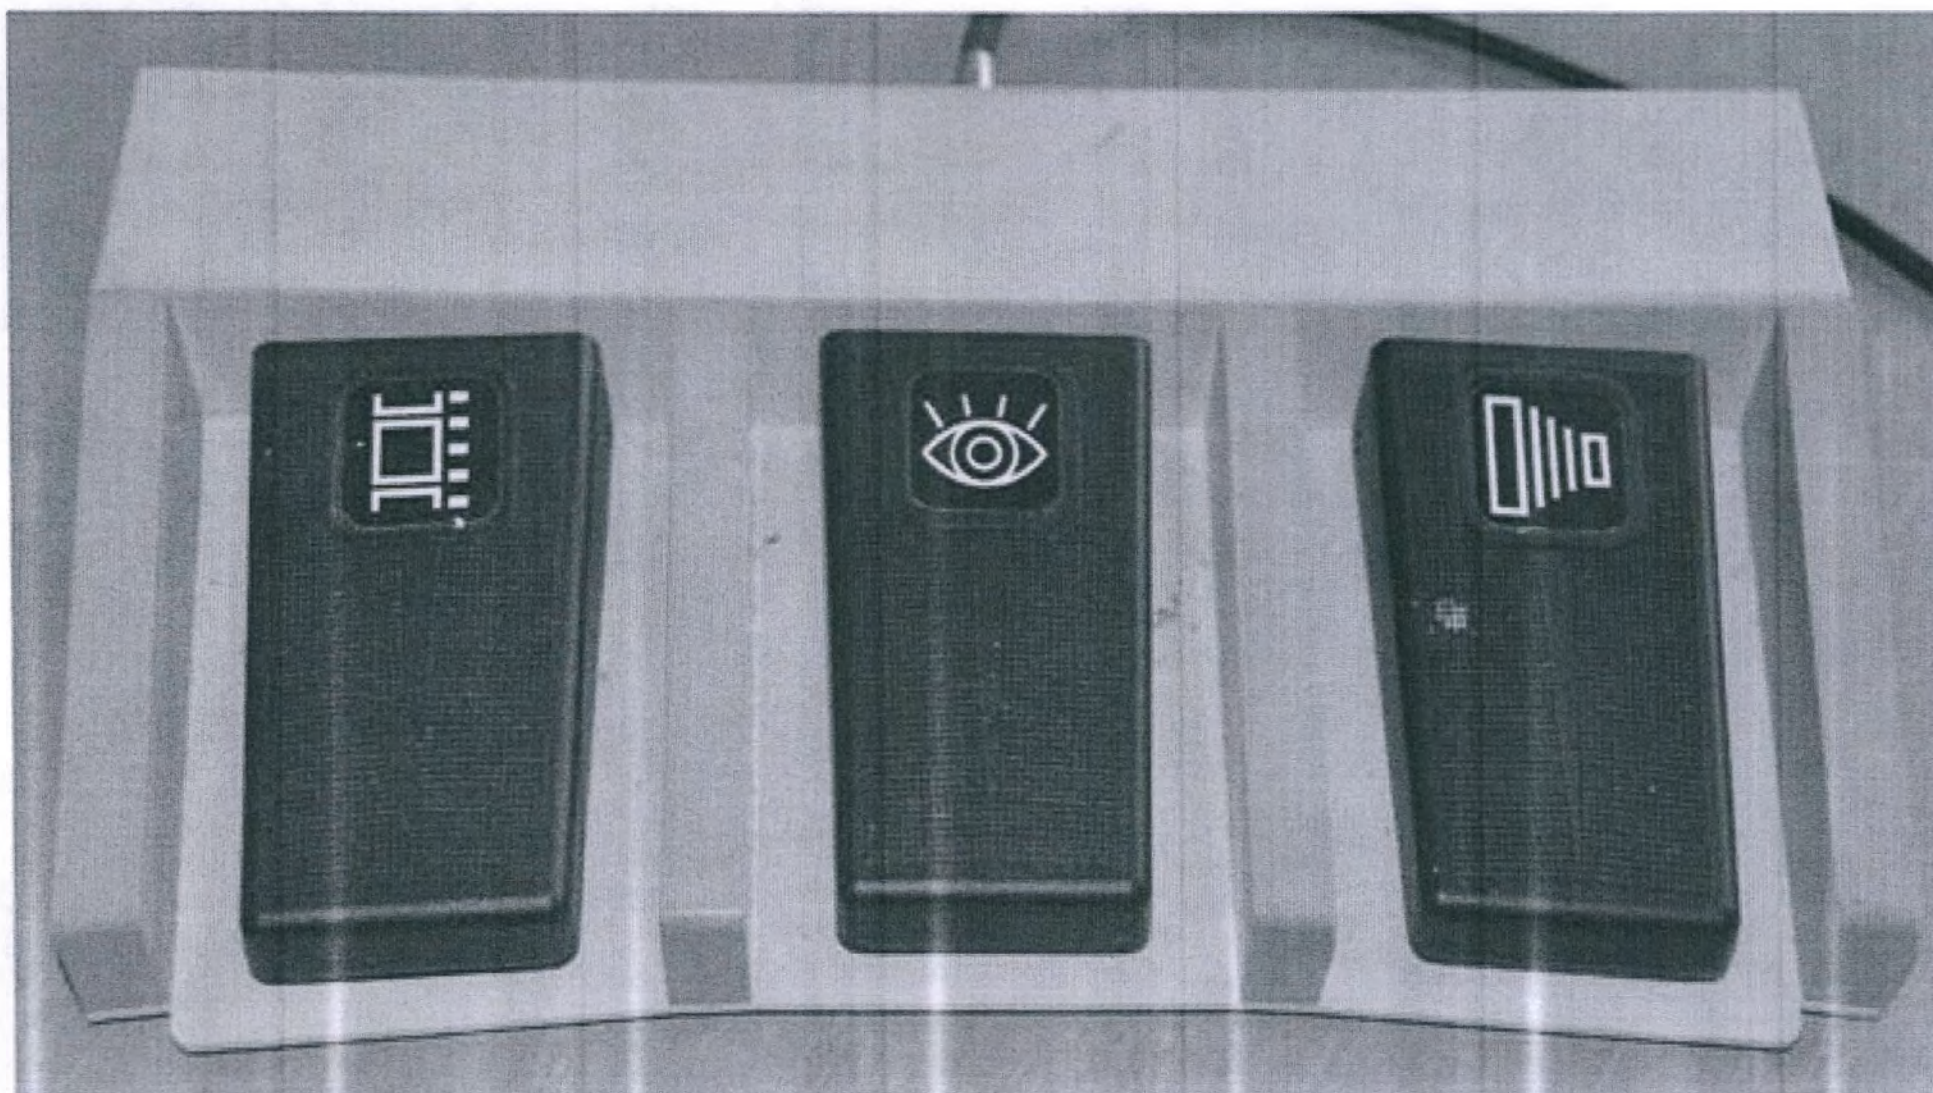

Педаль включения флюороскопии, производства STEPHANIX, Франция

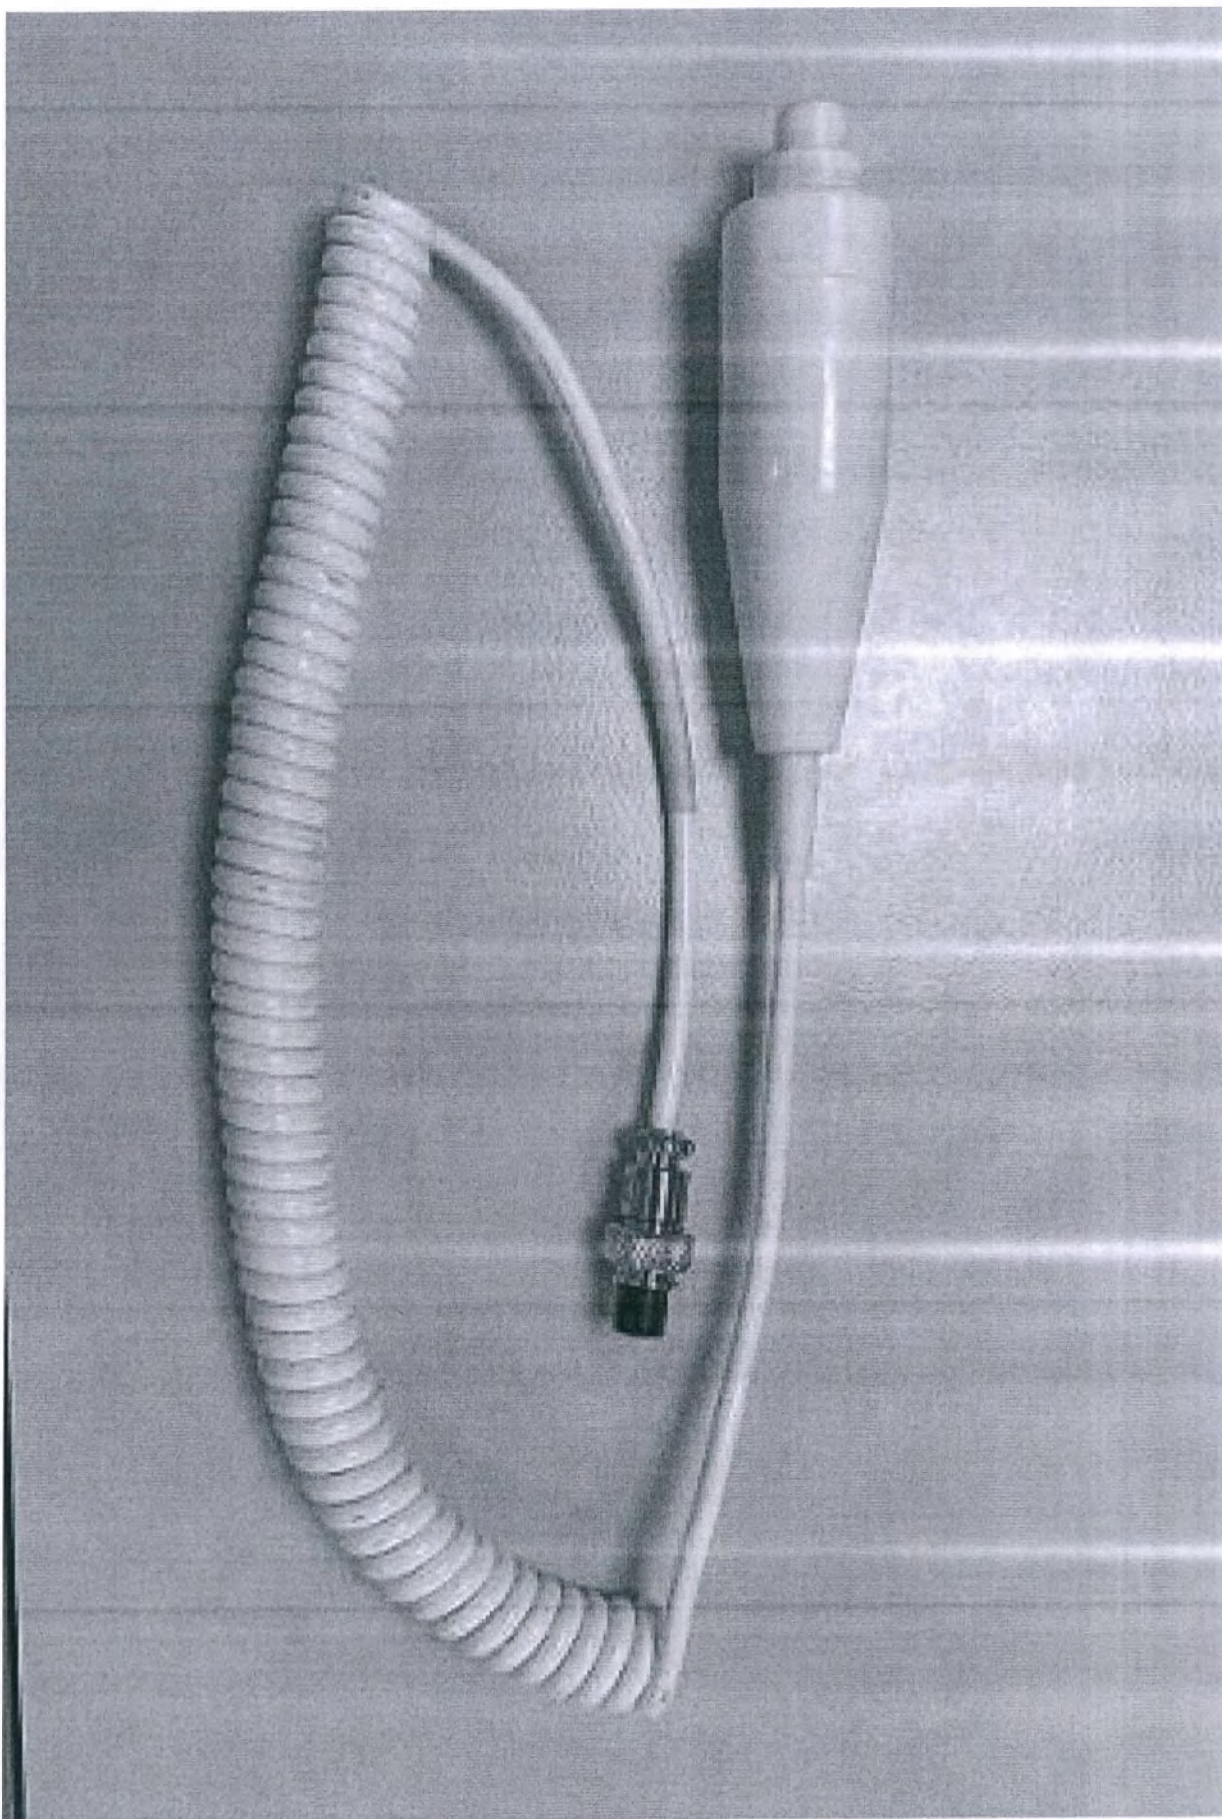


Устройство включения экспозиции 2,2 м и/или 5 м, производства Dongzi Medical System Co., Китай

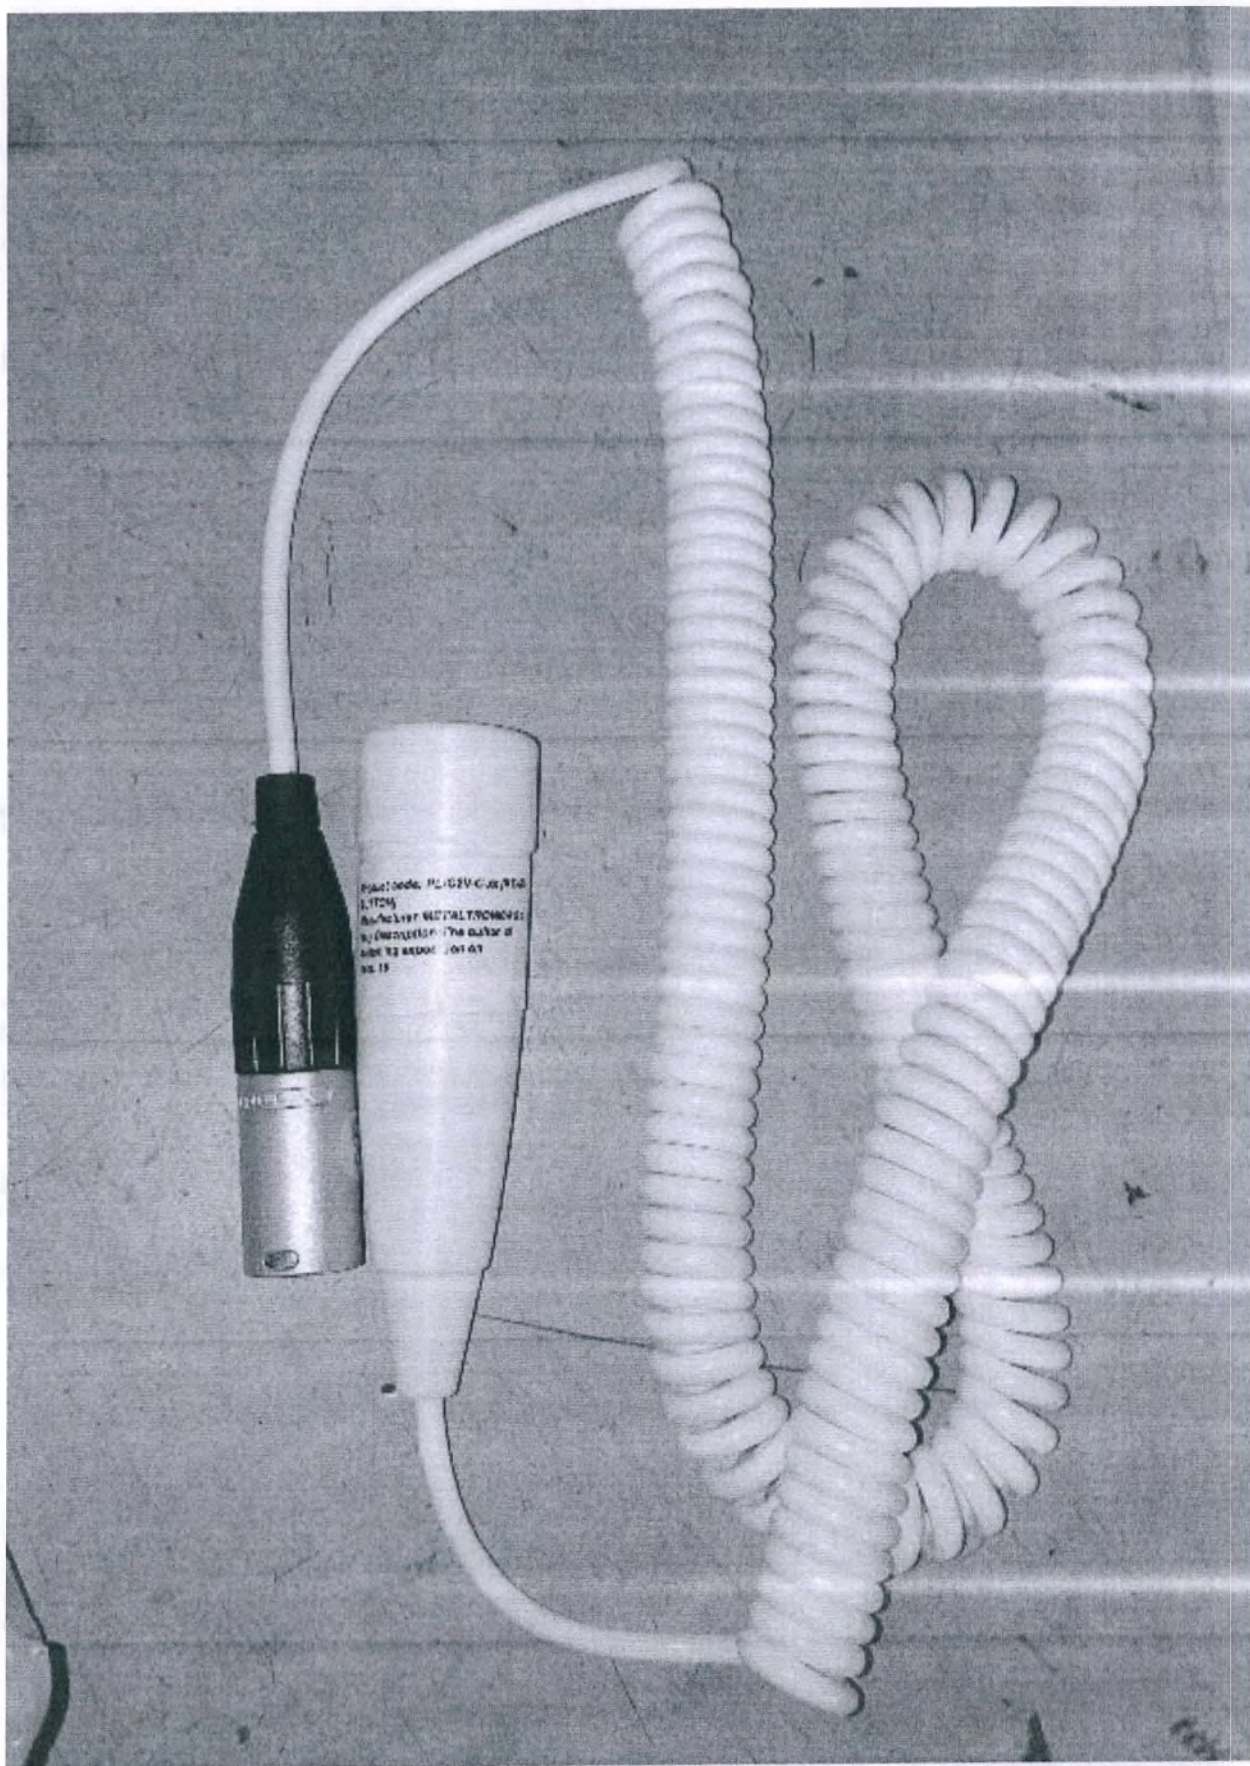


Устройство включения экспозиции 2,2 м и/или 5 м, производства
OMRON Corporation, Япония



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Tecnint,
производства Tecnint HTE s.r.l., Италия

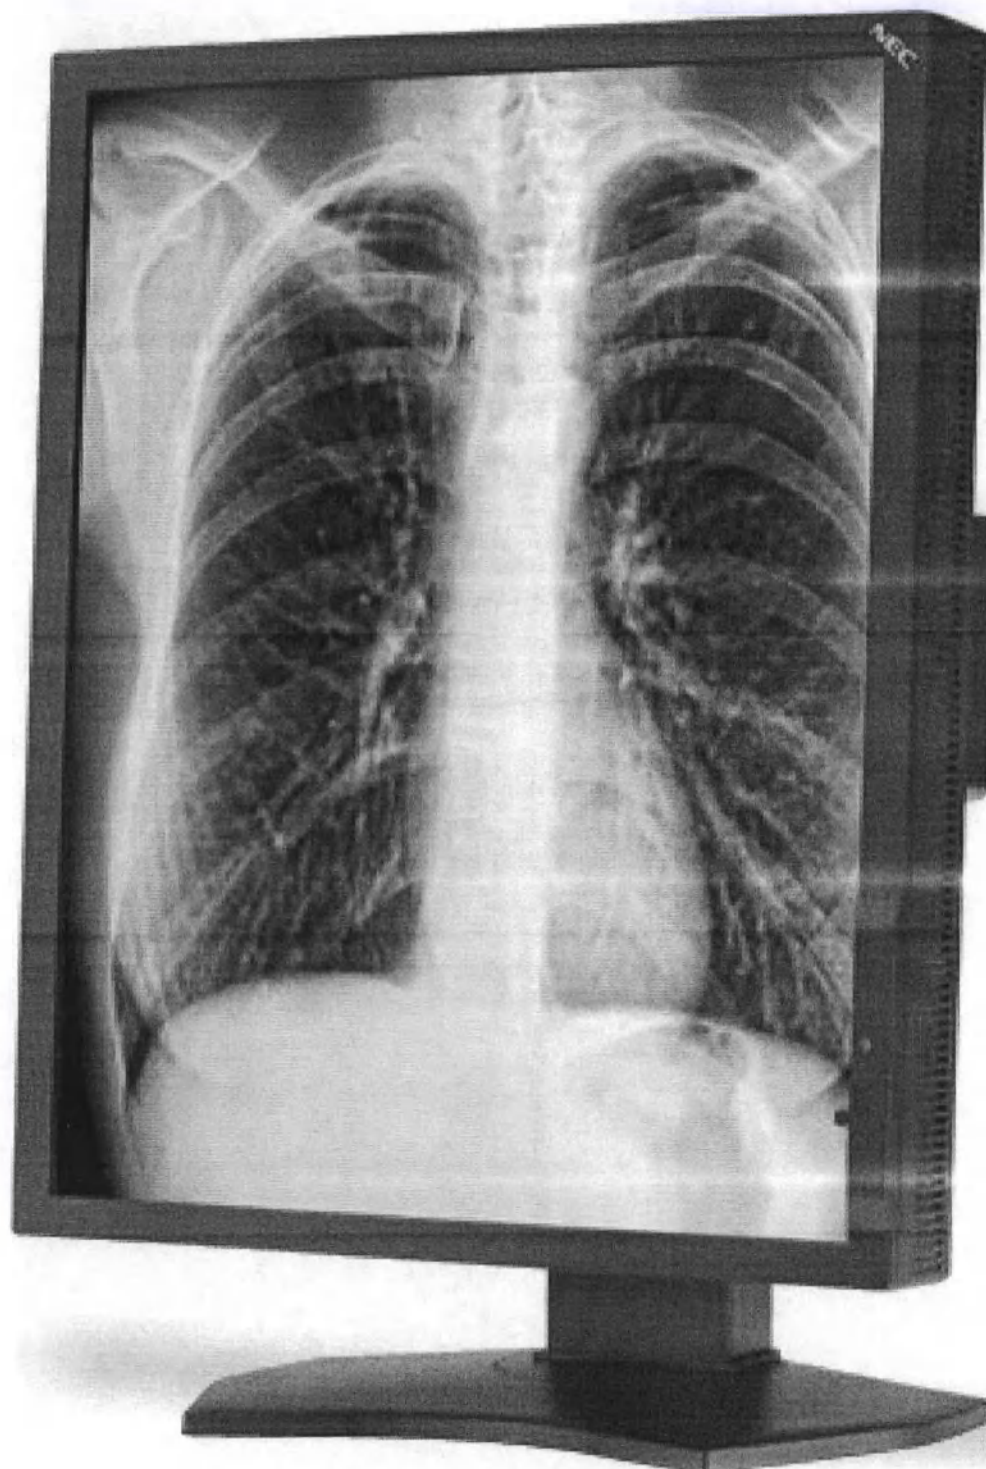


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай

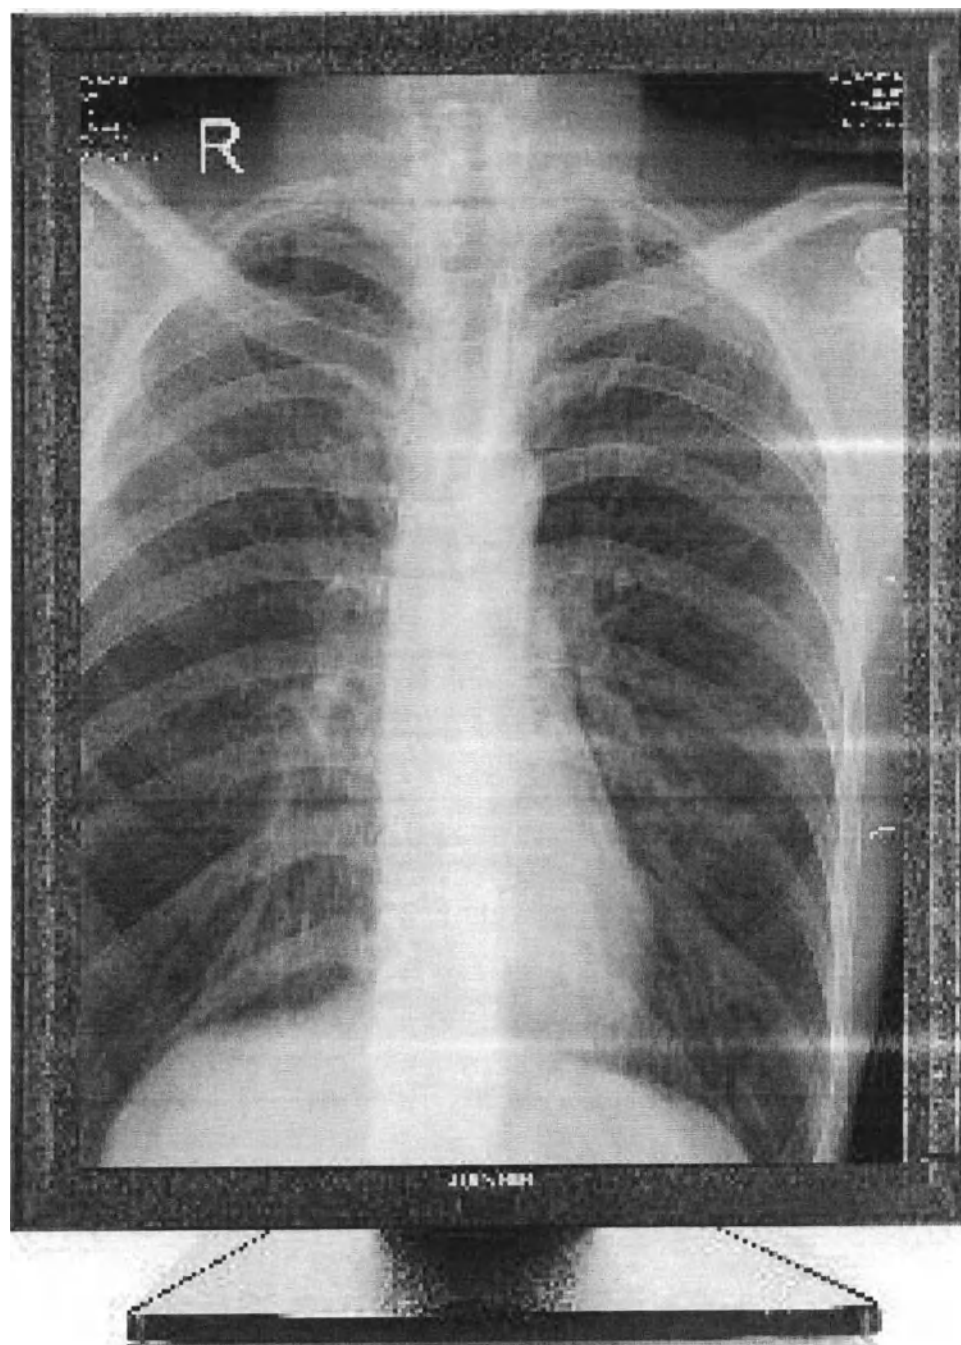


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Jusha, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов HP, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

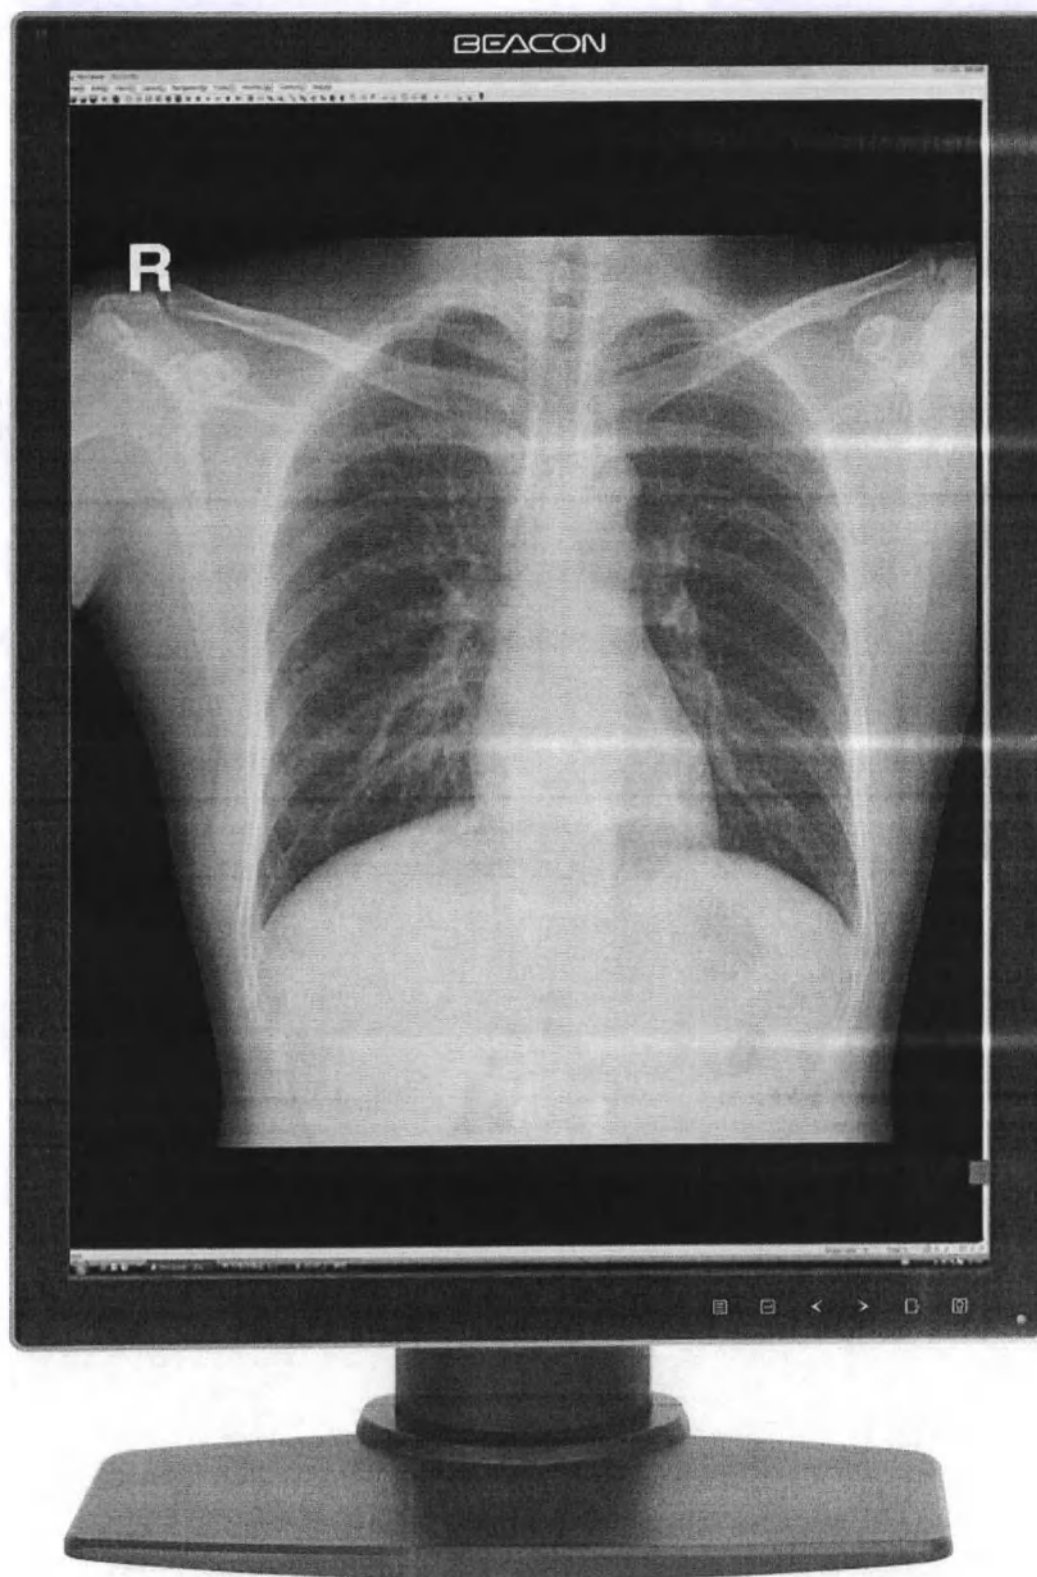


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon,
производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай

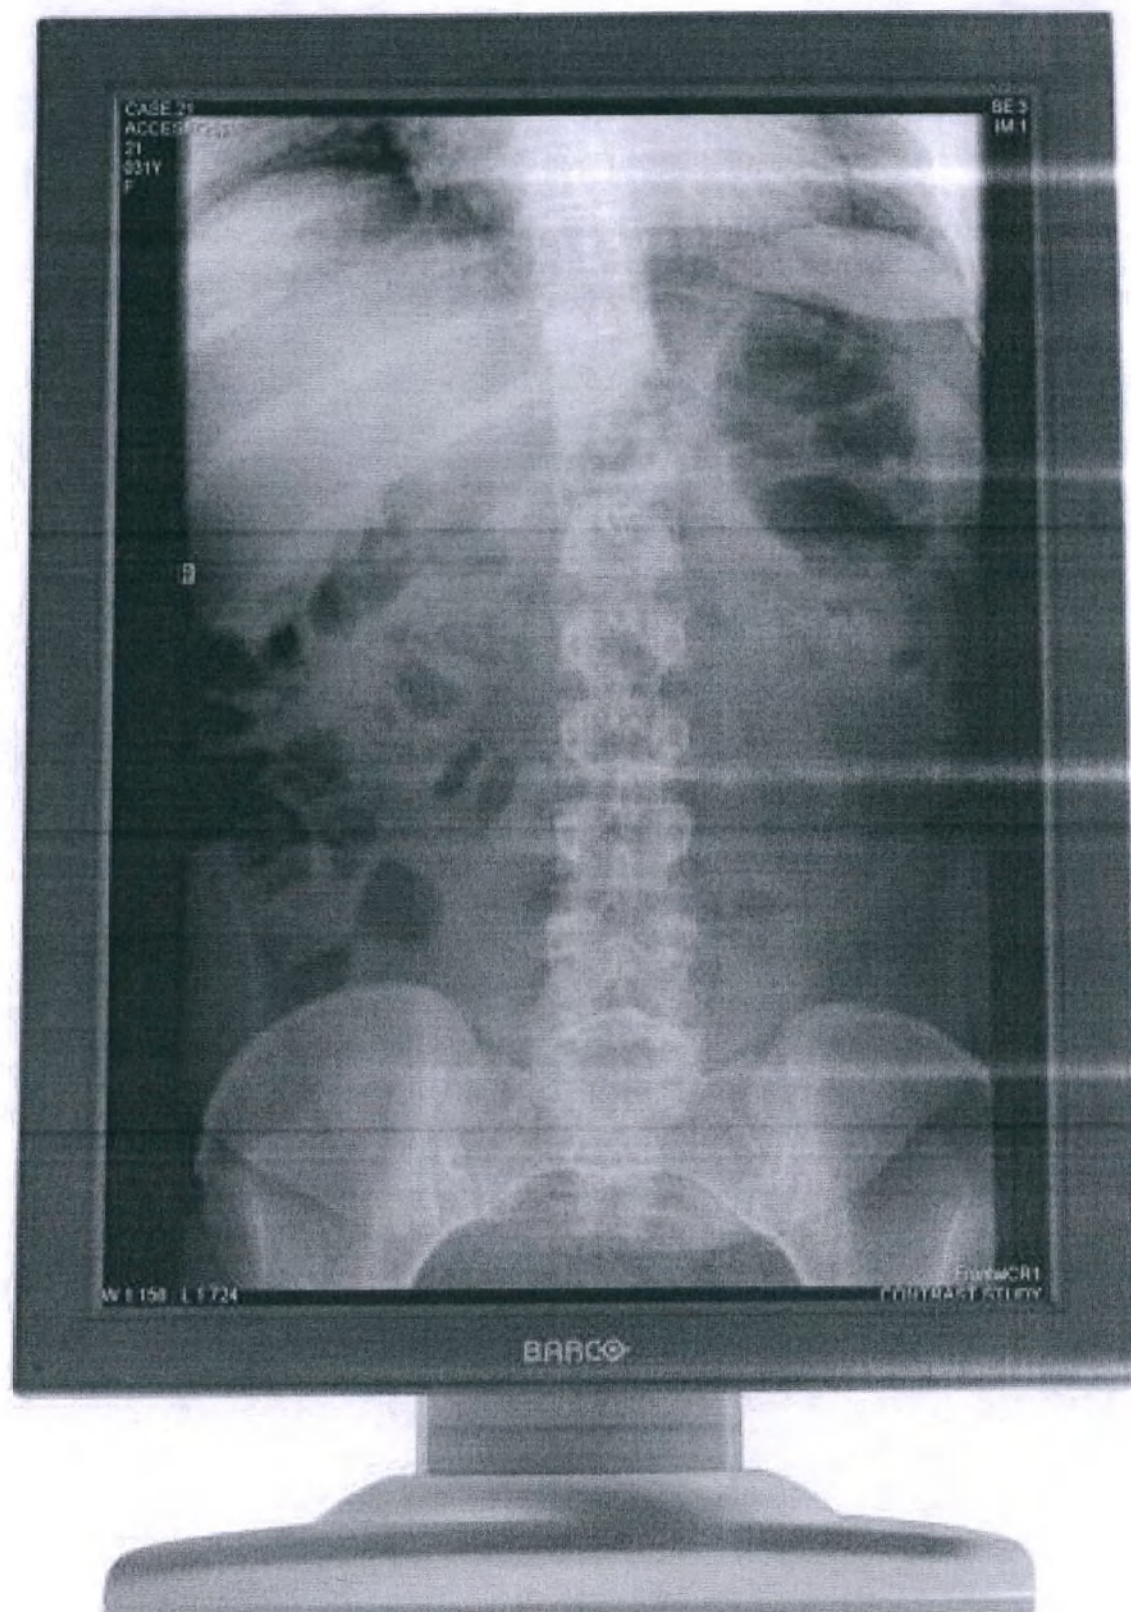


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Barco, производства Barco N.V., Бельгия

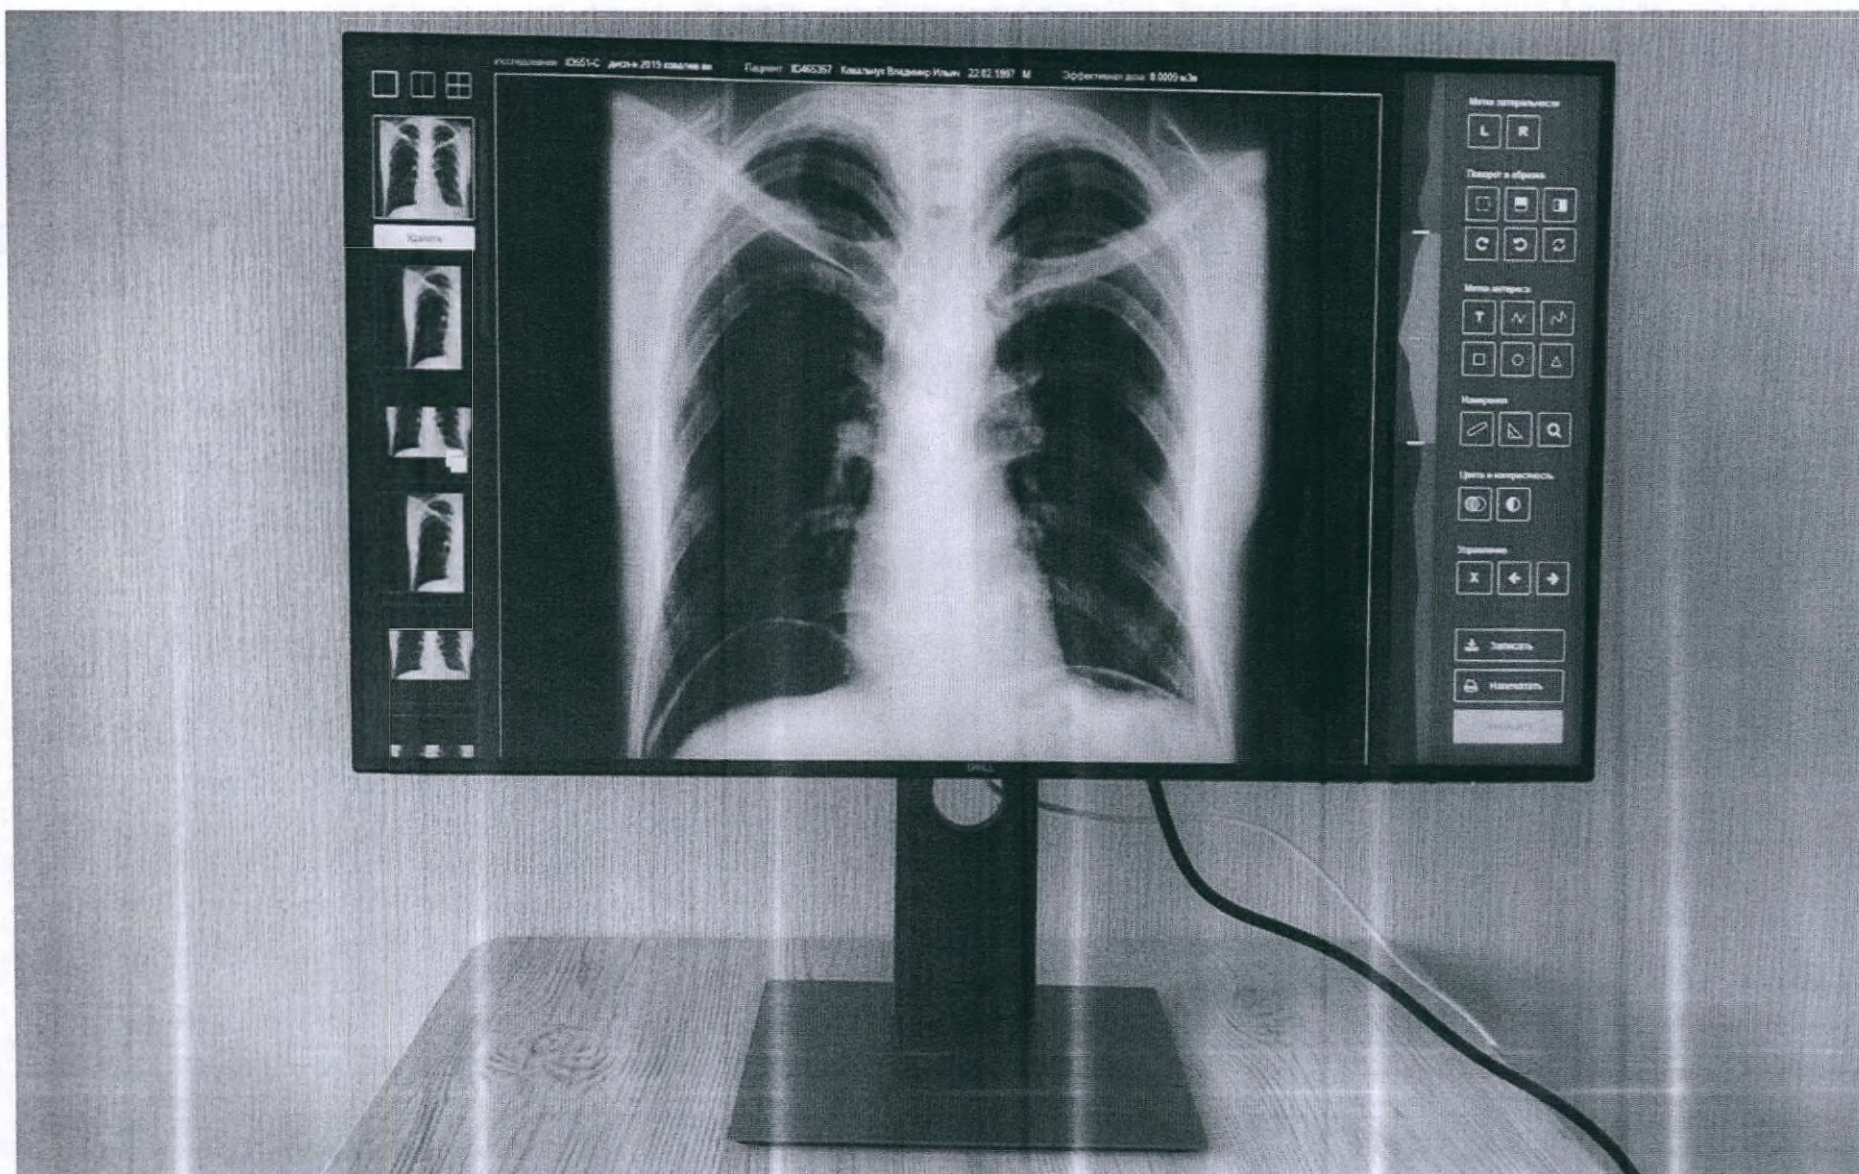


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай

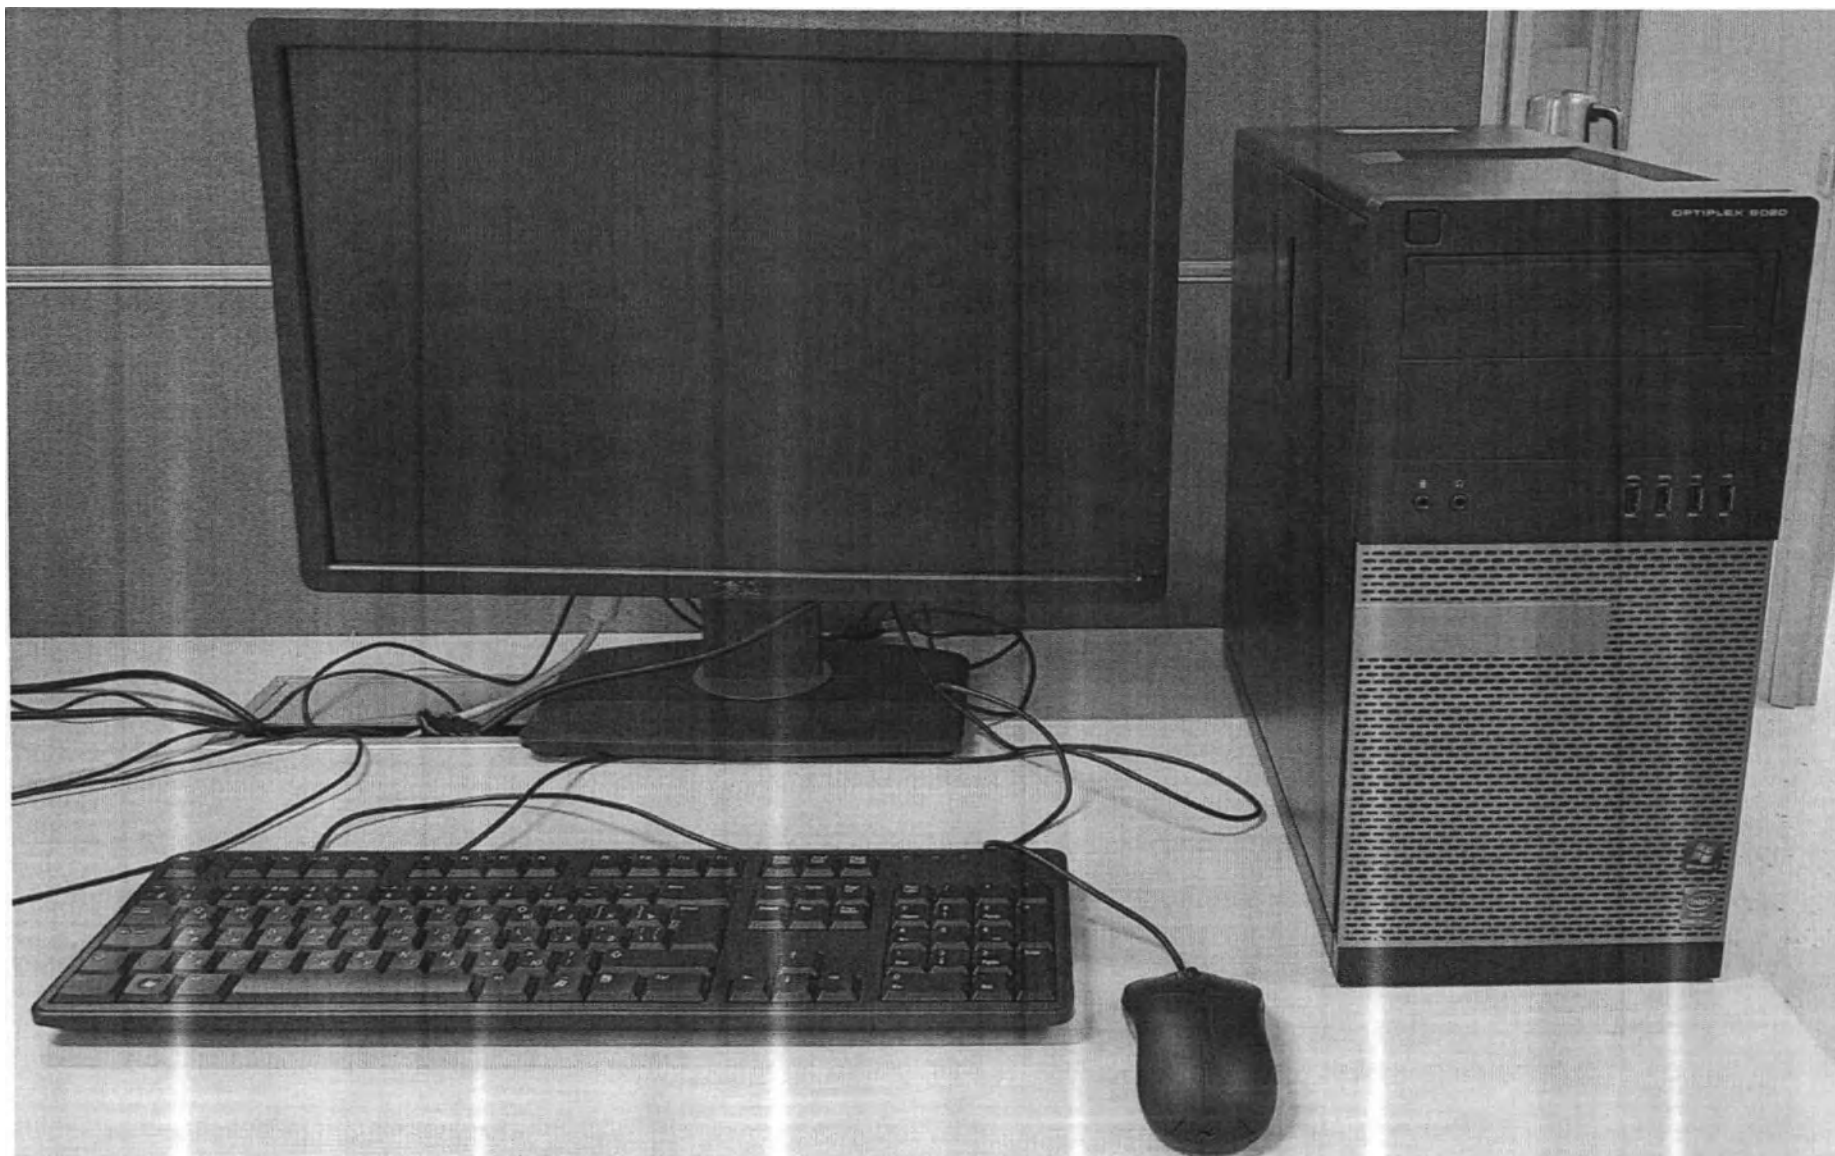


Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

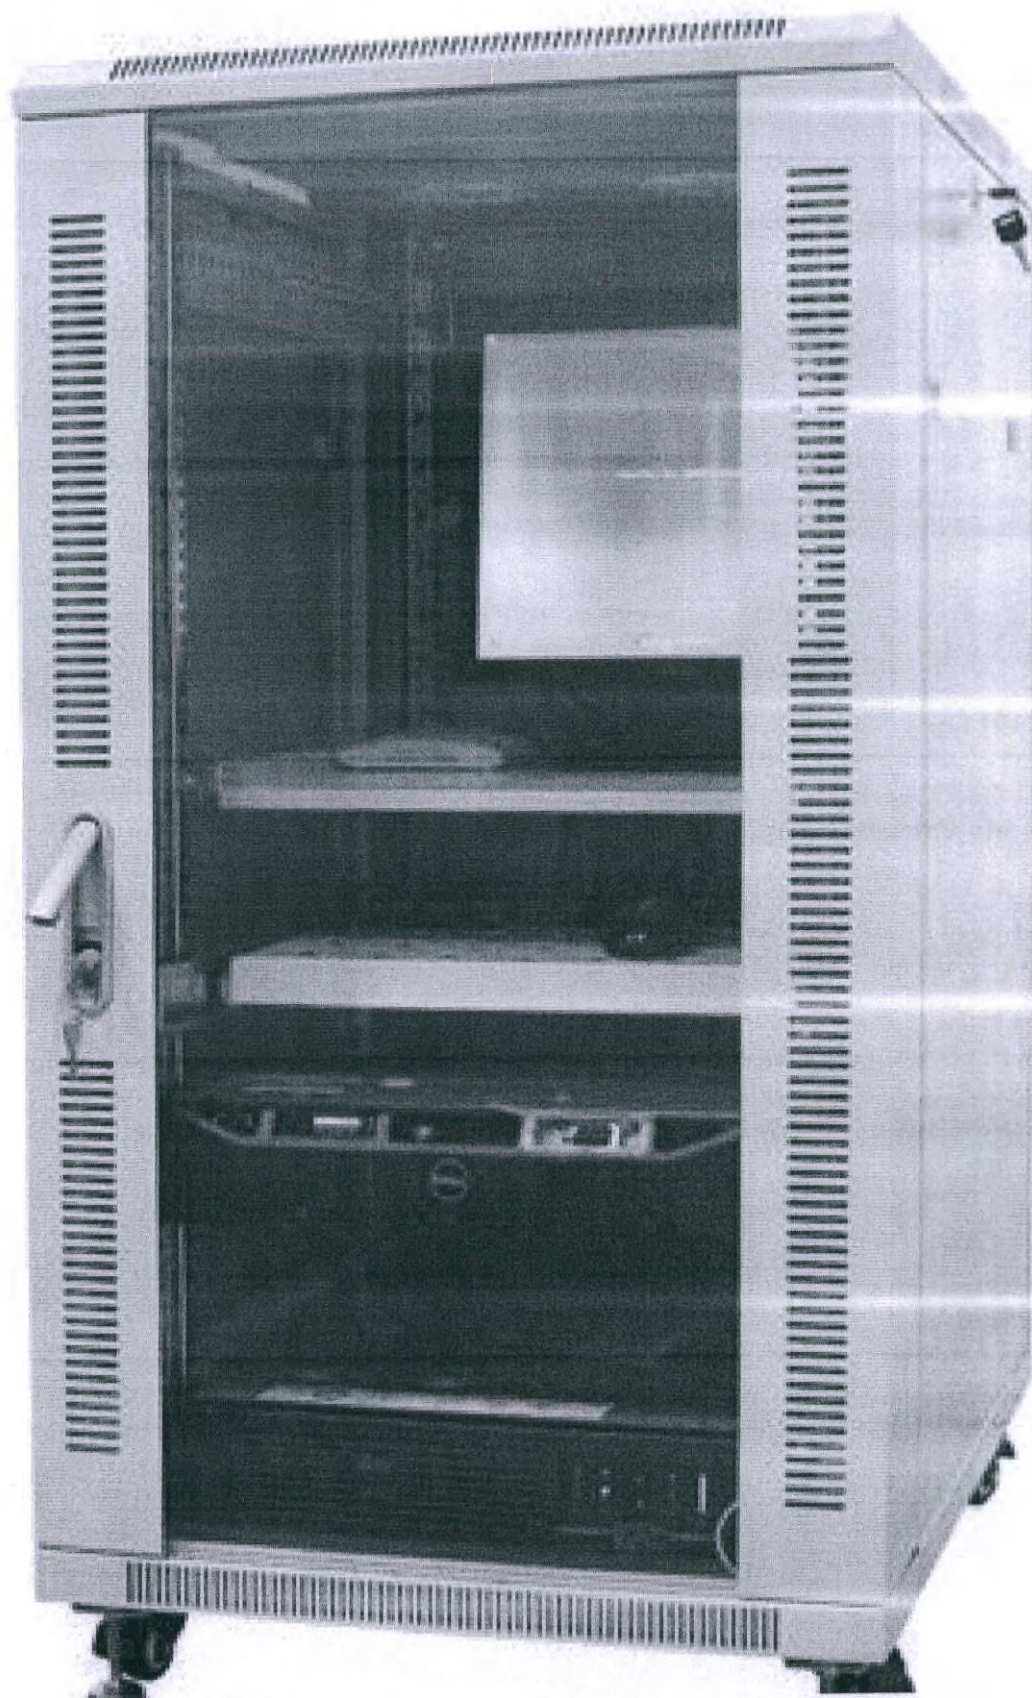


Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»,
производства АО «МТЛ», Россия

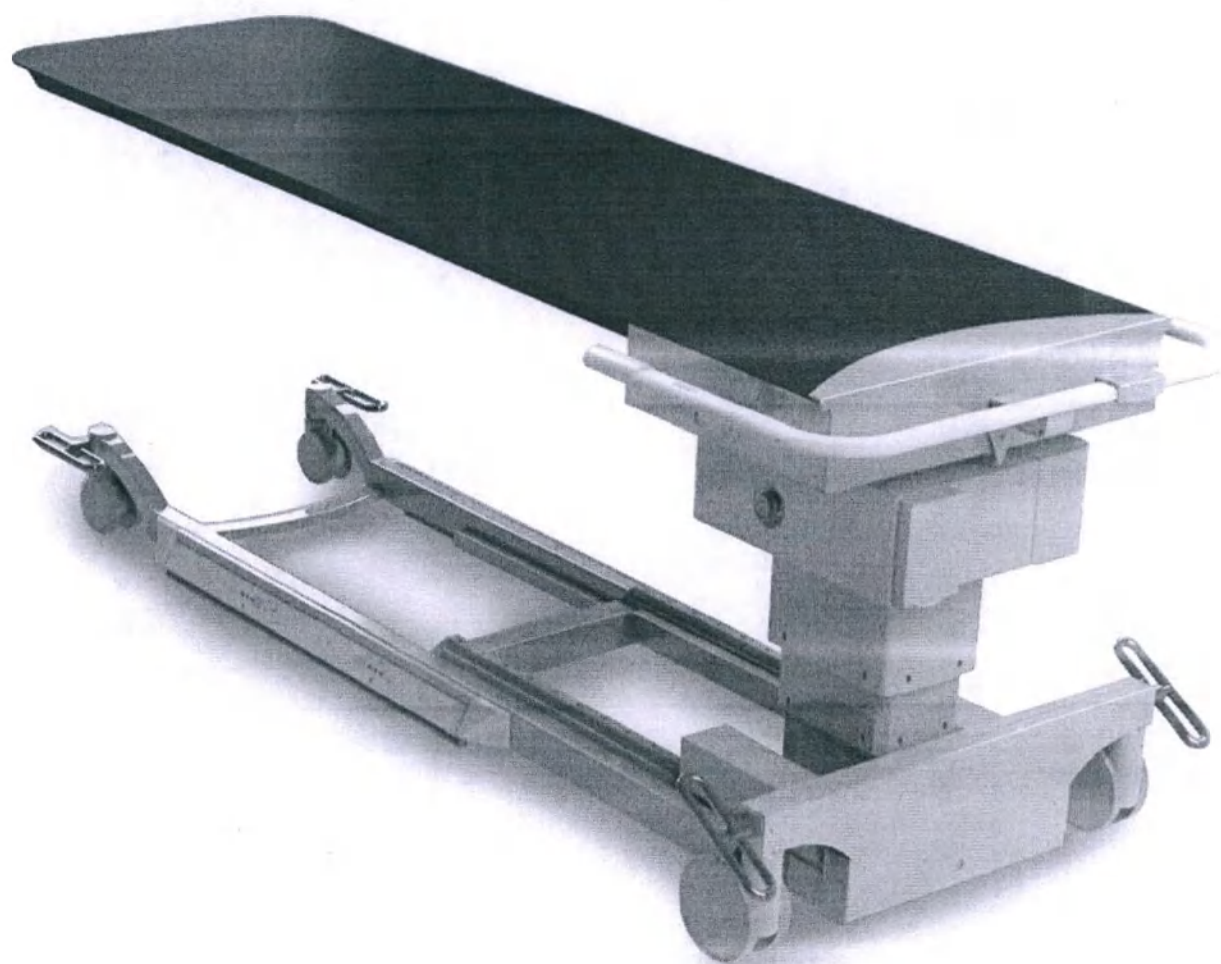


Стол-каталка серии X Mobil, производства ROESYS MedTec GmbH,
Германия

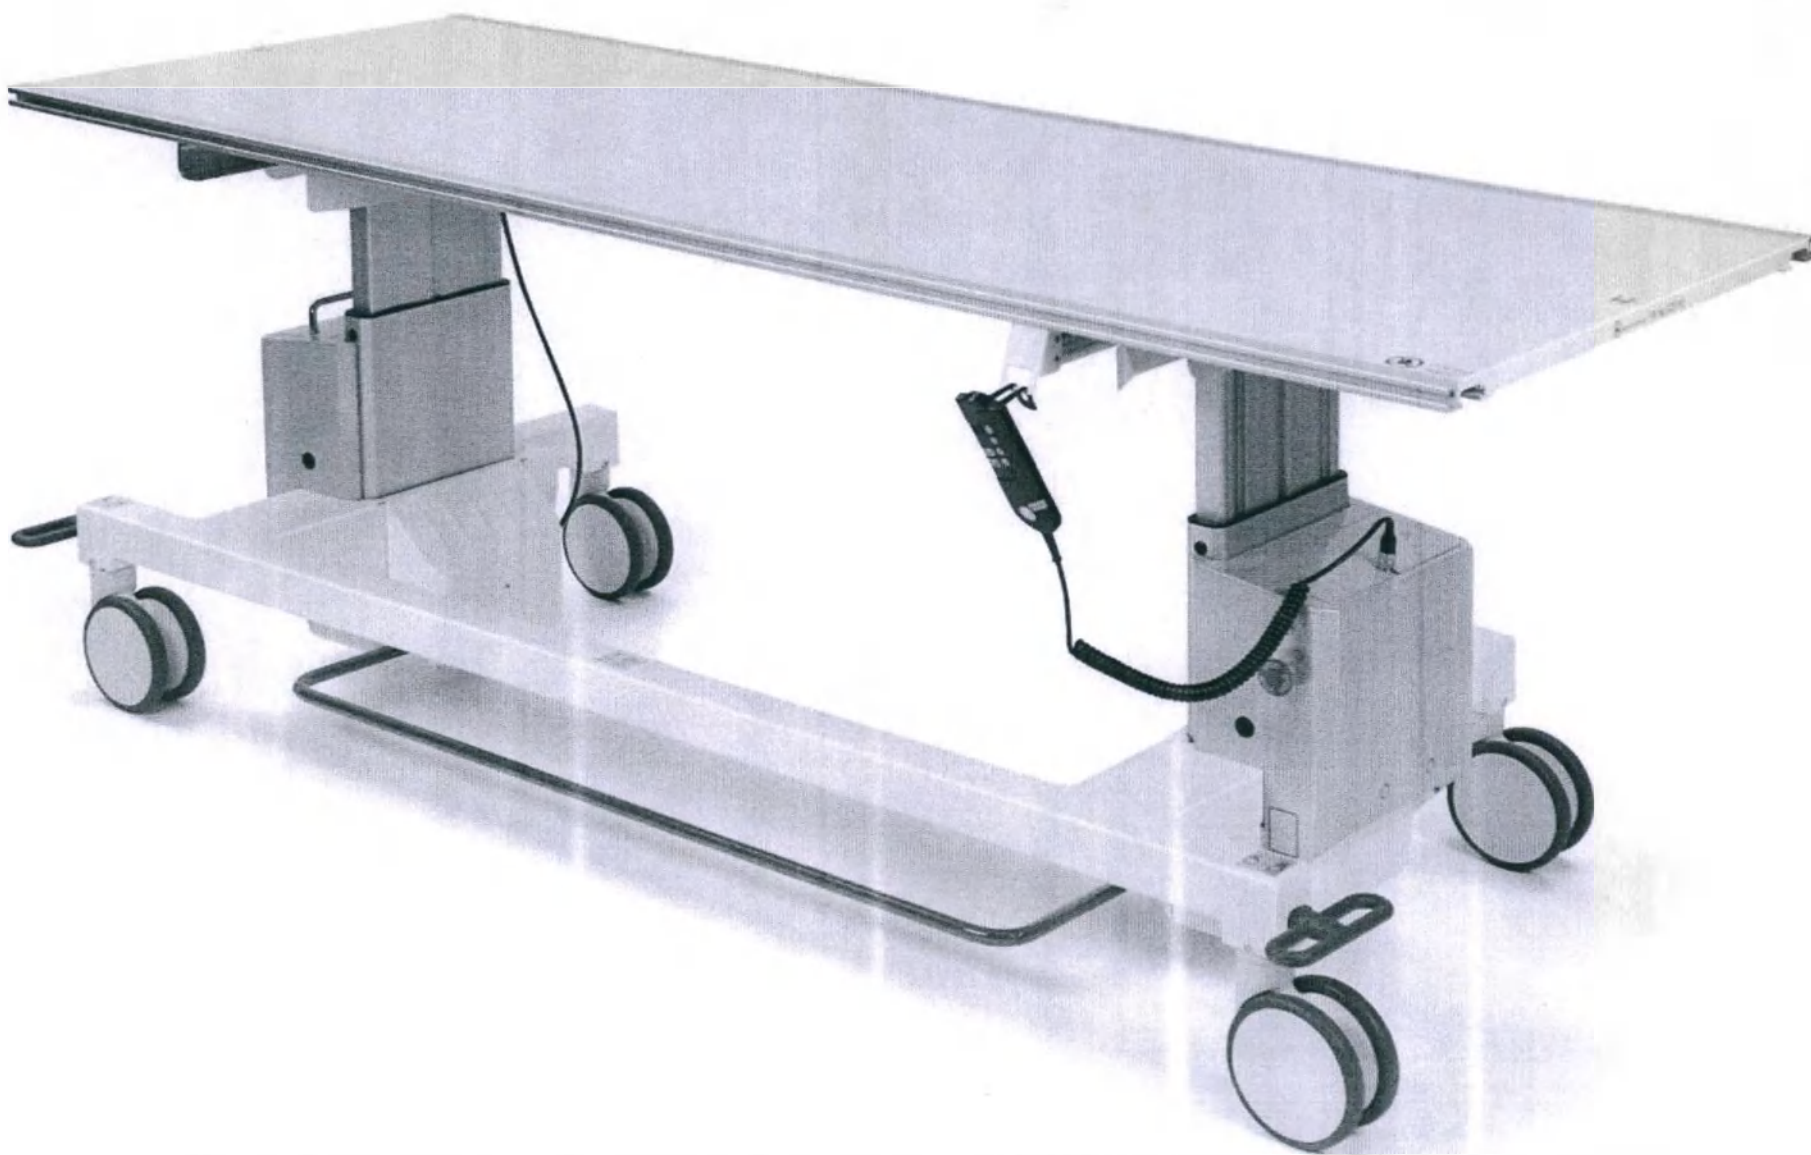


Стол-каталка серии Prognost, производства PROTEC GmbH & Co. KG, Германия

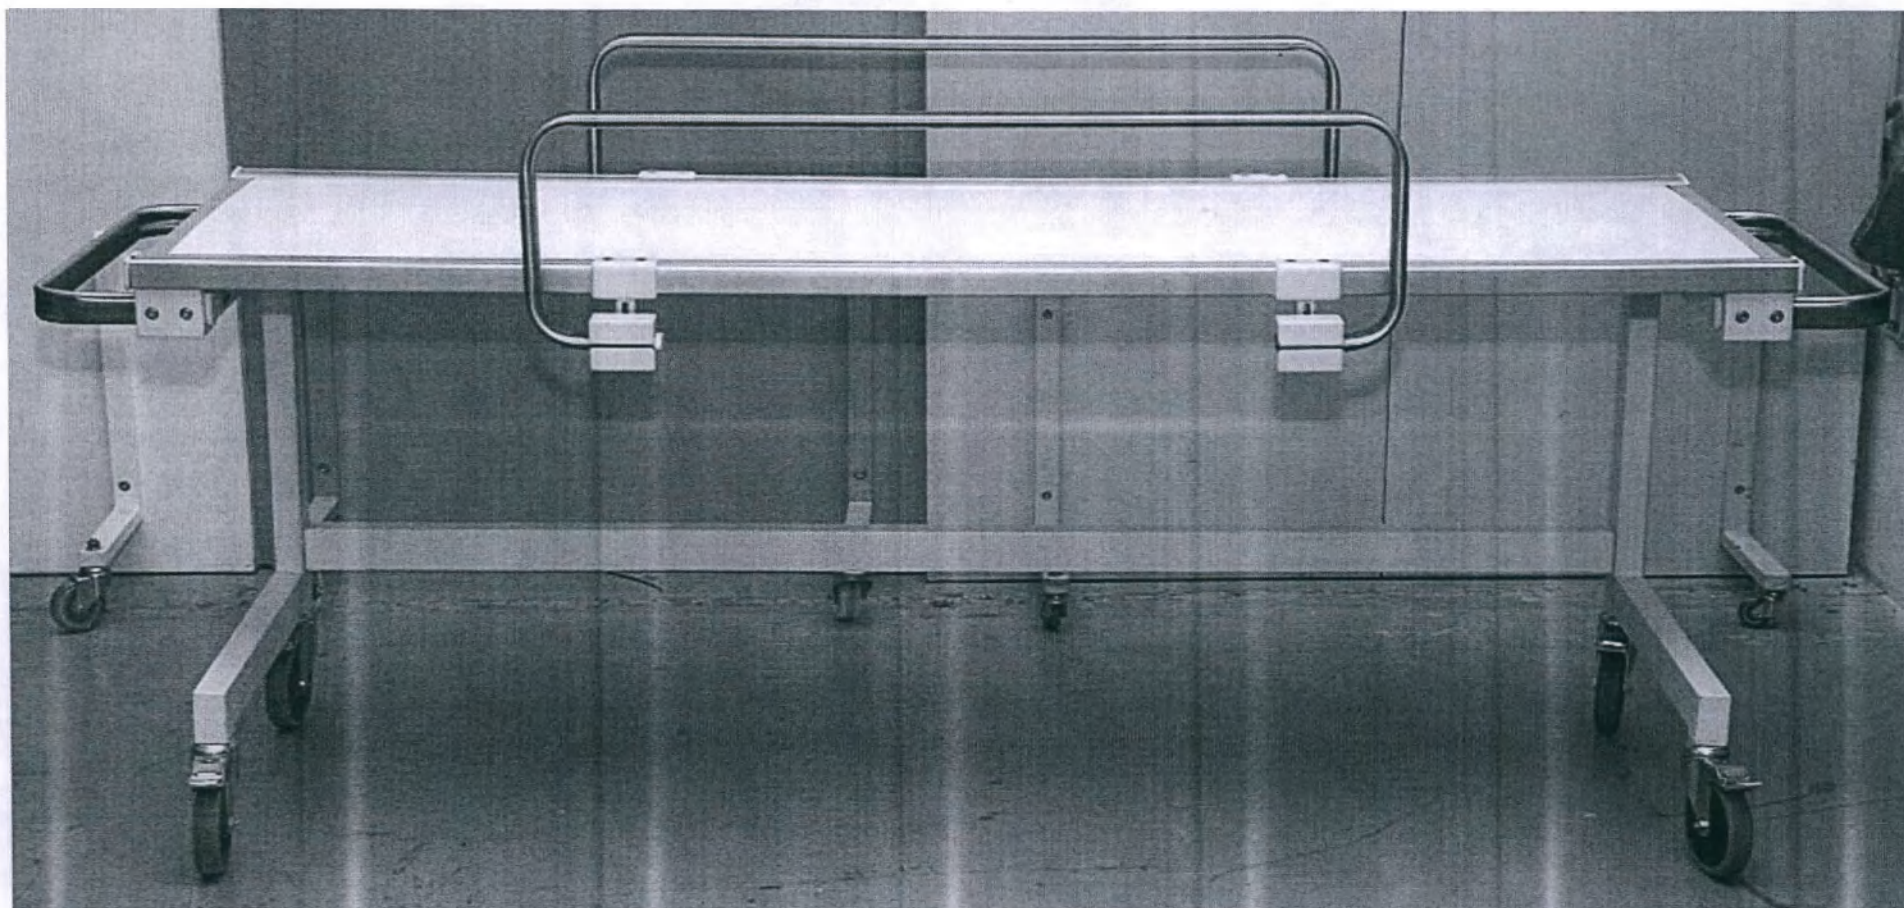

Стол пациента передвижной Y1-B0100, производства ООО «ВКО Медпром»,
Россия

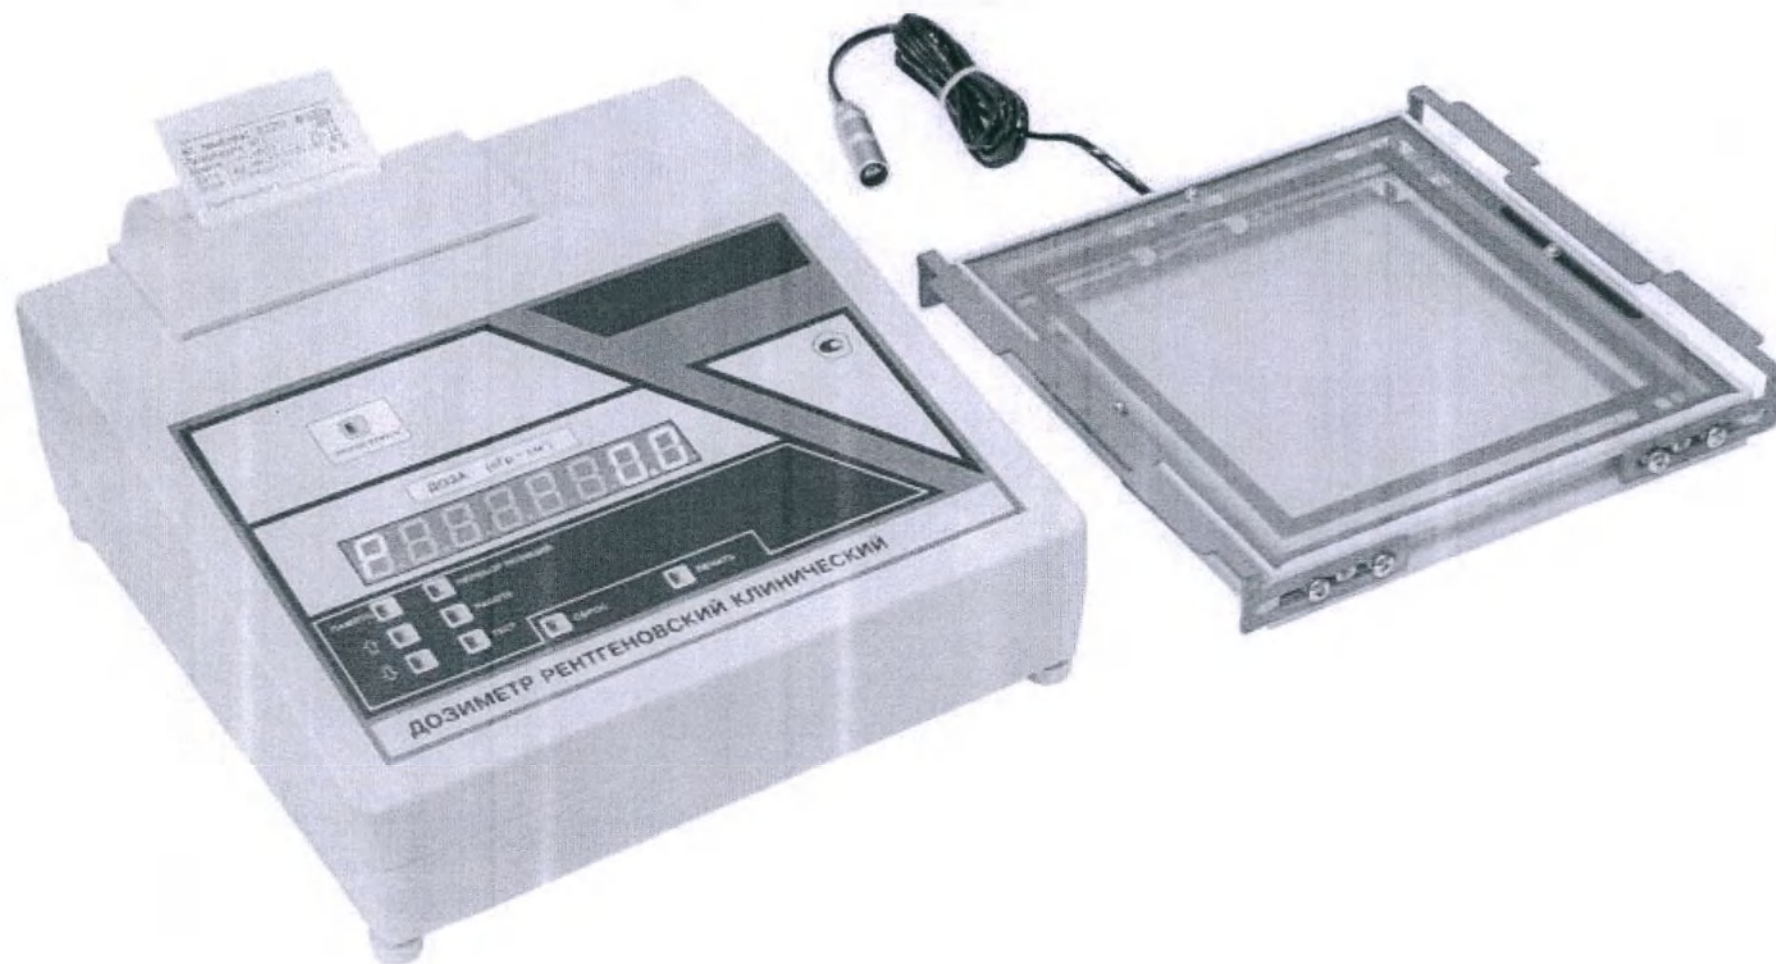

Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства ООО НПП «Доза»,
Россия

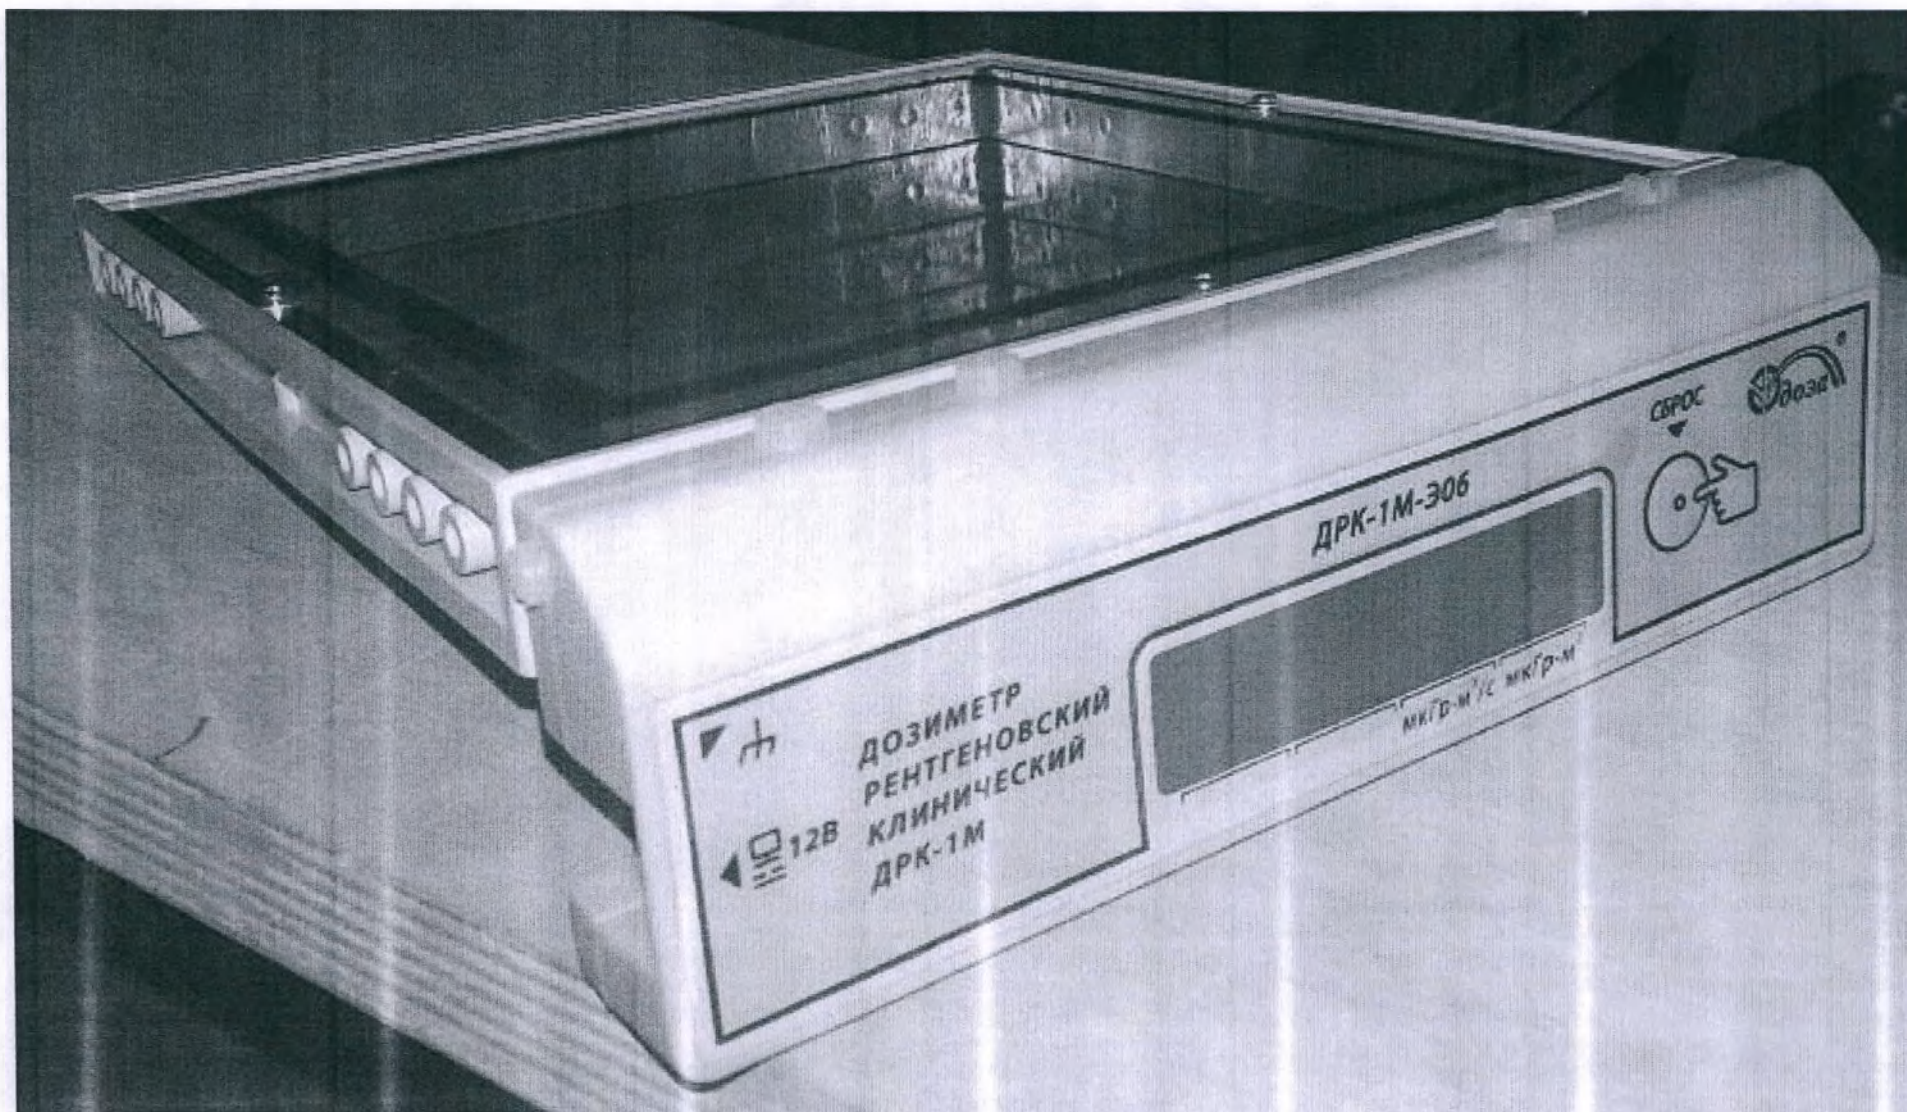


Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза», Россия



Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур,
производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия.




Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010,
производства ИП Давлетов Д.Я., Россия

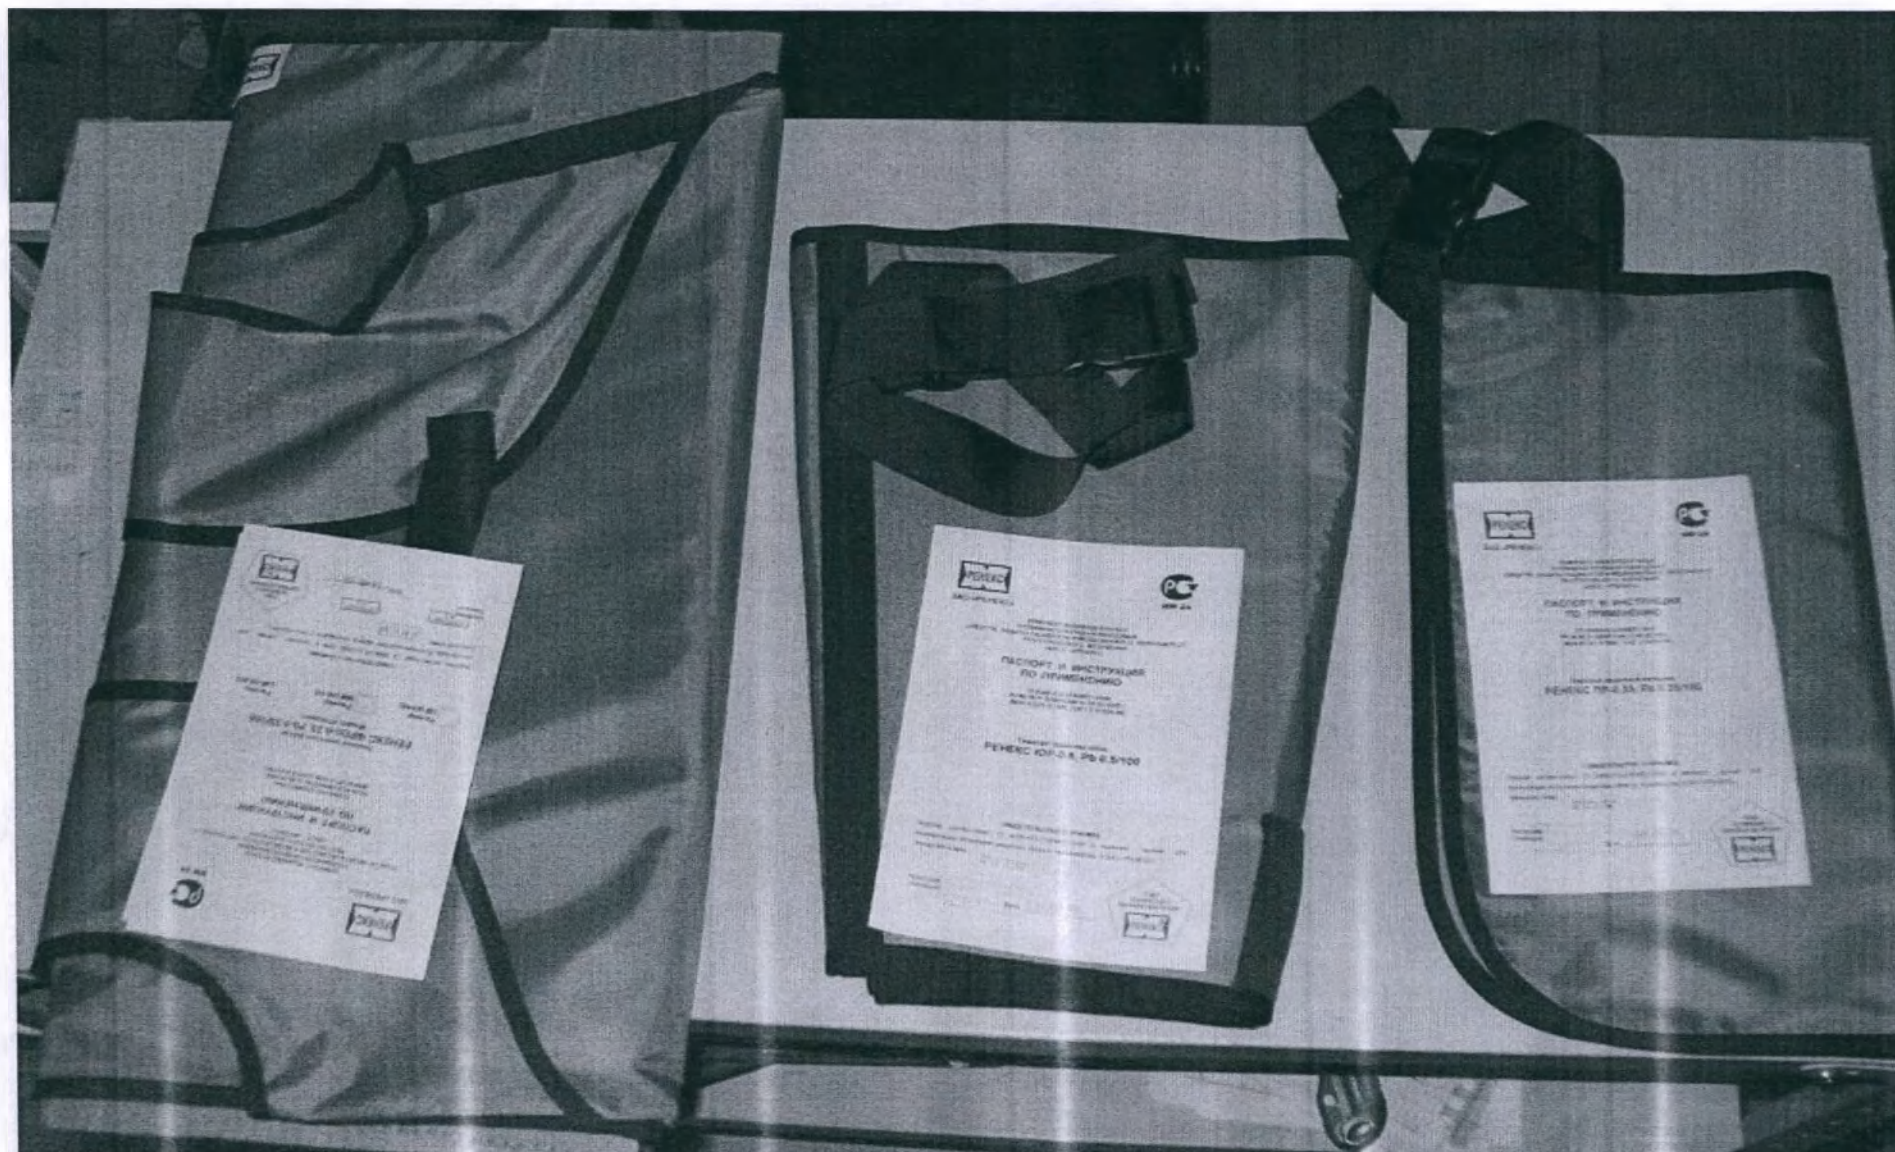

Комплект индивидуальных поливинилхлоридсвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия



Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия

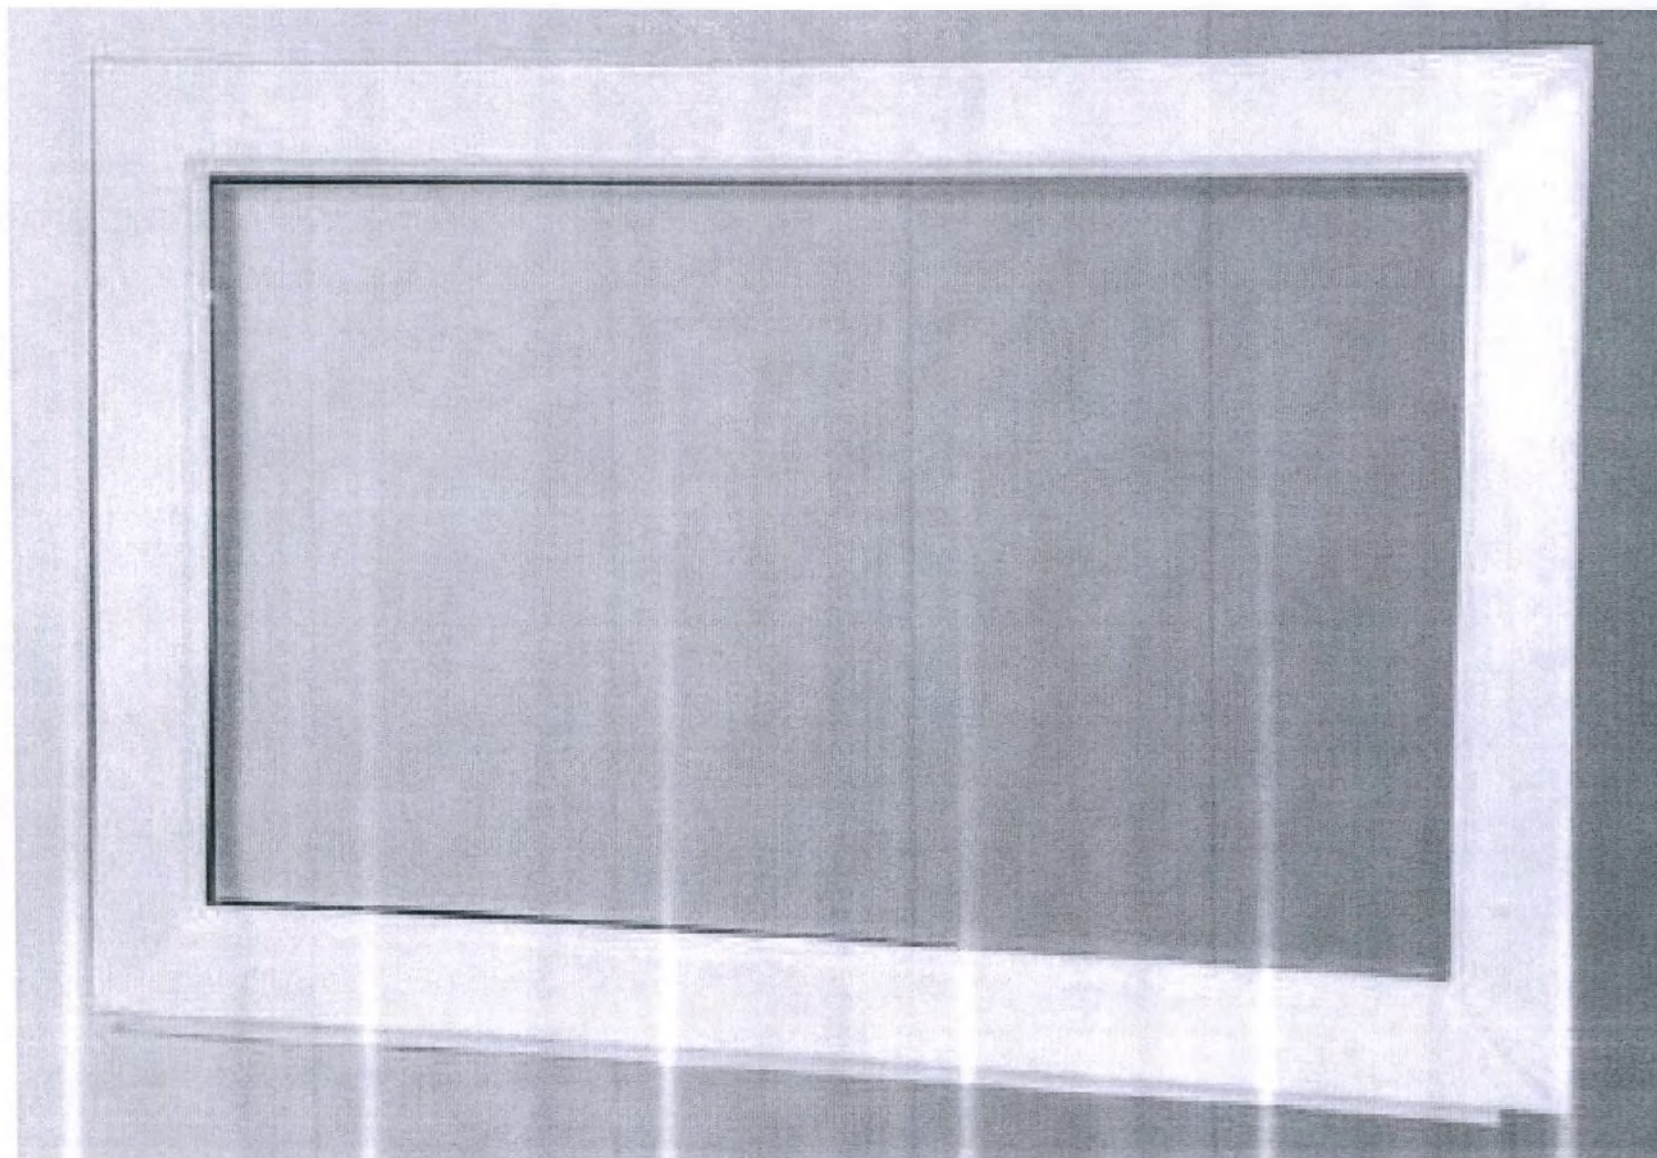

Окно рентгенозащитное размером не менее 1000×500 мм серии MASO, производства Hans O.Mahn & Co. KG, Германия или РЕНЕКС ОСРЗ производства ЗАО «Ренекс», Россия



Стойка мониторная передвижная ОН-С0070, производства ООО «ВКО Медпром», Россия


Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 65

(шестьдесят пять) листах



**Макет маркировки и
упаковки медицинского
изделия Аппарат
рентгеновский
диагностический
телеуправляемый
Р-600 «Полидиагност»**


**ООО
«ВКО Медпром»**



**Аппарат рентгеновский диагностический
телеуправляемый Р-600
«Полидиагност»**


Серийный номер:

Год и месяц упаковывания:

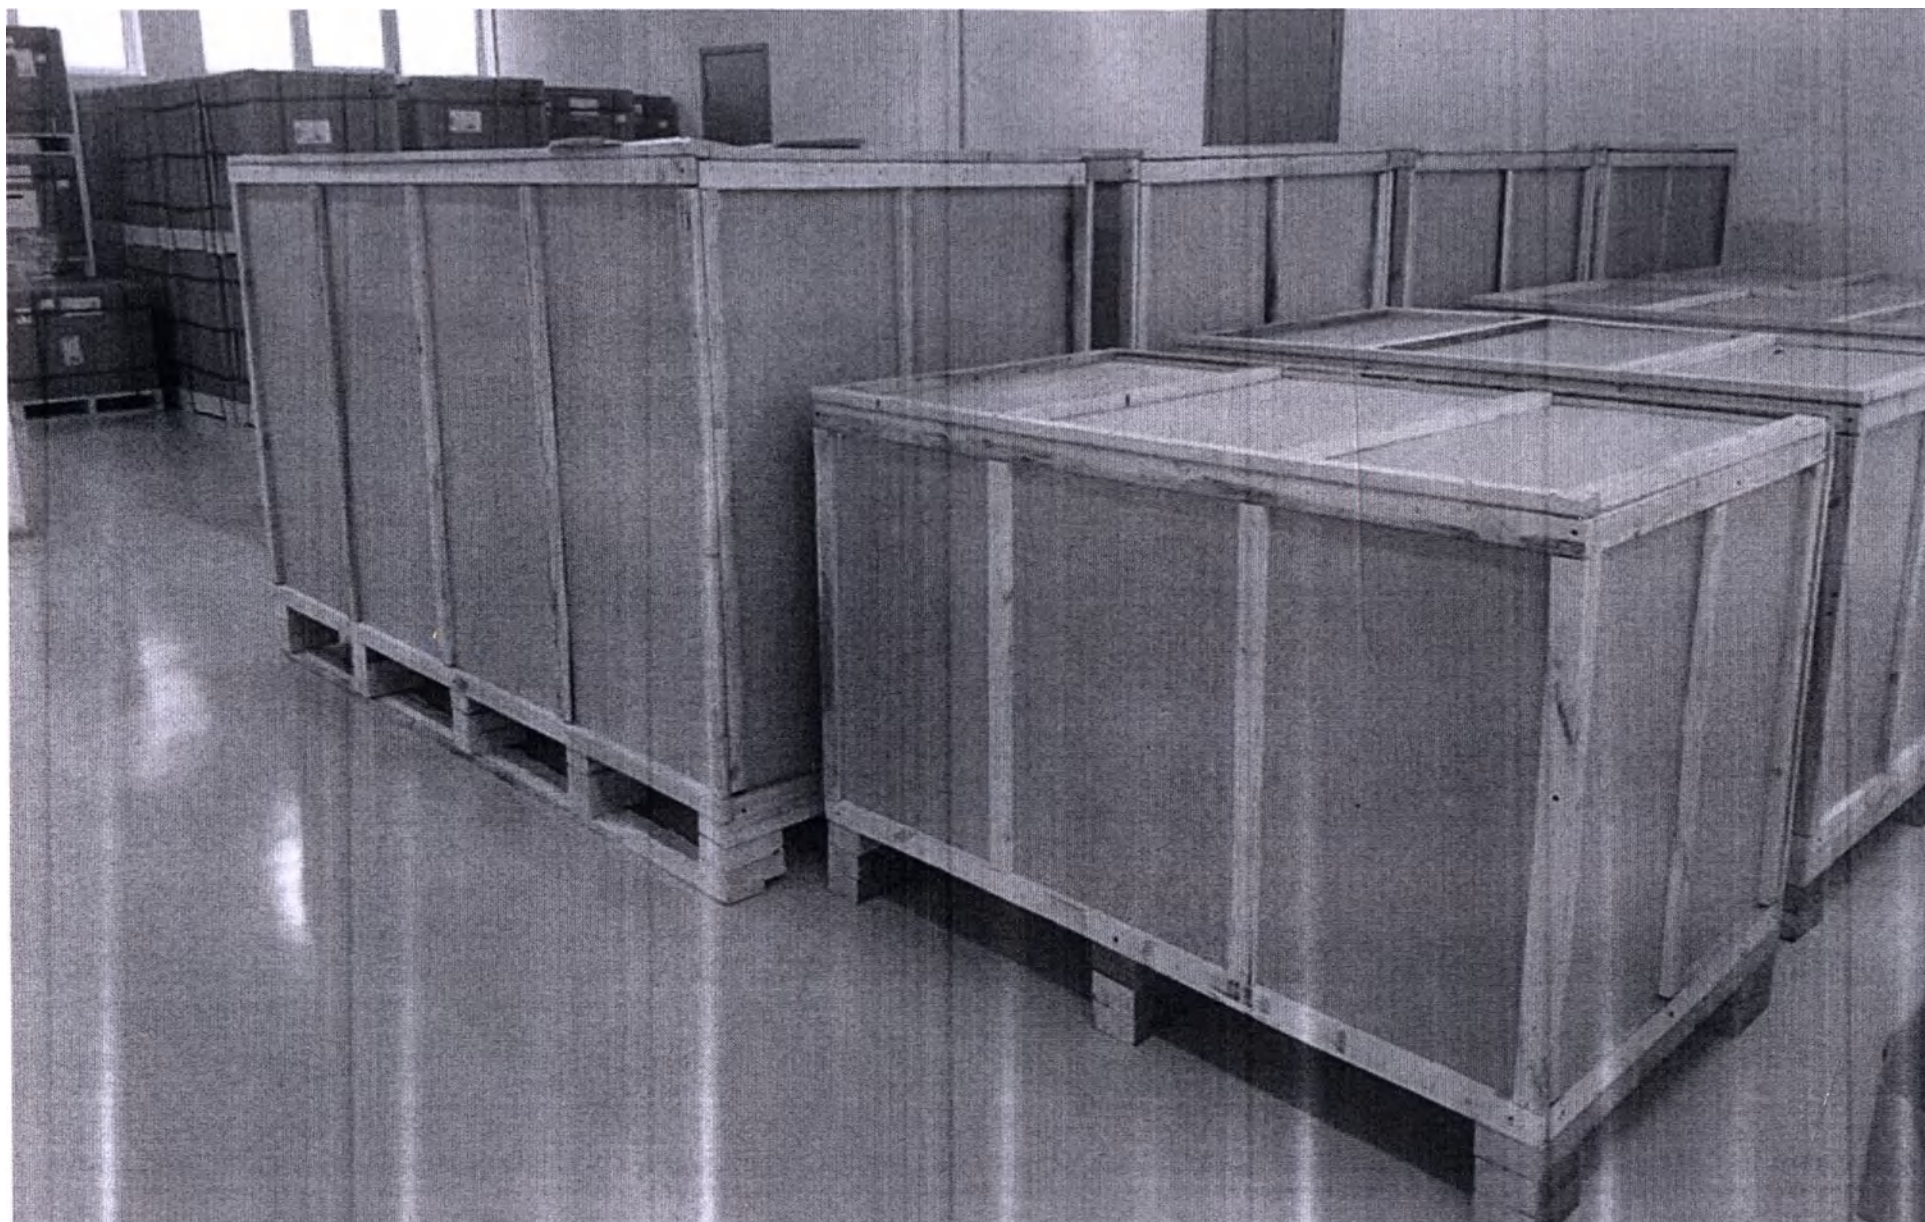

В зависимости от комплектации аппарат может быть упакован от 2 до 6 ящиков. В ящиках 3-6 расположены: АРМ врача, радиологическая информационная система, устройство печати, крепление для детей и другие изделия постовляемые по согласованию с заказчиком. Изделия поставляются в оригинальной упаковке производителей.

Макет маркировки



Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 «Полидиагност»

Обозначение

ТХ-А0000-0Х, исполнение Х

Технические условия

26.60.11-001-67684634-2020

Рег. удостоверение №

РЗН 2021/14657 от ХХ.ХХ.ХХХХ

Серийный номер

Р-ХХ-ХХХ

Дата производства

ХХ.ХХХХ

Производитель

ООО «ВКО Медпром»

EAC



3N~ 380/400 В, 50 Гц, 100 кВ·А



Х – значения указываются при поставке и после получении Регистрационного удостоверения

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

(подпись) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО МедСервис» (подпись) Мещеряков О.В.

