


Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Одноэтапный тест-картридж для определения
сердечного тропонина (сТнI) в цельной крови, сыворотке или плазме»
«ИХА-тропонин I»

Комплект №1, серия 001

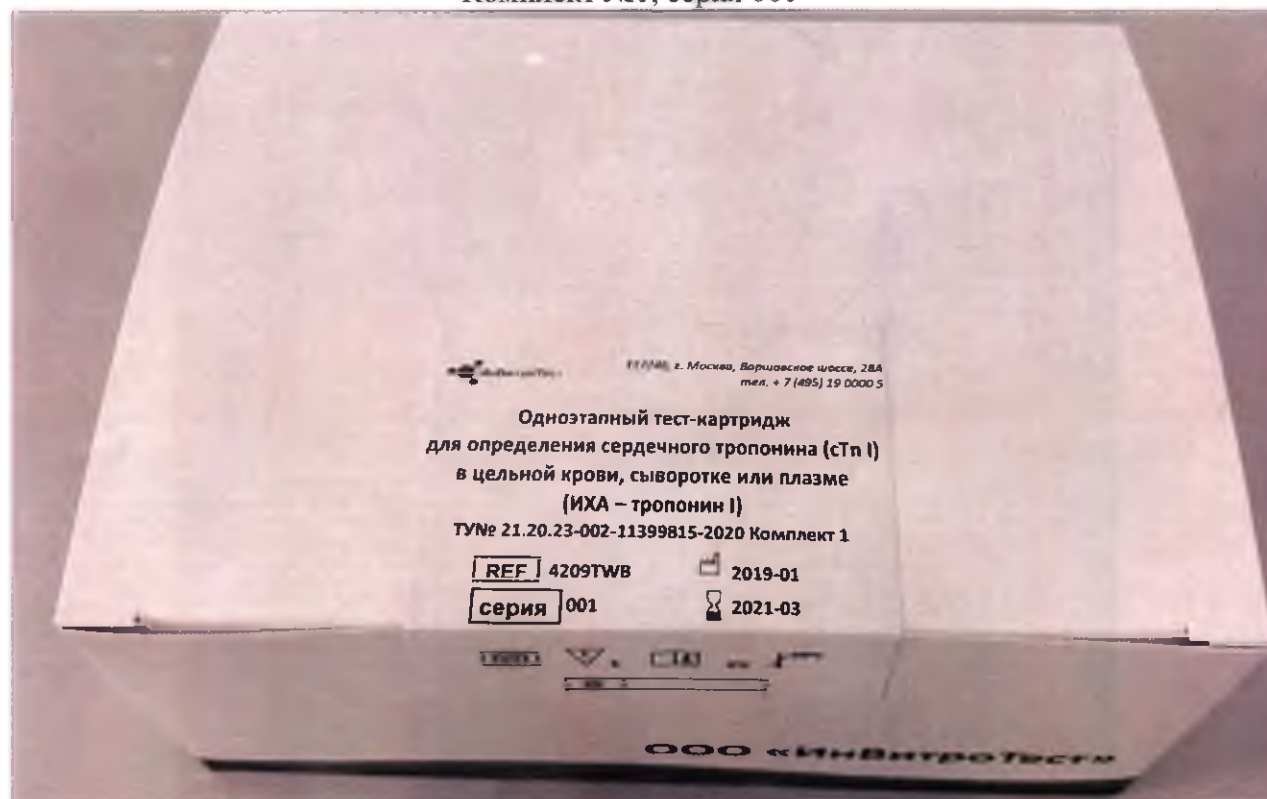

ПАСПОРТ № 001
 Измеритель расхода
 «Специальный термометр для измерения температуры в жидкостях»

ТУ 21.34.23-002 (1996) 15-2039
 Версия №1 (пересмотр)
 Дата вступления в силу 2011

Условия хранения: при температуре от 2 до 30 °С в течение 20 лет. Запрещено хранение в условиях повышенной влажности.


№	Наименование	Описание	Единица измерения	Значение
1	Внешний диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
2	Фланцевый диаметр	Диаметр фланца	мм	16
3	Полный диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
4	Средний диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
5	Средний диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
6	Полный диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
7	Полный диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
8	Полный диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16
9	Полный диаметр	Диаметр в месте установки датчика	мм	16

Комплект №2, серия 003






Комплект №3 Серия 005

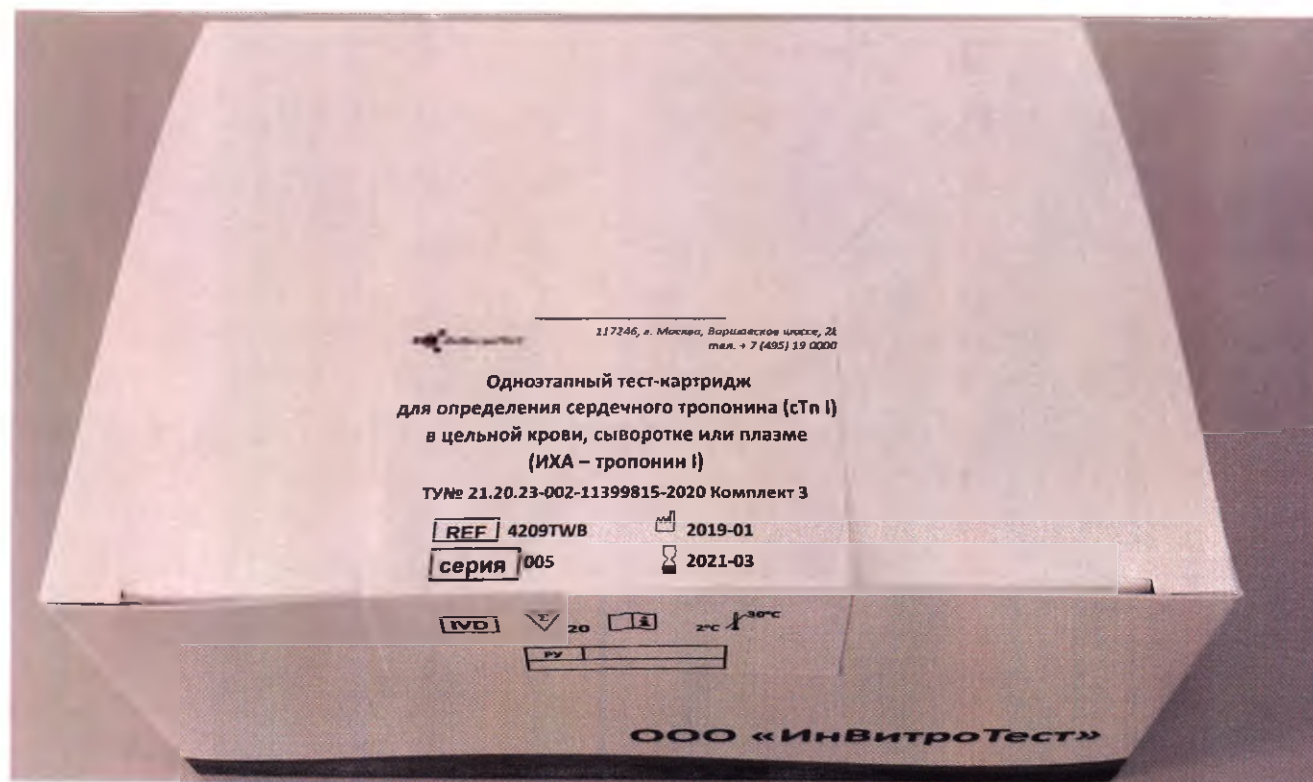



Комплект №4 Серия 007



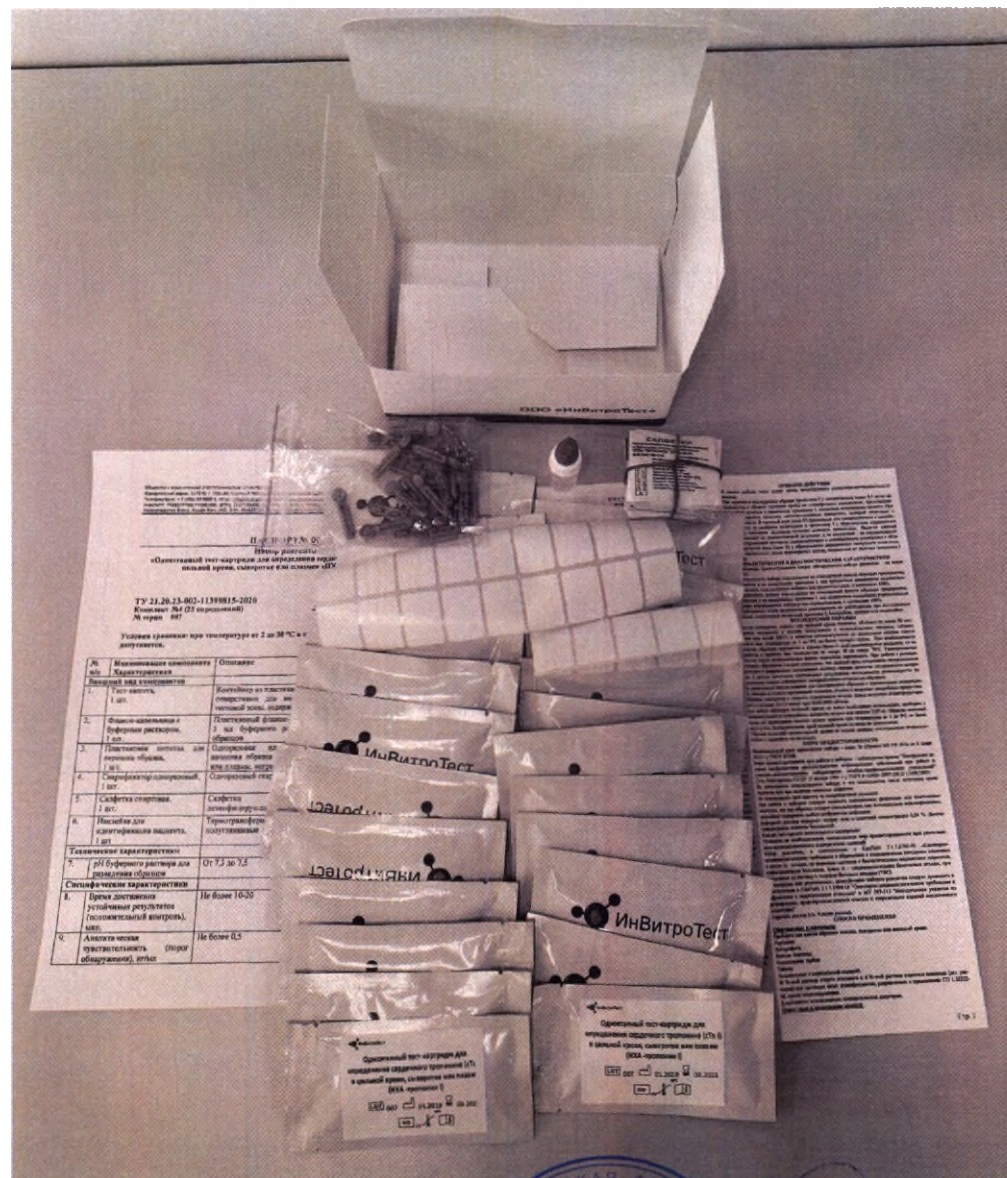

Генеральный директор ООО «ИнВитроТест»

А.И. Киреев



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

8 листов

Генеральный директор
ООО
"ИнВитроТест"
Киреев А.И.

