

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко

«11» апреля 2022 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно»

серия 1, серия 2, серия 3

1. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 1, серия 1
(общий вид)

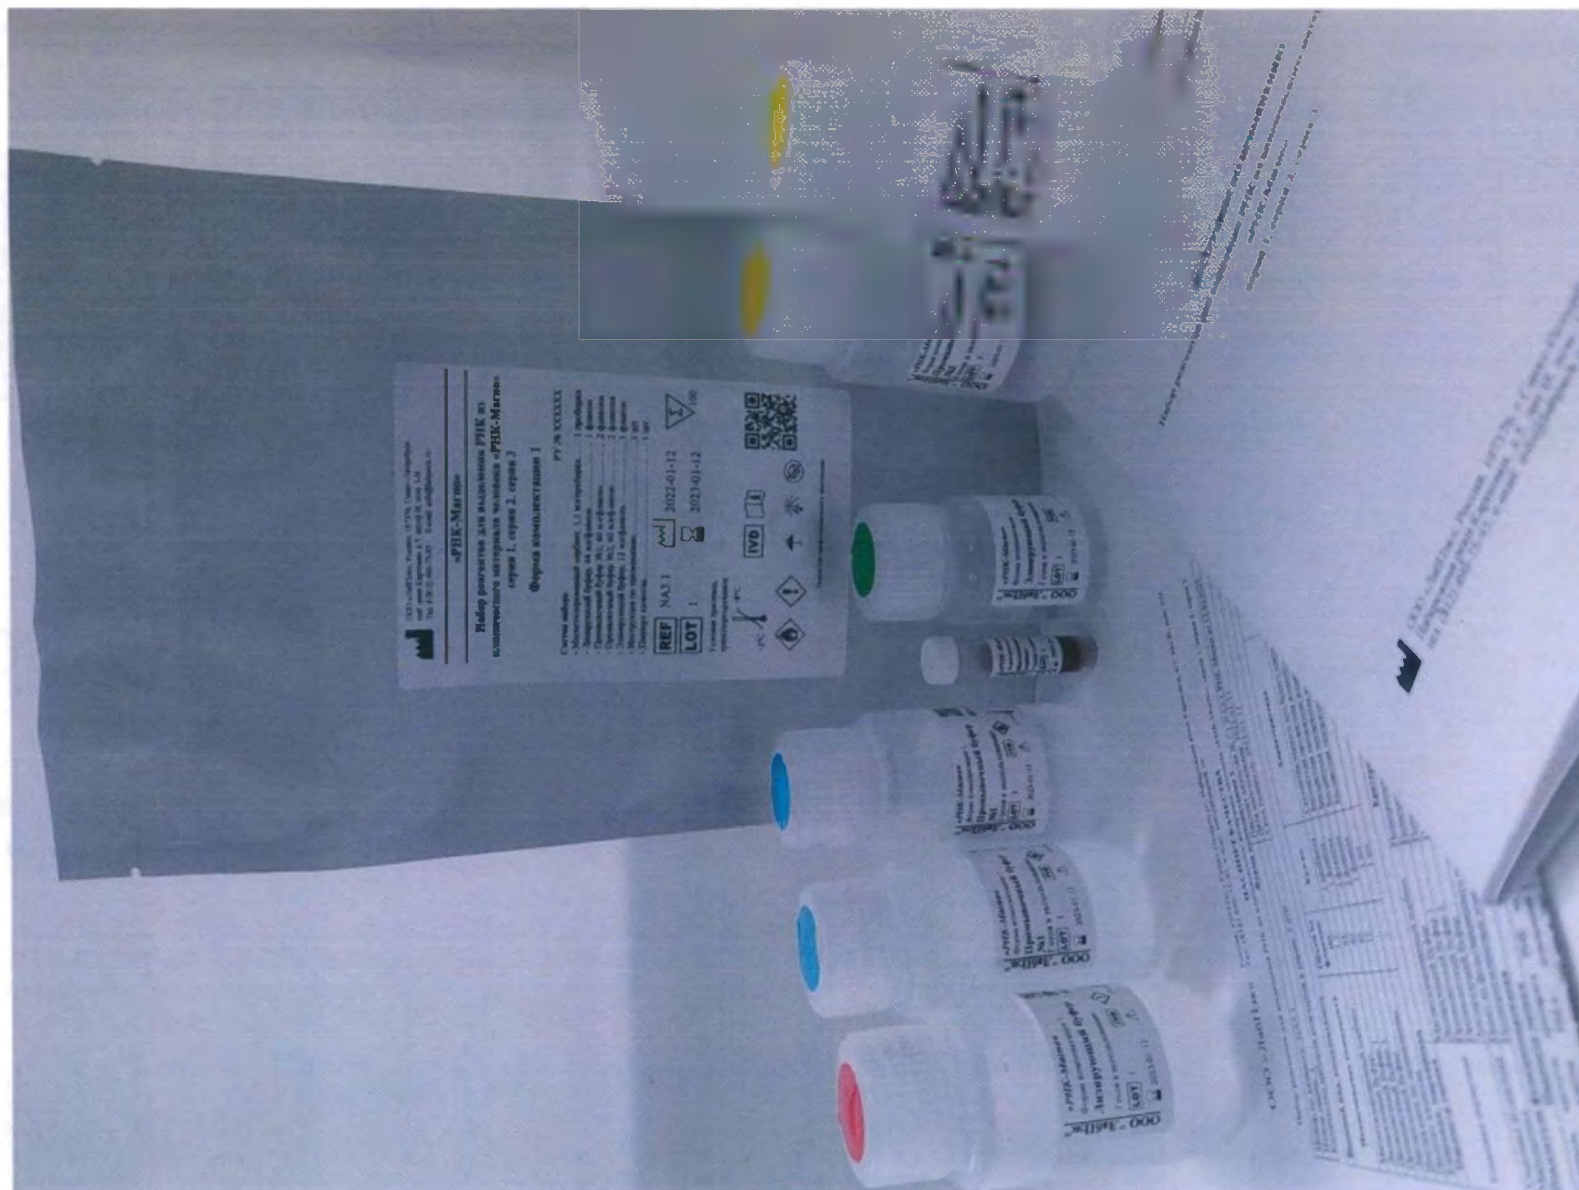



ООО «ЛабПак», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки д.3, литер 4, пом. 3-Н
Тел: 8 (812) 490-73-93 E-mail: info@labpak.ru

«РНК-Магнот»

Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магнот»
серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 1

РУ № XXXXXX

Состав набора:

- Магнетизирующая сорбент, 1,1 мл/флакон..... 1 флакон
- Лизерующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер №1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер №2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению..... 1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF NA3.1



2022-01-12




LOT 1



2023-01-12

100

Условия хранения,
транспортирования:




IVD





Только для профессионального применения



1.1. Магнетизированный сорбент

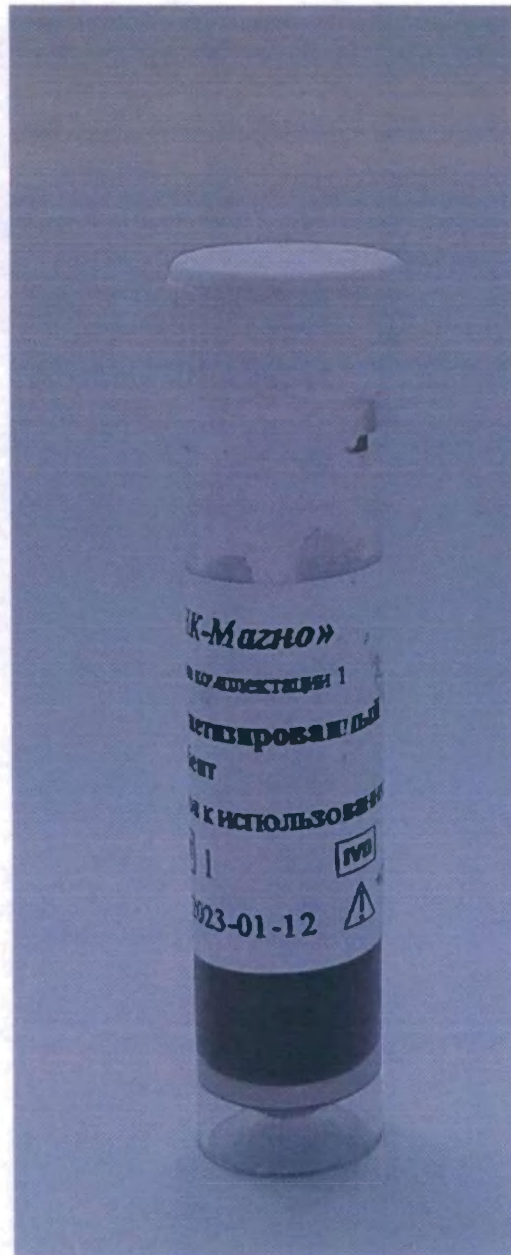


1.2. Лизирующий буфер

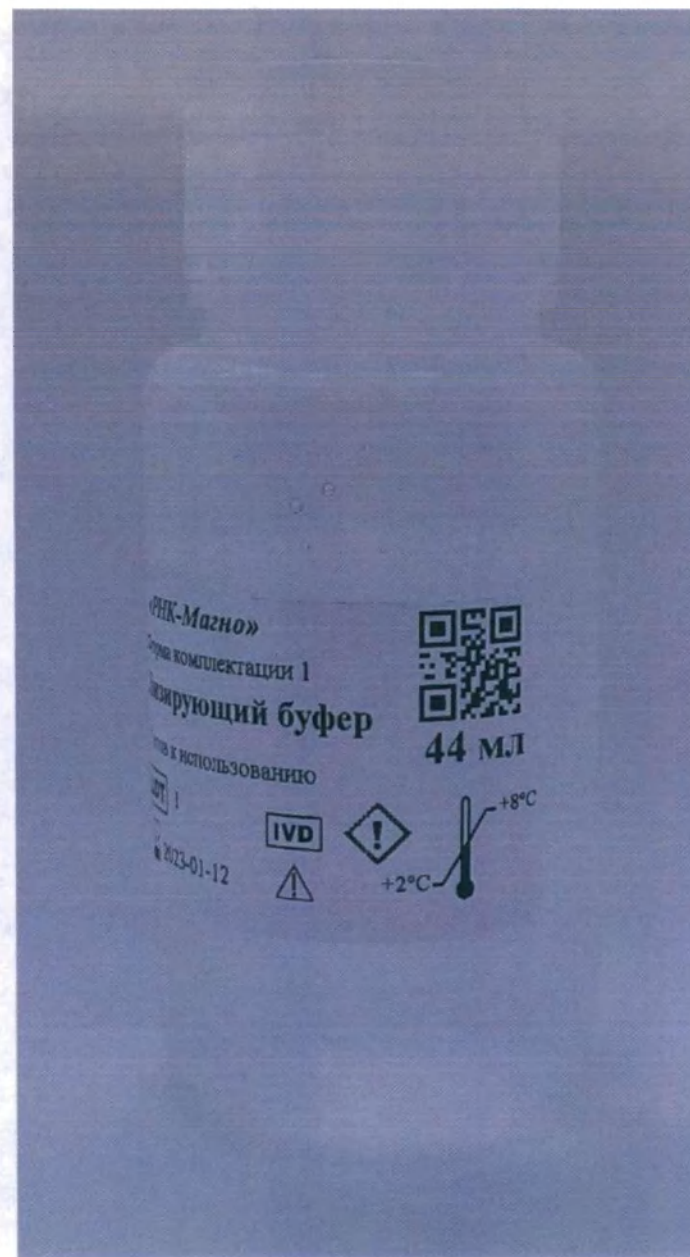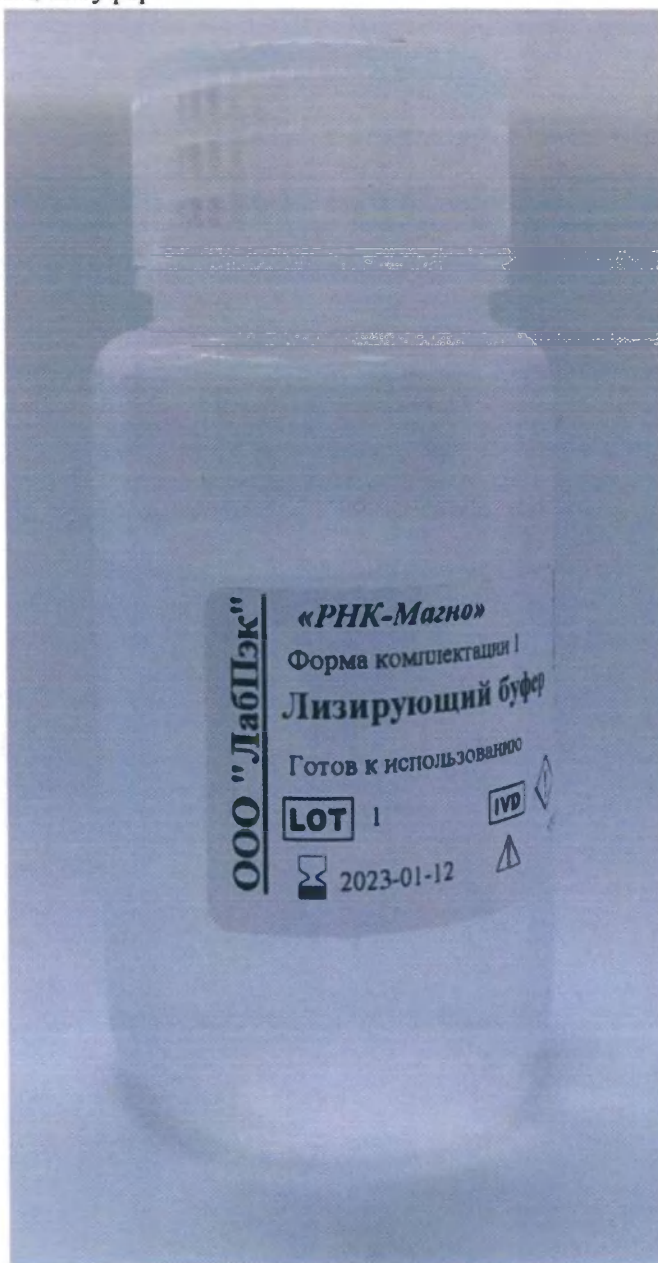



1.3. Промывочный буфер 1

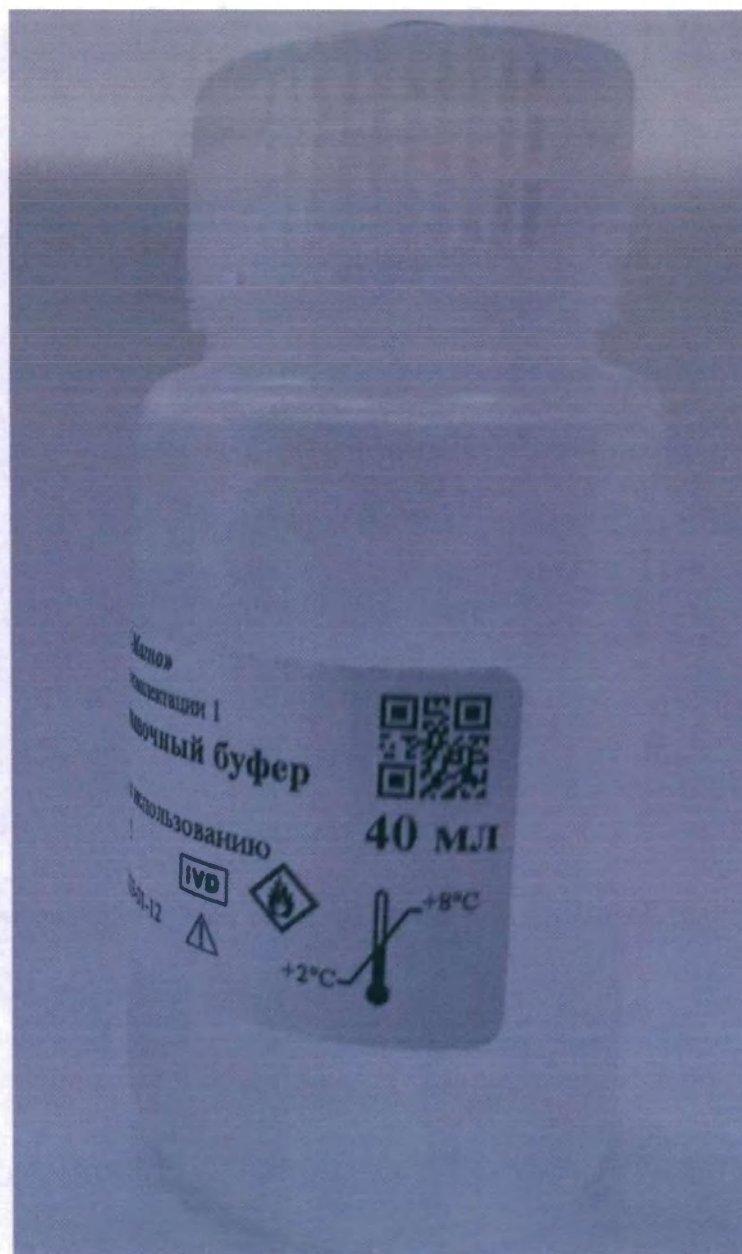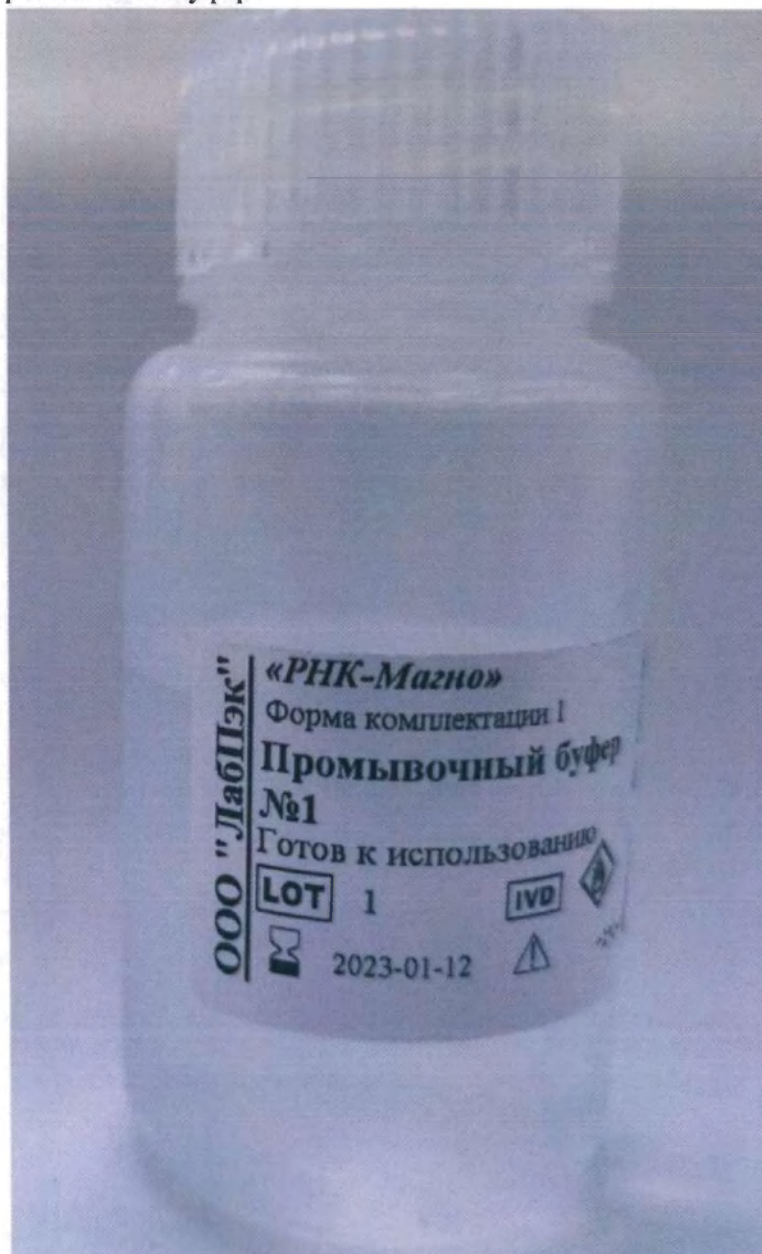


1.4. Промывочный буфер 2

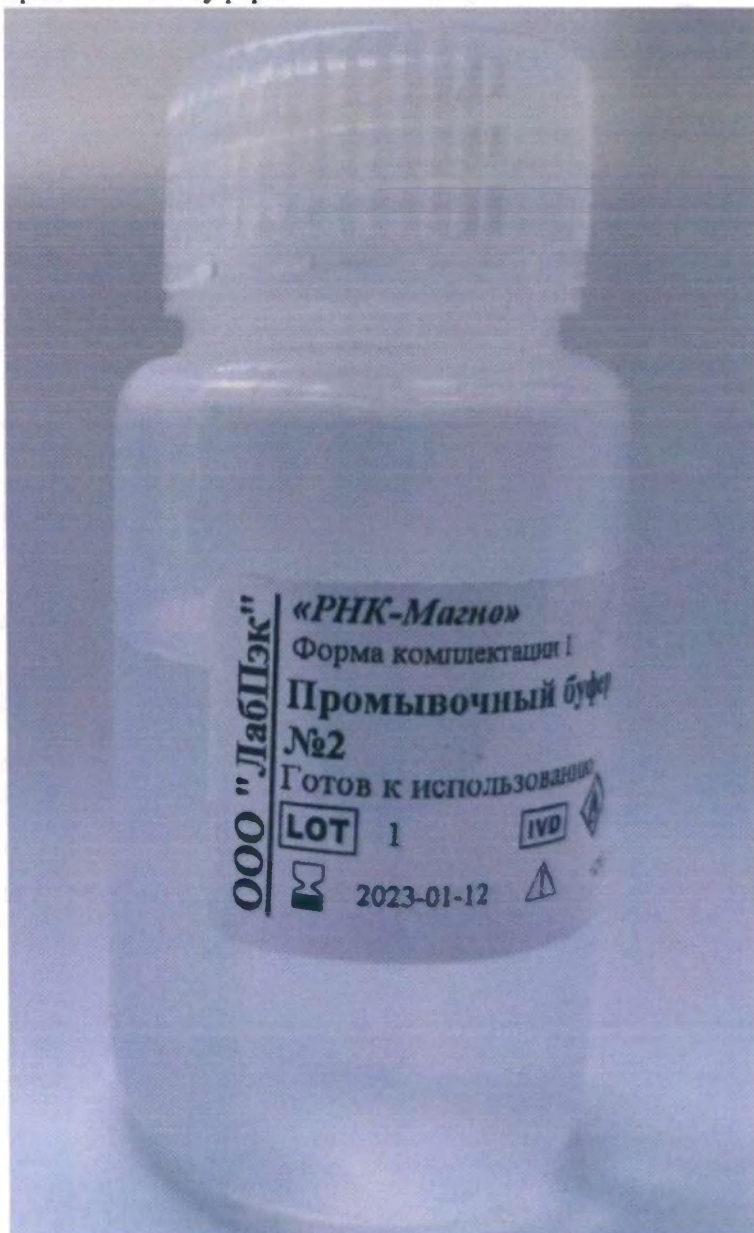

1.5. Элюирующий буфер

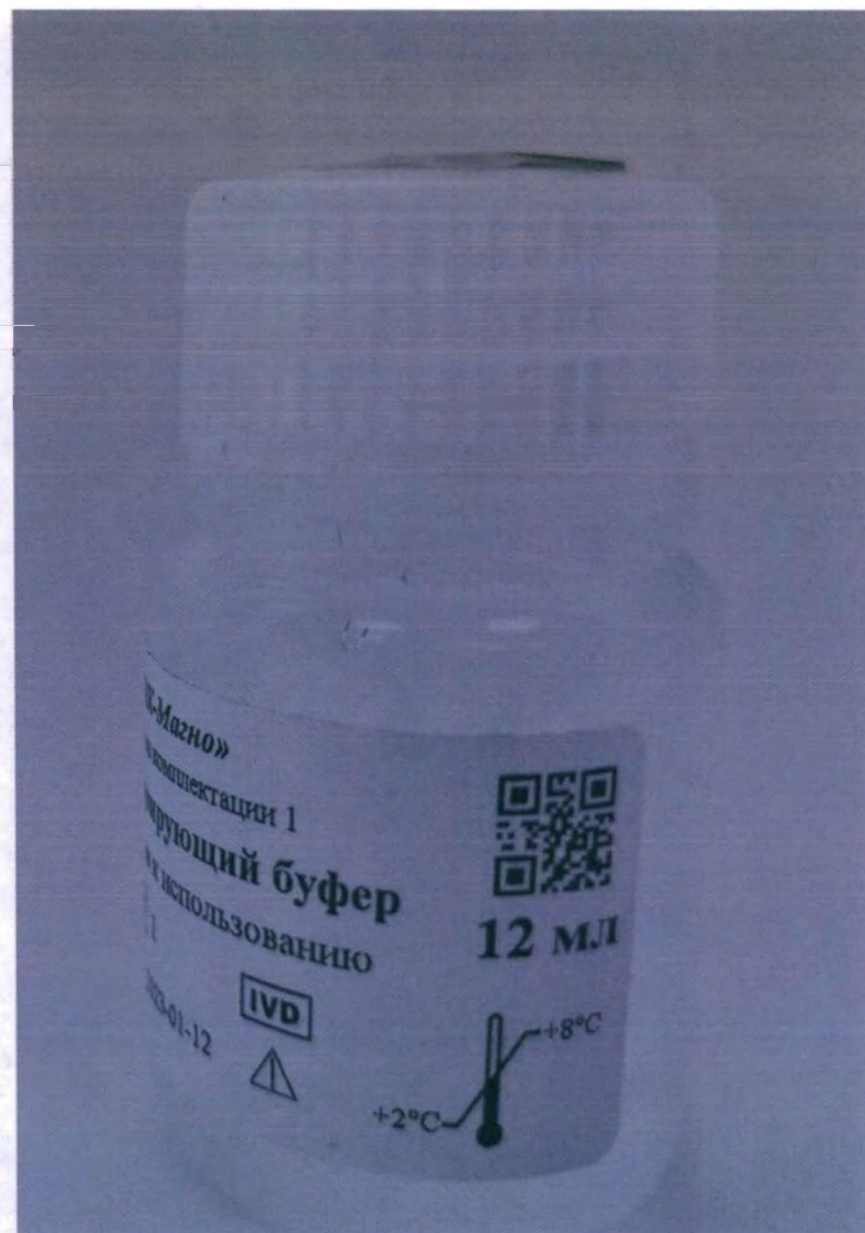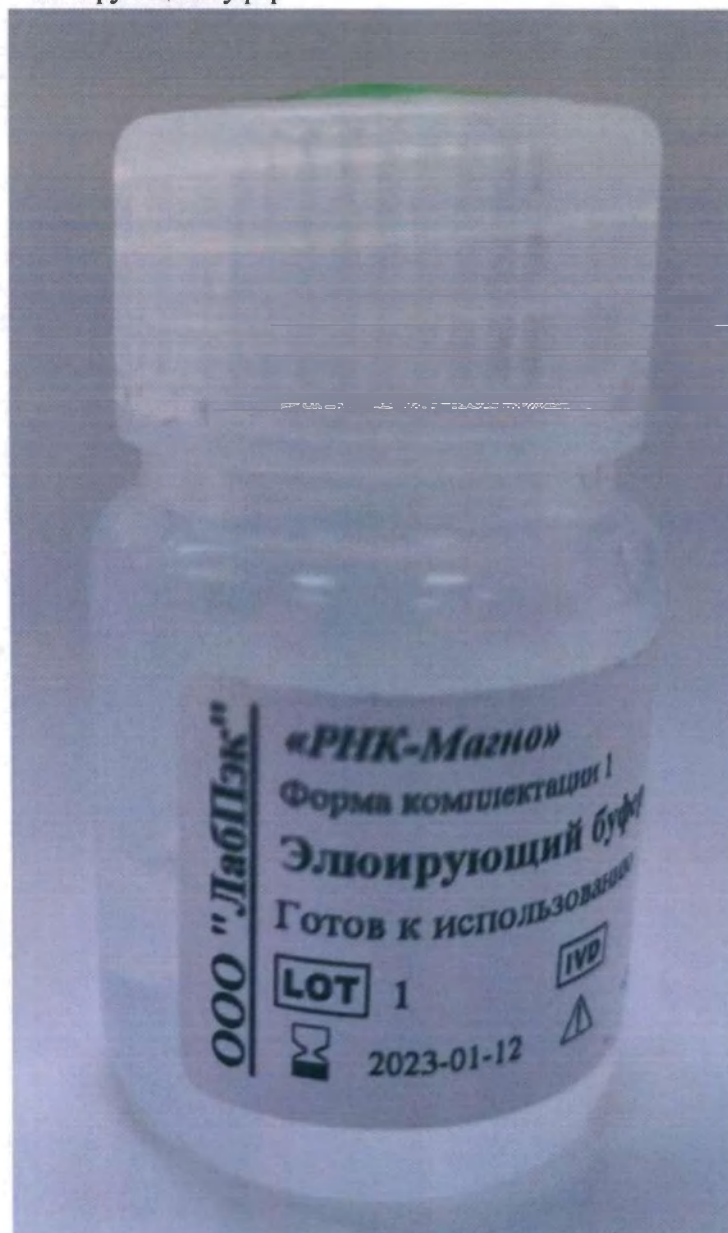

2. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 2, серия 1 (общий вид)

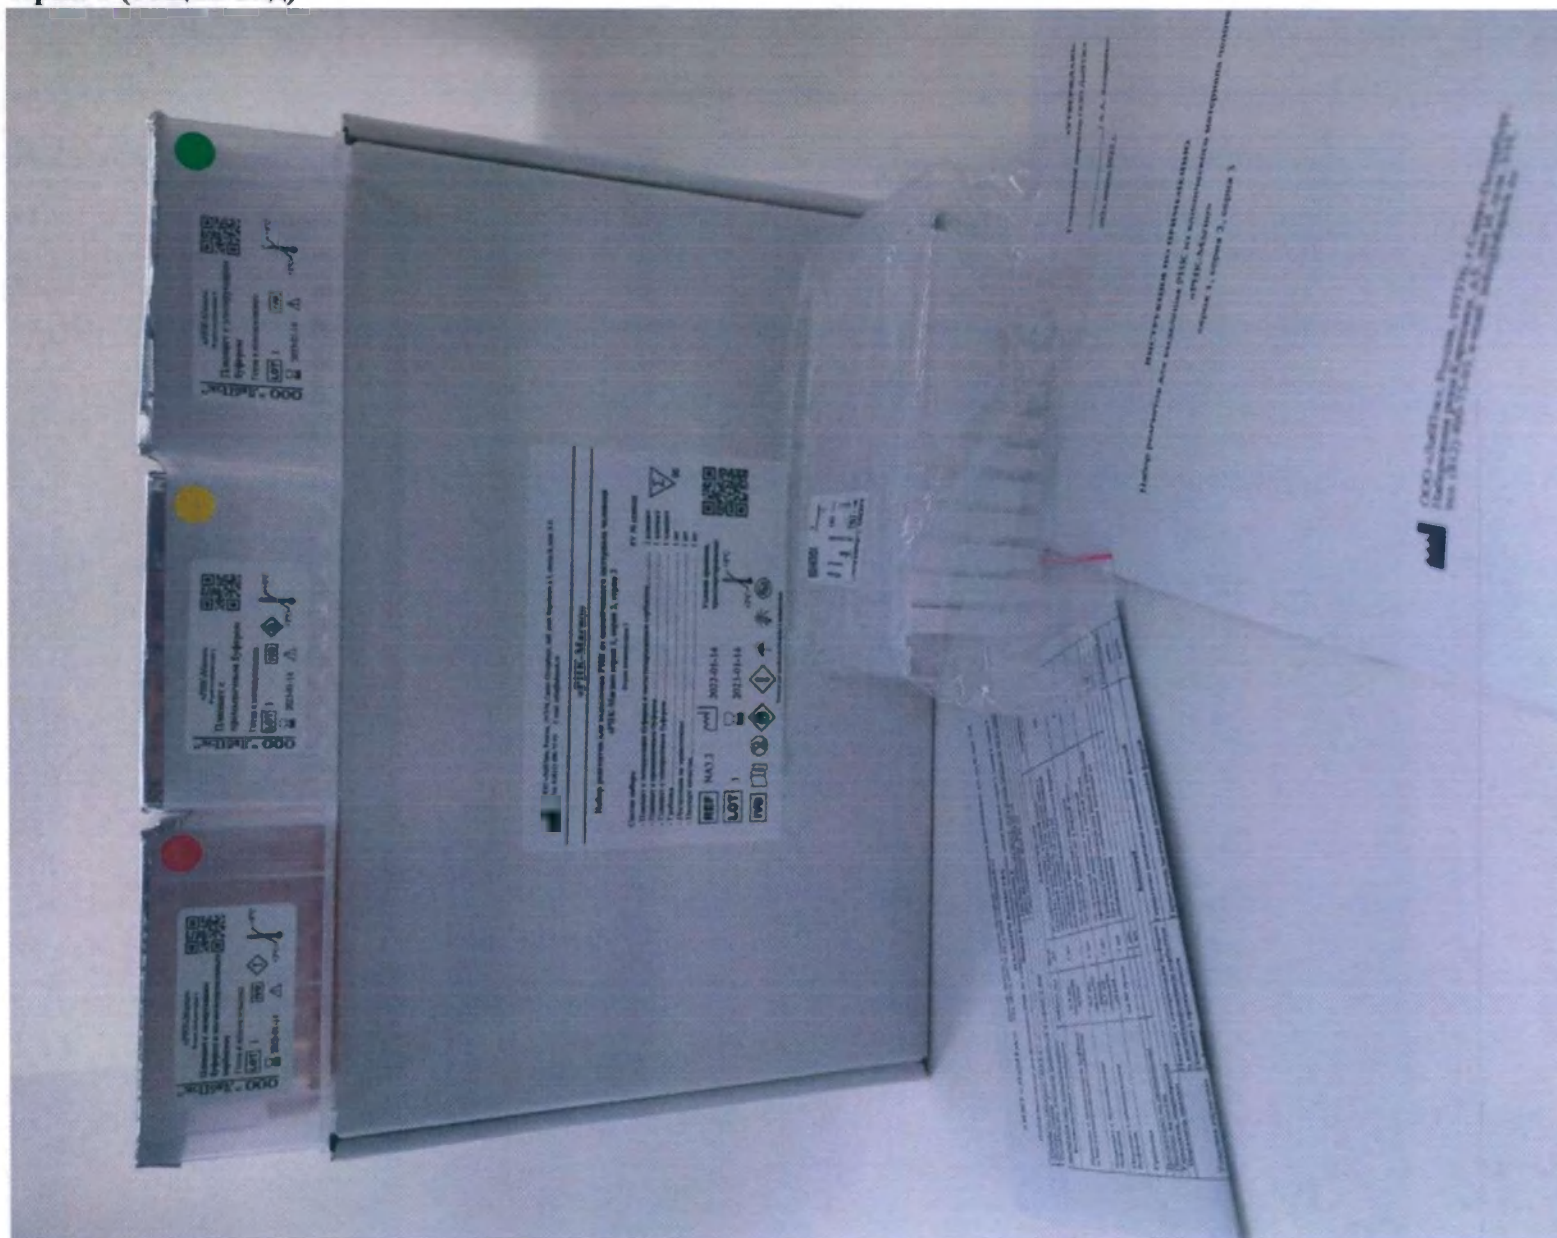



ООО «Лейбл», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, этаж 3-й
Тел. 8 (812) 498-75-93 E-mail: info@leibol.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Формат упаковки 2

РУ № XXXXXX

Состав набора:

- | | |
|--|-----------|
| - Планшет с дисперсионным буфером и магнитосорбентом | 1 планшет |
| - Планшет с промывочным буфером | 1 планшет |
| - Планшет с элюирующим буфером | 1 планшет |
| - Пробирки | 1 шт |
| - Инструкция по применению | 1 шт |
| - Паспорт качества | 1 шт |



REF NA3.2



2022-01-14

Условия хранения,
транспортировки:

LOT 1



2023-01-14

+8°C
+2°C

IVD



Только для профессионального применения






2.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



2.2. Планшет с промывочным буфером

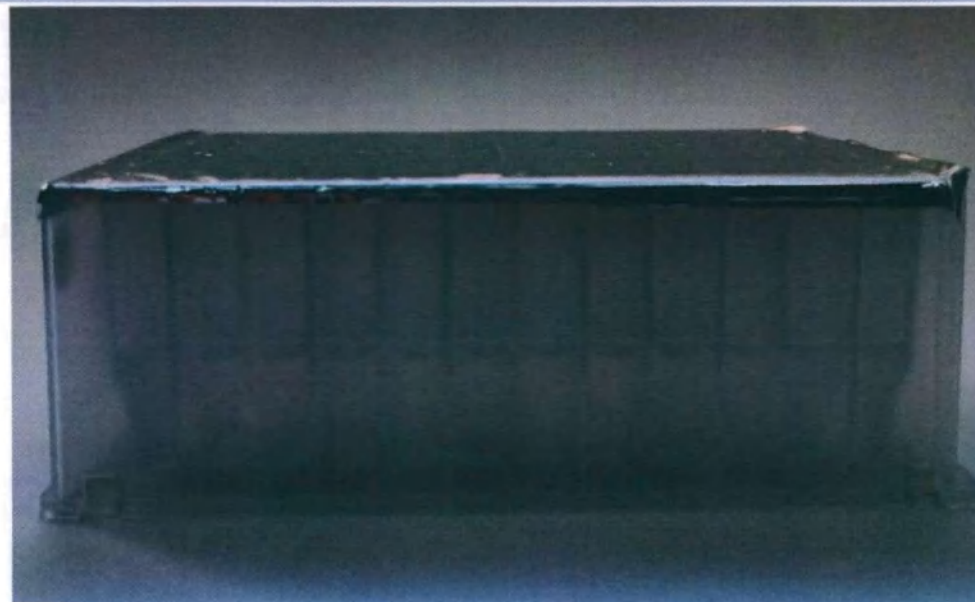


2.3. Планшет с элюирующим буфером



2.4. Гребенка



3. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 1, серия 2
(общий вид)

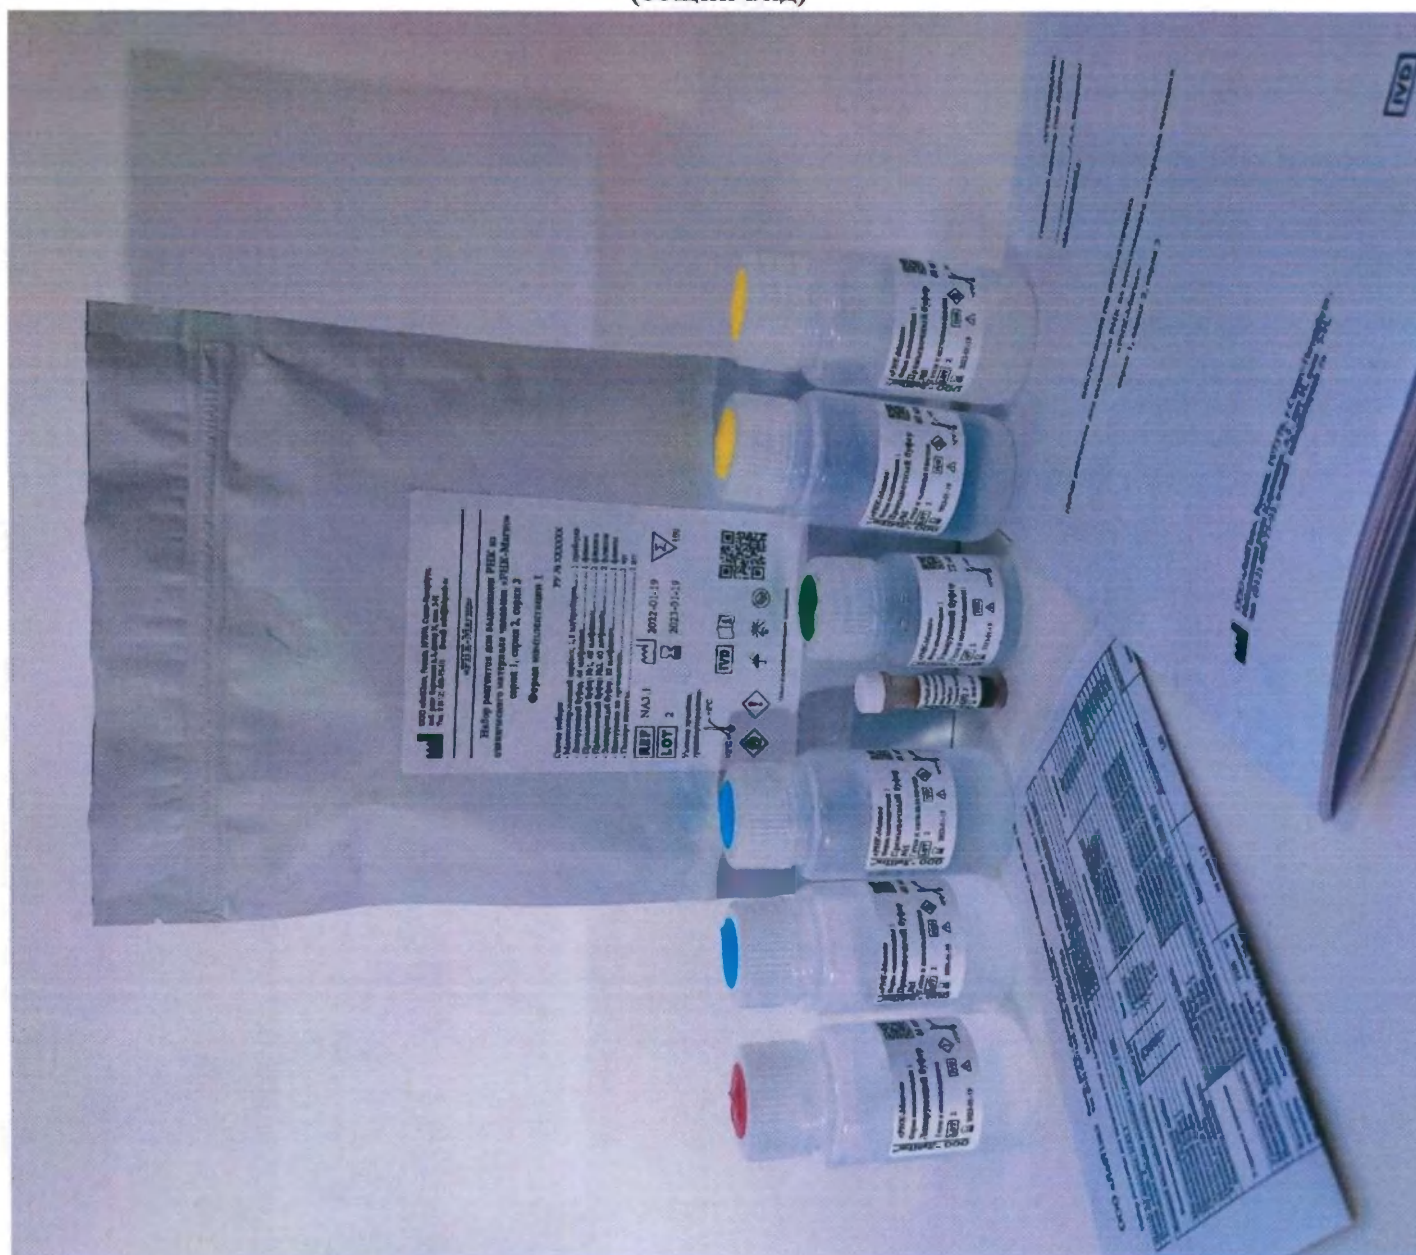





3.1. Магнетизированный сорбент





3.2. Лизирующий буфер

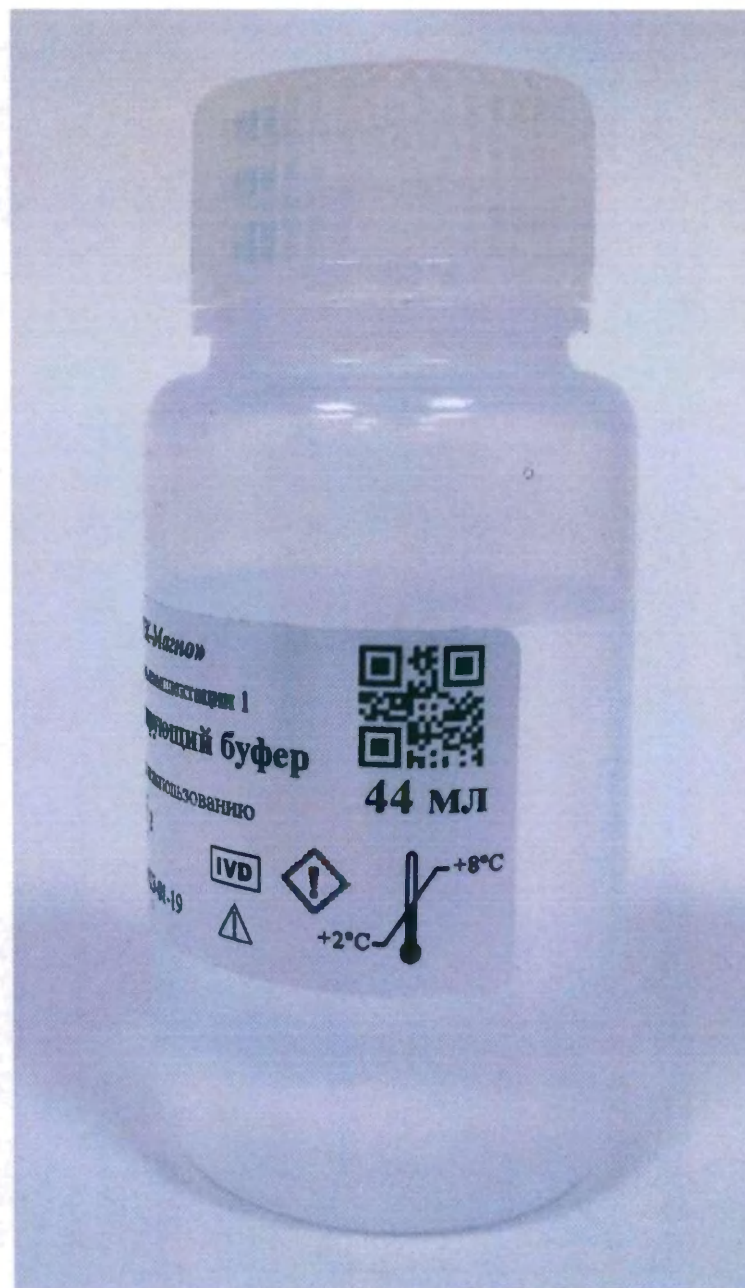



3.3. Промывочный буфер 1

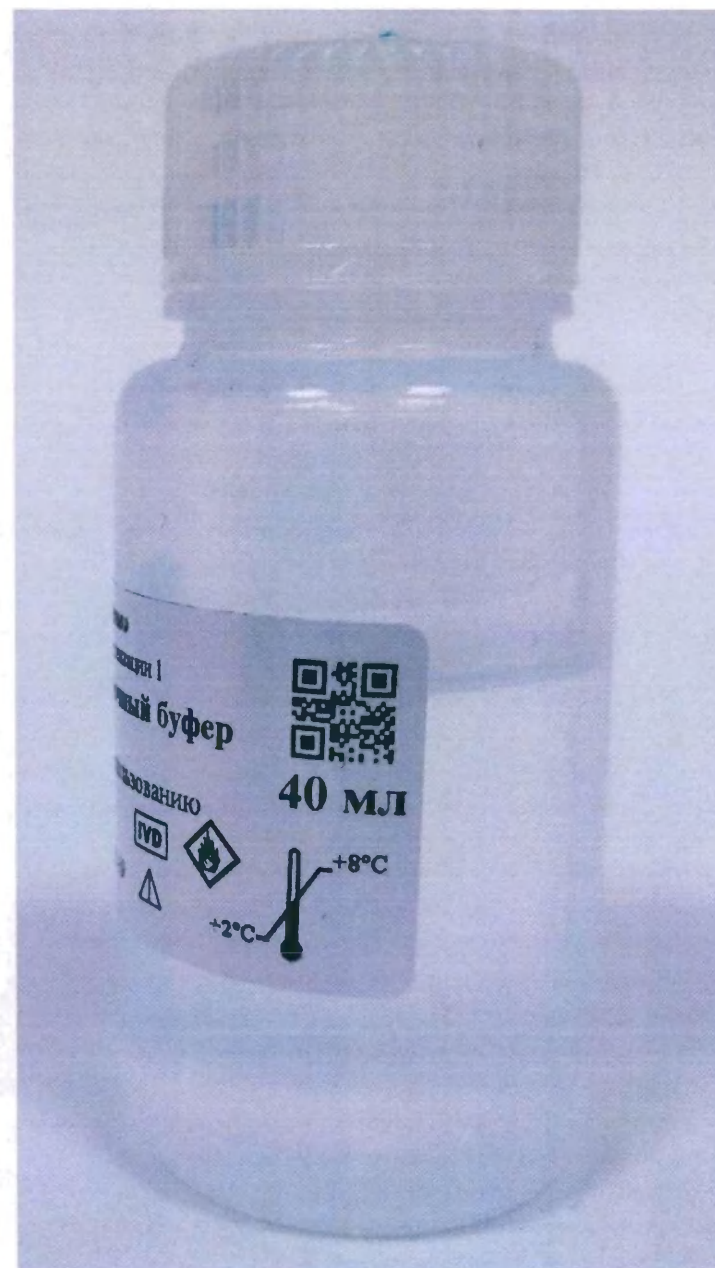

3.4. Промывочный буфер 2

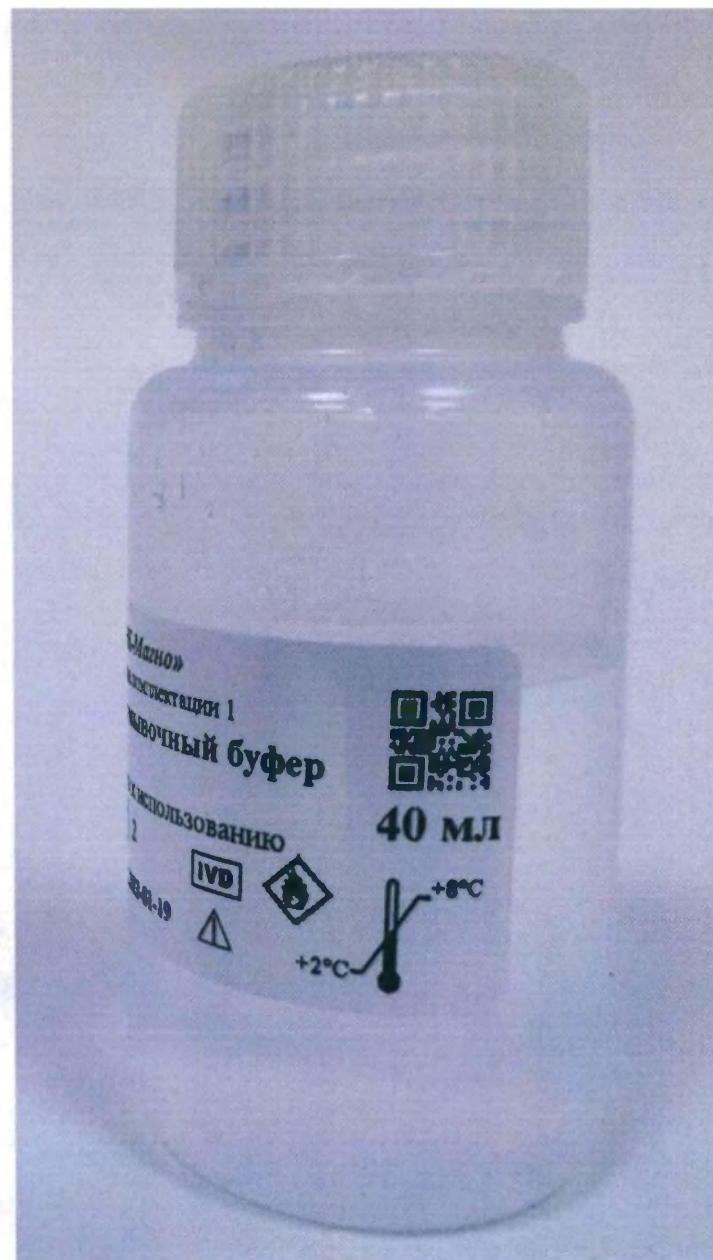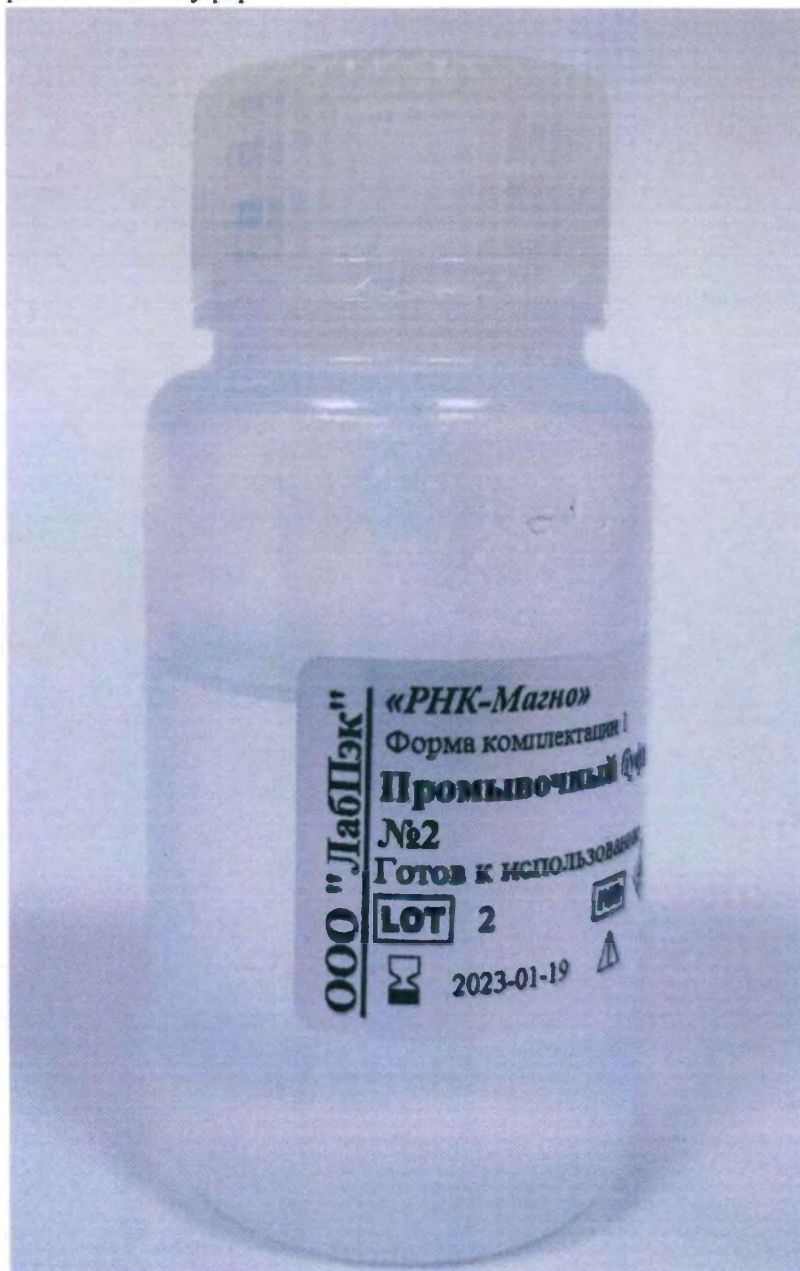

3.5. Элюирующий буфер

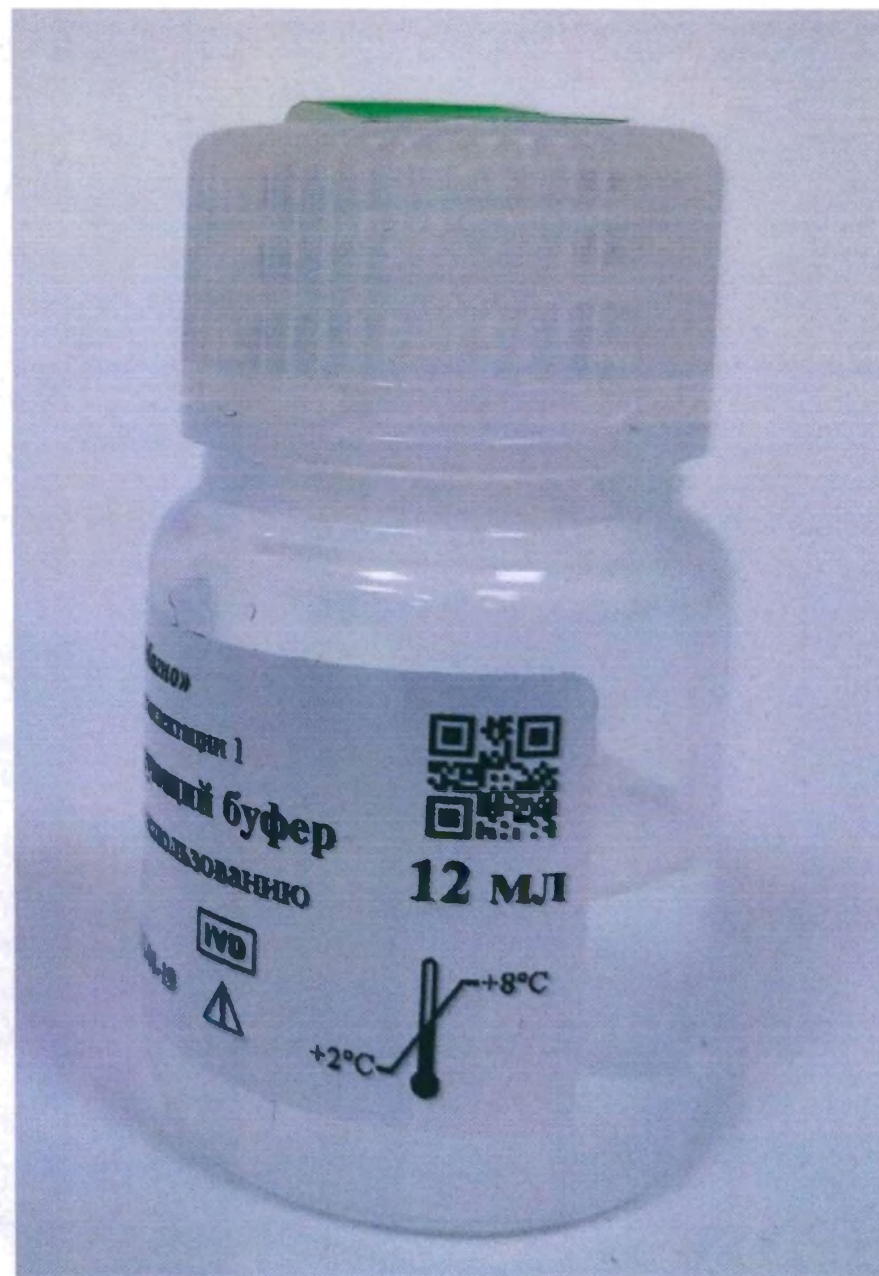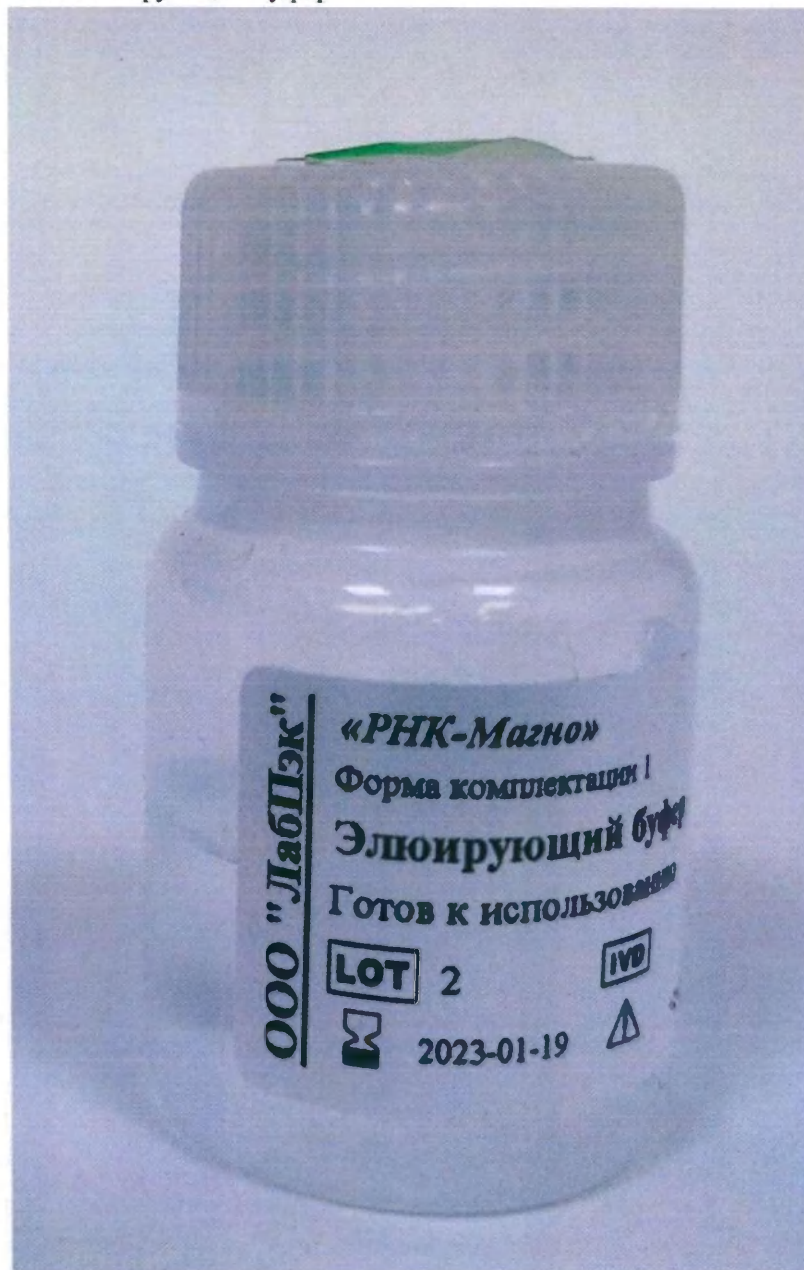

4. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 2, серия 2 (общий вид)





ООО «ИвИТек», Россия, 197770, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер М, пом. 3-Н
Тел: 8 (812) 490-75-95 E-mail: info@ivitek.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Формат идентификации 2

Состав набора:

- | | |
|---|-------|
| - Пипетка с калибровкой буфером и магнетиформовым сорбентом | 1 шт. |
| - Пипетка с прозрачным буфером | 1 шт. |
| - Пипетка с калибровкой буфером | 1 шт. |
| - Градуировка | 1 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |
| - Паспорт качества | 1 шт. |

Р/У № XXXXXX



REF

NA3.2



2022-01-21

LOT

2



2023-01-21

Условия хранения,
транспортирования:

+8°C
-2°C



IVD



Только для профессионального использования





4.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



4.2. Планшет с промывочным буфером



4.3. Планшет с элюирующим буфером



4.4. Гребенка



5. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 1, серия 3 (общий вид)





ООО «ЛабДиэг», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки д. 5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labdiag.ru

«РНК-Магнo»

Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магнo»
серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 1

RU M XXXXX

Состав набора:

- Магнетизируемый сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/фляка..... 1 фляка
- Промывочный буфер №1, 40 мл/фляка..... 2 фляка
- Промывочный буфер №2, 40 мл/фляка..... 2 фляка
- Элюирующий буфер, 12 мл/фляка..... 1 фляка
- Инструкция по применению..... 1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF NA3.1



2022-01-26


LOT 3



2023-01-26



Условия хранения,
транспортирования:





Только для профессионального применения



5.1. Магнетизированный сорбент





5.2. Лизирующий буфер

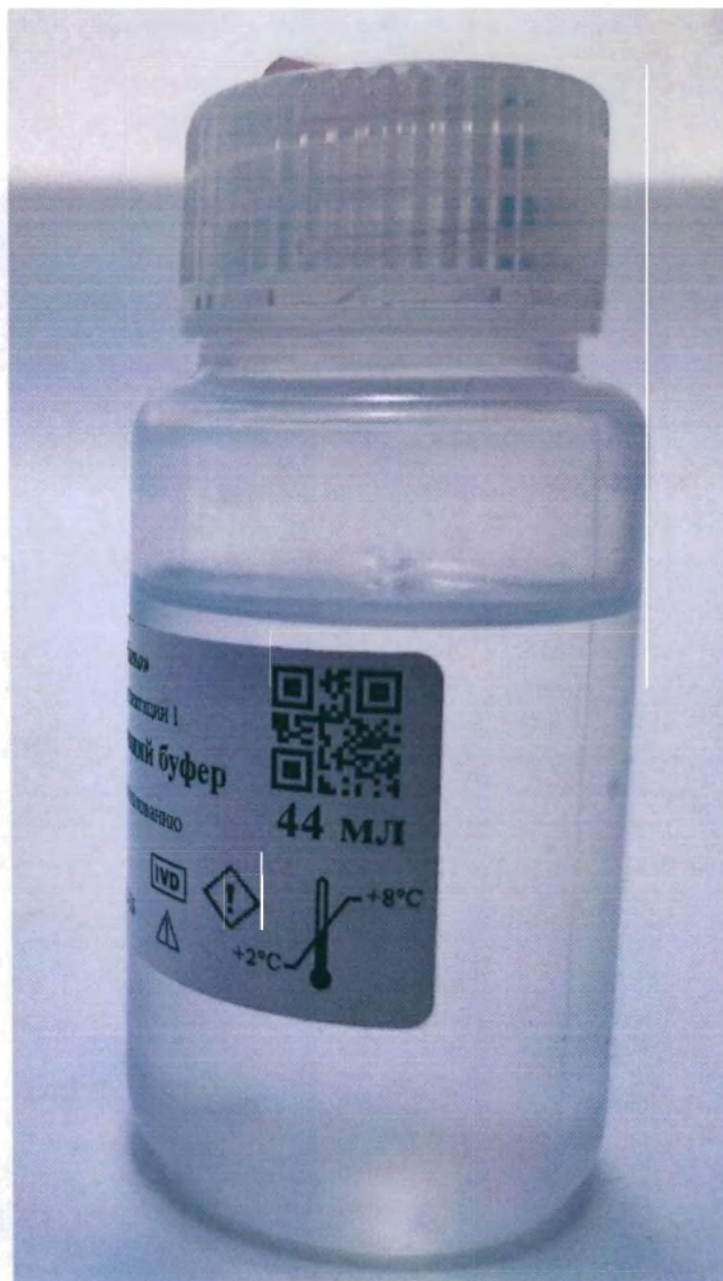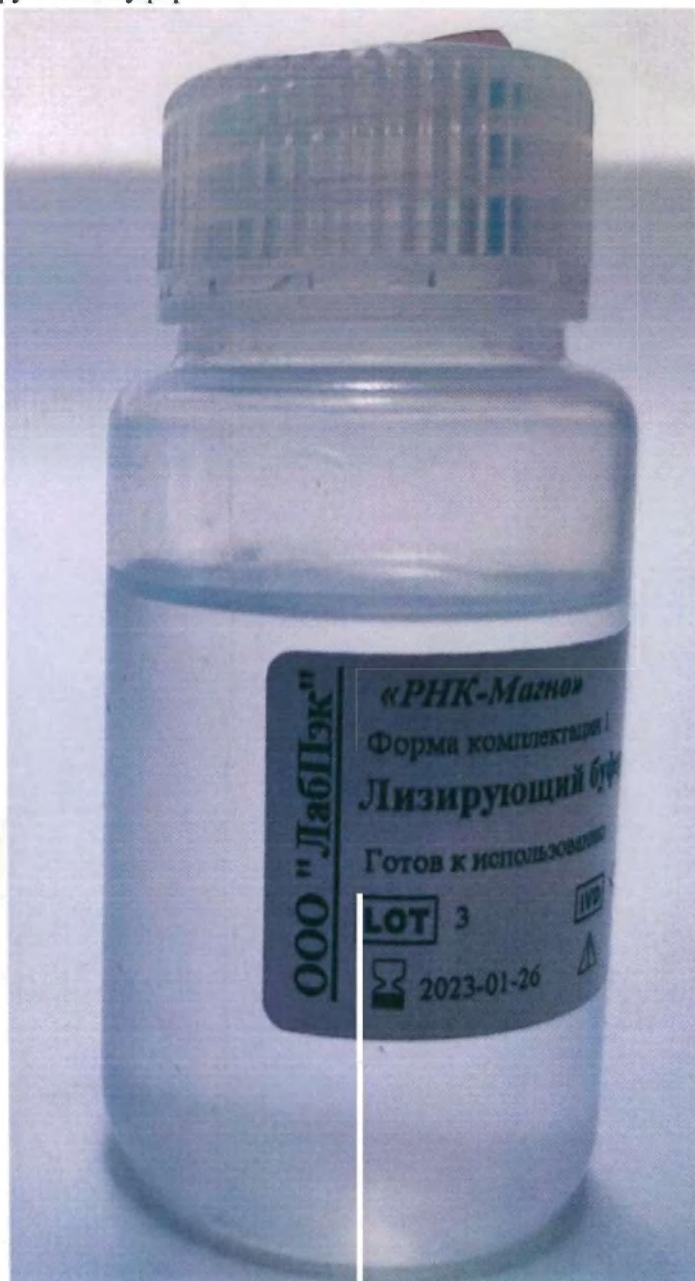



5.3. Промывочный буфер 1

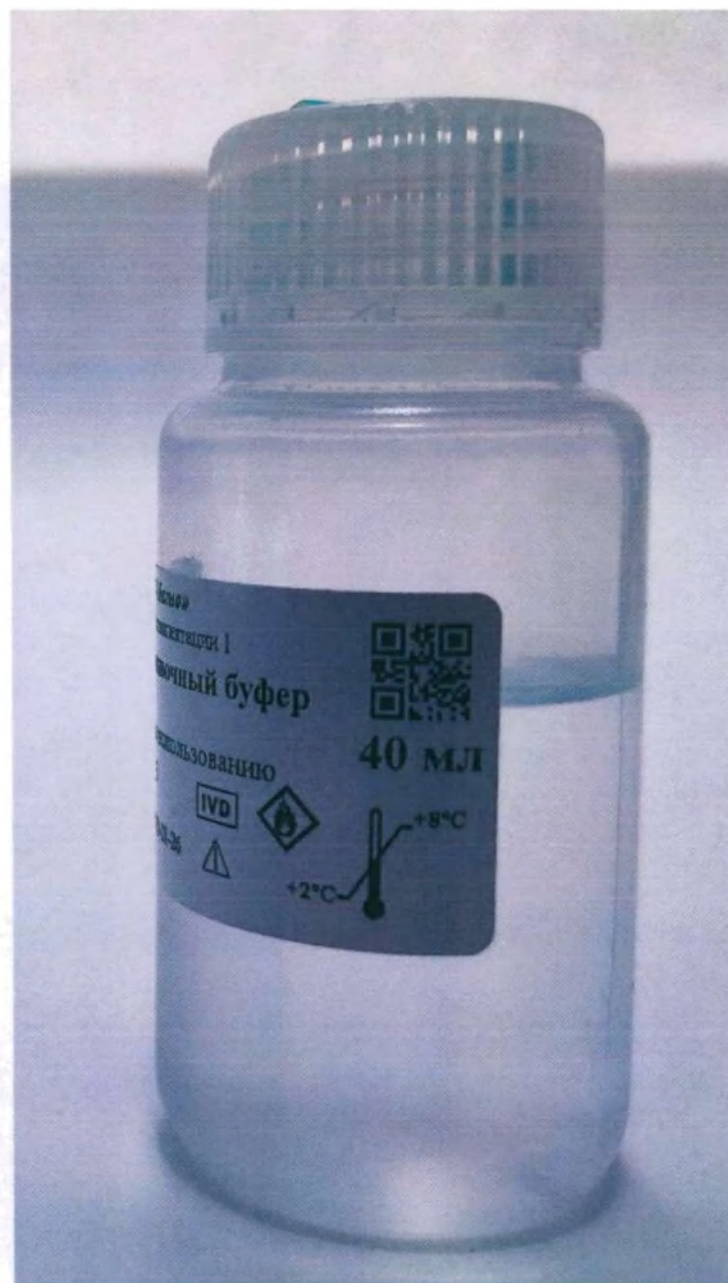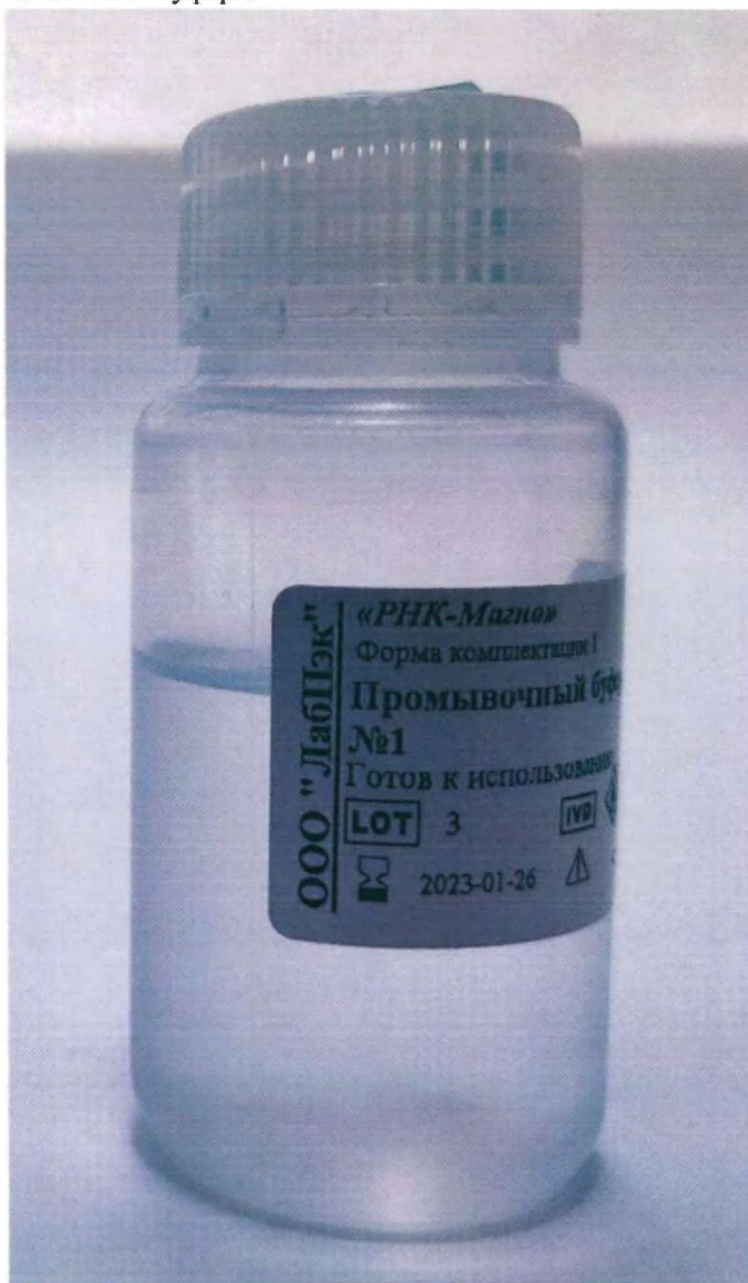

5.4. Промывочный буфер 2

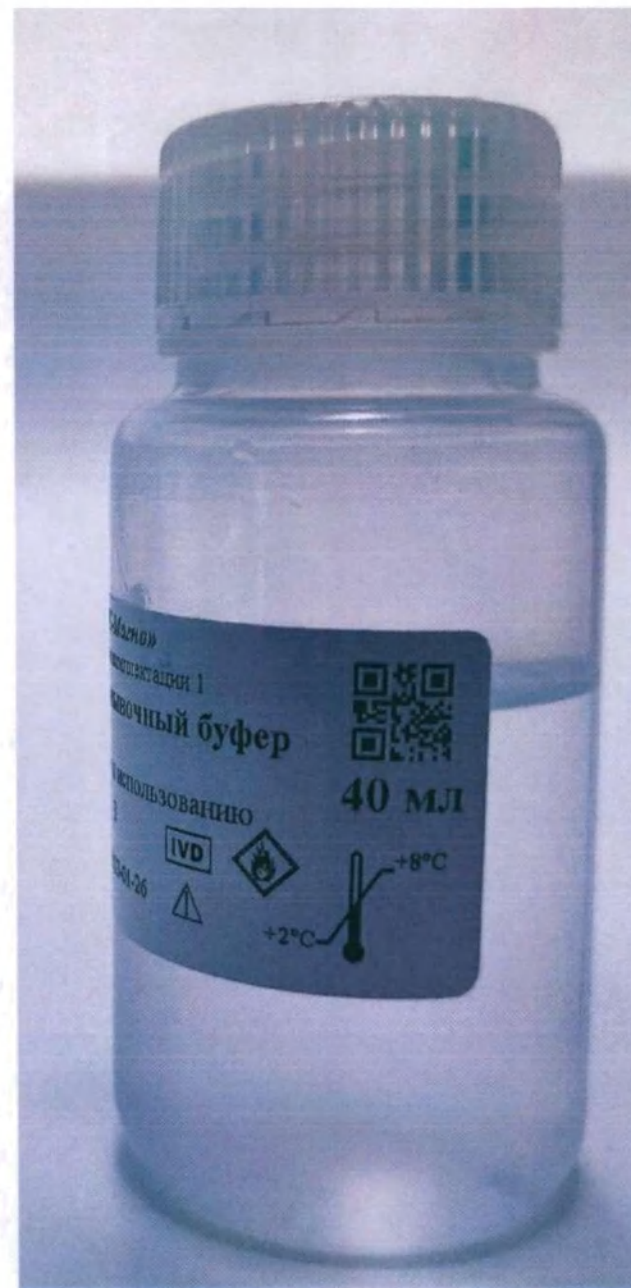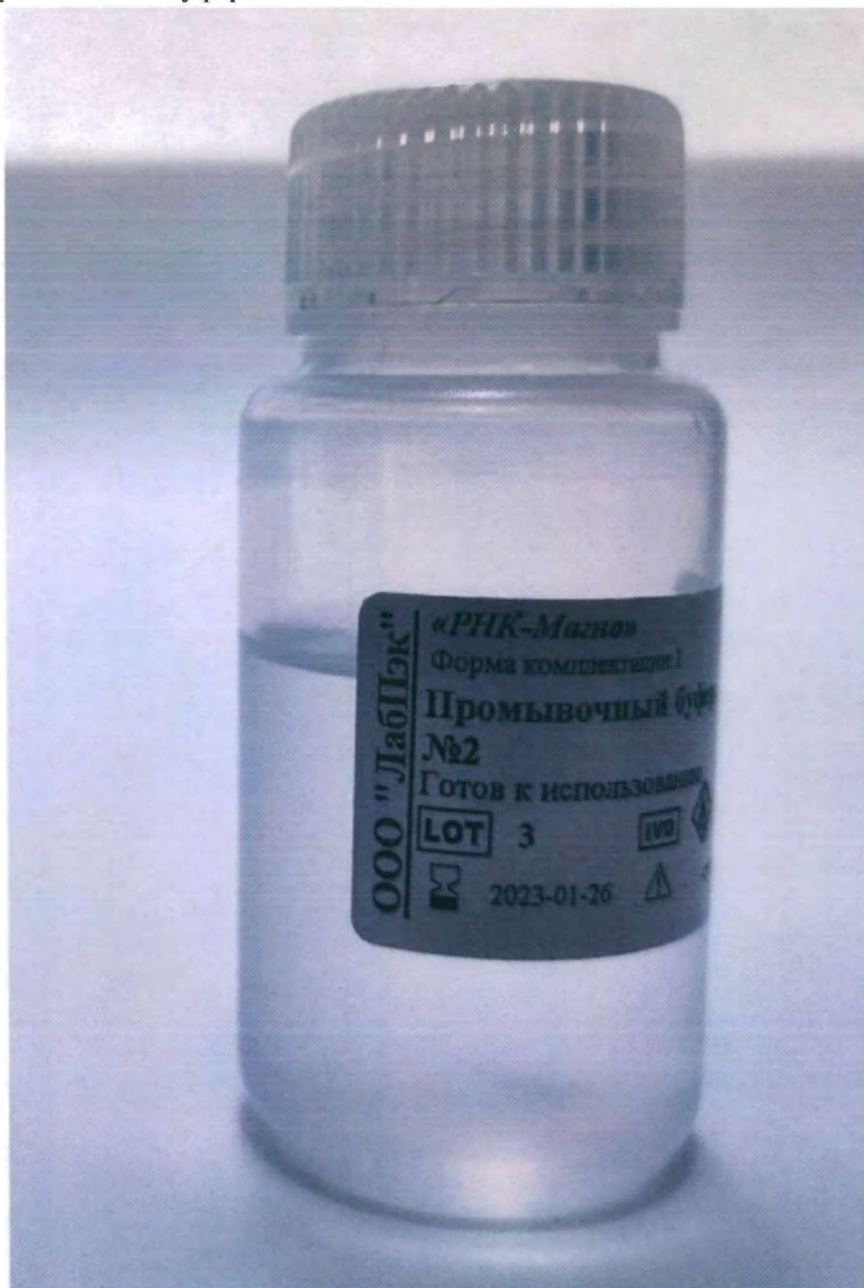

5.5. Элюирующий буфер

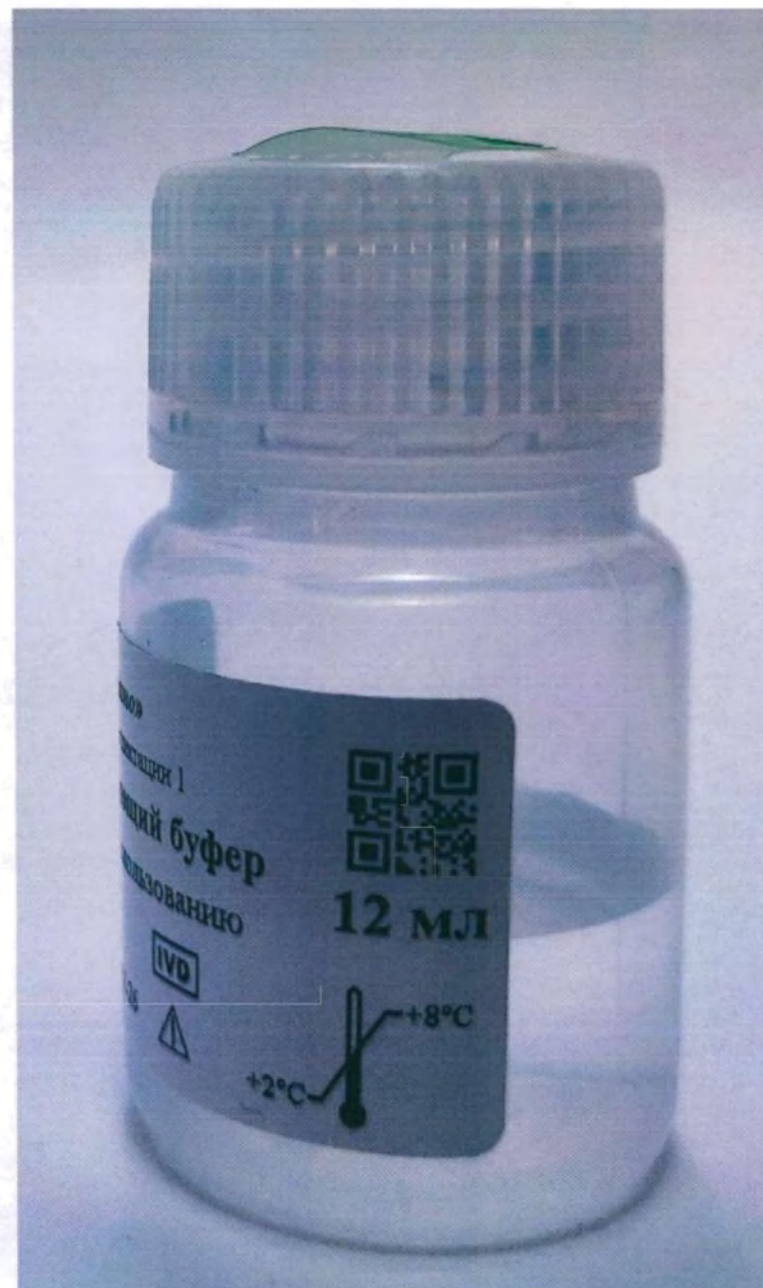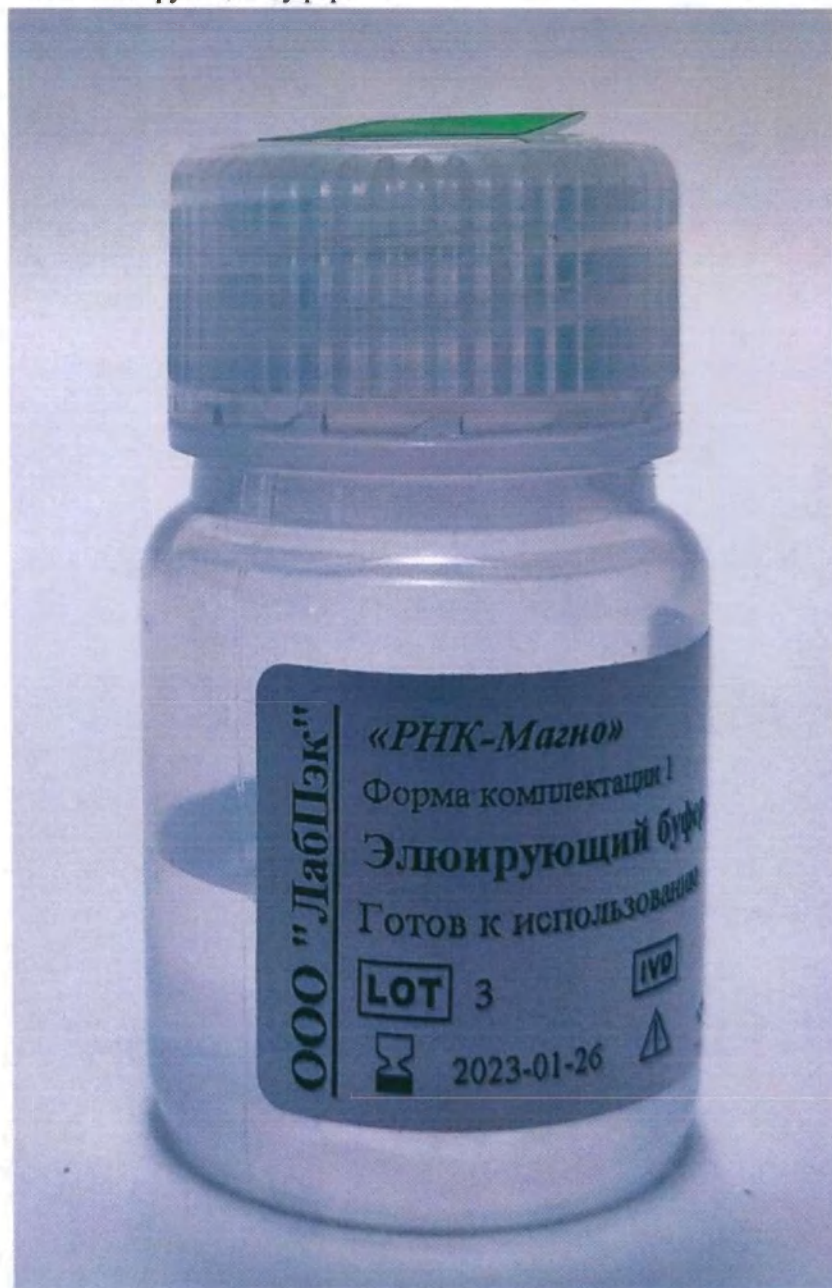

6. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 2, серия 3 (общий вид)





ООО «LabTiss», Россия, 197376, Санкт-Петербург, инд. парк «Корпусы» д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-90 E-mail: info@labtiss.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из биологического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Состав набора:

Формы упаковки: 2

RU № 0000000

- | | |
|--|-----------|
| - Пакетик с лизис-буфером и магнитосепарационным сорбентом | 1 пакетик |
| - Пакетик с праймерными буферами | 1 пакетик |
| - Пакетик с элюирующим буфером | 1 пакетик |
| - Гребешок | 1 шт |
| - Инкубатор по применению | 1 шт |
| - Паспорт качества | 1 шт |



REF

NA3.2



2022-01-28

LOT

3



2023-01-28


Условия хранения,
транспортировки:

+8°C

IVD



Только для профессионального применения

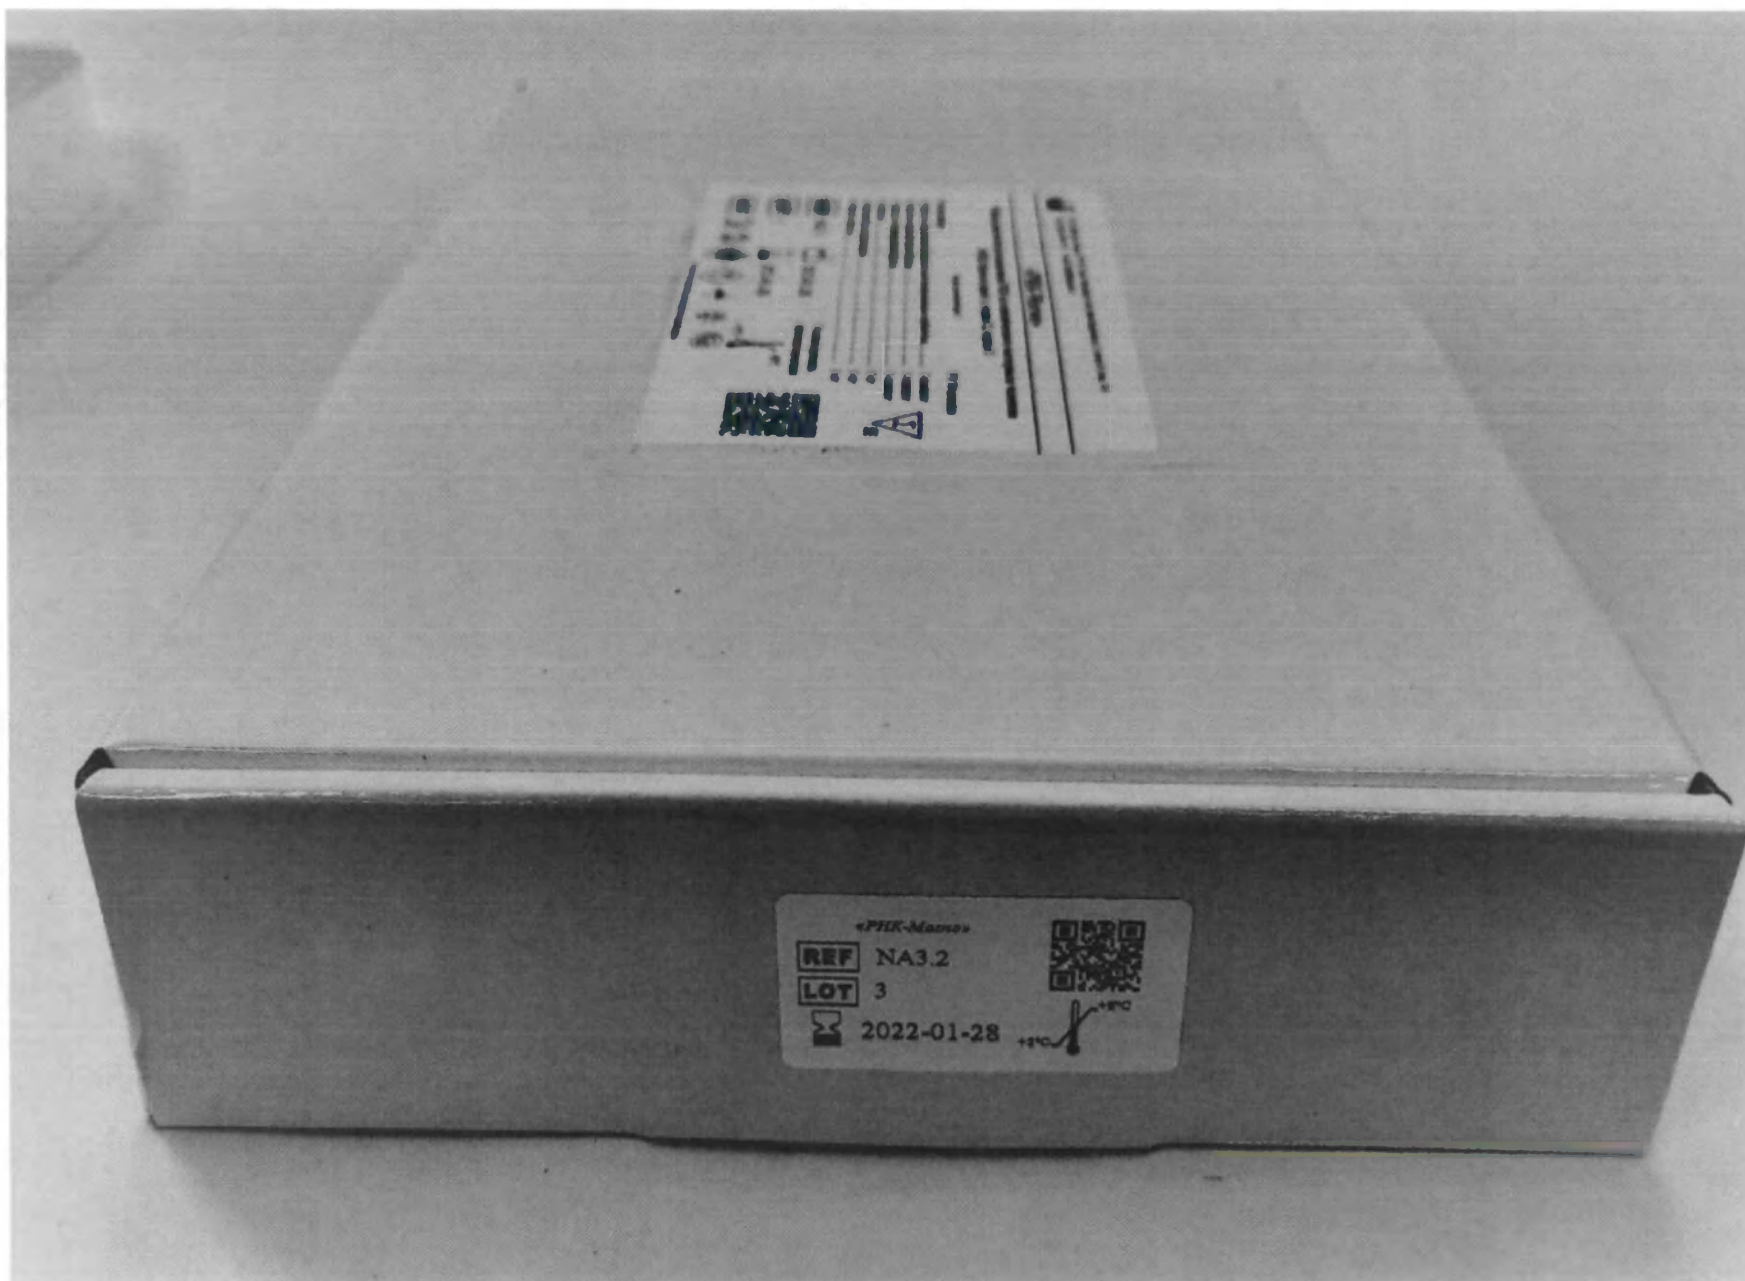




6.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



6.2. Планшет с промывочным буфером



6.3. Планшет с элюирующим буфером

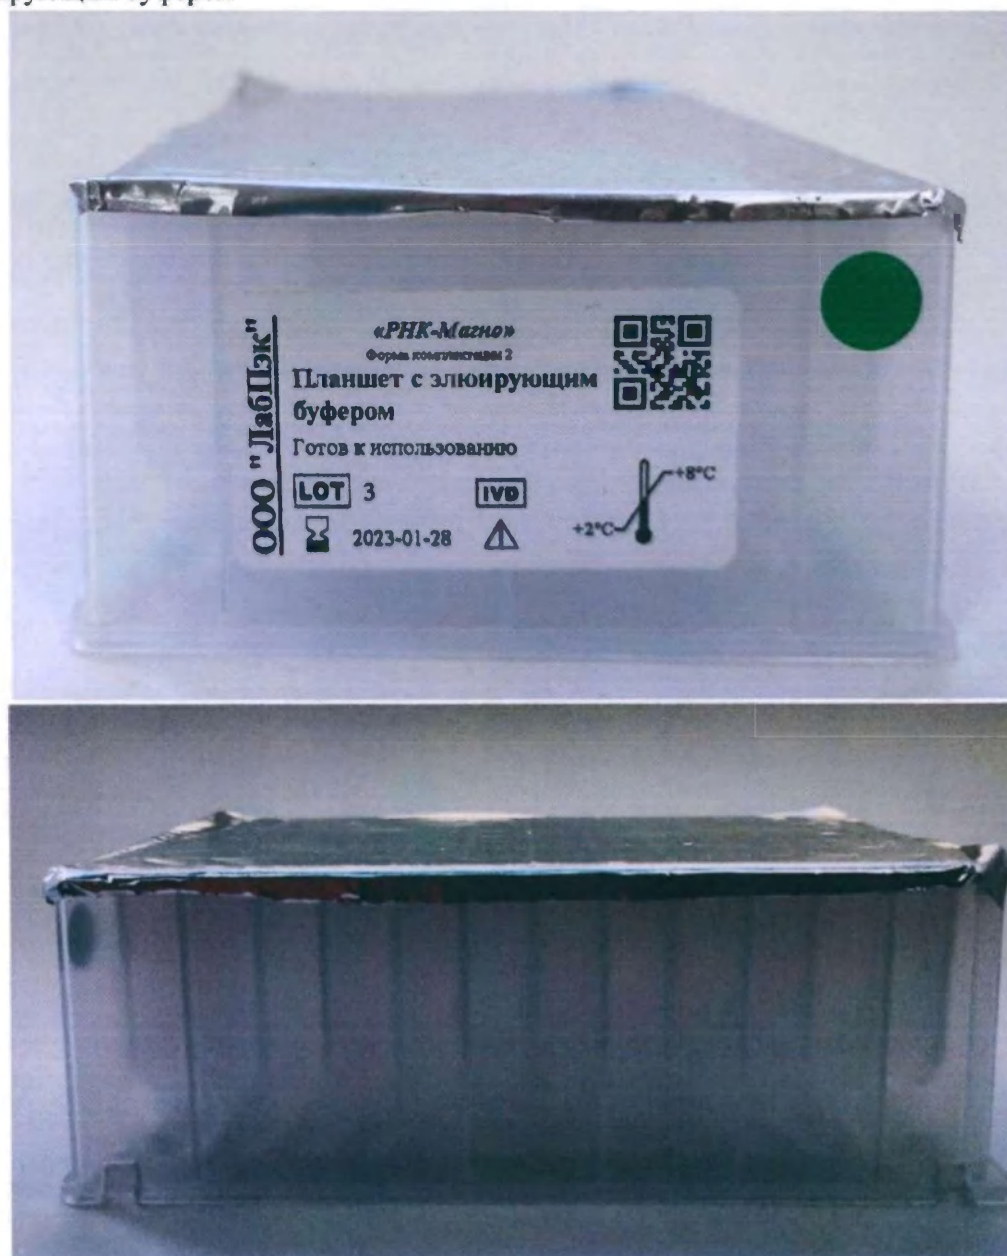

6.4. Гребенка





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО ЛабПэк»

А.А. Козаренко/

«11» апреля 2022 г.



Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

1. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 1. Серия 1.

1.1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер




Промывочный буфер 1

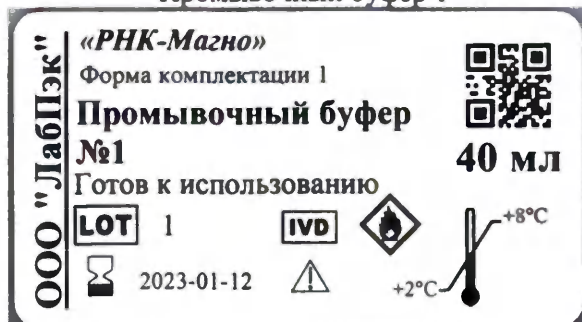

Промывочный буфер 2

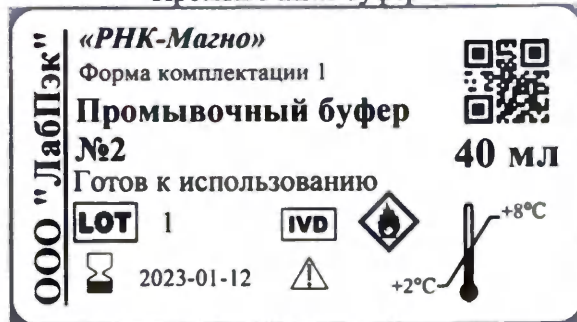

Элюирующий буфер

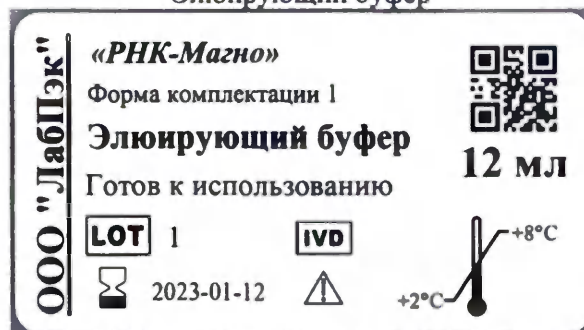

1.2.Образец маркировки потребительской упаковки

ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 1, серия 2, серия 3**

Форма комплектации 1

РУ № XXXXXX

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер №1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер №2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению.....1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF

NA3.1

2022-01-12

LOT

1

2023-01-12

100

**Условия хранения,
транспортирования:**

+2°C

+8°C

IVD

Только для профессионального применения

1.3.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3**

Форма комплектации 1

Число единиц потребительской упаковки изделийшт

Масса нетто групповой упаковкикг

Масса брутто групповой упаковки.....кг

Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF

NA3.1

2022-01

LOT

1

2023-01

**Условия хранения,
транспортирования:**

+2°C

+8°C


IVD

Только для профессионального применения

2. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 2. Серия 1.

2.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом

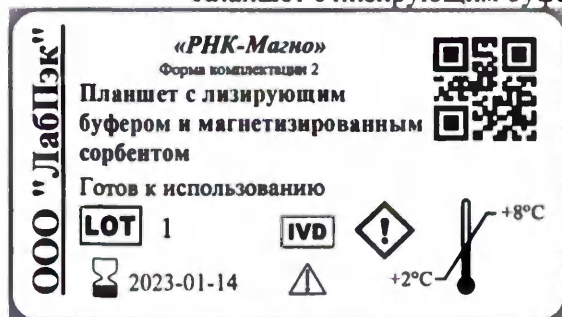

Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена красного цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с промывочным буфером




Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена желтого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с элюирующим буфером



Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена зеленого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Гребенка

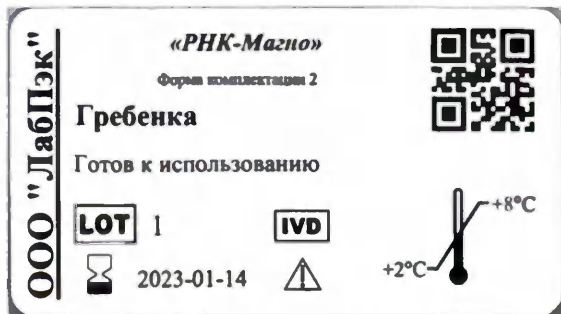

Дополнительной маркировке не подлежит

2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 2

Состав набора:

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом.....	1 планшет
- Планшет с промывочным буфером.....	1 планшет
- Планшет с элюирующим буфером.....	1 планшет
- Гребенка.....	1 шт
- Инструкция по применению.....	1 шт
- Паспорт качества.....	1 шт

REF NA3.2  2022-01-14 Условия хранения, транспортирования: +8°C
LOT 1  2023-01-14 +2°C
IVD       



 96

Только для профессионального применения

«РНК-Магно»

REF NA3.2  
LOT 1  2023-01-14 +2°C
 +8°C

Только для профессионального применения

2.1. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 2

Число единиц потребительской упаковки изделийшт
 Масса нетто групповой упаковкикг
 Масса брутто групповой упаковки.....кг
 Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF NA3.2  2022-01 Условия хранения, транспортирования: +8°C
LOT 1  2023-01 +2°C
IVD       

Только для профессионального применения



3. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 1. Серия 2.

3.1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер




Промывочный буфер 1

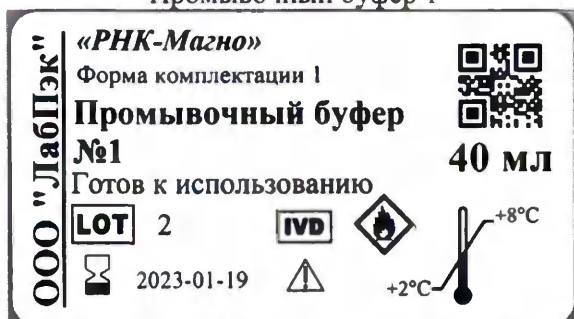

Промывочный буфер 2

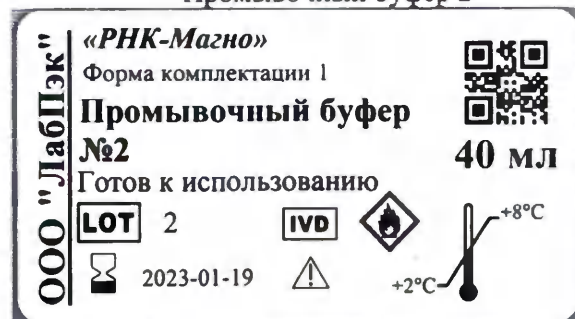

Элюирующий буфер

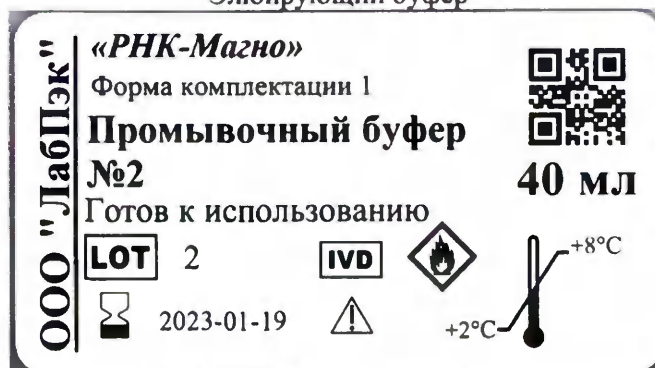

3.2.Образец маркировки потребительской упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
 наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-И
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 1, серия 2, серия 3**

Форма комплектации 1

РУ № XXXXXX

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер №1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер №2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению.....1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF

NA3.1



2022-01-19



100

LOT

2



2023-01-19

**Условия хранения,
транспортирования:**

+2°C



+8°C

IVD











Только для профессионального применения

3.3.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-И
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3**

Форма комплектации 1

Число единиц потребительской упаковки изделийшт

Масса нетто групповой упаковкикг

Масса брутто групповой упаковки.....кг

Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF

NA3.1



2022-01

LOT

2



2023-01

IVD




Условия хранения,
транспортирования:

+2°C



+8°C







Только для профессионального применения

4. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 2. Серия 2.


4.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом




Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена красного цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с промывочным буфером

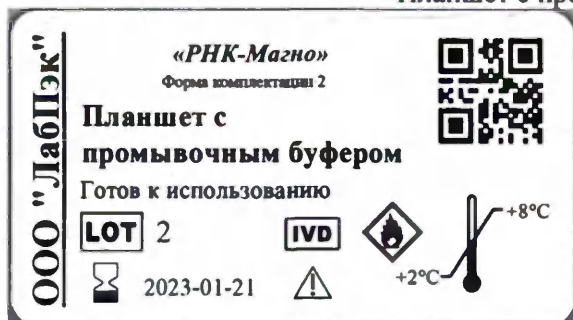


Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена желтого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с элюирующим буфером

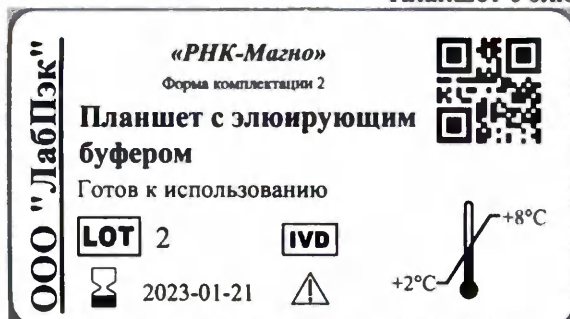

Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена зеленого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Гребенка

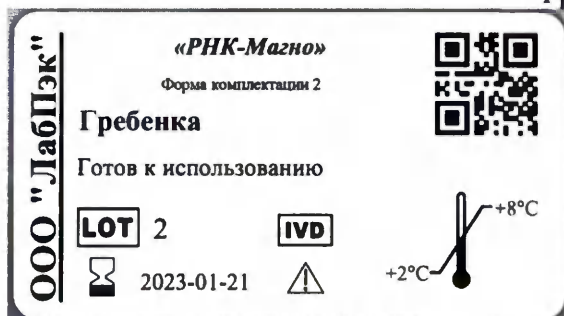

Дополнительной маркировке не подлежит

4.2.Образцы маркировки потребительской упаковки

ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 2

Состав набора:

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом.....	1 планшет
- Планшет с промывочным буфером.....	1 планшет
- Планшет с элюирующим буфером.....	1 планшет
- Гребенка.....	1 шт
- Инструкция по применению	1 шт
- Паспорт качества.....	1 шт

РУ № XXXXX

96

REF NA3.2

2022-01-21

Условия хранения, транспортирования:

LOT 2

2023-01-21

+2°C

+8°C

IVD

Только для профессионального применения

«РНК-Магно»

REF NA3.2

LOT 2

2023-01-21

+2°C

+8°C

2.2.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 2

Число единиц потребительской упаковки изделийшт

Масса нетто групповой упаковкикг

Масса брутто групповой упаковки.....кг

Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF NA3.2

2022-01

Условия хранения, транспортирования:

LOT 2

2023-01

+2°C

+8°C

IVD

Только для профессионального применения

5. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 1. Серия 3.

5.1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер




Промывочный буфер 1

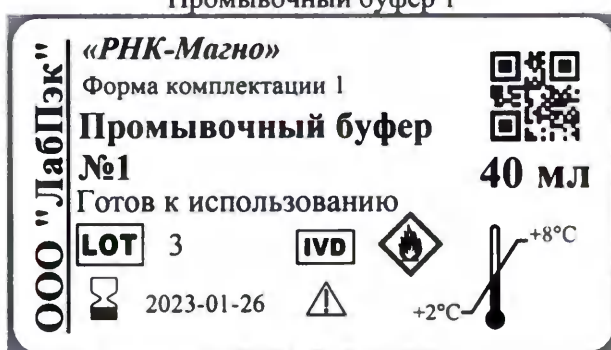

Промывочный буфер 2

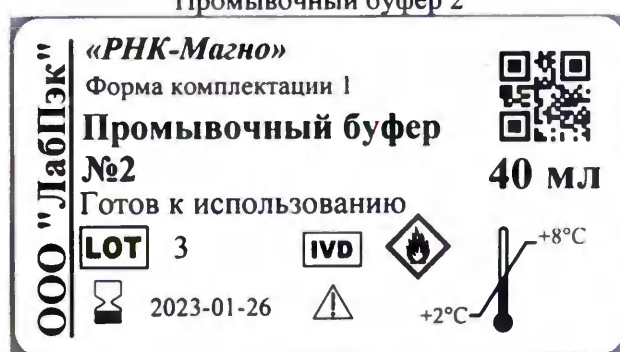

Элюирующий буфер

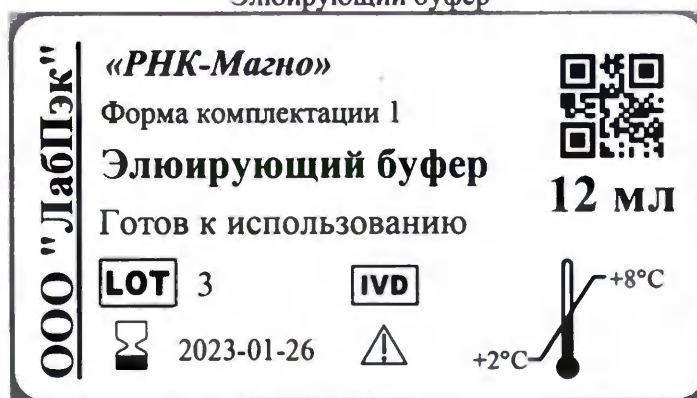

Образец маркировки потребительской упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 1

RU № XXXXXX

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1.1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер №1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер №2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению..... 1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF NA3.1

LOT 3

 2022-01-26

 2023-01-26



Условия хранения,
транспортирования:

 +8°C

 +2°C

















Только для профессионального применения

5.2.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 1

Число единиц потребительской упаковки изделийшт
Масса нетто групповой упаковкикг
Масса брутто групповой упаковки.....кг
Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF NA3.1

LOT 3

 2022-01

 2023-01







Условия хранения,
транспортирования:

 +8°C

 +2°C










Только для профессионального применения

6. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 2. Серия 3.


6.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом

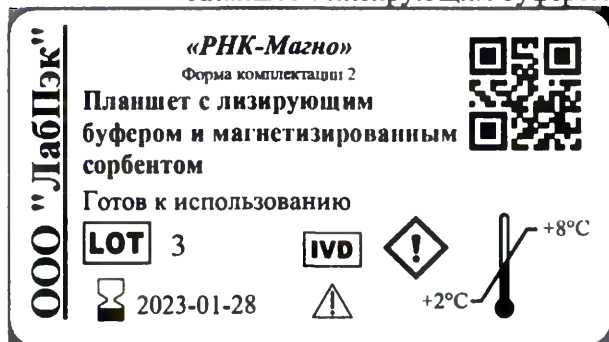


Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена красного цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с промывочным буфером

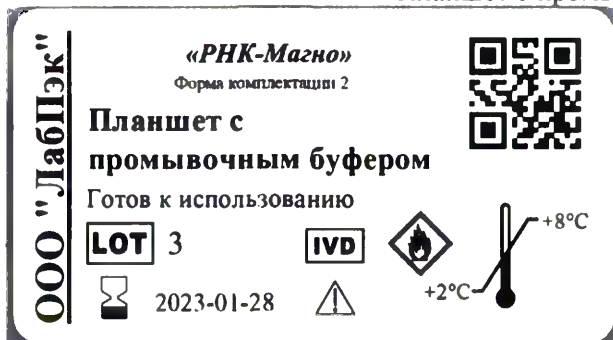


Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена желтого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с элюирующим буфером

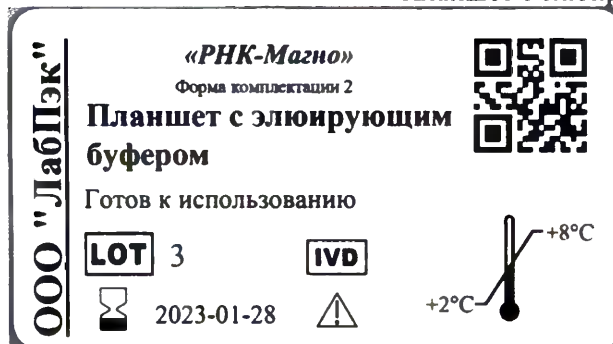

Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена зеленого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Гребенка

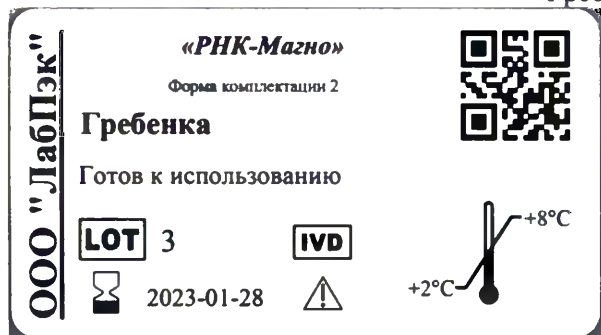

Дополнительной маркировке не подлежит

6.2.Образцы маркировки потребительской упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Состав набора:

Форма комплектации 2

РУ № XXXXX

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом.....

1 планшет

- Планшет с промывочным буфером.....

1 планшет

- Планшет с элюирующим буфером.....

1 планшет

- Гребенка.....

1 шт

- Инструкция по применению

1 шт

- Паспорт качества.....

1 шт

REF

NA3.2



2022-01-28

LOT

3



2023-01-28

IVD















Условия хранения, транспортирования:

+8°C

+2°C





96

Только для профессионального применения

«РНК-Магно»

REF

NA3.2

LOT

3



2022-01-28

Условия хранения, транспортирования:

+8°C

+2°C



Только для профессионального применения

2.3.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 1, серия 2, серия 3

Форма комплектации 2

Число единиц потребительской упаковки изделийшт

Масса нетто групповой упаковкикг

Масса брутто групповой упаковки.....кг

Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF

NA3.2



2022-01

LOT

3



2023-01

IVD







Условия хранения, транспортирования:

+8°C

+2°C





Только для профессионального применения

