

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»

Летохов С.В.

«23» марта 2022 г.




Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор мочи на тест-полосках URICKAN-про

по ТУ 9443-037-59879815-2015

Общий вид анализатора и принадлежностей

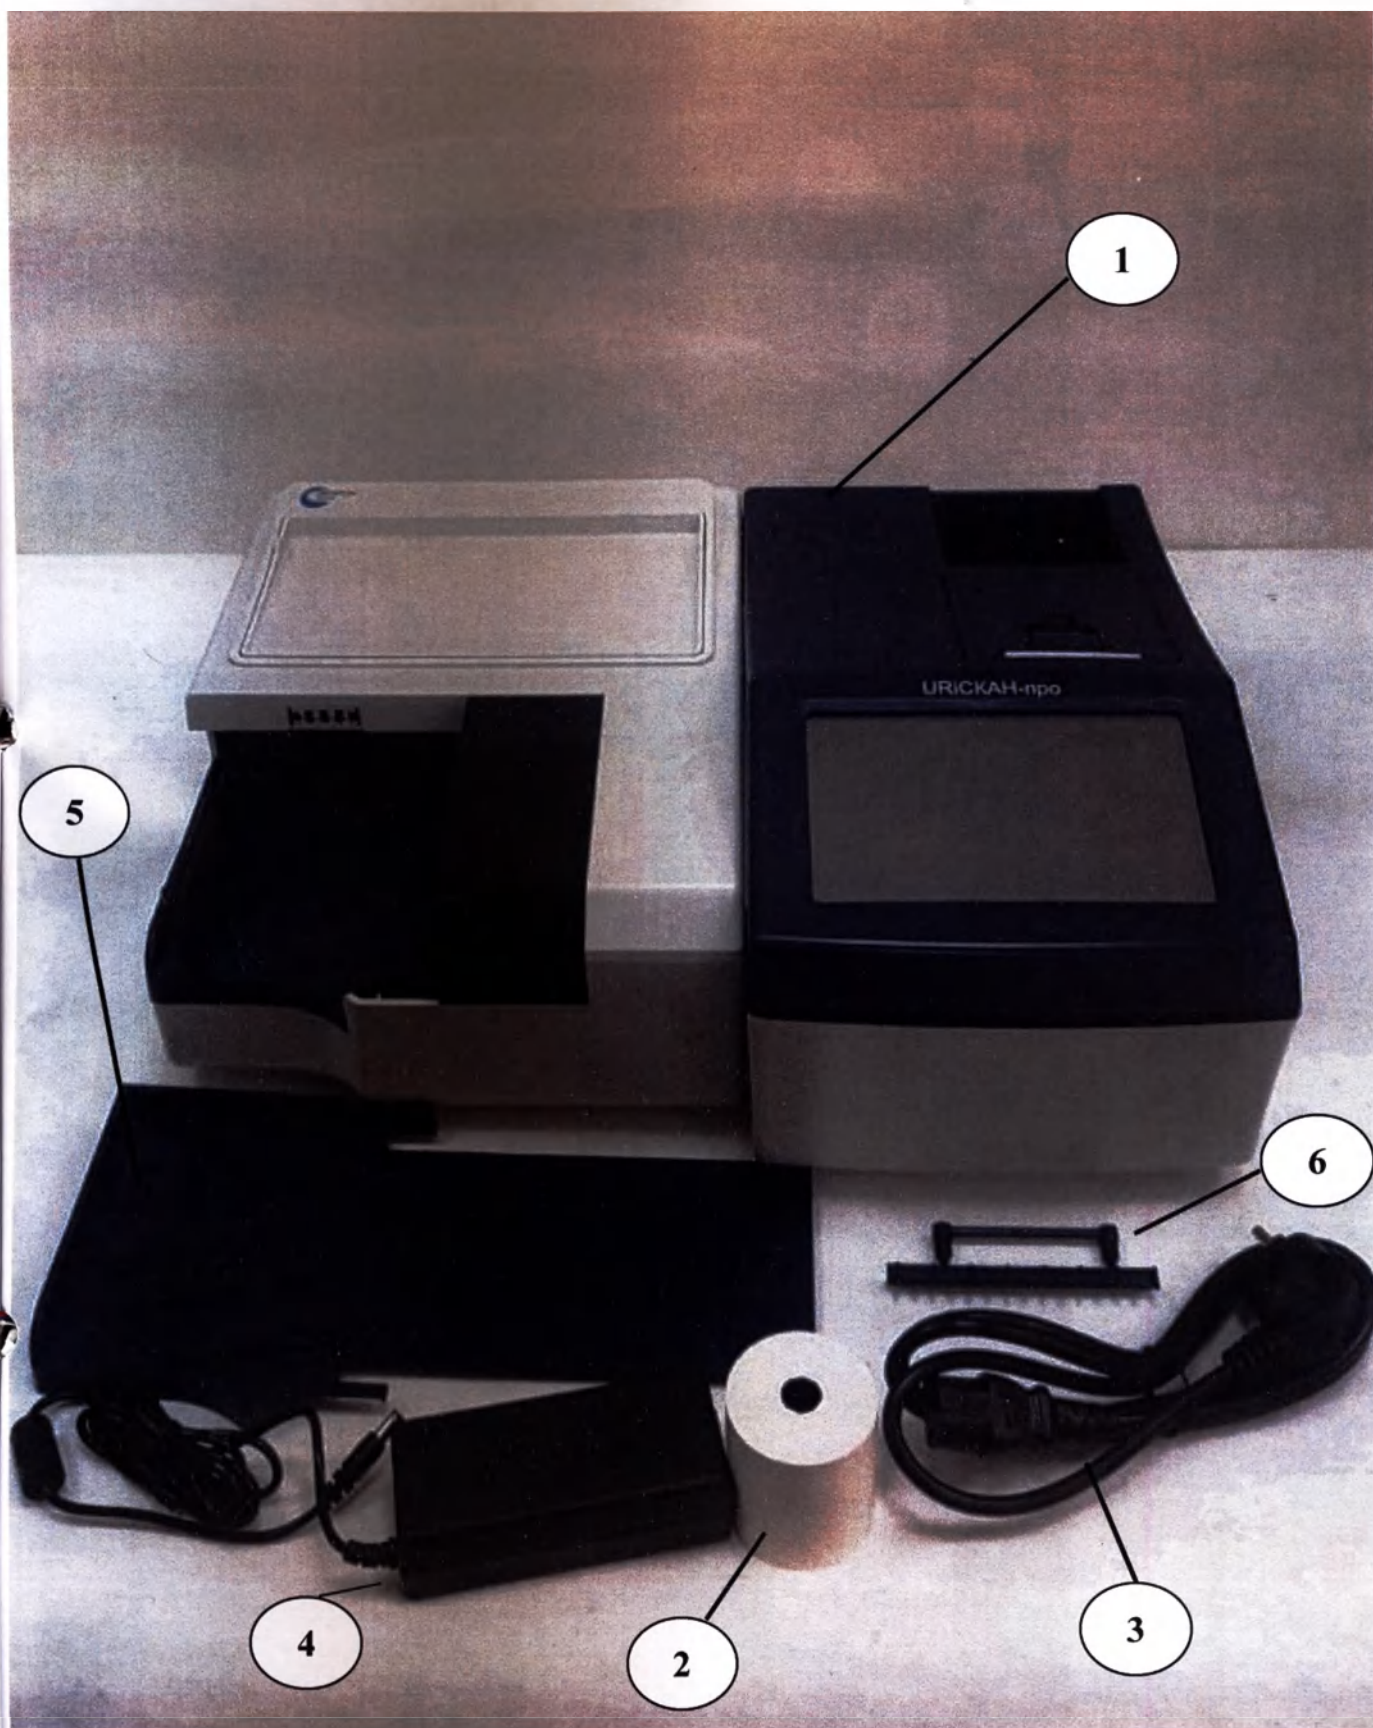

1 - Анализатор мочи на тест-полосках URiCKAH-
pro

Принадлежности:

2 - Бумага для термопринтера
3 - Кабель электропитания

4 - Сетевой адаптер питания

5 - Направляющая пластина для полосок (запасная)

6 - Толкатель полосок (запасной)



1 - Маркировка

2 - Порт RS232

3 - Порт сканера штрих-кода

4 - Порт LPT


5 - USB – коннектор В типа

6 - USB – коннектор А типа

7 - Коннектор питания 12 В

8 - Выключатель питания

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист.
Генеральный директор


Летохов С.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»

Летохов С.В.

«23» марта 2022 г.



Макет маркировки медицинского изделия

Анализатор мочи на тест-полосках URICKAN-про по ТУ 9443-037-59879815-2015



ООО «Эйлитон» г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом.29

Сделано в России

АНАЛИЗАТОР МОЧИ НА ТЕСТ-ПОЛОСКАХ

URISKAH-про

по ТУ 9443-037-59879815-2015

~220 В

50 Гц

42 ВА

РАМ.СХПА1-214-2.0.1-_____

20_____ г.

РУ № РЗН 2016/3738 от 20.02.2016

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 лист.
Генеральный директор


Летохов С.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»


Летохов С.В.

«23» марта 2022 г.



Макет маркировки упаковки медицинского изделия

Анализатор мочи на тест-полосках URICKAN-про по ТУ 9443-037-59879815-2015

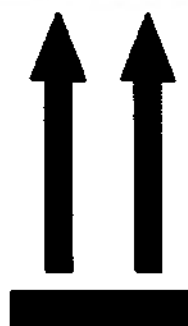

ЭЙЛИТОН

Производство
медицинских изделий

ООО «Эйлитон» г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, пом.29

Сделано в России

**АНАЛИЗАТОР МОЧИ НА ТЕСТ-ПОЛОСКАХ
URISKAN-про**

по

ТУ 9443-037-59879815-2015

~220 В

50 Гц

42 ВА

РАМ.СХПА1-214-2.0.1-_____


20____ г.

IVD

Хранить и транспортировать при
температуре от +5 до +40°C

Дата упаковки « _____ » 20 ____ г.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 лист.
Генеральный директор


Летохов С.В.

