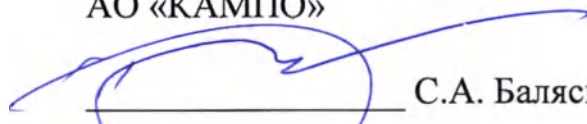


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «КАМПО»


_____ С.А. Балясников

« 19 » апреля 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ВМЕСТЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Аппарат
искусственной вентиляции легких ГС-16 с пневмоприводом по
ТУ 32.50.21-001-23435930-2017» с изм. № 1**

2022

Заводской знак ГС-16



**Аппарат искусственной вентиляции легких ГС-16 с пневмоприводом по
ТУ 32.50.21-001-23435930-2017, исполнение 1
(с баллоном К-2-250 ТУ 14-3-422 вместимостью 2,0 л (стальной), с вентилем,
9В5.887.201)**



**Аппарат искусственной вентиляции легких ГС-16 с пневмоприводом по
ТУ 32.50.21-001-23435930-2017, исполнение 2**
(с баллон ВМК2-99-200 вместимостью 2,0 л (металлокомпозитный), с вентилем,
9В5.887.201-02)



Футляр 9В6.875.285




Кейс 9В4.143.111



***Баллон LA4-0356 вместимостью 2,0 л (стальной), с вентилем,
9B5.887.201***




***Баллон К-2-250 ТУ 14-3-422-75 вместимостью 2,0 л (стальной) с
вентилем, 9В5.887.201***

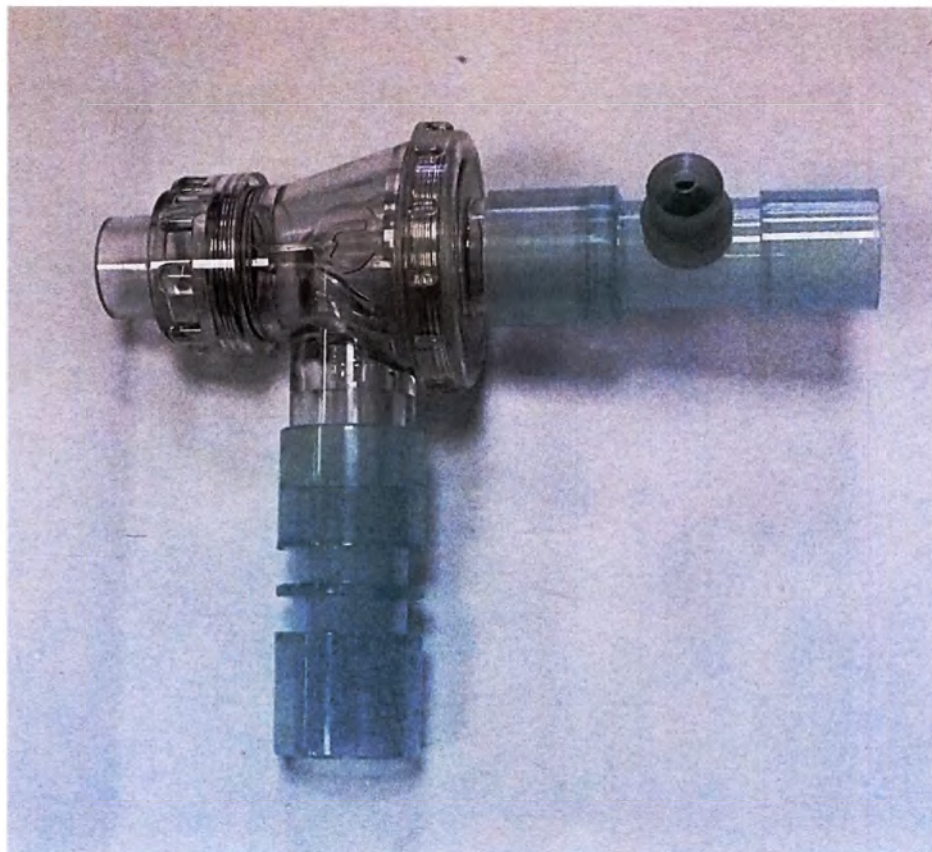

Клапан пациента 9B5.893.093



Клапан пациента 9B5.893.094

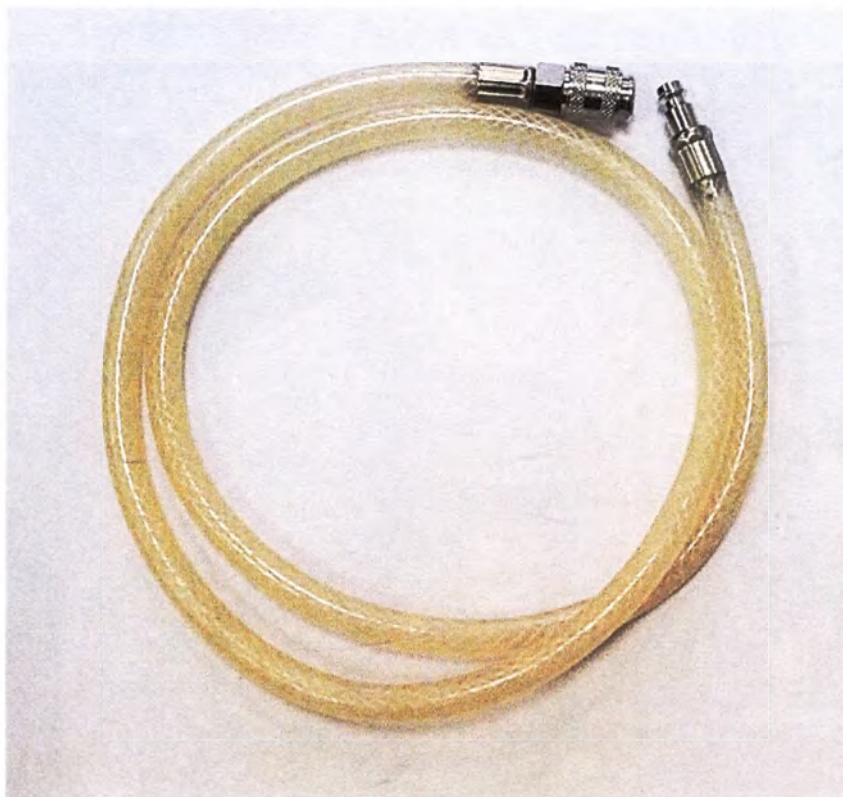


Шланг кислородный 9В6.450.571




Трубка гофрированная силиконовая, ТГСД 15-22F/22F-1060



*Маска анестезиологическая «Clear Flex» размер 2, 8848002,
производства «Интерседжикал Лтд.»*

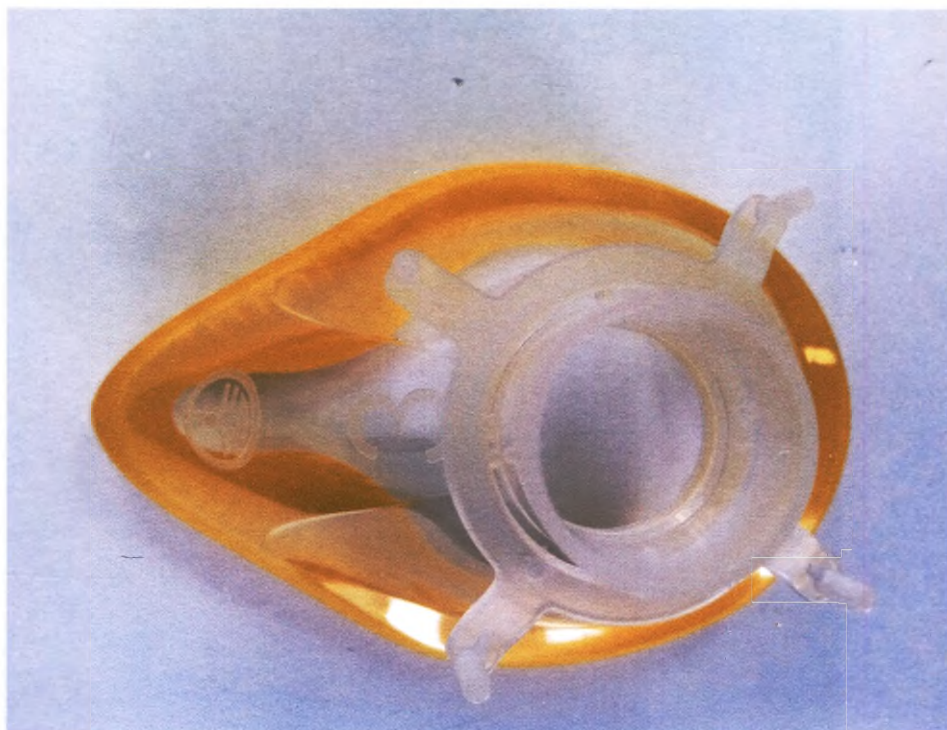

***Маска анестезиологическая «QuadraLite» размер 3, 7193000,
производства «Интерседжикал Лтд.»***

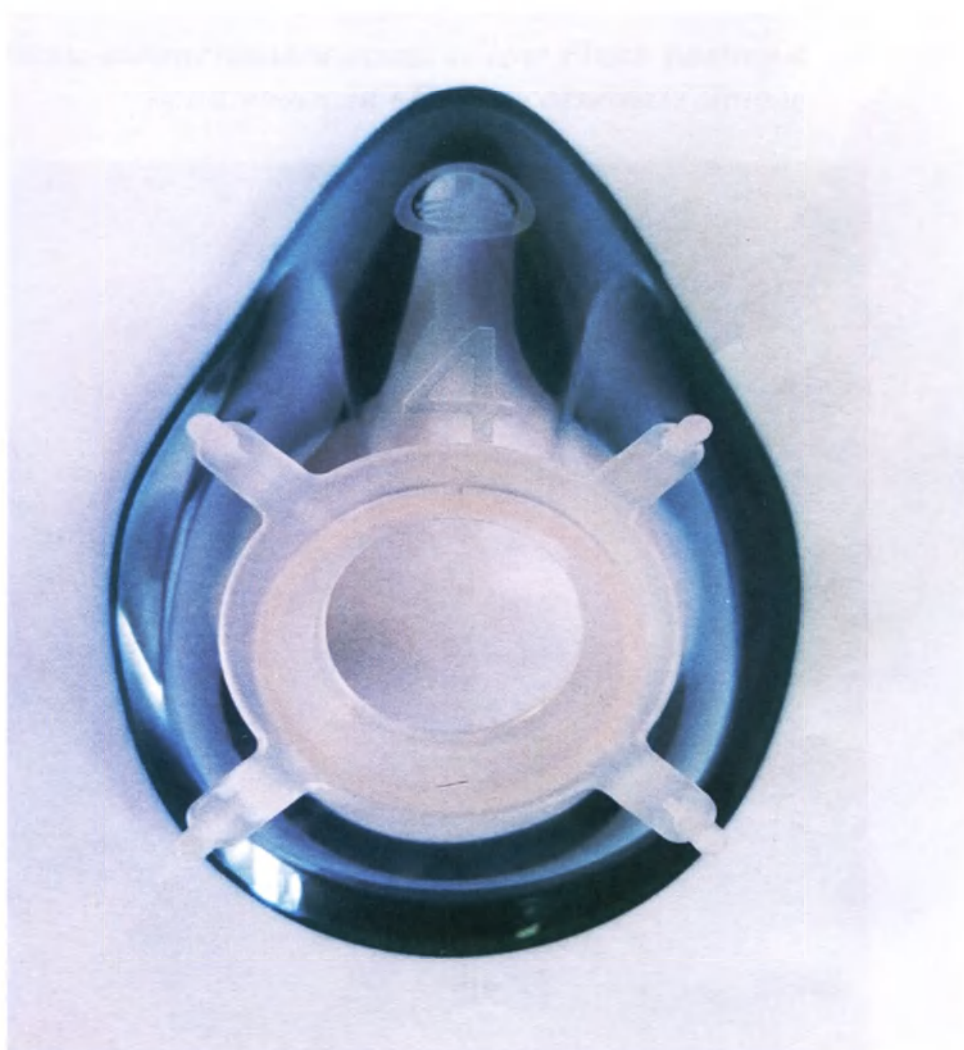


***Маска анестезиологическая «QuadraLite» размер 4, 7194000,
производства «Интерседжикал Лтд.»***



**Маска анестезиологическая «Clear Flex» размер 4, 8848004,
производства «Интерседжикал Лтд.»**



**Маска анестезиологическая «Clear Flex» размер 5, 8848005,
производства «Интерседжикал Лтд.»**

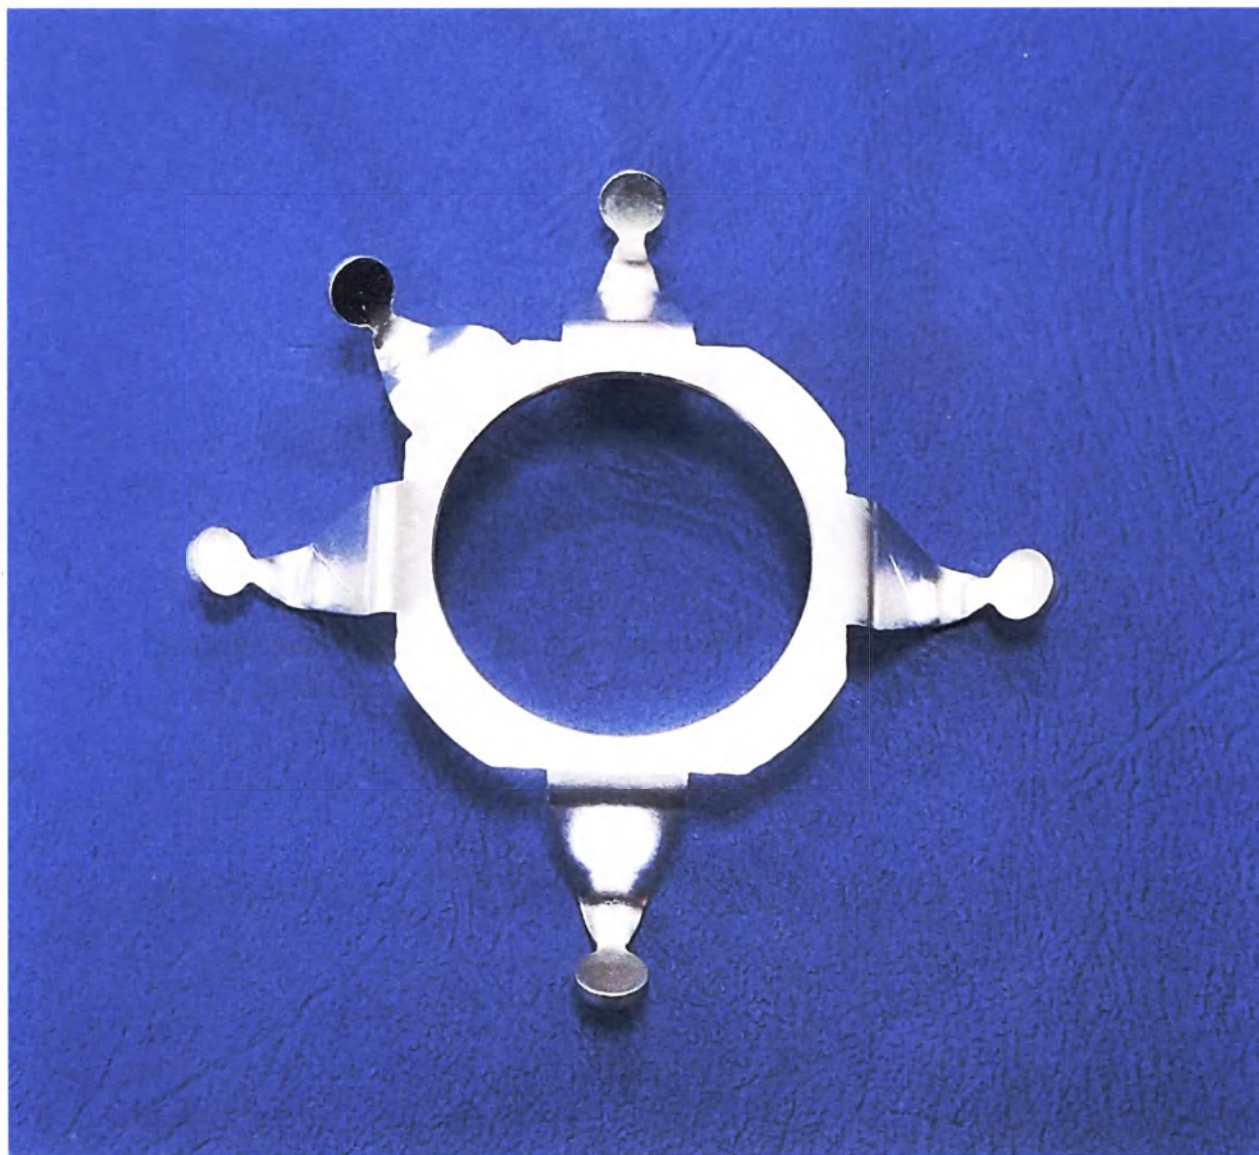


Кольцо-держатель 9B8.126.551



***Воздуховод № 2
1112080***

***Воздуховод № 4
1114100***

***Воздуховод № 3
1113090***

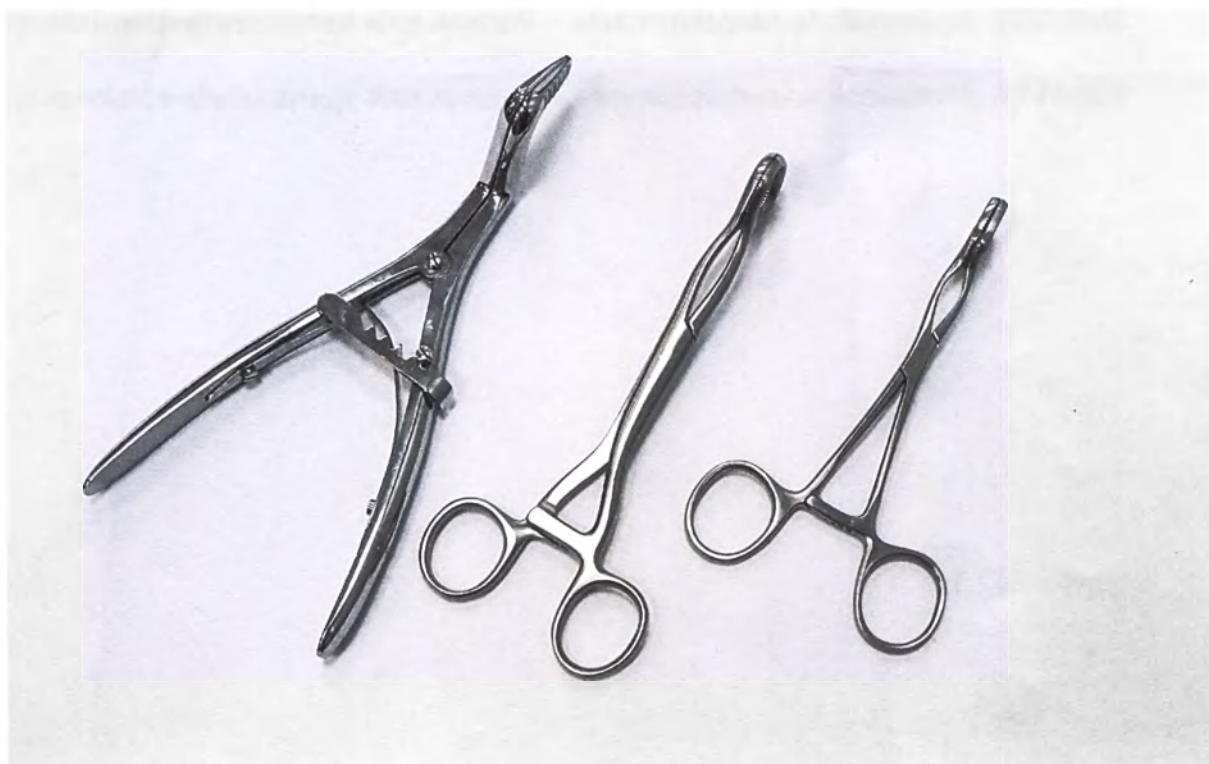

***Роторасширитель с кремальерой, языкодержатель для взрослых,
языкодержатель для детей.***



Держатель-фиксатор для маски – эластомерный головной, 2224000

Держатель-фиксатор для маски – эластомерный головной, 8740008

"Аппарат искусственной вентиляции
легких ГС-16 с пневмоприводом"
ТУ 32.50.21-001-23435930-2017

Исполнение 1 Заводской номер 1418
с баллоном K-2 - 250 (280) и масками Clear Flex: 8848002,
8848004, 8848005
Дата выпуска 21.10



КАМПО

Сделано в России

Ярлык (маркировка упаковки)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
16 (шестнадцать) листов

Начальник секретариата

Баркова
И.Ю. Баркова

