


**Фотографические изображения
Ингалятор ультразвуковой, модели:
UN-231, UN-232, UN-233
с принадлежностями**


UN-231

В стандартный комплект поставки входит:


1. Блок основной в корпусе.

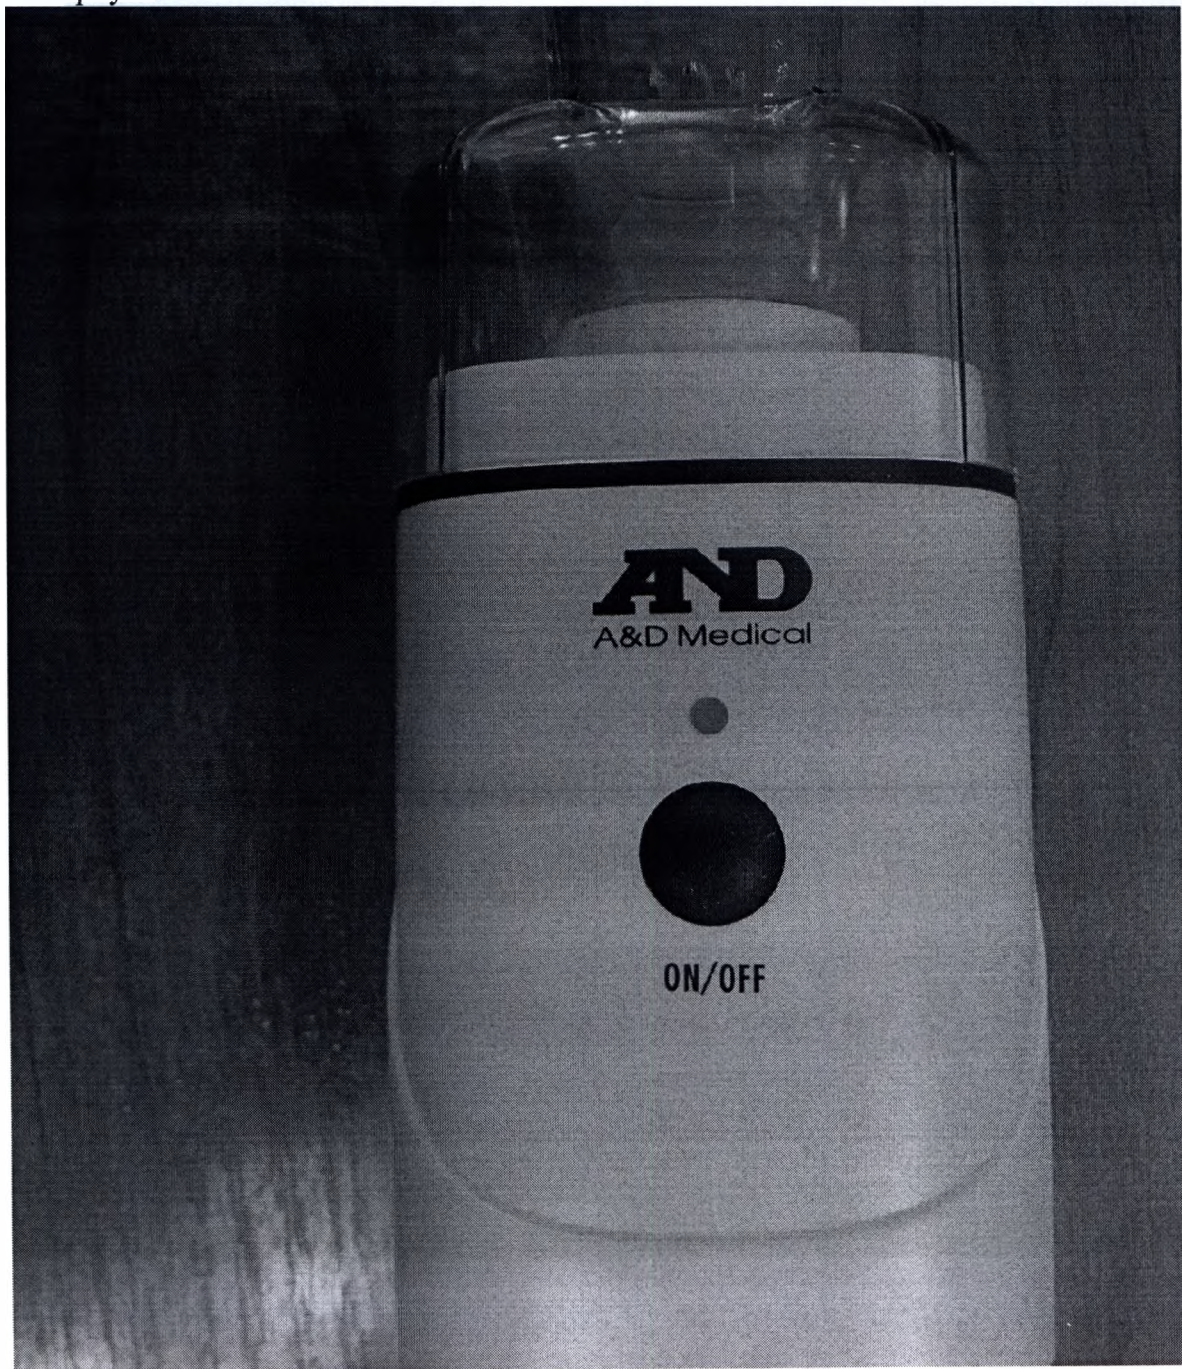

Маркировка

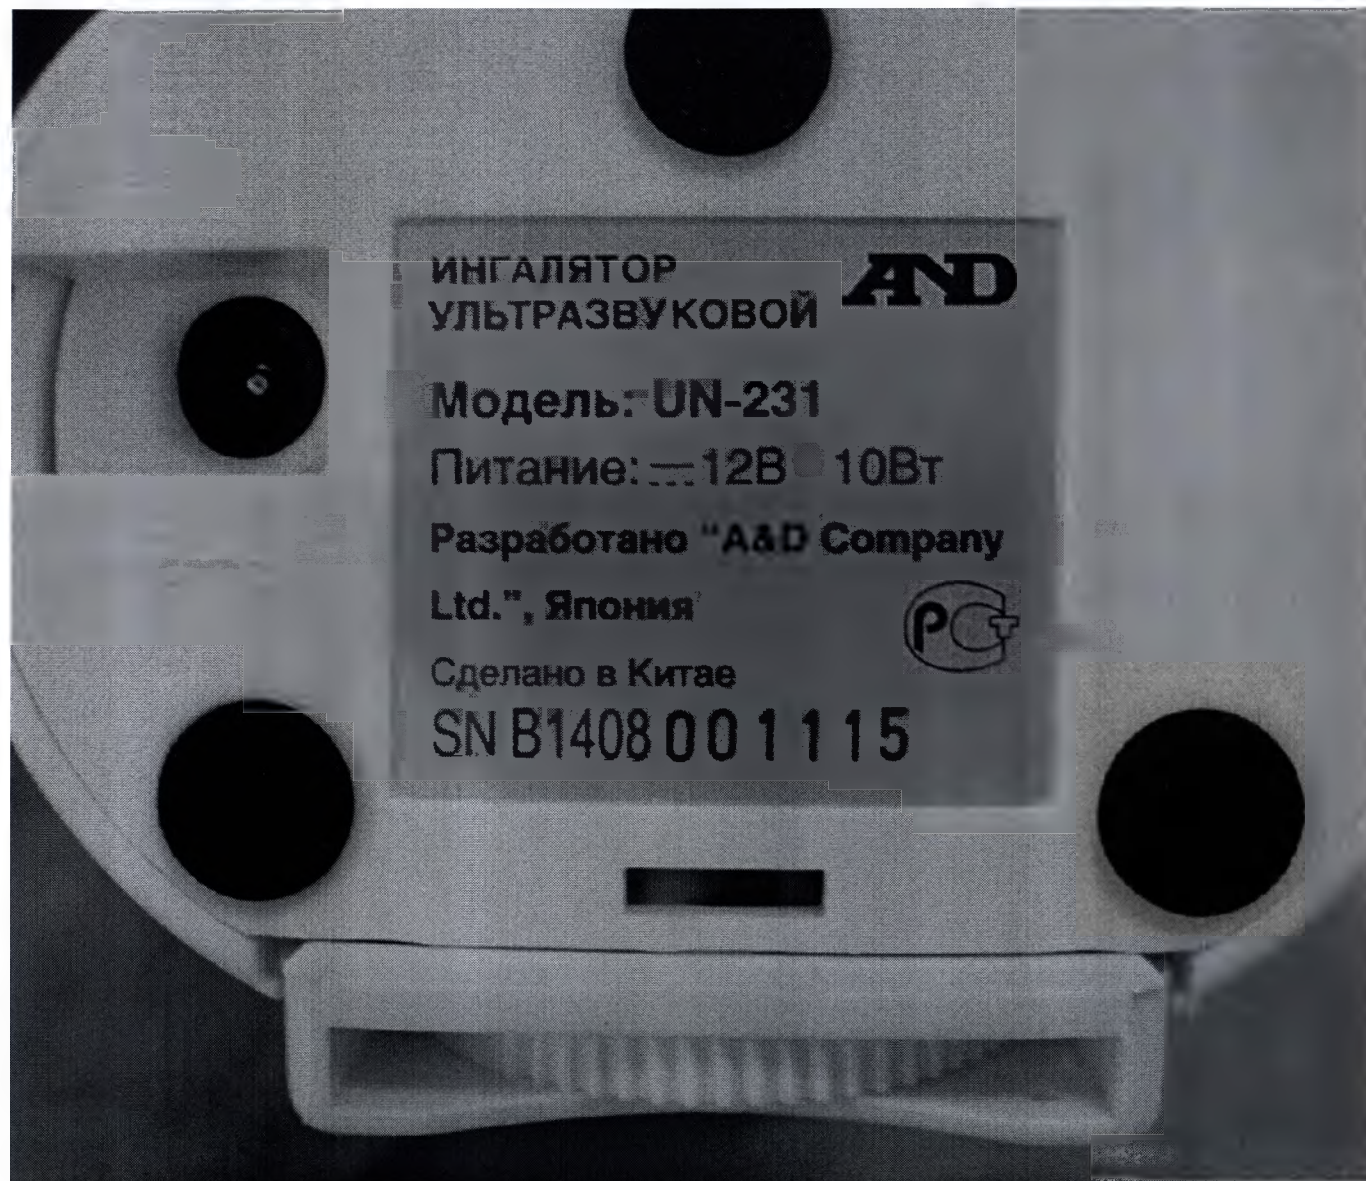


2. Адаптер сетевой.

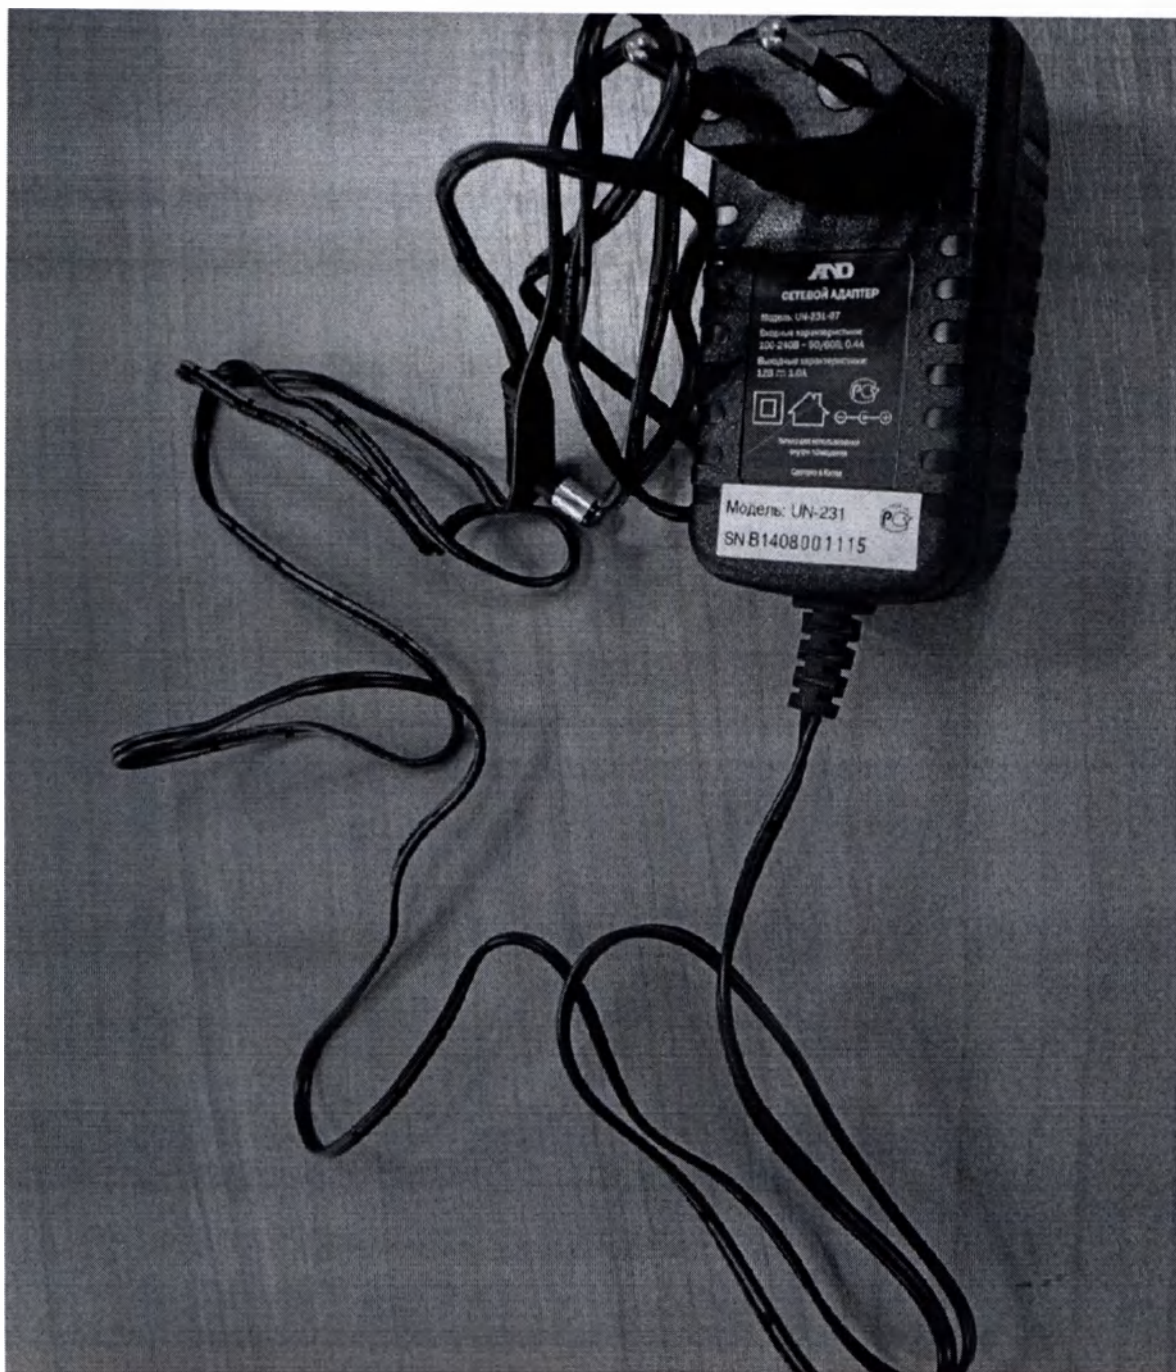


3. Адаптер для автомобиля.




4. Емкость для лекарства.

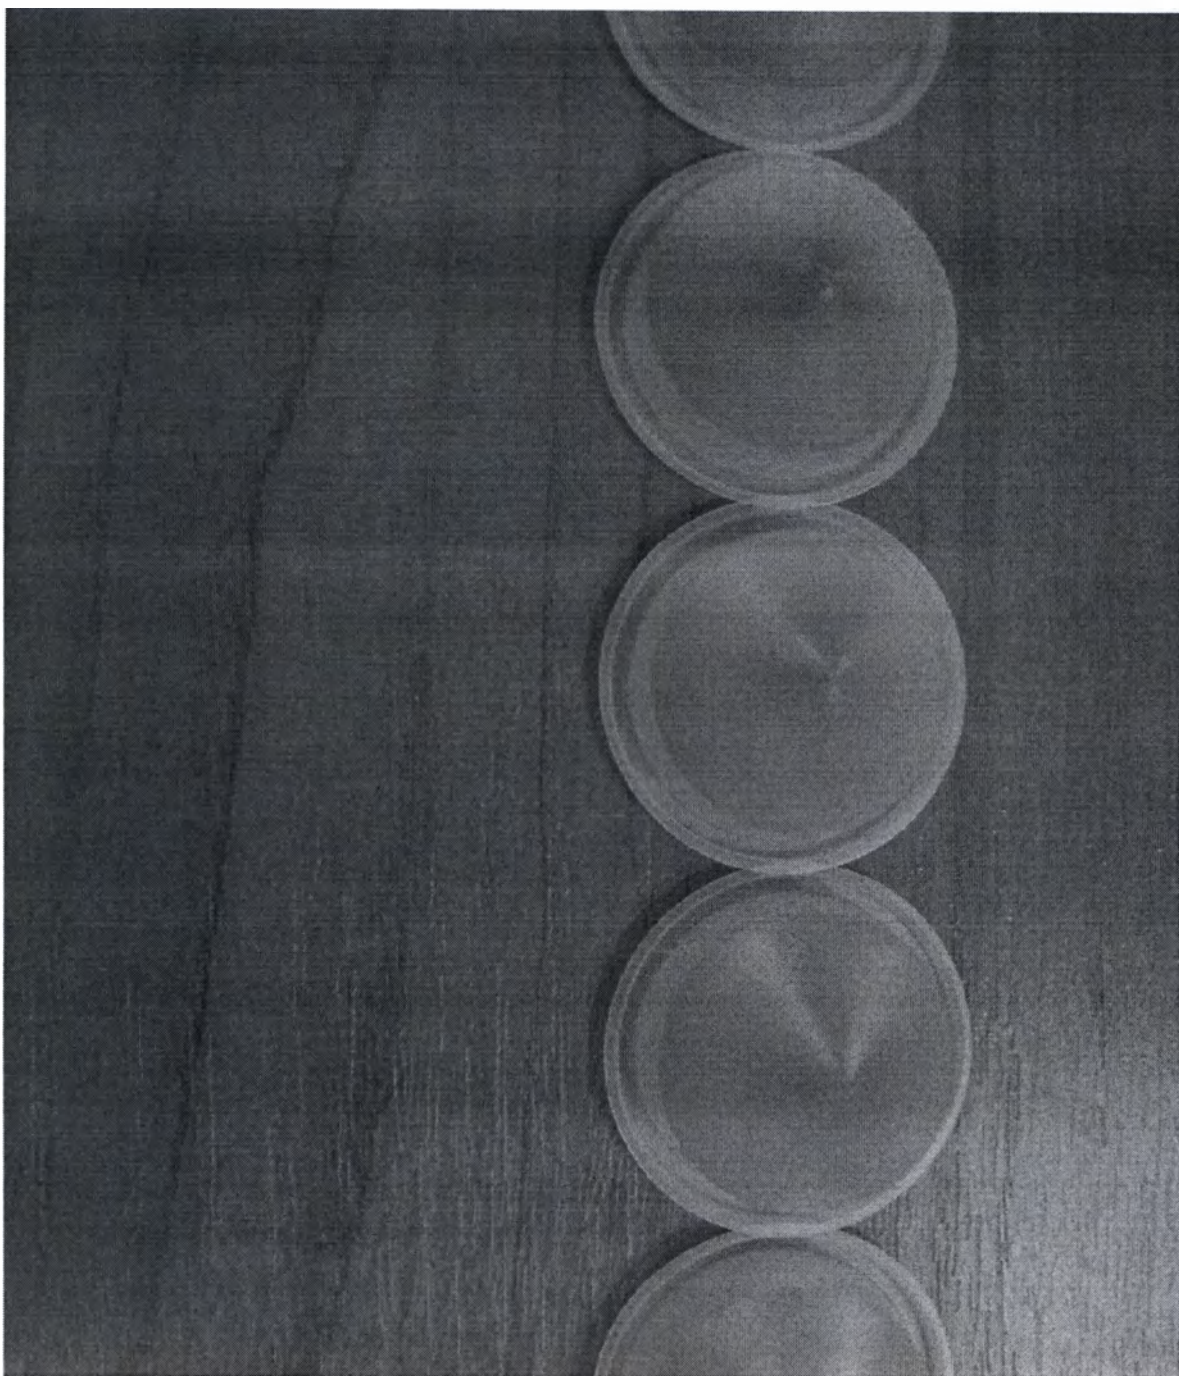


Трубка соединительная – 1 шт.

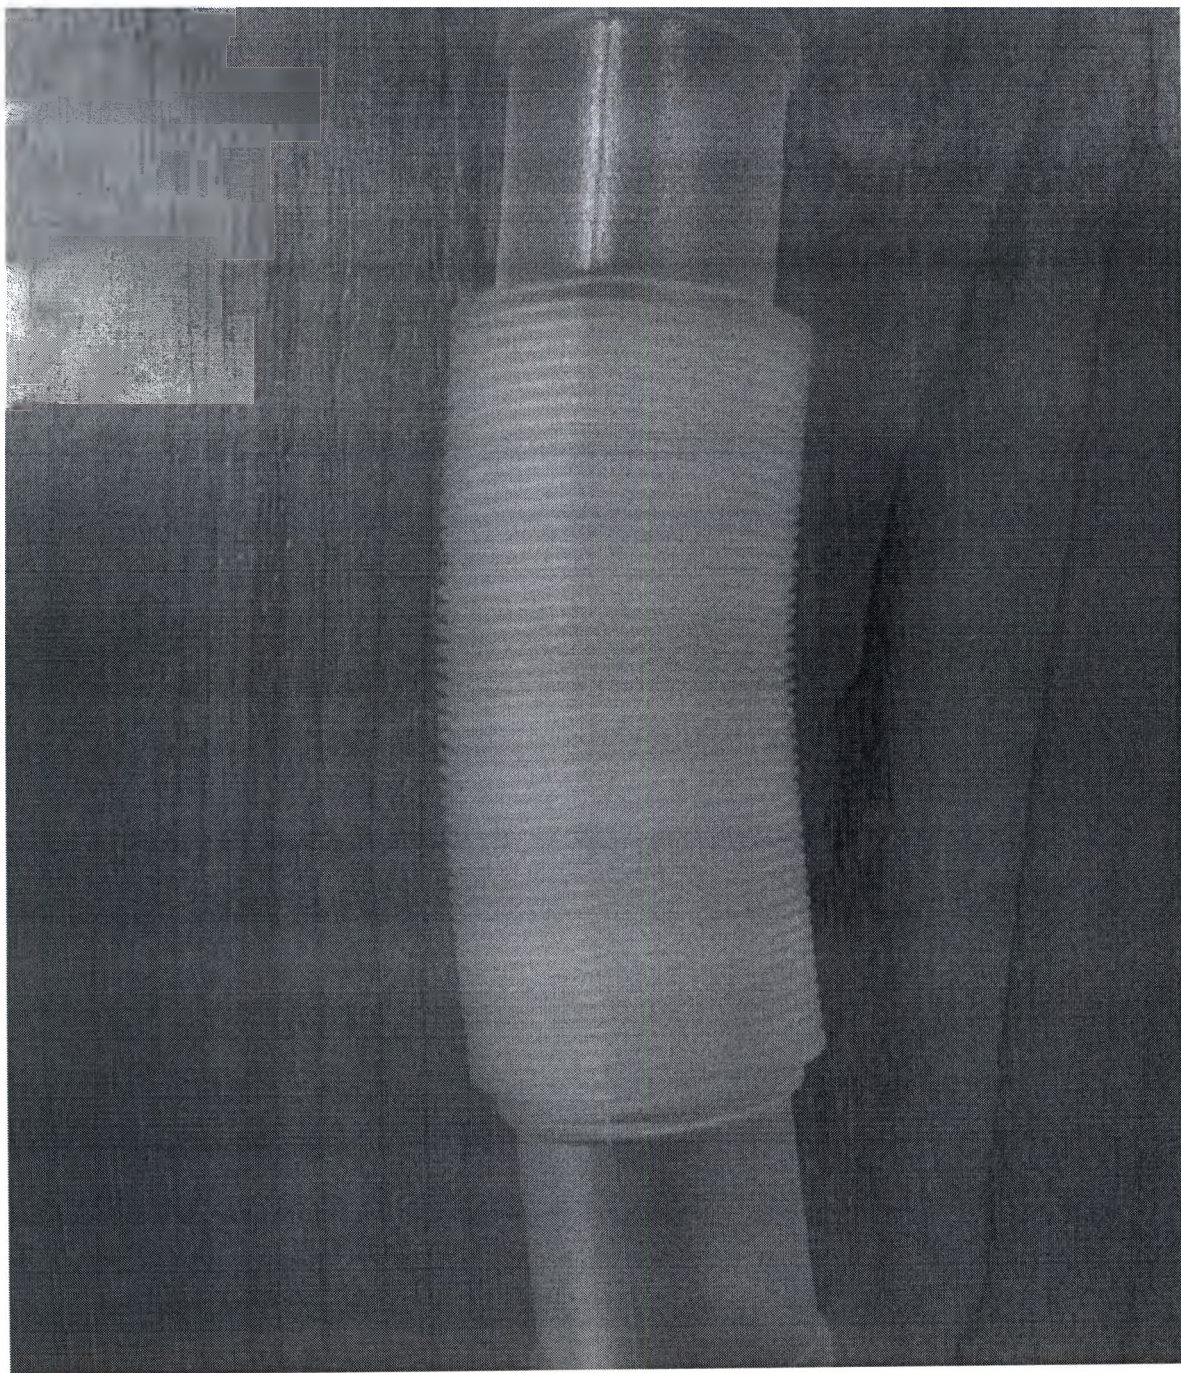

6. Маска для детей.


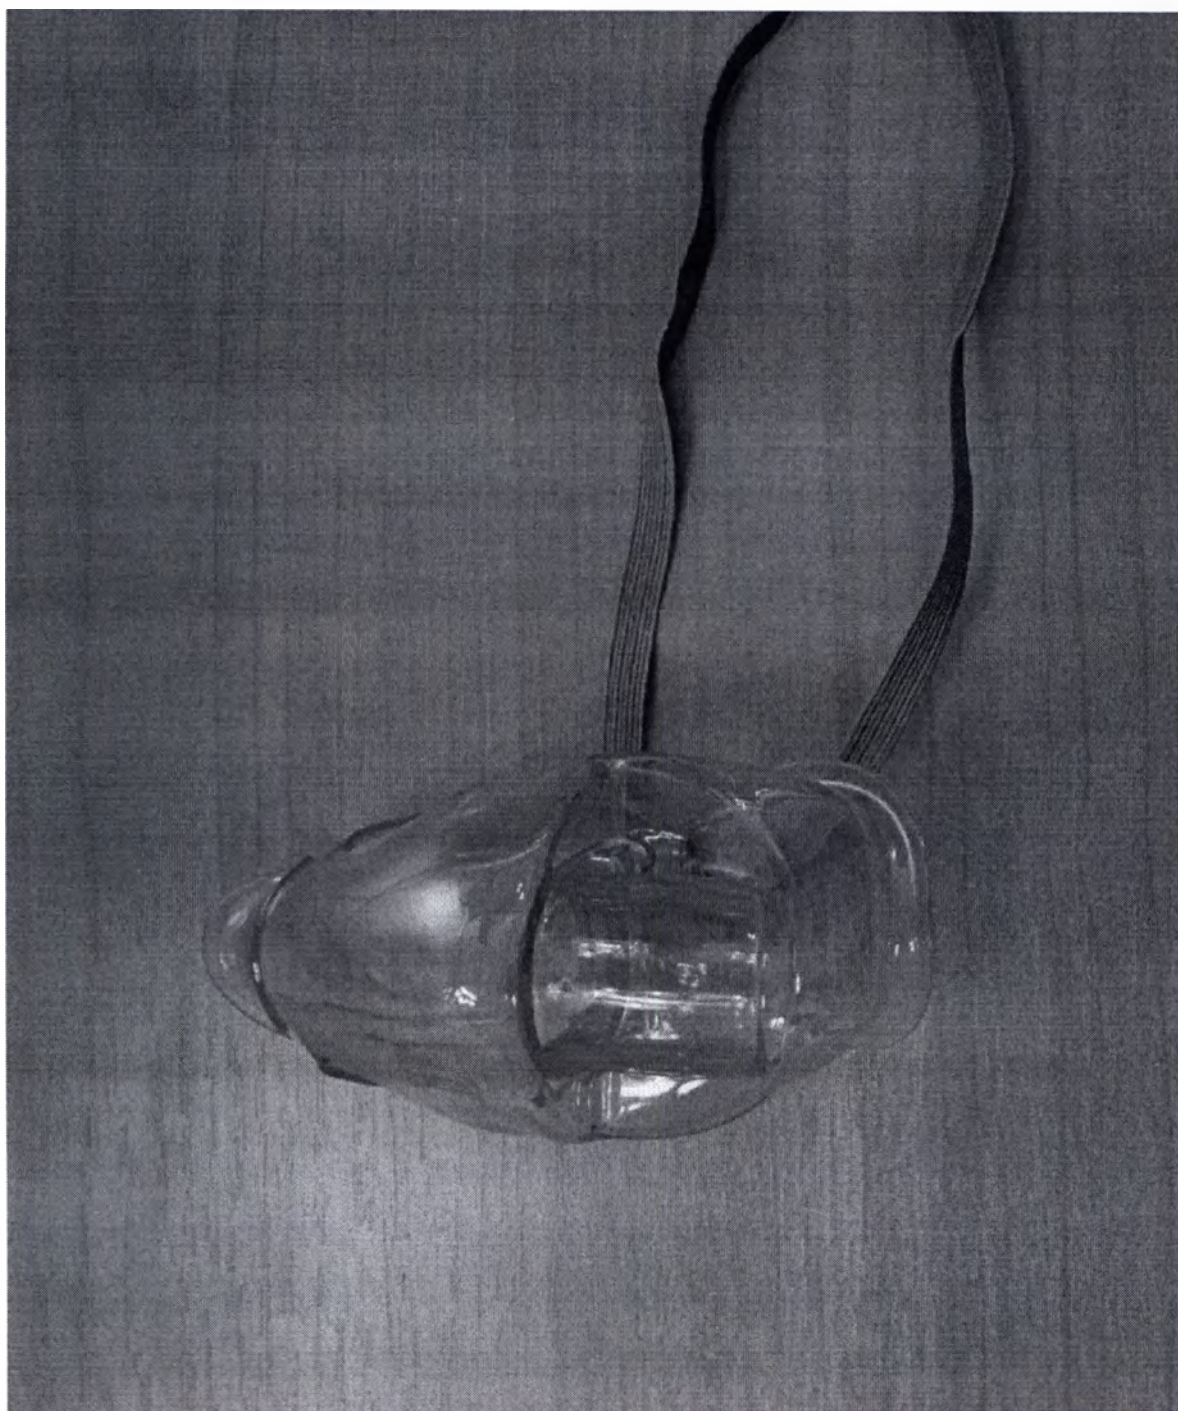


7. Маска для взрослых.


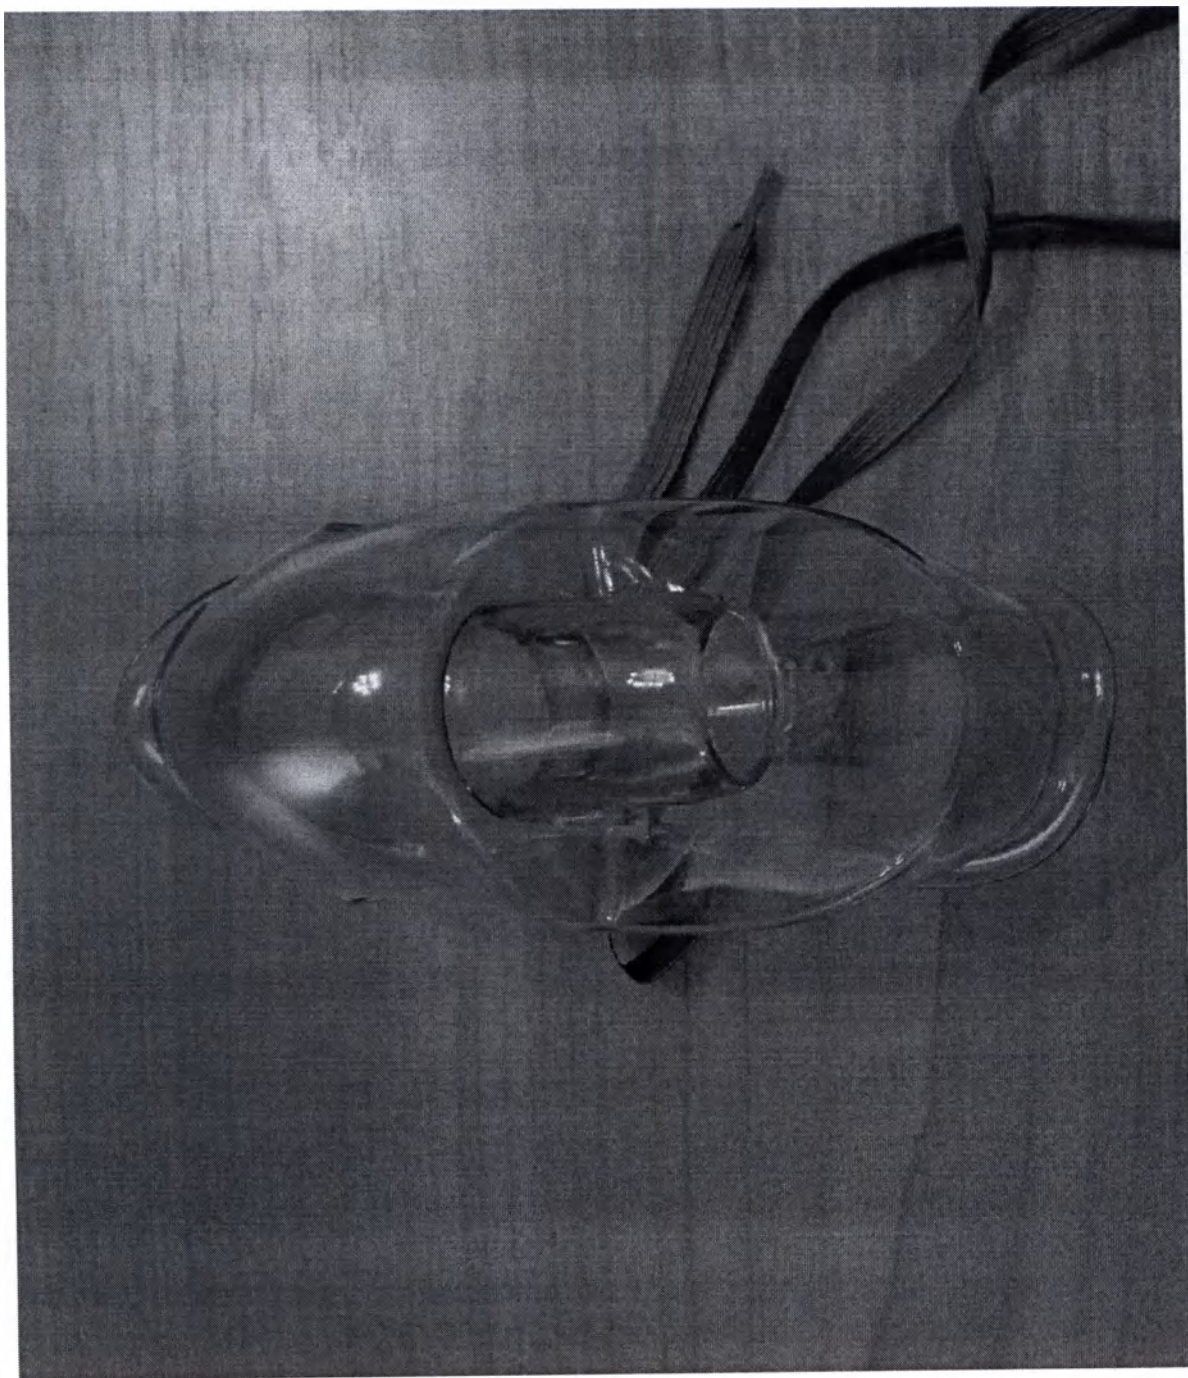


8. Руководство по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



1. Снимите верхнюю прозрачную крышку и, если есть, емкость для деаэрации (рис. 1).
2. Заполните резервуар водой до отмеченного уровня (всегда держите линию внутри резервуара). Температура воды должна быть 20–30°C (рис. 2).
3. Для малой скорости ингаляции используйте воду с низкой температурой. Для высокой скорости ингаляции используйте воду с высокой температурой.
4. Поместите емкость для деаэрации внутри резервуара с водой и заполните ее лекарством (рис. 3, 4).
5. Поместите сверху прозрачную крышку (рис. 5). Различ, находящийся в нижней части прибора (рис. 6) и установите ингалятор на столе.
6. Включите спусковой адаптер в сеть переменного тока.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF (рис. 1). Убедитесь, что горит лампочка индикатора питания. Аэрозоль будет выходить через маску для рта.
2. Поместите прибор на расстоянии двух сантиметров от лица и вдыхайте аэрозоль через рот.
 - Для проведения ингаляции сразу на два вдоха сделайте два вдоха, используя одну маску.
 - Для проведения ингаляции сразу на три вдоха сделайте три вдоха, используя одну маску.
 - Для проведения ингаляции сразу на четыре вдоха сделайте четыре вдоха, используя одну маску.
3. В начале работы приборный индикатор протечки сигнала работает непрерывно, затем через несколько минут становится индикатором завершения ингаляции.
4. Регулируйте поток аэрозоля, используя рычажок выключного фазатора, расположенный на обратной стороне прибора (рис. 5).
 - Пользуясь прибором, переключившись на режим ингаляции, вы можете использовать 30 минут.
 - Максимально вы можете использовать 30 минут.
 - Максимально вы можете использовать 30 минут.
 - Средний срок ингаляции можно проводить не менее, чем через 30 минут.
5. Для окончания ингаляции нажмите кнопку ON/OFF. В обратном случае прибор автоматически отключится через 10 минут.
6. Очистите сеточку и материал маски герметичного типа.
7. Очистите шланг от своего устройства от прибора.

Модель UN-231

— **СЛУЖБА И ЗВУКОВОЗДУШНО ЕКСПЛУАТАЦИЈА**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Важнейшим из них является создание единой системы управления предприятием, позволяющей обеспечить согласованность действий всех подразделений и отделов. Для этого необходимо разработать единую систему показателей, позволяющую оценить эффективность работы каждого подразделения и отдела. Кроме того, необходимо создать единую систему отчетности, позволяющую получать информацию о работе предприятия в реальном времени. Это позволит оперативно реагировать на изменения в рыночной среде и принимать необходимые меры.

BY APPOINTMENT ONLY

- [illegible]

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Модель: UN-231

Серийный номер: SN B1408001115

Дата продажи:

Число

Месяц

Год

ВНИМАНИЕ!

Гарантия действительна только при наличии печати продавца.

Комплектация и работа прибора во всех режимах проверены в присутствии покупателя

Печать фирмы продавца

Подпись покупателя

Регулярный контроль измерителей артериального давления и термометров

Прибор поверен и на основании поверки признан годным к эксплуатации. Клеймо поверки находится на корпусе прибора.

Периодическая поверка средств измерений на заводе-изготовителе O Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. согласно протоколам заседаний метрологической комиссии по

AND

Эй энд Ди, Япония

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

приложение к паспорту

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь в том, что фирма правильно и четко заполнила гарантийную карту и паспорт. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Эй энд Ди нуждается в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр ООО «Эй энд Ди РУС». При отсутствии в Вашем регионе центра ООО «Эй энд Ди РУС», отправьте изделие вместе с паспортом и чеком в ближайший сервисный центр.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 года медицинские приборы и аппараты входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другой марки, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В соответствии со статьей 18 закона РФ от 07.02.92 «О защите прав потребителей» при возникновении спора по поводу возникновения недостатков товара продавец или исполнитель, выполняющий функции продавца, обязан провести экспертизу.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые продавец, потребитель обязан возместить расходы на проведение экспертизы, выполняющей функции продавца, продавец обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ней расходы на транспортировку товара.



11. Коробка.



AND
A&D Medical

**Ультразвуковой
ИНГАЛЯТОР**
Модель UN-231

- Управление одной кнопкой
- Плавная регулировка воздушного потока
- Взрослая и детская маски
- Встроенный таймер на 10 мин.
- Бесшумен при работе

Сетевой Адаптер 220 В

Легкий
Всего 185 грамм


5 лет

**ФАКТОР
ЯПОНСКОГО
КАЧЕСТВА**

UN-232

В стандартный комплект поставки входит:

1. Корпус прибора.

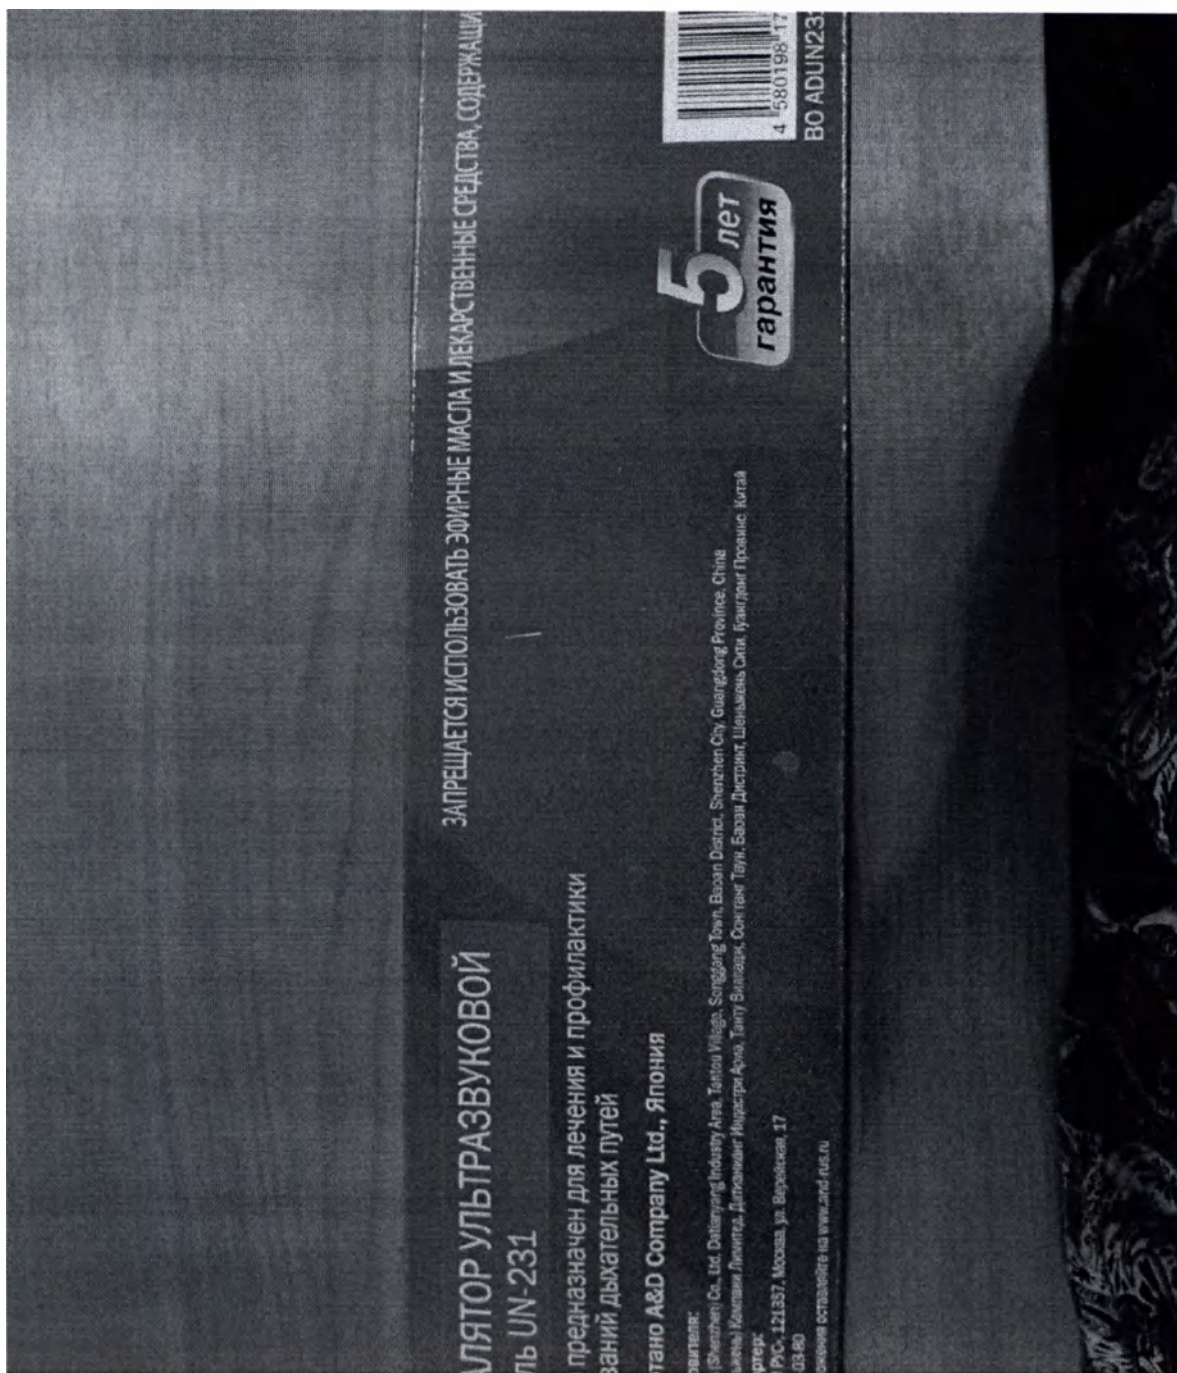



UN-232



SN 51401 00014

Игальатор ультразвуковой


A&D

Модель: UN-232

Питание: ~220В, 50Гц, 170 Вт

Разработано "A&D Company Ltd.", Япония
Сделано в Китае




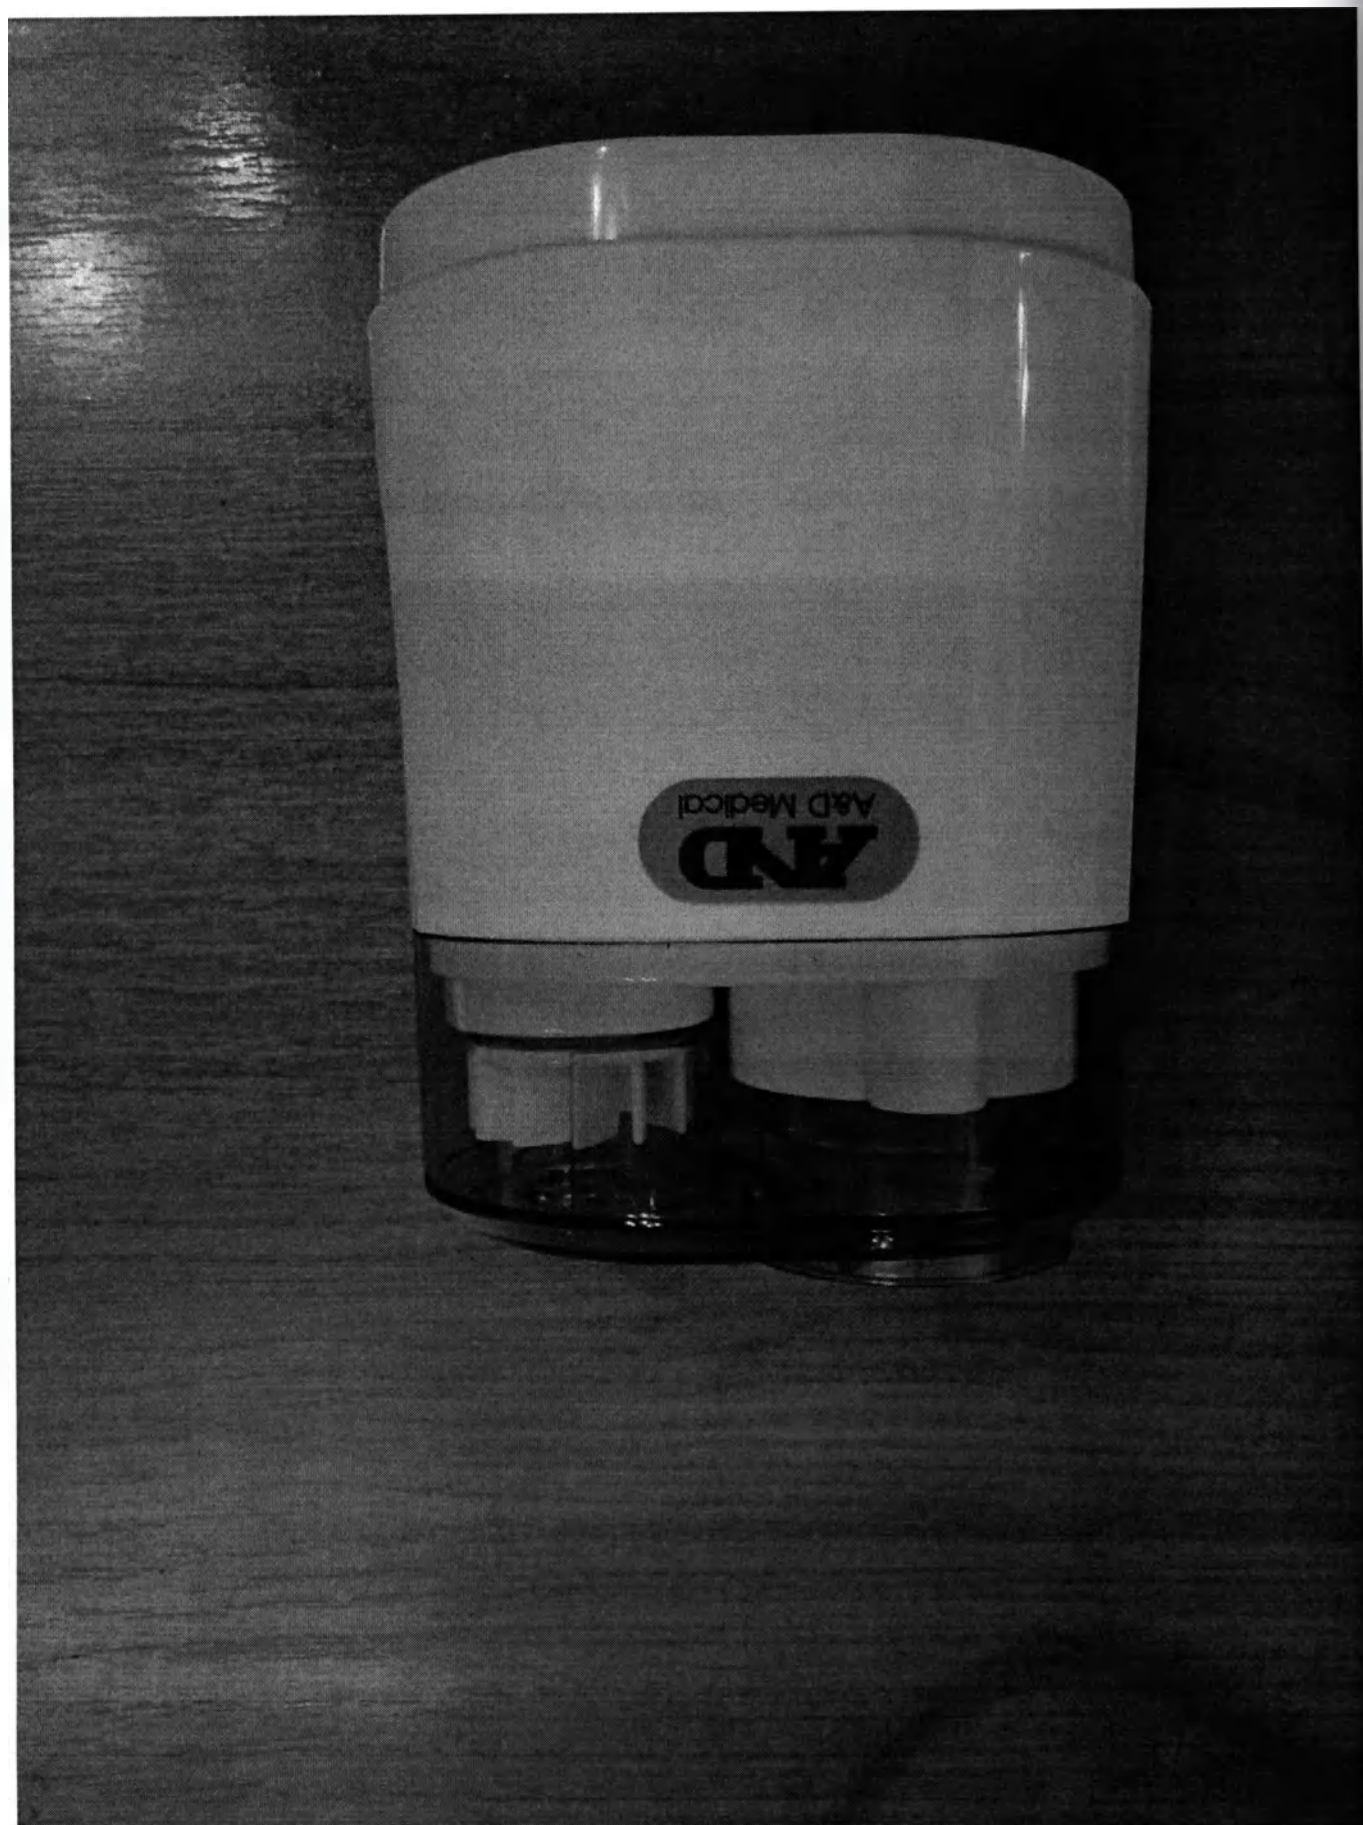

3. Защитный элемент.



4. Респираторная маска.

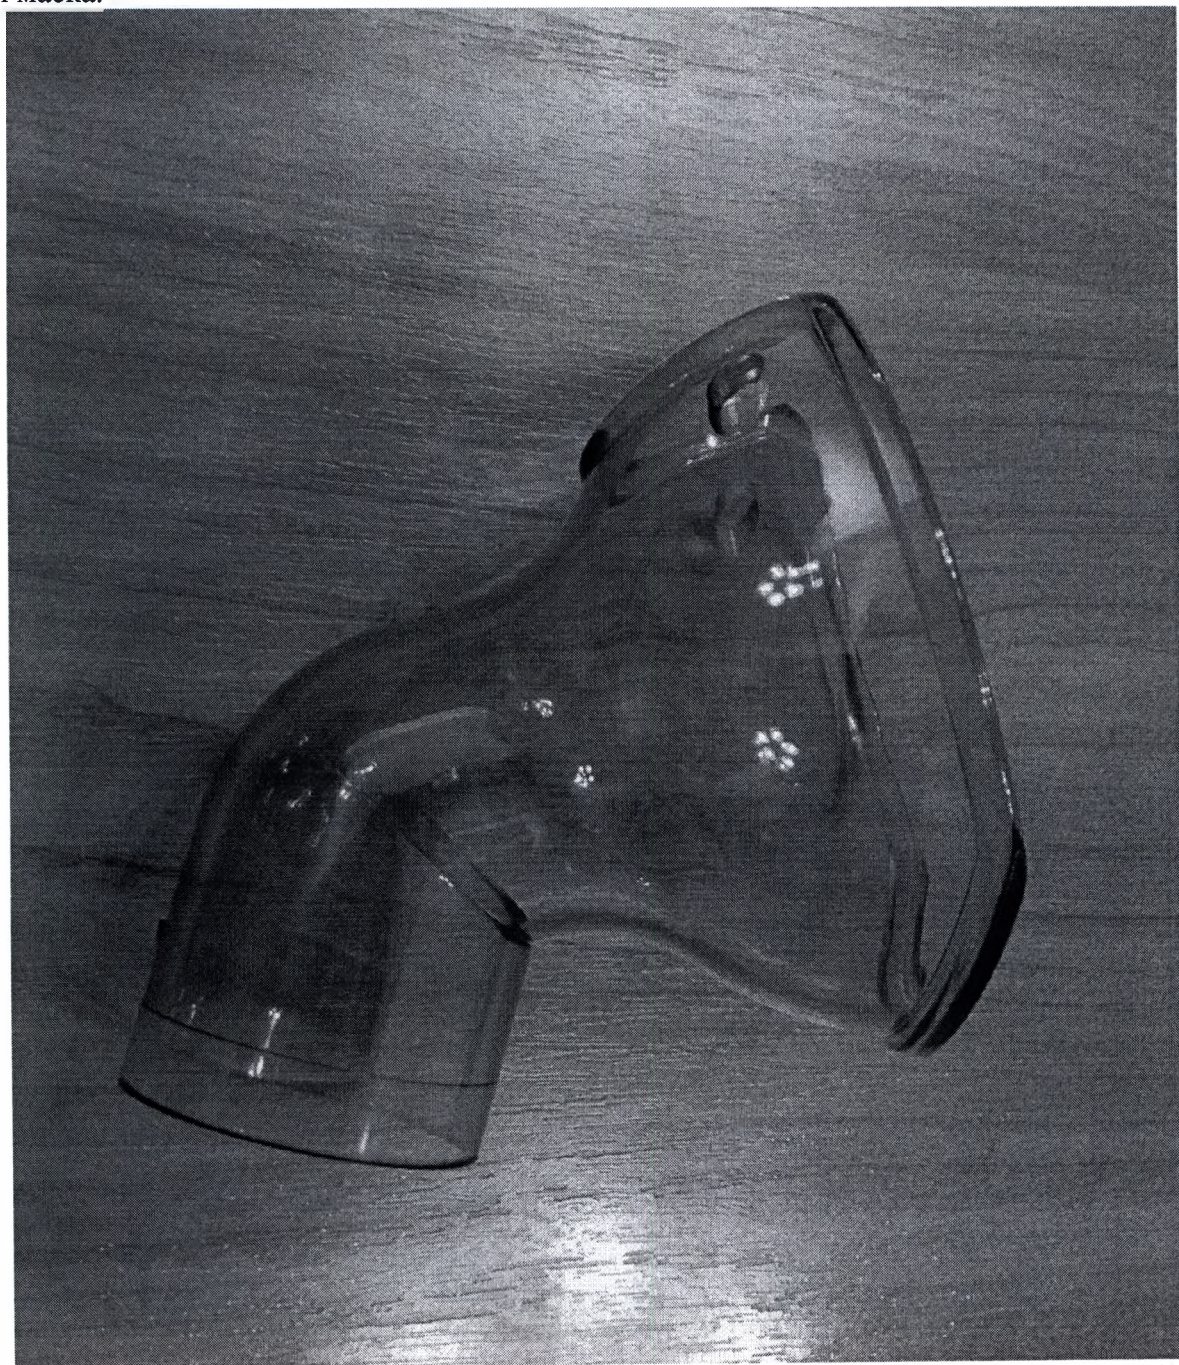

5. Руководство по эксплуатации.



Модель UN-232



1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструмент маркировки АД-0 (30 шт.) для бланков для получения идентификационного индикатора, позволяющего на основе данных, полученных при помощи прибора, быть уверенным, что техника маркировки, надежна и достоверна. В комплект этого прибора, Вы получите, подробные инструкции по эксплуатации и руководство по эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для маркировки и получения идентификационного индикатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- При работе с прибором не касаться его металлических частей.
- Не допускать попадания воды на поверхность корпуса и на органы управления.
- Не использовать прибор в условиях повышенной влажности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной температуры.
- Не использовать прибор в условиях повышенной вибрации.
- Не использовать прибор в условиях повышенной запыленности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной загазованности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной радиации.
- Не использовать прибор в условиях повышенной электромагнитной помехи.
- Не использовать прибор в условиях повышенной влажности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной температуры.
- Не использовать прибор в условиях повышенной вибрации.
- Не использовать прибор в условиях повышенной запыленности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной загазованности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной радиации.
- Не использовать прибор в условиях повышенной электромагнитной помехи.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ МАСЛА.

- Перед началом эксплуатации прибора необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- При работе с прибором необходимо соблюдать следующие правила:
- Не использовать прибор в условиях повышенной влажности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной температуры.
- Не использовать прибор в условиях повышенной вибрации.
- Не использовать прибор в условиях повышенной запыленности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной загазованности.
- Не использовать прибор в условиях повышенной радиации.
- Не использовать прибор в условиях повышенной электромагнитной помехи.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Длительное хранение.
- Резервация данных и результатов.
- Уникальный код для данных и результатов.
- Интервал работы на 5 минут.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типовые	АС220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	170 Вт
Аппаратный размер	10 мм
Разрешение	Разрешение "NORMAL" - 1.0 мм/мин Разрешение "HIGH" - 1.6 мм/мин
Длительность цикла работы	5 мин
Температура хранения	Около 42 °C
Максимальная влажность	20 мм
Максимальная температура	40-45-50 мм

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

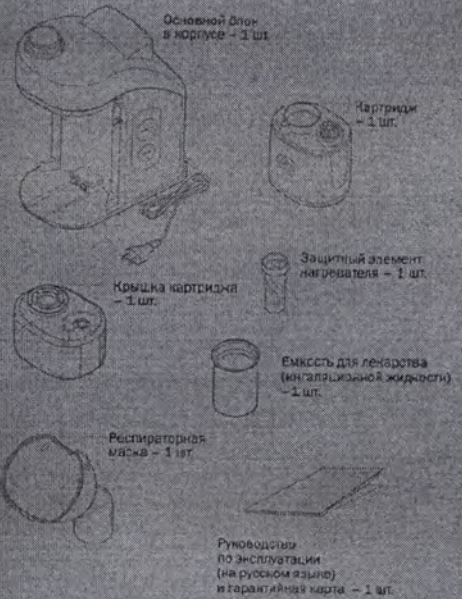

3 СБОРКА ПРИБОРА

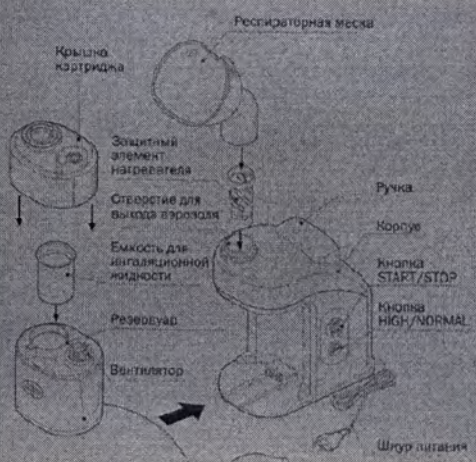

Гарантийная карта.

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи:

--	--

Число

--	--

Месяц

--	--	--	--

Год

ВНИМАНИЕ!

Настоящая гарантия действительна только при наличии печати фирмы-продавца.

Комплектация и работа прибора во всех режимах проверены в присутствии покупателя

Печать фирмы продавца

Подпись покупателя

Метрологический контроль
(для измерителей артериального давления и термометров)

Прибор поверен и на основании результатов поверки признан годным к применению. Клеймо поверки находится на наклейке с серийным номером на корпусе прибора.

Первичная поверка средств измерений проводится на заводе-изготовителе "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", КНР, согласно протоколам заседаний Научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Ростехрегулирования.

Периодическая поверка

A&D
Эй энд Ди, Япония

**ГАРАНТИЙНАЯ
КАРТА**
прилагается к паспорту

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Эй энд Ди нуждается в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр ООО «Эй энд Ди РУС». При отсутствии в Вашем регионе Сервисного центра ООО «Эй энд Ди РУС», отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 года медицинские приборы и аппараты входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В соответствии со статьей 18 закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» при возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец или организация, выполняющая функции продавца, обязана провести экспертизу.

Если в результате экспертизы будет установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель вправе возместить продавцу или организации, выполняющей функции продавца, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

A&D
A&D Medical

ДЕЙСТВЕННО УДОБНО КАЧЕСТВЕННО

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНГАЛЯТОР

Подогрев аэрозоля

Универсальная маска для детей и взрослых в комплекте
Регулировка скорости распыления
Встроенный термометр

Модель UN-232

НАСТОЯЩЕЕ
ЯПОНСКОЕ
КАЧЕСТВО

5 лет
гарантия





ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Модель UN-232



ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Производитель: A&D Company, Limited / Эй энд Ди Компани, Лимитед

Юридический адрес: 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama, 108 0072 Japan / 1-243, Асахи, Китамото-ши, Сайтама, 108 0072, Япония

Фактический адрес: 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo 170-0013, Japan / 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Токио-ку, Токио, 170 0013, Япония

Производственный подразделение: A&D (Shanghai) Company Co., Ltd. / Эй энд Ди Компани (Шанхай) Ко. Лтд.

Адрес производственного подразделения: Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Baoshan District

Шанхай, Китай / Дантянян Индустриальный Район, Тантоу Виллидж, Сонганг Таун, Баошан Район, Шанхай, Китай

Импортер:

ООО «Эй энд Ди Рус», 121357, Москва, ул. Верейская, д. 17

Тел.: 8 800-200-03-80; факс: 8 800-200-03-80; e-mail: info@cirml.ru

BO ADUN2320912



4 981046 350020


В стандартный комплект поставки входит:

1. Блок основной в корпусе.



Маркировка




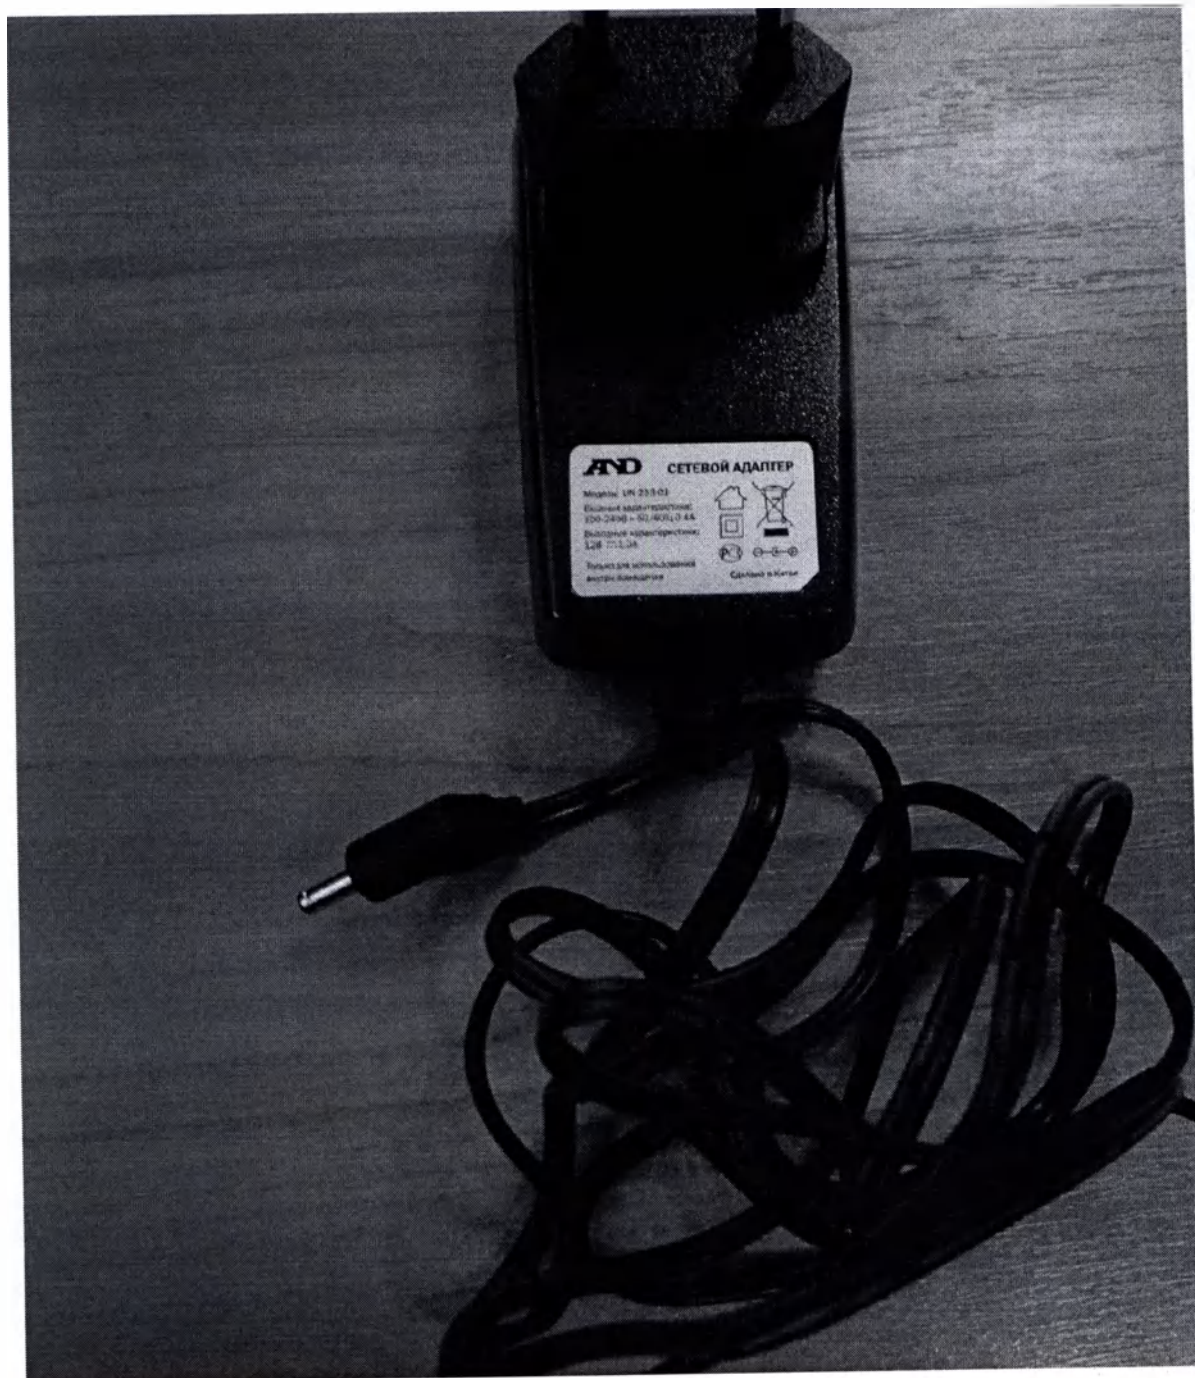

3. Емкость для лекарства.




4. Насадка для рта.

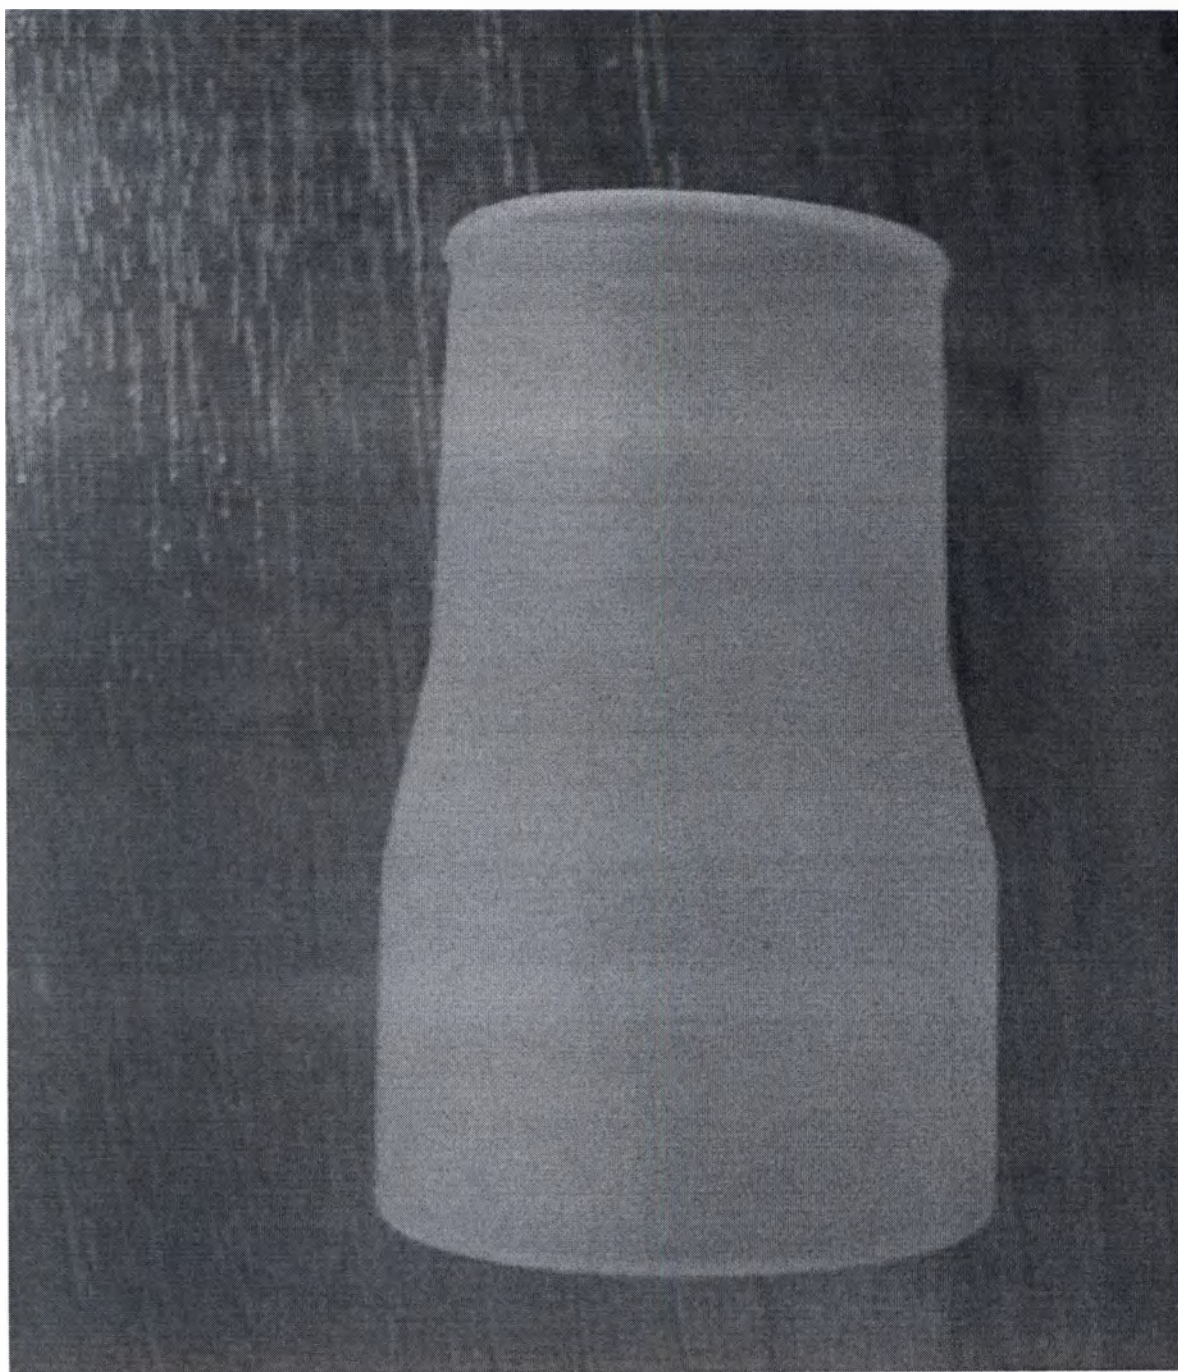


5. Элементы питания - 2шт.




6. Маска для детей с соединительной трубкой.

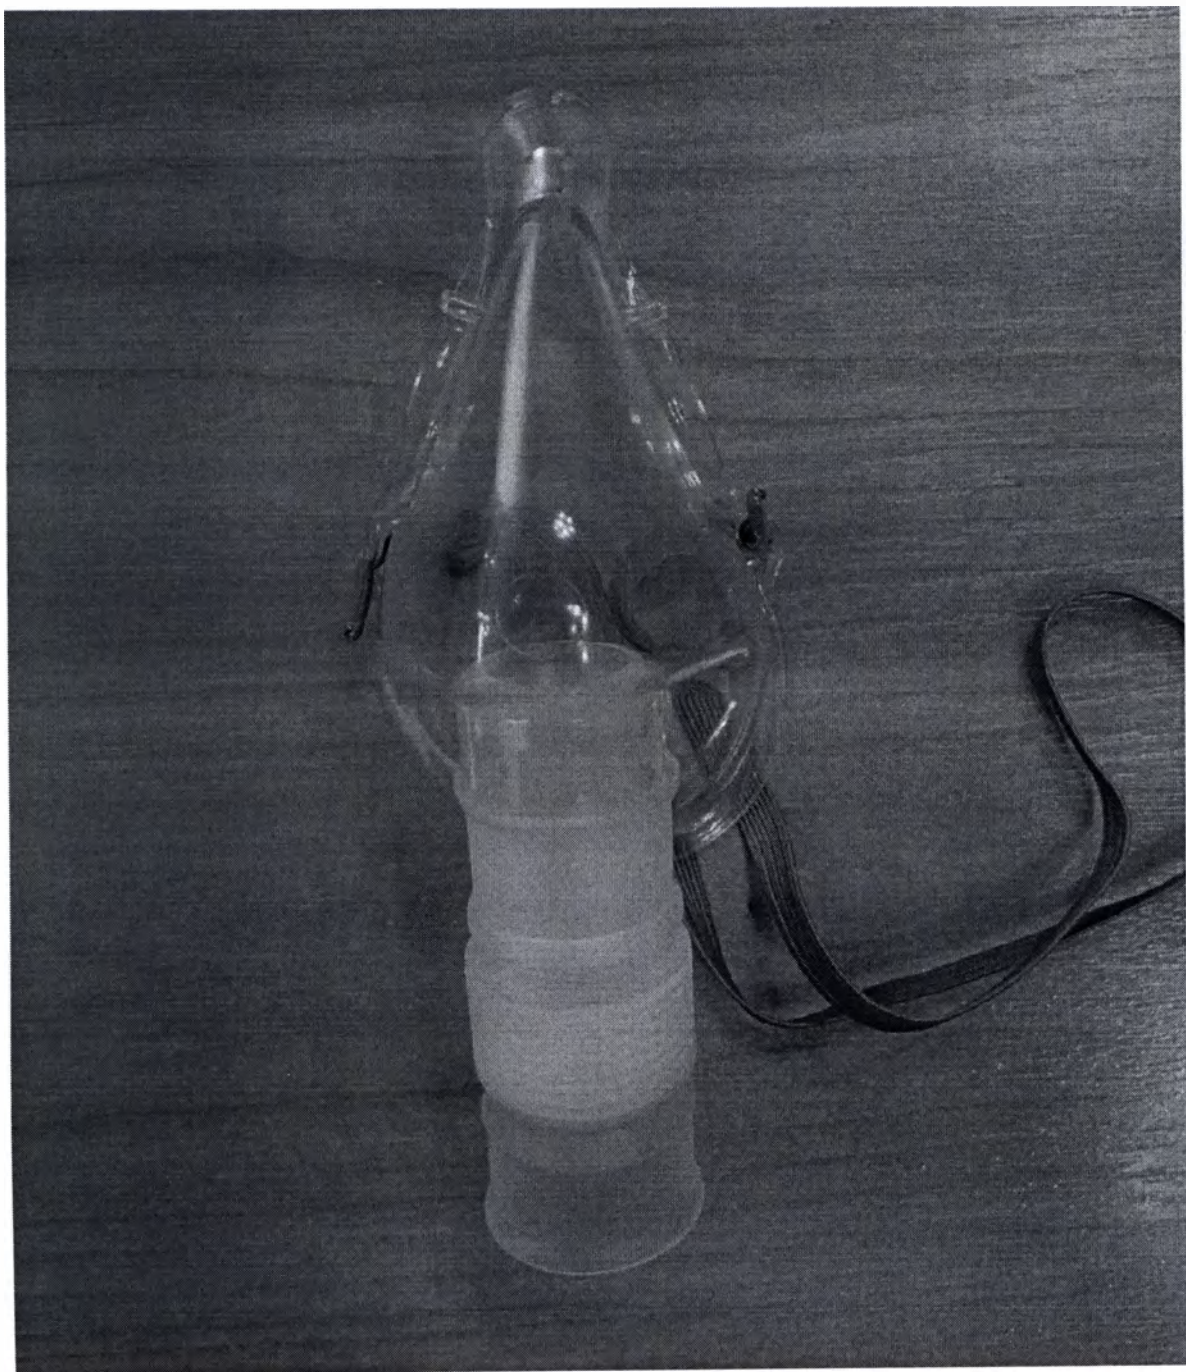

7. Маска для взрослых с соединительной трубкой.

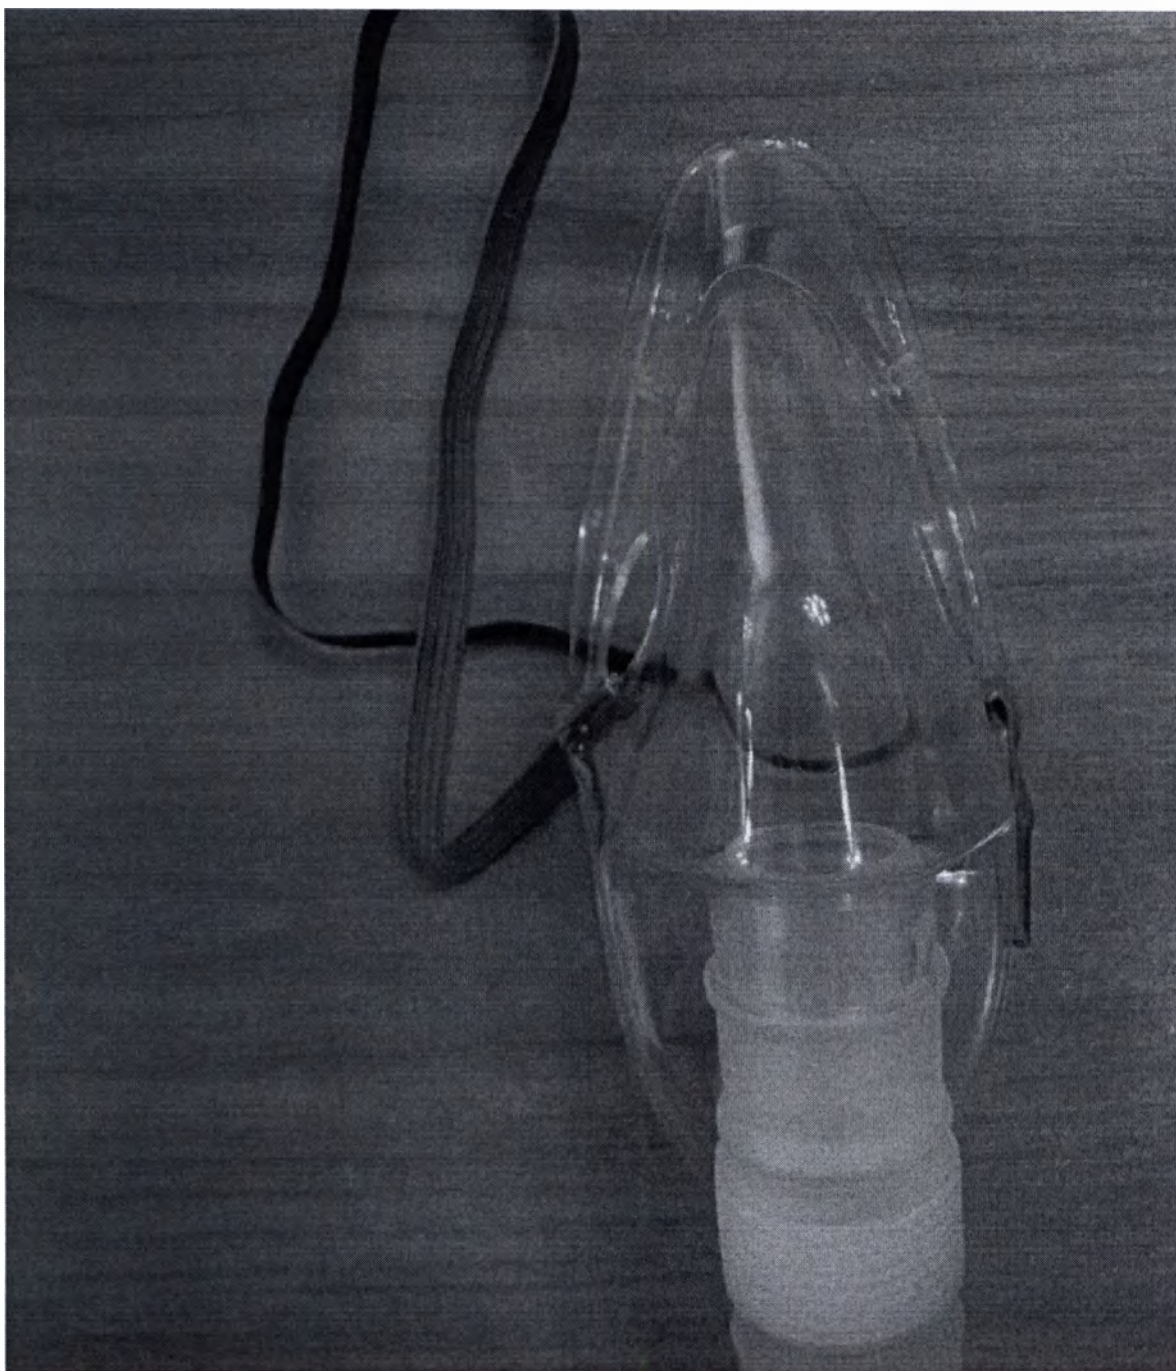

8. Руководство по эксплуатации.

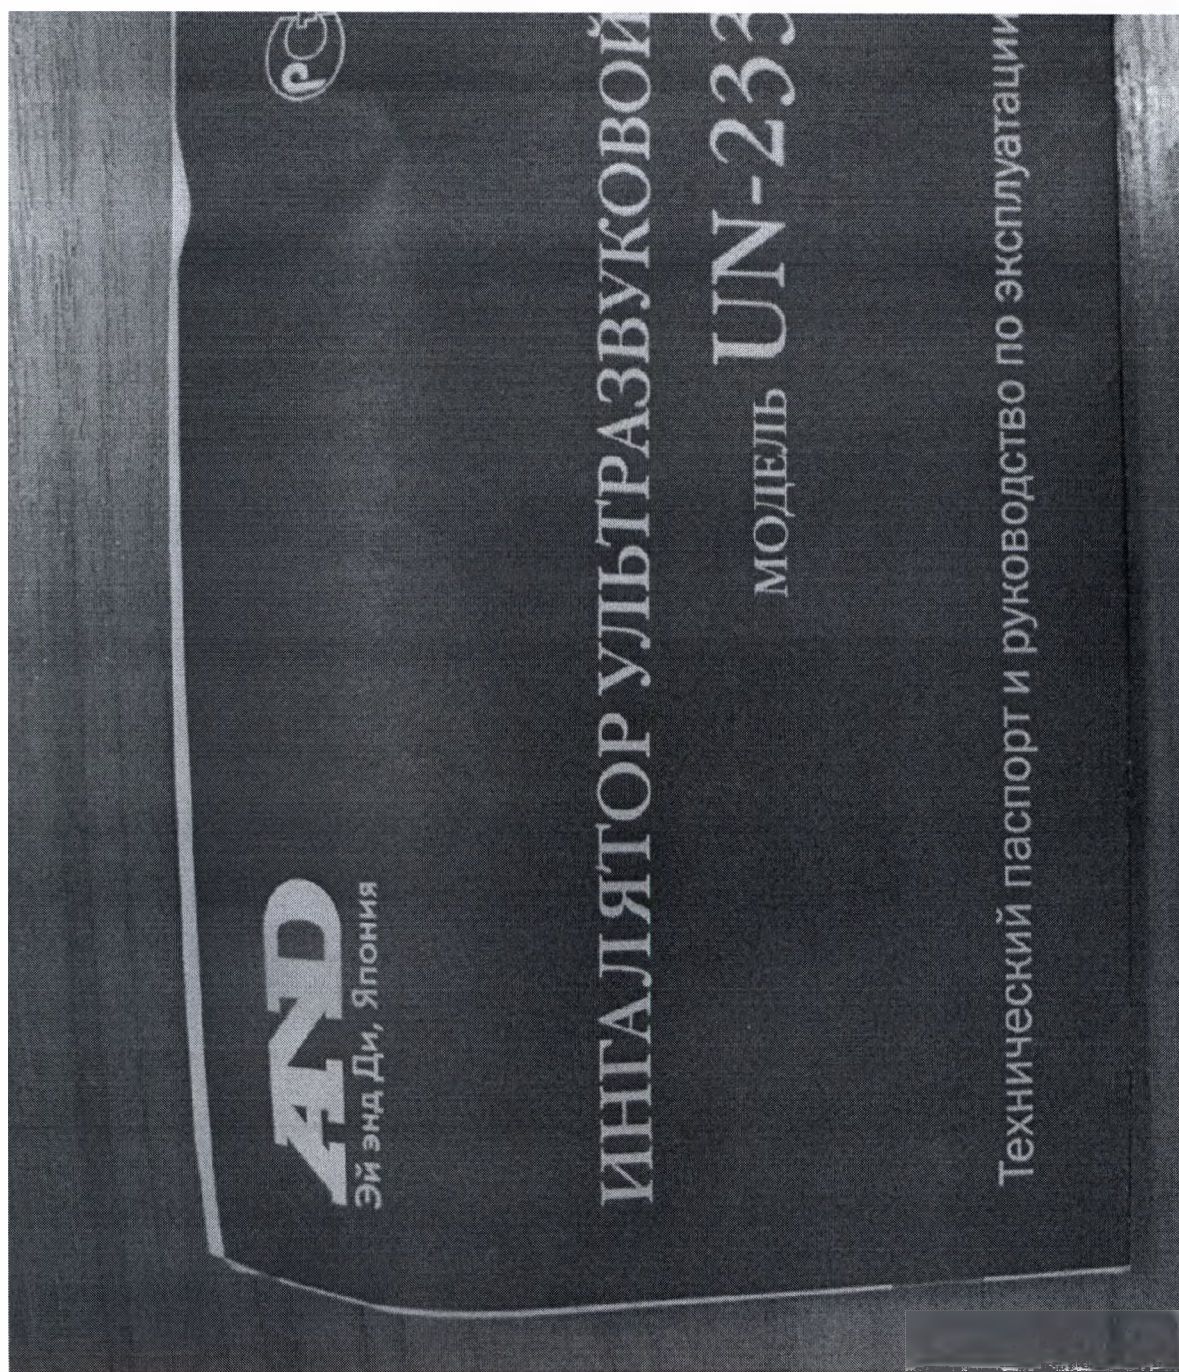

9. Карта гарантийная.

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи:

--	--

Число

--	--

Месяц

--	--	--	--

Год

ВНИМАНИЕ!

Настоящая гарантия действительна только при наличии печати фирмы-продавца.

Комплектация и работа прибора во всех режимах проверены в присутствии покупателя

Печать фирмы-продавца

Подпись покупателя

Метрологический контроль
(для измерителей артериального давления и термометров)

Прибор проверен и на основании результатов поверки признан годным к применению. Клеймо поверки находится на наклейке с серийным номером на корпусе прибора.

Первичная поверка средств измерений проводится на заводе-изготовителе "A&D Electronics (Shenzhen) Co. Ltd.", КНР, согласно протоколам заседаний Научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Ростехрегулирования.

Периодическая поверка

A&D
Эй энд Ди, Япония

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

приложение к паспорту

Уважаемый покупатель!


При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила ее. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Эй энд Ди нуждается в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр ООО «Эй энд Ди РУС». При отсутствии в Вашем регионе Сервис-центра ООО «Эй энд Ди РУС», отправьте изделие вместе с паспортом неисправности в ближайший сервисный центр.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.98 года «О мерах по защите потребителей от недобросовестных действий продавцов», потребитель имеет право в случае возникновения претензий к качеству, количеству, комплектности, срокам годности, безопасности, надежности, внешнему виду, упаковке, форме, габаритам, весу, расцветке или комплектации.

В соответствии со статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» при получении товара и при возникновении претензий к качеству, количеству, комплектности, срокам годности, безопасности, надежности, внешнему виду, упаковке, форме, габаритам, весу, расцветке или комплектации, потребитель имеет право предъявить претензии к продавцу, выполняющей функции продавца, в том числе к исполнителю, осуществляющему транспортировку товара.

Если в результате эксплуатации товара возникли претензии к качеству, количеству, комплектности, срокам годности, безопасности, надежности, внешнему виду, упаковке, форме, габаритам, весу, расцветке или комплектации, потребитель имеет право предъявить претензии к продавцу, выполняющей функции продавца, в том числе к исполнителю, осуществляющему транспортировку товара.

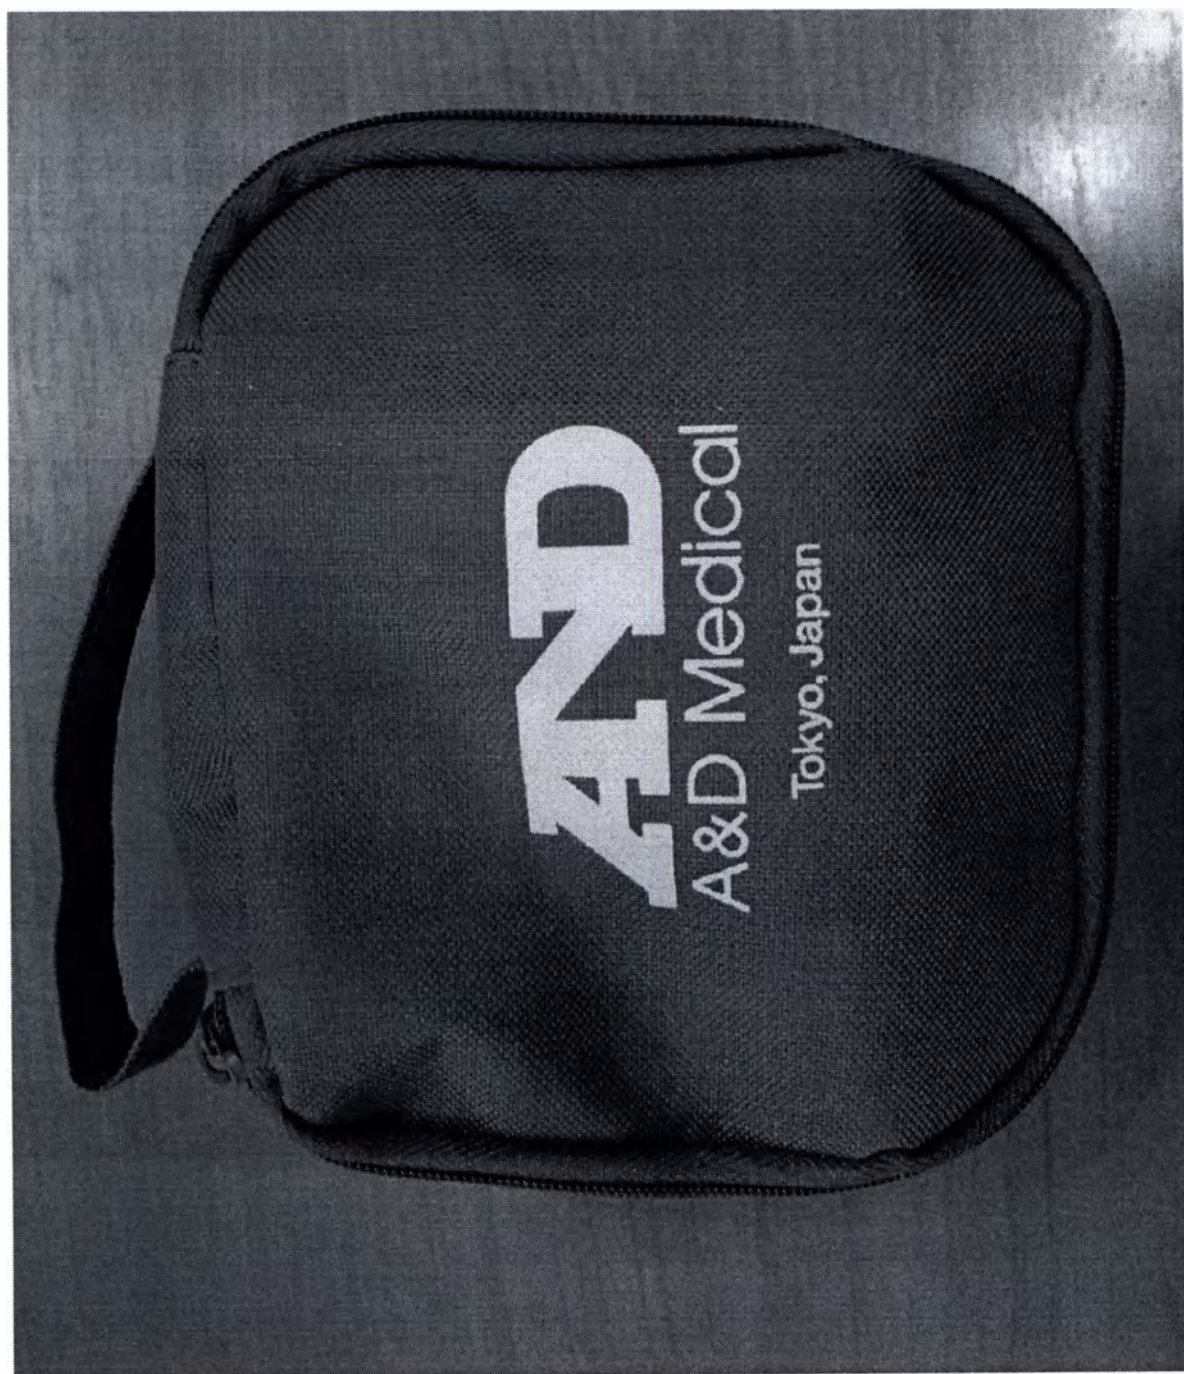

11. Коробка.

AND

Эй энд Ди, Япония

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНГАЛЯТОР UN-233

компактный с MESH (МЕШ) технологией



AND

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
Модель UN-233



**ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

Manufacturer / Производитель:

A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama, 108 0072 Japan

Production Facility / Производственное подразделение:

A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd, Datianyang Industrial Zone, Tantou Village
Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Importer / Импортёр:

ООО «Эй энд Ди Рус», 121357, Москва, ул. Верейская, д. 17.

Тел.: 8 800-200-03-80; отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru



4 981046 350051