

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия «Набор реагентов
для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом обратной транскрипции –
петлевой изотермической амплификации в реальном времени
(КовиГен-LAMP-01)»,
ТУ 21.20.23-001-08534994-2022

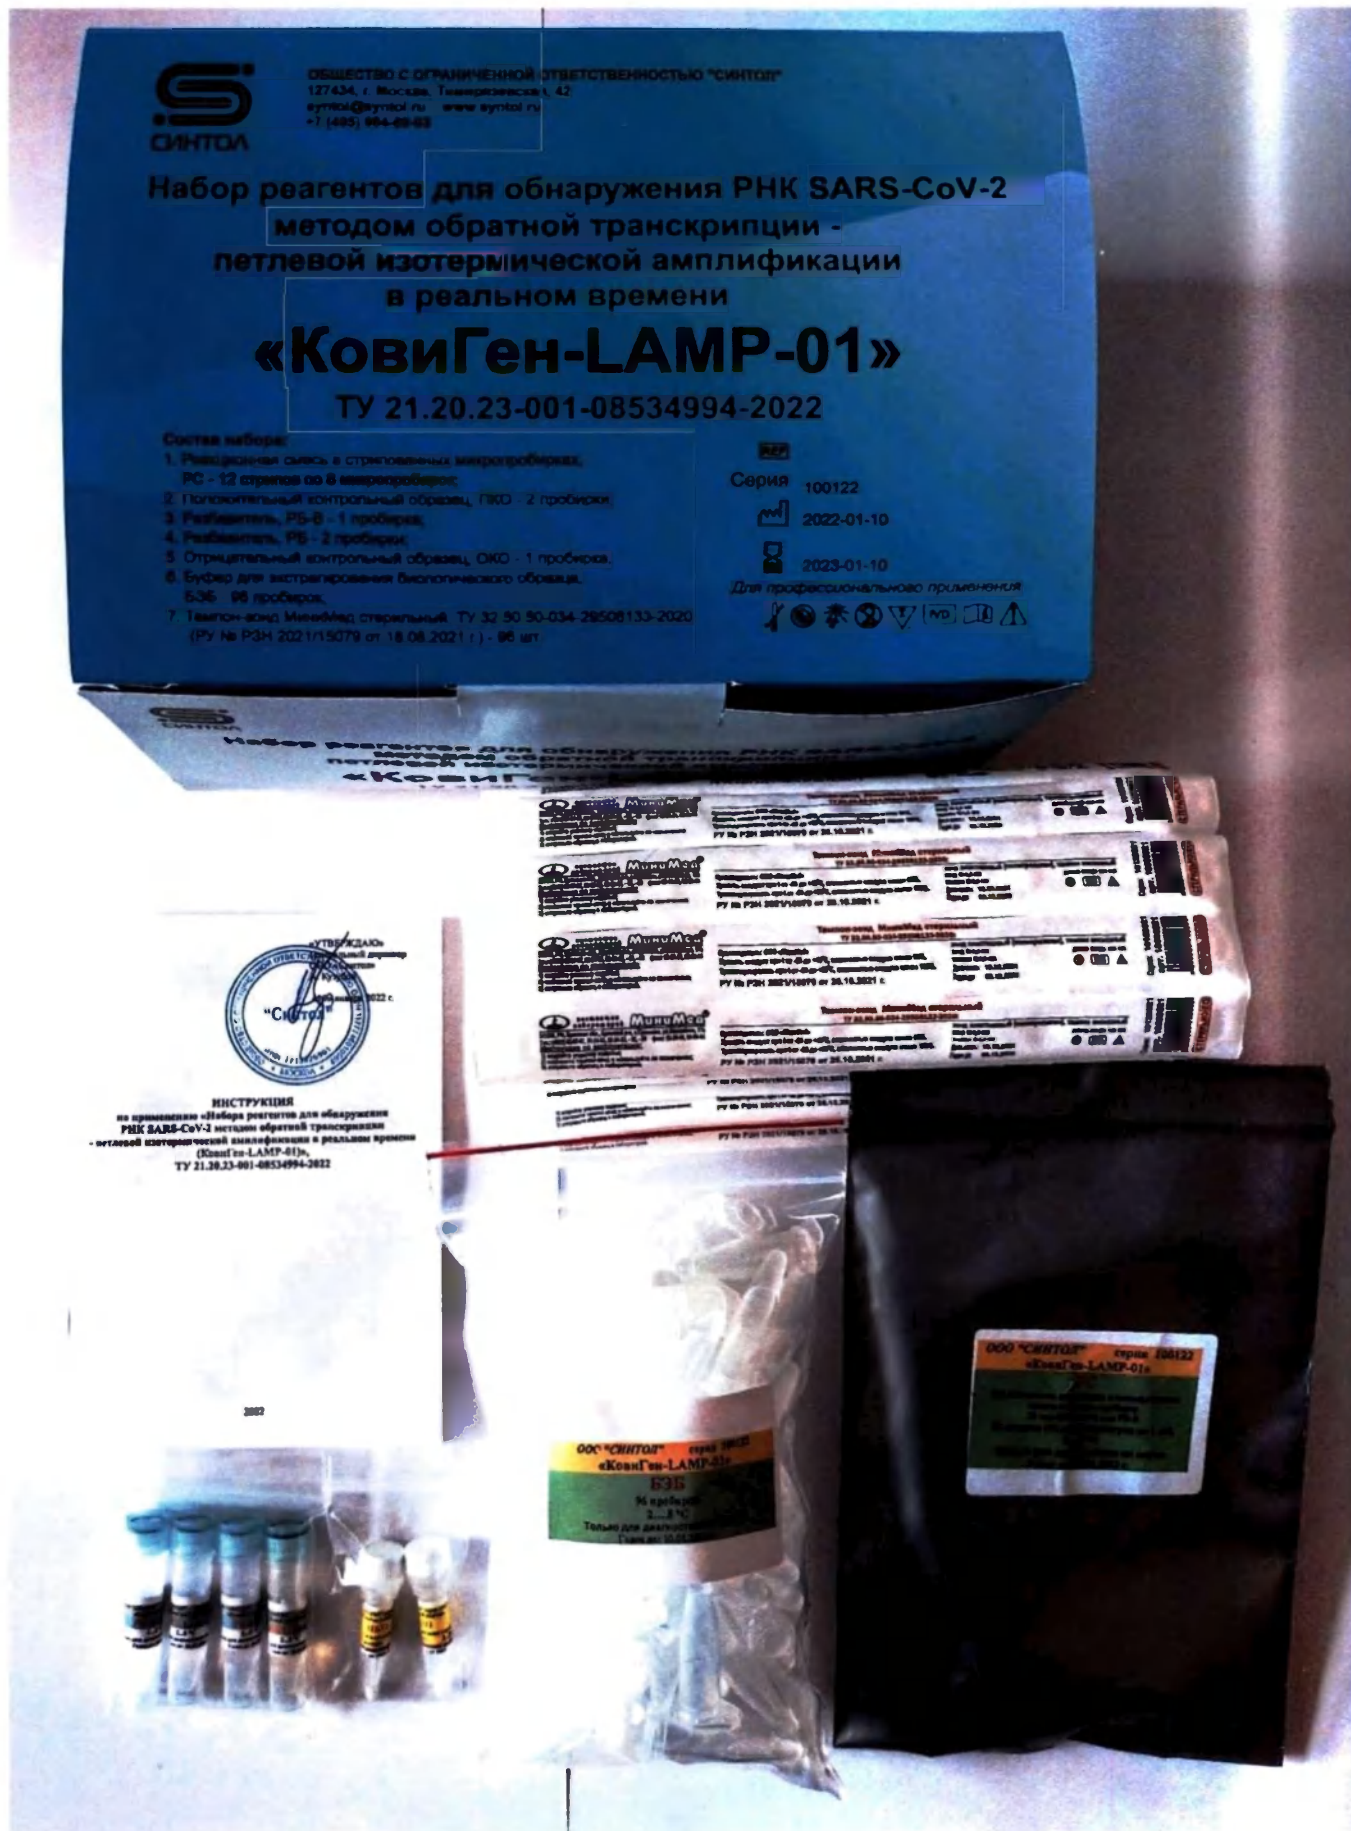


Рисунок 1 – Общий вид «Набора реагентов для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом обратной транскрипции – петлевой изотермической амплификации в реальном времени (КовиГен-LAMP-01)», ТУ 21.20.23-001-08534994-2022

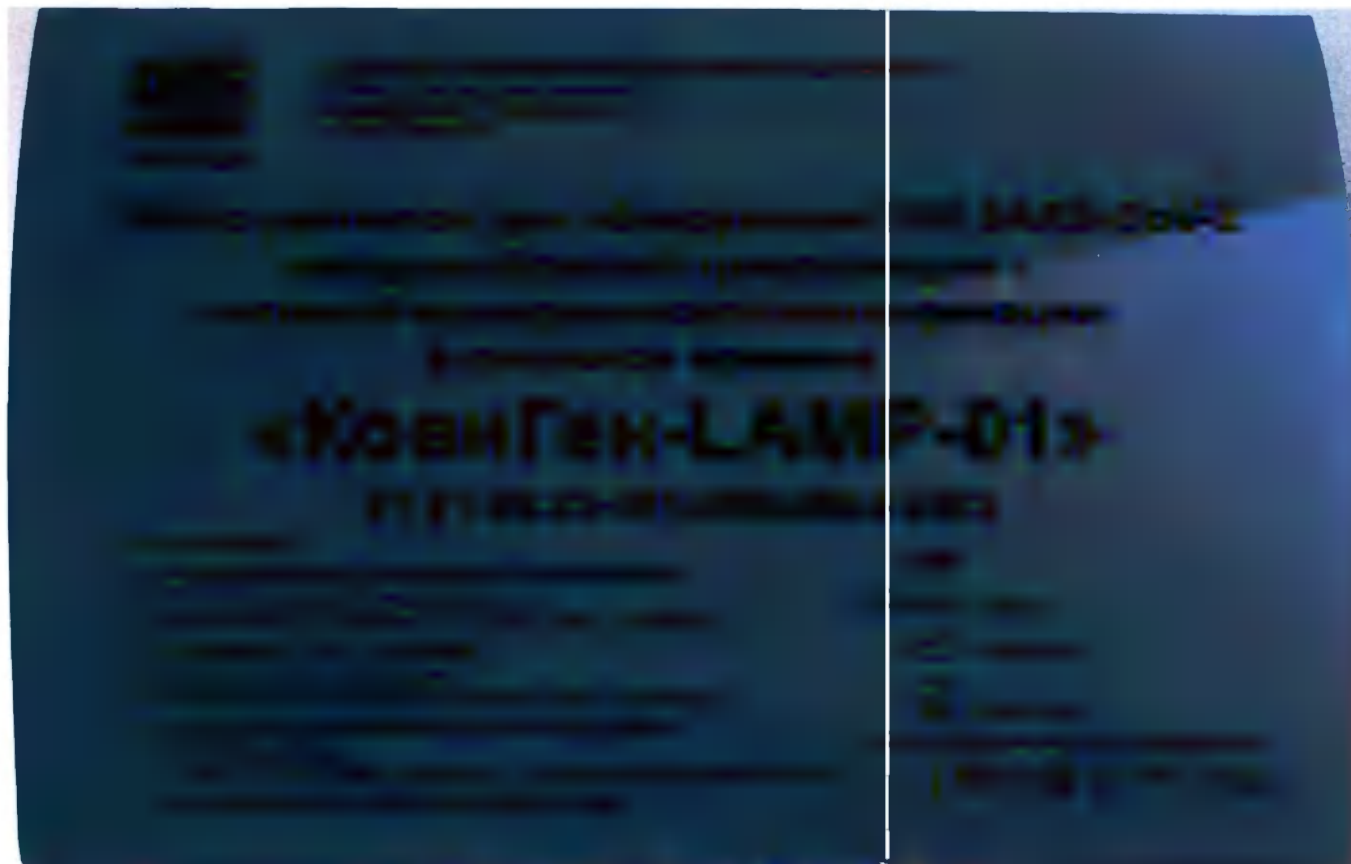


Рисунок 2 – Коробка (крышка)



Рисунок 3 – Коробка (лицевая сторона)



Рисунок 4 – Коробка (боковая сторона)



Рисунок 5 – Коробка (задняя сторона)

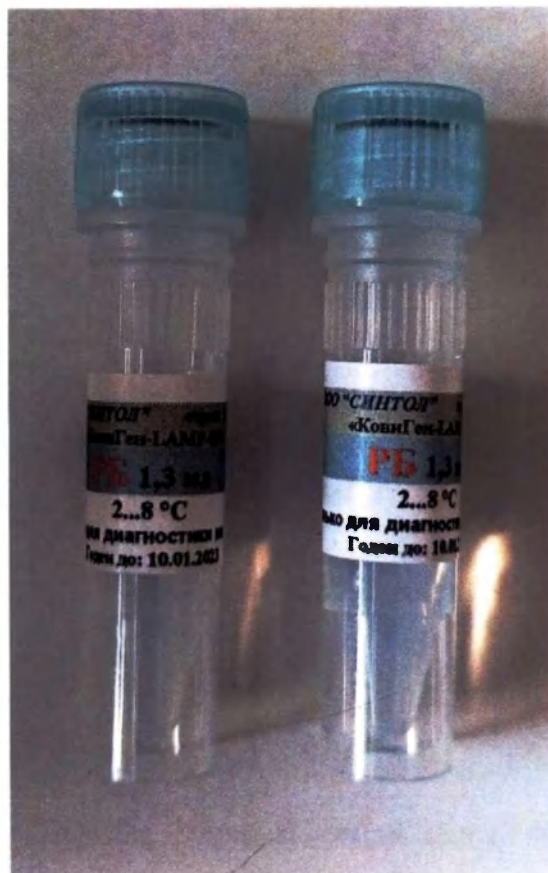


Рисунок 6 – Разбавитель, РБ



Рисунок 7 – Разбавитель, РБ-В



Рисунок 8 – Положительный контрольный образец, ПКО

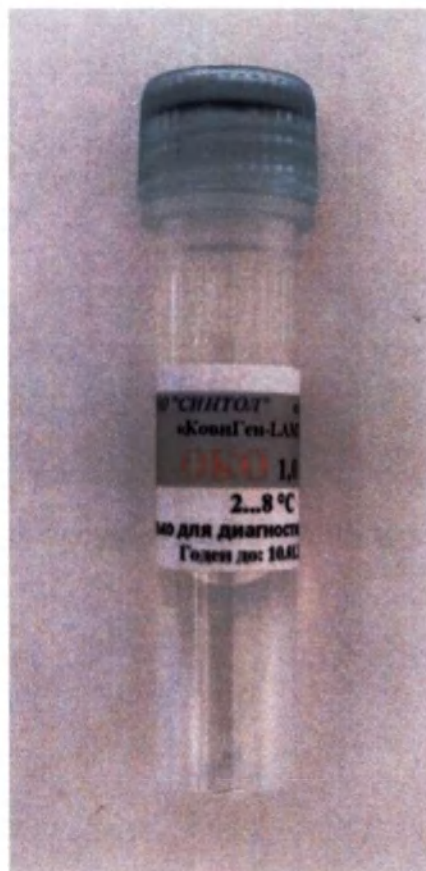


Рисунок 9 – Отрицательный контрольный образец, ОКО



Рисунок 10 – Буфер для экстрагирования биологического образца, БЭБ



Рисунок 11 – Реакционная смесь в стрипованных микропробирках РС

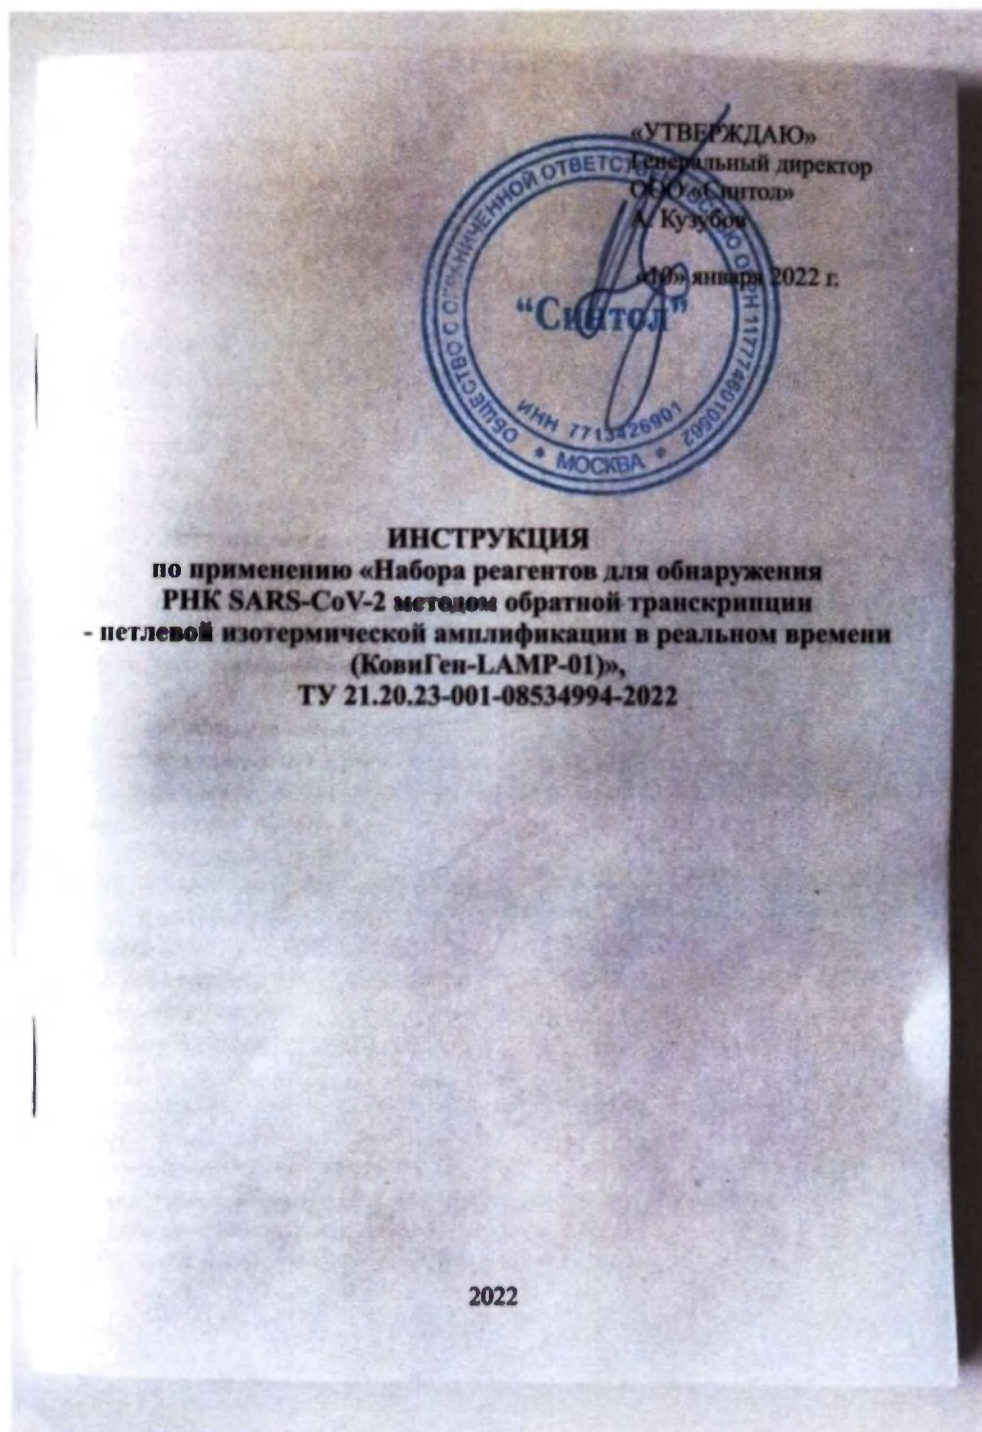


Рисунок 12 – Инструкция по применению












Рисунок 13 – Образцы маркировки

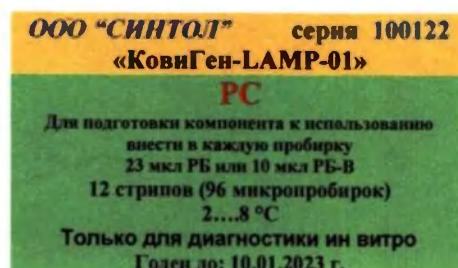

пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

10 (десять) листов

Подпись *Сергей С. Борисевич*

«20» апреля 2022 г.