



Фотографии общего вида медицинского изделия

Анализатор дискретный автоматизированный клинической химии NS-Prime для количественного in vitro определения и мониторинга концентраций аналитов в биологических жидкостях человека, с принадлежностями

Анализатор NS-Prime 01 – Вид спереди

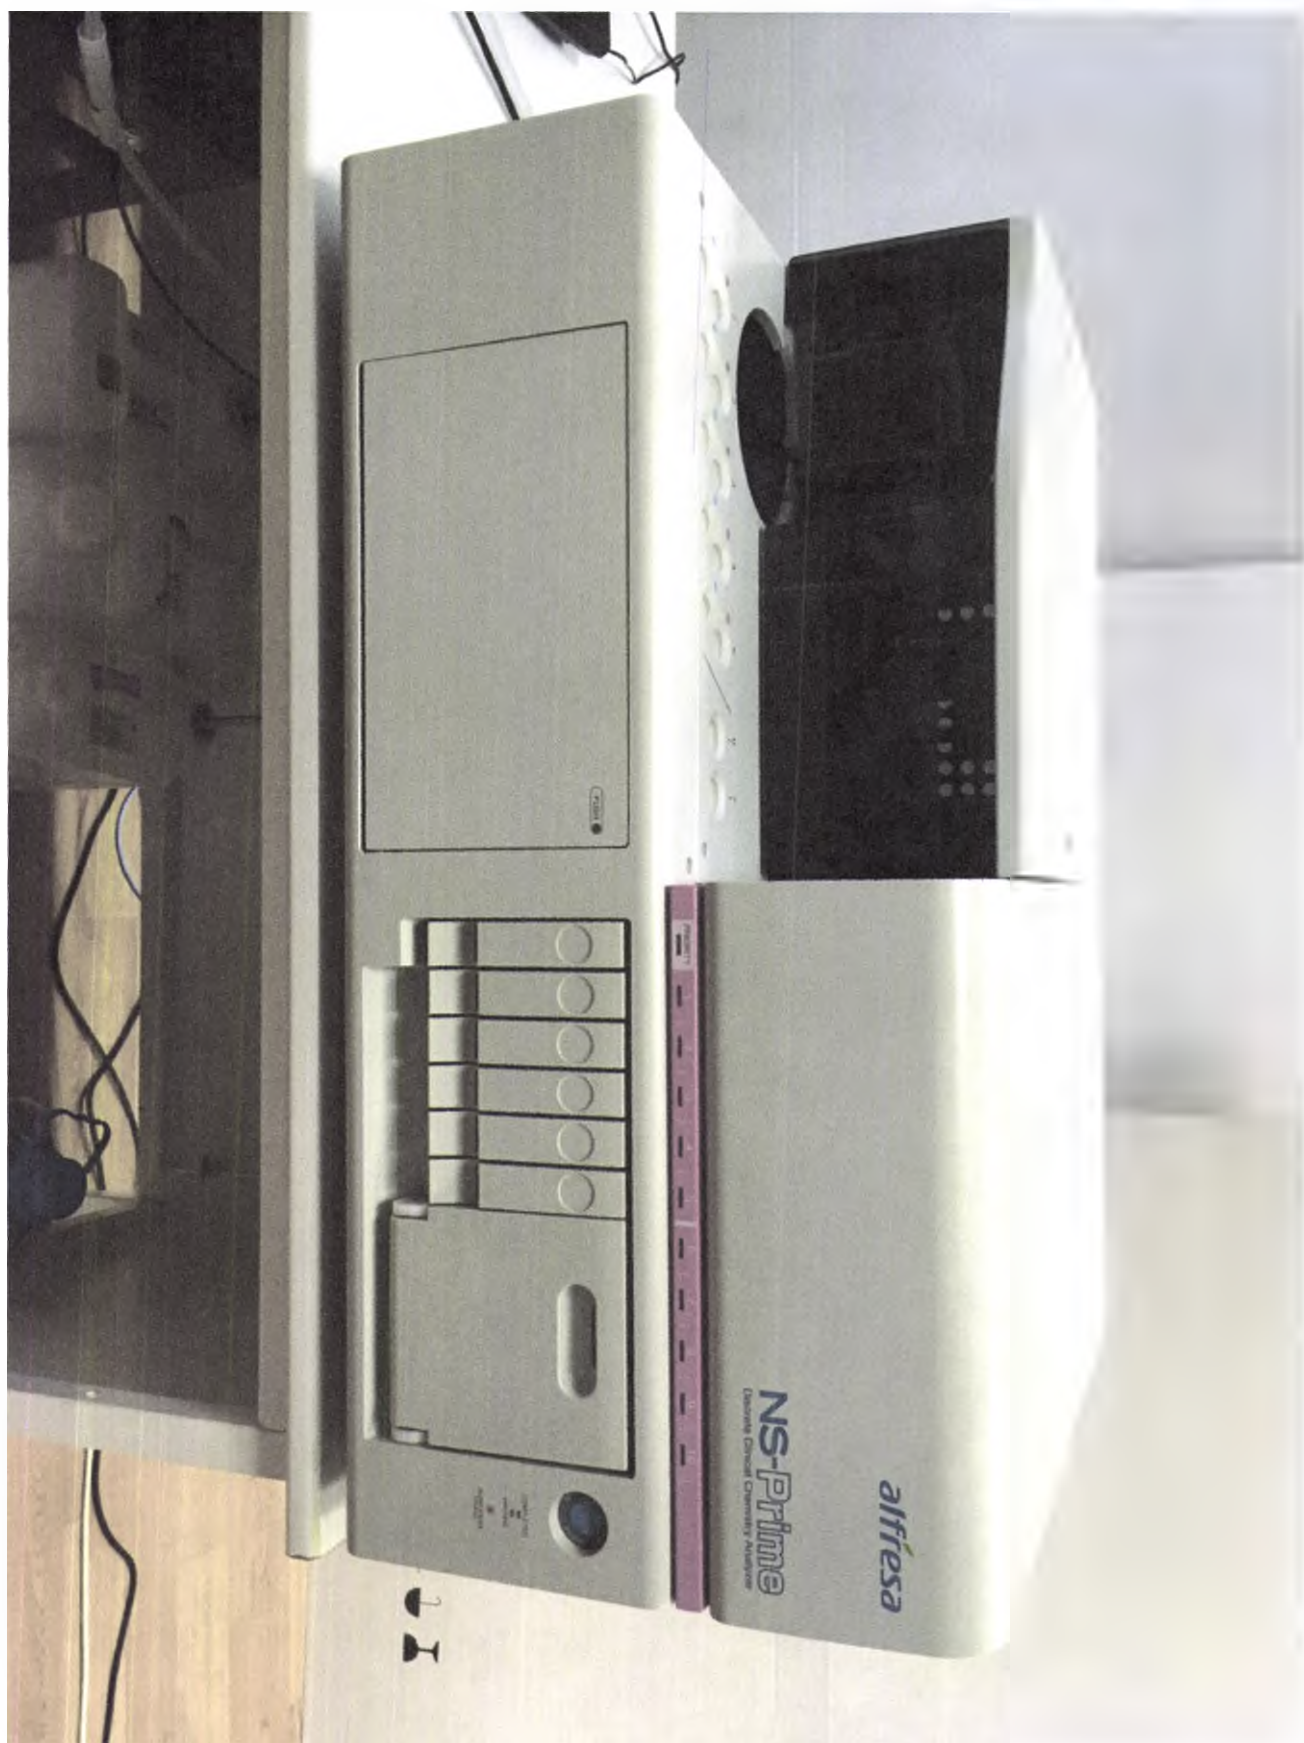

Анализатор NS-Prime 02 – Вид сзади

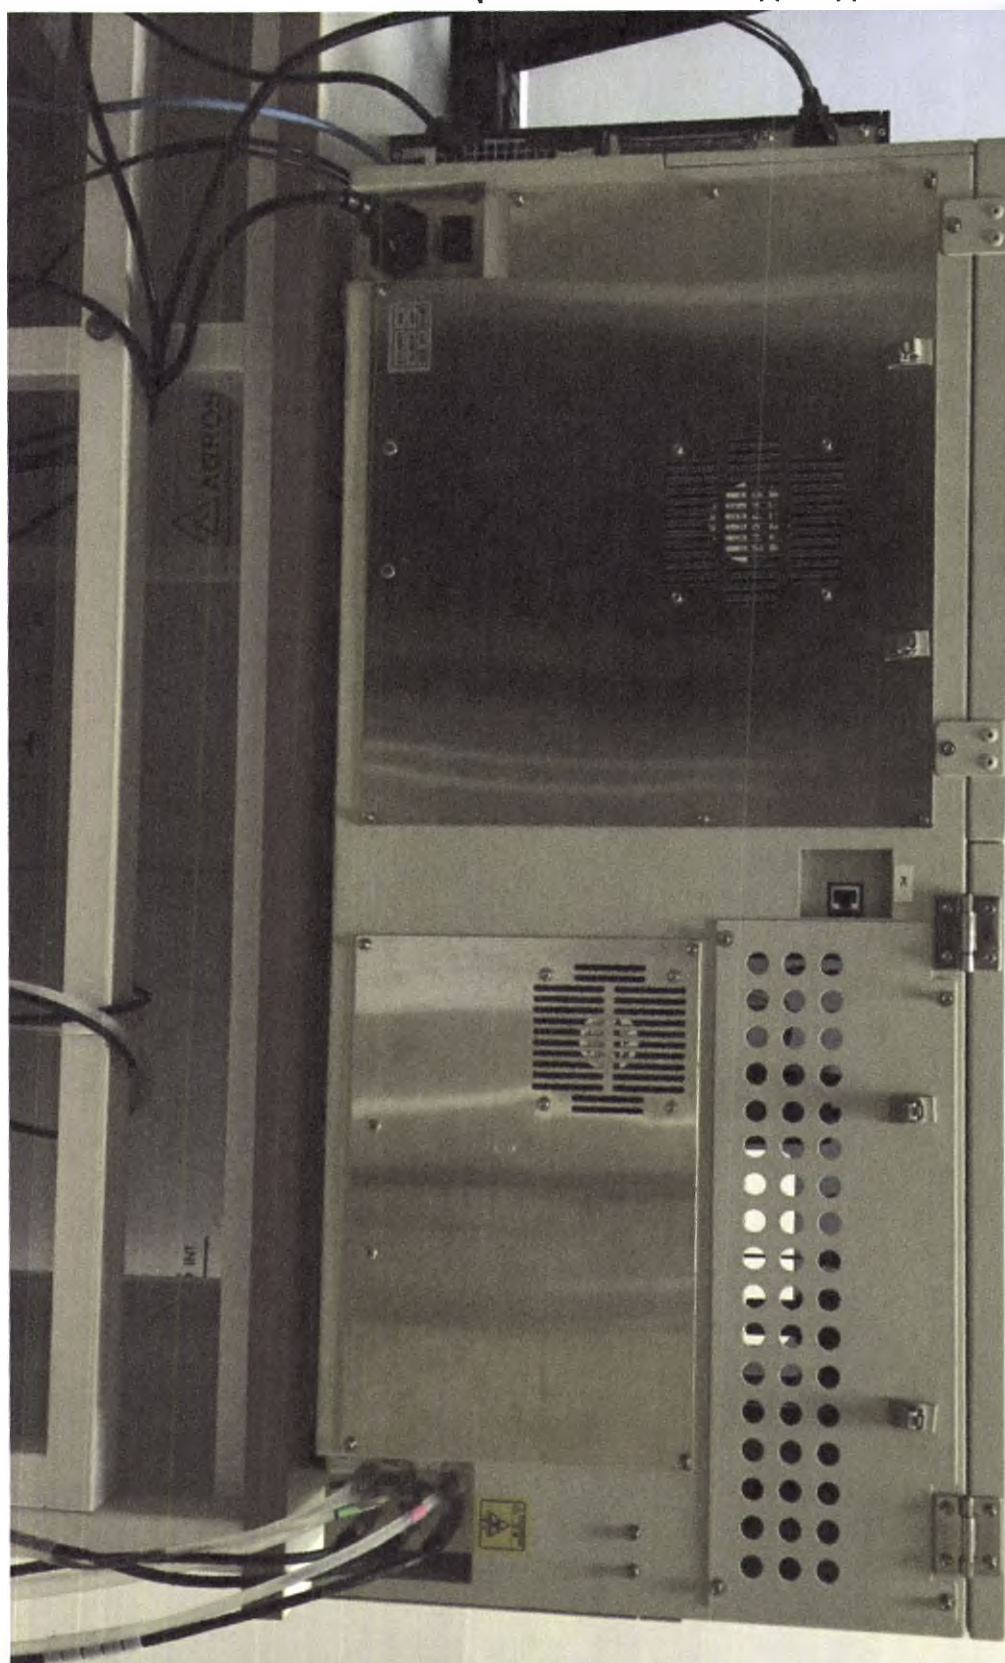

Анализатор NS-Prime 03 – Кабель питания



Анализатор NS-Prime 04 – Предупредительная маркировка



Анализатор NS-Prime 05 – Разъём для ПК



Анализатор NS-Prime 06 – Вид сбоку




Анализатор NS-Prime 07 - Маркировка



Анализатор NS-Prime 08 – Вид сбоку



Анализатор NS-Prime 09 – Вид сверху

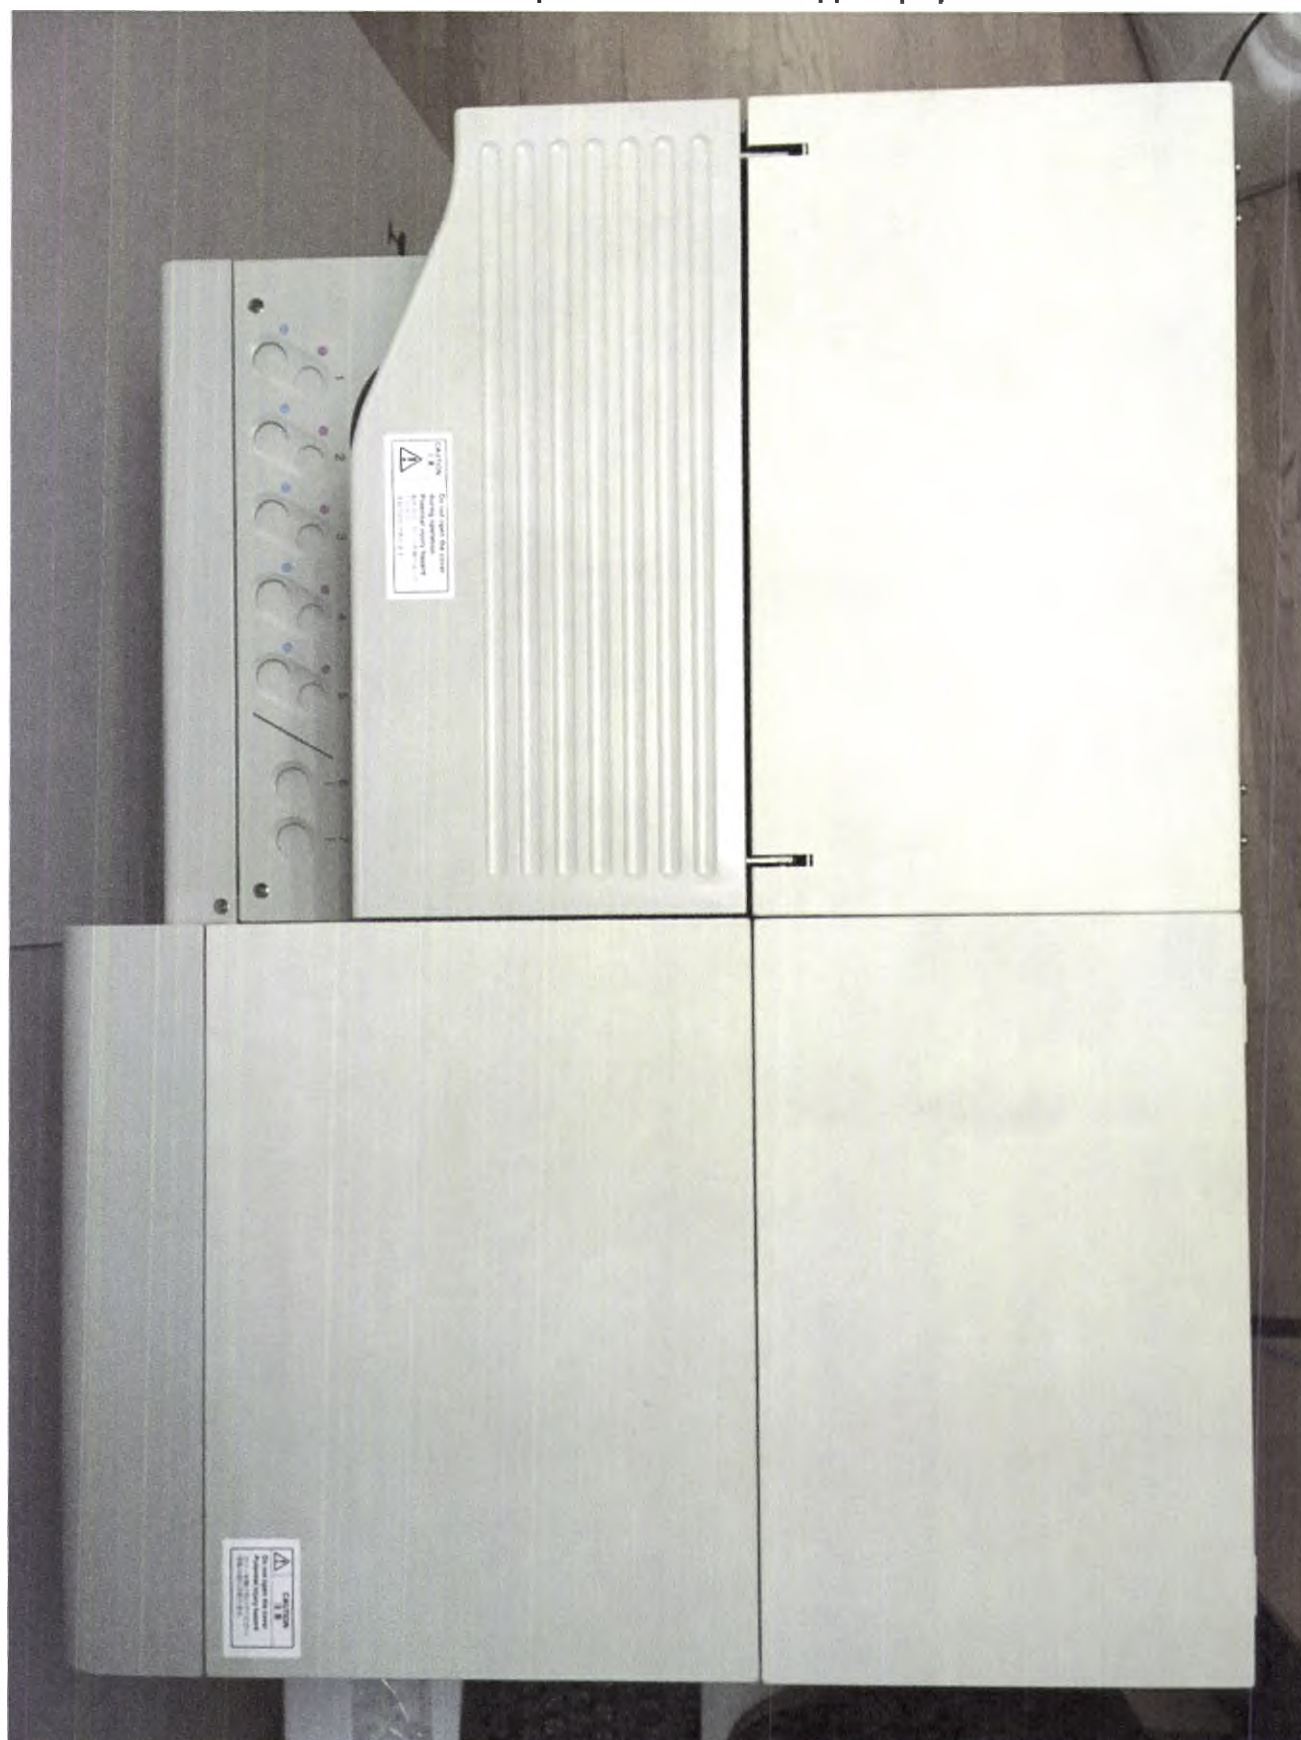



Анализатор NS-Prime 11 – Предупредительная маркировка



CAUTION
注意

**Do not open the cover .
Potential injury hazard.**

カバーを開けないでください。
怪我の恐れがあります。

Штатив для образцов 001



Штатив для образцов 002



Штатив для образцов 003



Штатив для образцов 004




Штатив для образцов 005



Штатив для образцов 006



Штатив для образцов 007

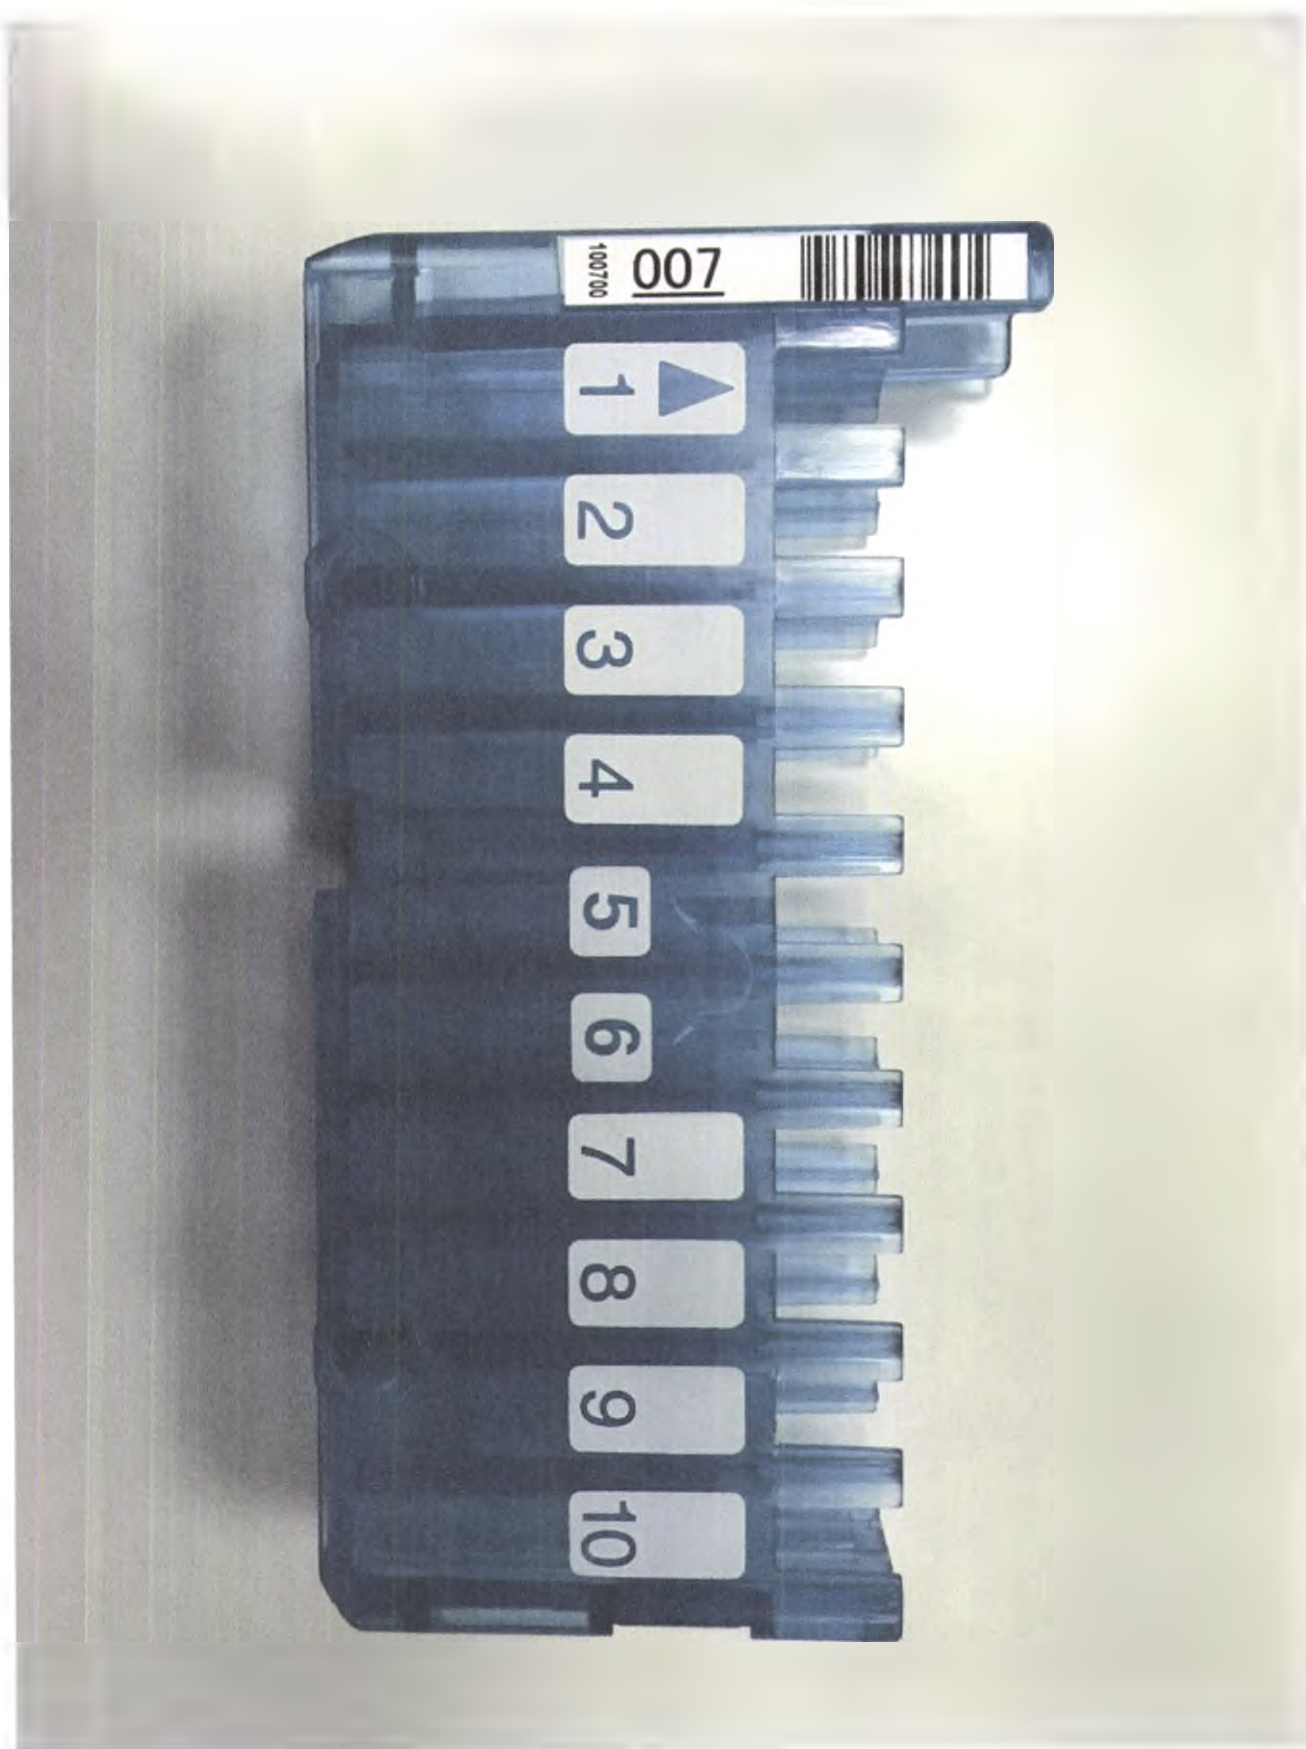


Штатив для образцов 008




Штатив для образцов 009



Штатив для образцов 010

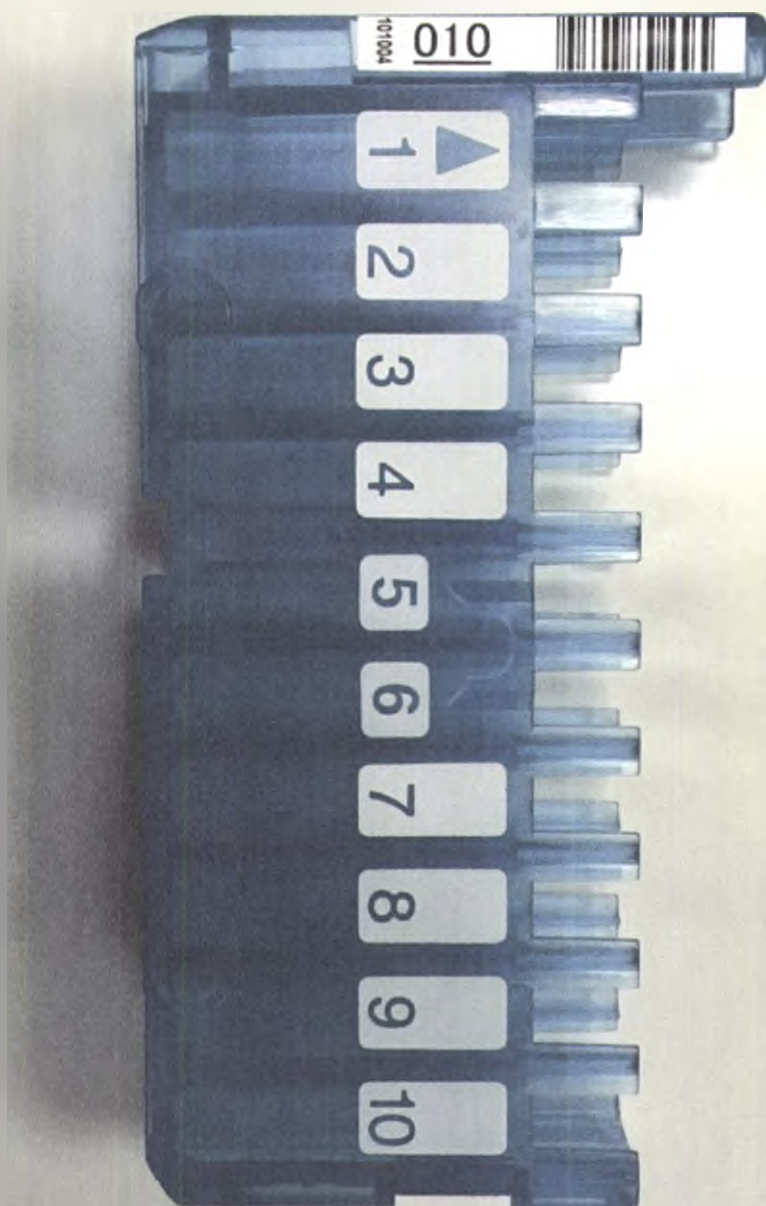

Штатив для образцов 011

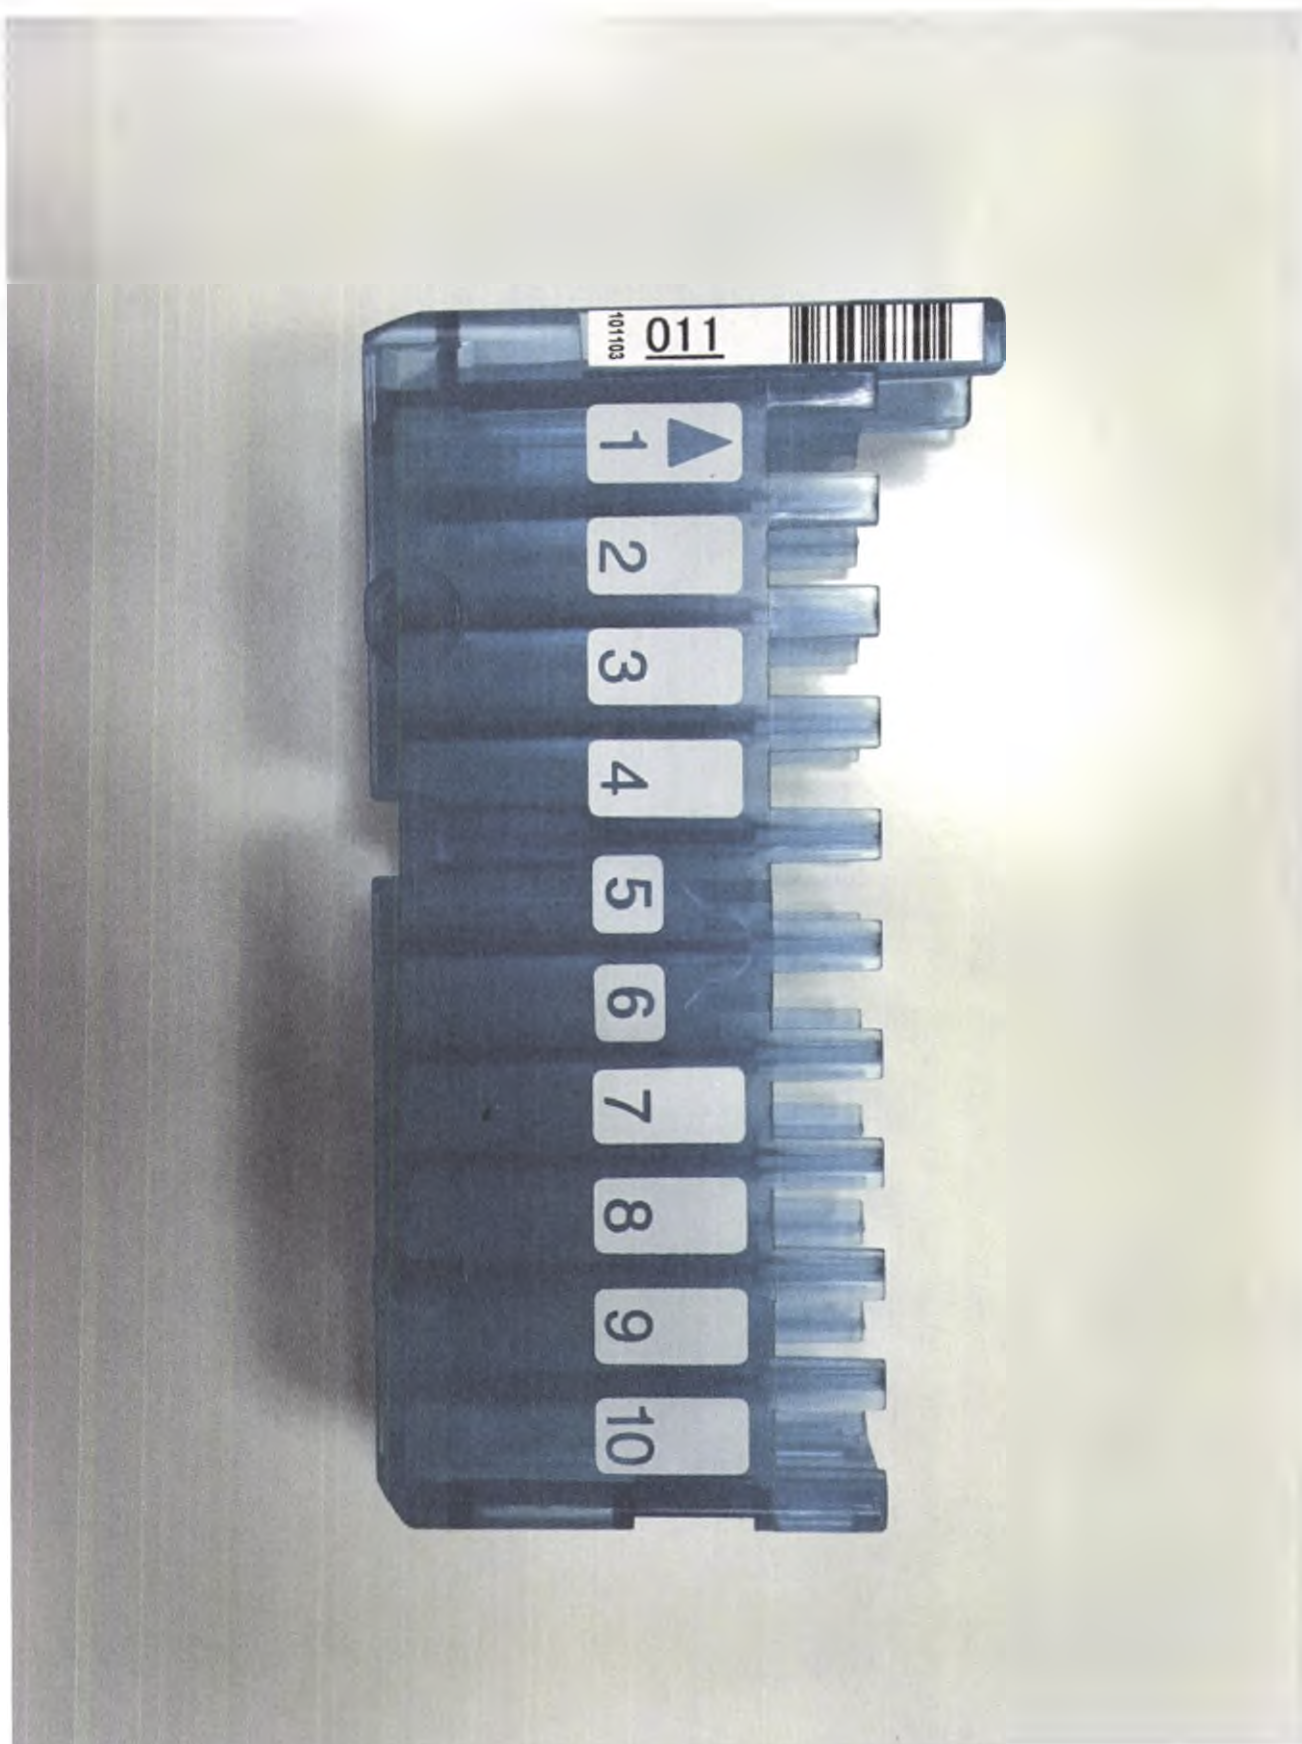

Штатив для образцов 012




Штатив для образцов 013



Штатив для образцов 014



Штатив для образцов 015

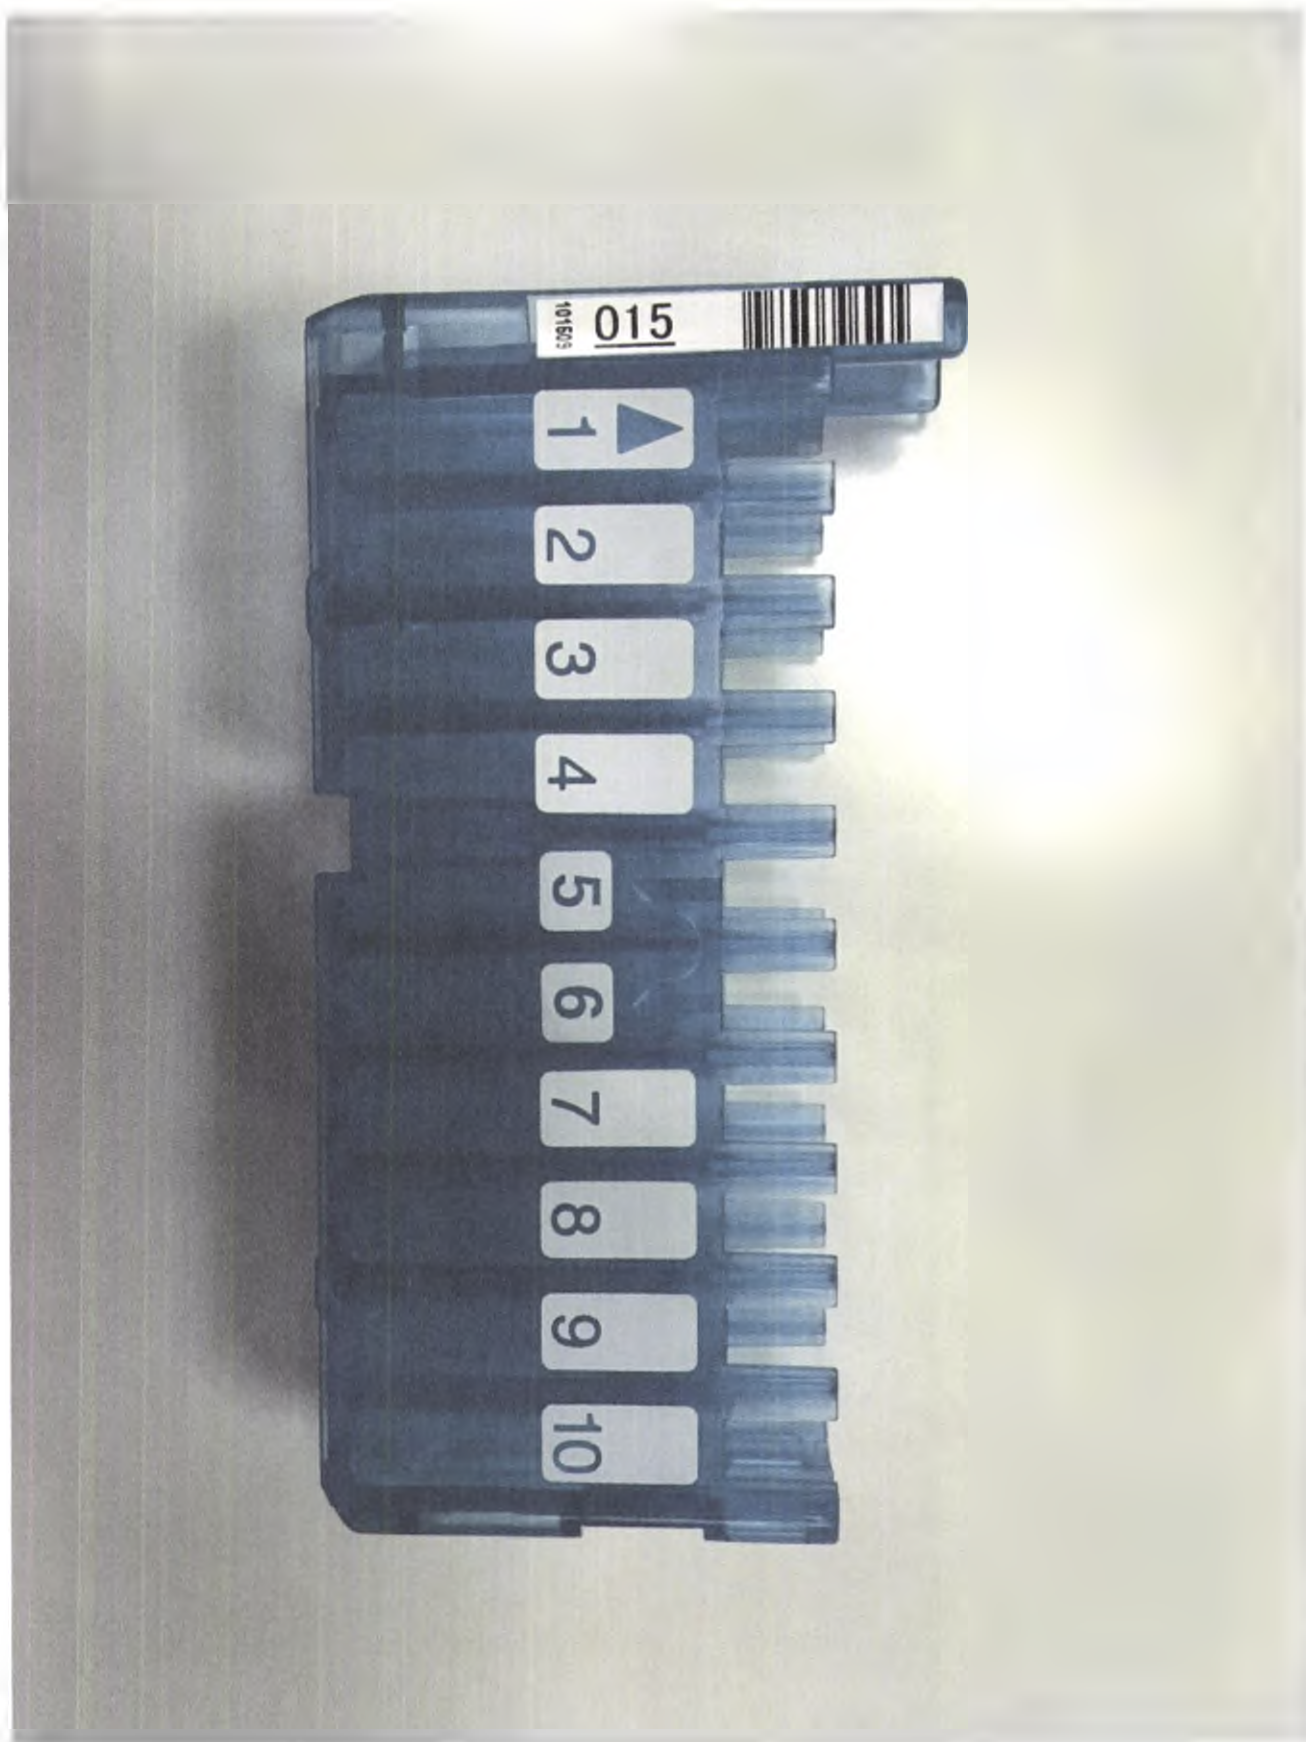


Штатив для образцов 016



Штатив для образцов 017



Штатив для образцов 018

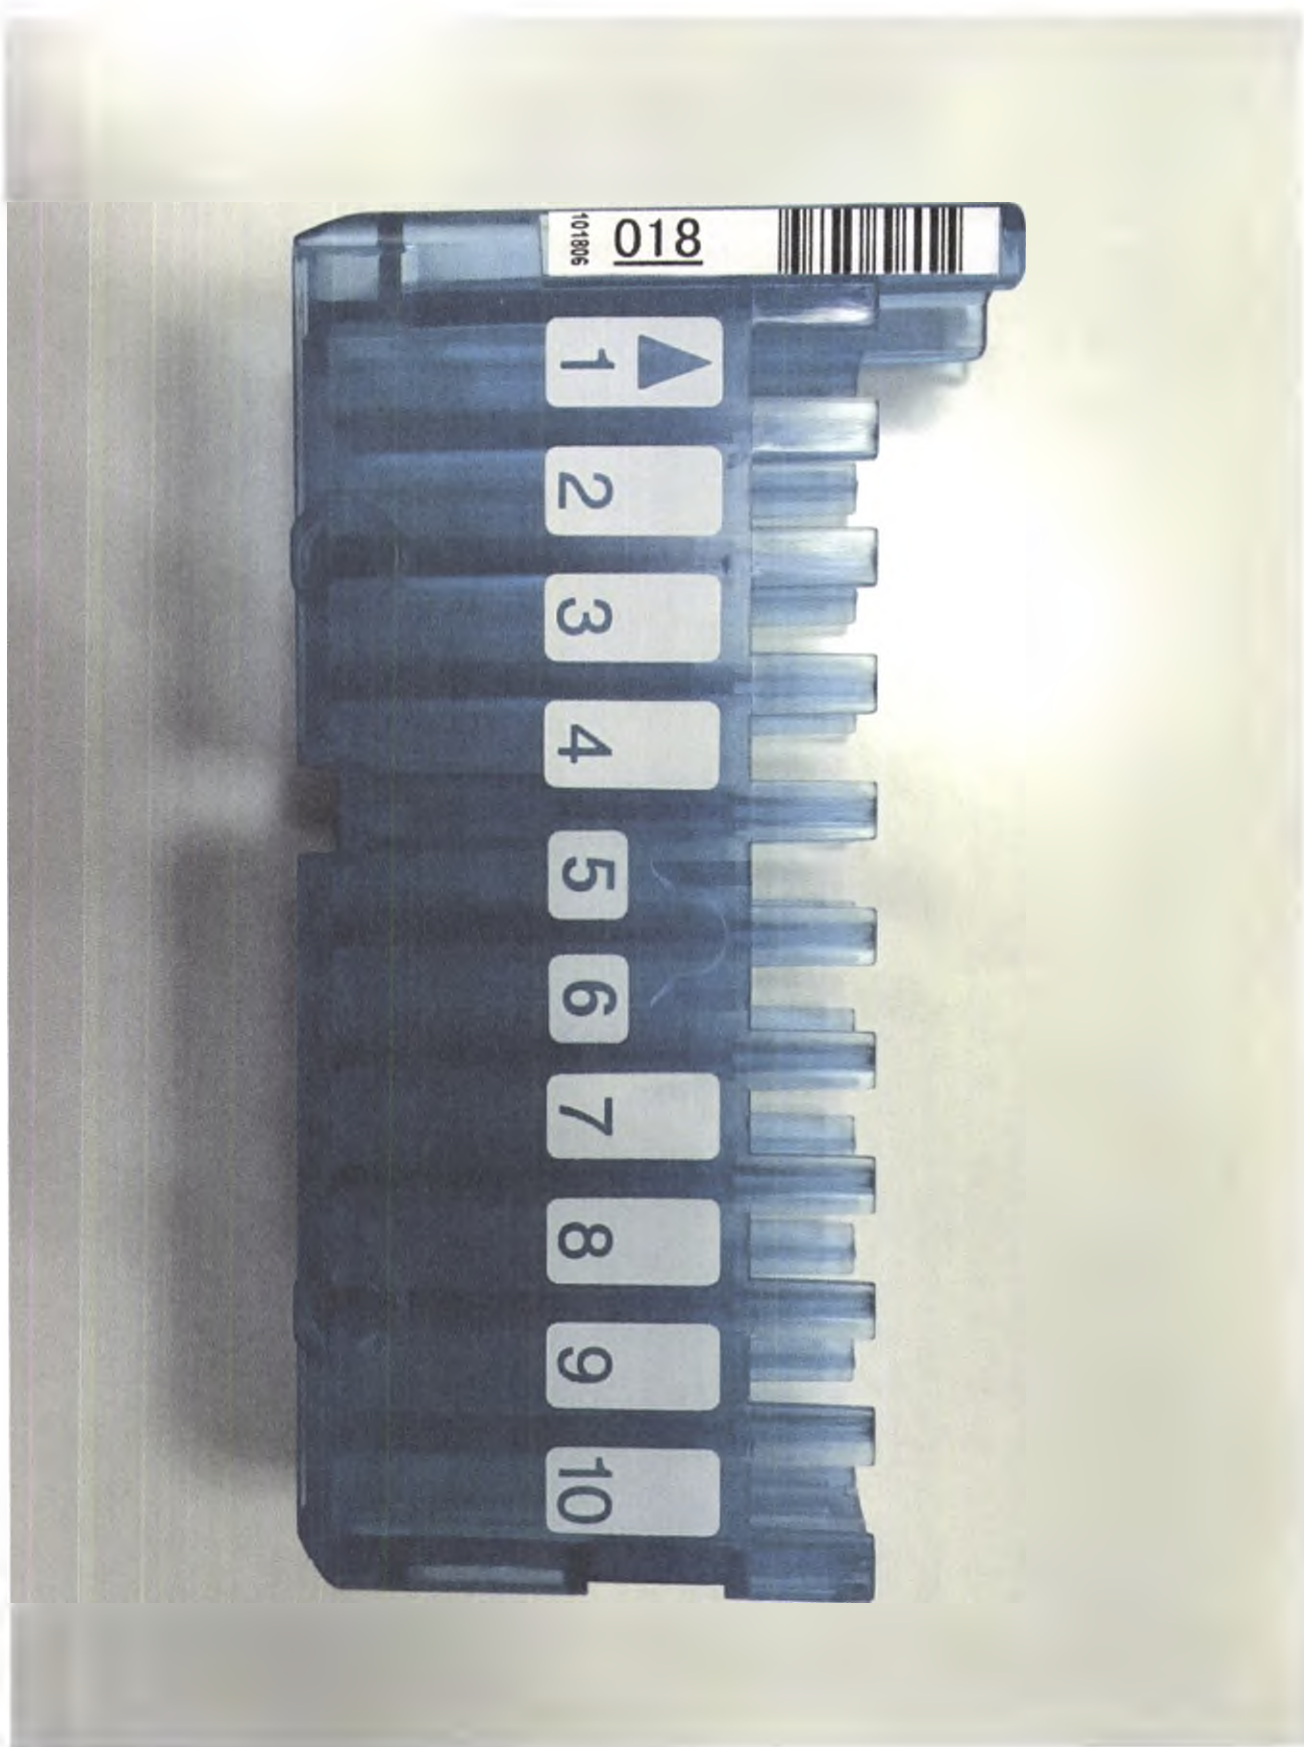


Штатив для образцов 019



Штатив для образцов 020




Штатив для образцов 021

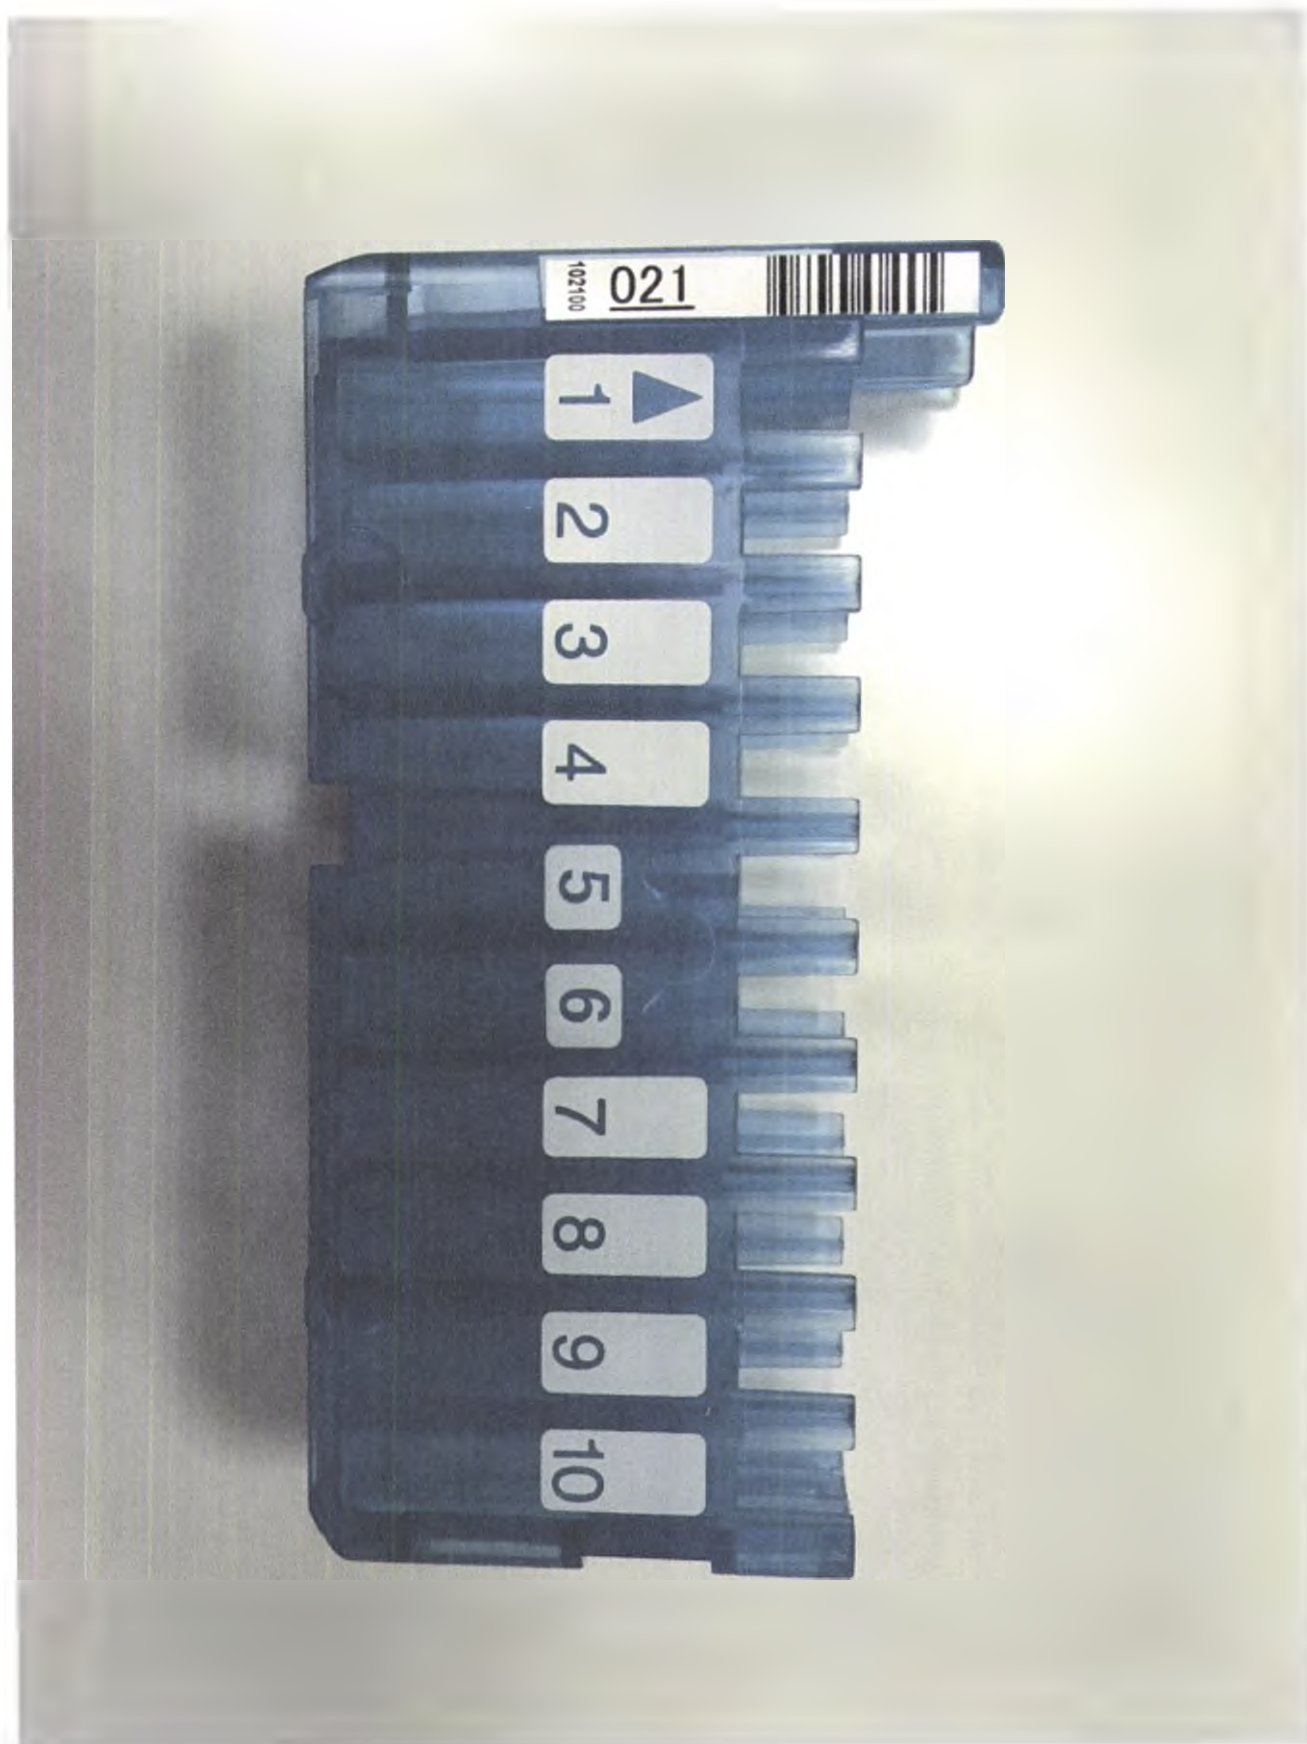


Штатив для образцов 022



Штатив для образцов 001 - Вид сверху

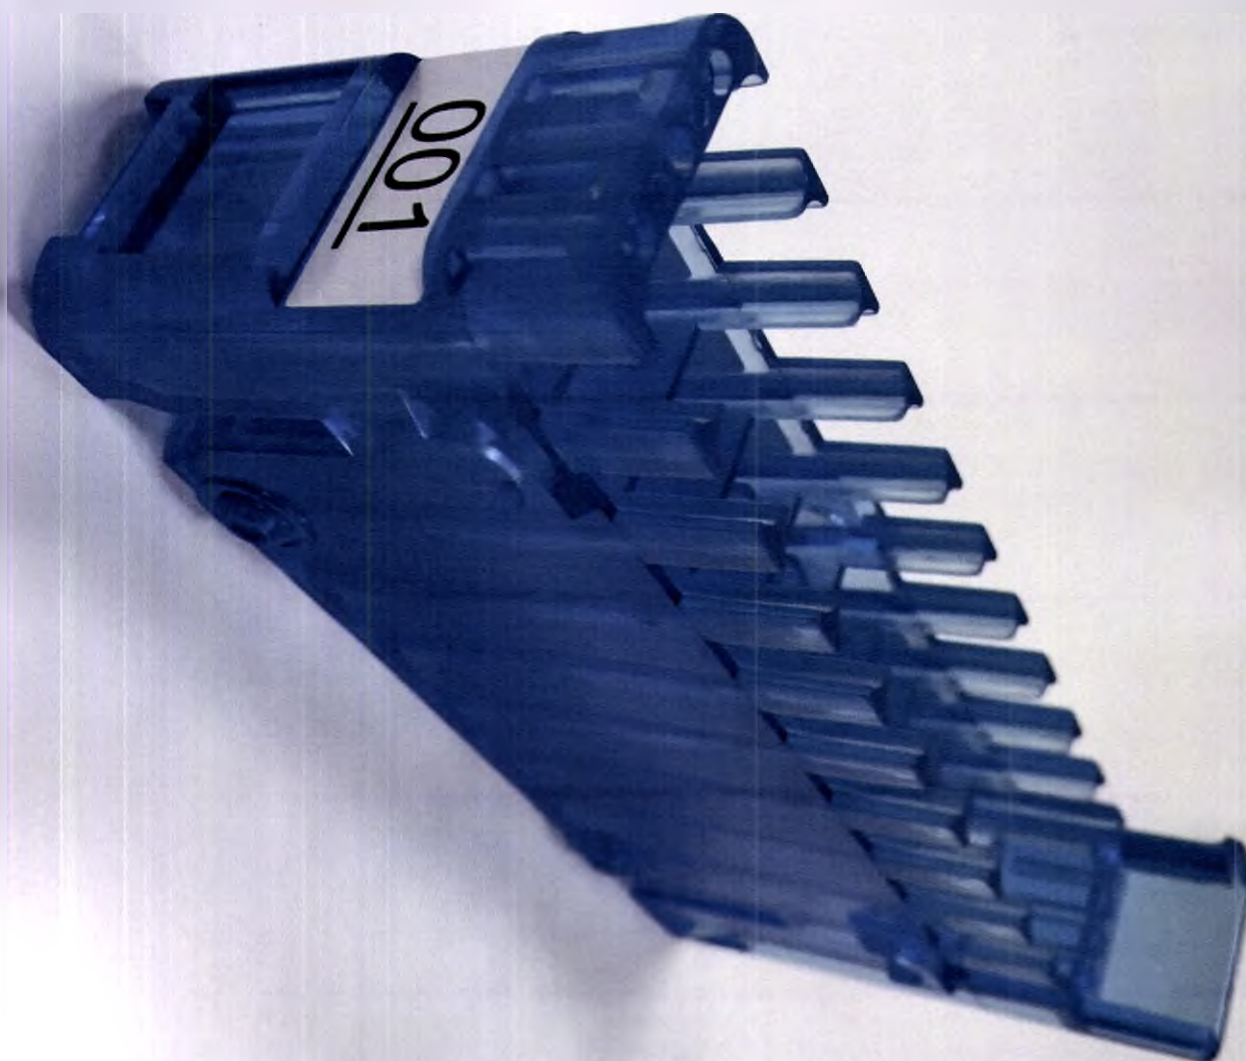

Штатив для образцов 002 - Вид сверху

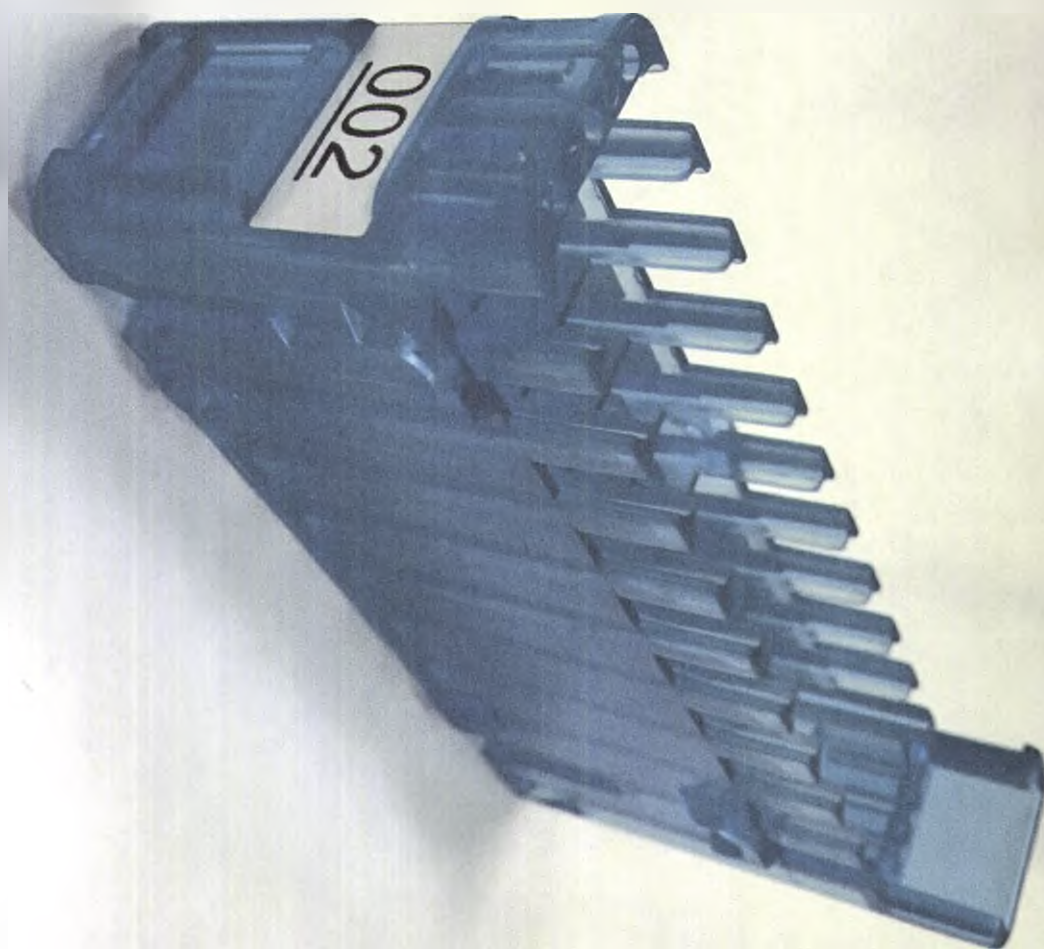


Штатив для образцов 003 - Вид сверху




Штатив для образцов 004 - Вид сверху




Штатив для образцов 005 - Вид сверху

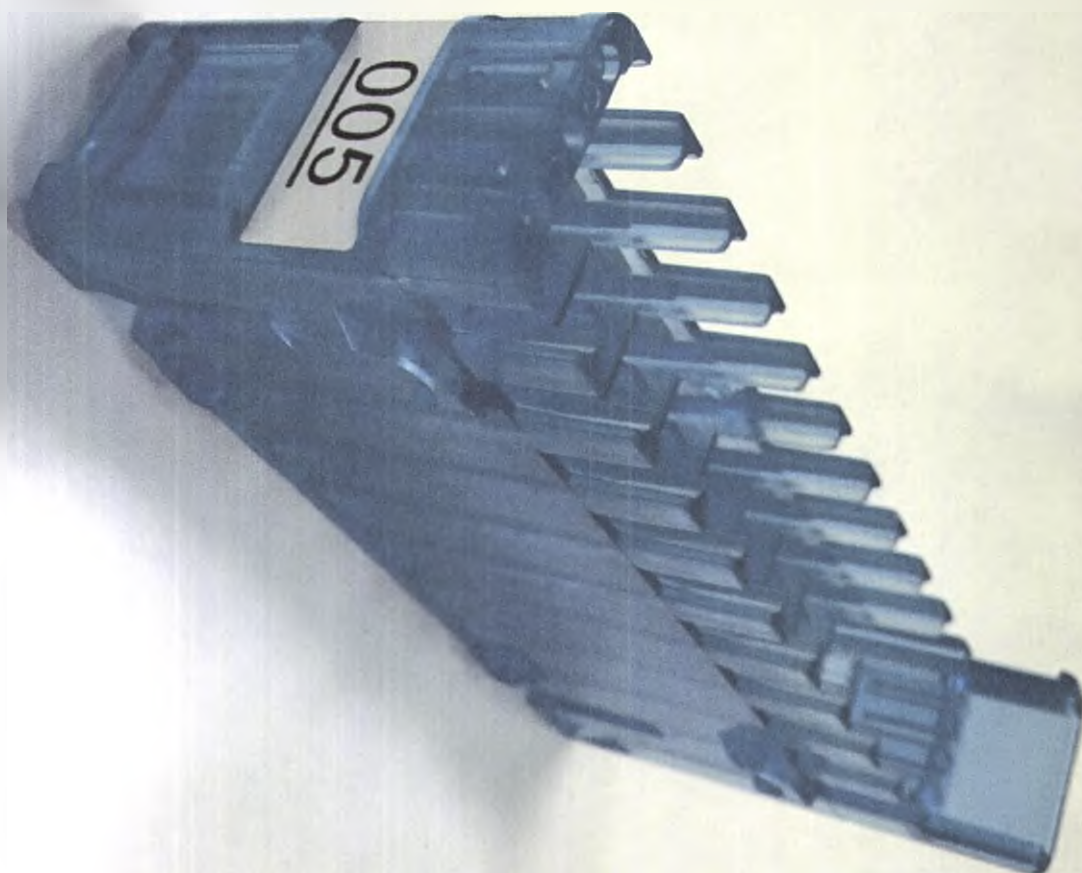


Штатив для образцов 006 - Вид сверху

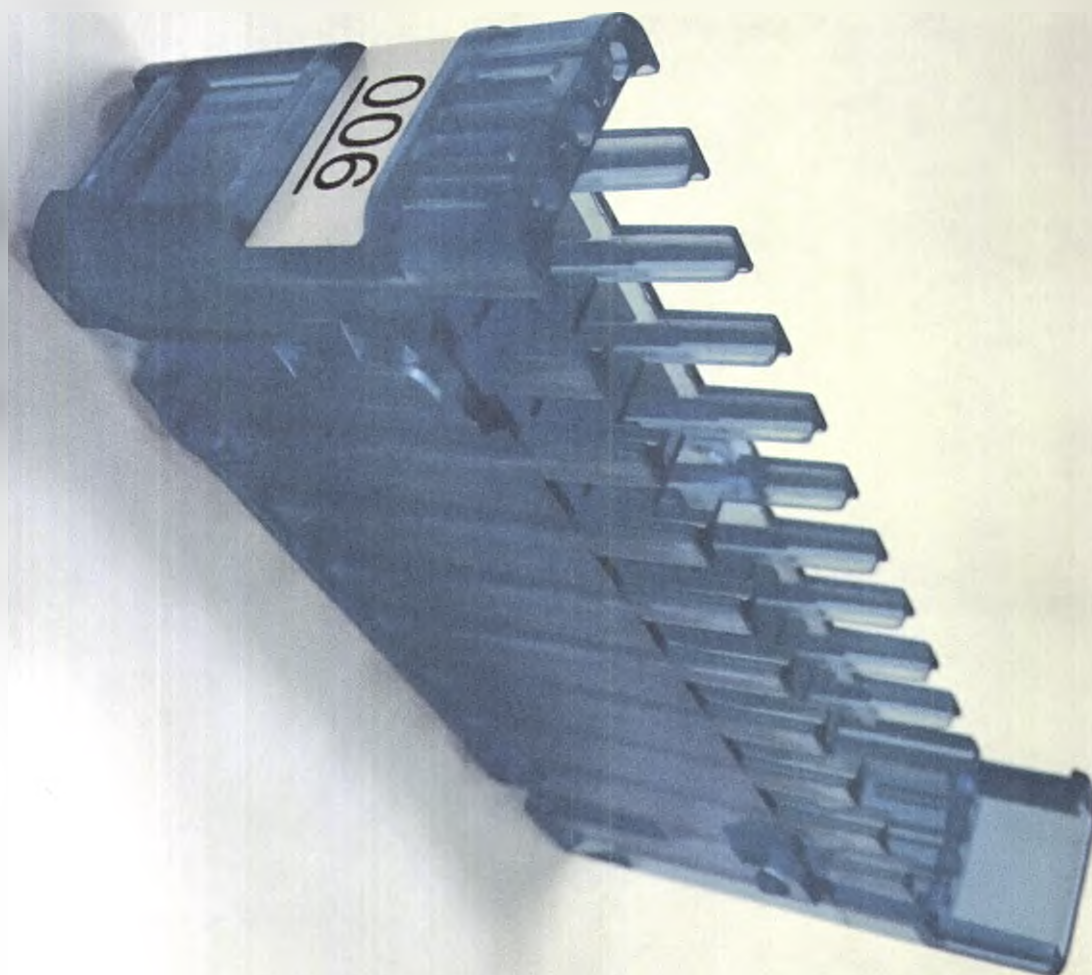


Штатив для образцов 007 - Вид сверху

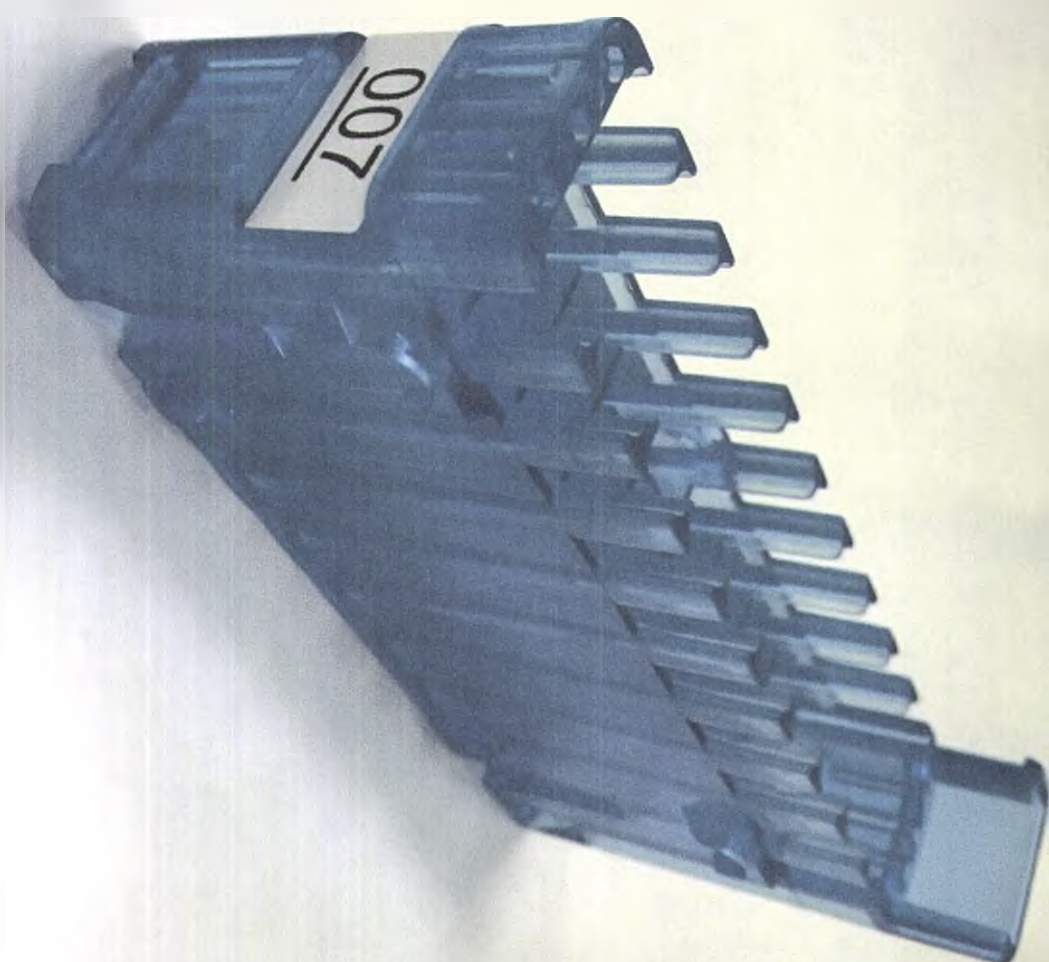

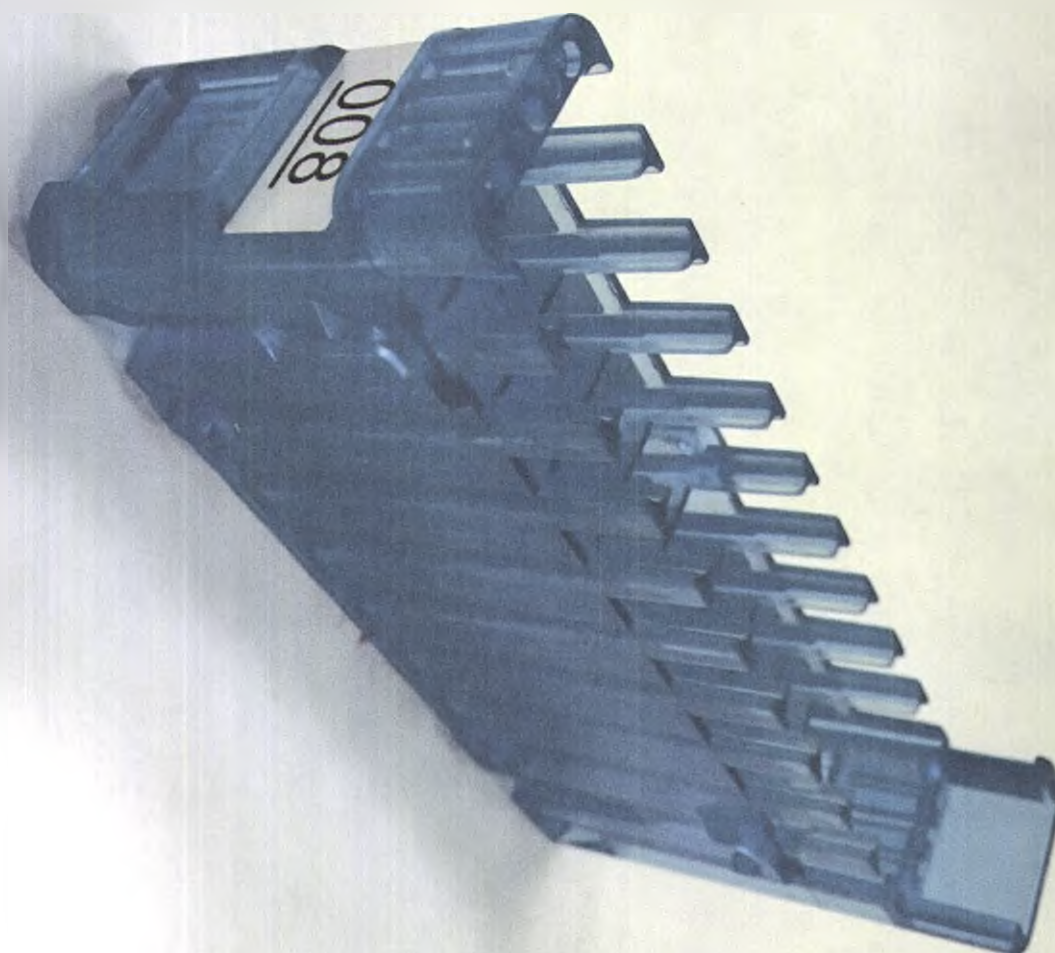





Штатив для образцов 010 - Вид сверху

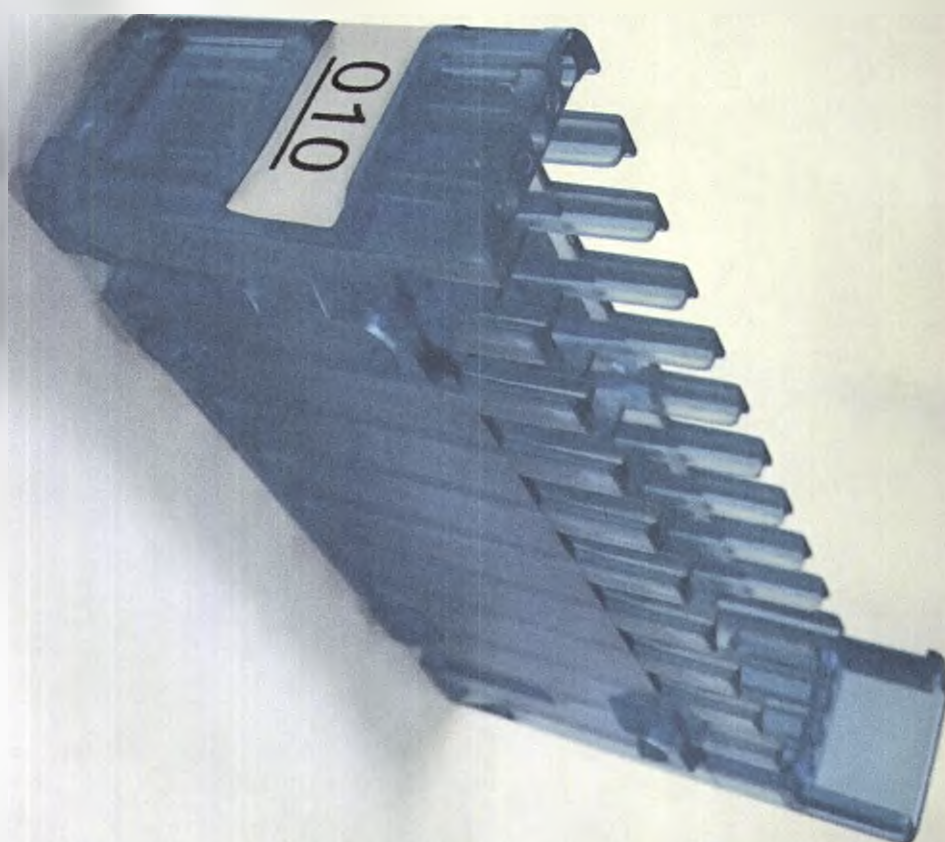



Штатив для образцов 011 - Вид сверху

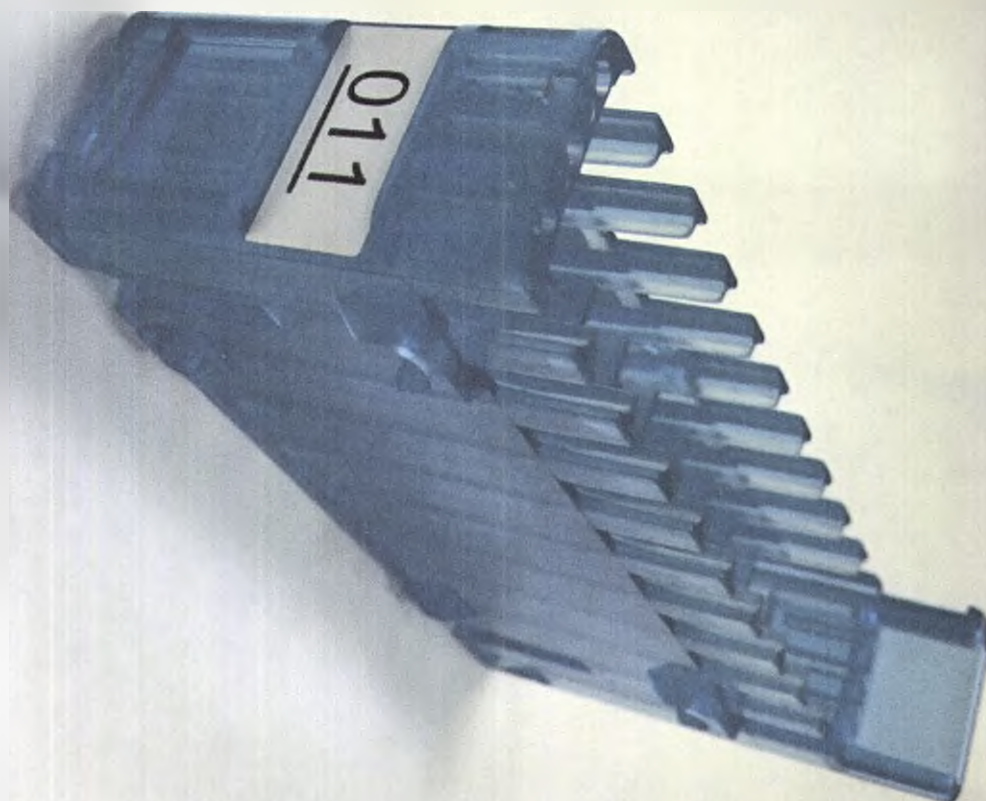

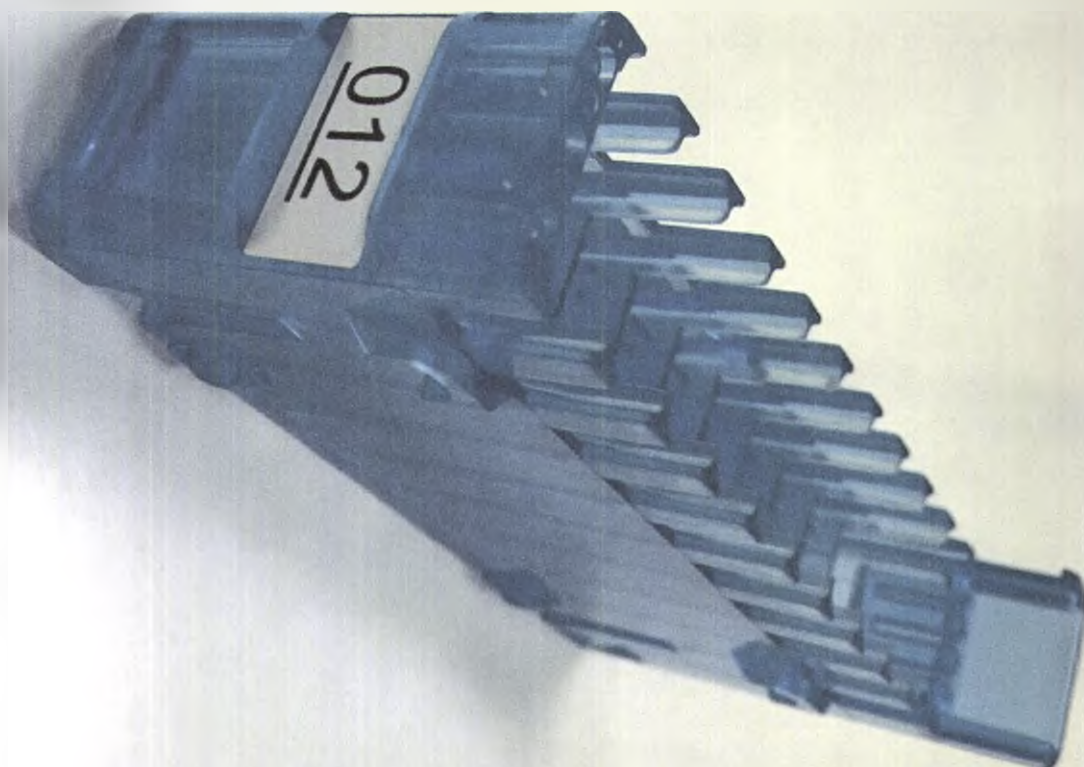


Штатив для образцов 013 - Вид сверху

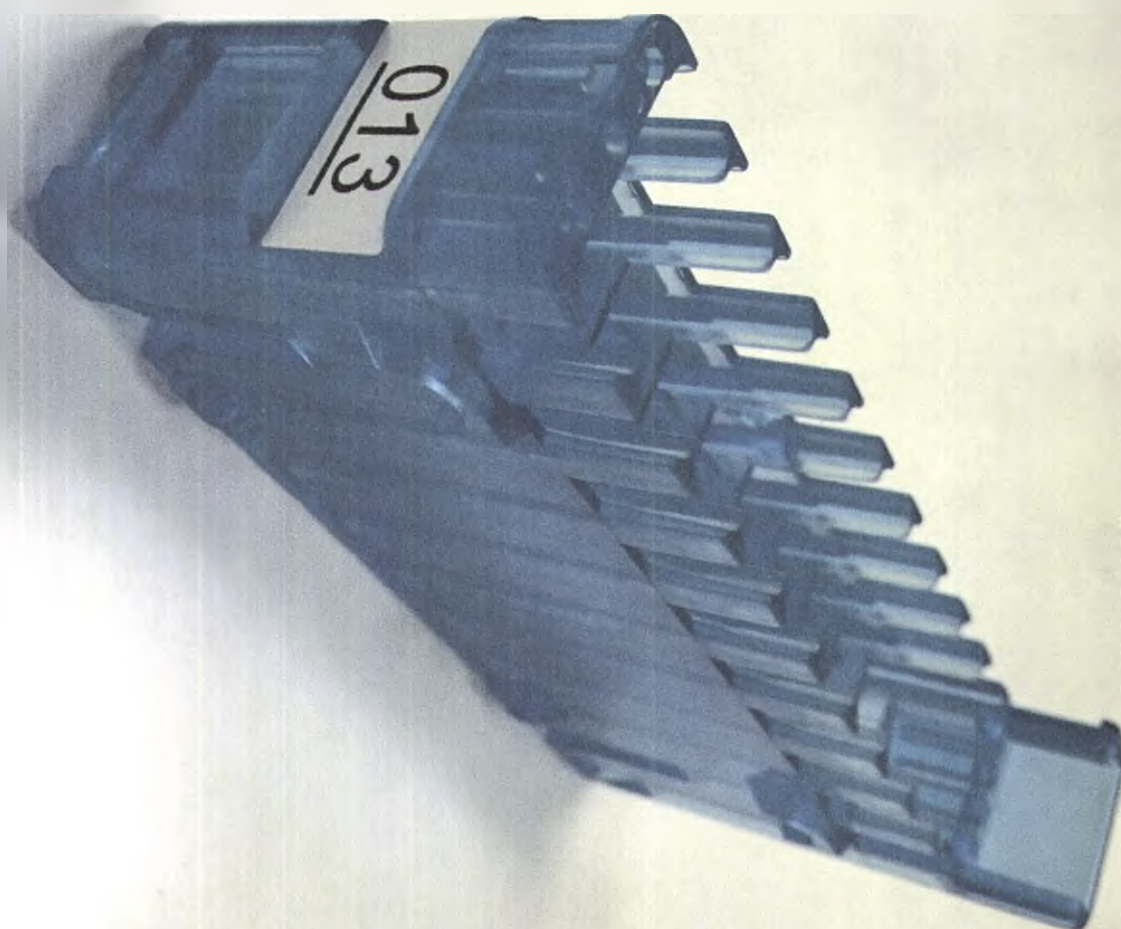


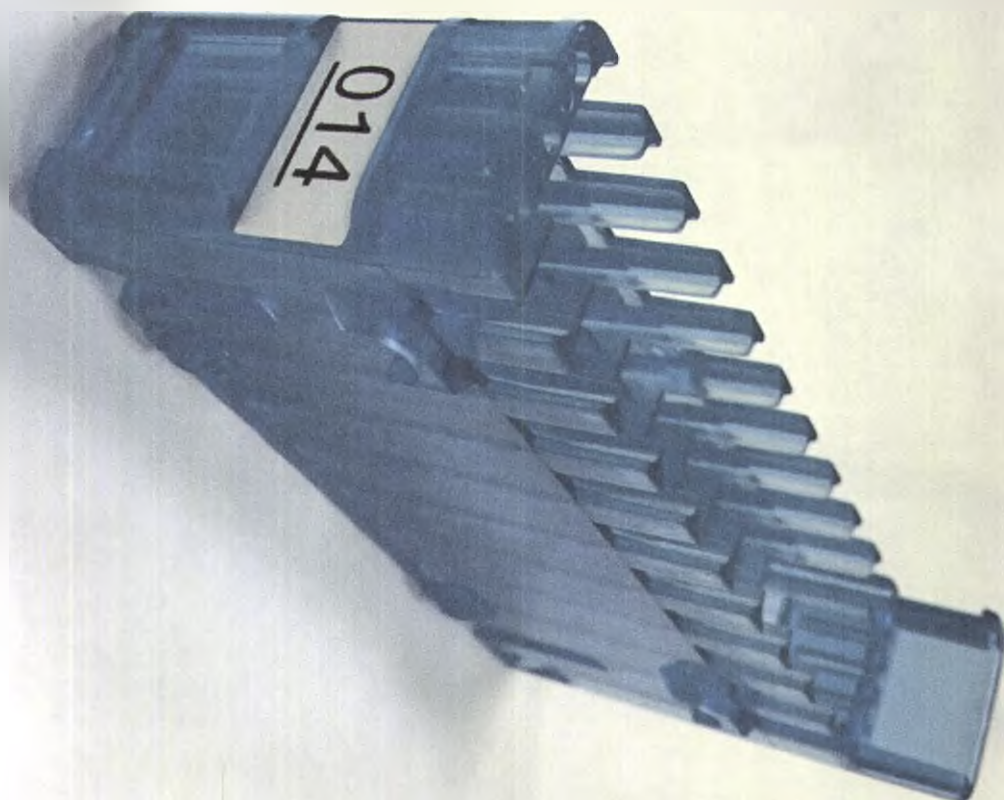


Штатив для образцов 015 - Вид сверху

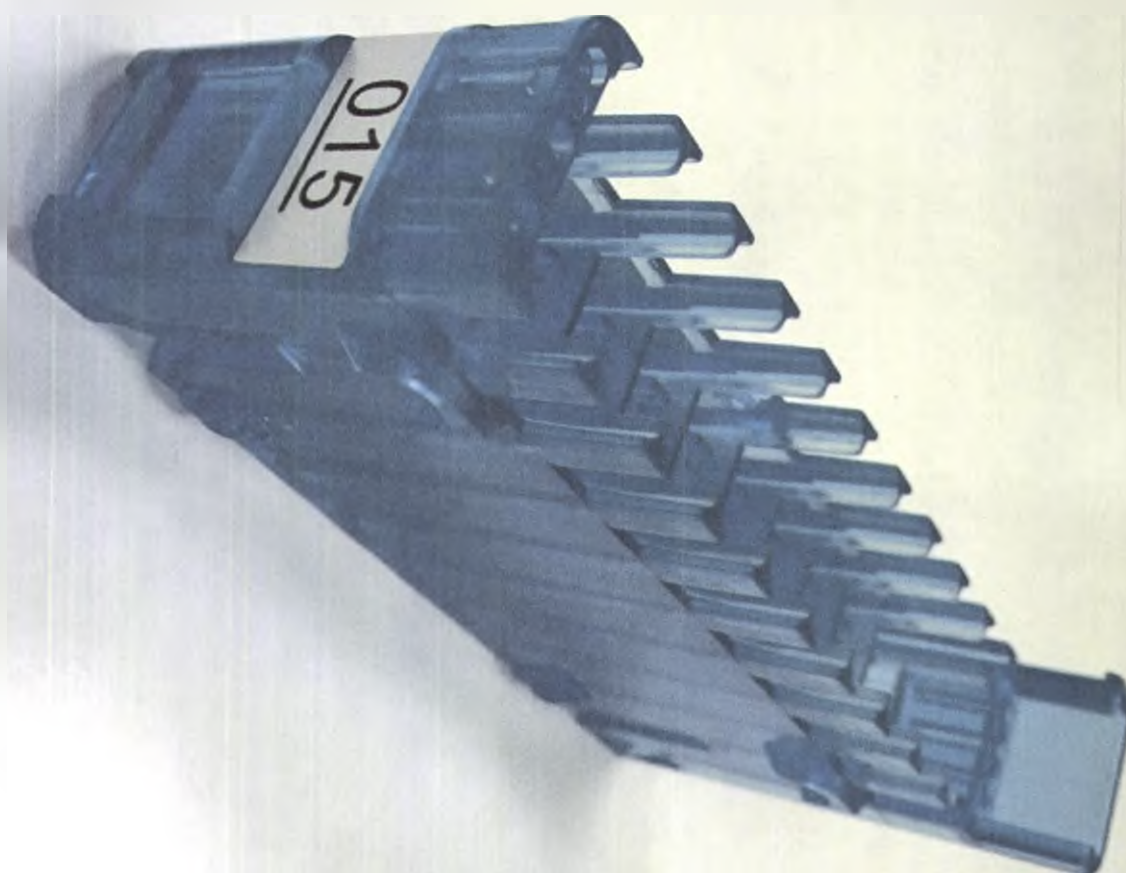


Штатив для образцов 016 - Вид сверху

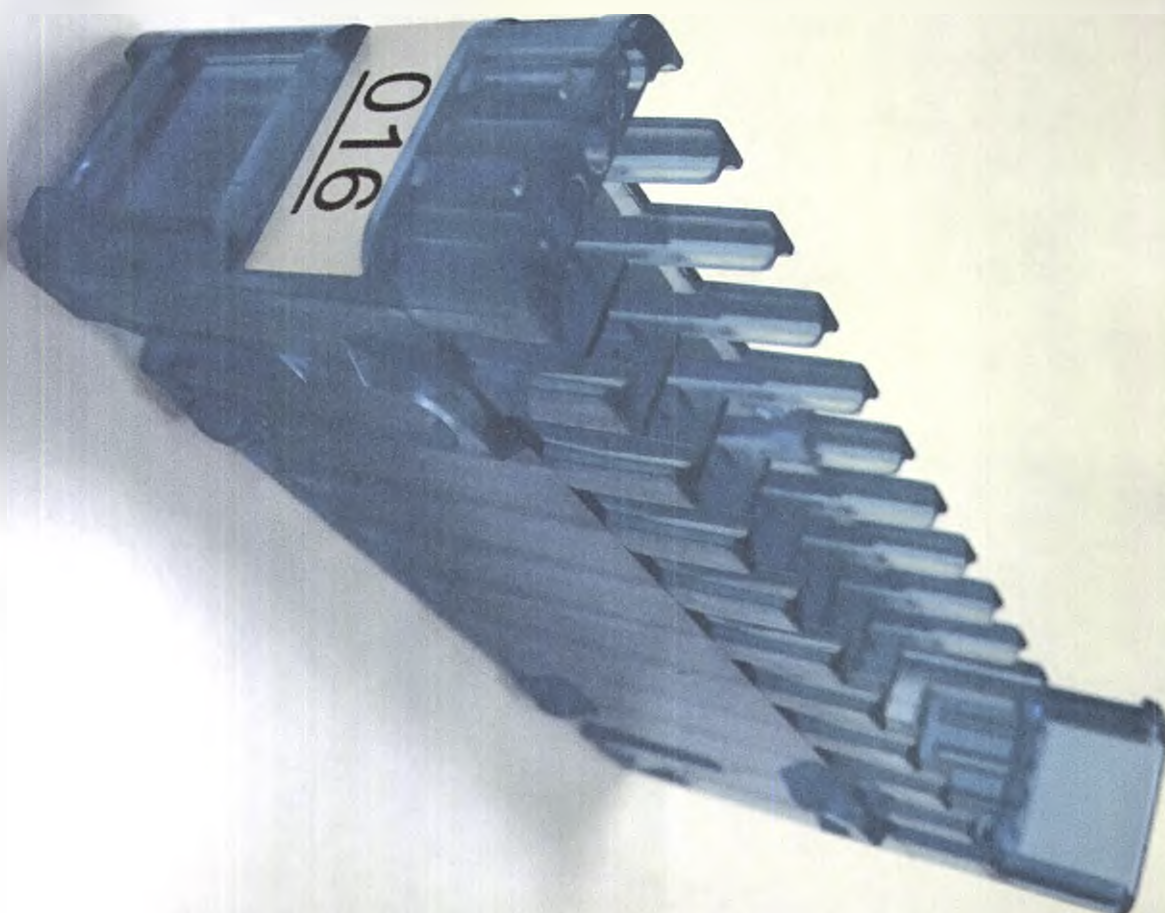


Штатив для образцов 017 - Вид сверху

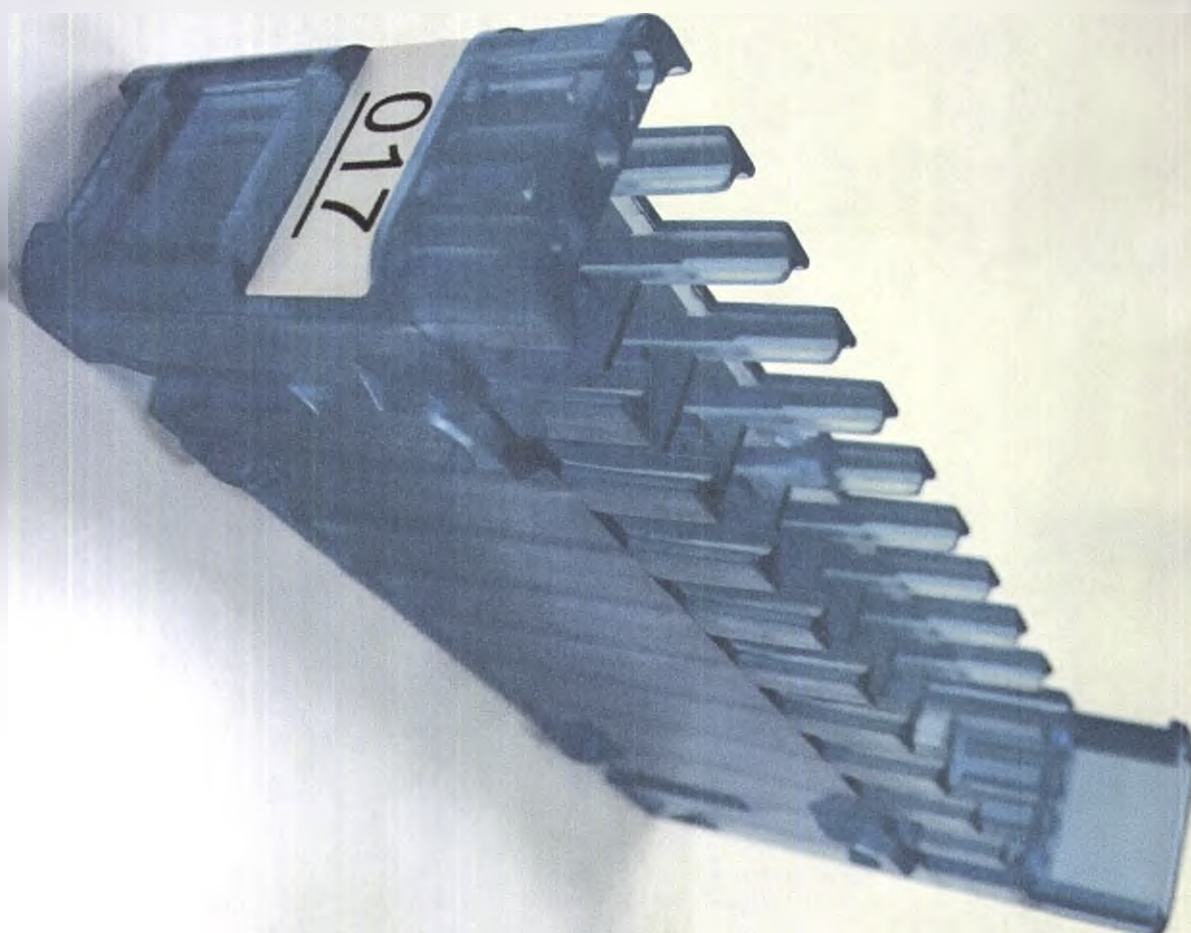


Штатив для образцов 018 - Вид сверху

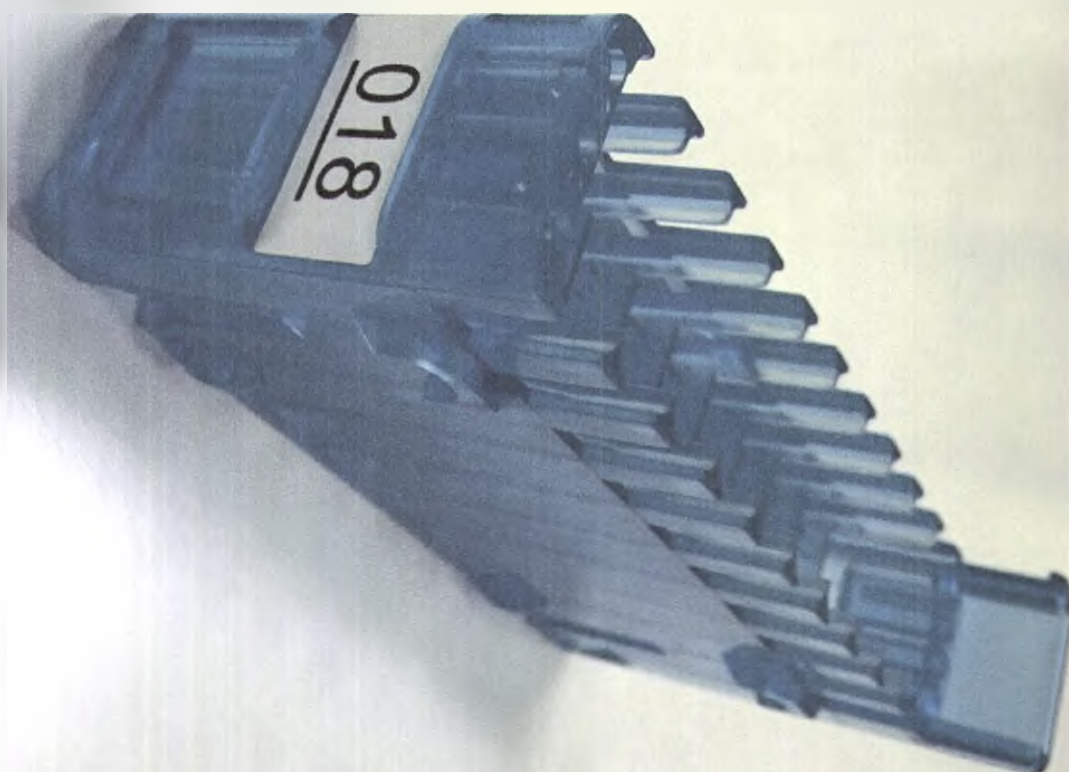

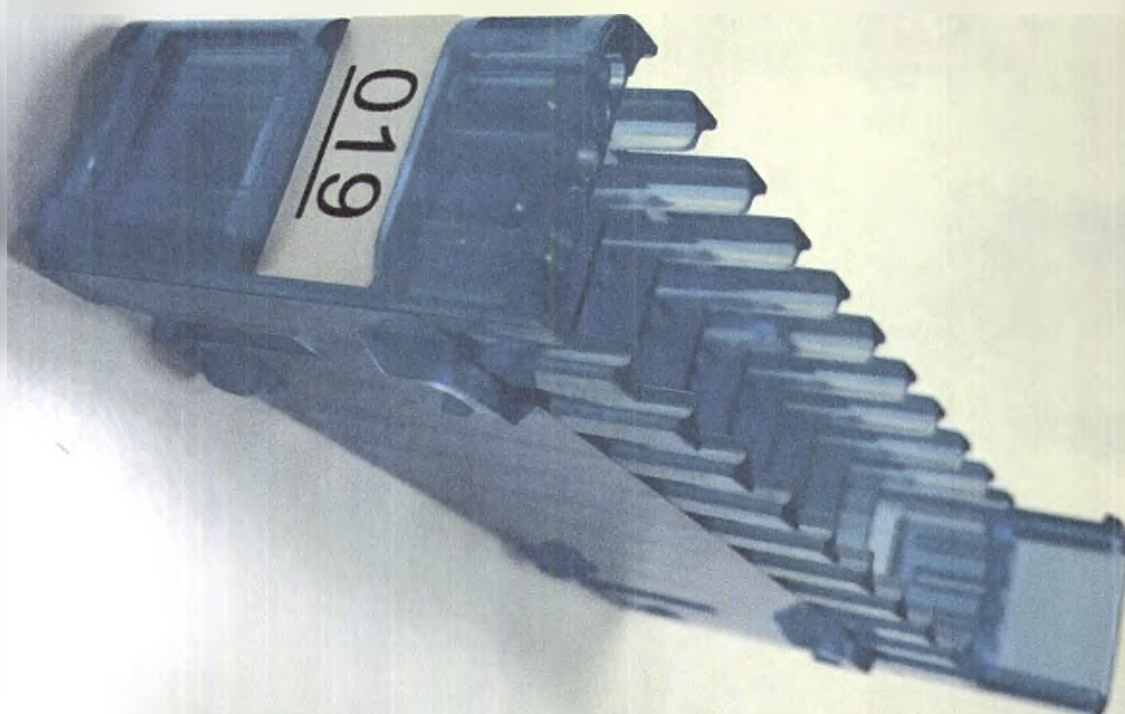


Штатив для образцов 020 - Вид сверху




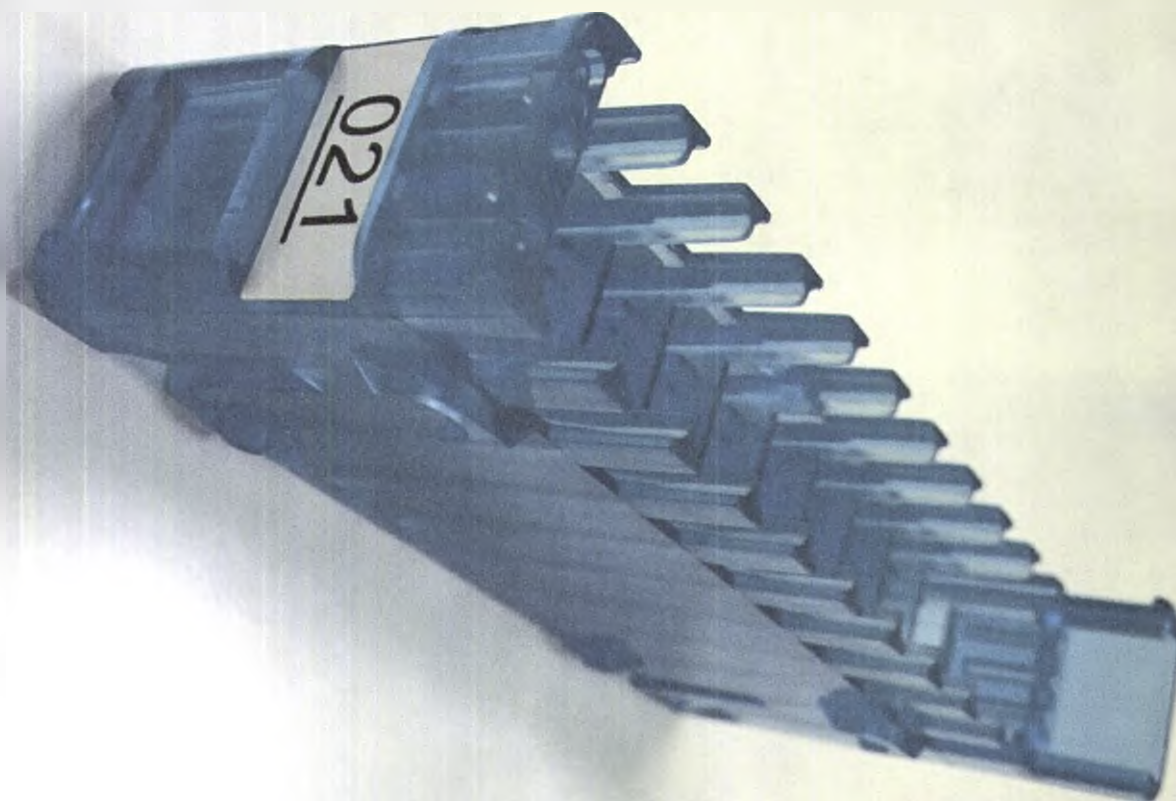


Штатив для образцов 022 - Вид сверху

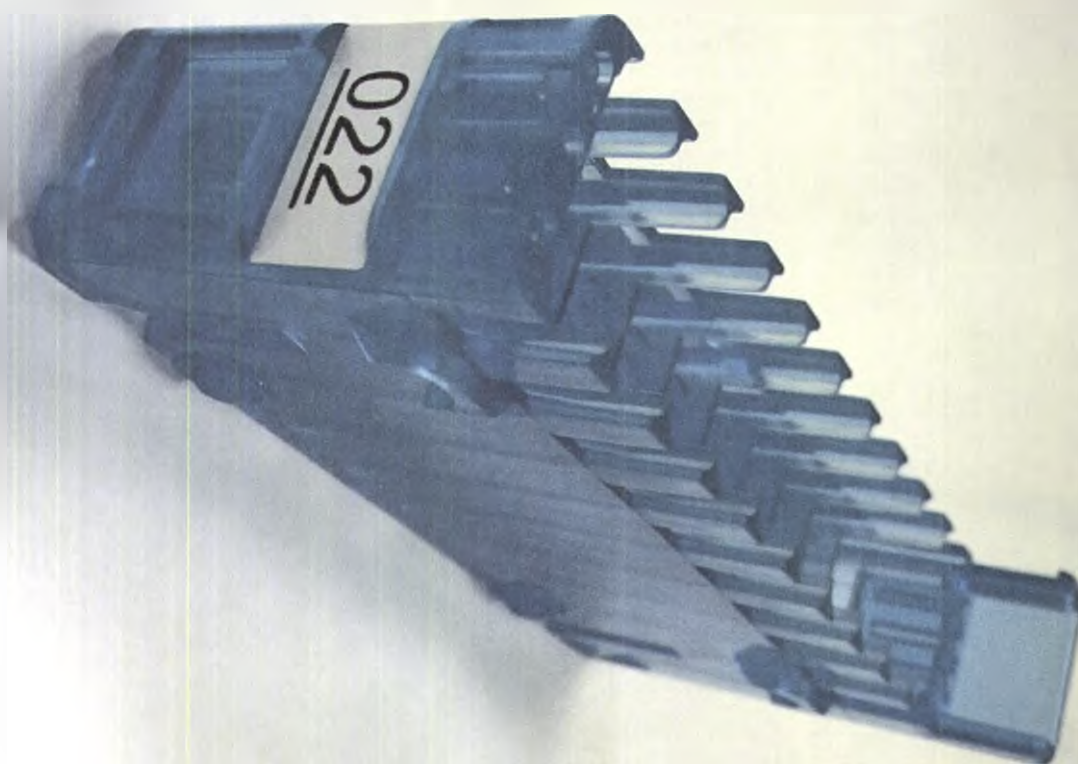


Штатив для образцов - Общий вид всех штативов для образцов, фотография 1

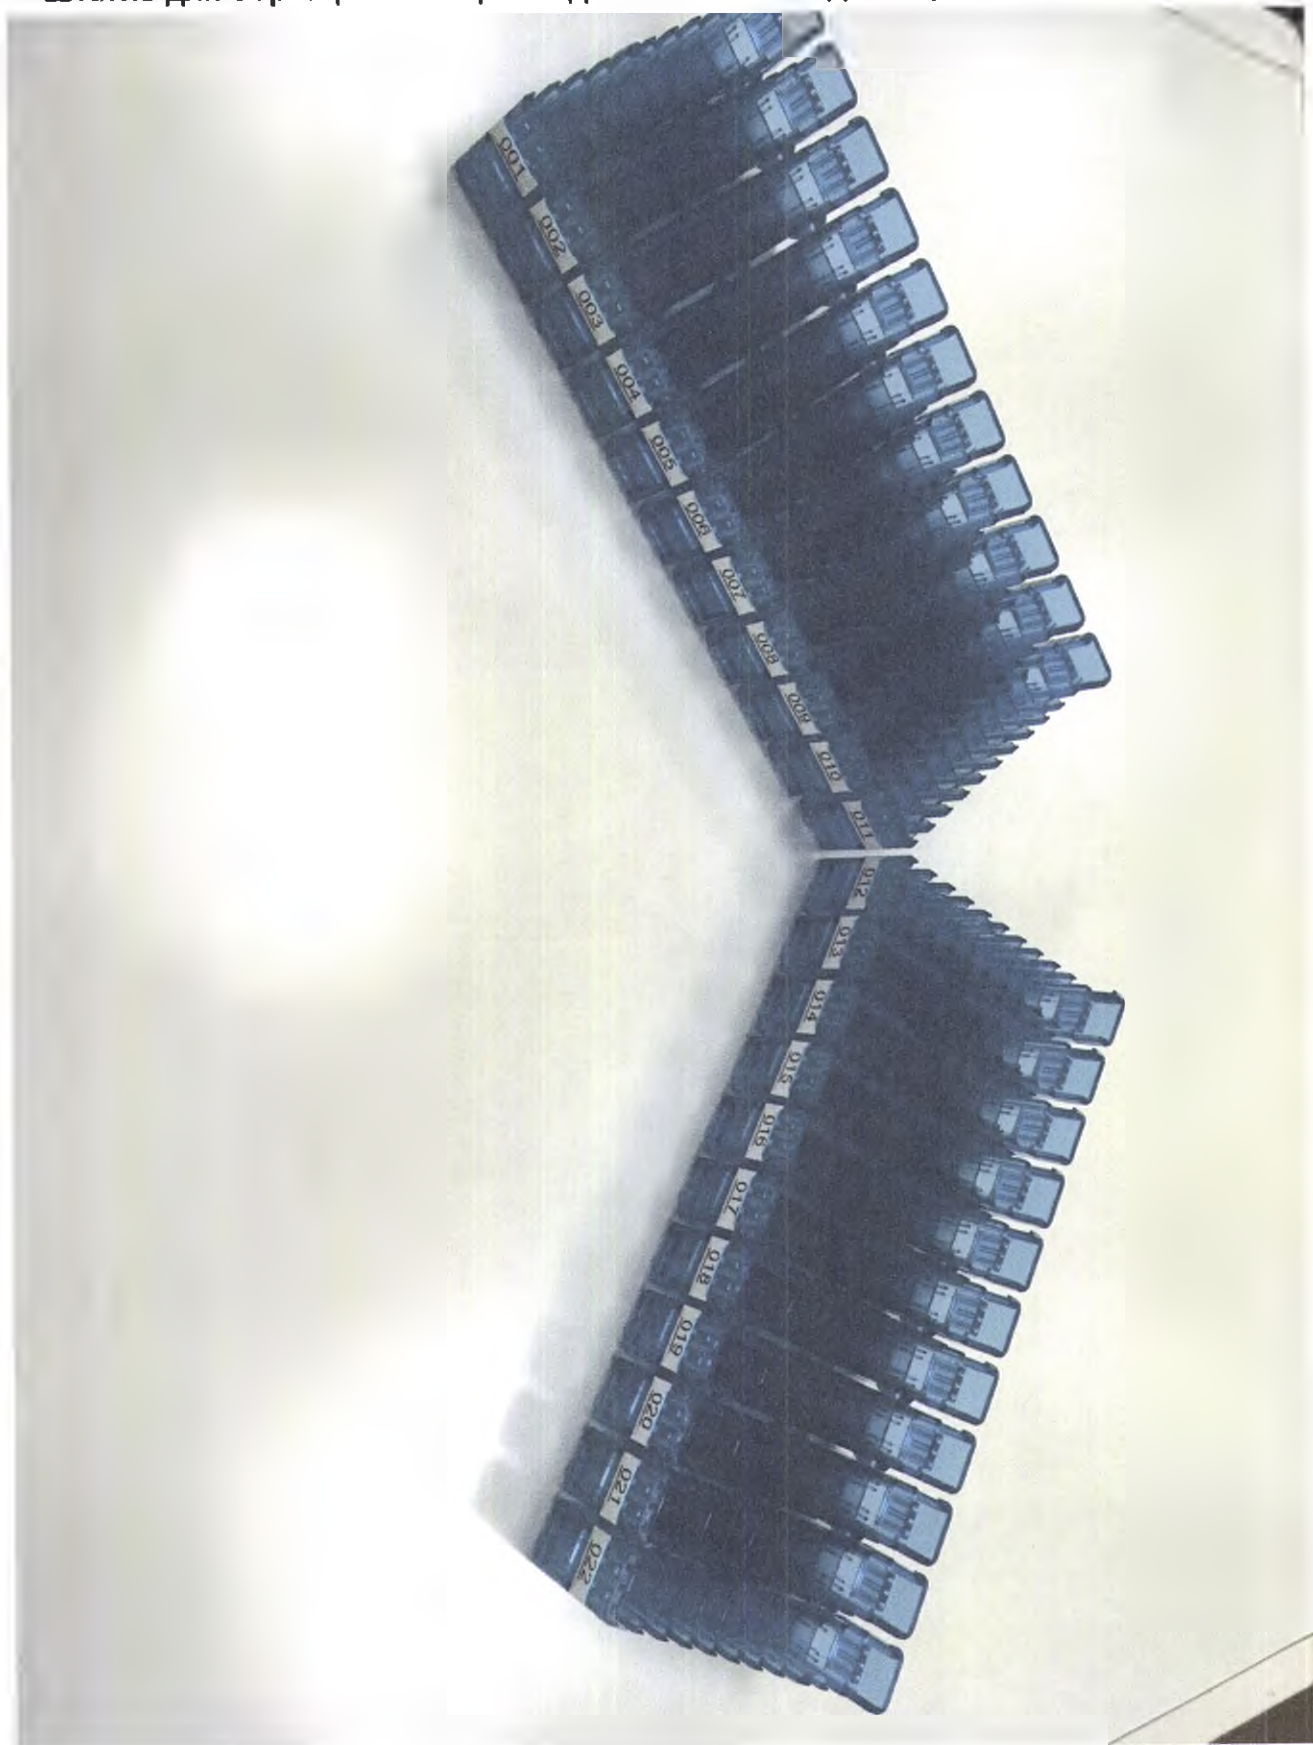




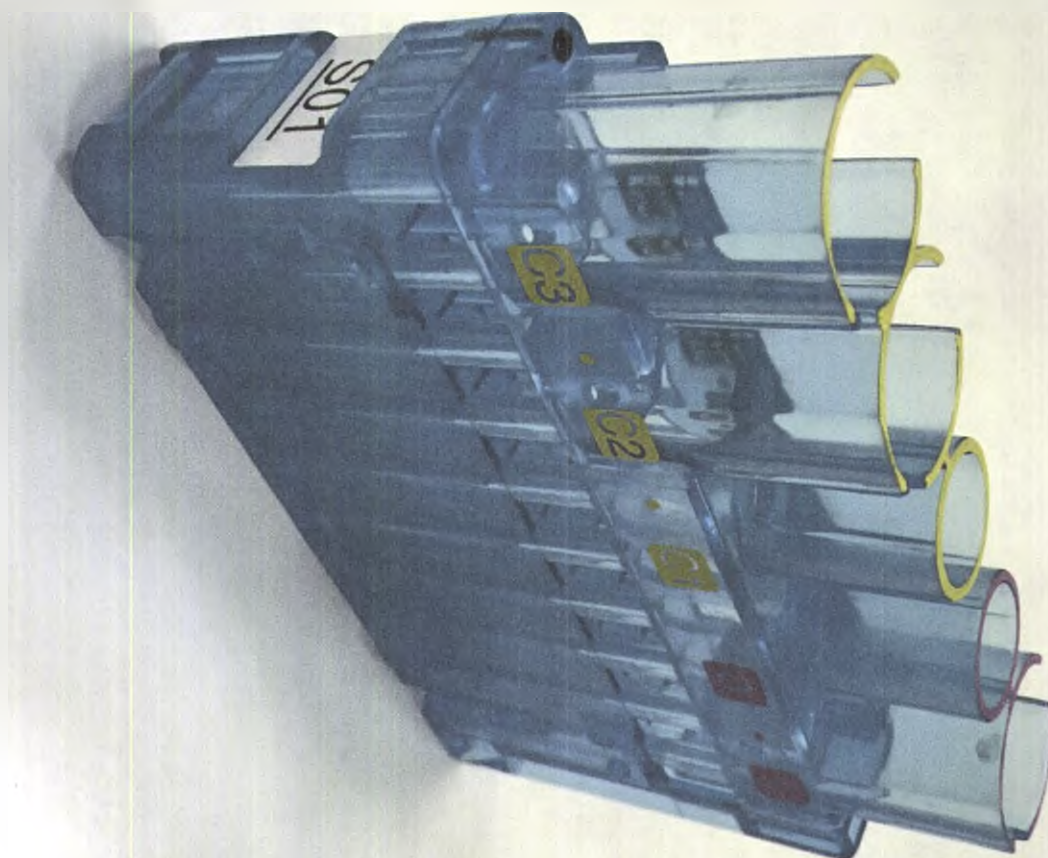


Штатив для образцов малого объёма (штатив М) – М01

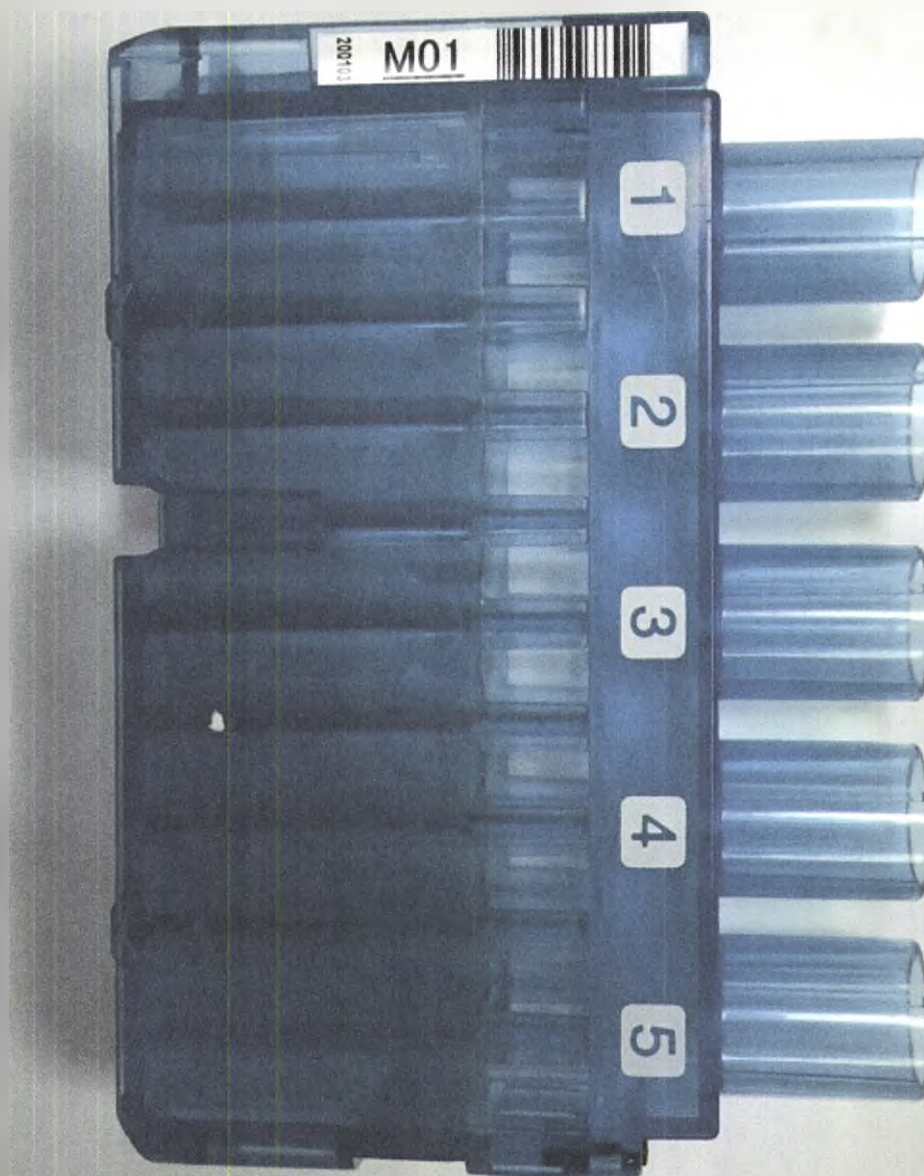


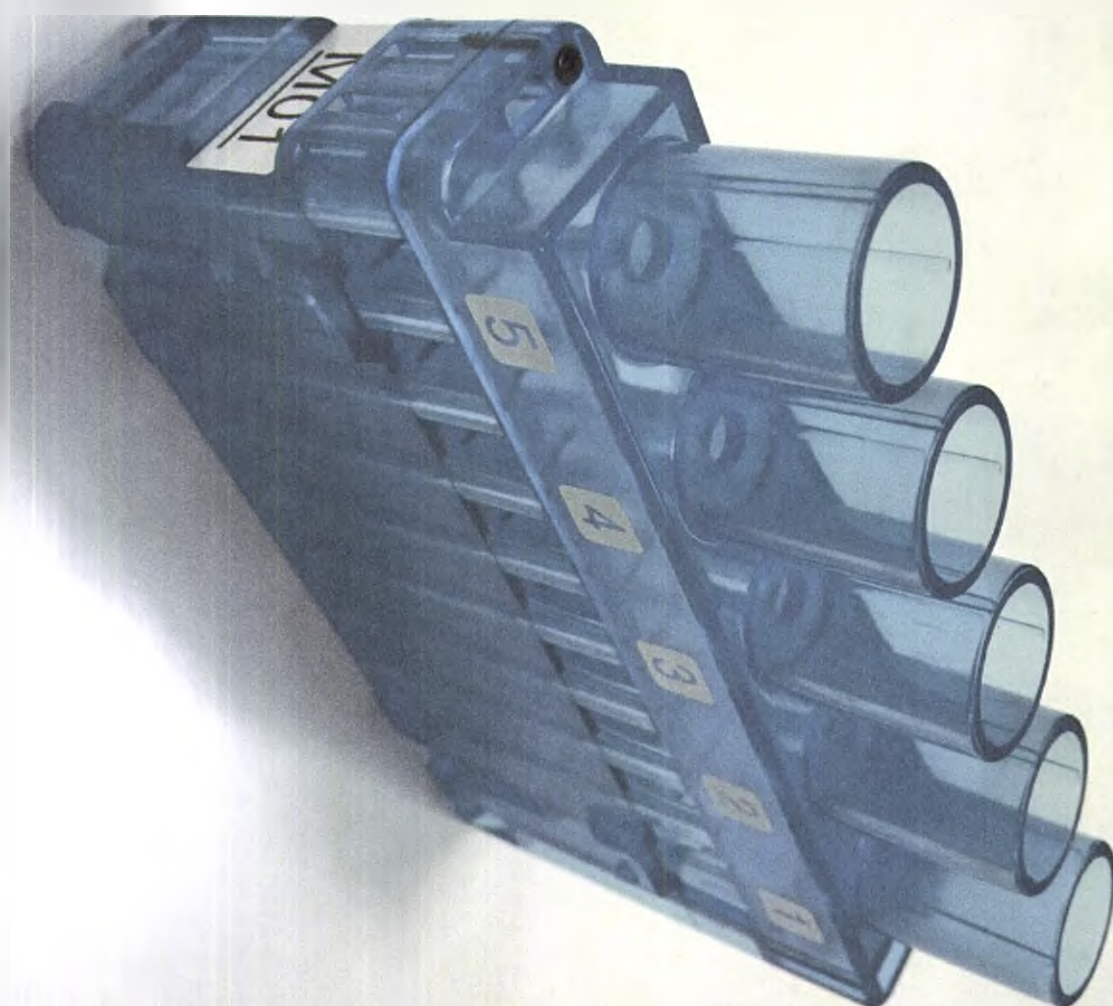

Лоток с 10 штативами – Фотография 1

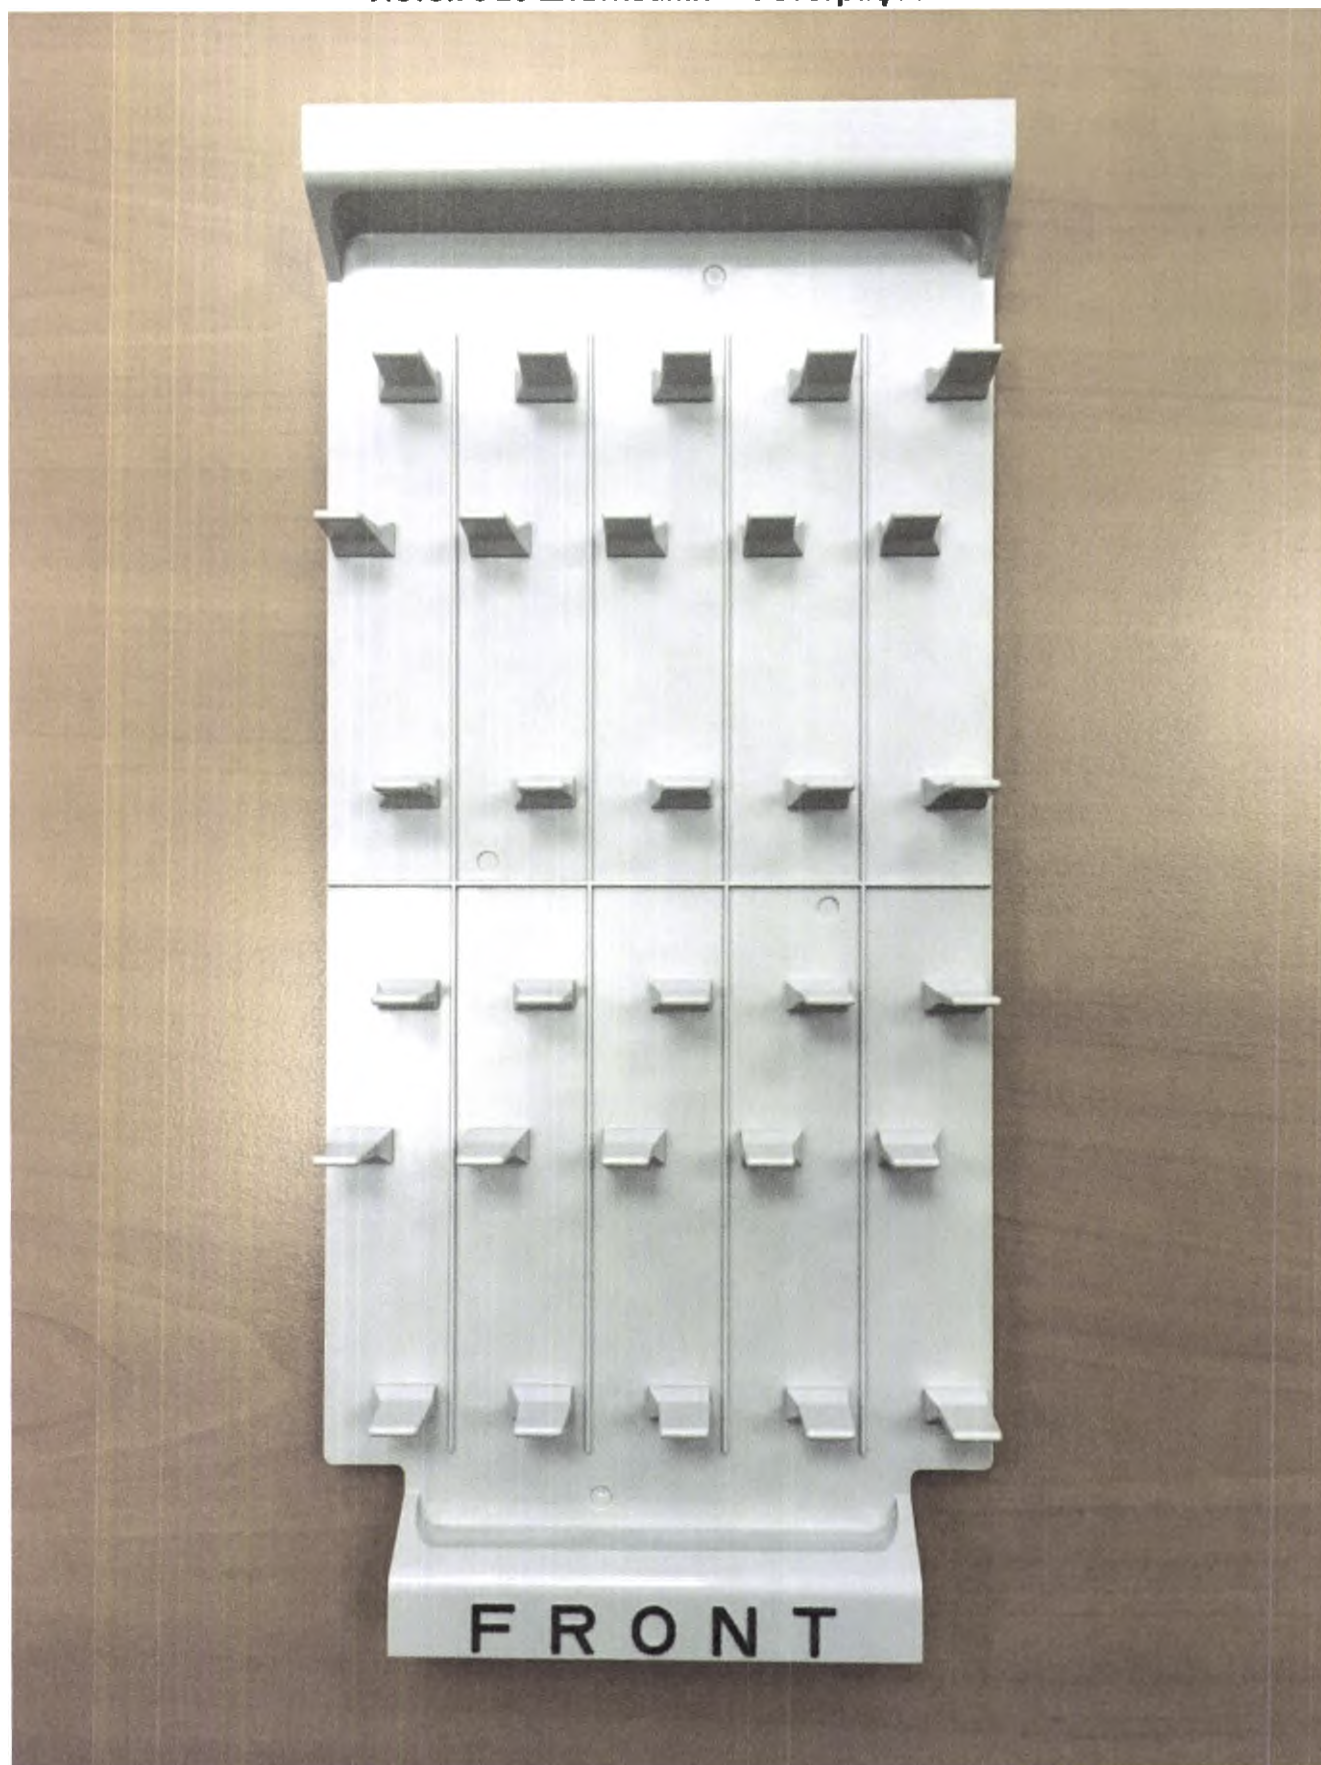

Ёмкость для дистиллированной и/или деионизированной воды, включая соединительные кабели и 1 набор трубок - Фотография 1

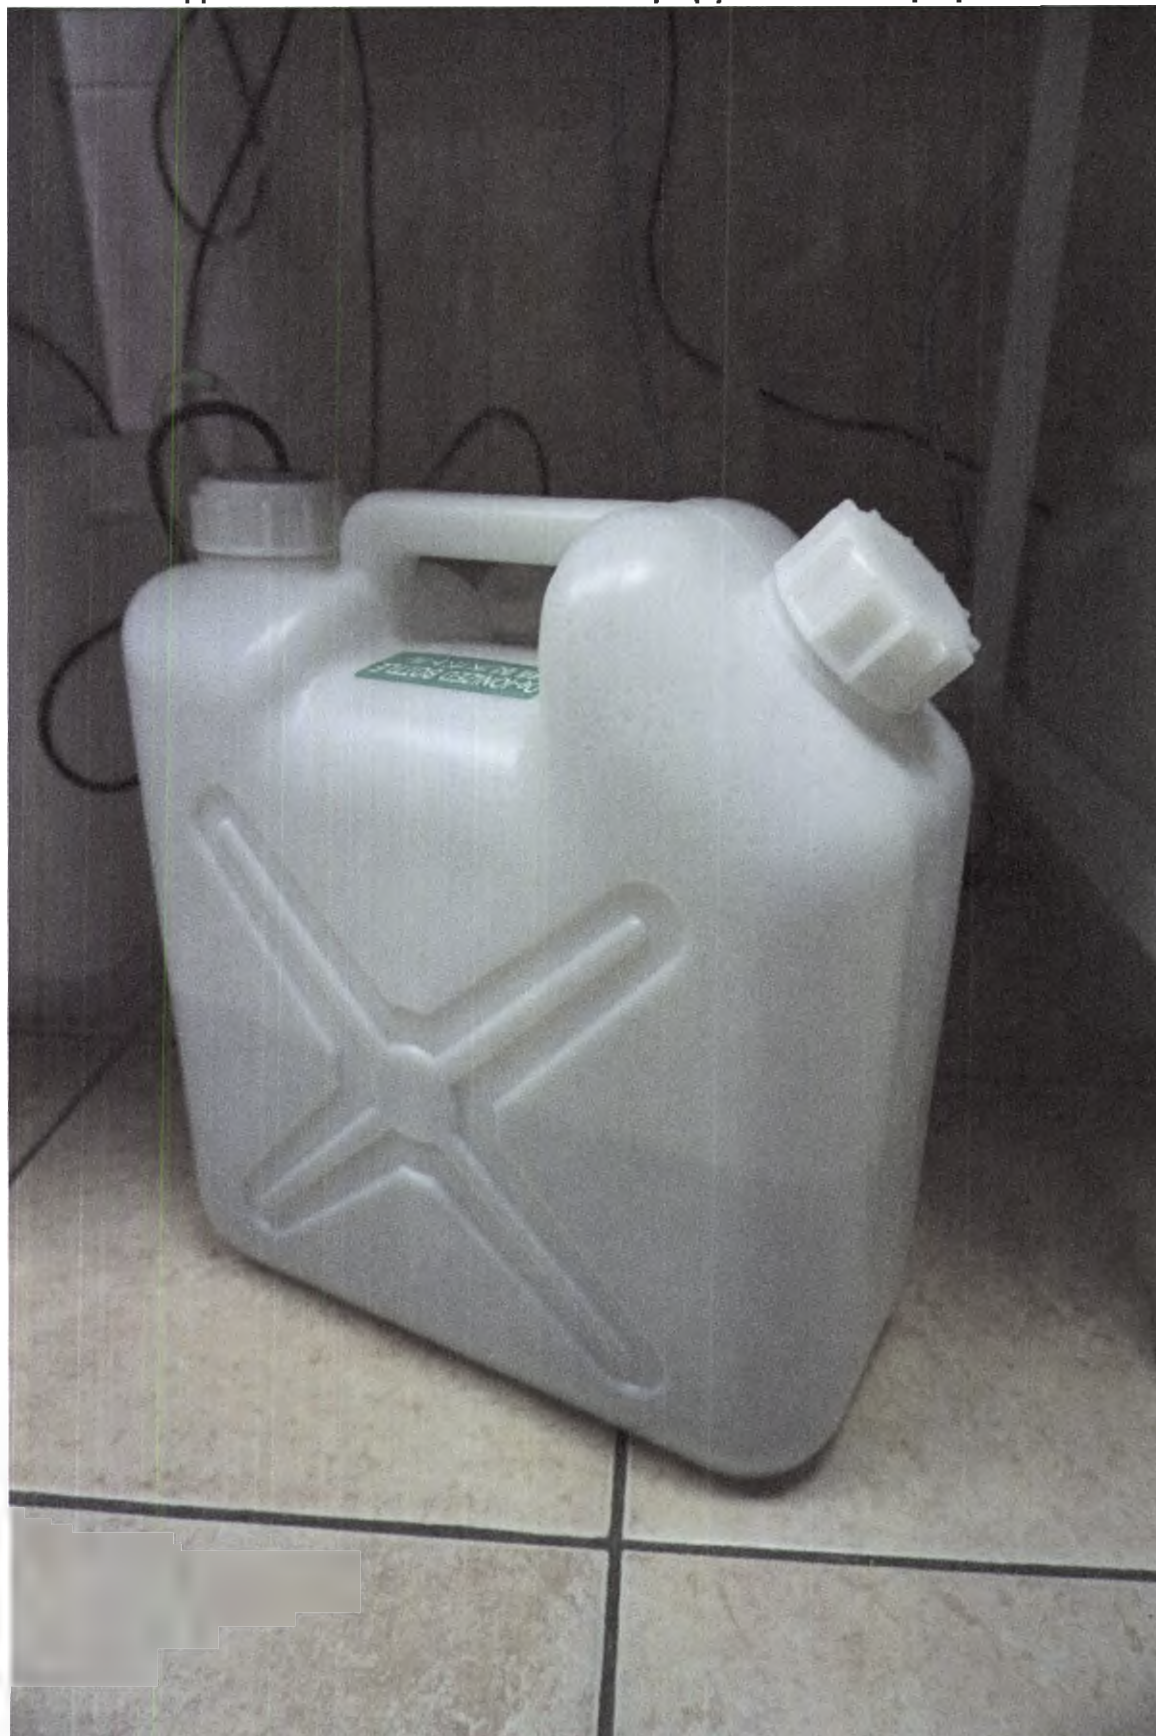

Ёмкость для дистиллированной и/или деионизированной воды, включая соединительные кабели и 1 набор трубок - Фотография 2



Ёмкость для промывающего раствора, включая соединительные кабели и 1 набор трубок - Фотография 1




Ёмкость для промывающего раствора, включая соединительные кабели и 1 набор трубок - Фотография 2



Ёмкость для отработанной жидкости, включая соединительные кабели и 1 набор трубок – фотография 1



Ёмкость для отработанной жидкости, включая соединительные кабели и 1 набор трубок – фотография 2

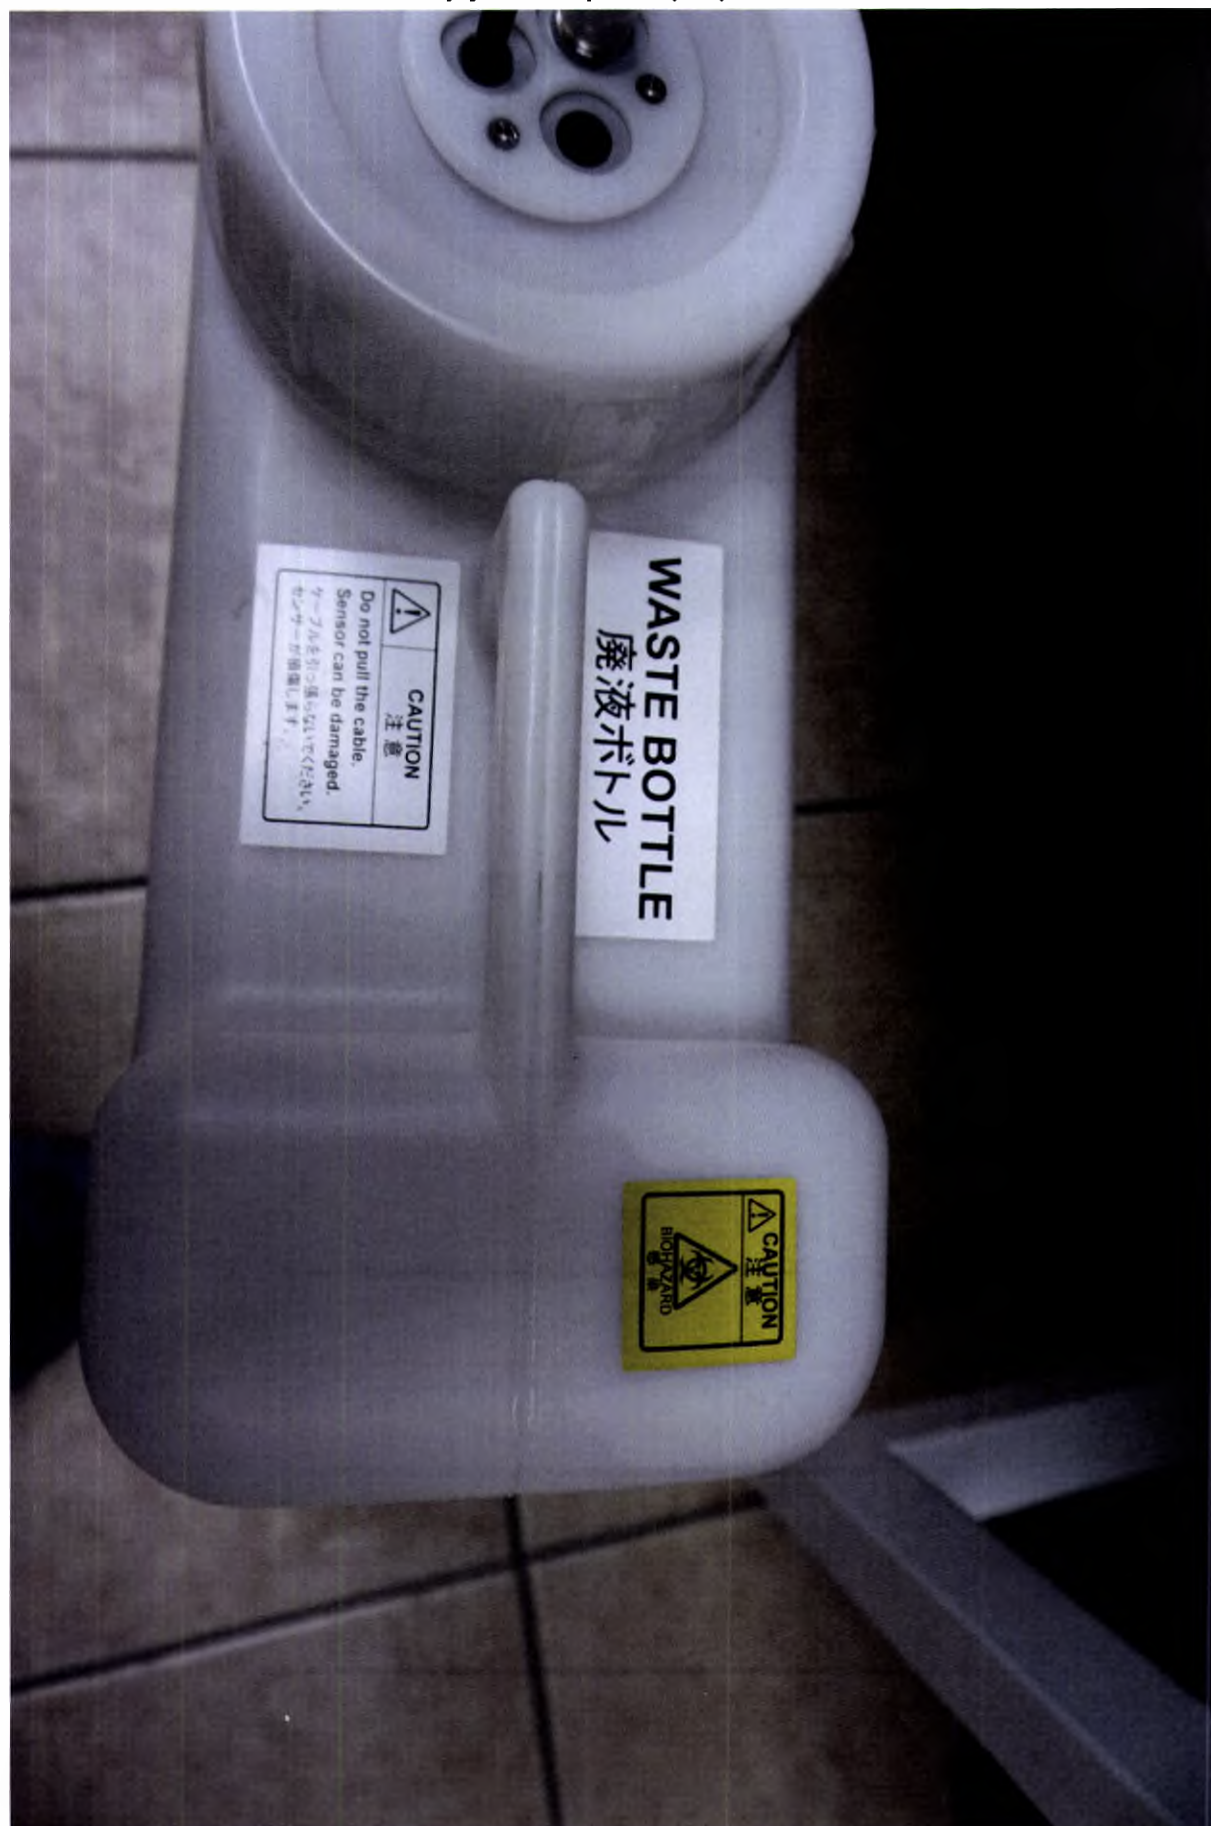

Ёмкость для отработанной жидкости, включая соединительные кабели и 1 набор трубок – фотография 3



Кабель питания



Программное обеспечение на компакт-диске



Кабель локальной сети



Емкость для дистиллированной и/или деионизованной воды (для пополнения) –
Фотография 1



Емкость для дистиллированной и/или деионизованной воды (для пополнения) –
Фотография 2



Емкость для дистиллированной и/или деионизованной воды (для пополнения) –


Фотография 3




Емкость для дистиллированной и/или деионизованной воды (для пополнения) –
Фотография 4



Ёмкость для промывающего раствора (для пополнения) – фотография 1

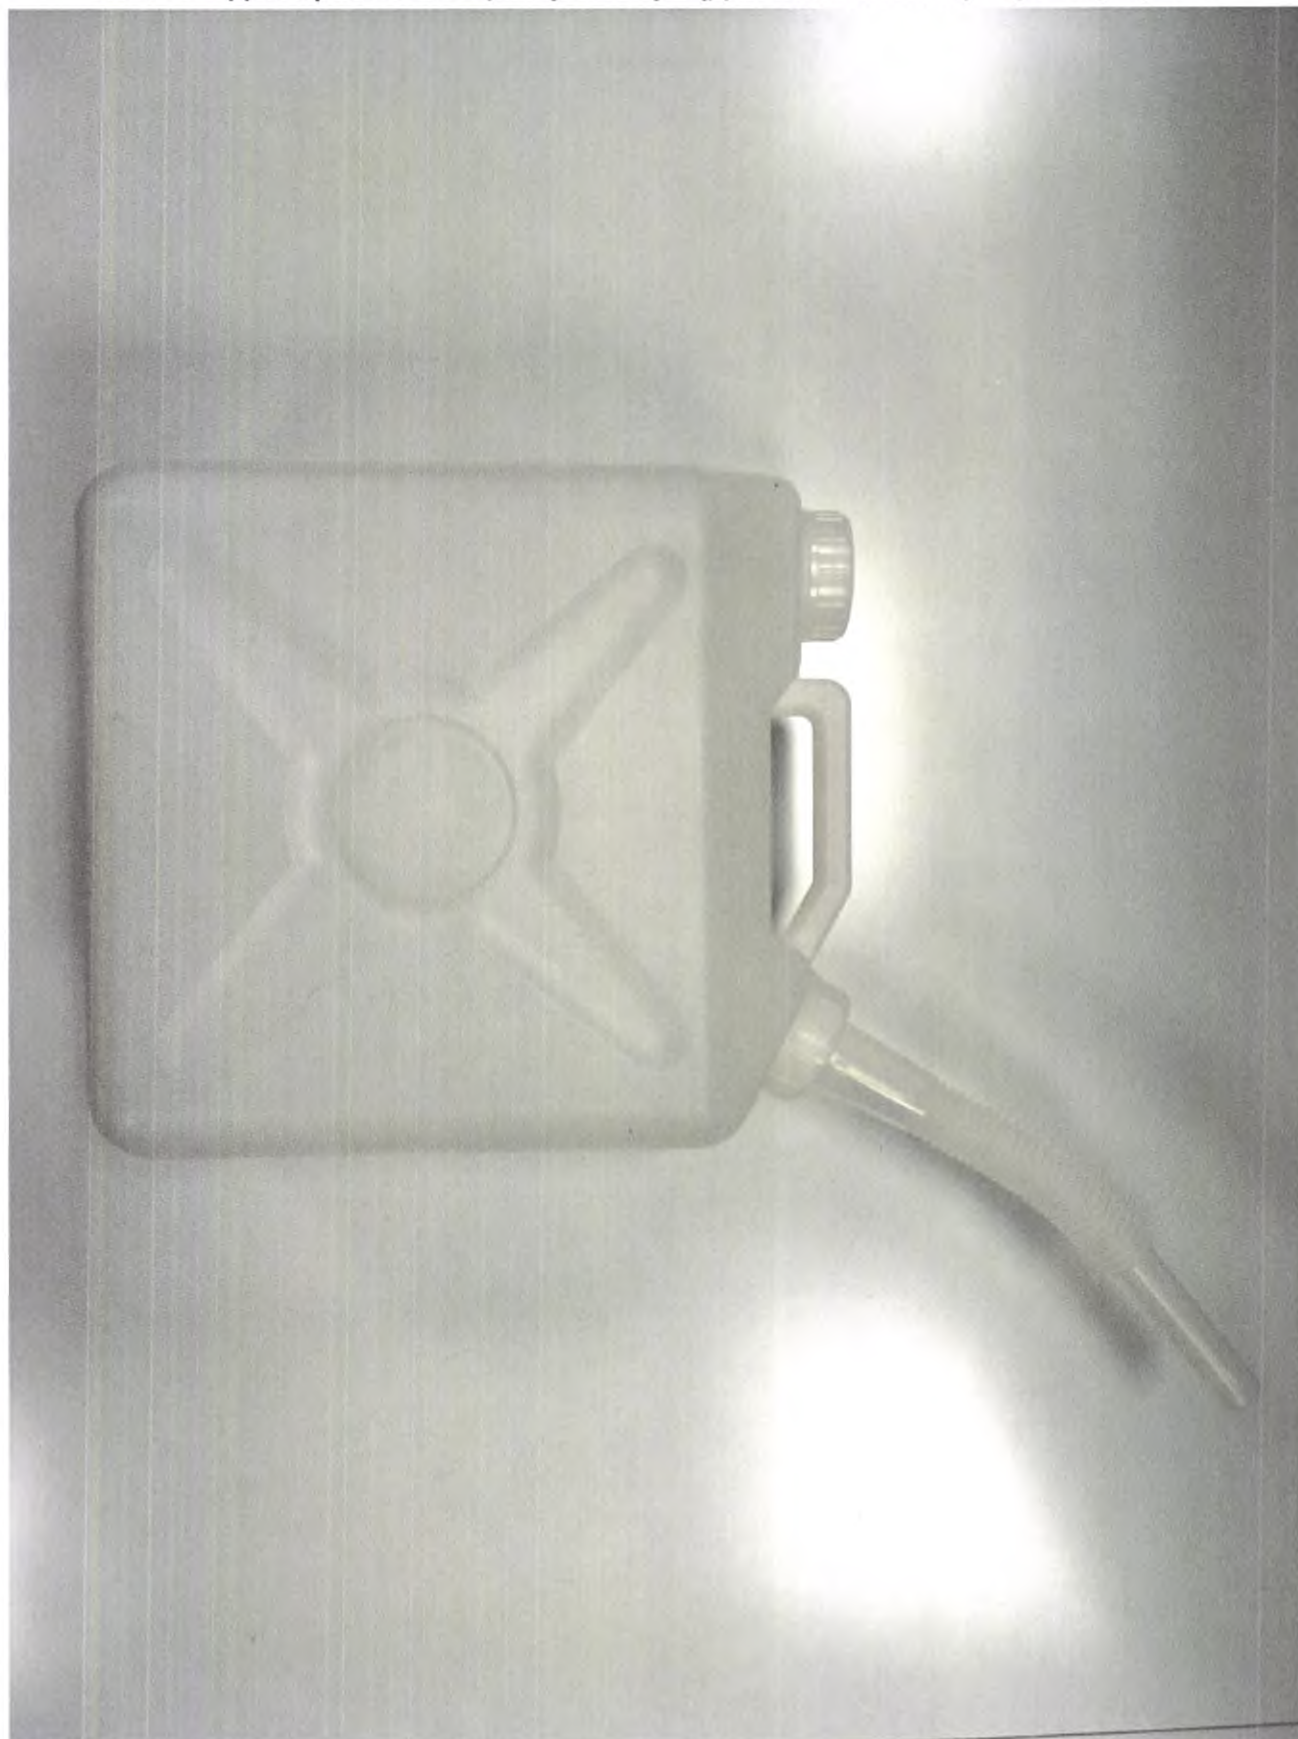

Ёмкость для промывающего раствора (для пополнения) – фотография 2

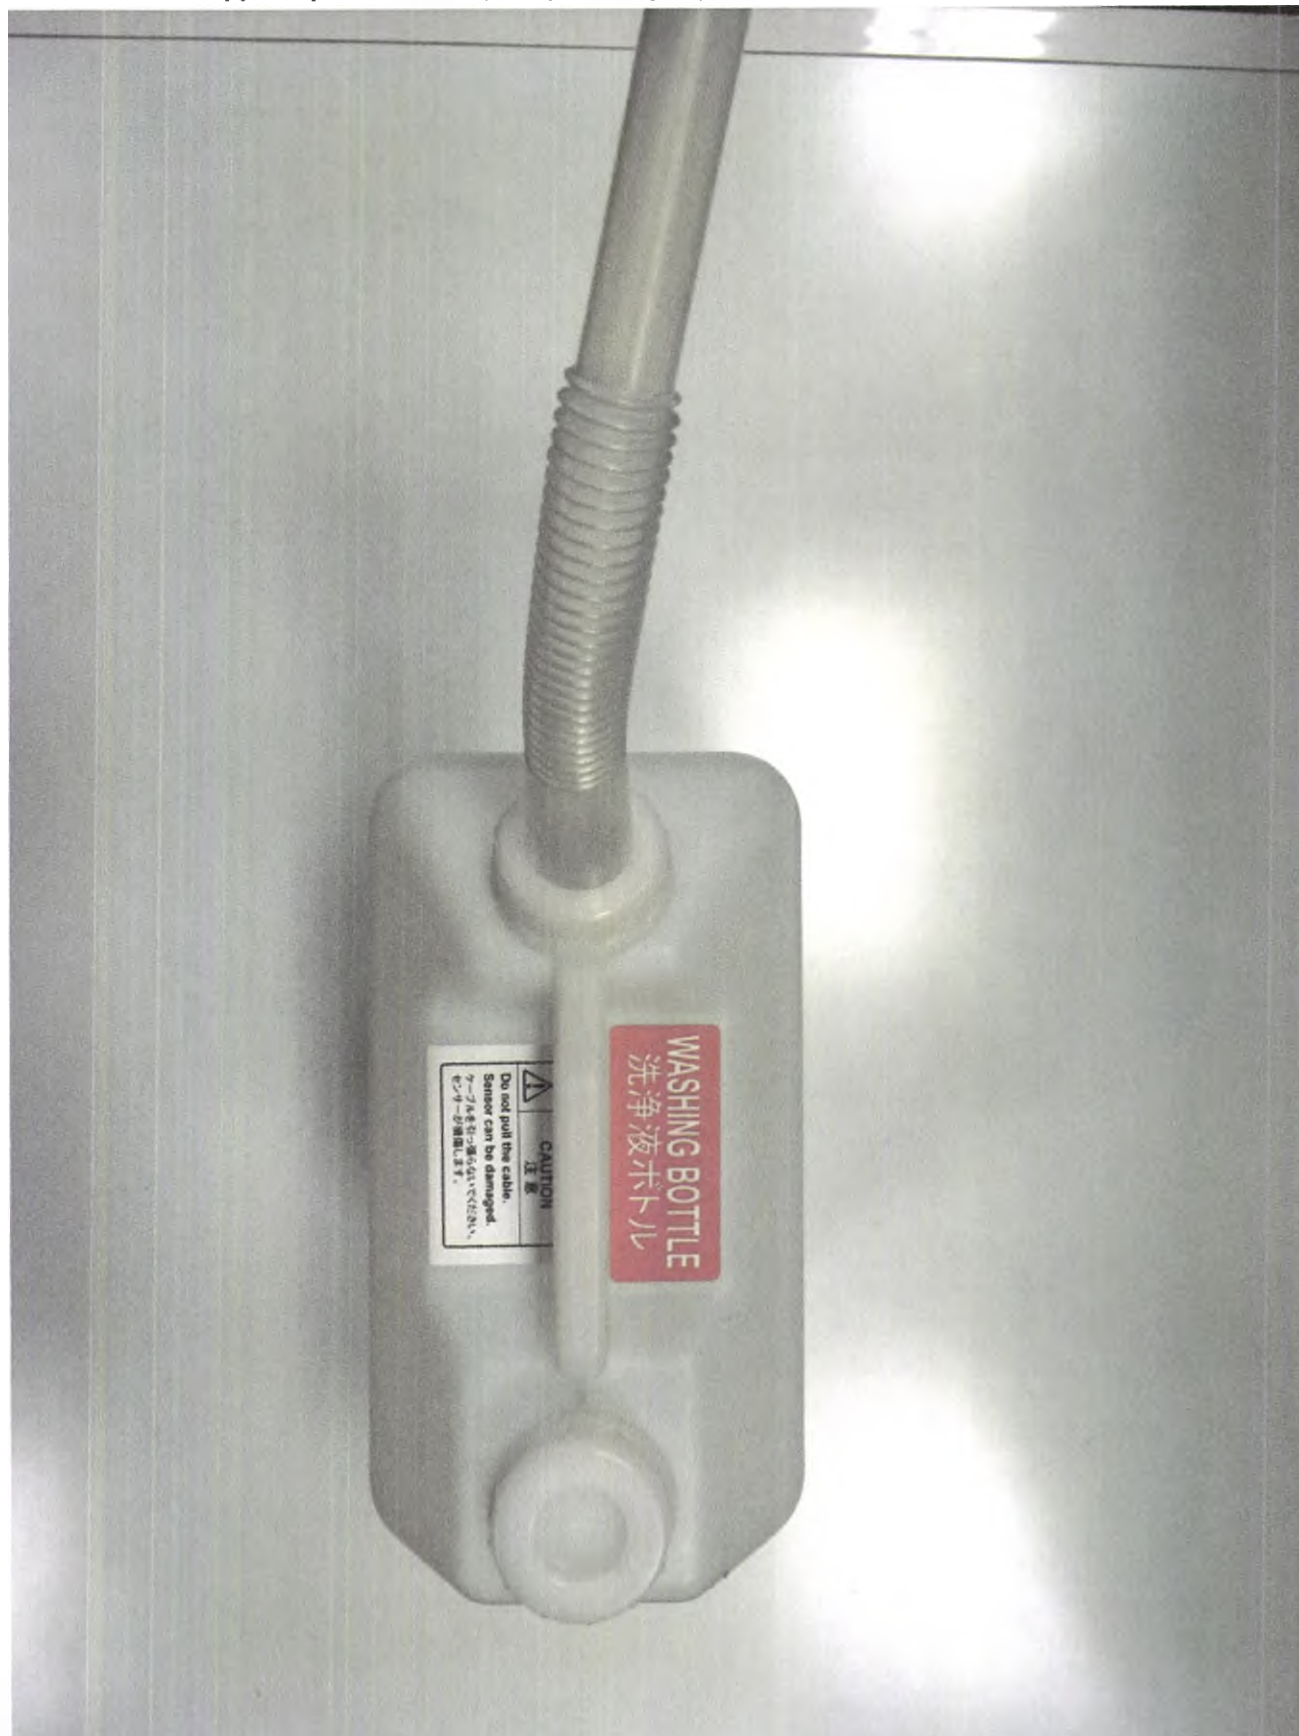

Ёмкость для промывающего раствора (для пополнения) – фотография 3




Установочная пластина для загрузочного лотка на два штатива




ПК – Системный блок - Фотография 1




ПК – Системный блок - Фотография 2

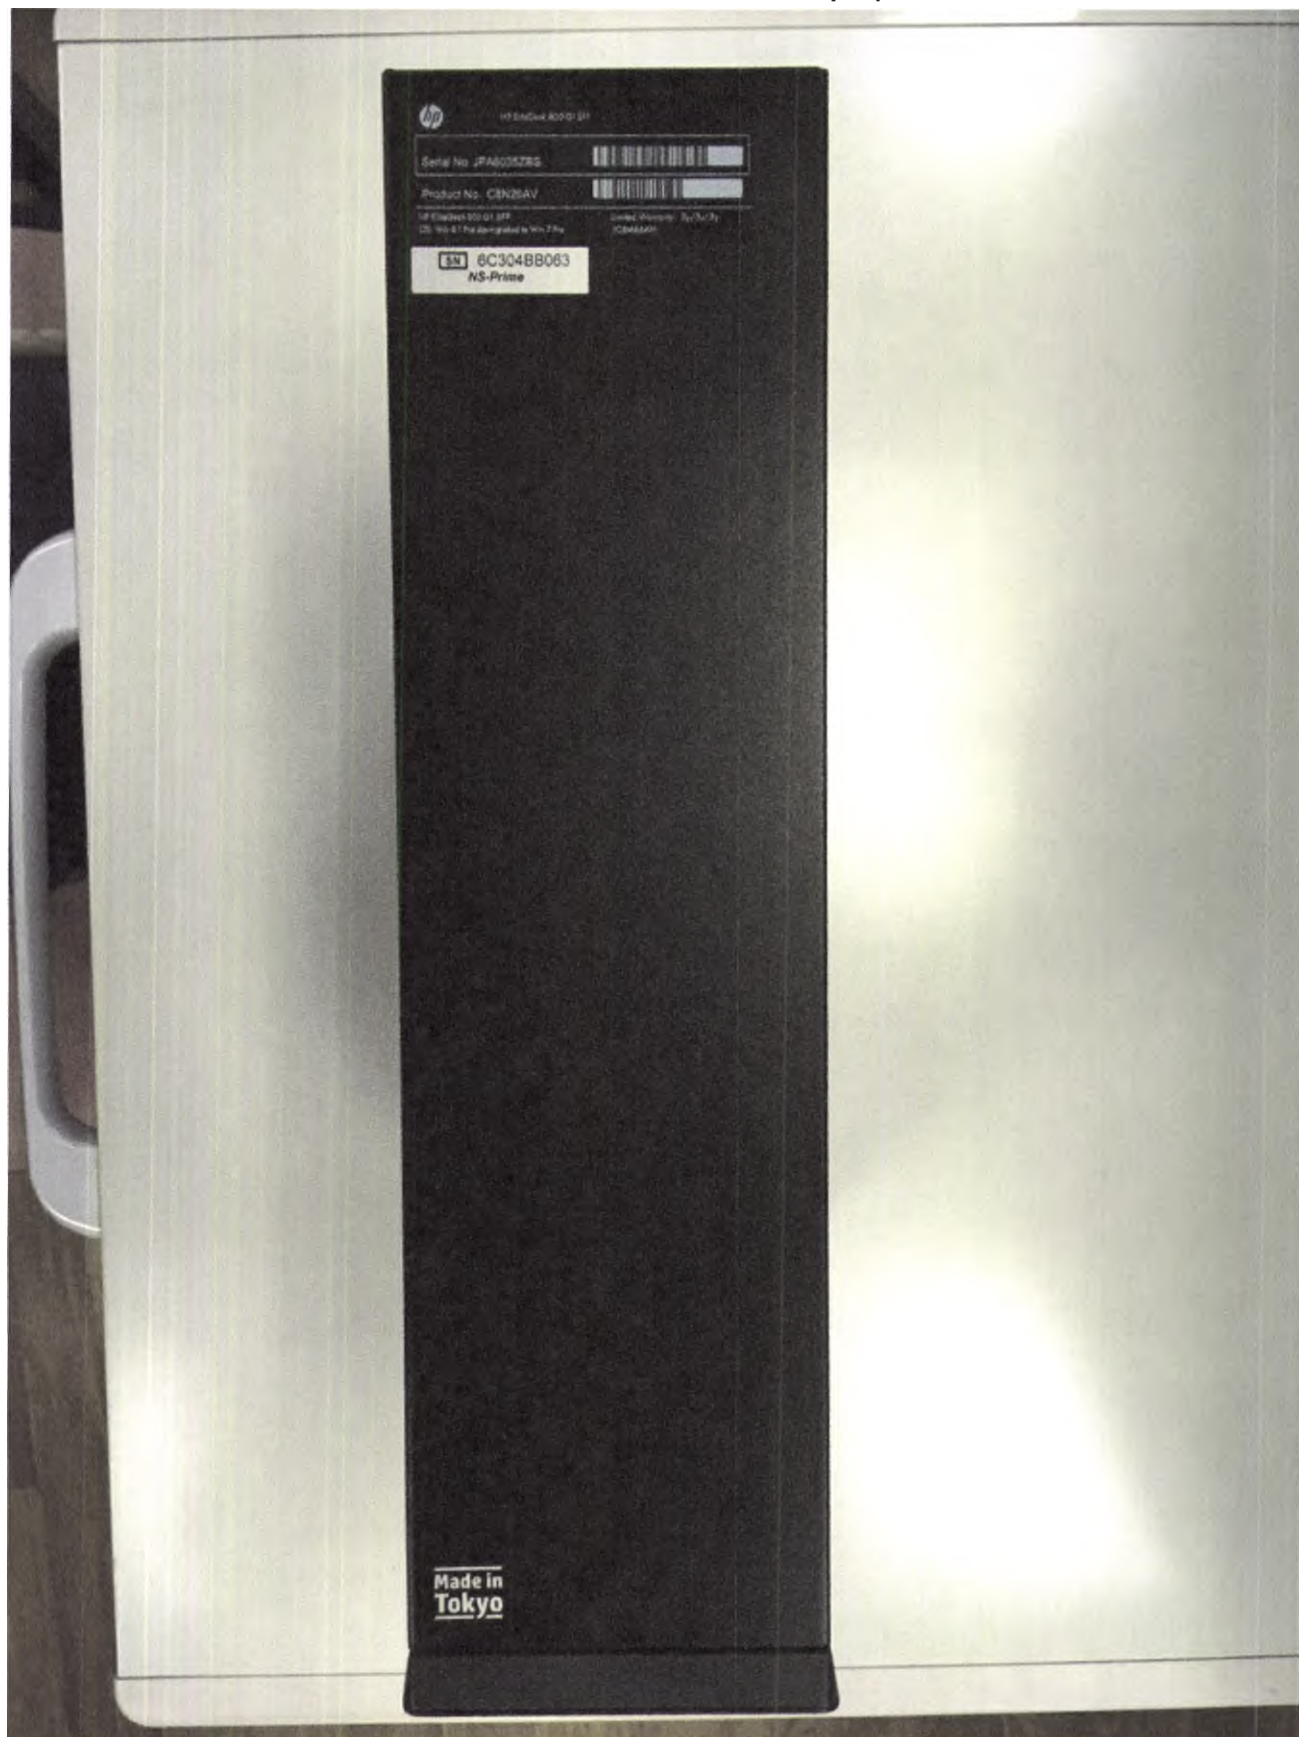

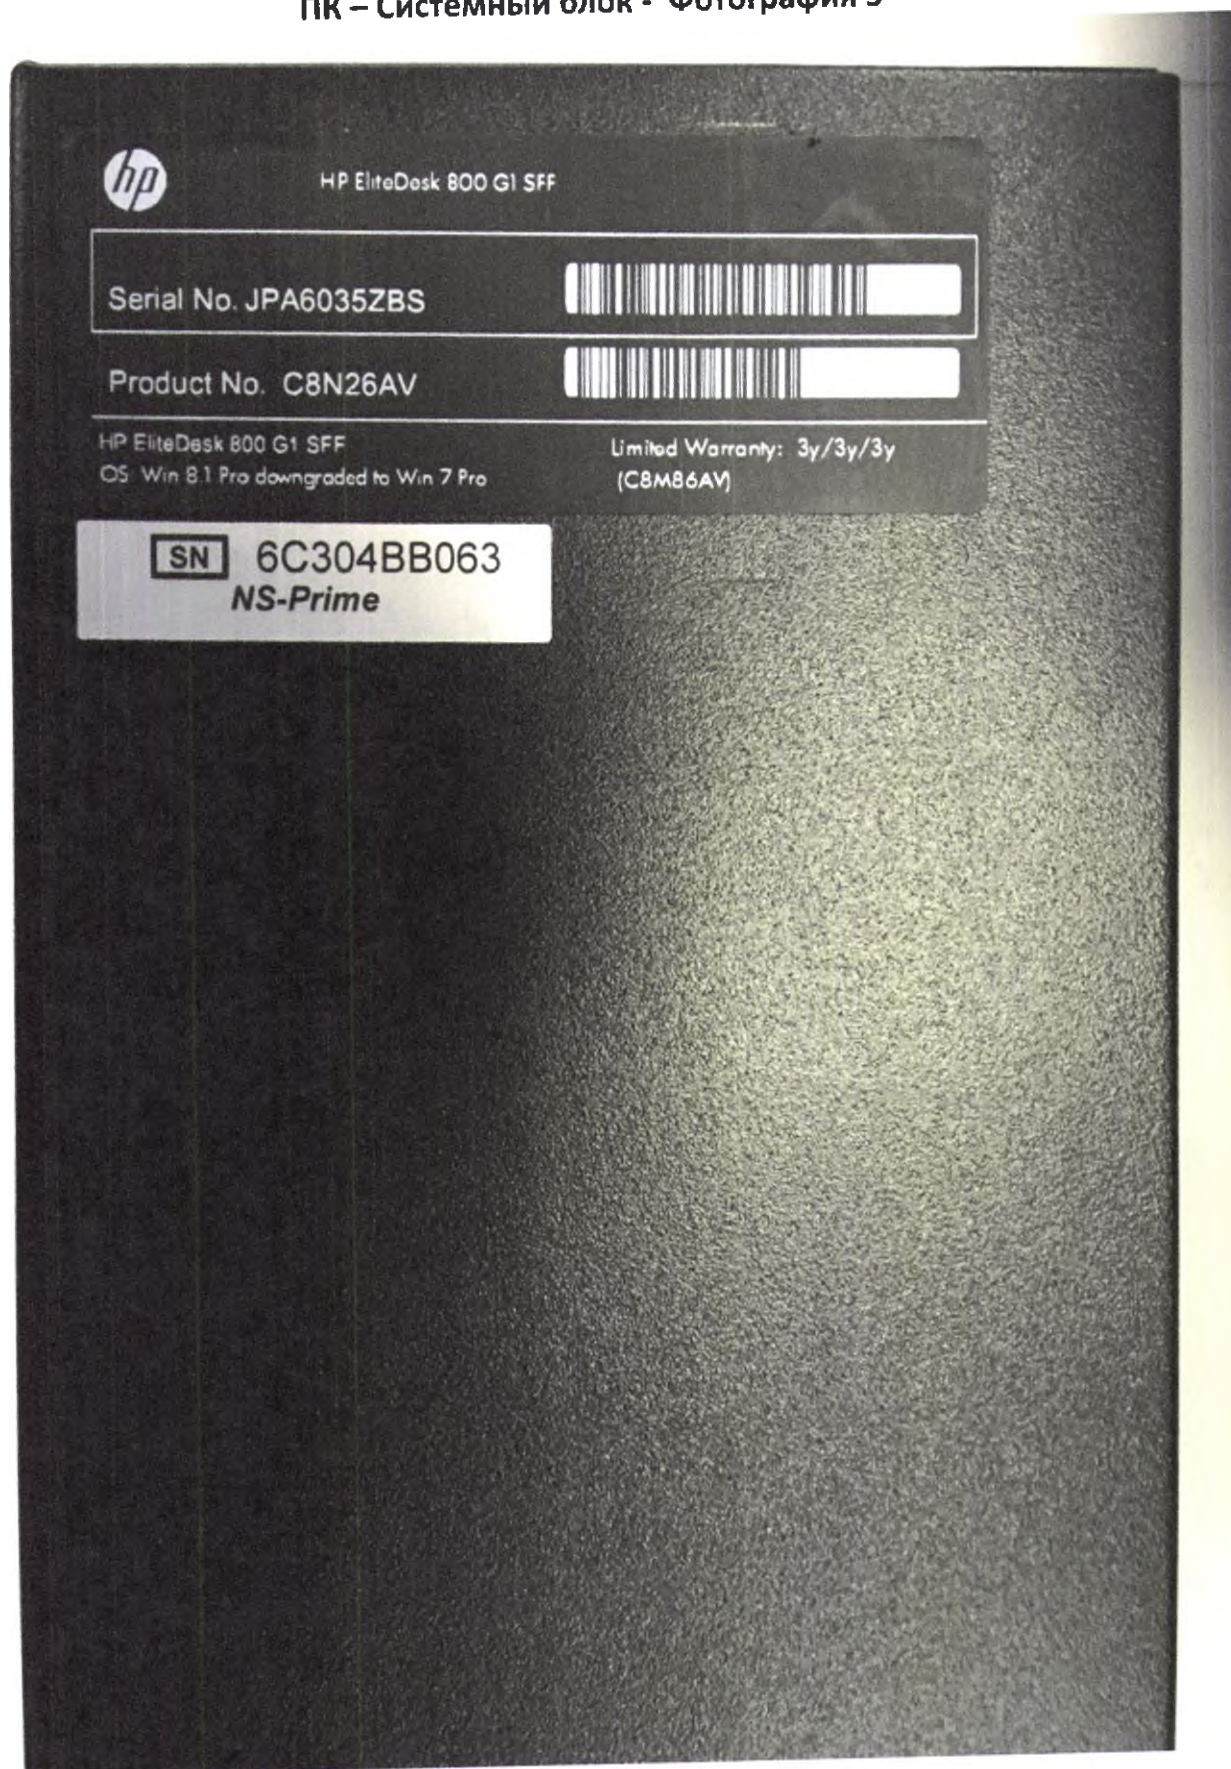


ПК – Системный блок - Фотография 4

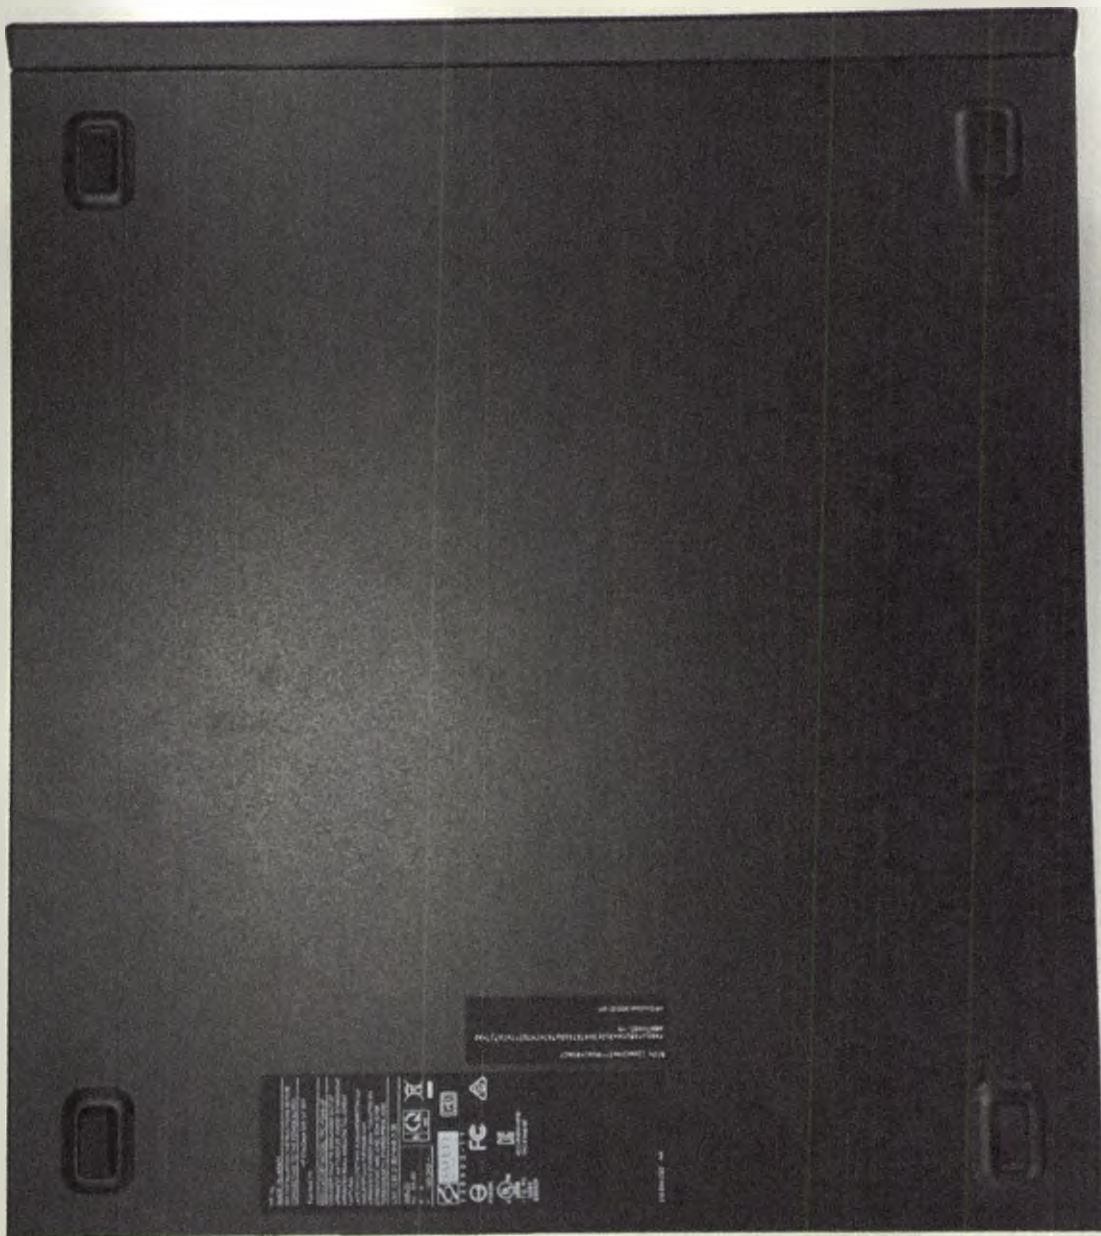





ПК - Монитор - Фотография 2 – Вид сзади

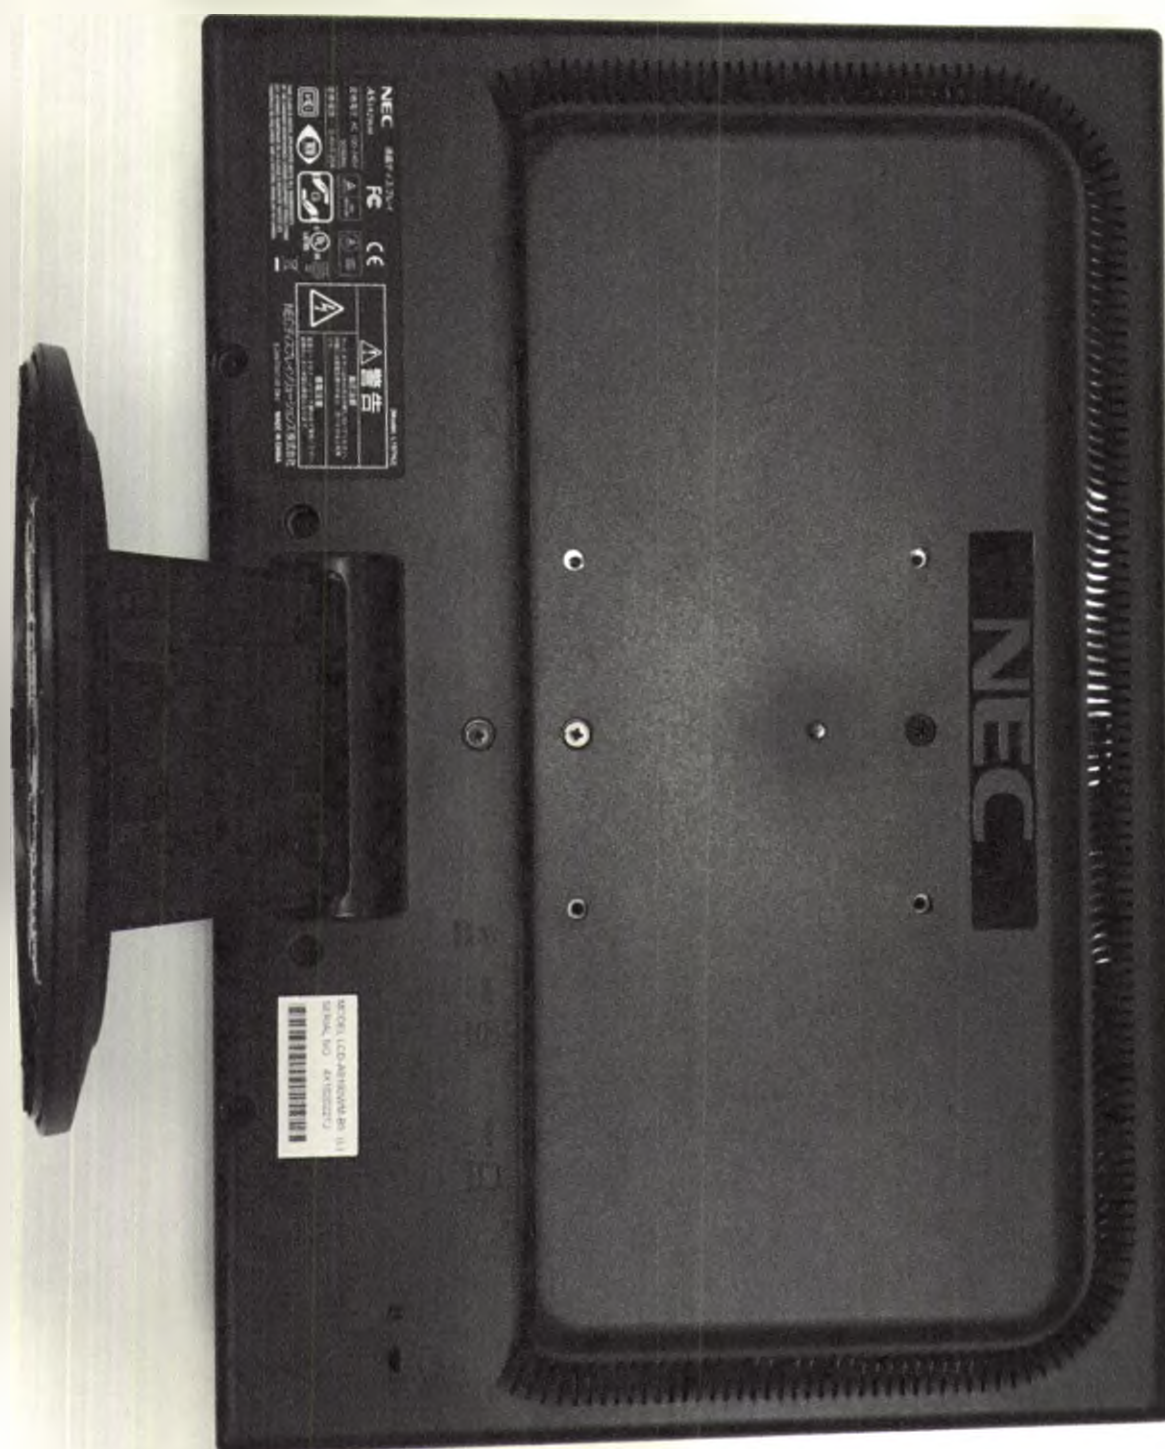



MODEL: LCD-AS192WM-B5 (L)
SERIAL NO.: 4X102022TJ






ПК - Клавиатура - Фотография 1



ПК - Клавиатура - Фотография 2 – Вид сзади

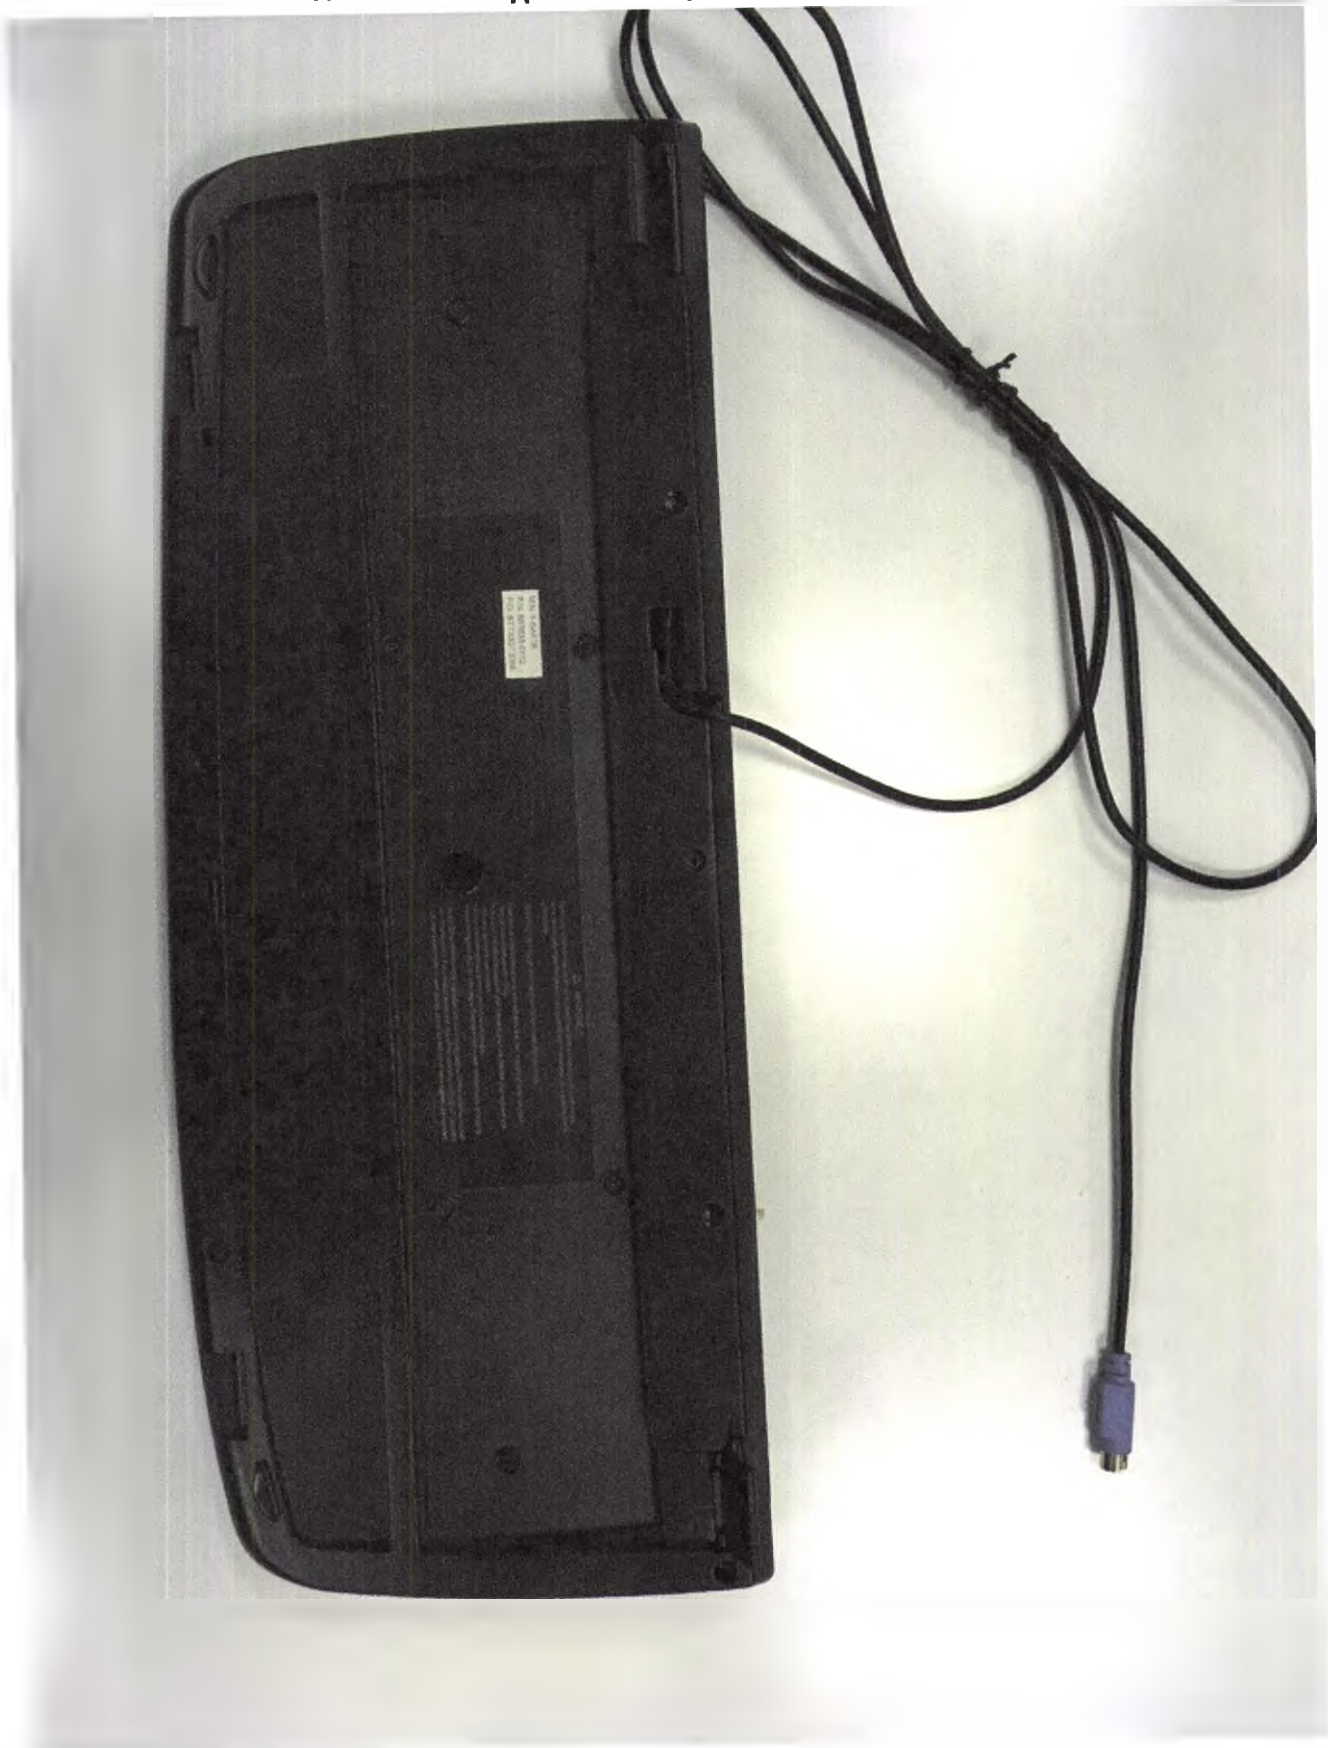




WARNING !


Some experts believe that use of any keyboard may cause serious injury to hands, wrists, arms, neck or back. If you feel pain, numbness, weakness in these areas see a qualified health professional.

TO REDUCE THE RISKS OF SUCH INJURIES FOLLOW THESE PRECAUTIONS:

- Take frequent short breaks. Get up and walk around at least a couple of times every hour.
- Vary your tasks throughout the day.
- Keep your shoulders relaxed with your elbows at your side. Position your keyboard and mouse so you don't have to reach.
- Adjust your chair and keyboard so your wrists are straight.
- Avoid resting your wrists on sharp edges. If you use a wrist or palm rest don't use it while typing.

For additional information that may reduce your risk of injury read the Comfort Guidelines included with this keyboard. If you need an additional copy of the comfort guidelines call Logitech's Customer Support (refer to user's guide), or visit our web site at www.logitech.com/comfort

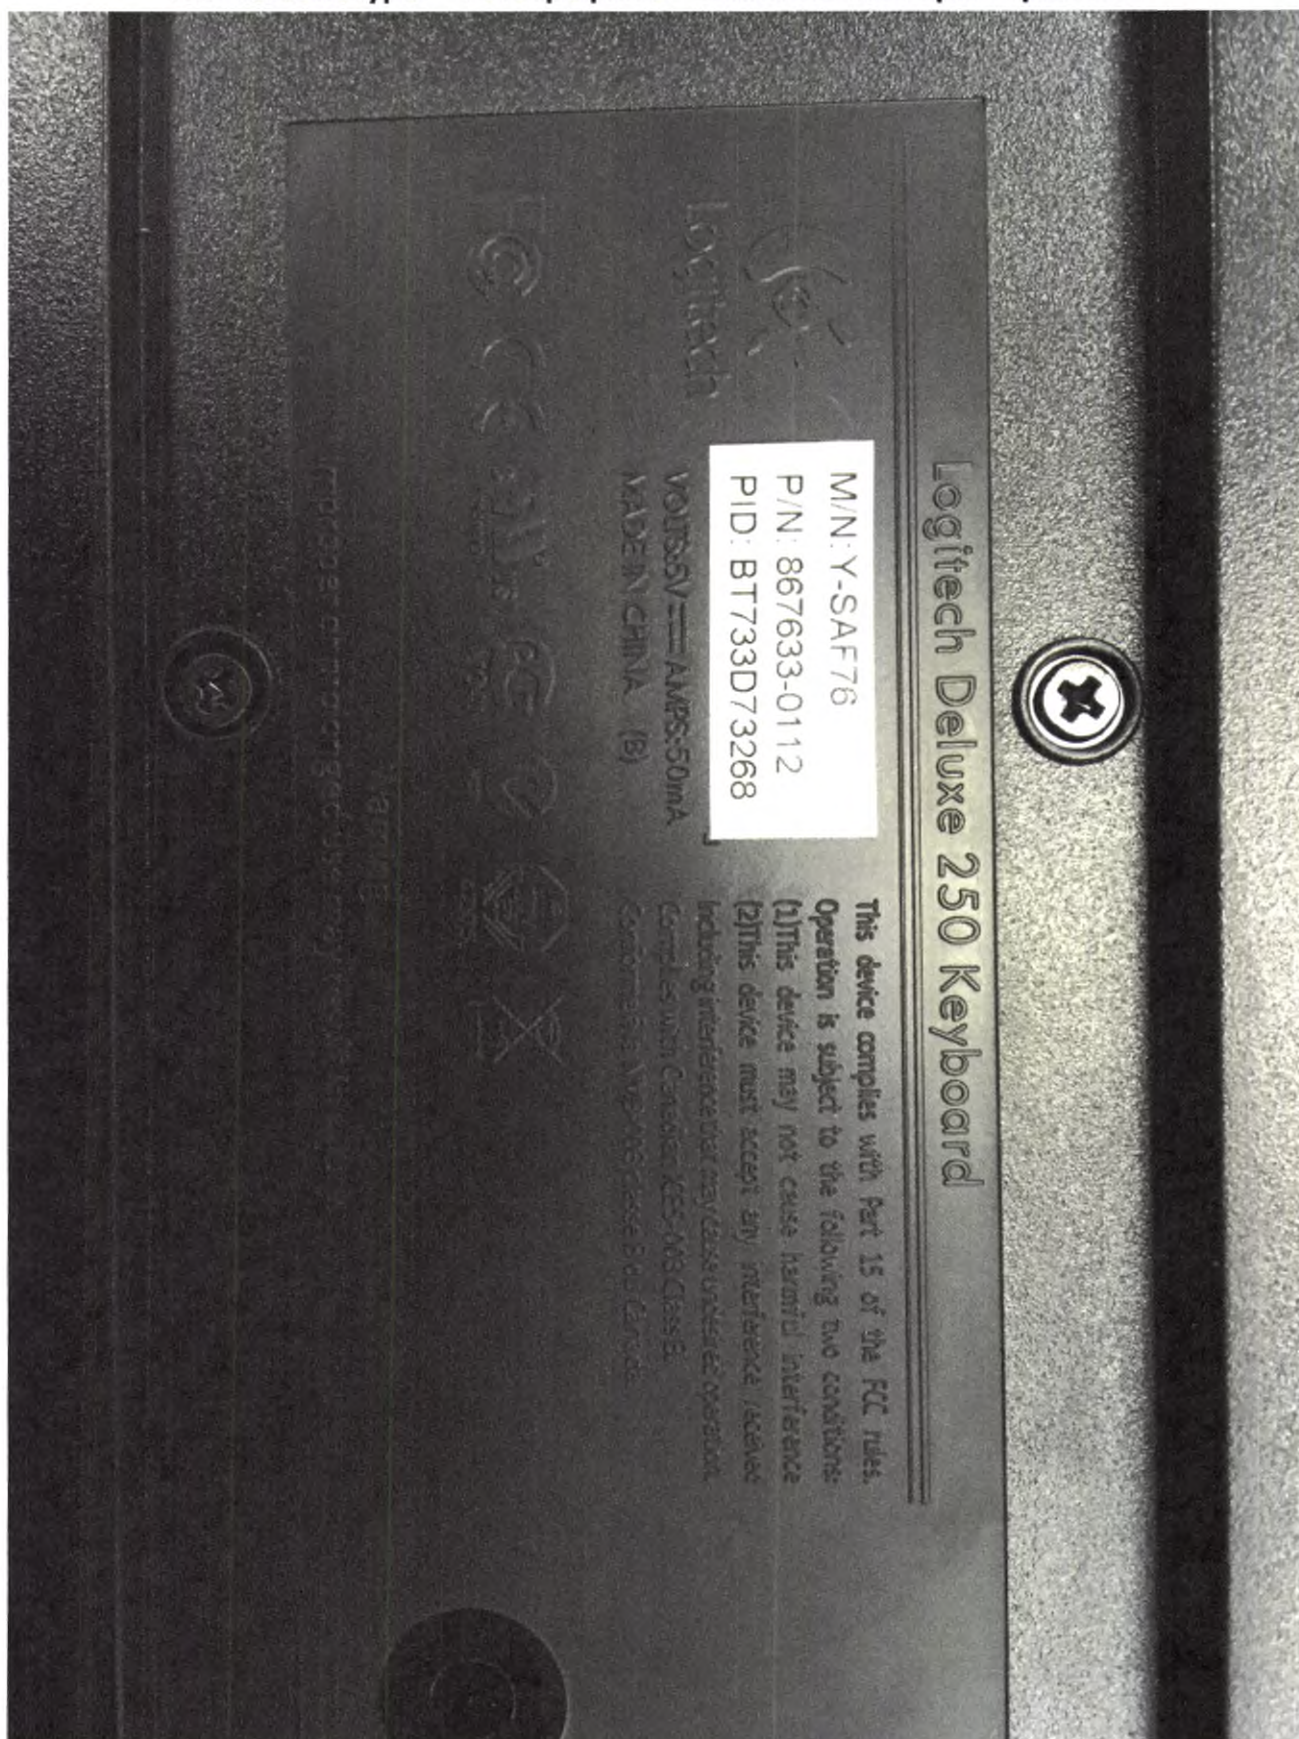

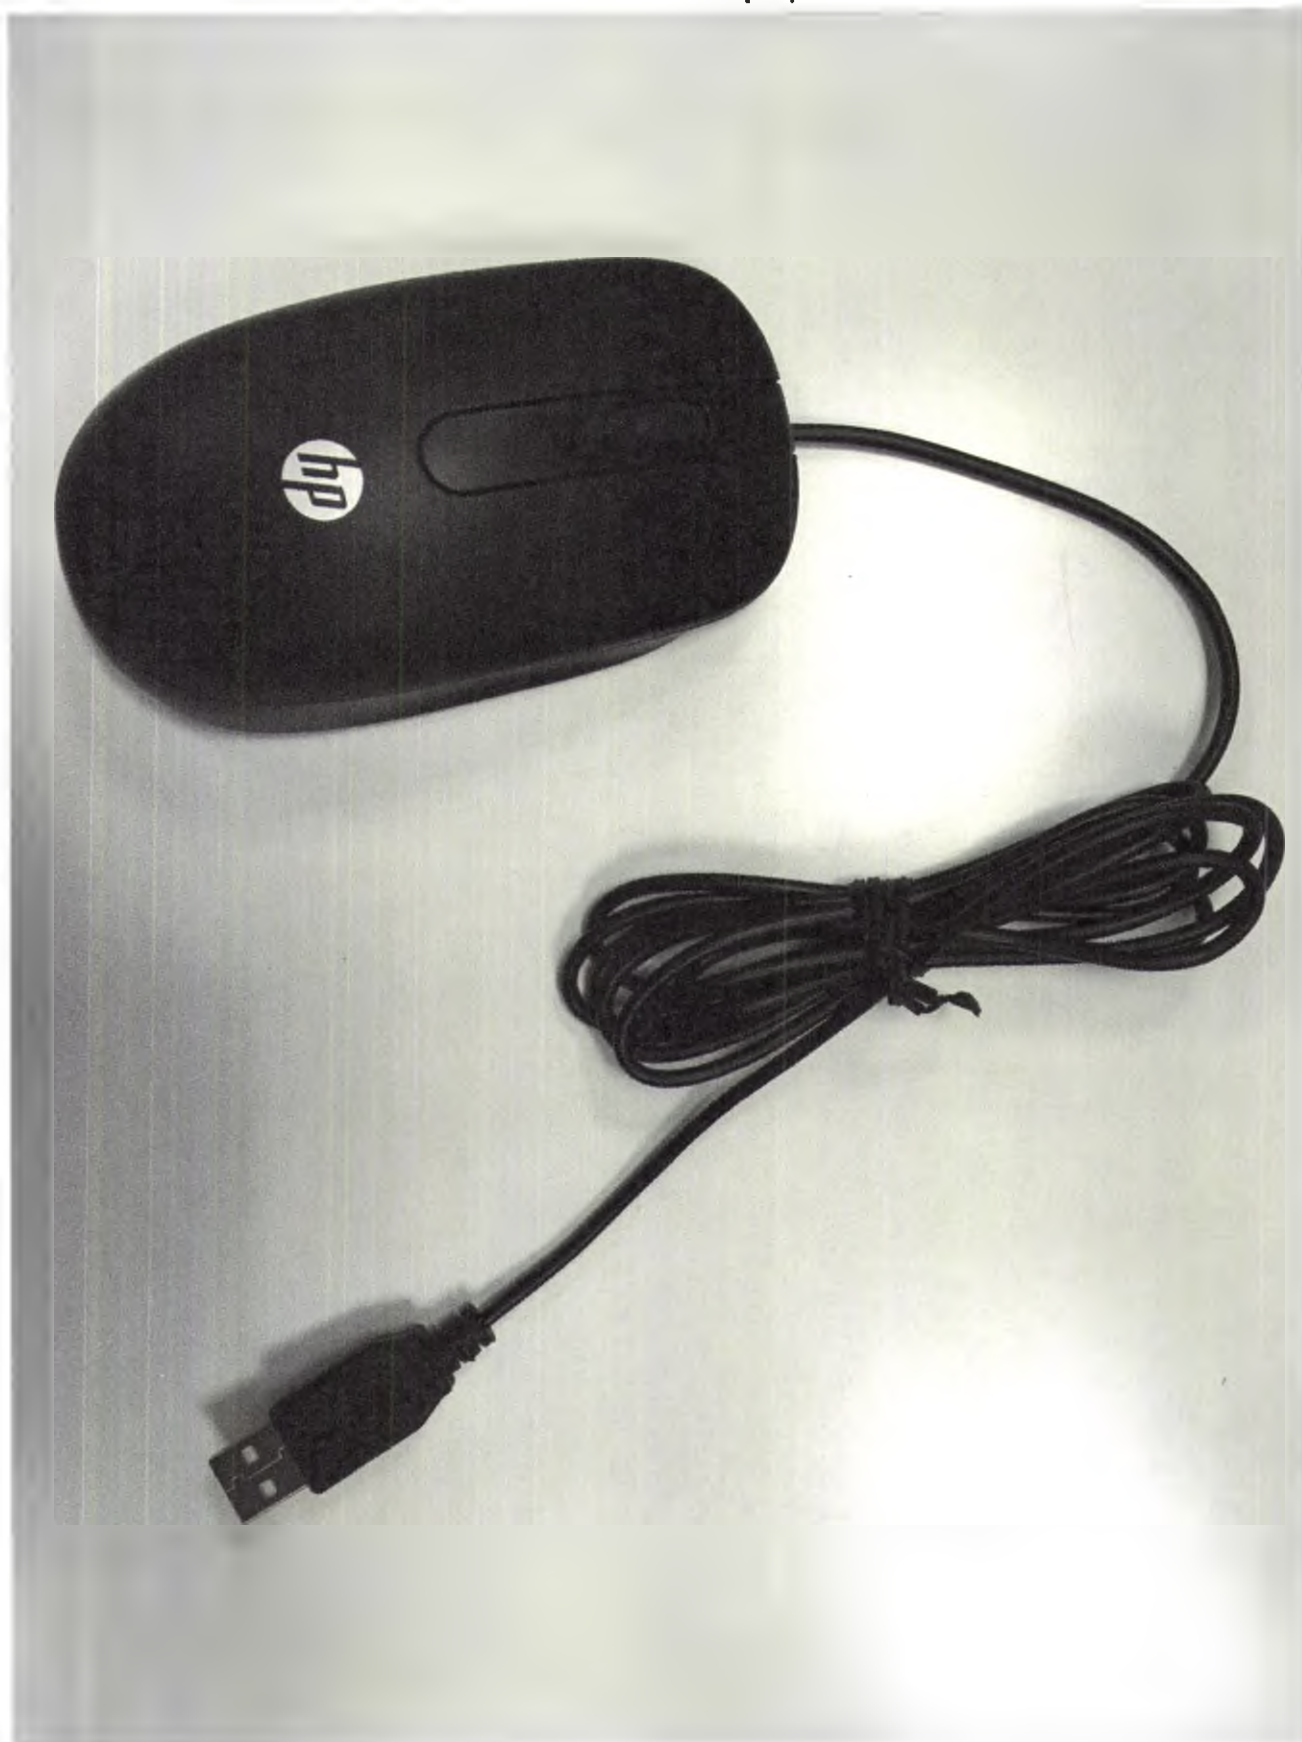


















Принадлежности – Зонд для очистки дозирующих игл

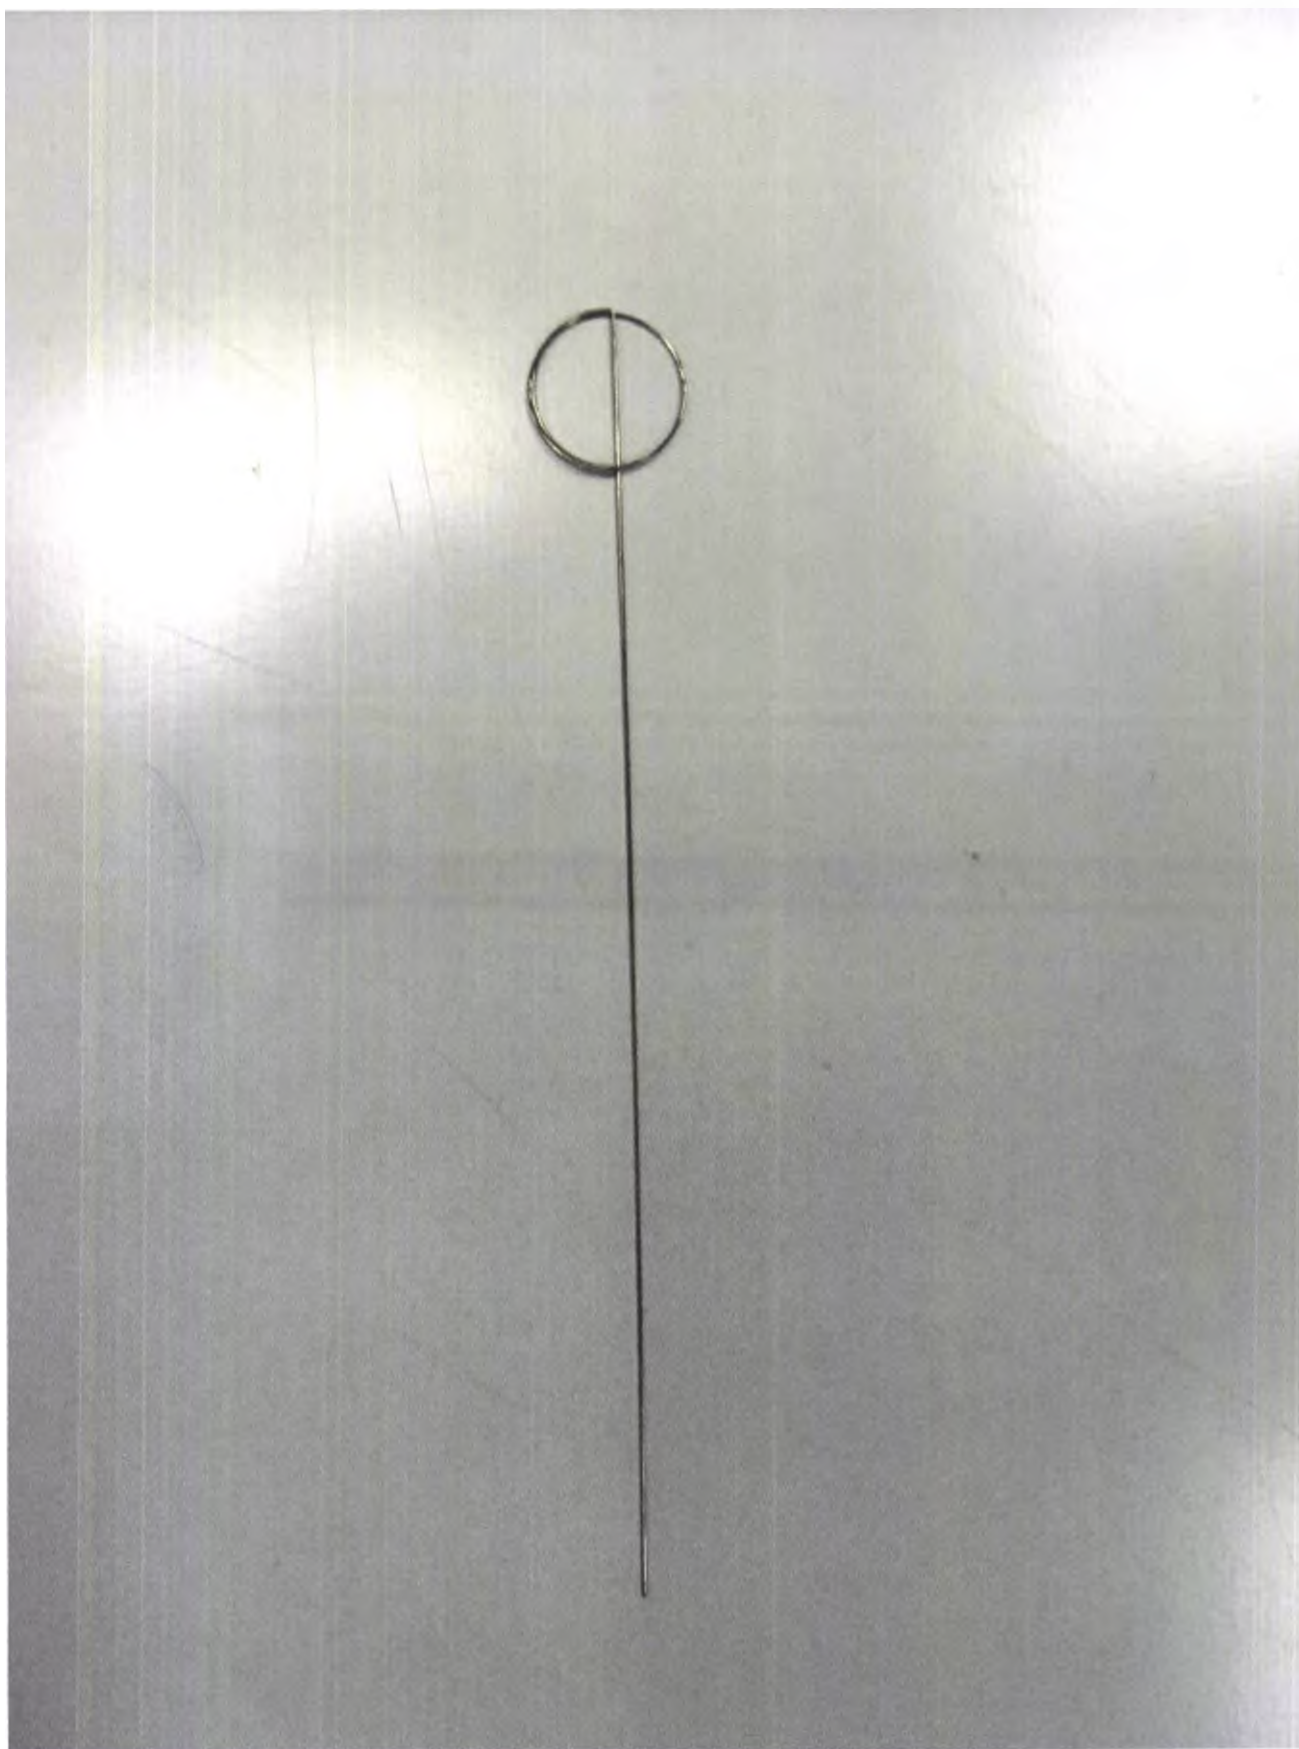

Прошито пронумеровано

108 (с.с. А. О. О. Р. Е.)

листа(ов)

Генеральный директор

ООО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»

Воновалов С.А.

