

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по
научно-производственной
деятельности Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центр стратегического
планирования и управления медико-
биологическими рисками здоровью»
Федерального медико-биологического
агентства (ФГБУ «ЦСП» ФМБА
России)




Г.А. Шипулин

2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК вируса кори
(*Measles morbillivirus*) в биологическом материале
методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

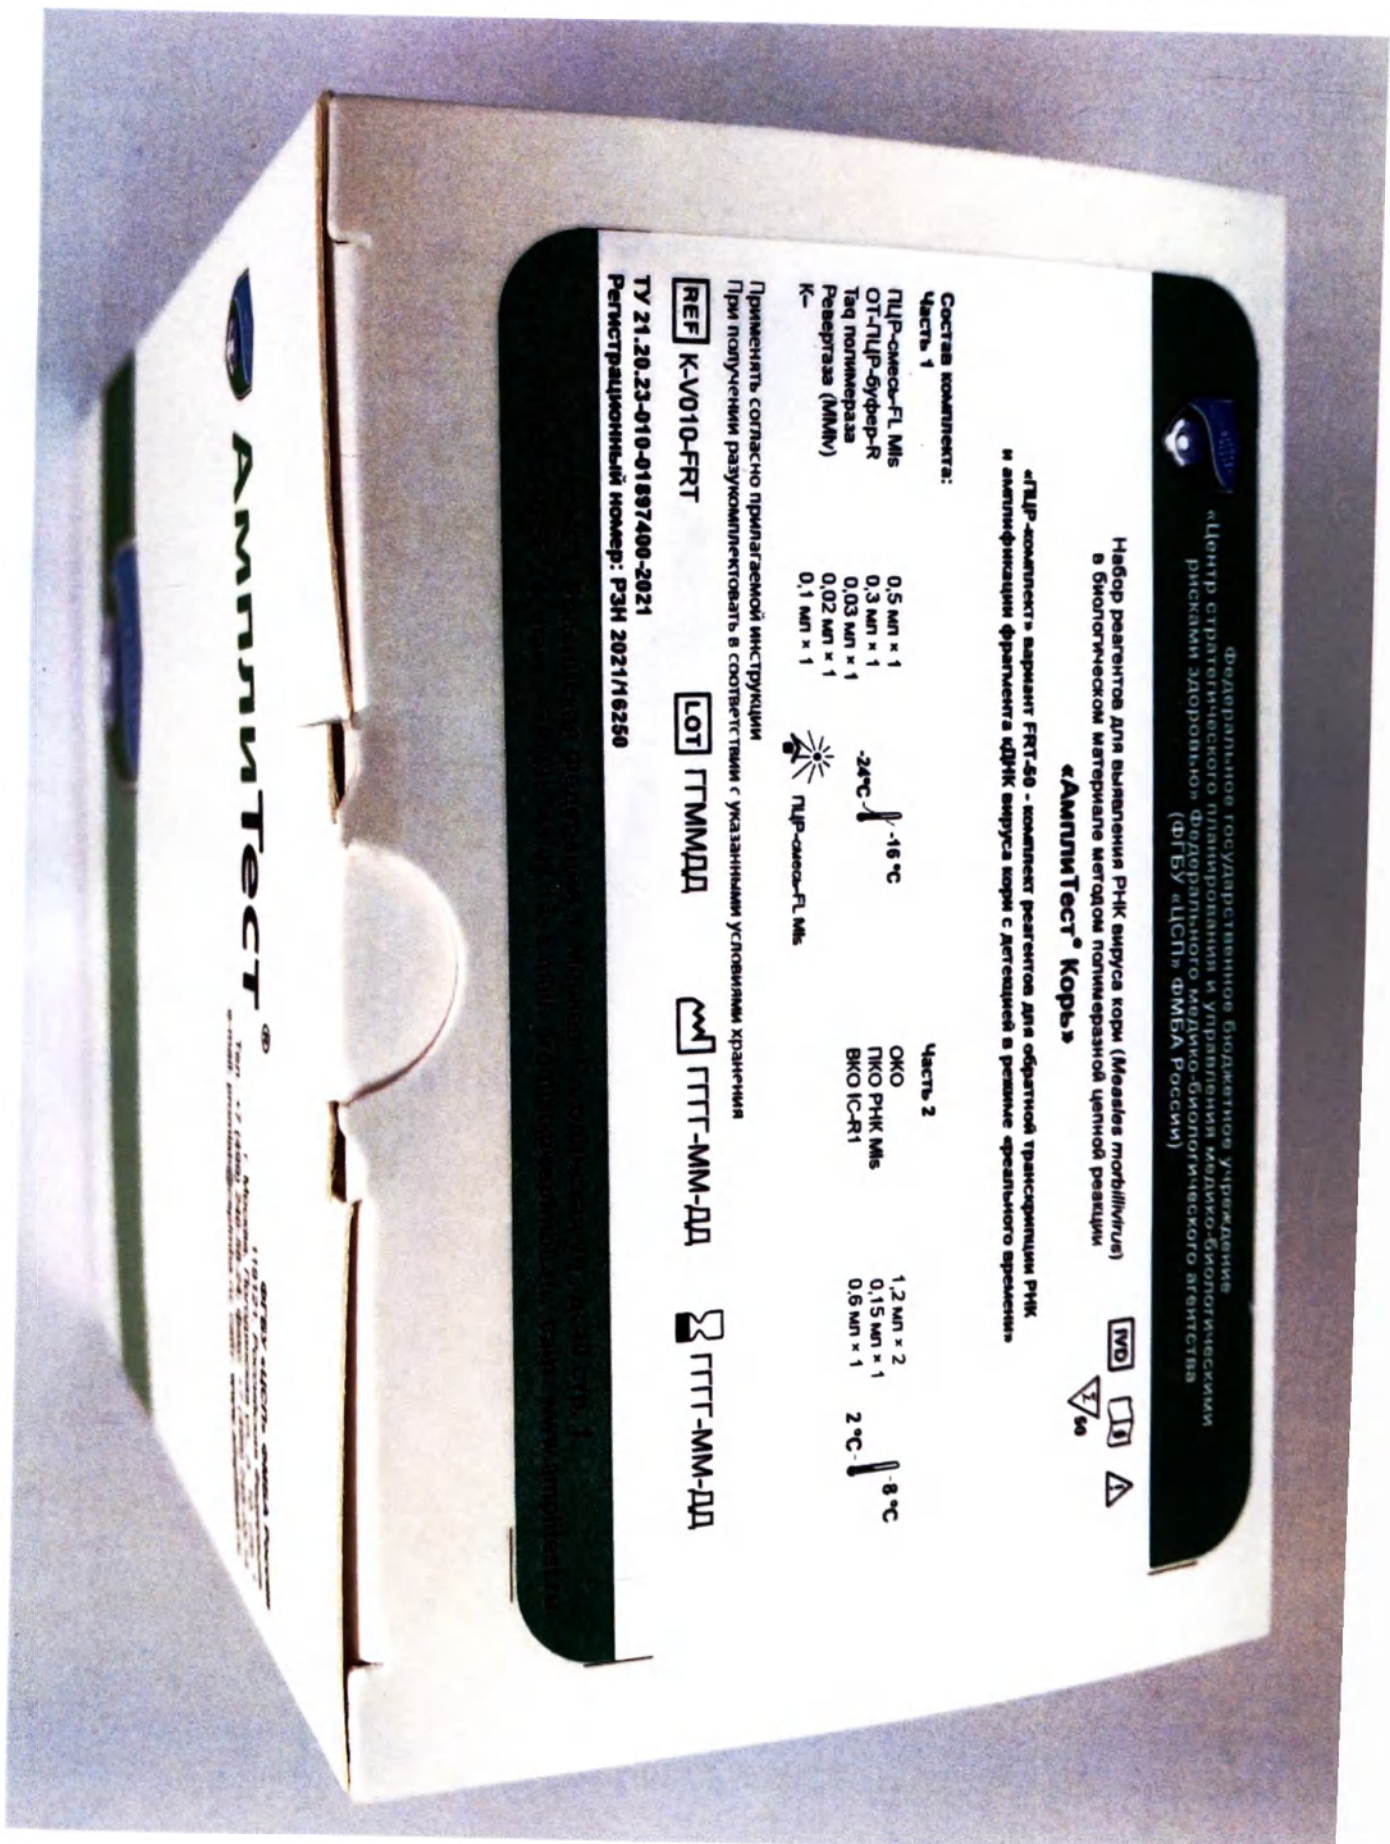

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровья» федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (Measles morbillivirus)
в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест® Корь»

«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 - комплект реагентов для обратной транскрипции РНК
и амплификации фрагмента генома вируса кори с детекцией в режиме реального времени



Состав комплекта:

Часть 1
ПЦР-смесь-FL MIs 0,5 мл × 1
ОТ-ПЦР-буфер-R 0,3 мл × 1
Тад полимеразы 0,03 мл × 1
Рвертаза (MMLV) 0,02 мл × 1
К- 0,1 мл × 1

-24°C -16°C
ПЦР-смесь-FL MIs

Часть 2
ОКО 1,2 мл × 2
ПКО РНК MIs 0,15 мл × 1
ВКО IC-R1 0,6 мл × 1

2°C -8°C

Применять согласно прилагаемой инструкции
При получении разукрупненного в соответствии с условиями хранения

REF K-V010-FRT

LOT ГТММД

ГТТ-ММ-ДД

ГТТ-ММ-ДД

ТУ 21.20.23-010-01897400-2021

Регистрационный номер: РЗН 2021/16250

АмплиТест®

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
г. Москва, ул. Савицкого, д. 1
Тел: +7 (495) 709-11-11
E-mail: info@cirmi.ru
www.goszdravnadzor.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
набора реагентов для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале методом полимеразной
цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

LOT ПТММДД ПТТТ-ММ-ДД
ПТТТ-ММ-ДД

REF K-V010-FRT
«АмплиТест® Корь»
для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале
методом полимеразной цепной реакции

Краткое руководство
Набор реагентов
для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале
методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
ВКЛАДЫШ
к набору реагентов «АмплиТест® Корь»
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50
REF K-V002-FRT
LOT ПТММДД

Настройка для прибора водородного типа (Rotor-Gene Q)

Канал	Optimization / Run time	Dynamic mode / Sensitivity	Block Contact / Unblock	Transfer / Rotor	Max Setting / Rotor position / Rotor speed
FLUO-Opt	97.5-10.0	экспоненциальная	экспоненциальная	экспоненциальная	0.05
DOE/Gen	97.2-10.0	экспоненциальная	экспоненциальная	экспоненциальная	0.05

Объем реакционной смеси – 25 мкл

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинский район, д. 10 стр. 1
т. +7 (495) 246-58-24, факс: +7 (495) 246-03-14
e-mail: info@amplitest.ru, сайт: www.amplitest.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

Часть 1 из 2
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состав комплекта (часть 1):
ПЦР-смазка (1 мкл) 0.5 мл x 1
Олигодезоксирибонуклеотиды (1 мкл) 0.03 мл x 1
Термостабильный ДНК-полимеразный комплекс (1 мкл) 0.02 мл x 1
Буферный раствор (1 мкл) 0.1 мл x 1

REF K-V010-FRT

LOT ПТММДД ПТТТ-ММ-ДД ПТТТ-ММ-ДД

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинский район, д. 10 стр. 1
т. +7 (495) 246-58-24, факс: +7 (495) 246-03-14
e-mail: info@amplitest.ru, сайт: www.amplitest.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

Часть 2 из 2
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состав комплекта (часть 2):
Олигодезоксирибонуклеотиды (1 мкл) 0.03 мл x 2
Термостабильный ДНК-полимеразный комплекс (1 мкл) 0.15 мл x 1
Буферный раствор (1 мкл) 0.6 мл x 1

REF K-V010-FRT

LOT ПТММДД ПТТТ-ММ-ДД ПТТТ-ММ-ДД

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинский район, д. 10 стр. 1
т. +7 (495) 246-58-24, факс: +7 (495) 246-03-14
e-mail: info@amplitest.ru, сайт: www.amplitest.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

Часть 2 из 2
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состав комплекта (часть 2):
Олигодезоксирибонуклеотиды (1 мкл) 0.03 мл x 2
Термостабильный ДНК-полимеразный комплекс (1 мкл) 0.15 мл x 1
Буферный раствор (1 мкл) 0.6 мл x 1

REF K-V010-FRT

LOT ПТММДД ПТТТ-ММ-ДД ПТТТ-ММ-ДД

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинский район, д. 10 стр. 1
т. +7 (495) 246-58-24, факс: +7 (495) 246-03-14
e-mail: info@amplitest.ru, сайт: www.amplitest.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (Мен-
гера) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® Корь»

Часть 2 из 2
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состав комплекта (часть 2):
Олигодезоксирибонуклеотиды (1 мкл) 0.03 мл x 2
Термостабильный ДНК-полимеразный комплекс (1 мкл) 0.15 мл x 1
Буферный раствор (1 мкл) 0.6 мл x 1

REF K-V010-FRT

LOT ПТММДД ПТТТ-ММ-ДД ПТТТ-ММ-ДД



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@cspfmmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (*Measles morbillivirus*)
в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест® Корь»

Часть 1 из 2

«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состав комплекта (часть 1):

ПЦР-смесь-FL MIs	0,5 мл × 1
ОТ-ПЦР-буфер-R	0,3 мл × 1
Taq полимераза	0,03 мл × 1
Ревертаза (MMLV)	0,02 мл × 1
К-	0,1 мл × 1



-24°C -16°C



ПЦР-смесь-FL MIs

REF K-V010-FRT

LOT ГТММДД

ПТТ-ММ-ДД


ПТТ-ММ-ДД

ТУ 21.20.23-010-01897400-2021

Регистрационный номер: РЗН 2021/16250



Фотография реагентов набора «АмплиТест® Корь»
(часть 2 – хранение при температуре от 2 до 8 °С)

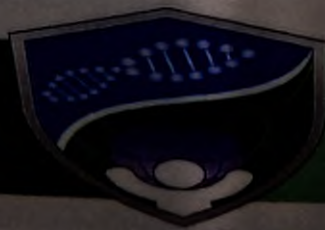

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@cspfmbaru.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса кори (*Measles morbillivirus*)
в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции


«АмплиТест® Корь»

Часть 2 из 2

«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состав комплекта (часть 2):

ОКО	1,2 мл × 2
ПКО РНК MIs	0,15 мл × 1
ВКО IC-R1	0,6 мл × 1



REF K-V010-FRT

LOT ГГММДД

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ТУ 21.20.23-010-01897400-2021

Регистрационный номер: РЗН 2021/16250




Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

5

лист

26

Зам. генерального директора по научно-
производственной деятельности ФГБУ «НЦП»
ФМБА России



Г.А. Шипулин

